

2016-05


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Synchro®-10

Neuro Guidewire with Hydrophilic Coating

Neuro Guidewire with Hydrophilic Coating. Neuro guia con recubrimiento hidrófilo. Guide neurovasculaire avec revêtement hydrophile. Neuro Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung. Fögguide neurologica con rivestimento idrofilo. Neuro-voerdraad met hydrofiele coating. Шлифт с гидрофильным покрытием. Neuroleidišis su hidrofilu beplėnyne. Neurovaskulární ovládací drát s hydrofilní vrstvou. Ties-Guia Neurologica con Recubrimiento Hidrofílico. Neuro leidi su hidrofilu beplėnyne. Neuro vezeldrót hidrofili bevonattal. Neurovaskulární vodič drát s hydrofilní vrstvou. Prowadnik neurologiczny z powłoką hydrofilową. Neuroleidišis su hidrofilu beplėnyne. 神经导管具有亲水涂层. 神经导管具有亲水涂层. Hydrofilik Kaptenli Neuro Kılavuz Tel.

Common (1)

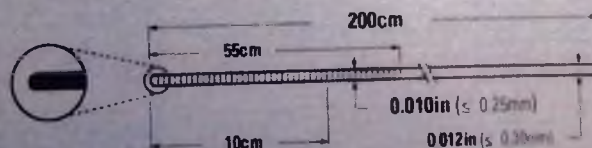

0.010in
x200cm

REF Catalog No. 1631

Use By 2016-07

Рис.2. Проводник внутрисосудистый Synchro. Вариант исполнения:Synchro-10, длиной 200 см.

2016-06

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

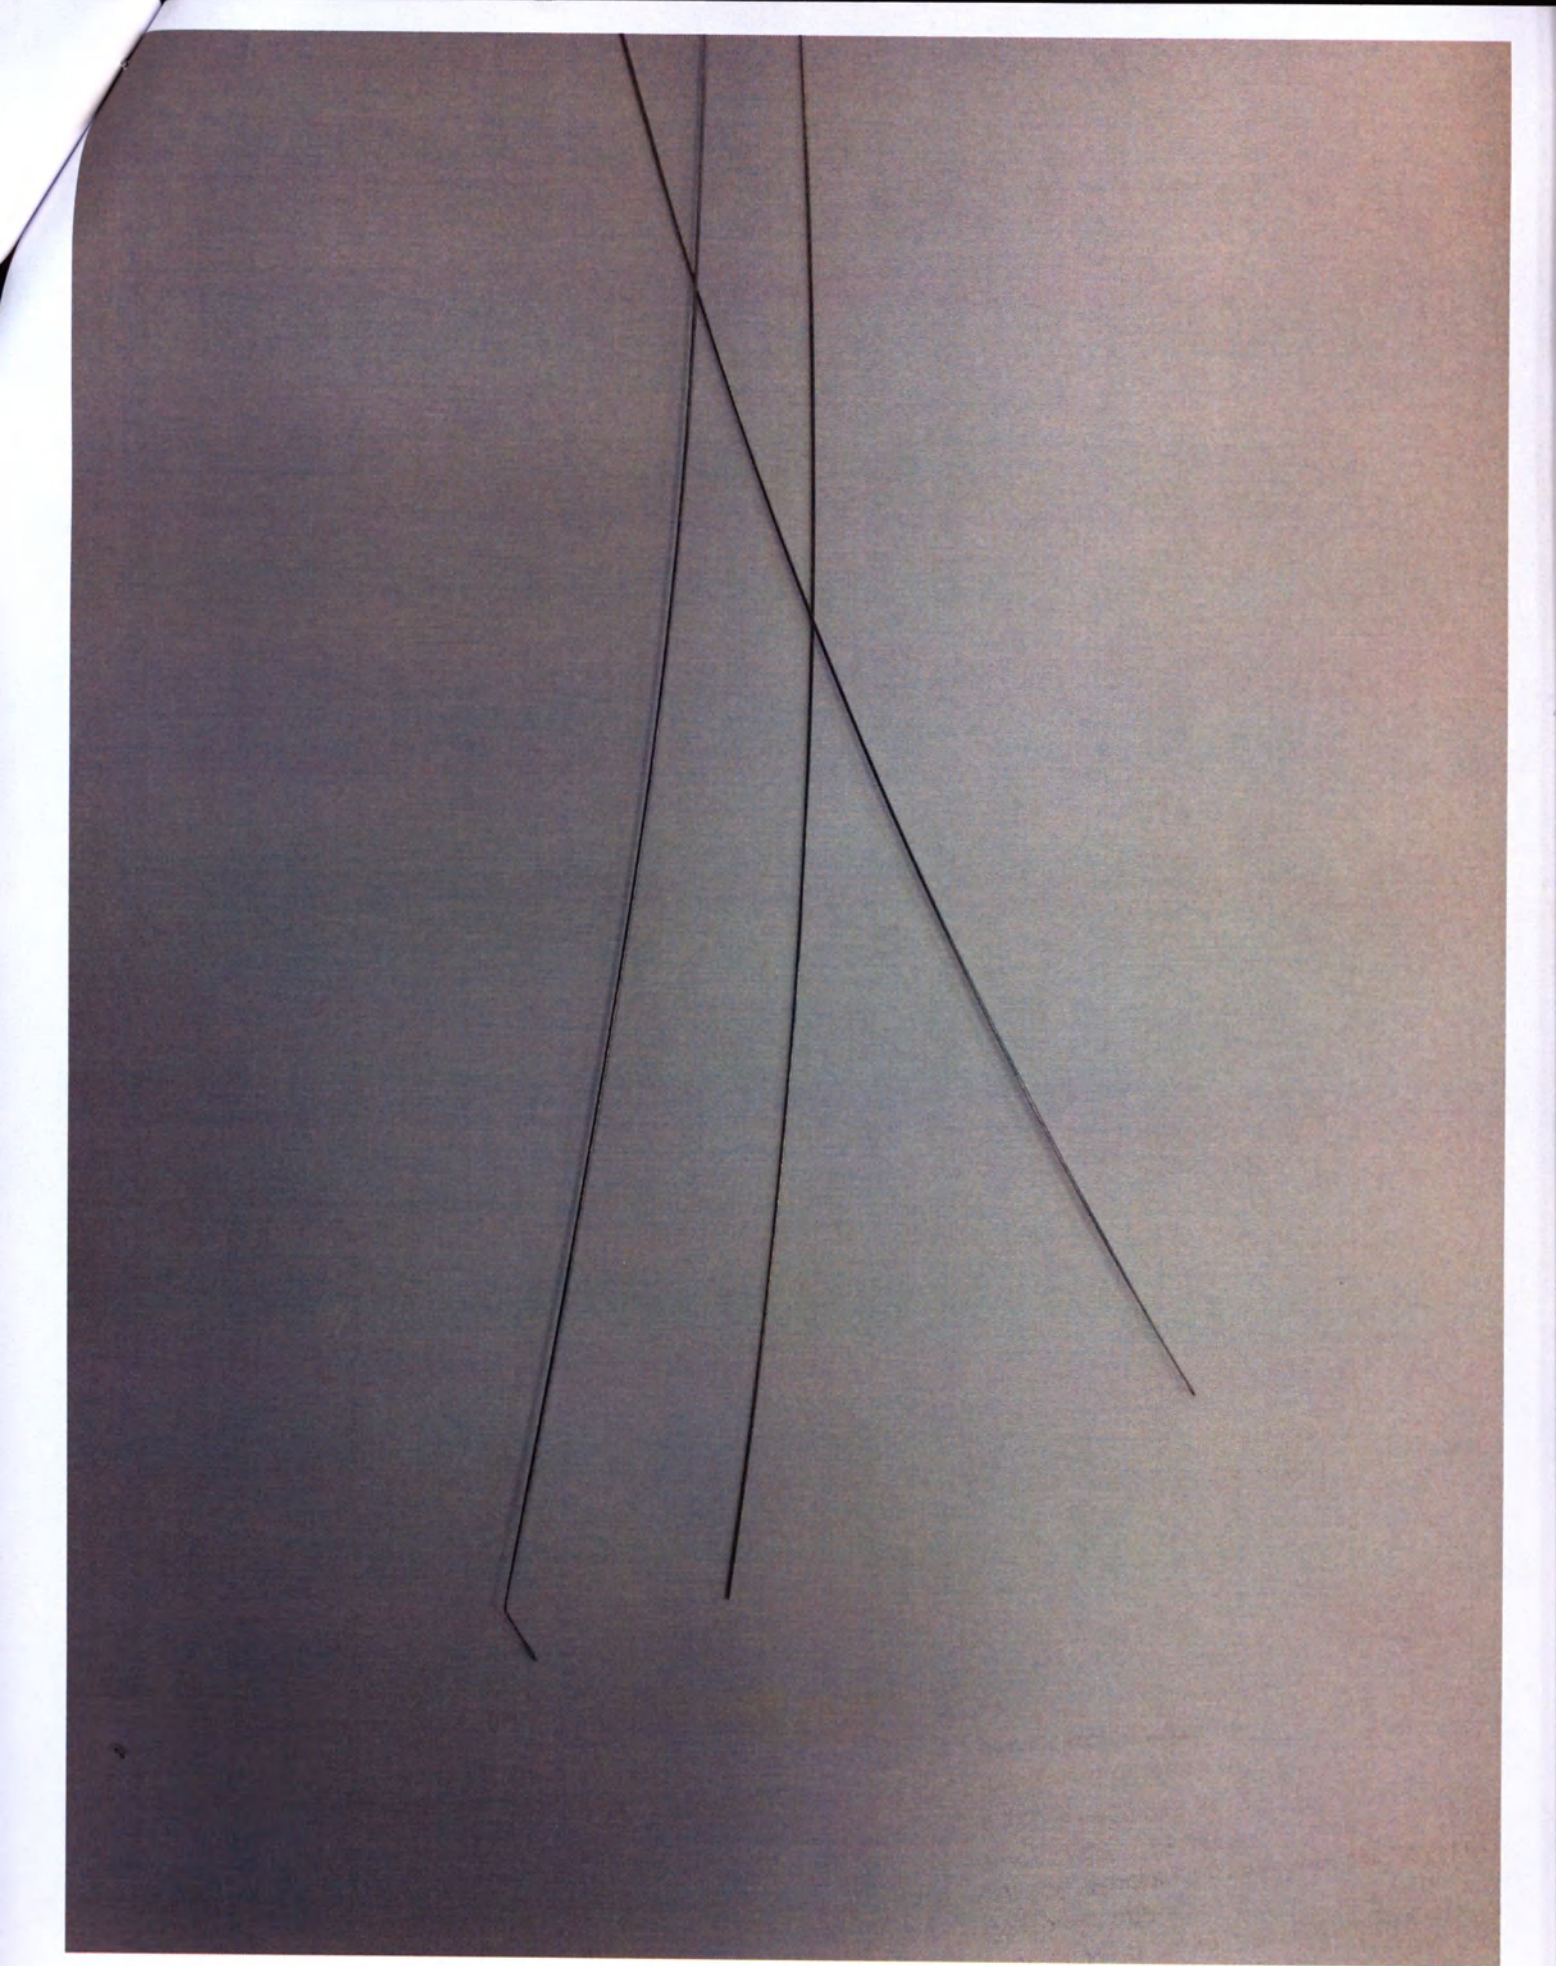


Рис. 4. Проводник внутрисосудистый Synchro. Варианты исполнения: Synchro², длиной 300 см, Synchro-10, длиной 200 см, Synchro-14, длиной 200 см. Без упаковки.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Кардиомедикс»

Меролаев А.А.