


Катетер баллонный Bakri Postpartum Balloon:
Вариант исполнения: J-SOS-100500

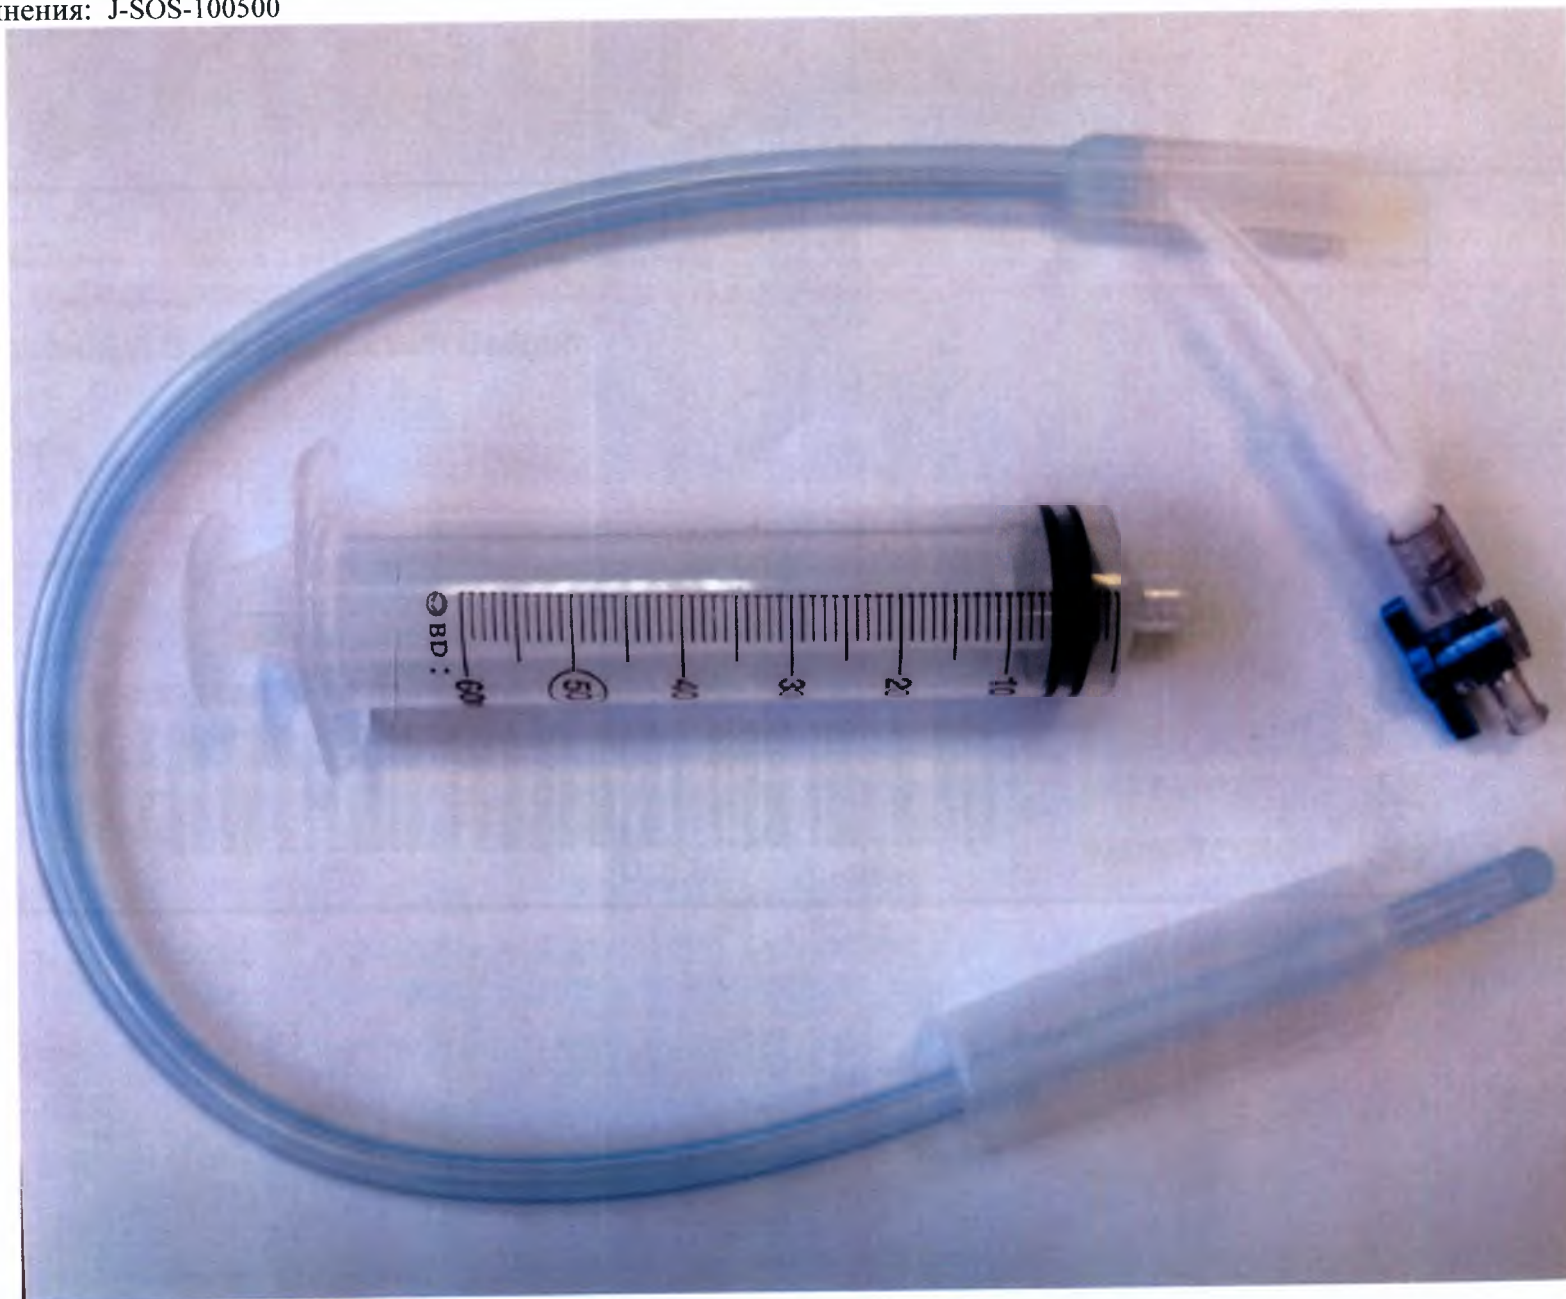

Макет маркировки:

J-SOS-100500

Катетер баллонный Bakri Postpartum Balloon

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



NON-TOXIC



Катетер баллонный Bakri Postpartum Balloon:
Вариант исполнения: J-SOSR-100500

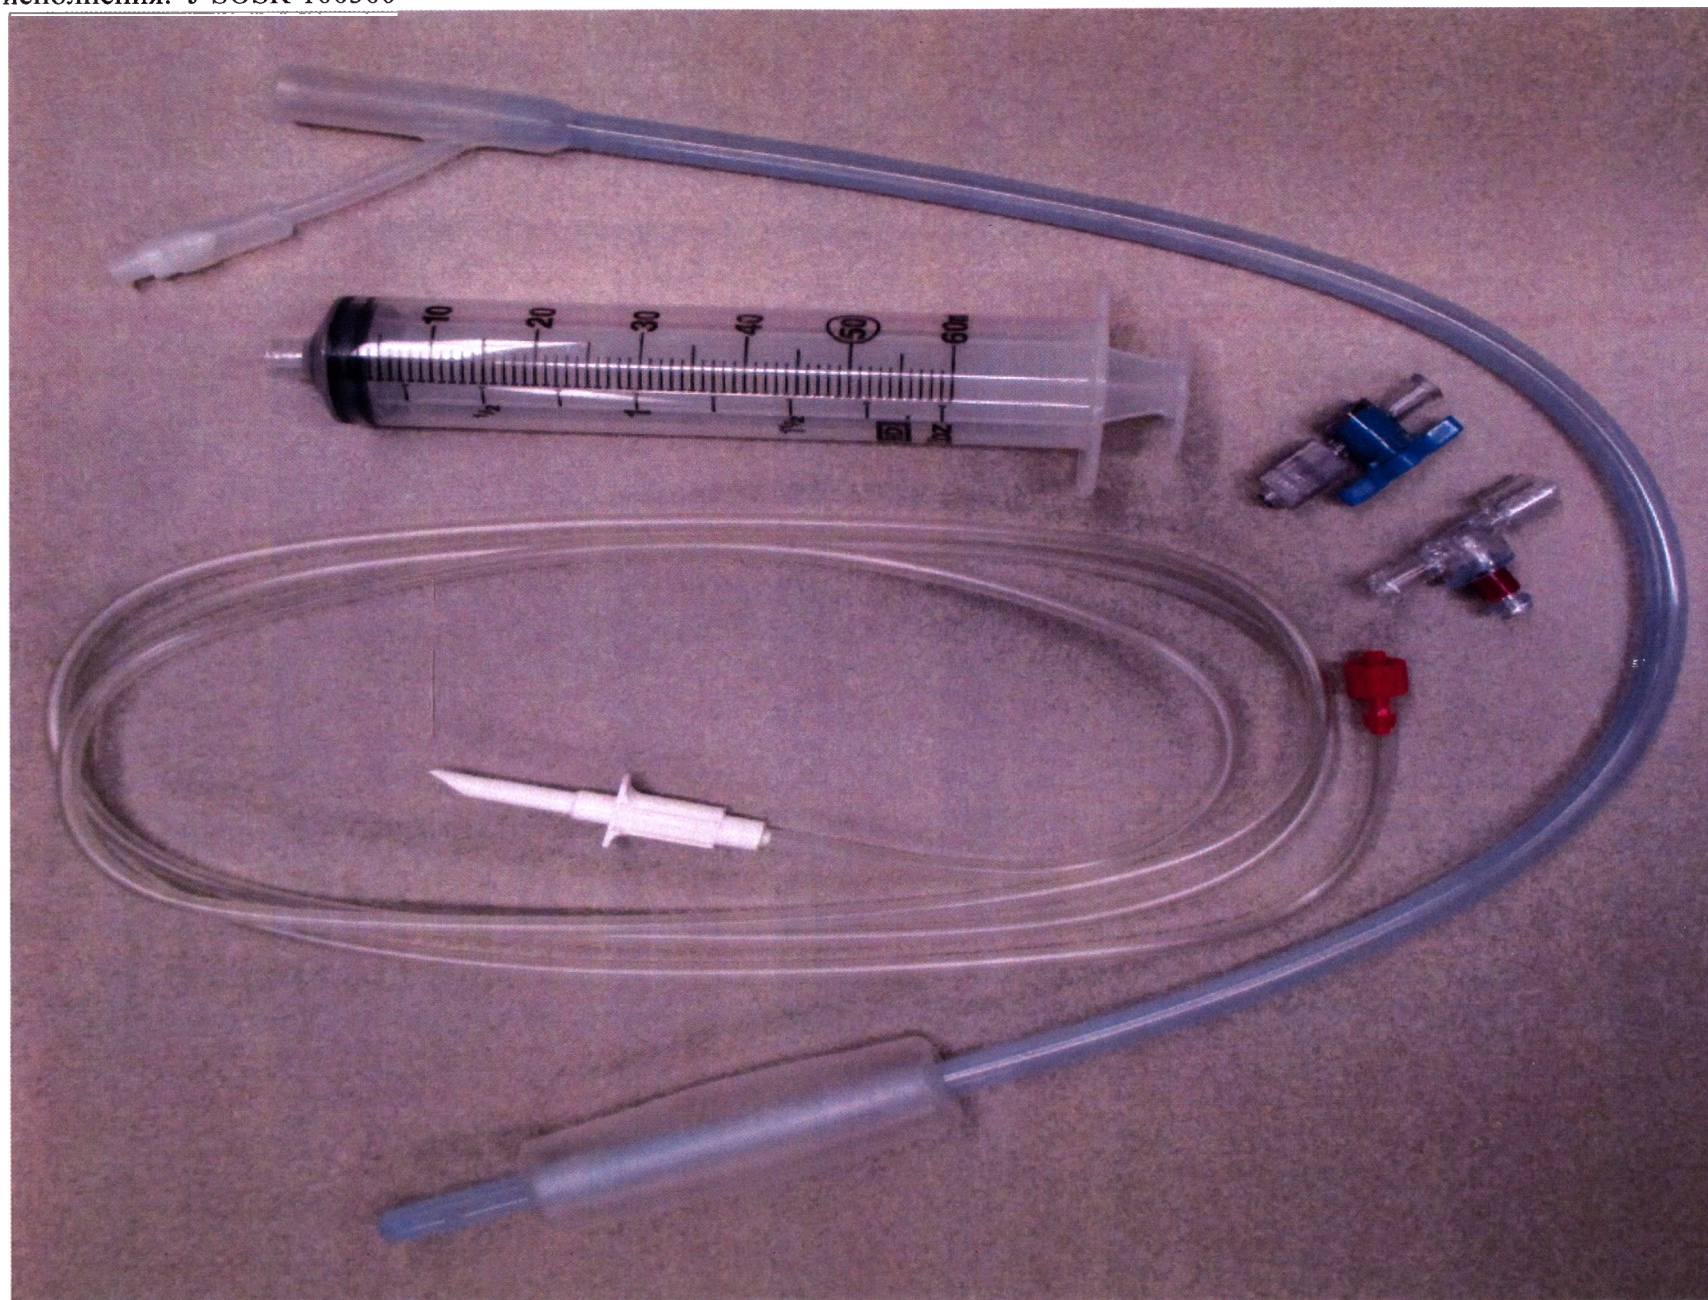

Макет маркировки:

J-SOSR-100500

Катетер баллонный Bakri Postpartum Balloon

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



NON-TOXIC



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов
Генеральный директор

