

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Чэнь Син

« 04 »


2018 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор биохимический автоматический в следующих исполнениях: BS-230, BS-240 с принадлежностями


I. Анализатор биохимический автоматический BS-230
Базовый состав:

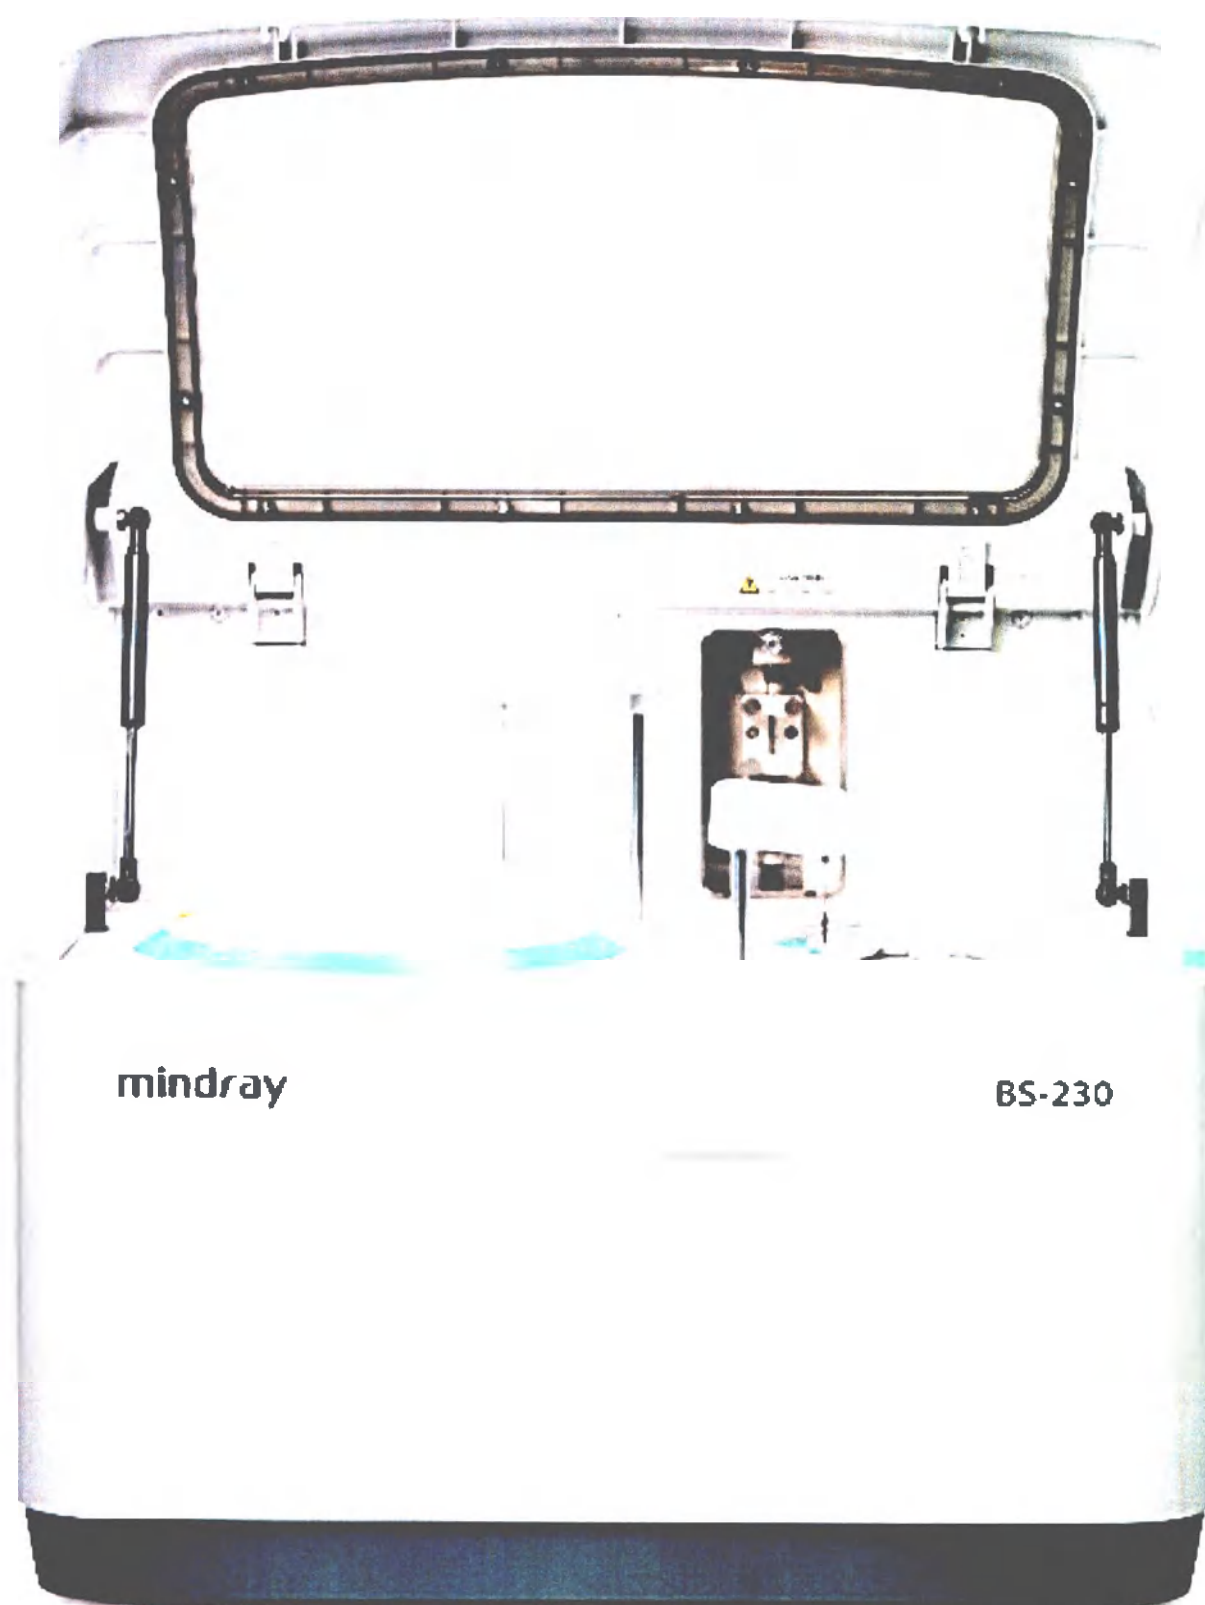

1. Анализатор BS-230

Анализатор
биохимический автоматический
BS-230

Руководство оператора

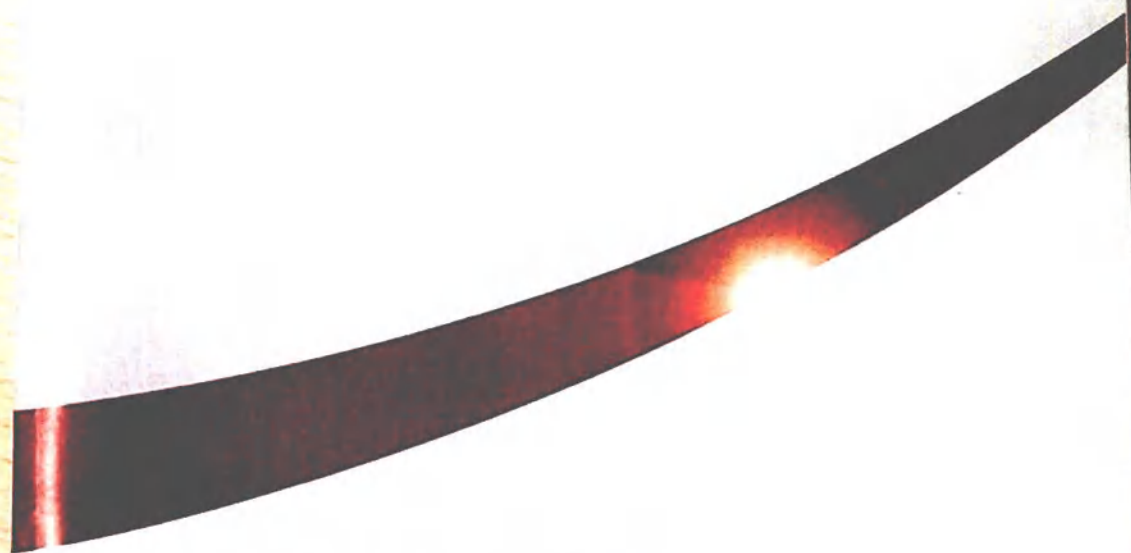

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)


8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray


2. Руководство оператора, не более 2 штук

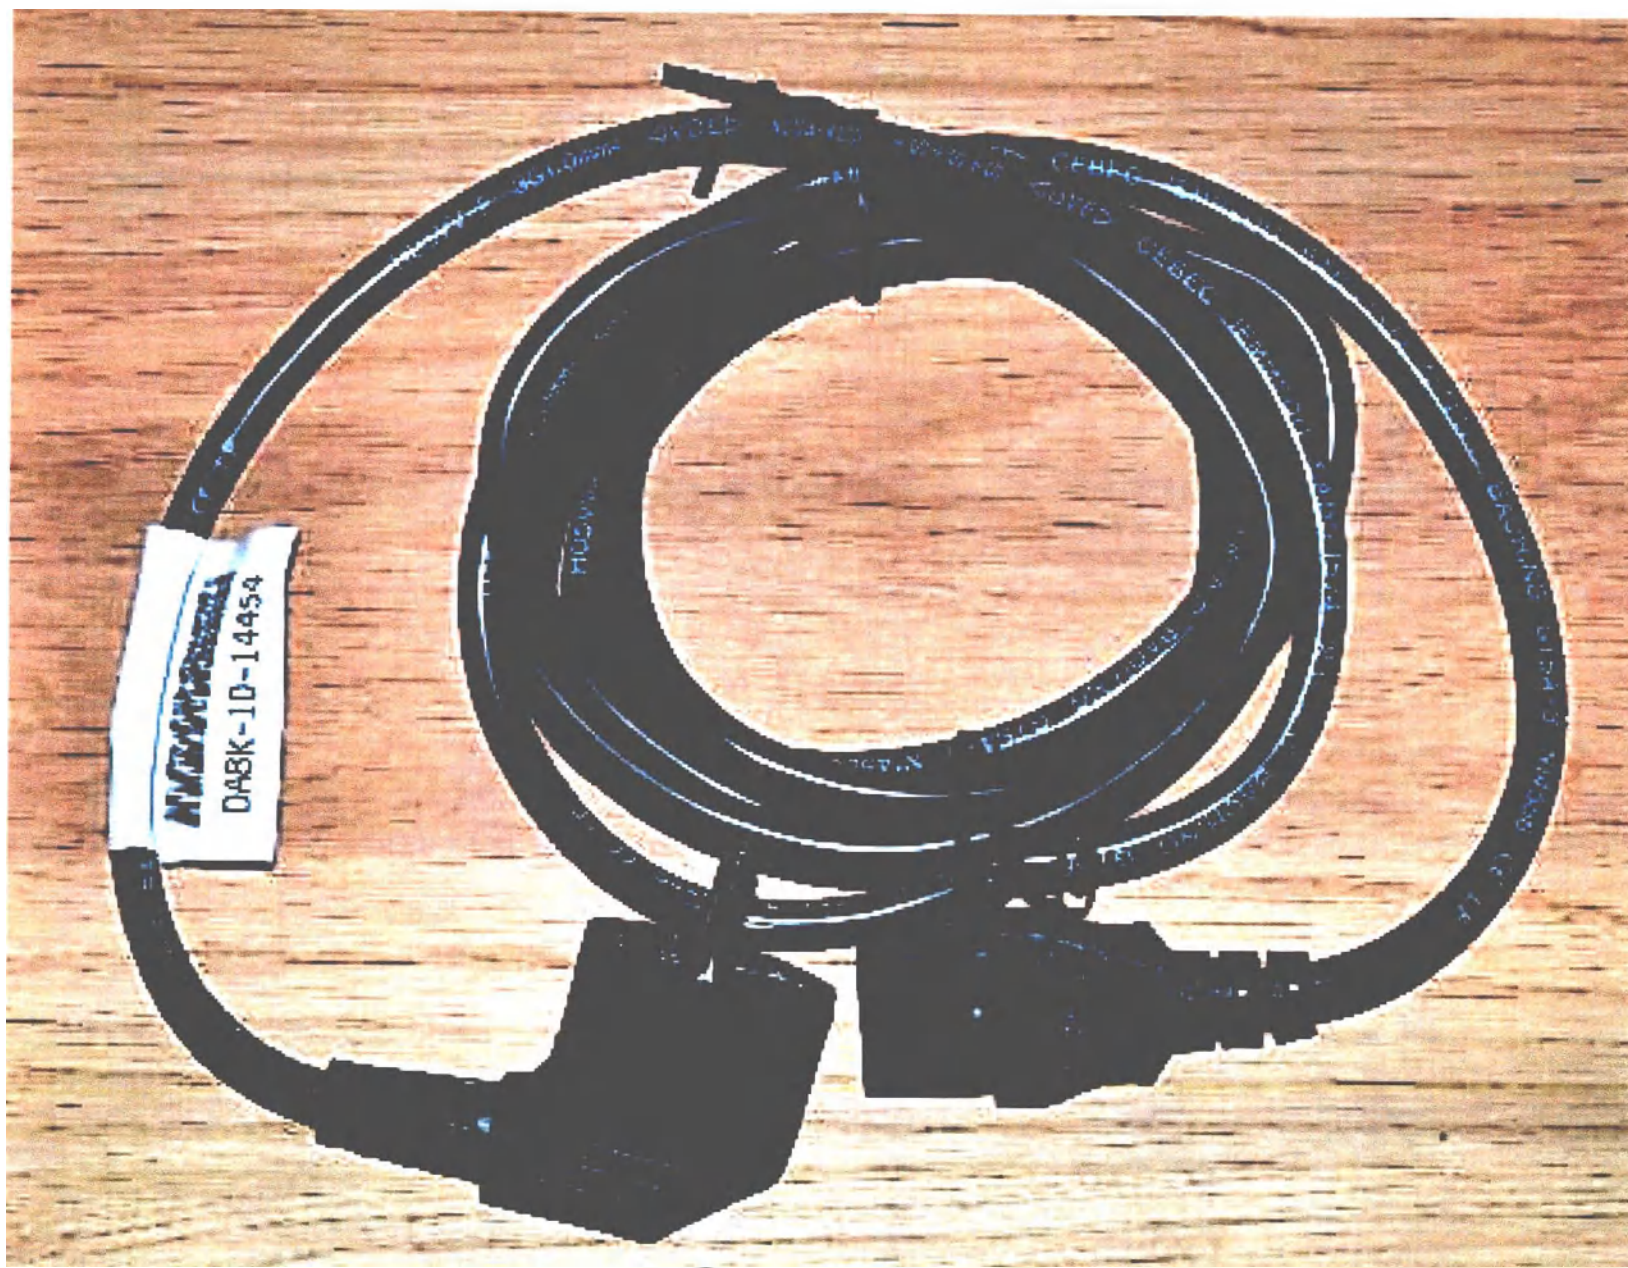

3. Кабель питания




5. Детергент CD80 (при необходимости)

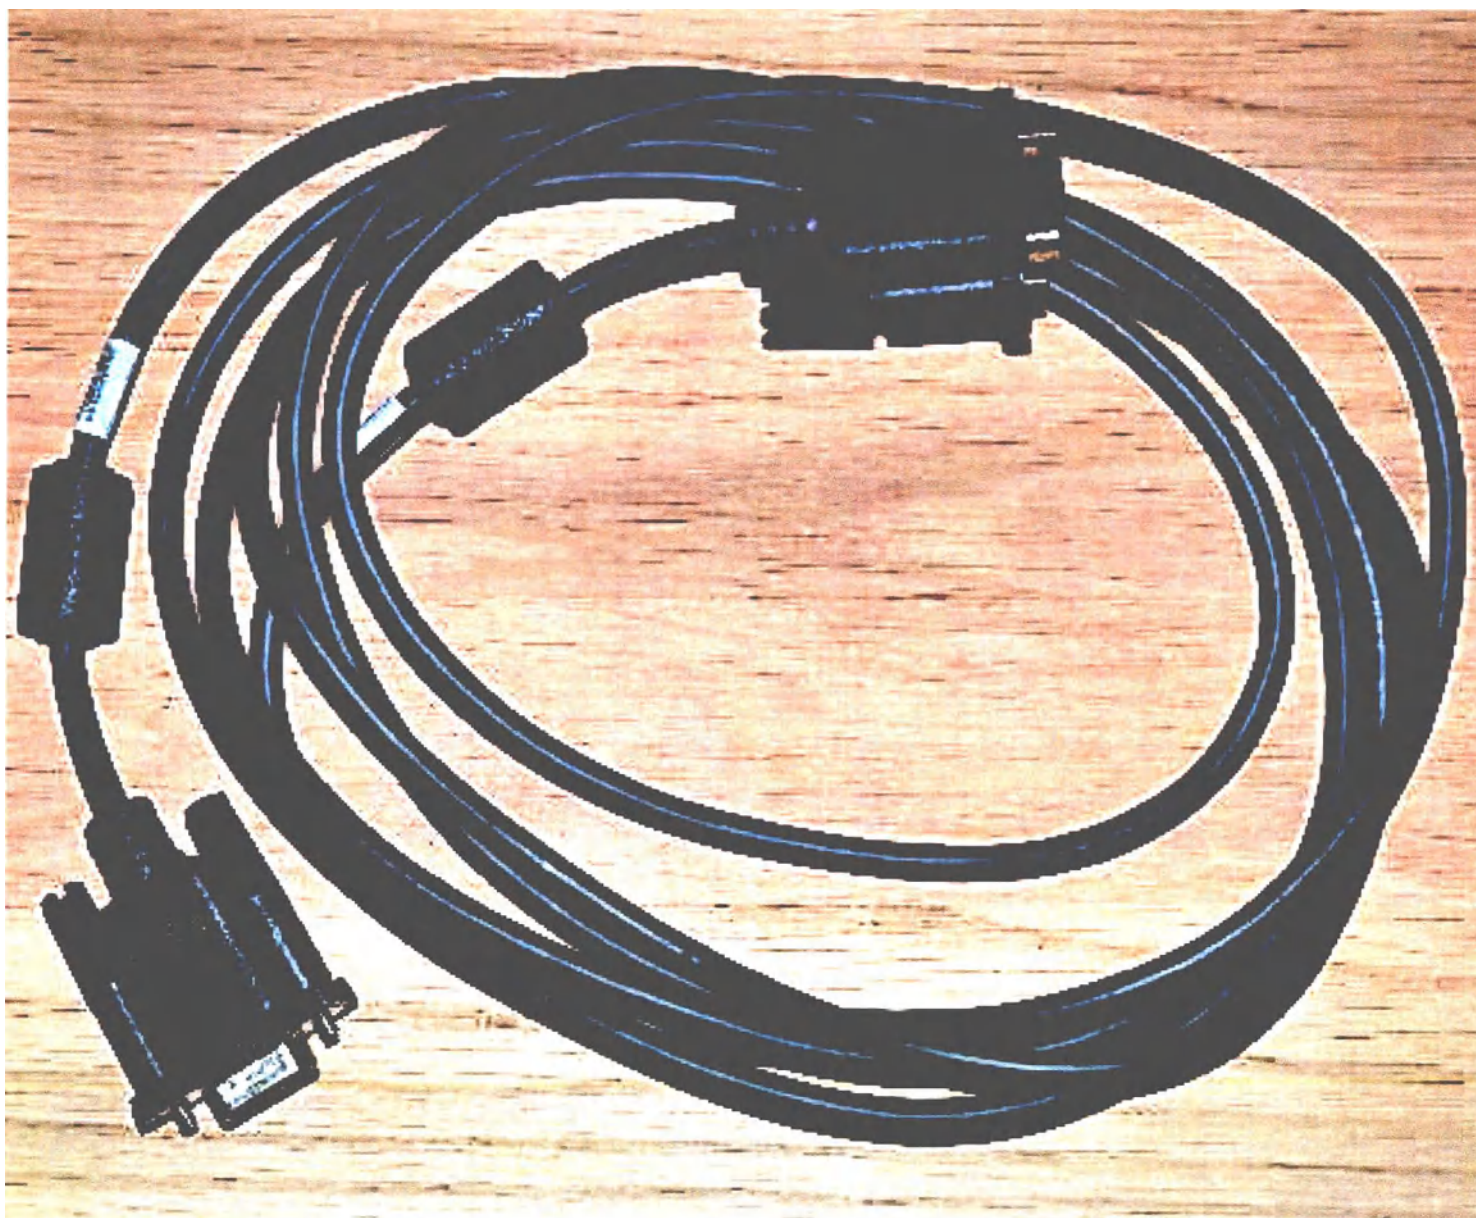


6. Кабель сетевой для соединения с компьютером, не более 2 штук


Принадлежности:

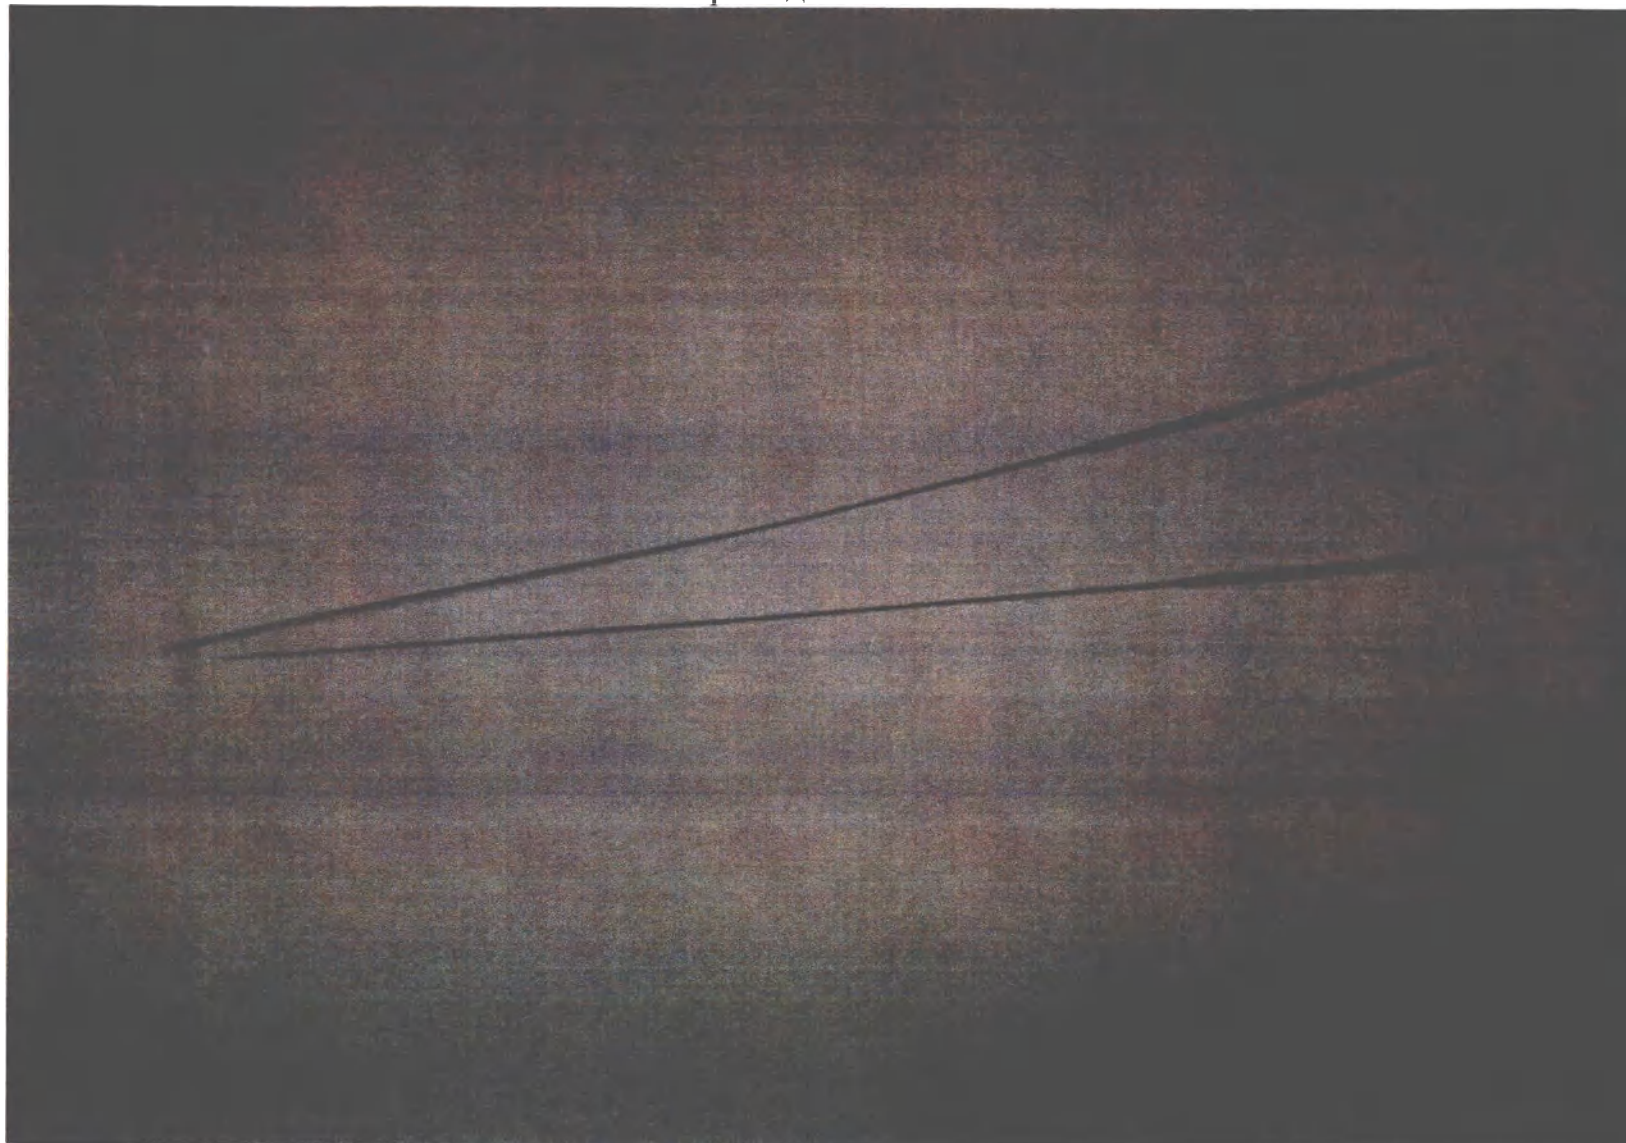

1. Инструмент очистки, не более 4 штук

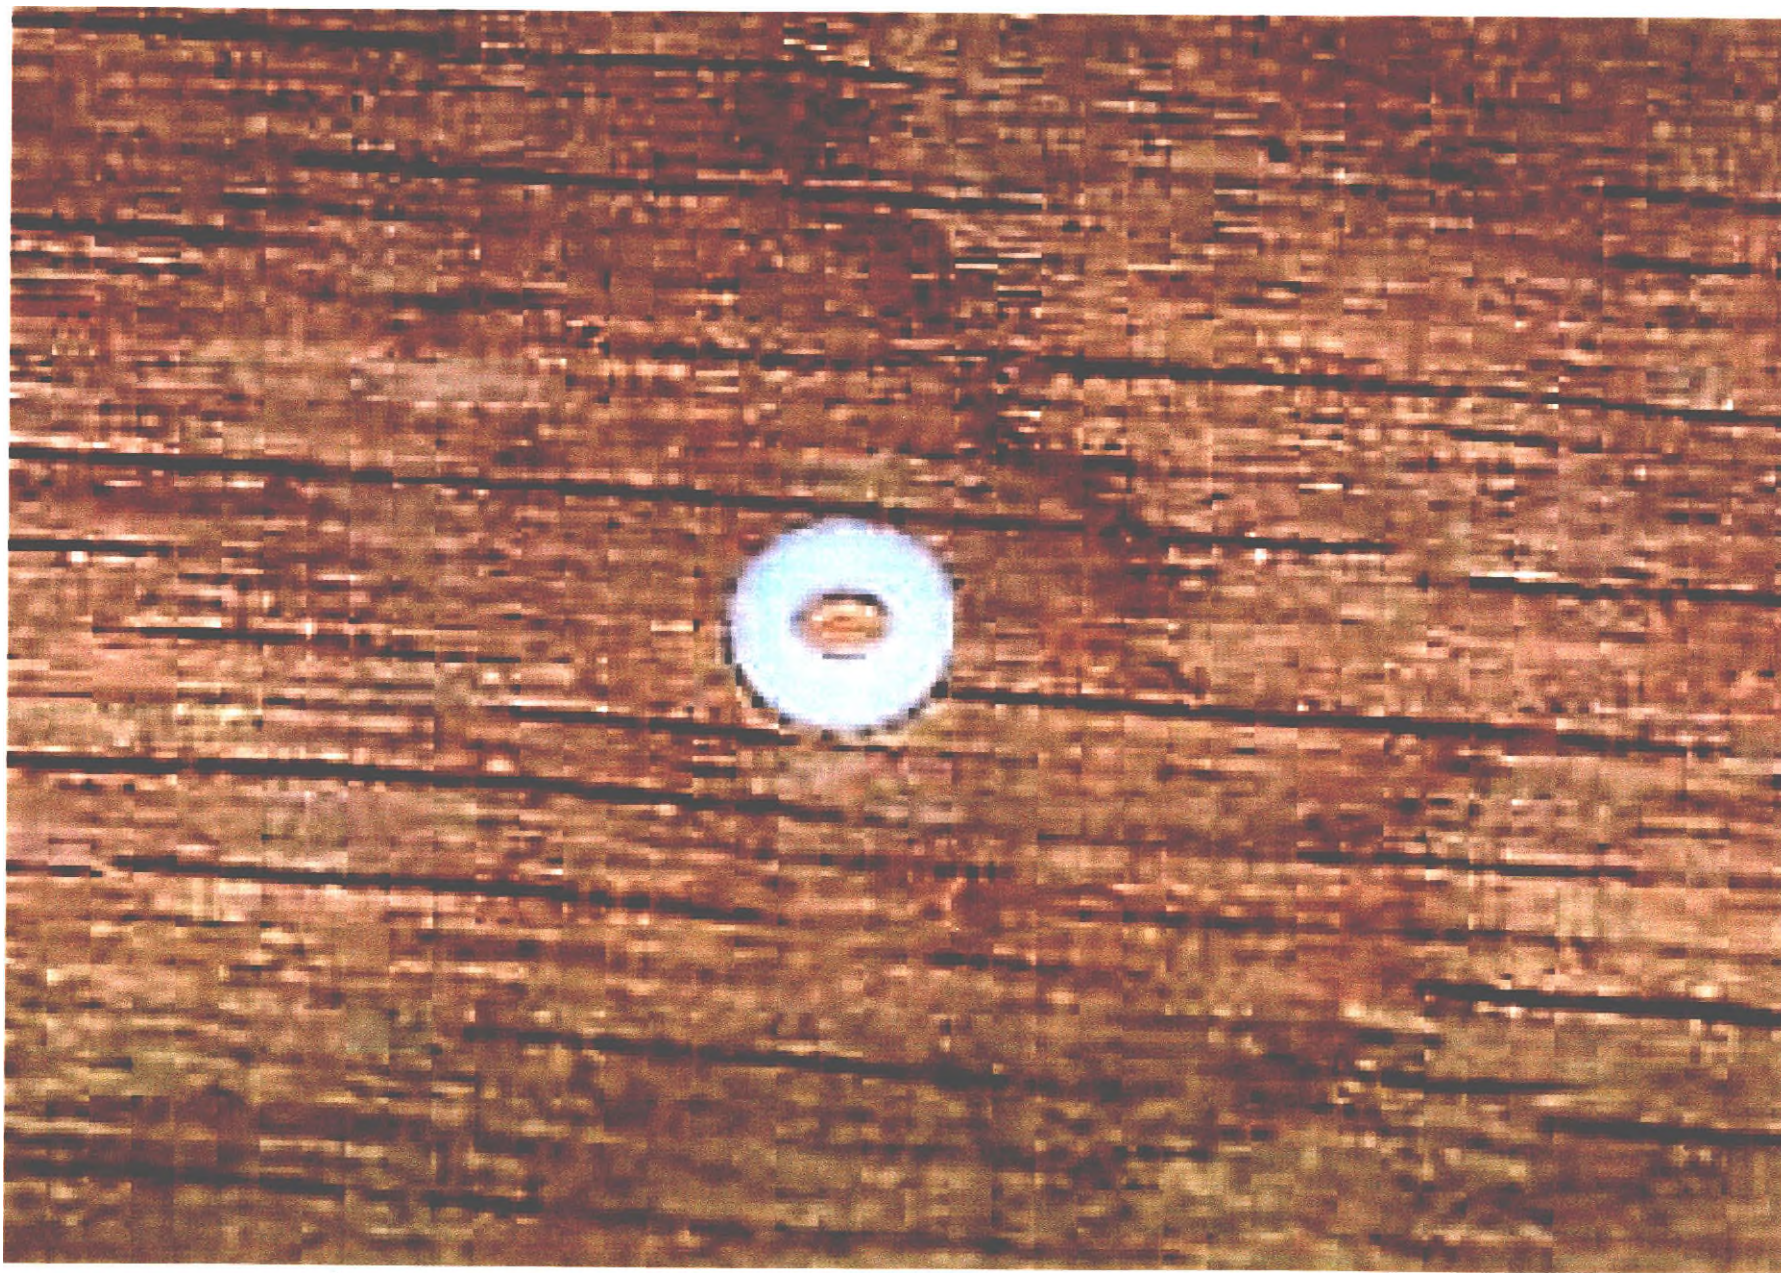


2. Прокладка для промывающей станции дозатора, не более 3 штук

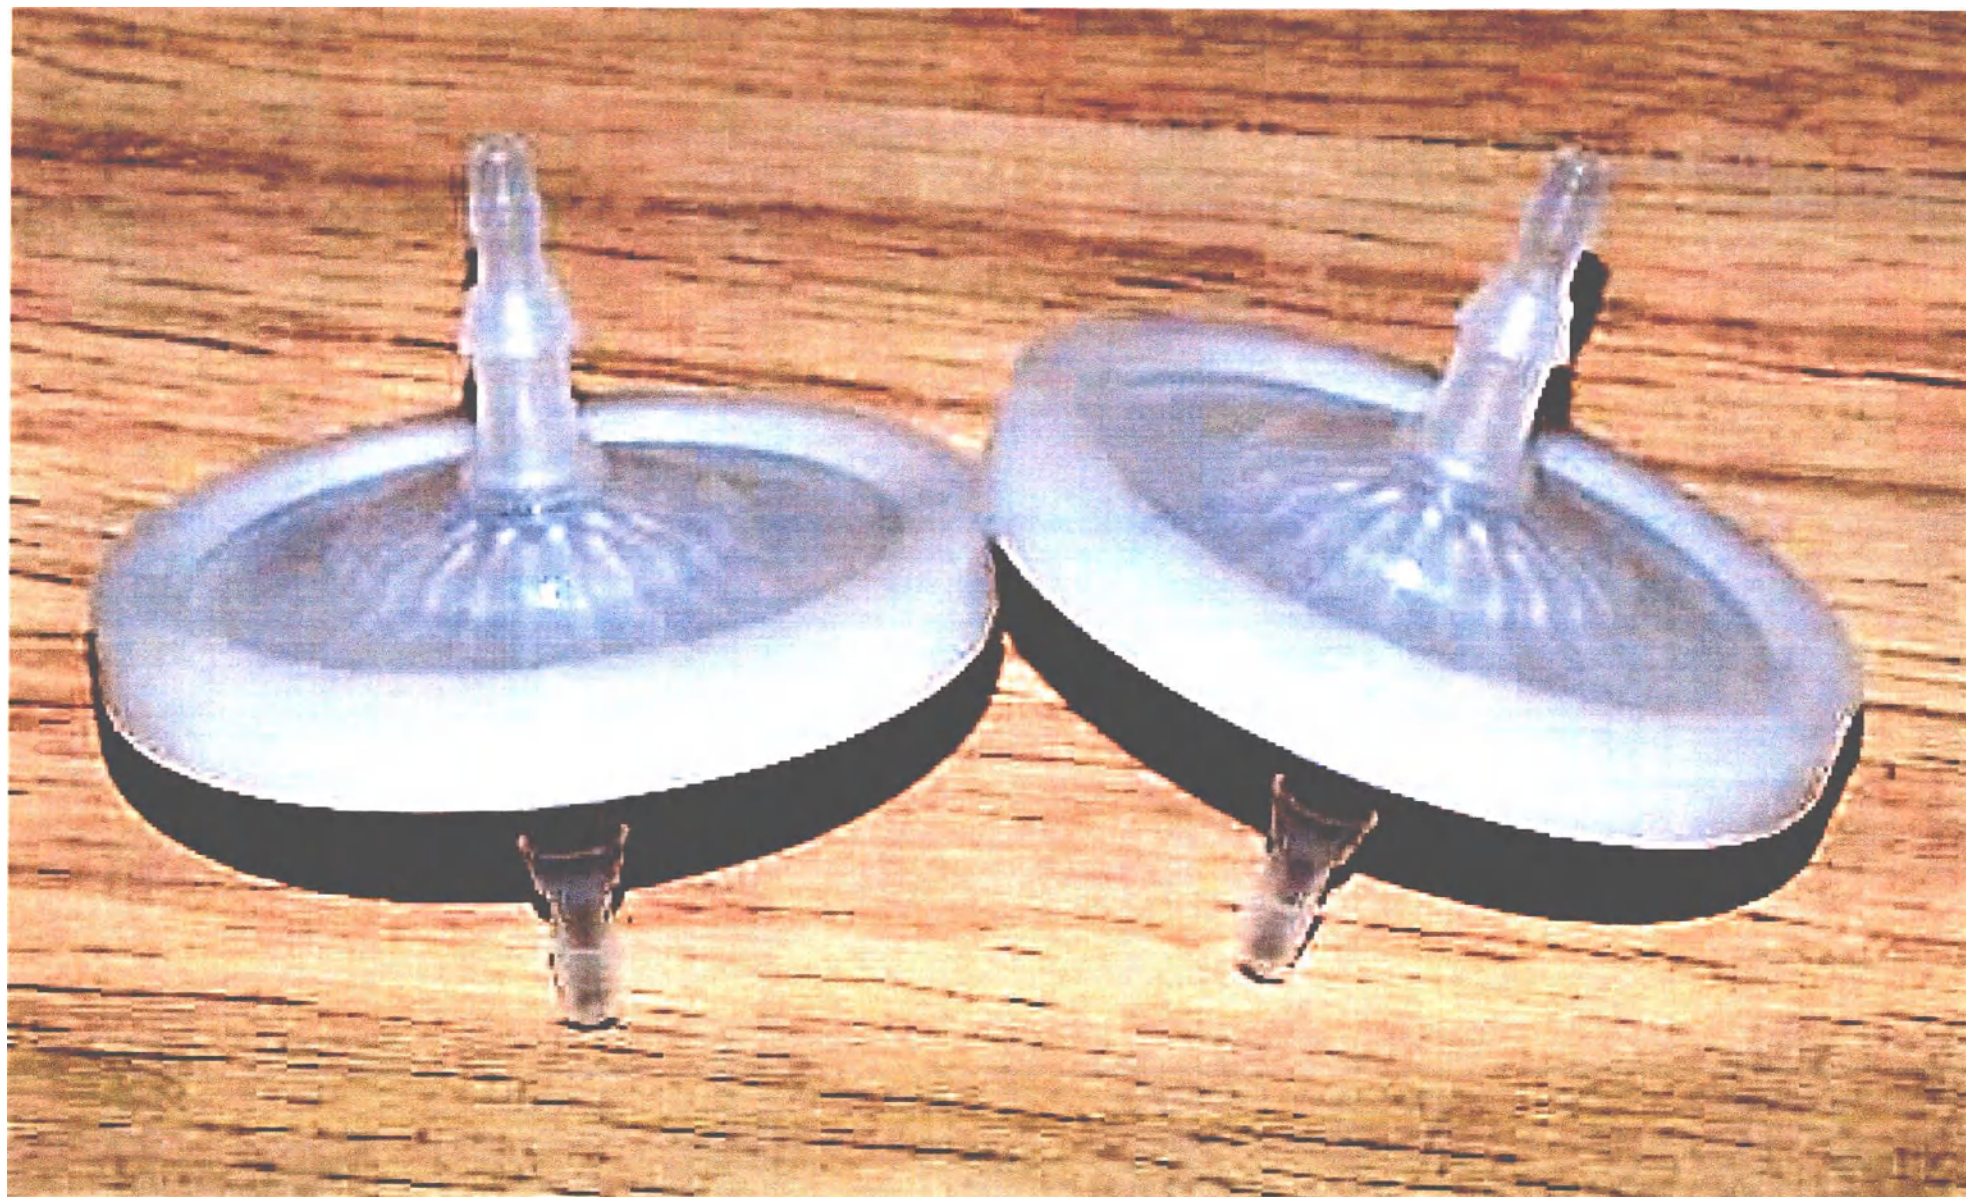

3. Фильтр, не более 4 штук




4. Канистра пластиковая, не более 4 штук

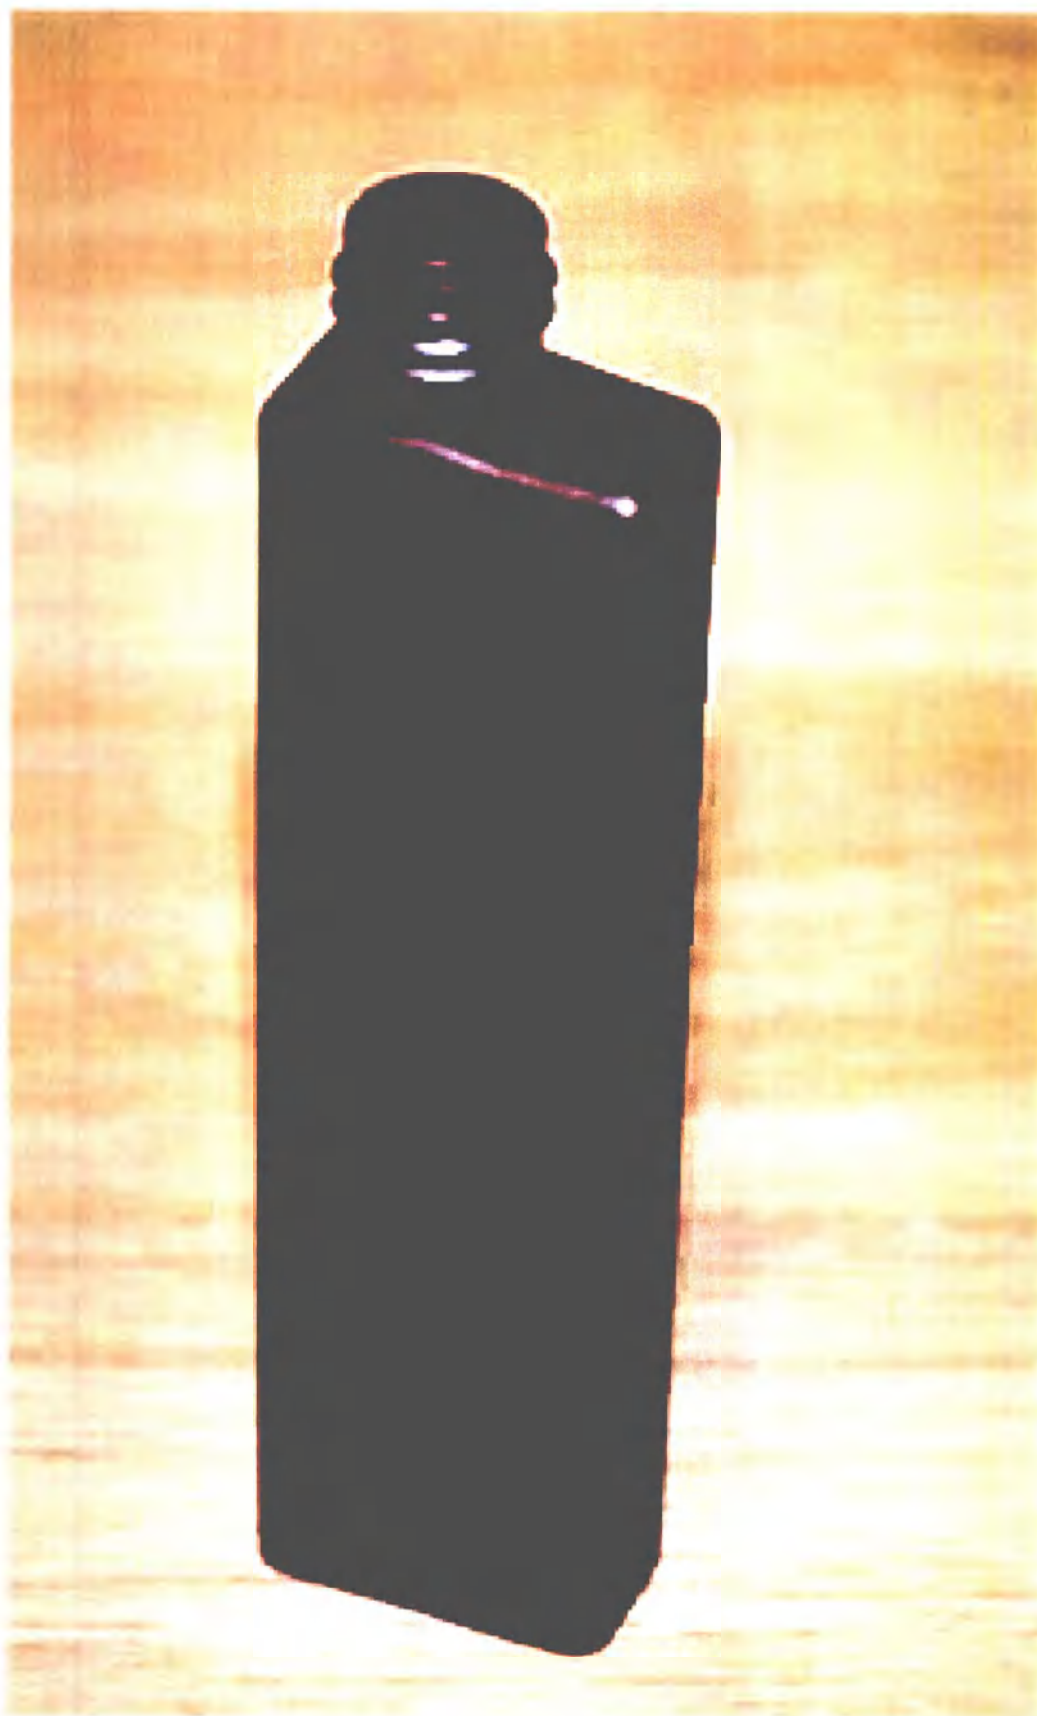


5. Флакон реагента, 20 мл, не более 50 штук




6. Флакон реагента, 40 мл, не более 50 штук

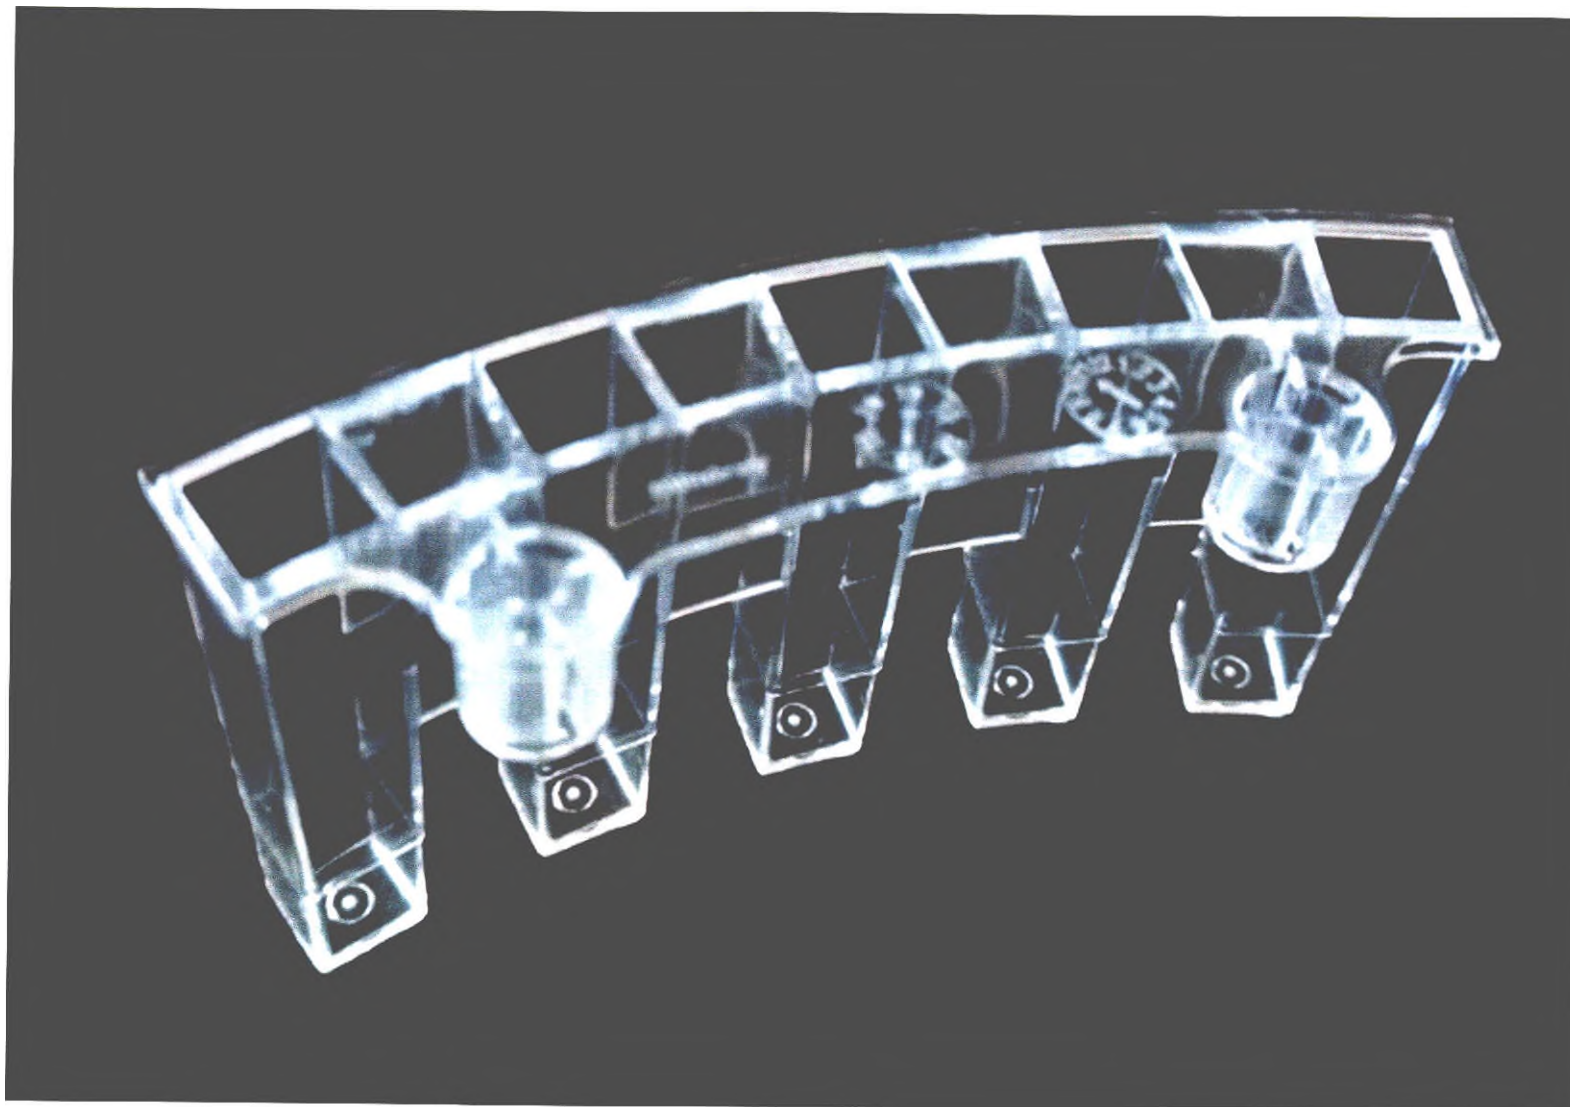


7. Кюветы реакционные, не более 150 штук

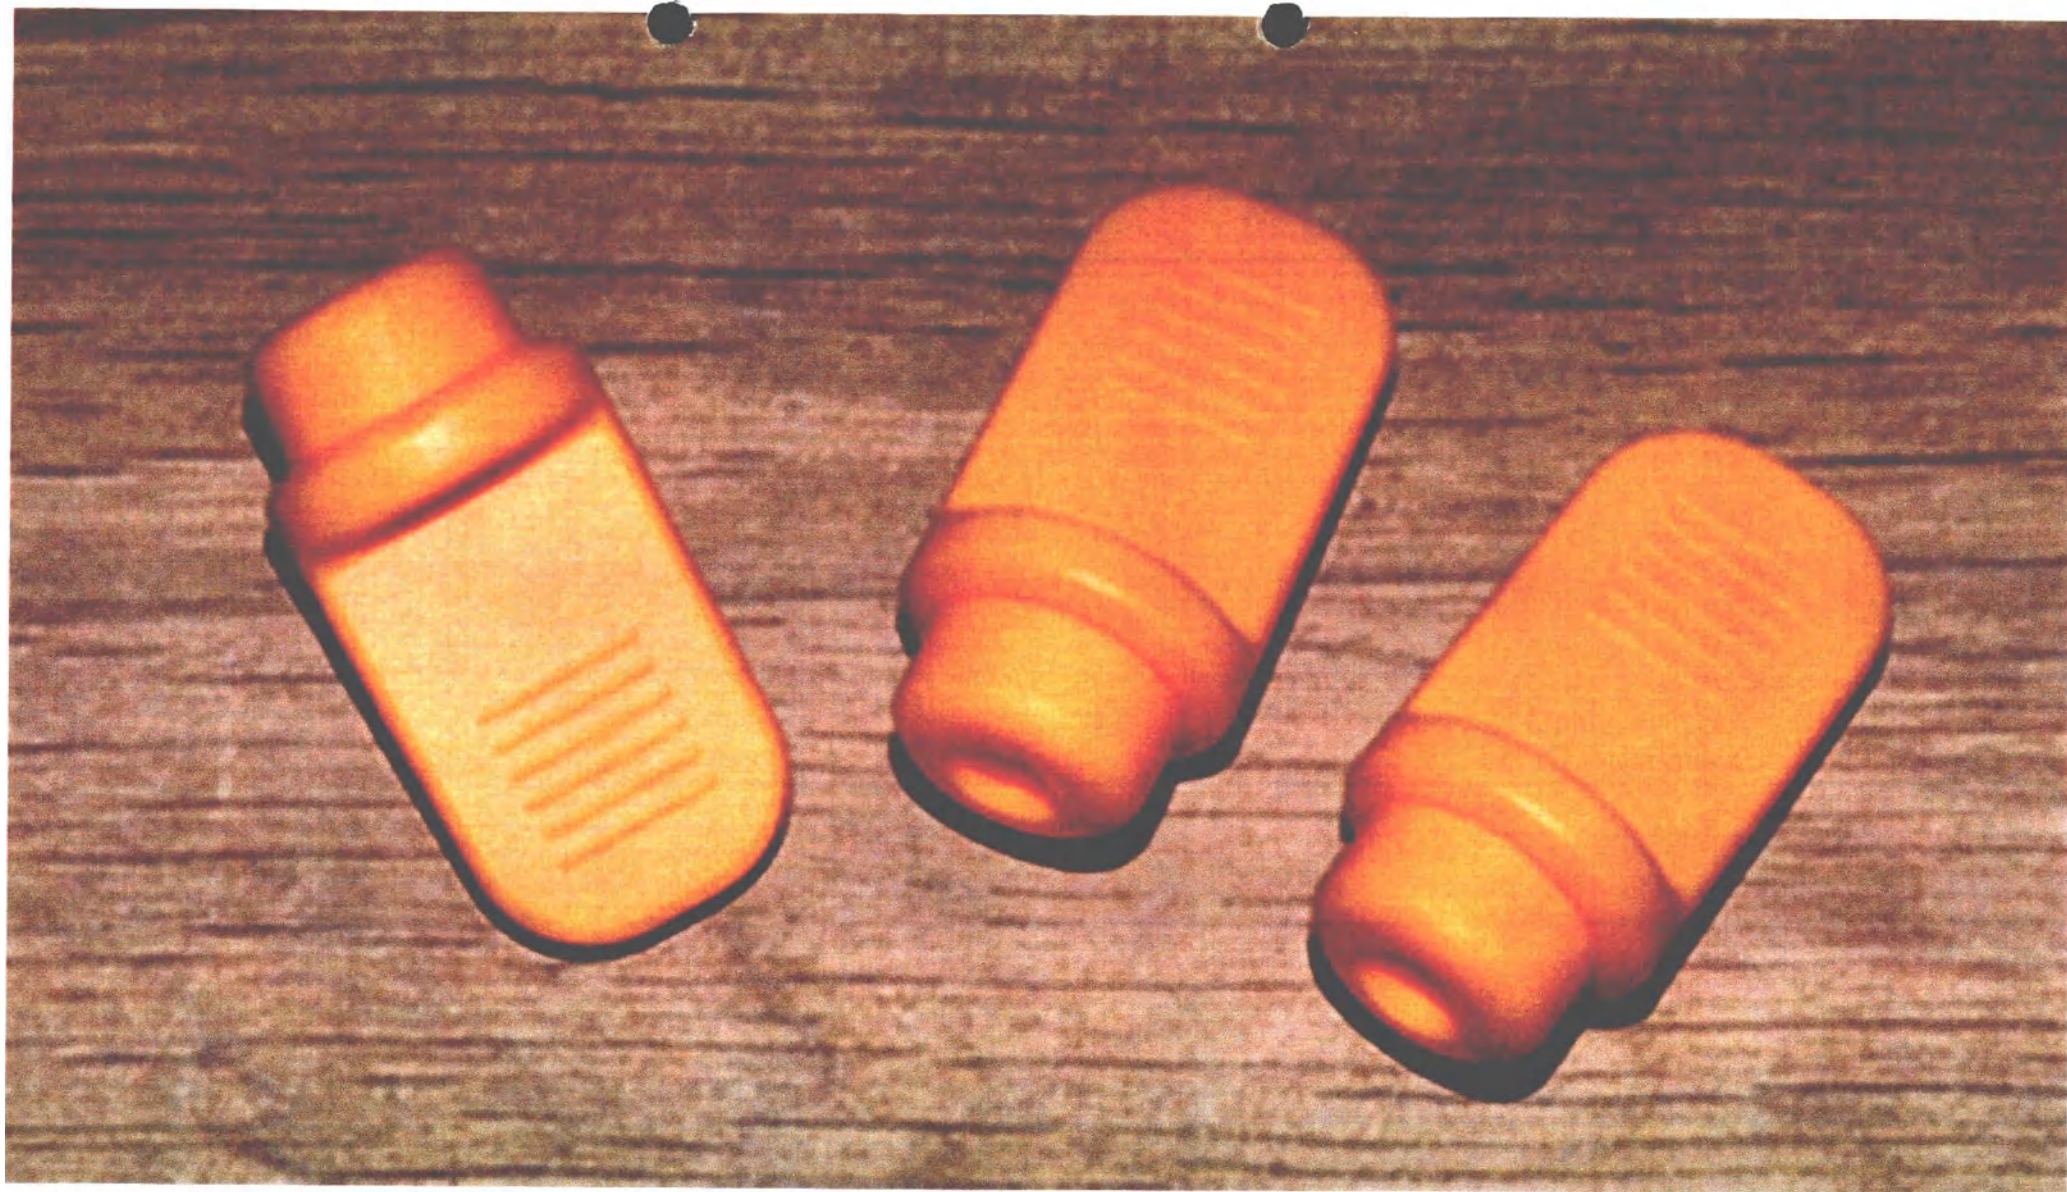


8. Заглушка пластиковая, не более 3 штуки

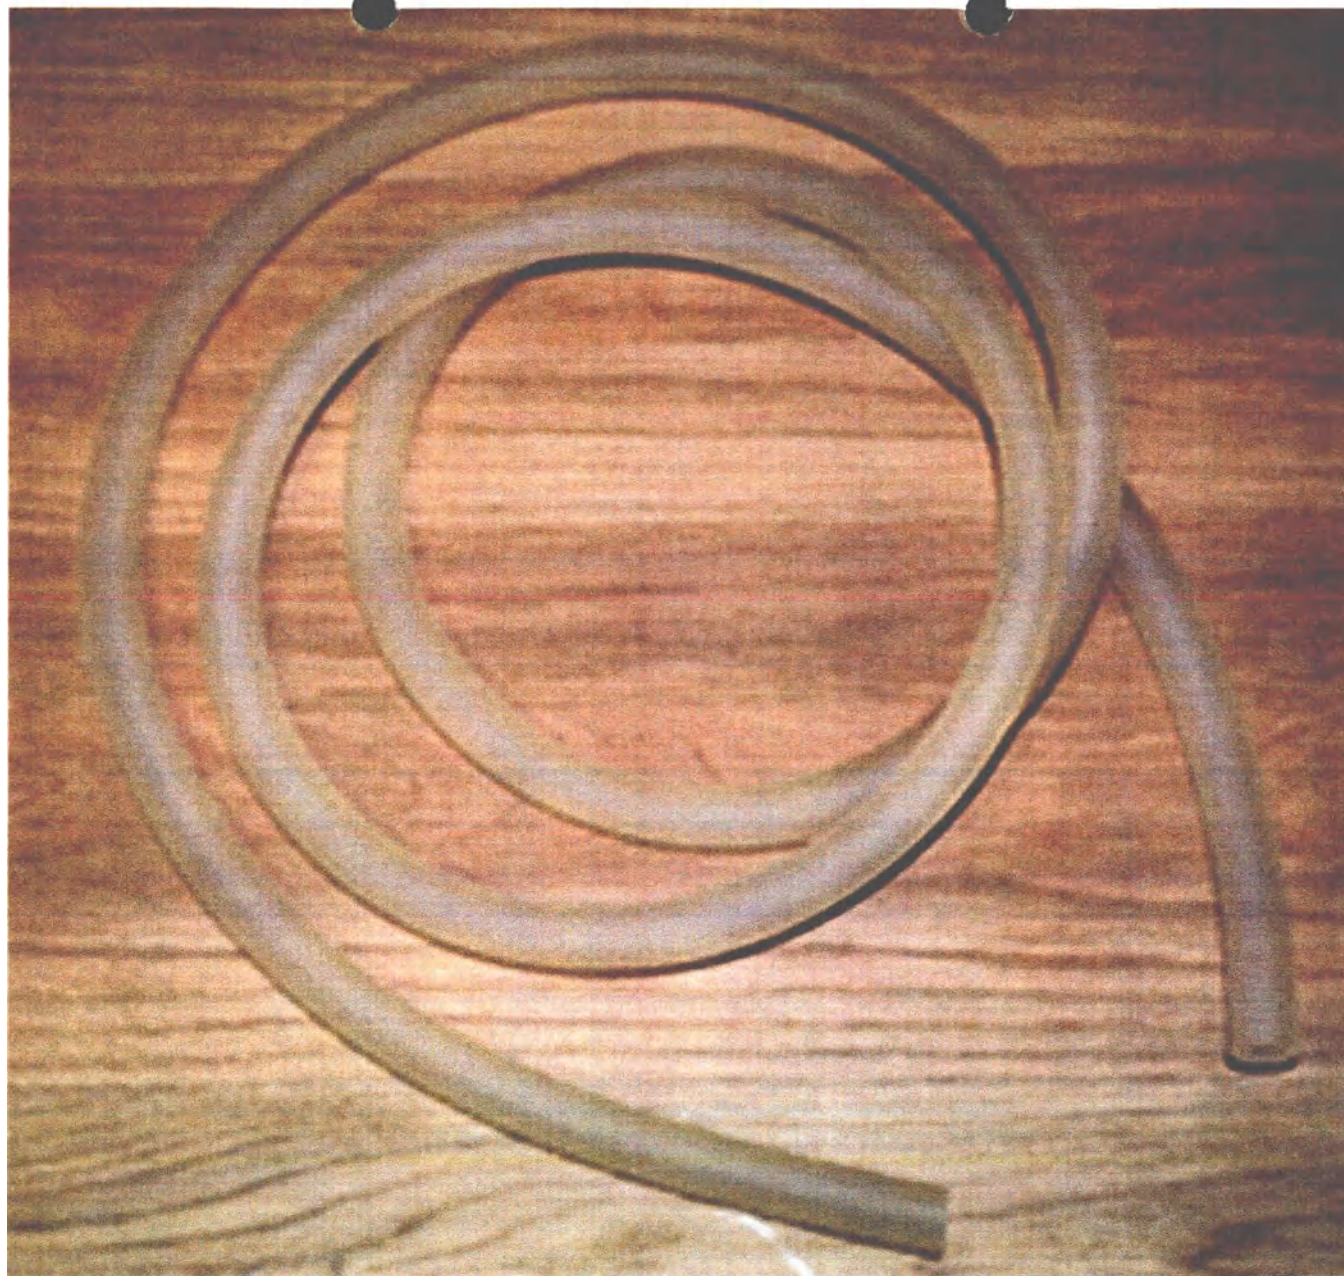


9. Трубка соединительная, не более 3 штук

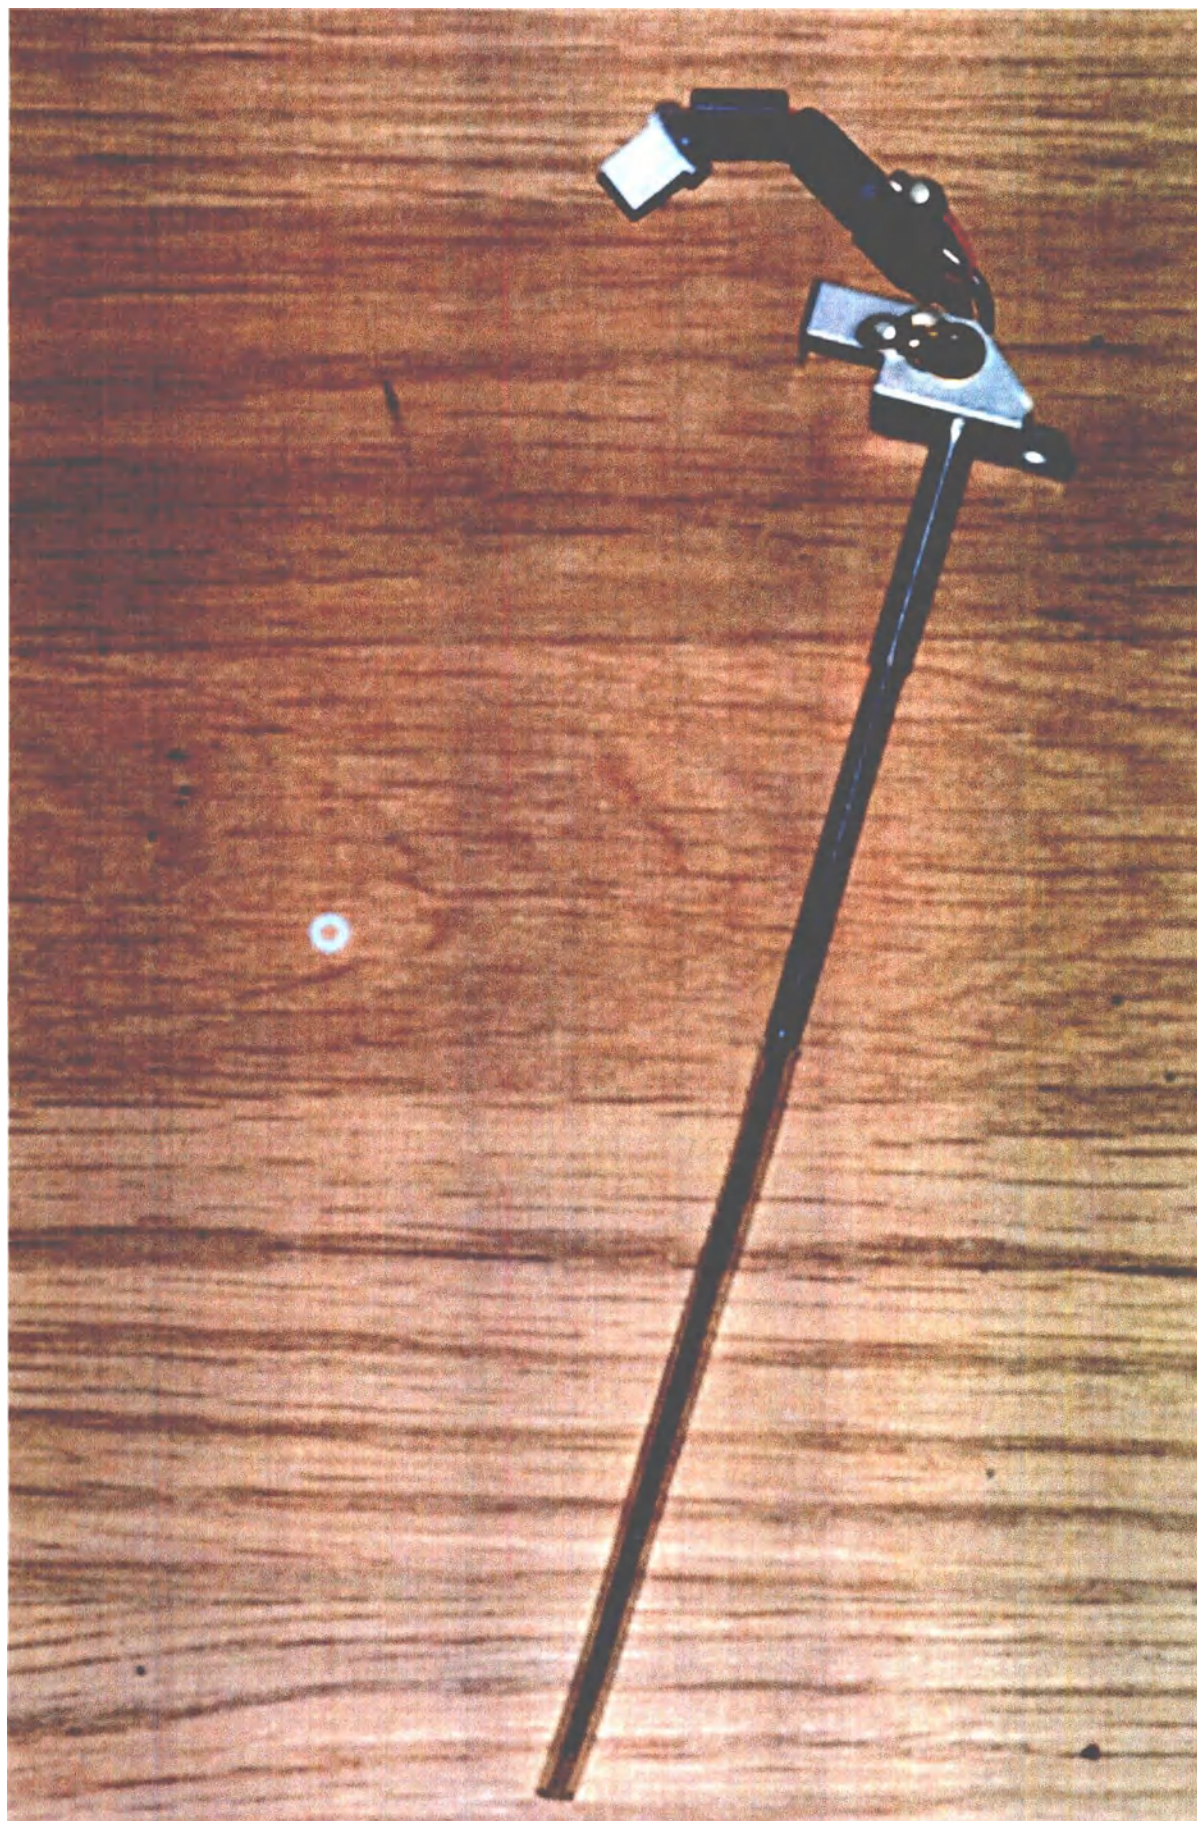


10. Дозатор в сборе, не более 3 штук

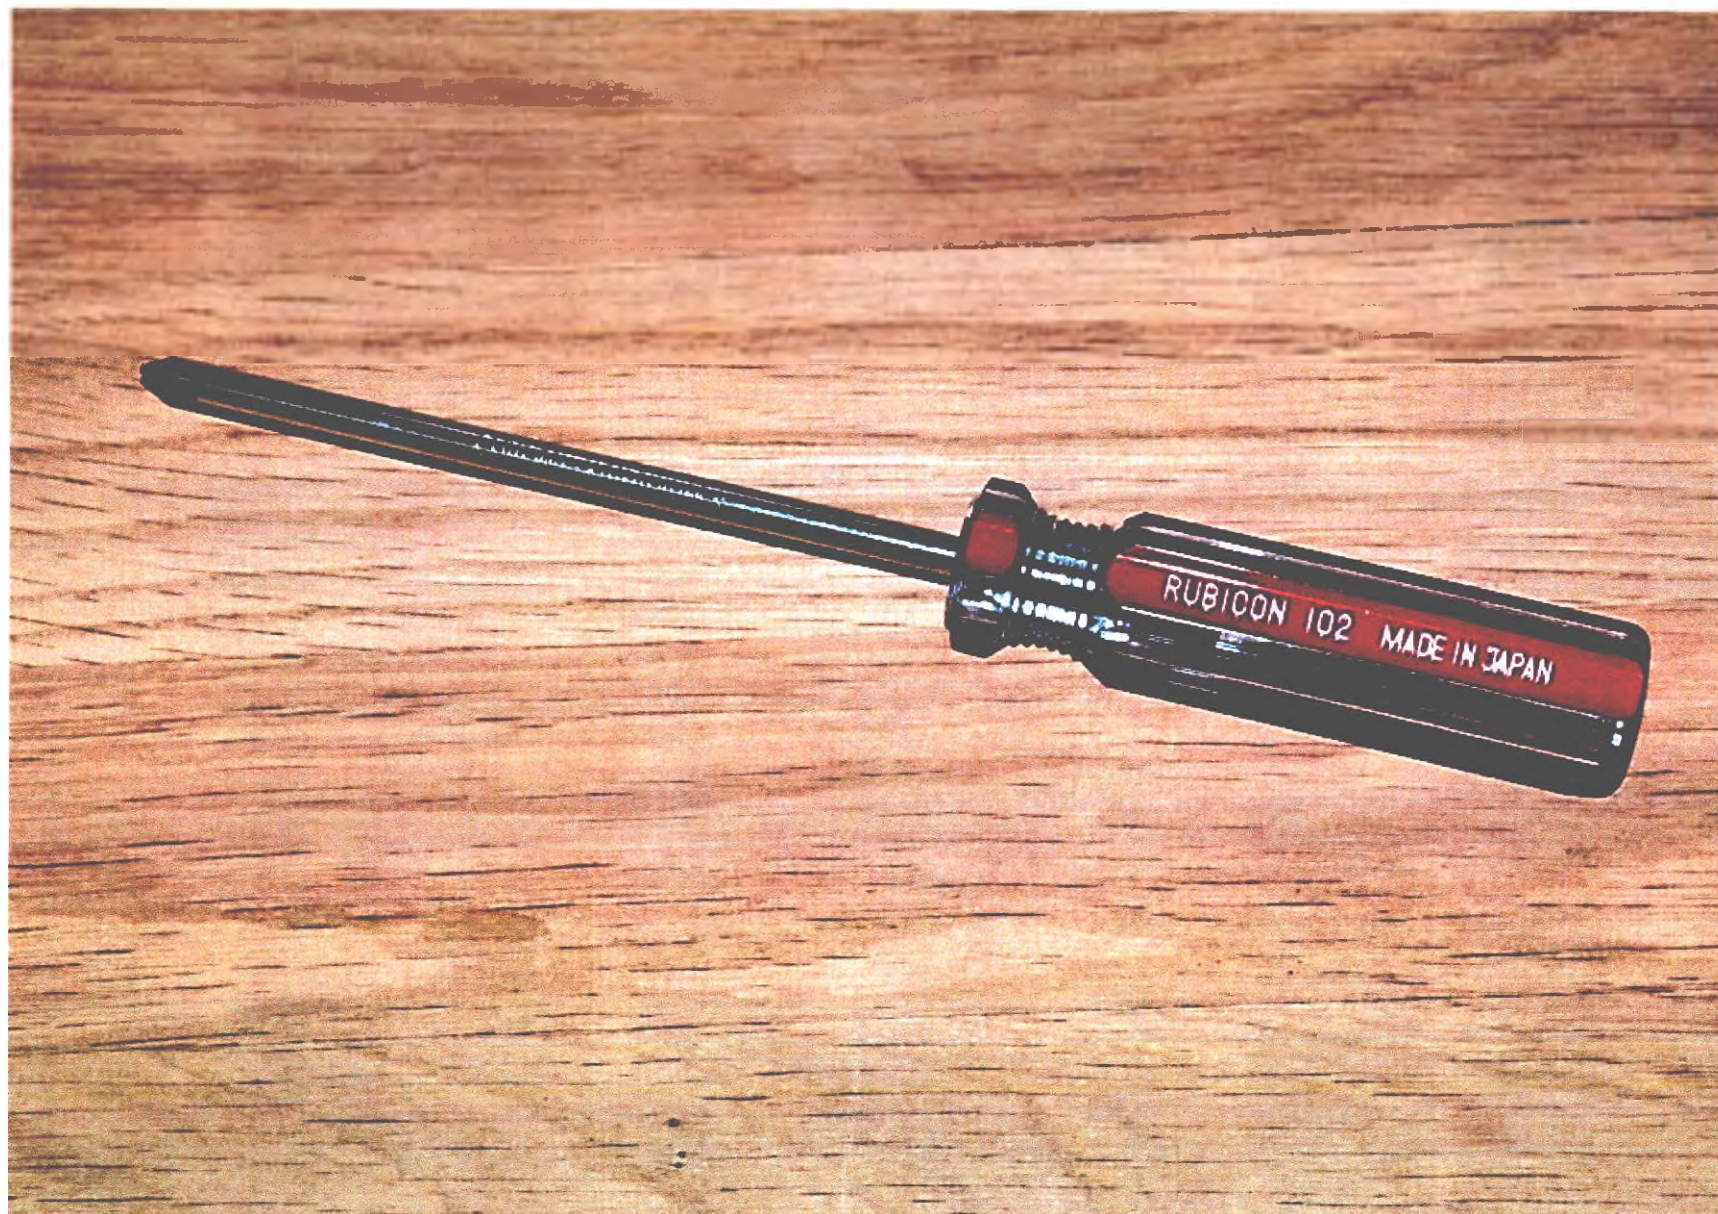

11.Отвертка, не более 2 штук

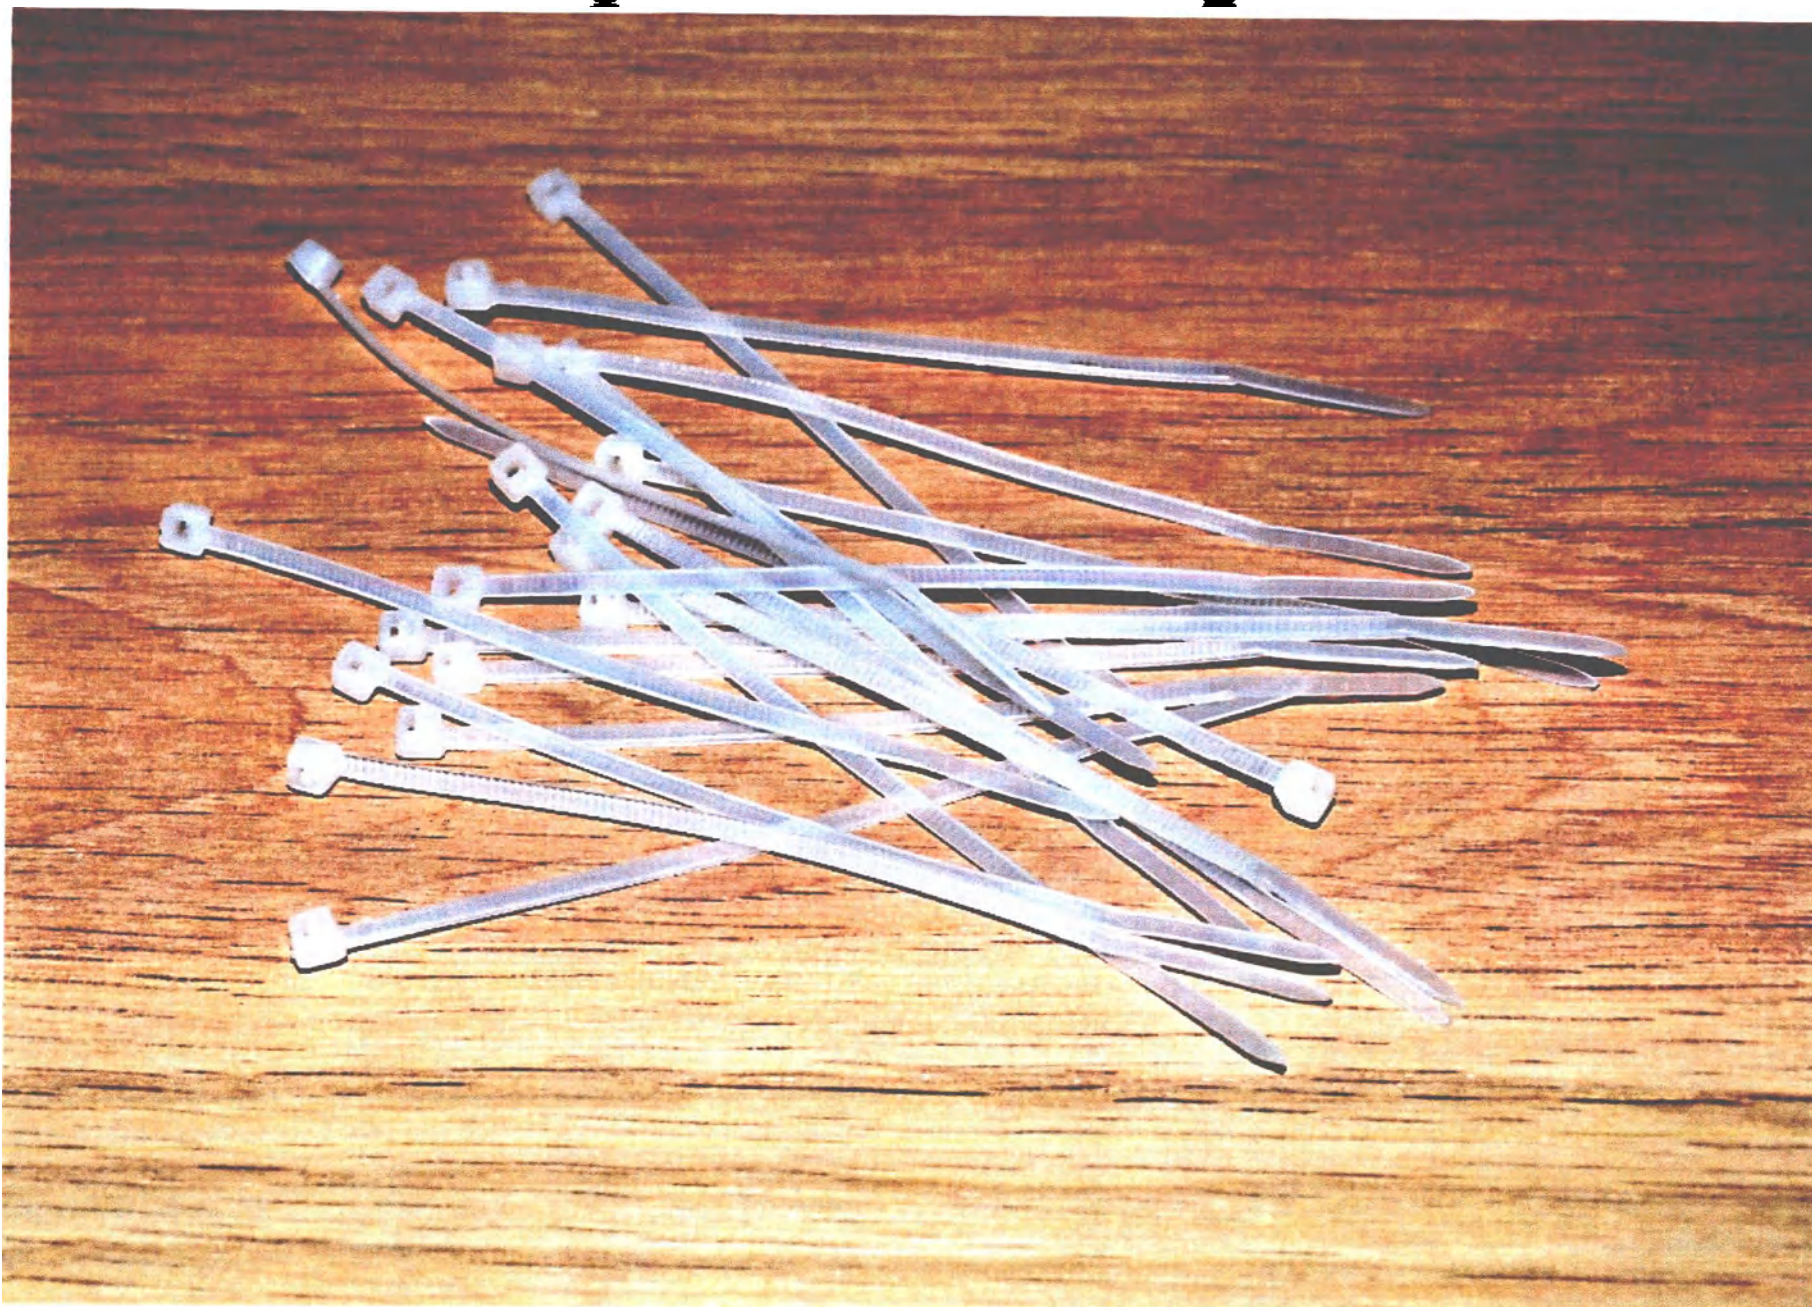


12. Стяжки кабельные, не более 50 штук

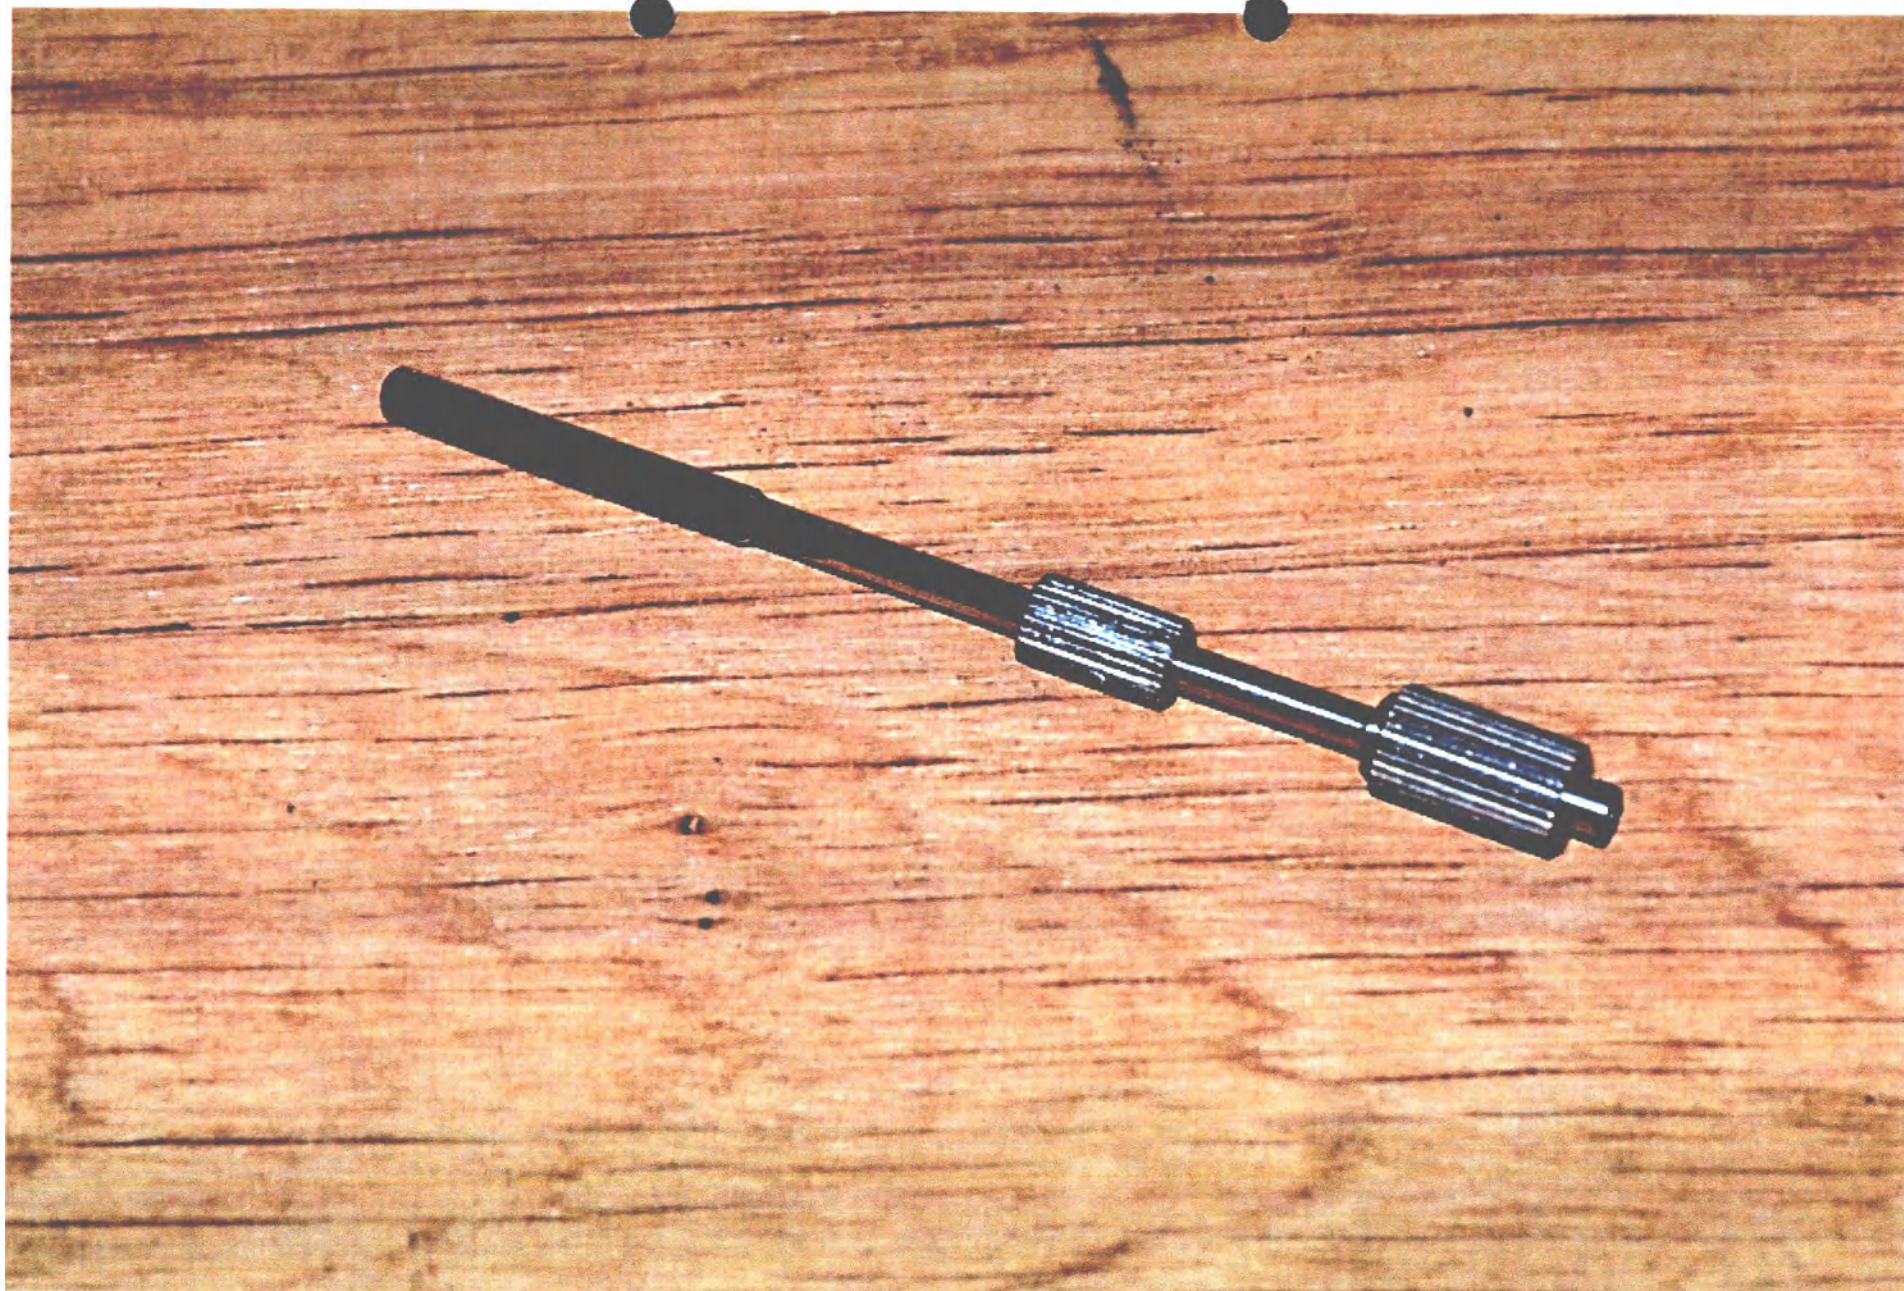


13. Гайка стопорная (для миксера), не более 5 штук



15. Крышки флаконов реагентов, не более 100 штук

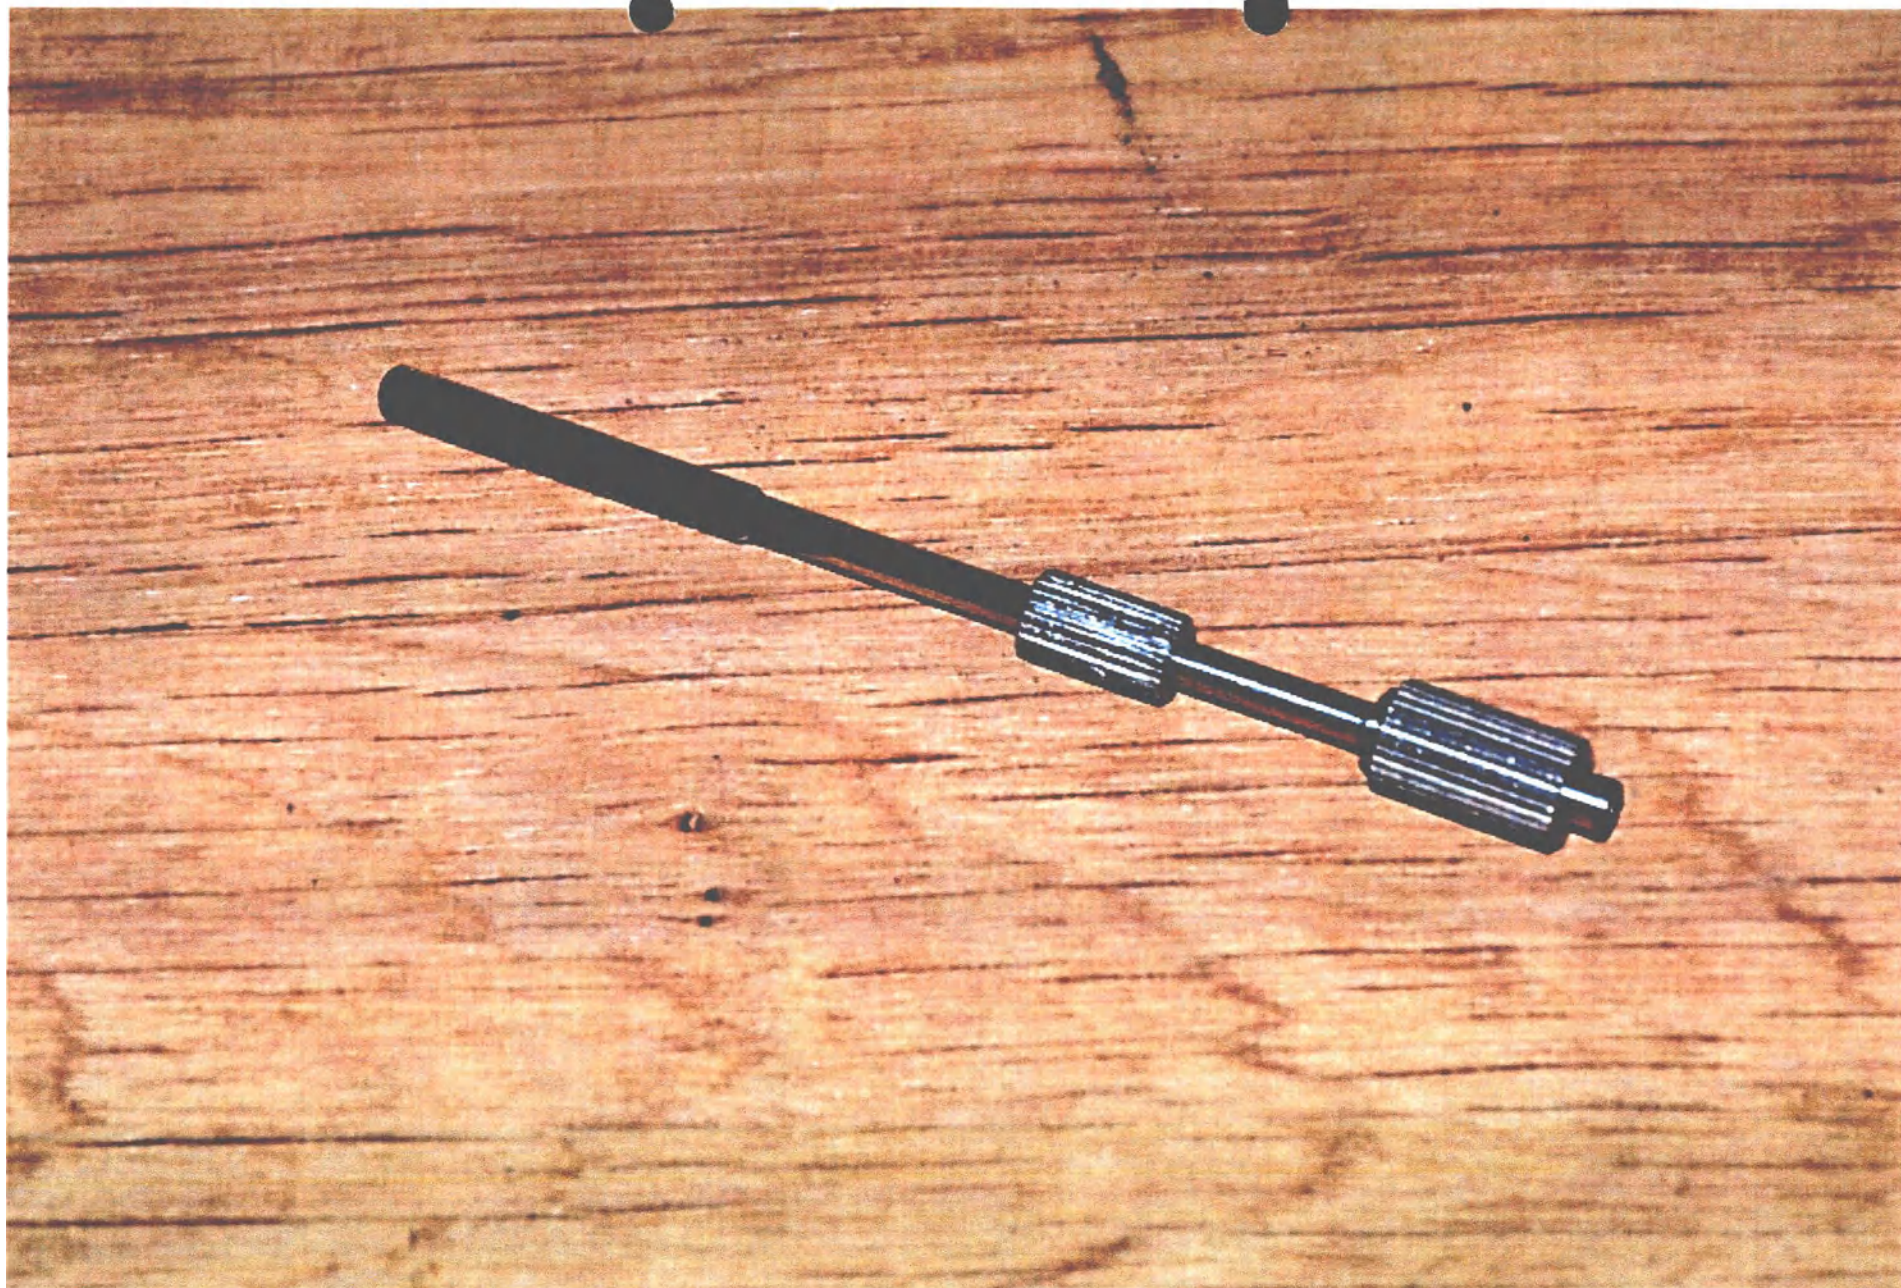

16.Миксер, не более 2 штук

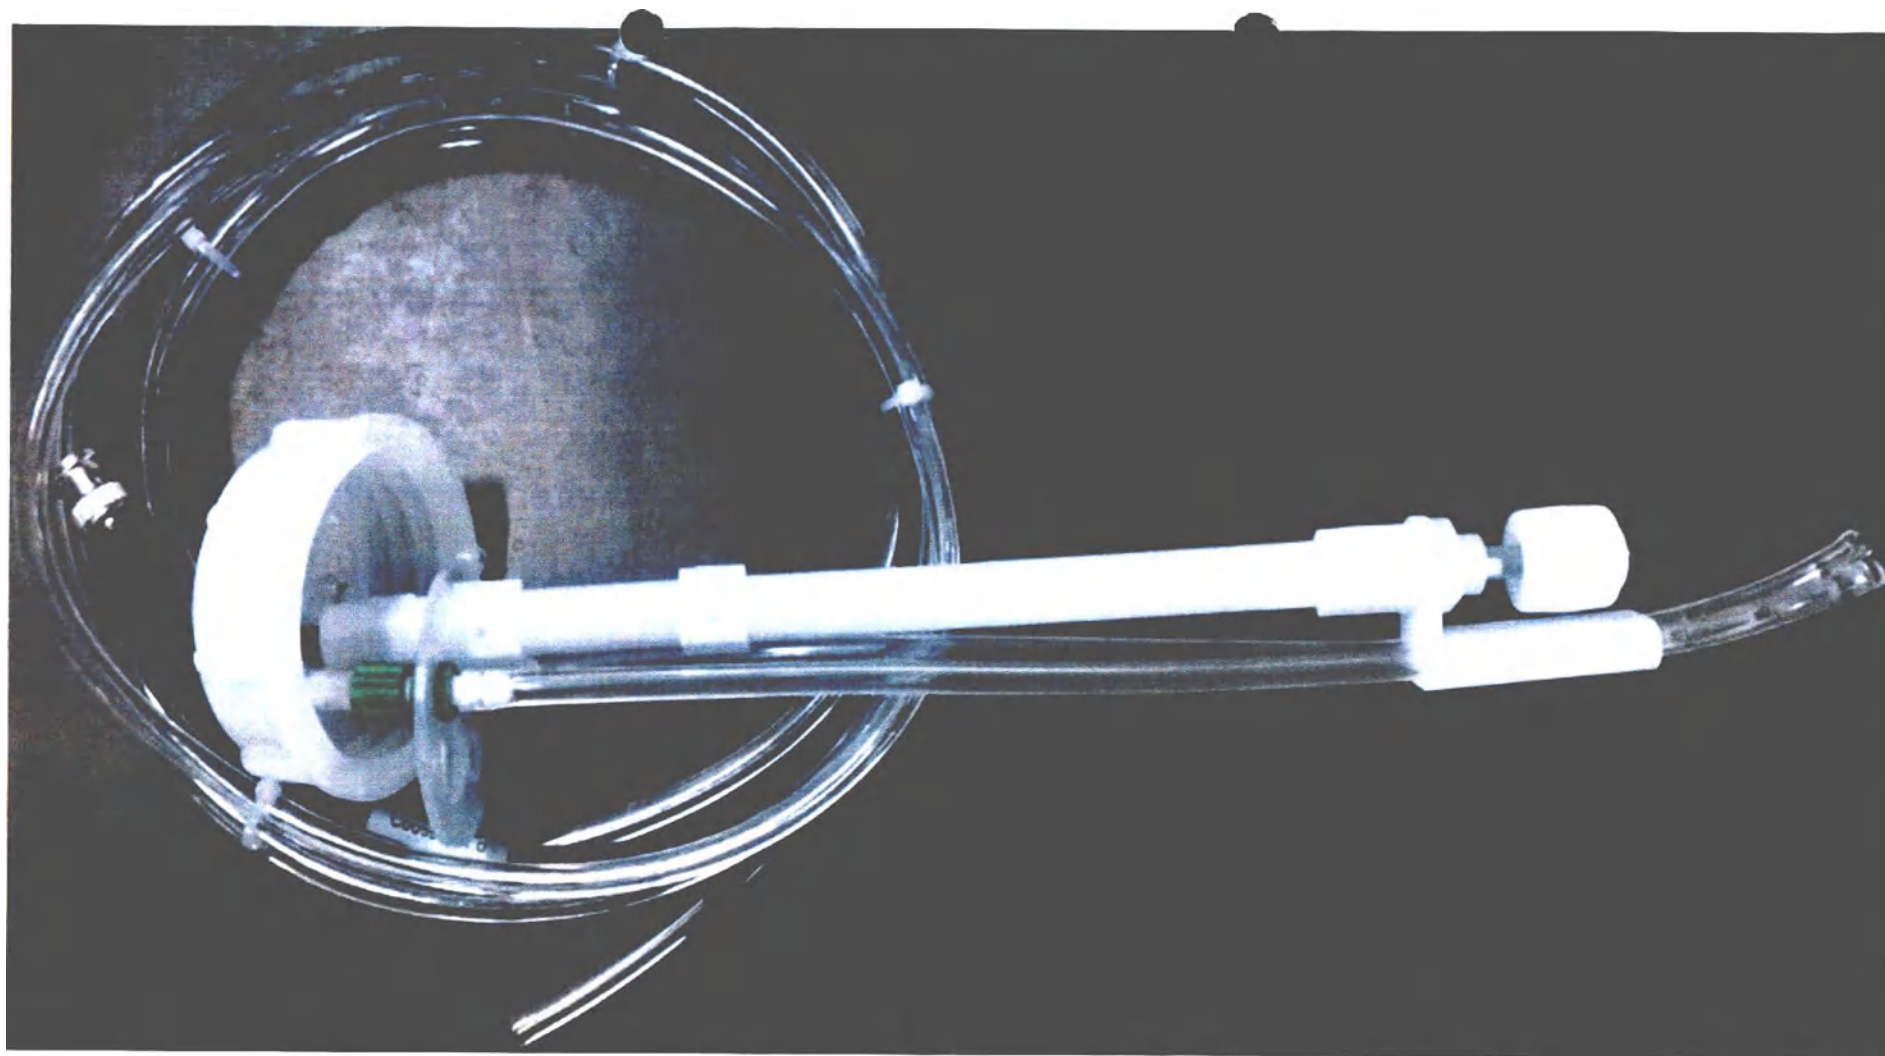

17. Крышка канистры в сборе, не более 4 штук

II. Анализатор биохимический автоматический BS-240
Базовый состав:



1. Анализатор BS-240



1.1. Паспортная табличка анализатора BS-240

Анализатор
биохимический автоматический
BS-240

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)


8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)


E-mail: ruservice@mindray.com

mindray


2. Руководство оператора не более 2 штук

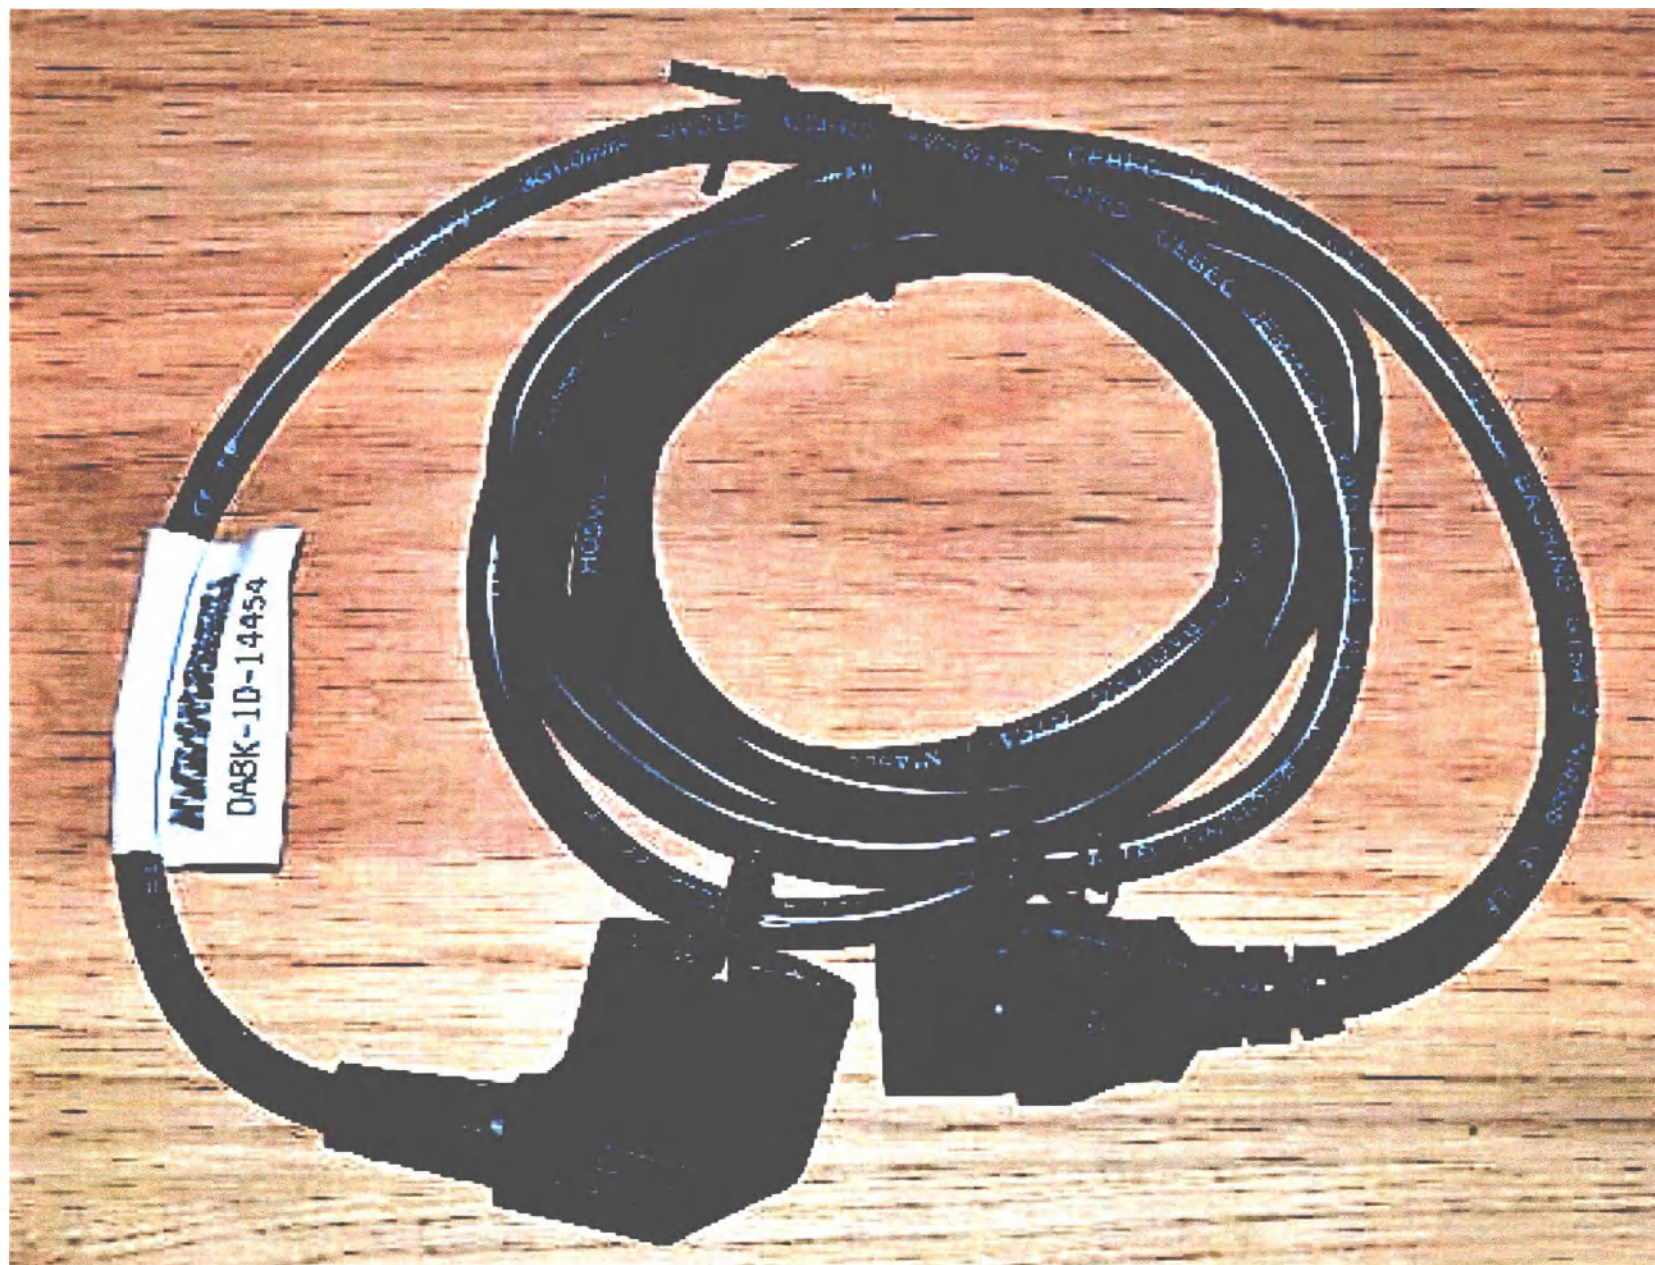


3. Кабель питания

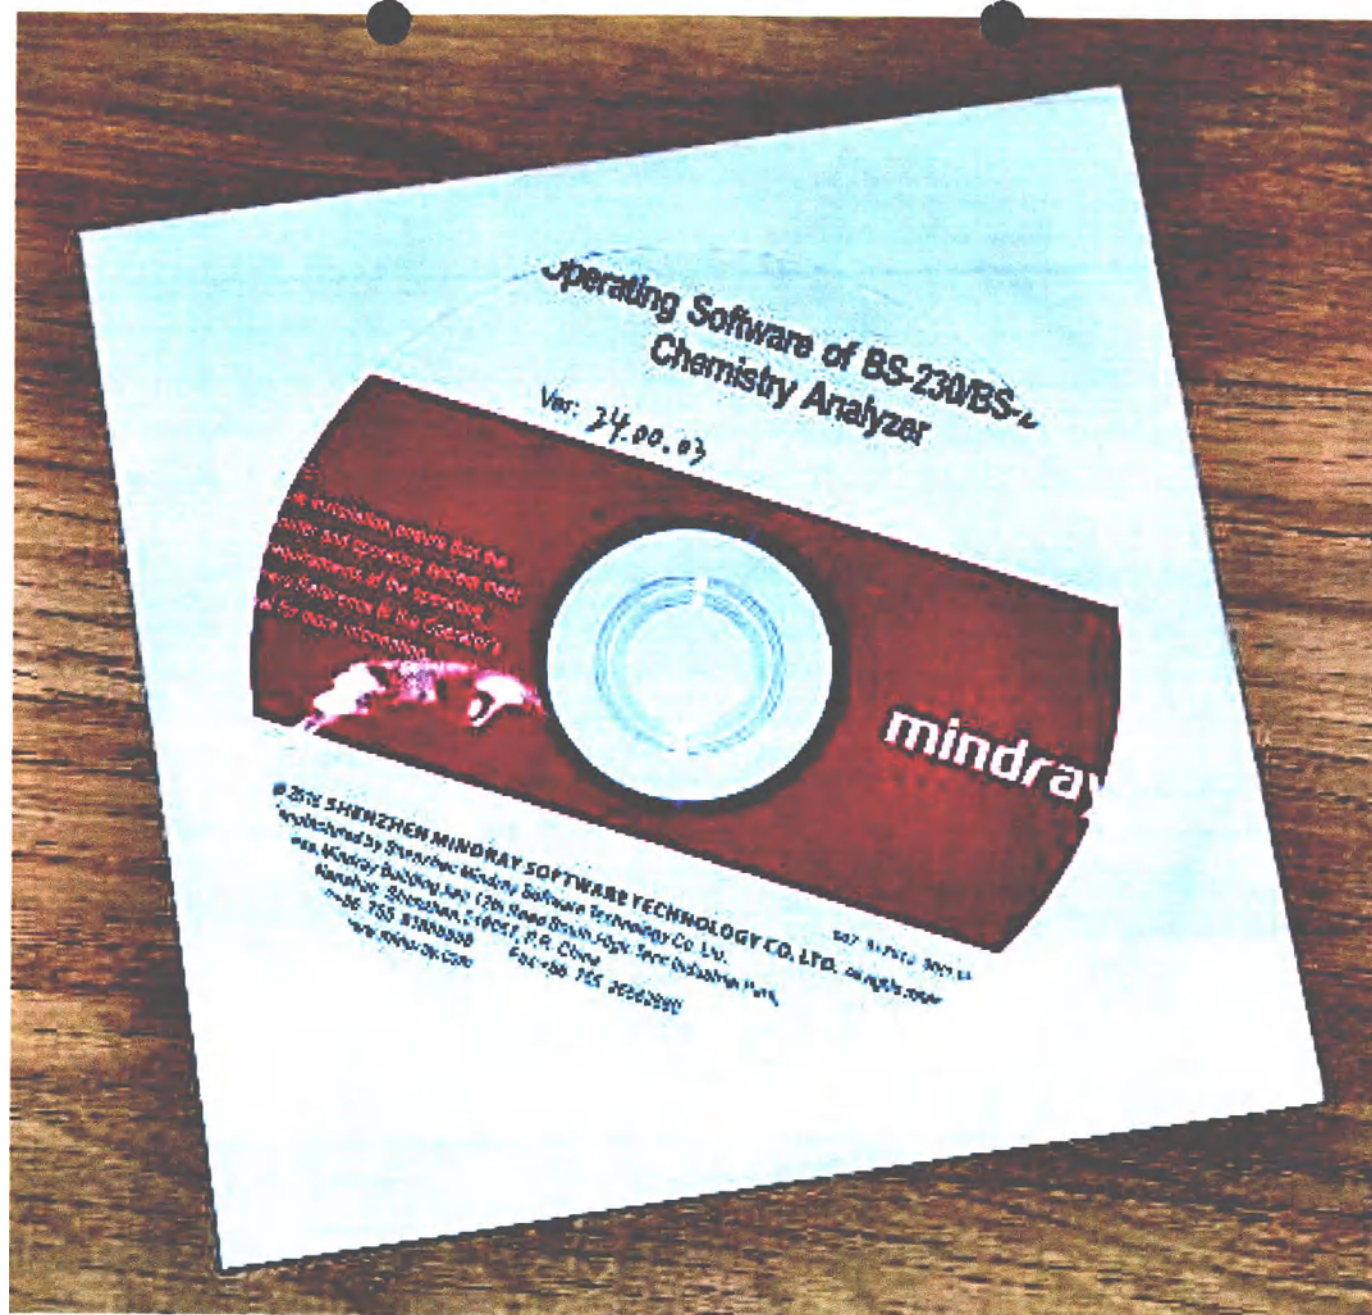

4. Диск с программным обеспечением

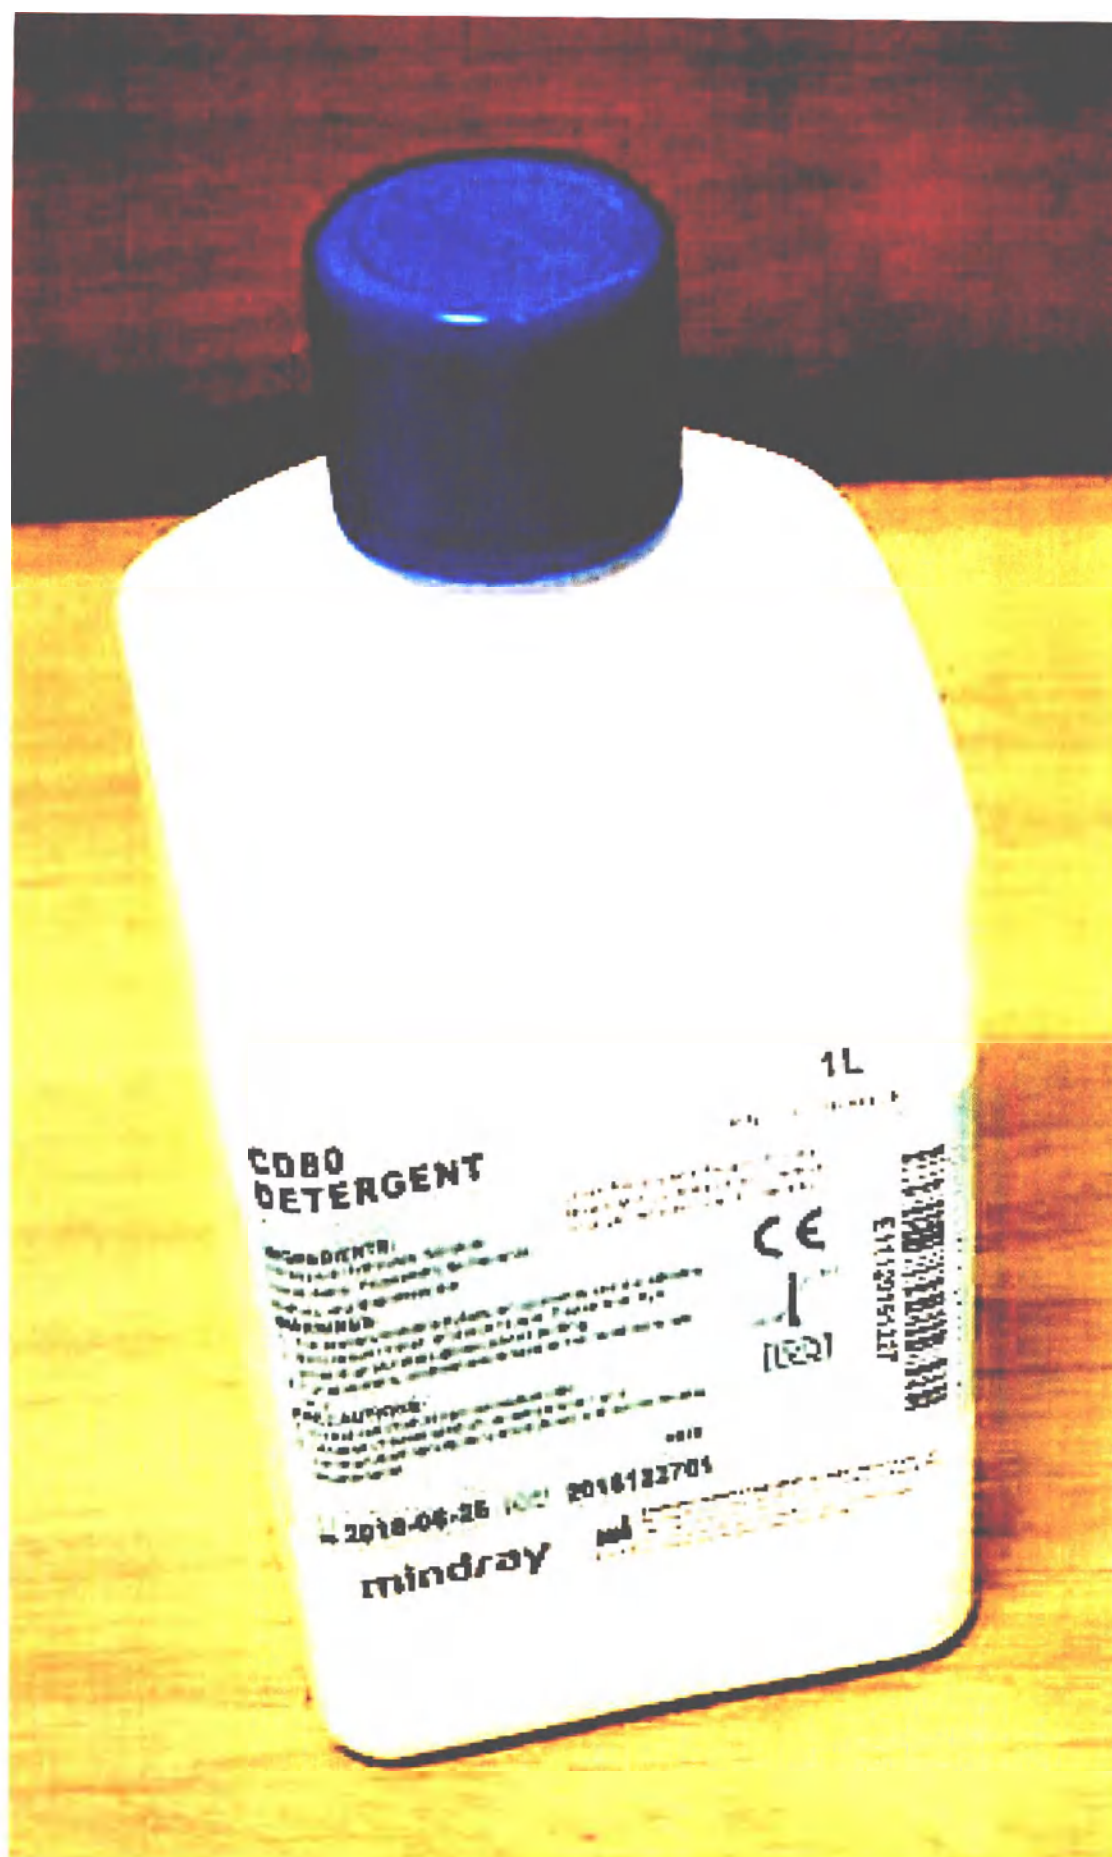


5. Детергент CD80 (при необходимости)

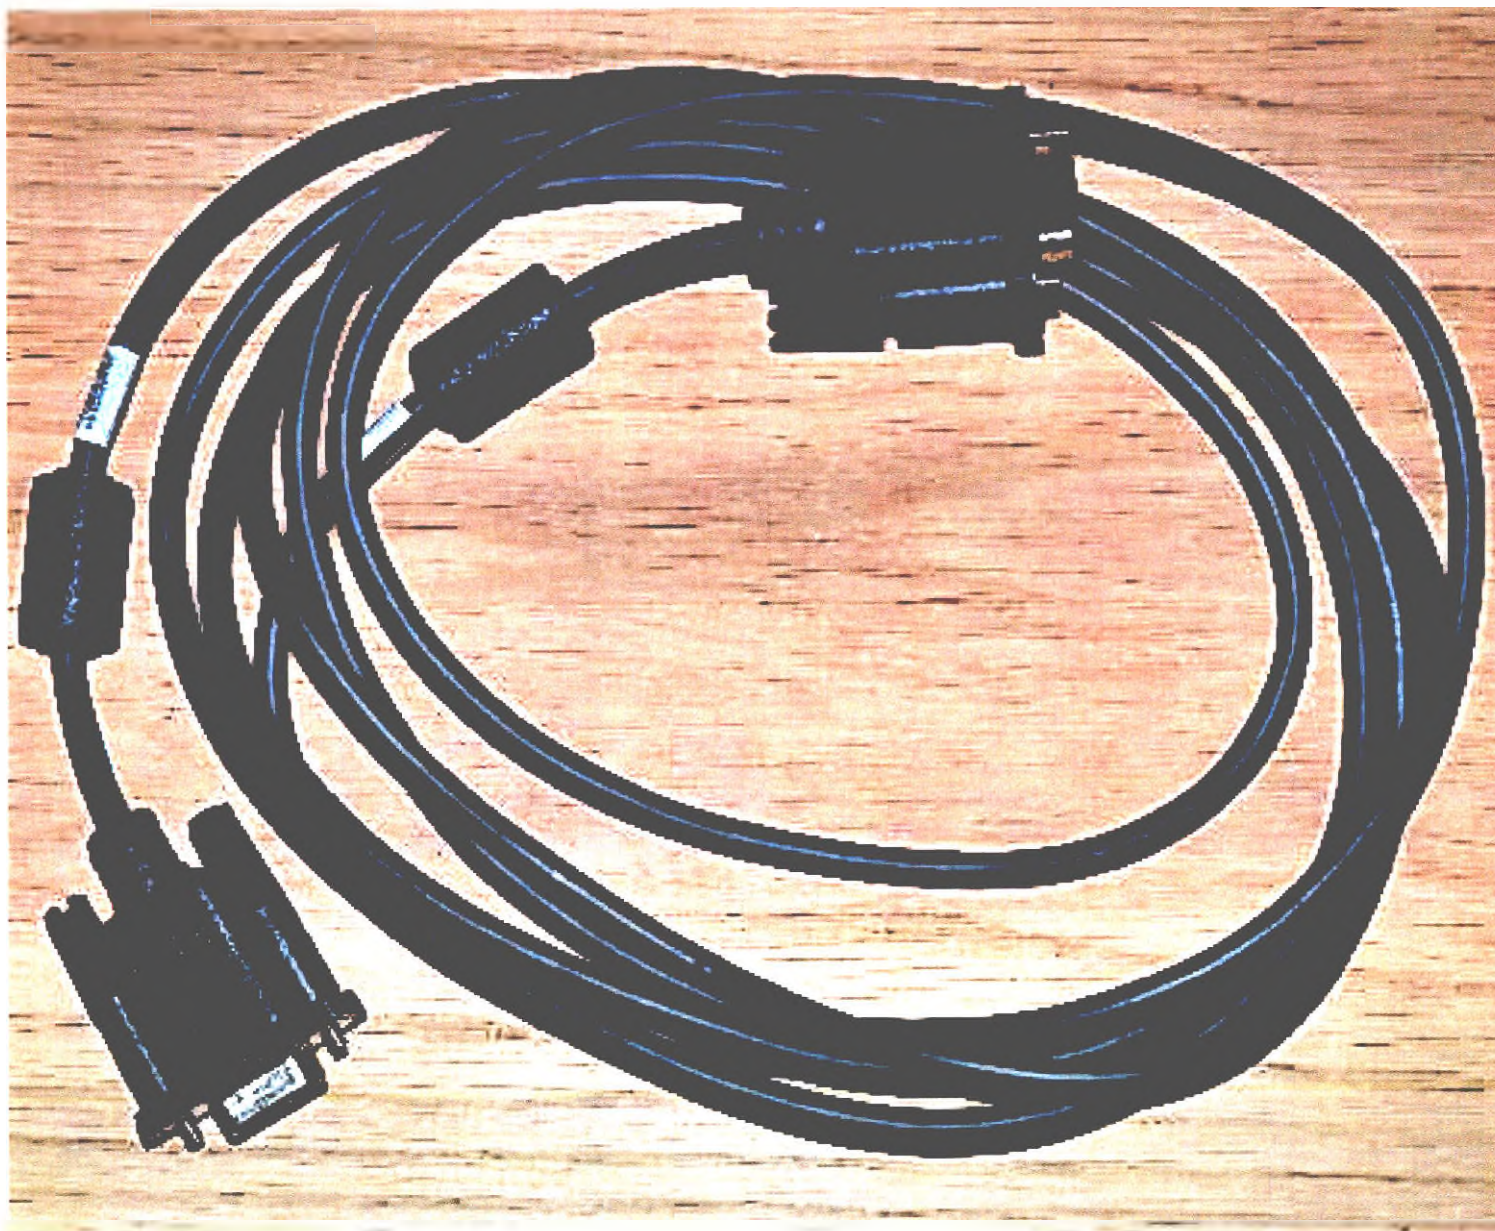


6. Кабель сетевой для соединения с компьютером, не более 2 штук


Принадлежности:

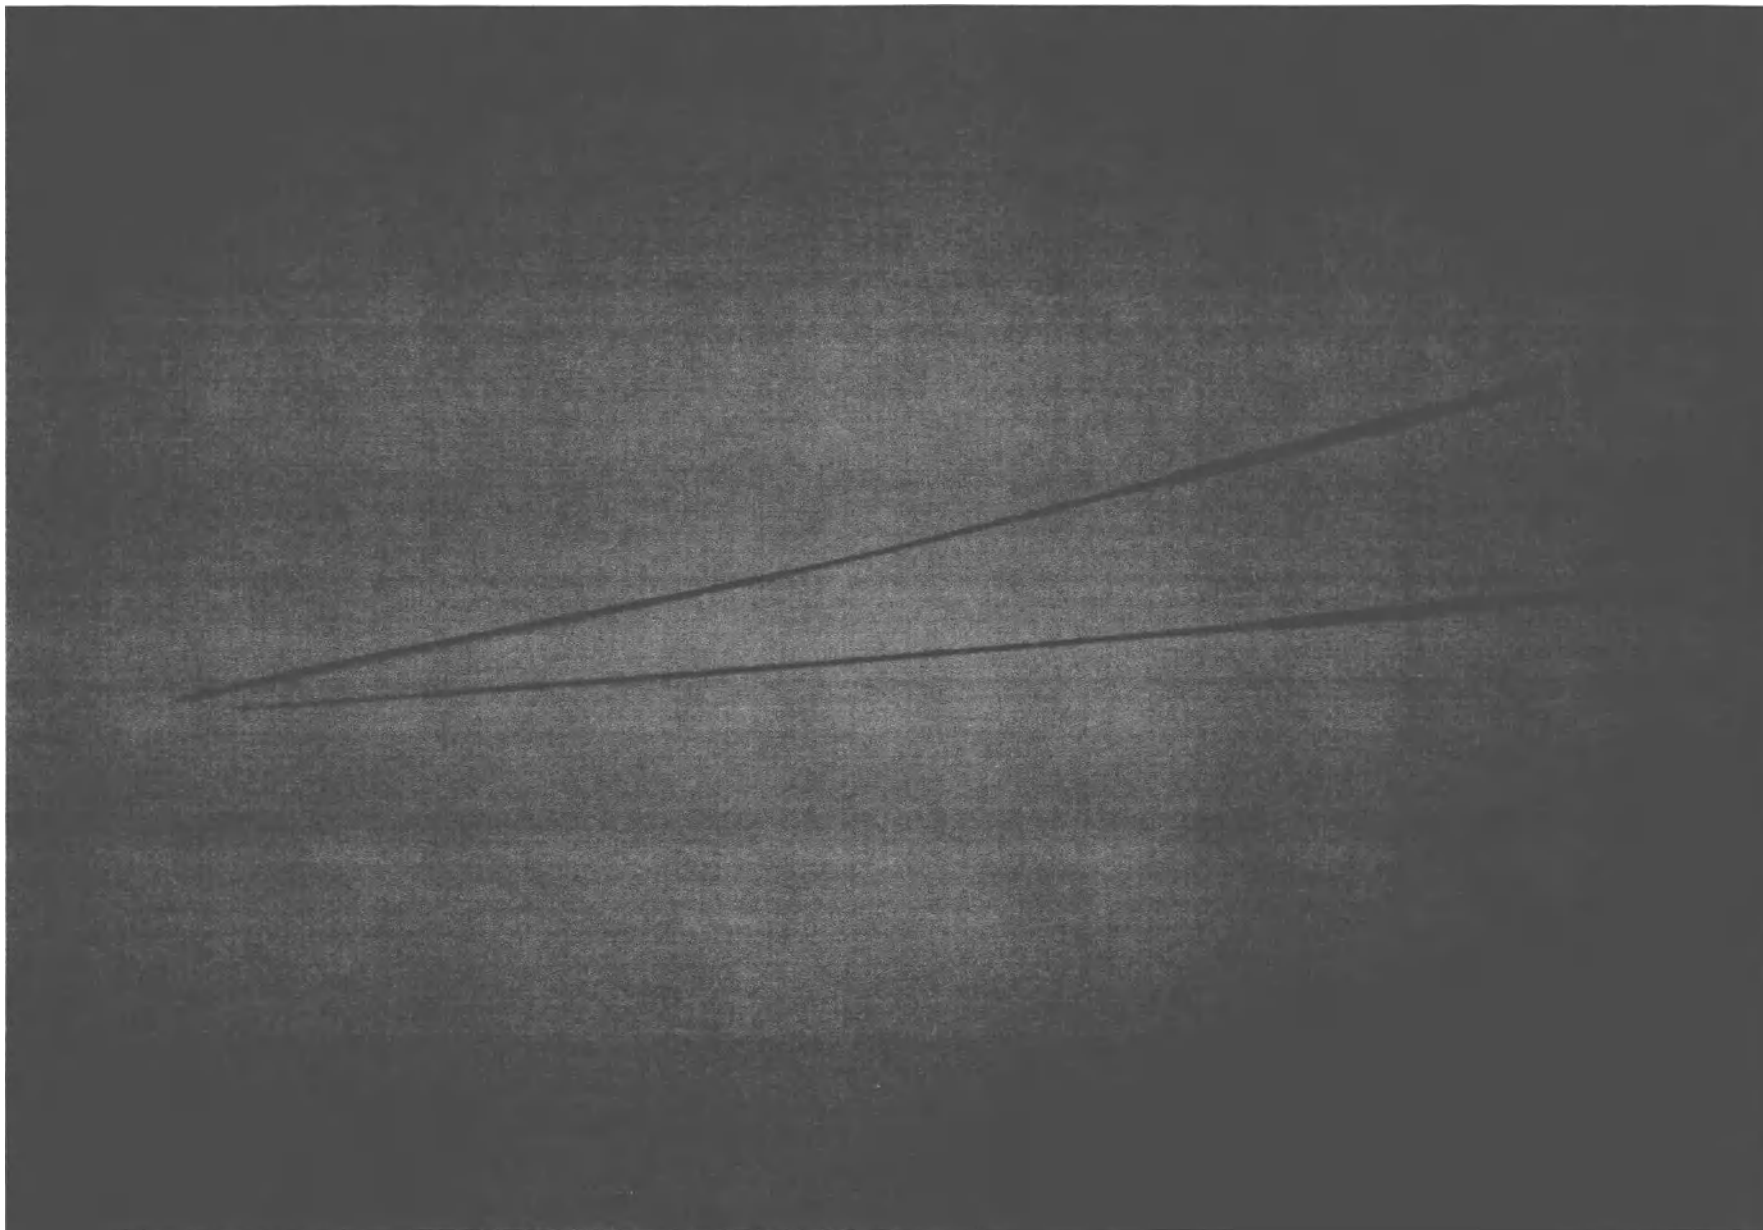

1. Инструмент очистки, не более 4 штук

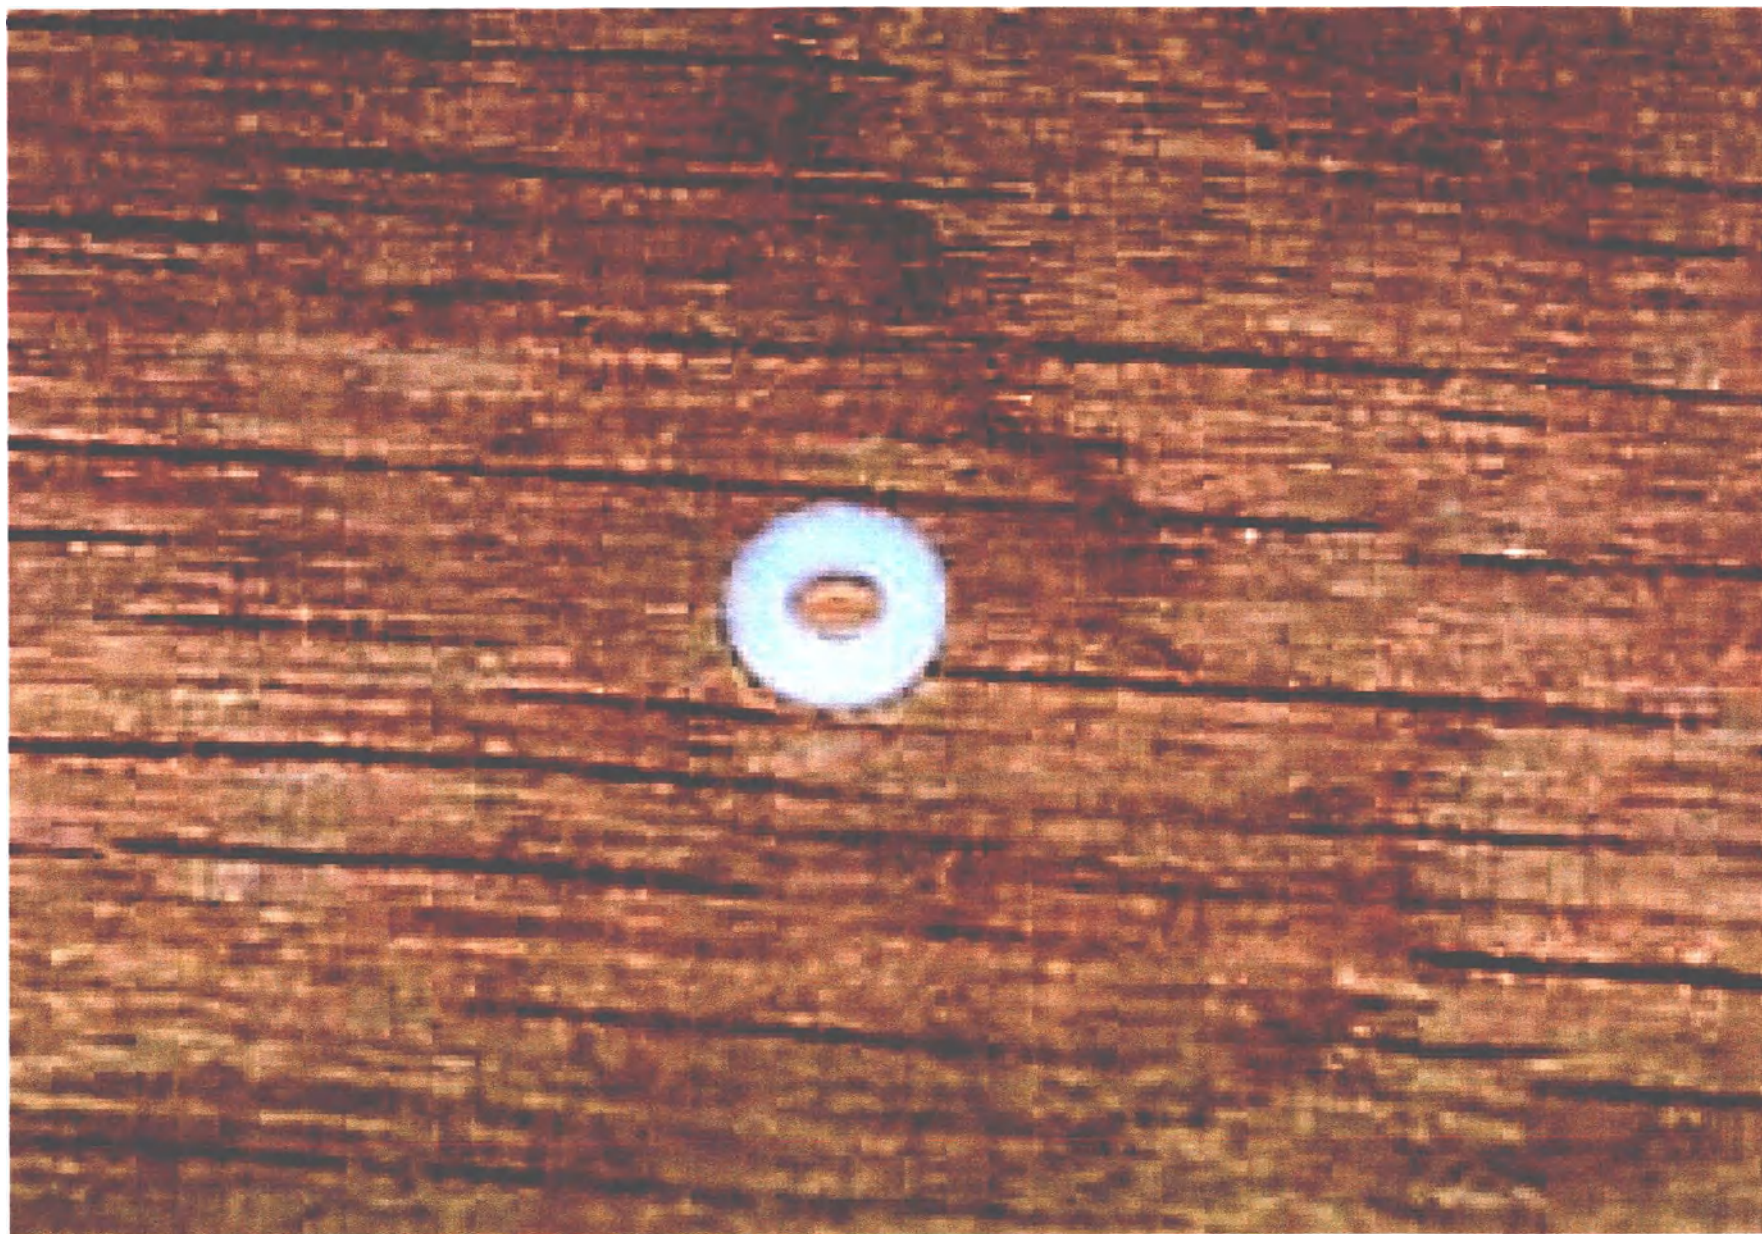

2. Прокладка для промывающей станции дозатора, не более 3 штук

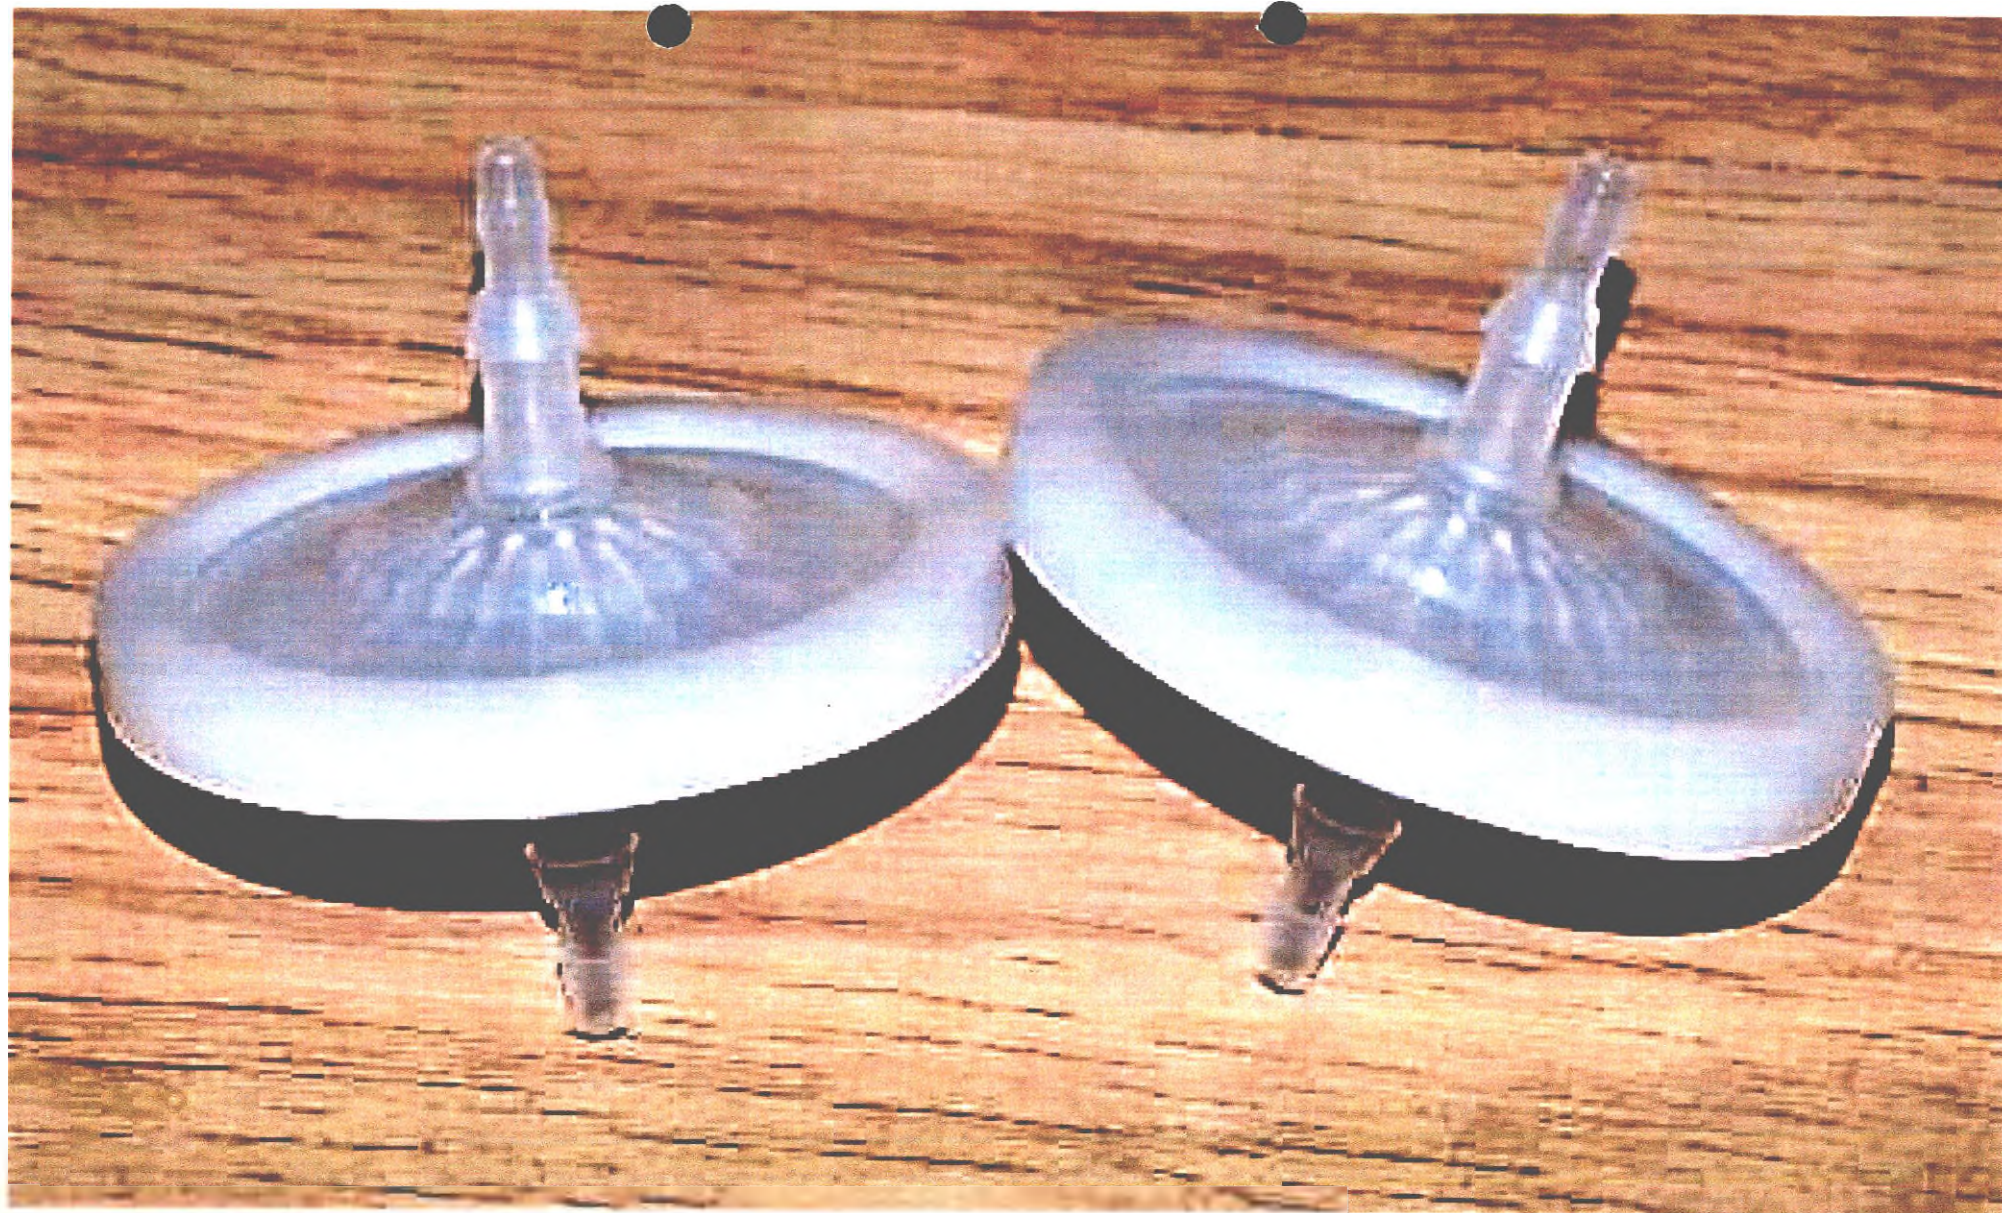


3. Фильтр, не более 4 штук



4. Канистра пластиковая для отходов, не более 4 штук




5. Канистра для воды, не более 2 штук

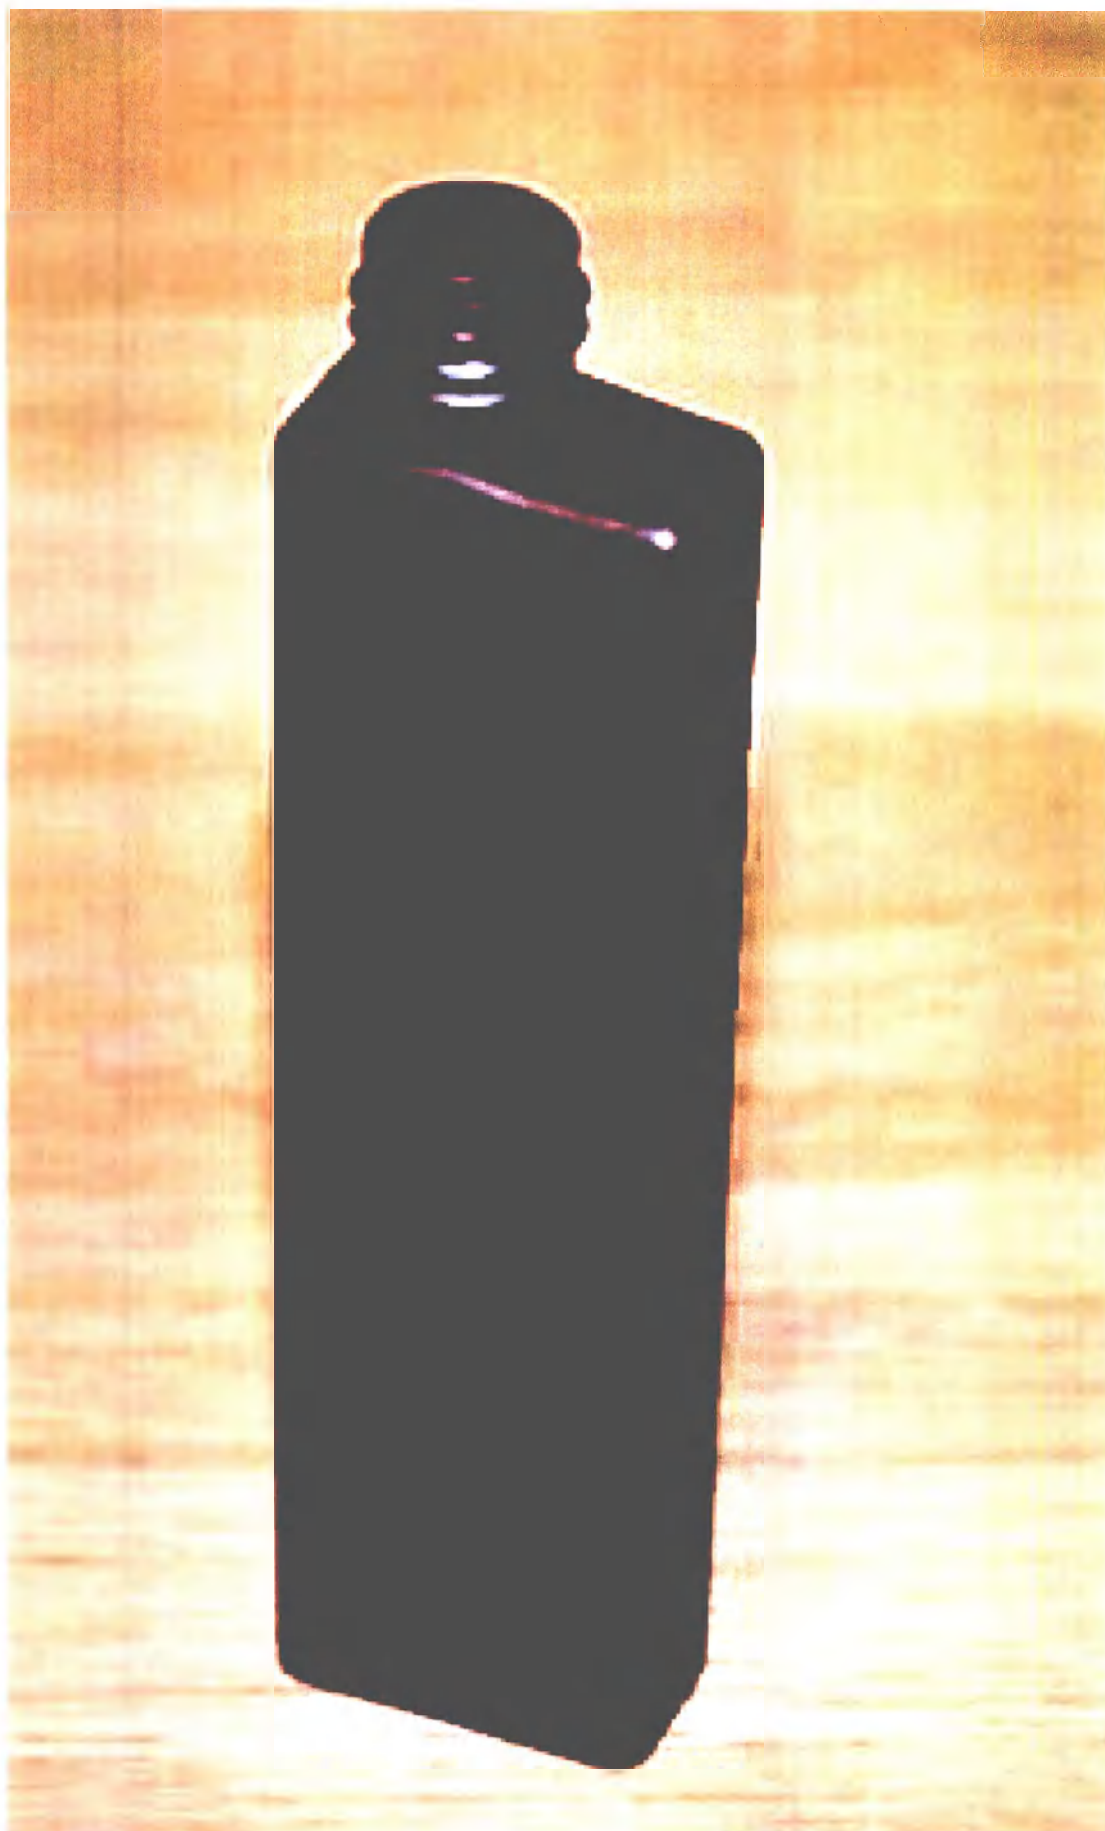


6. Флакон реагента, 20 мл, не более 50 штук




7. Флакон реагента, 40 мл, не более 50 штук

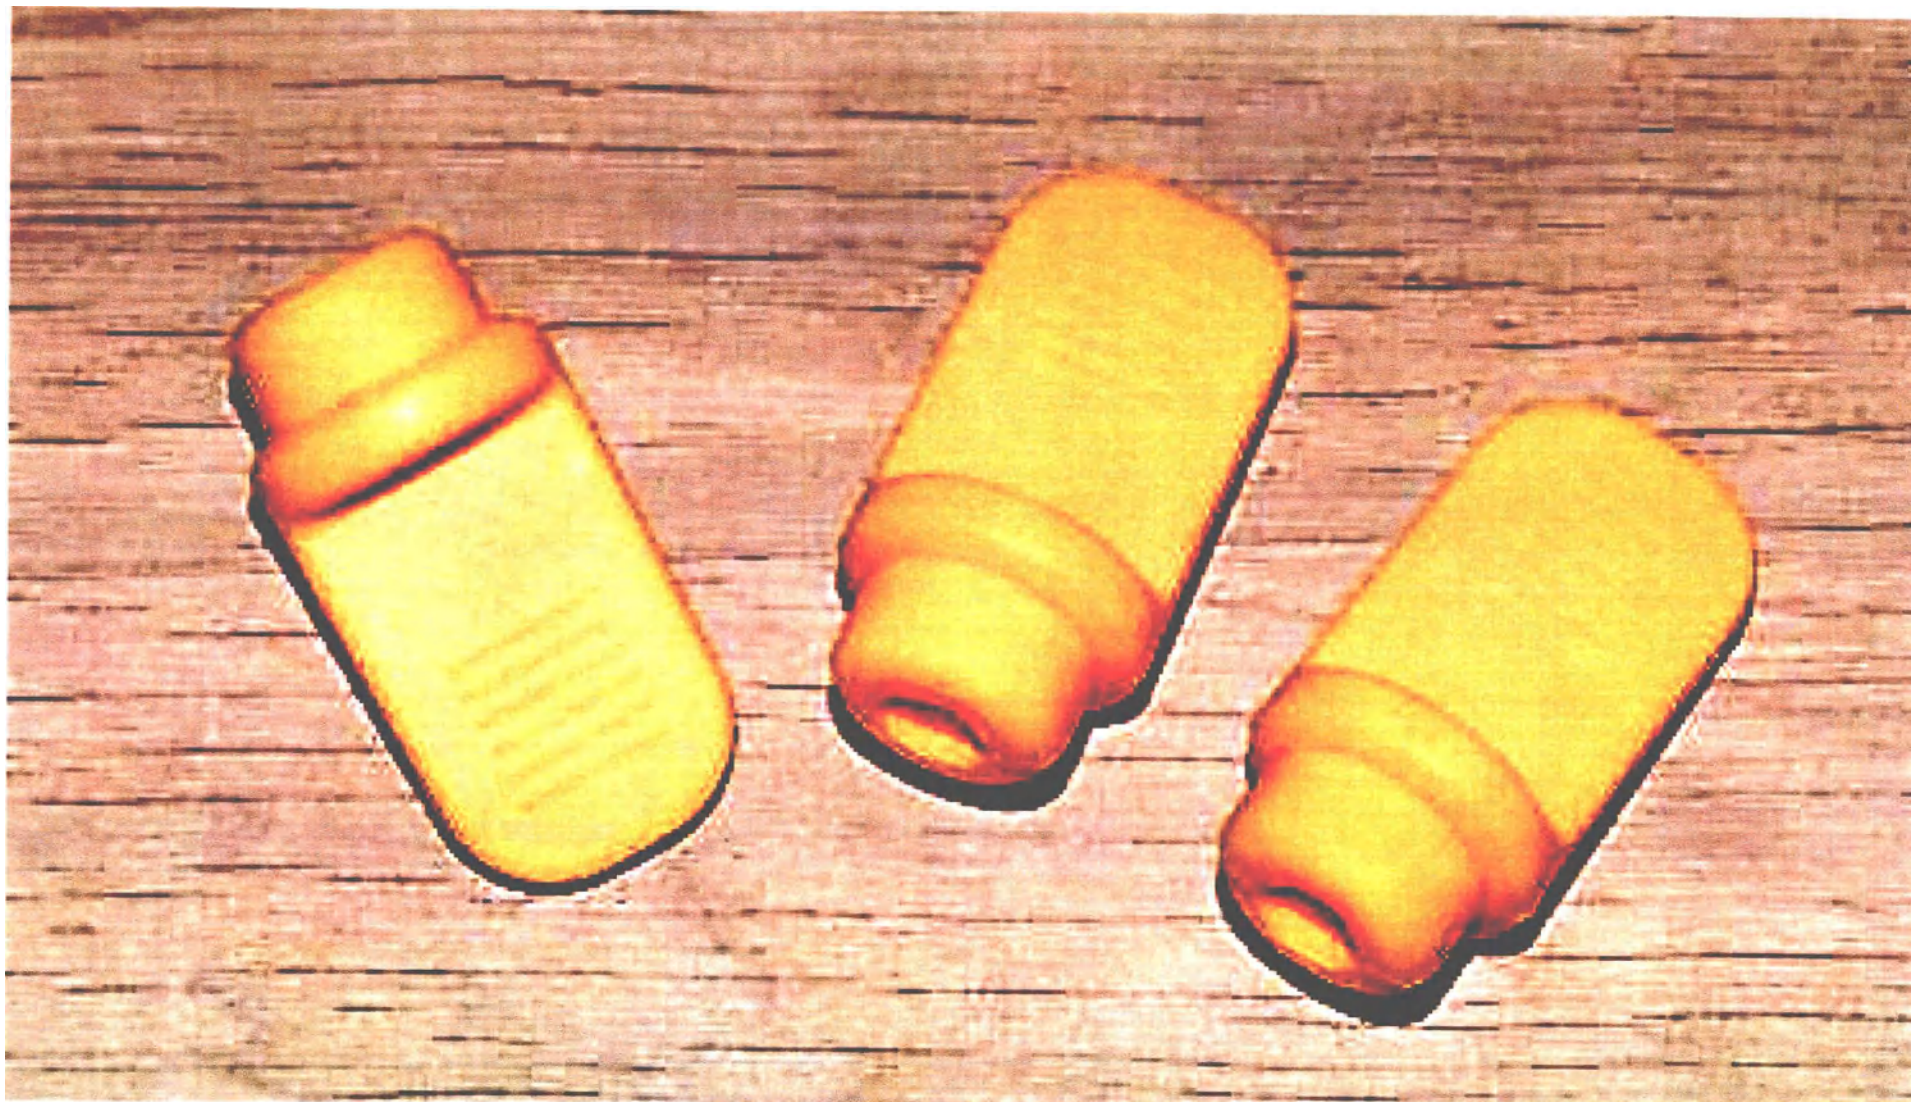

8. Заглушка пластиковая, не более 3 штук

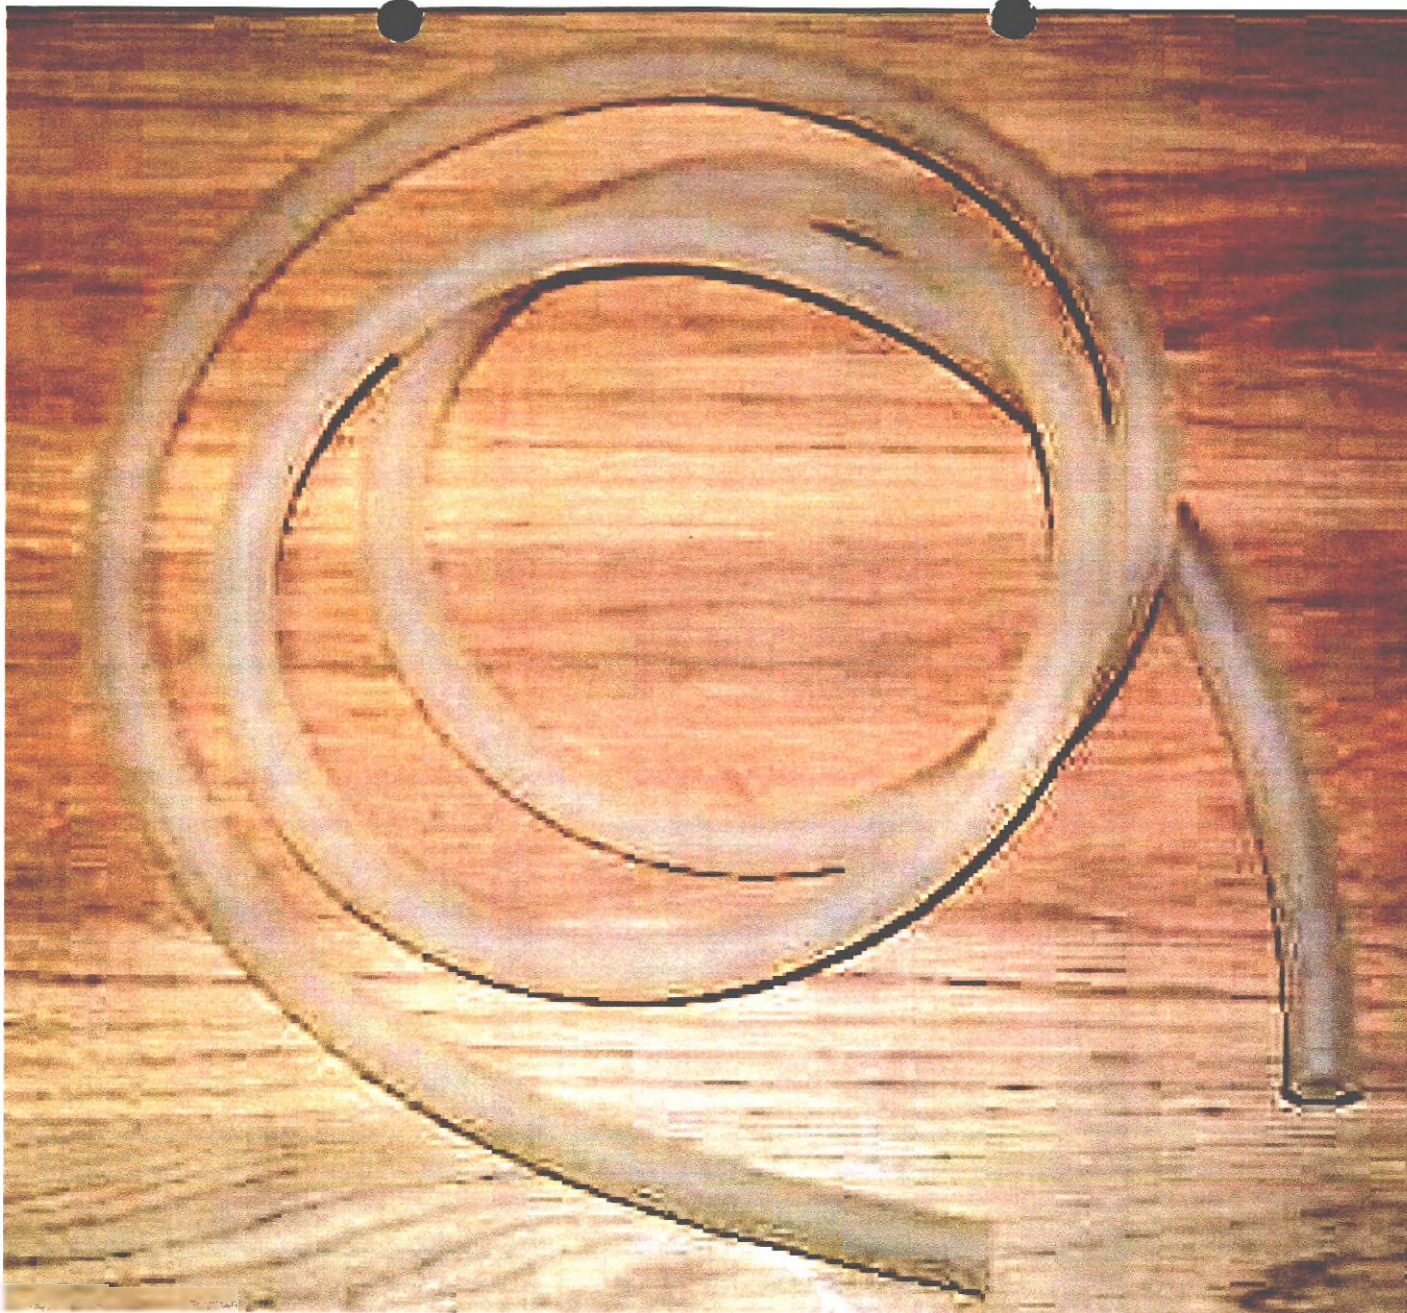


9. Трубка соединительная, не более 6 штук

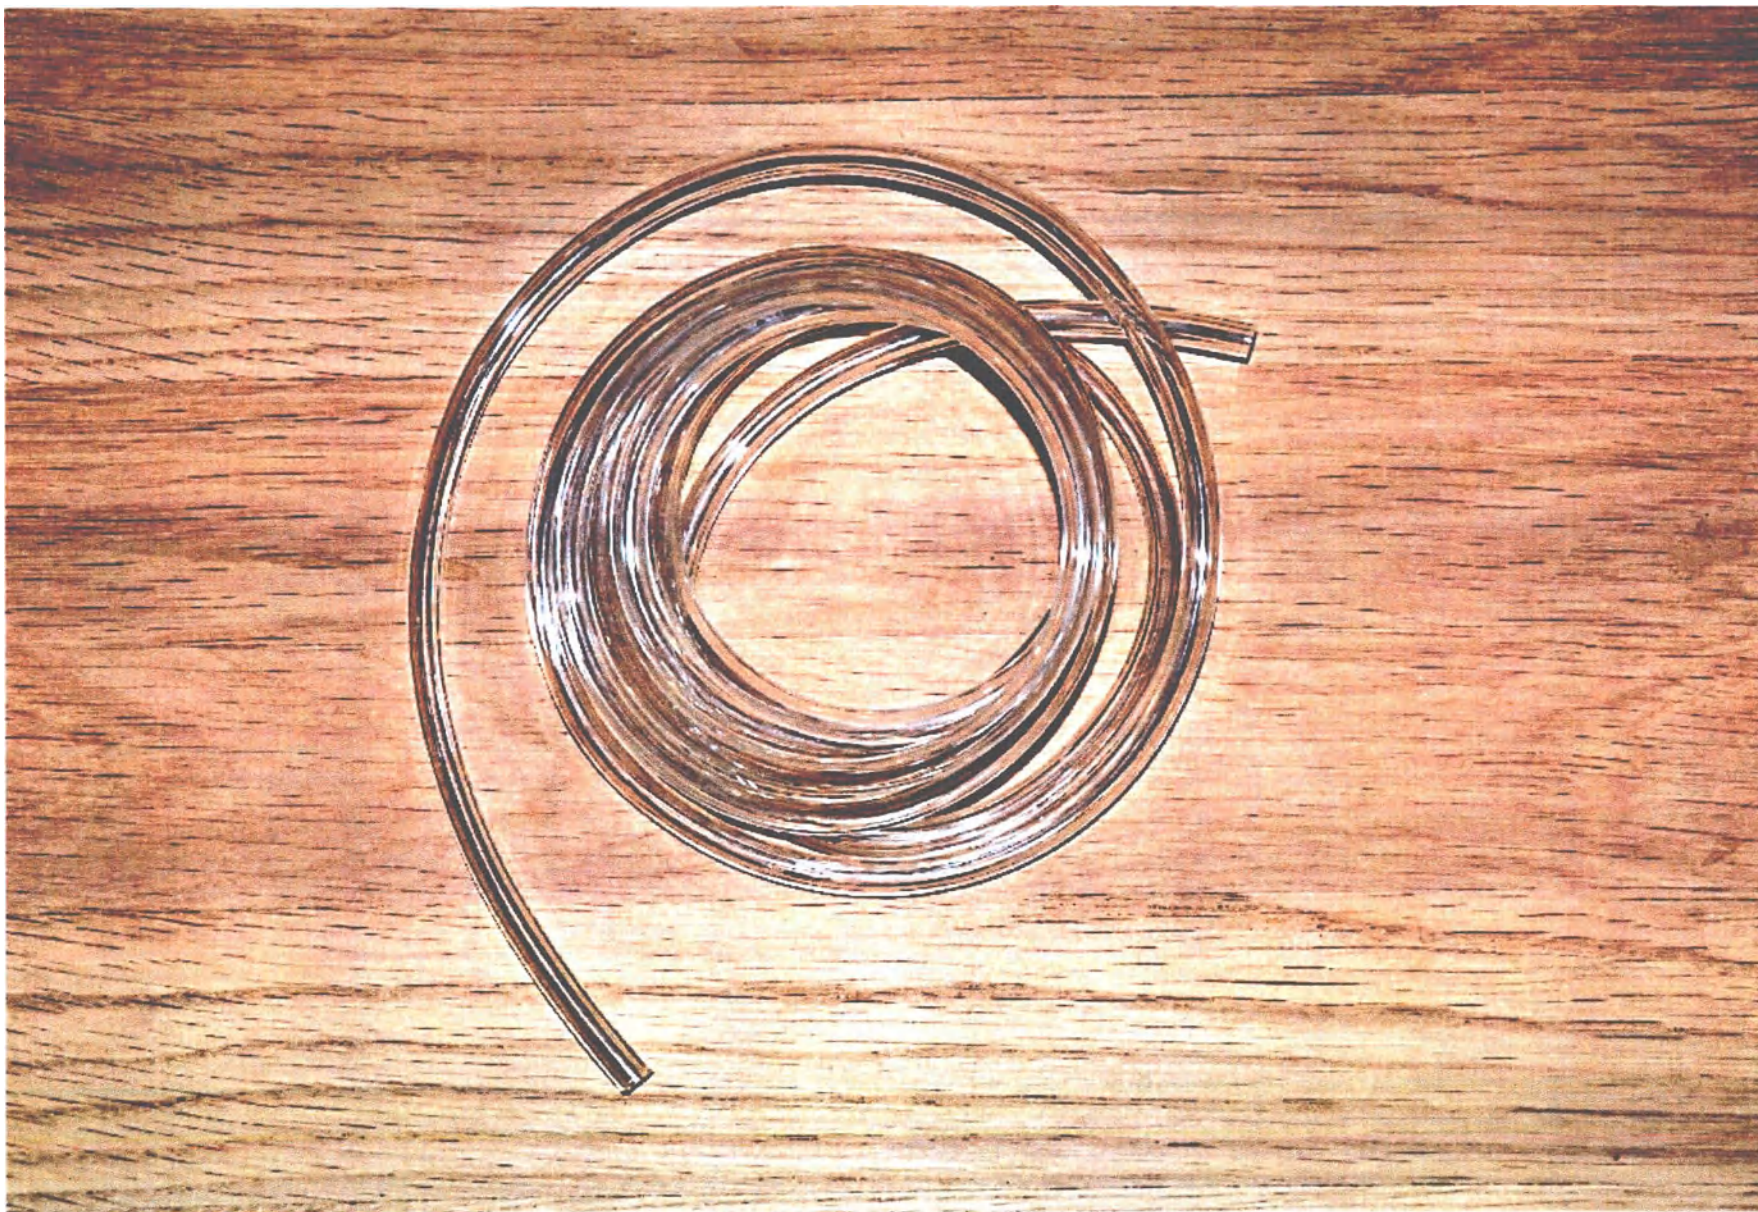


10.Трубка 3,2х6,4 мм, не более 2 штук




11.Сегмент реакционных кювет, не более 5 штук

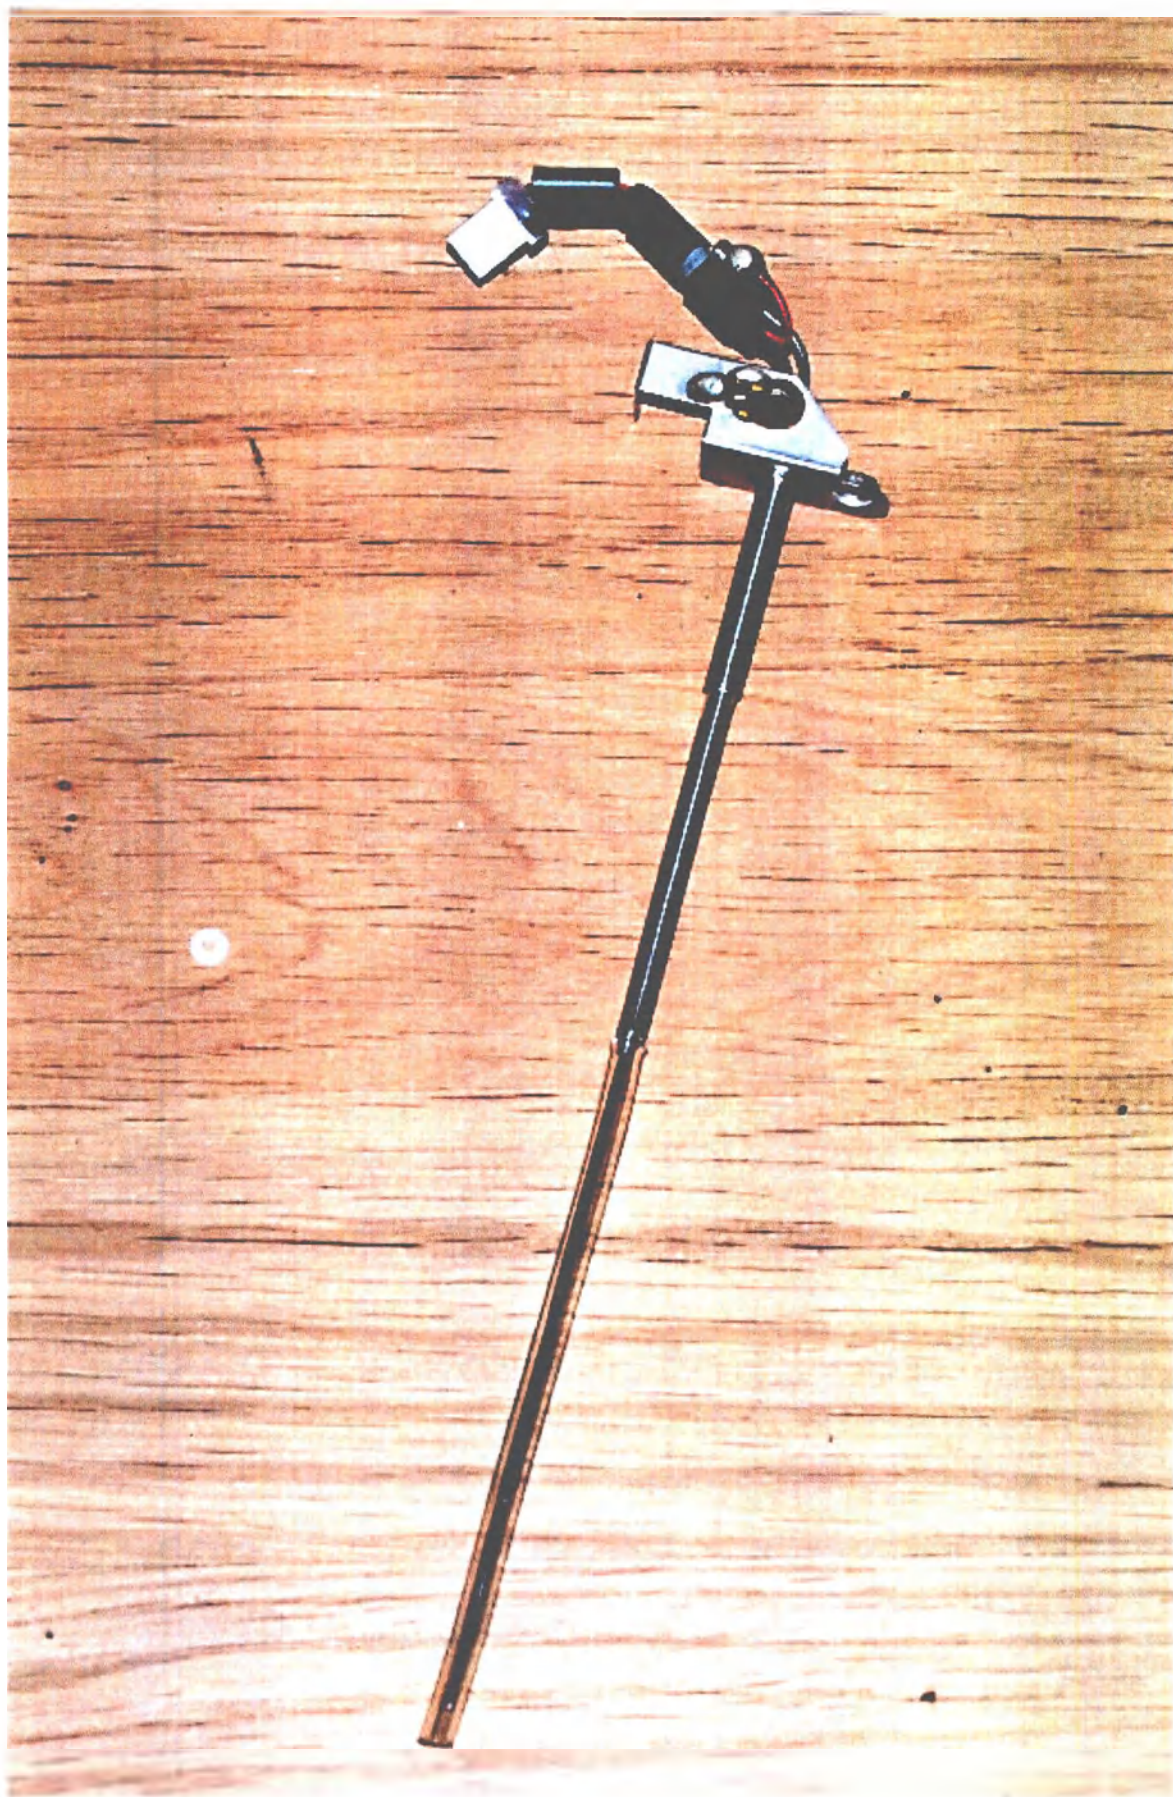


12. Дозатор в сборе, не более 3 штук

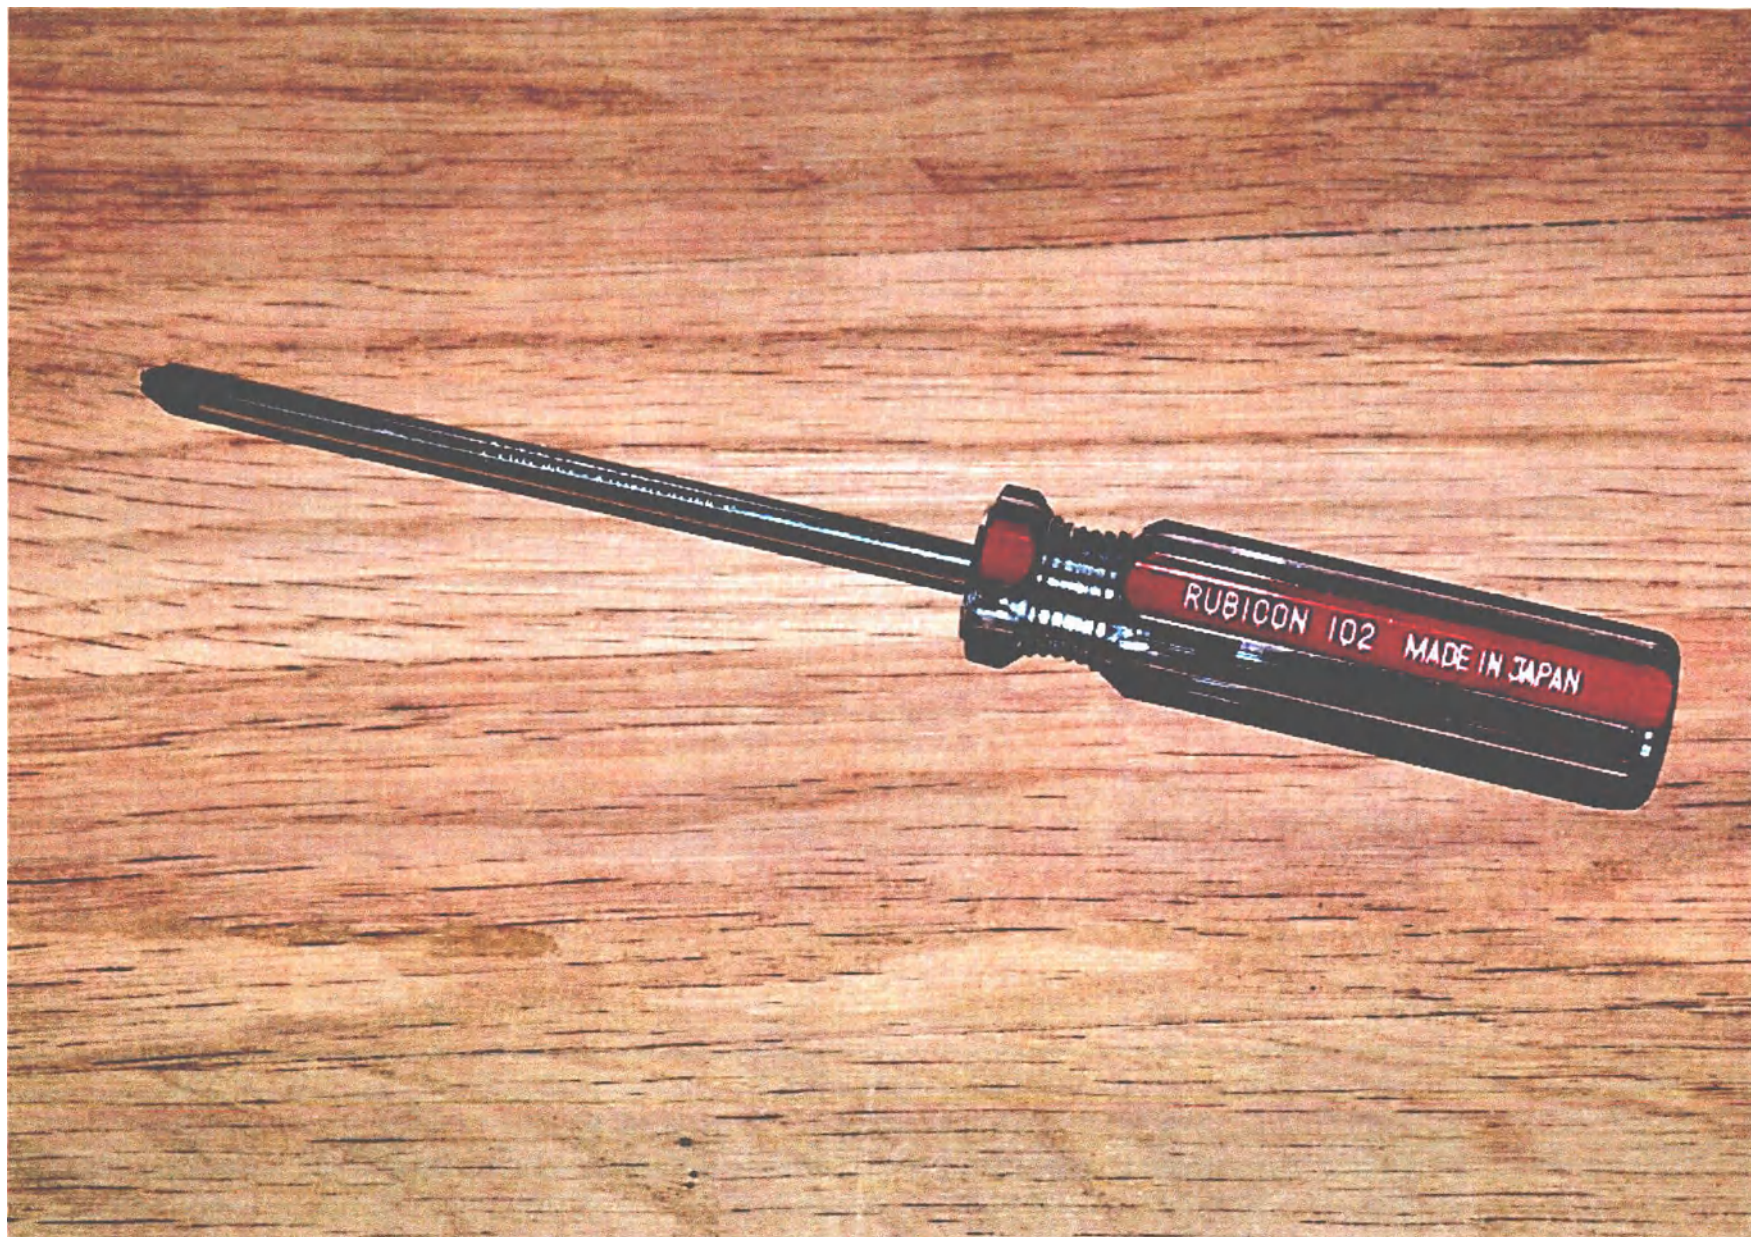

13.Отвертка, не более 2 штук

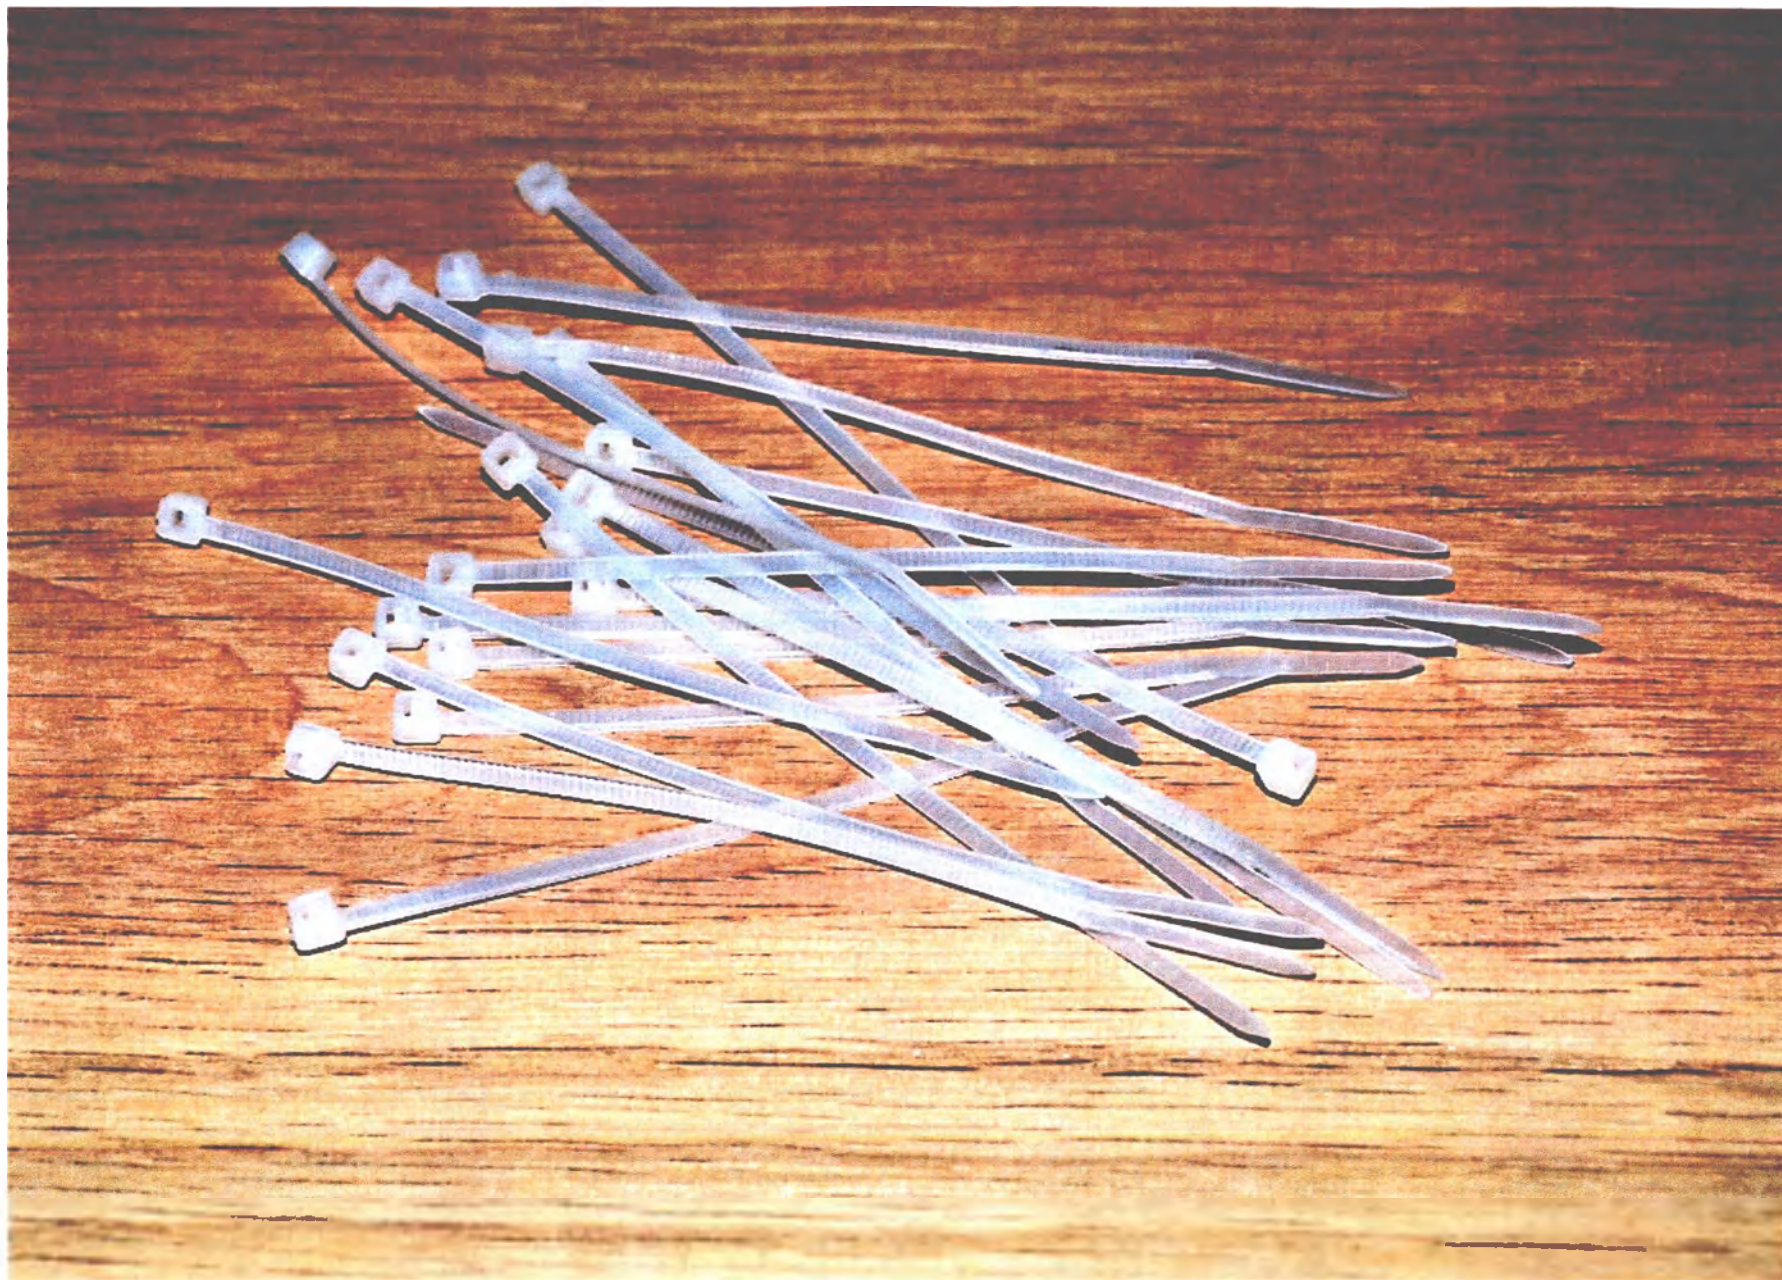


14. Стяжки кабельные, не более 50 штук

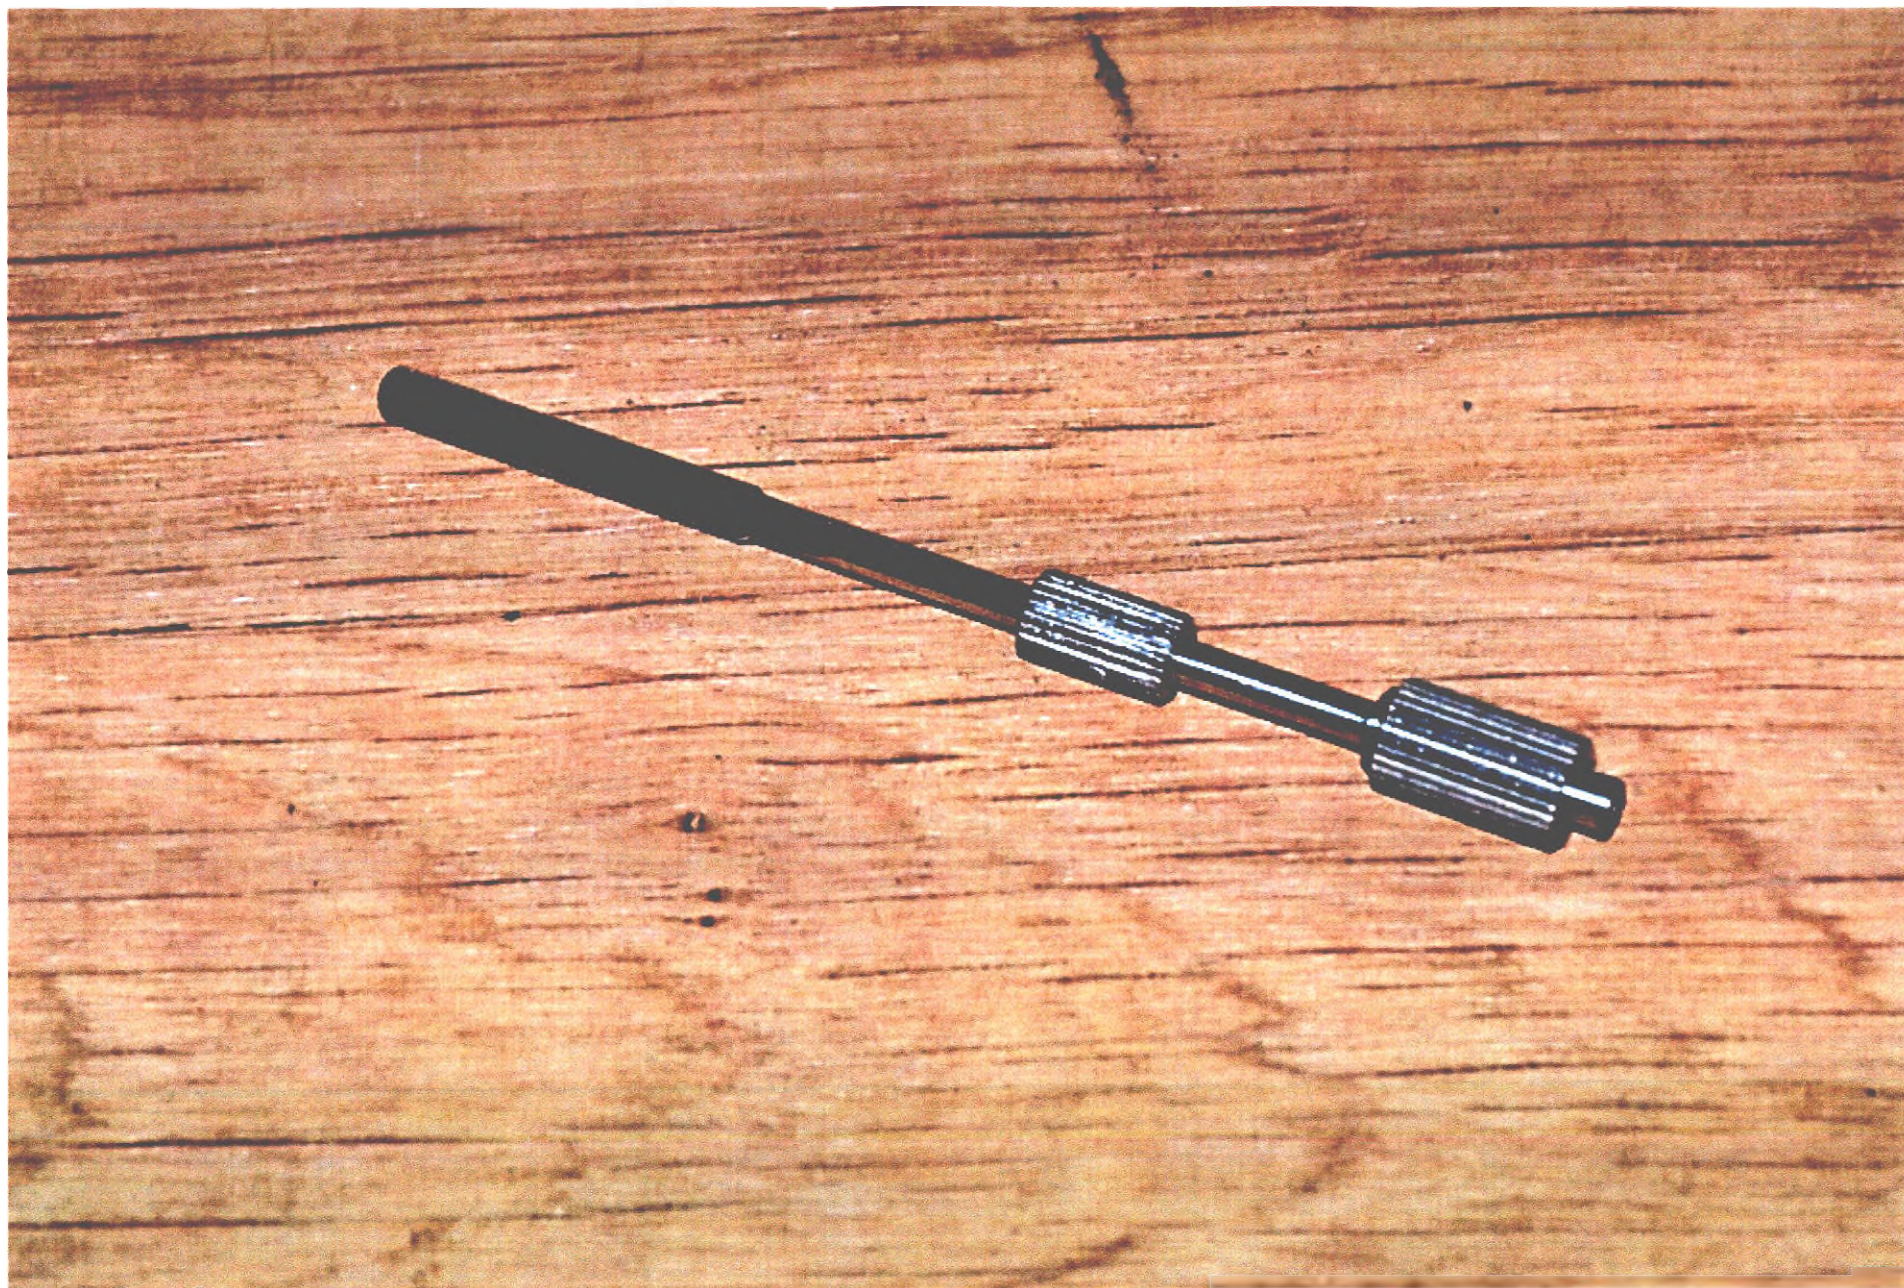


15. Гайка стопорная (для миксера), не более 5 штук



17. Крышки флаконов реагентов, не более 100 штук

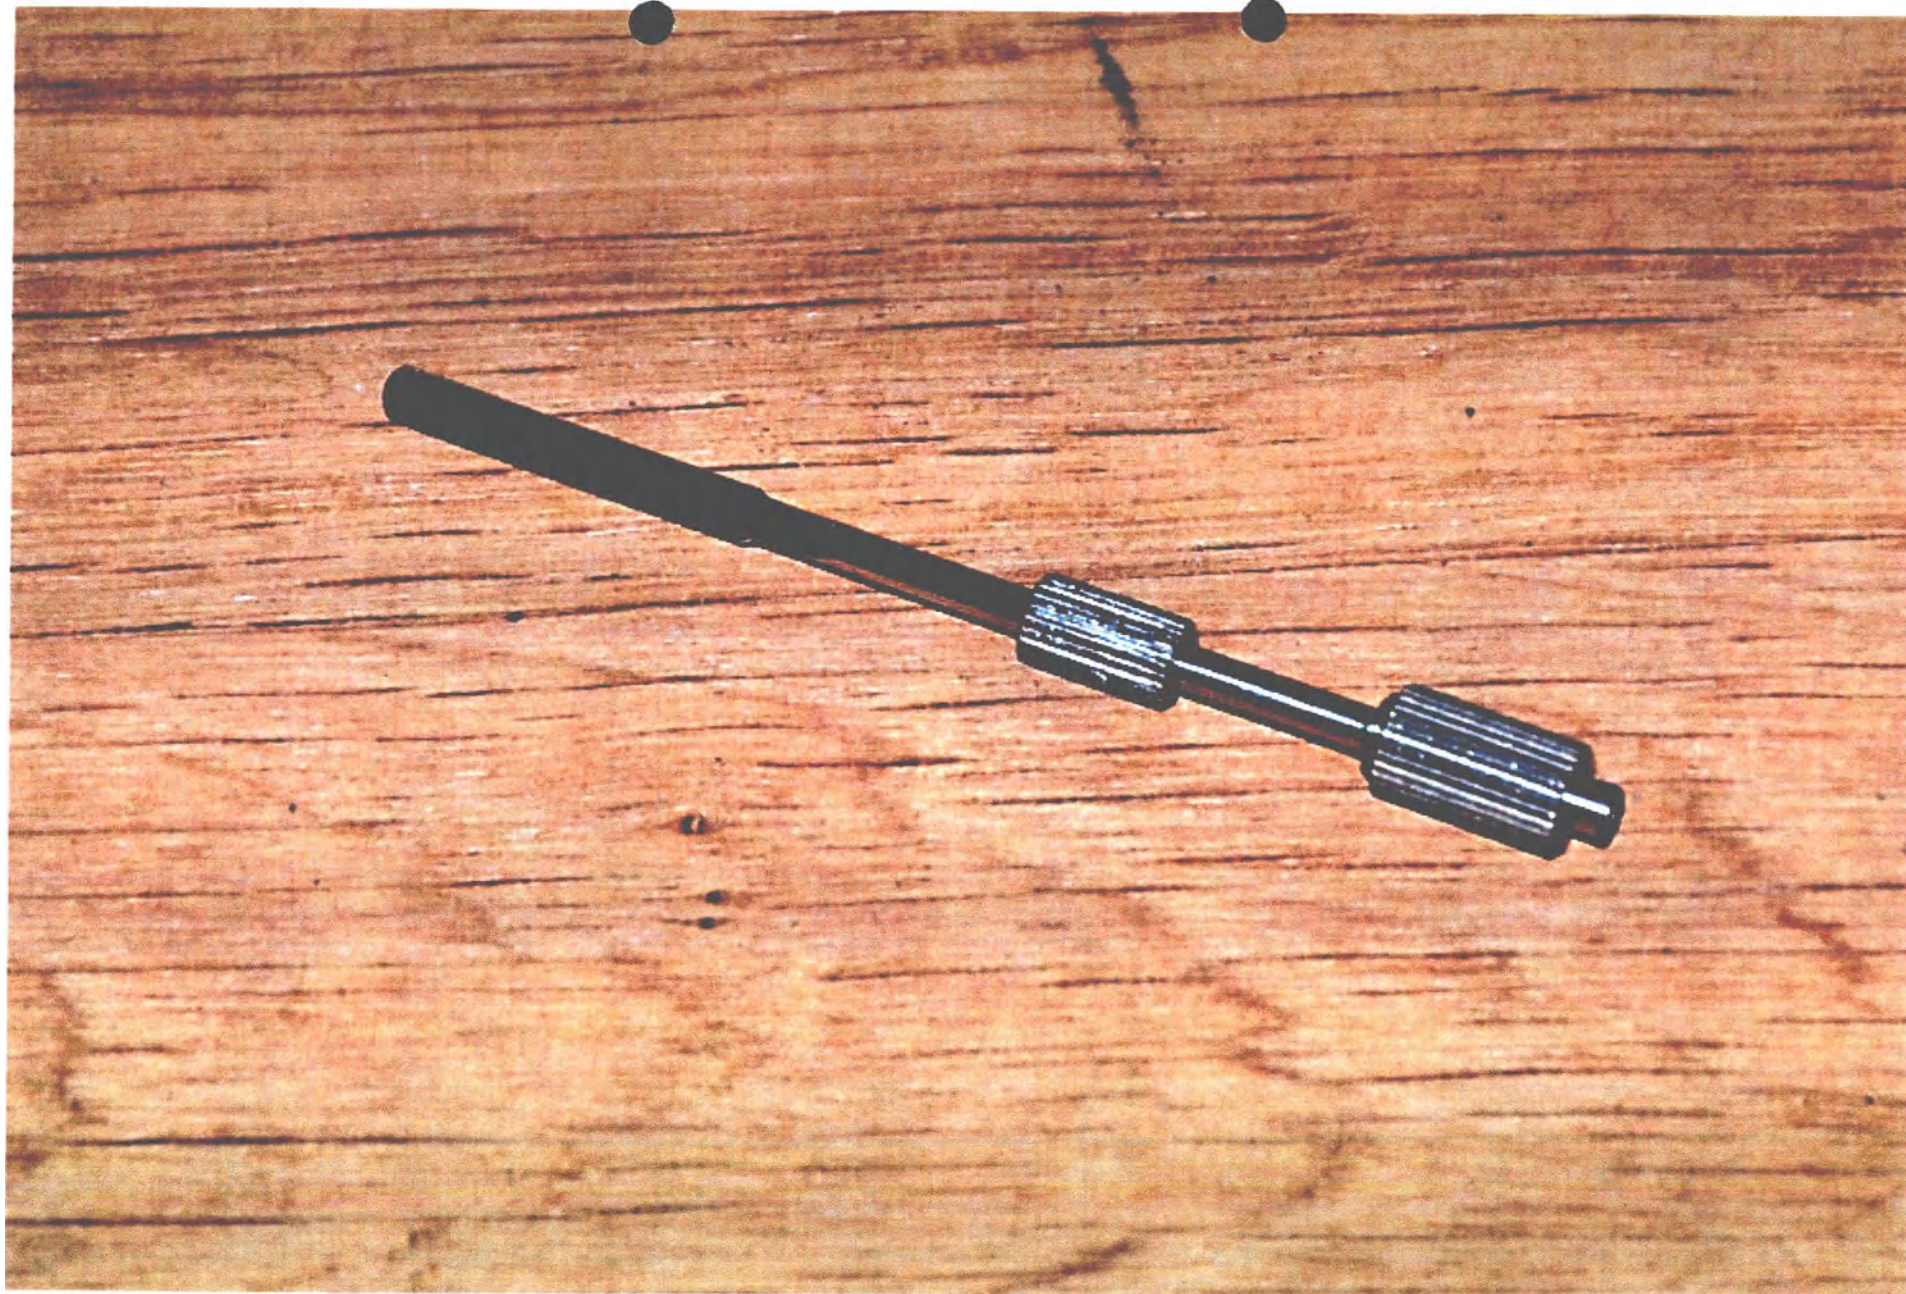

18.Миксер, не более 2 штук

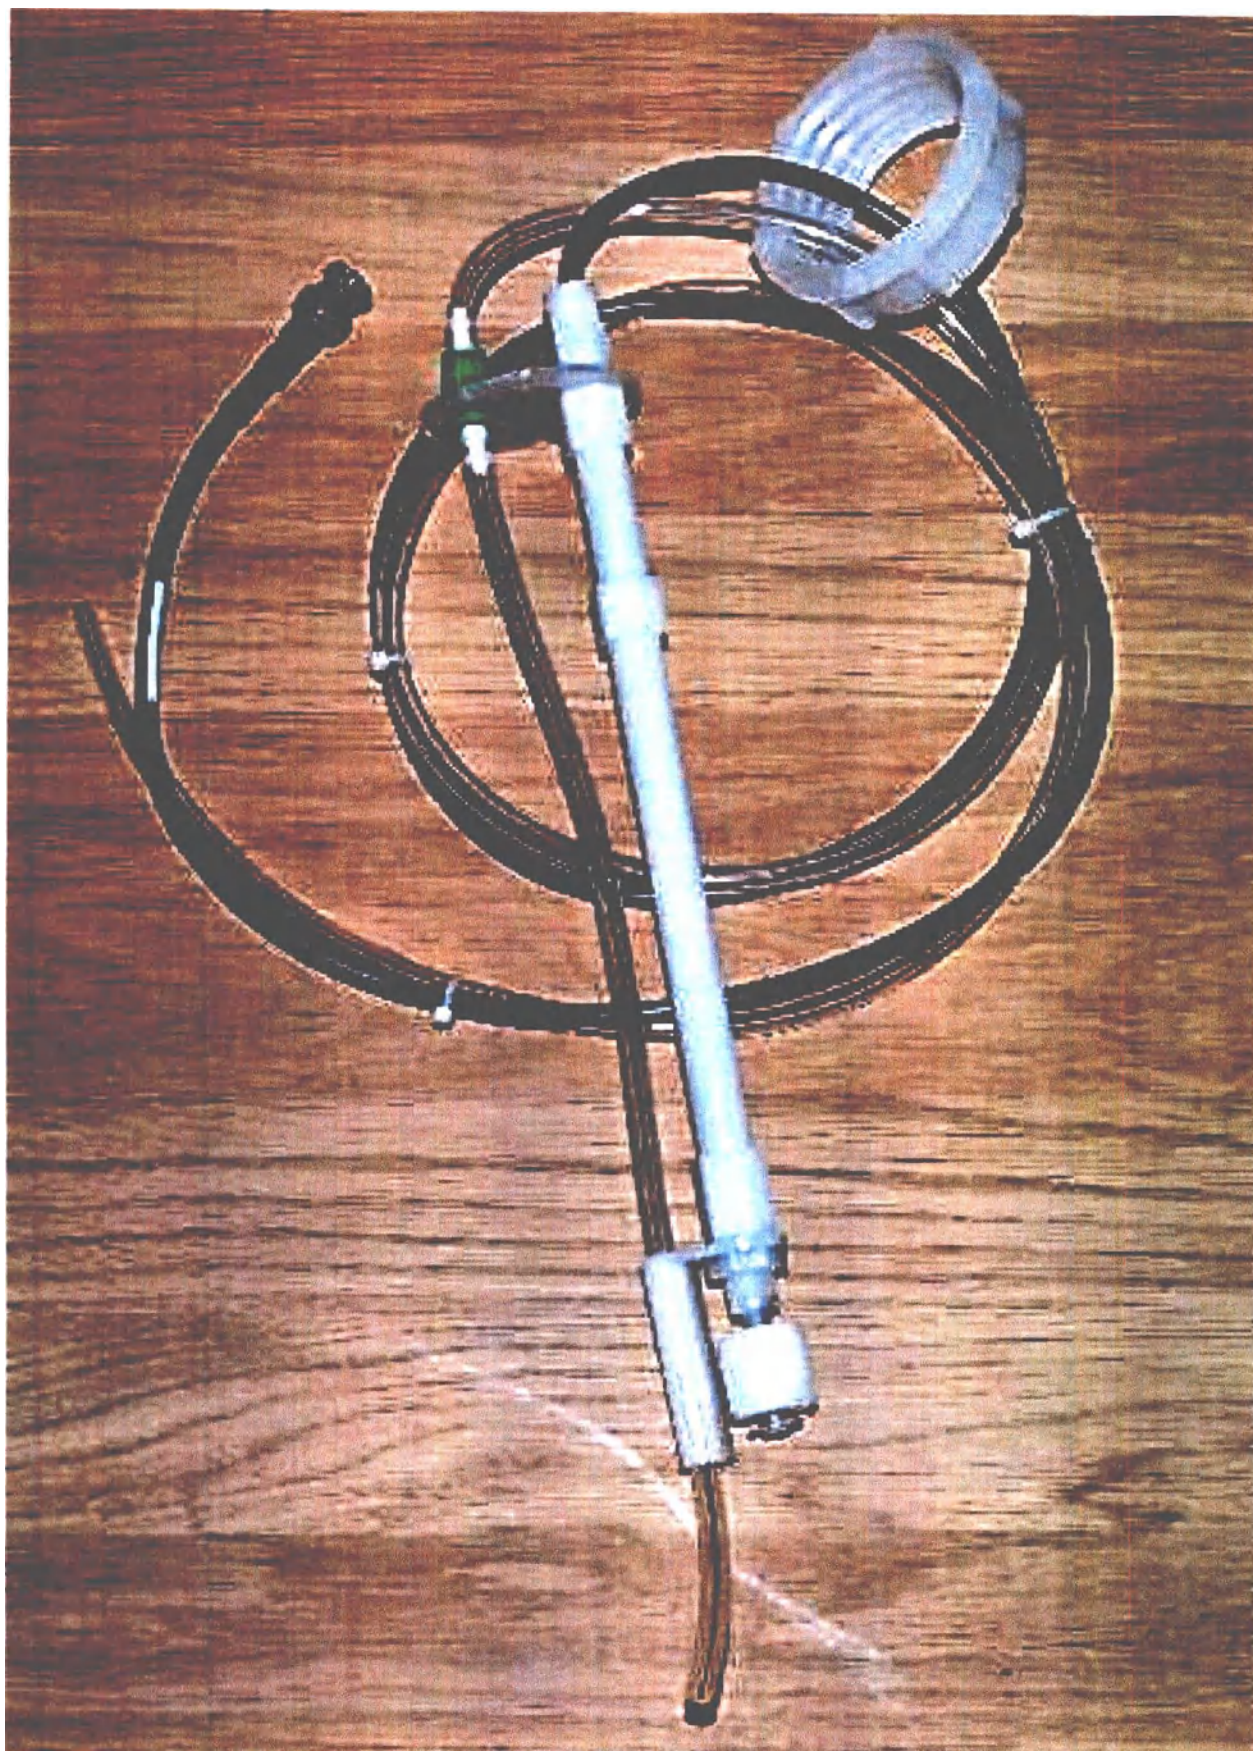

19. Крышка канистры для воды в сборе, не более 4 штук



20. Крышка канистры для отходов в сборе, не более 2 штук

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
51 листа (ов)

