

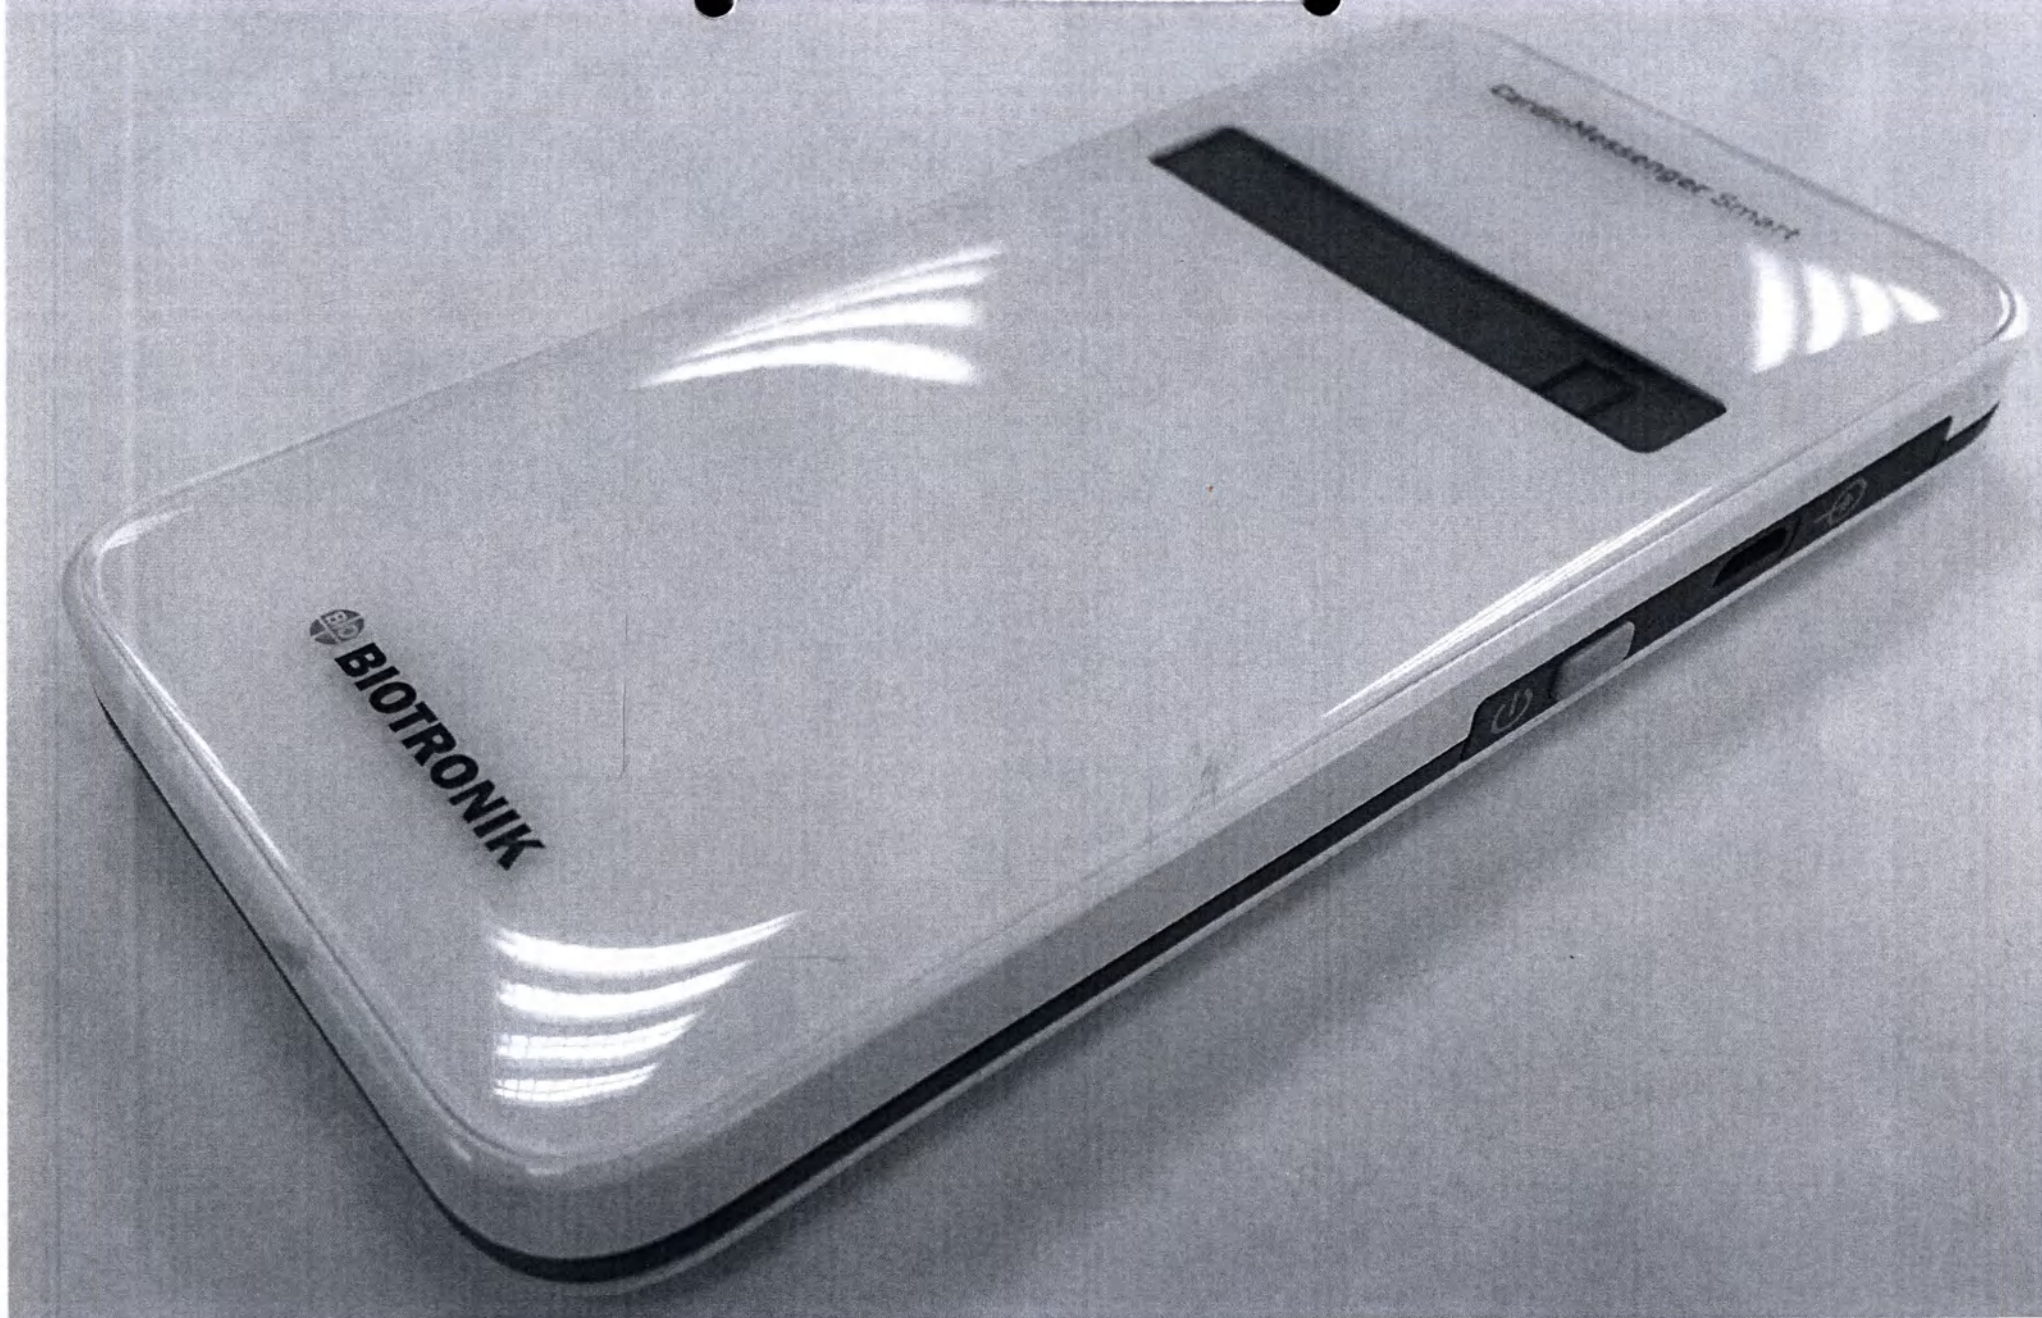


Фото 1. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:
Устройство CardioMessenger Smart 3G – лицевая сторона

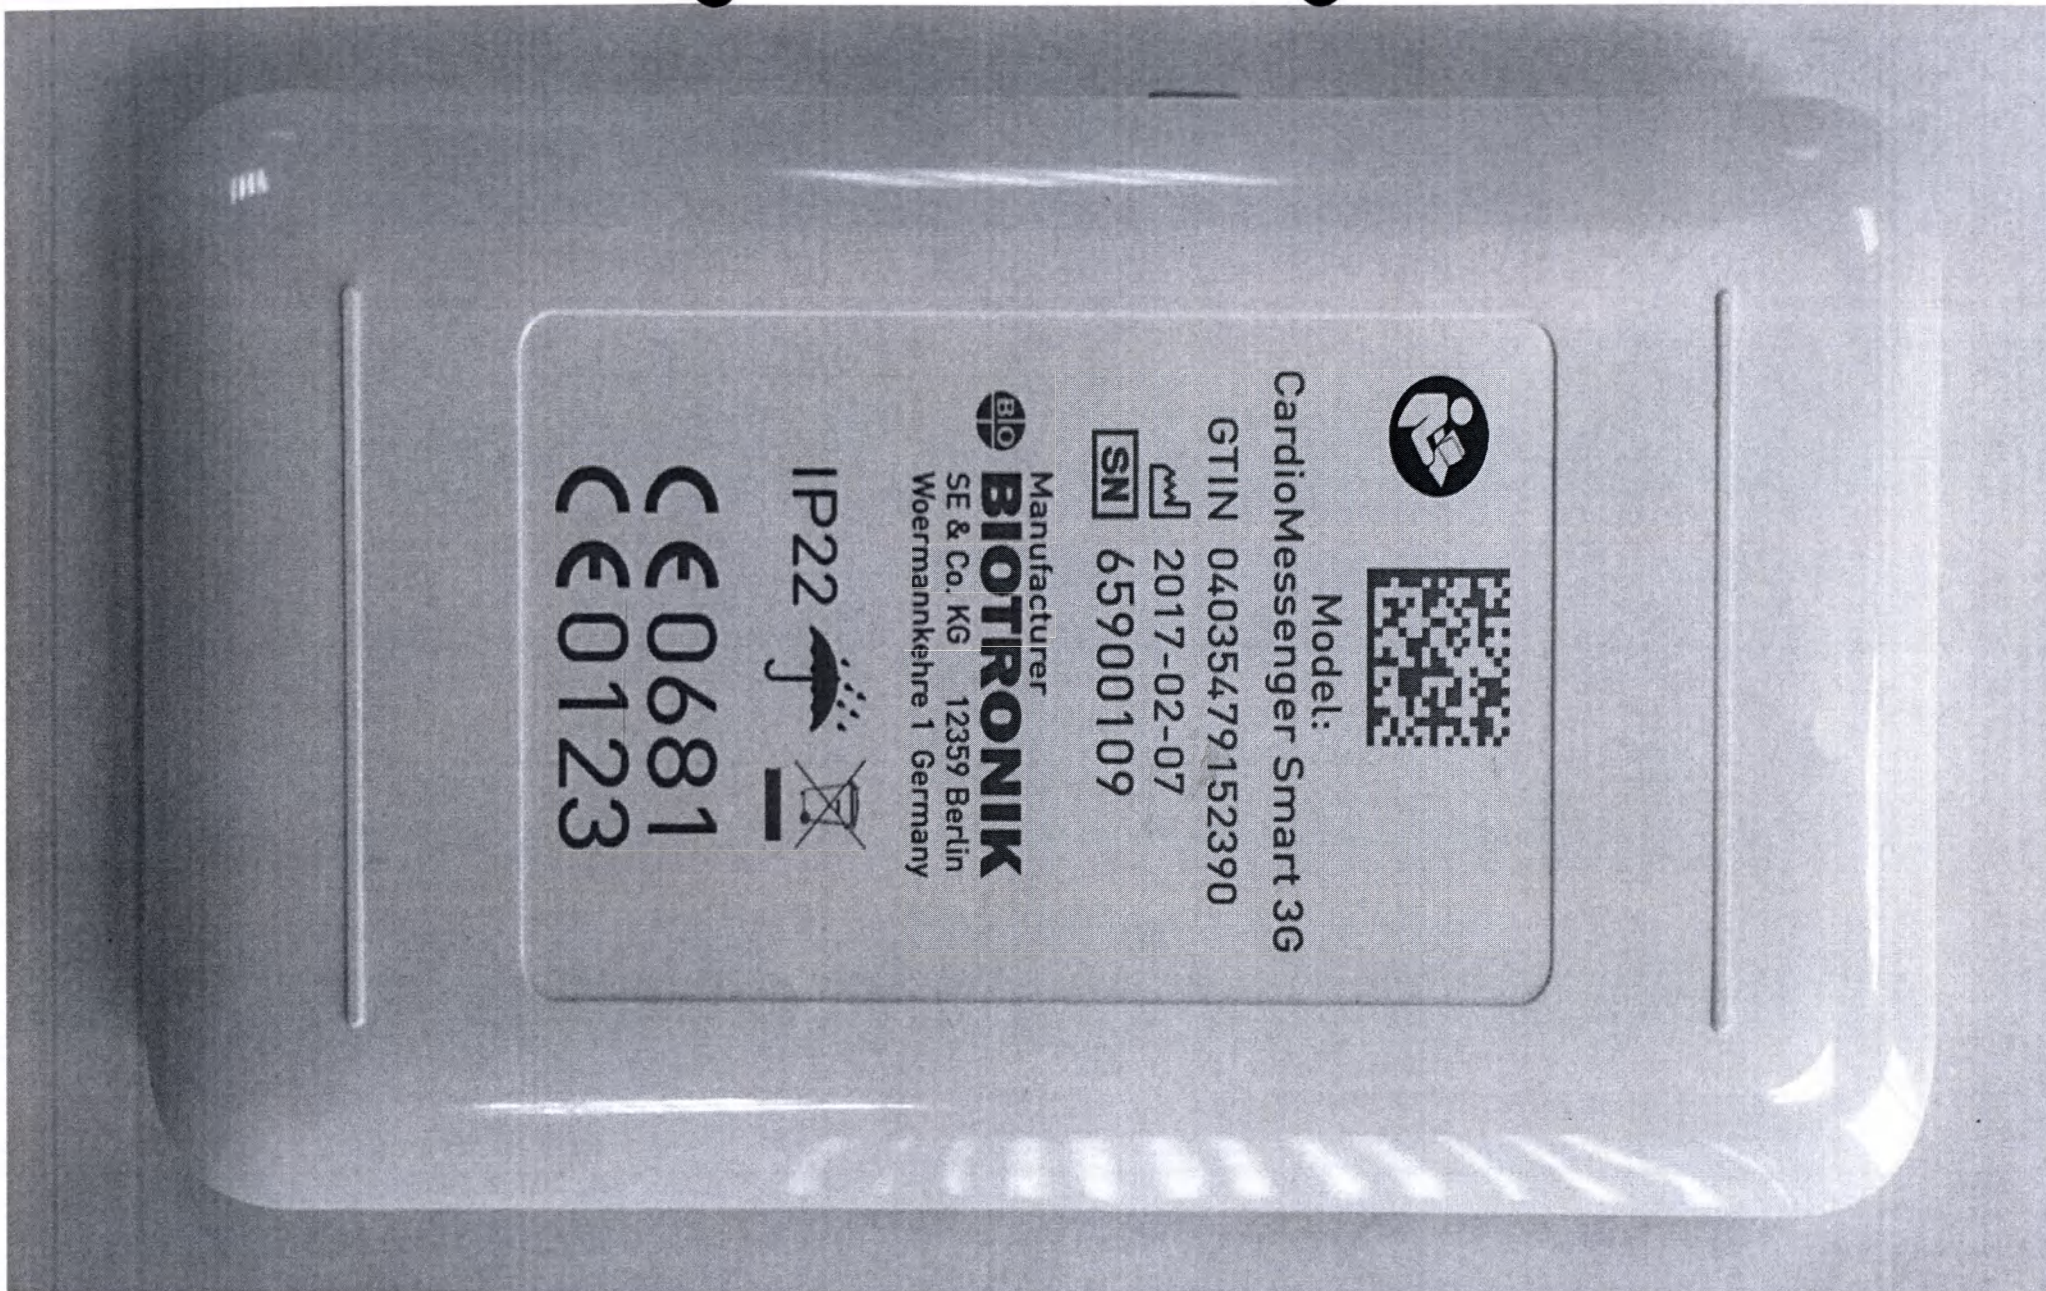


Фото 2. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:

Устройство CardioMessenger Smart 3G – обратная сторона



Фото 3. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:
Блок питания с кабелем и штекером

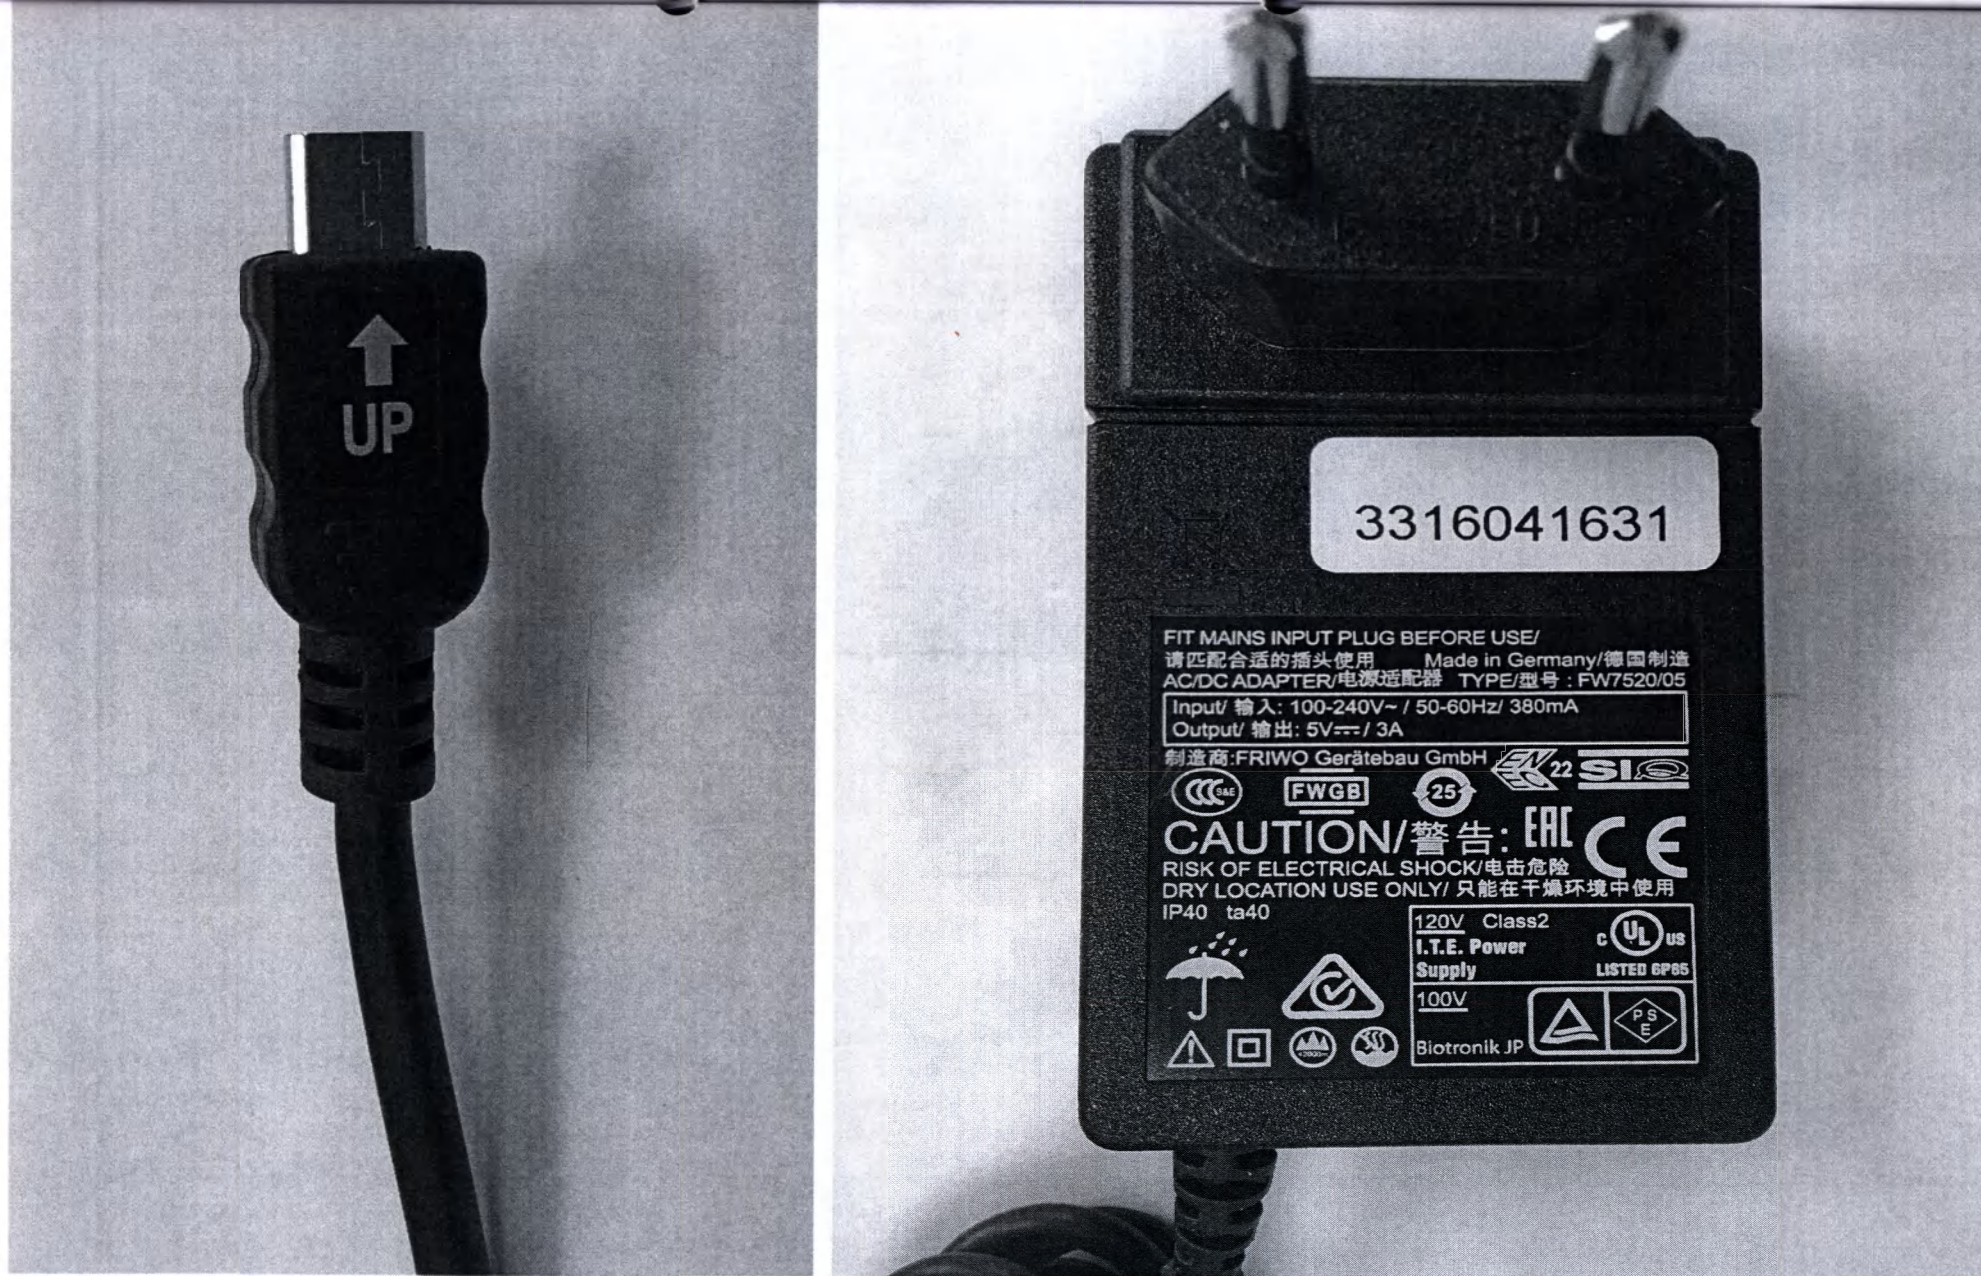


Фото 4. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:
Блок питания с кабелем и штекером

CardioMessenger Smart

de Gebrauchsanweisung
fr Manuel technique
en Technical Manual
it Manuale tecnico di istruzioni
es Manual técnico
nl Technische handleiding



BIOTRONIK
excellence for life


CardioMessenger Smart

zh 技术手册
ru Техническое руководство
ar دليل الاستعمال



BIOTRONIK
excellence for life

CardioMessenger Smart Quick Start Guide

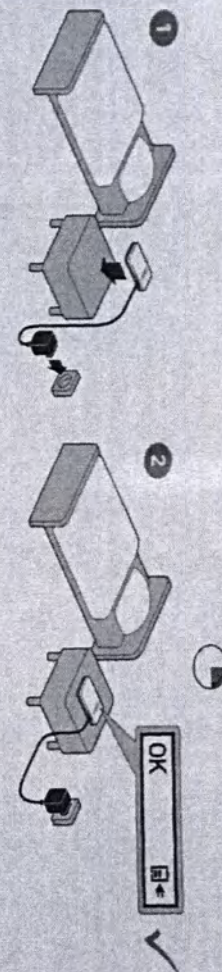

BIOTRONIK
excellence for life

Фото 5. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:

Слева направо: Дополнение к руководству по эксплуатации для рынка РФ; Руководство по эксплуатации; Краткое руководство по эксплуатации;

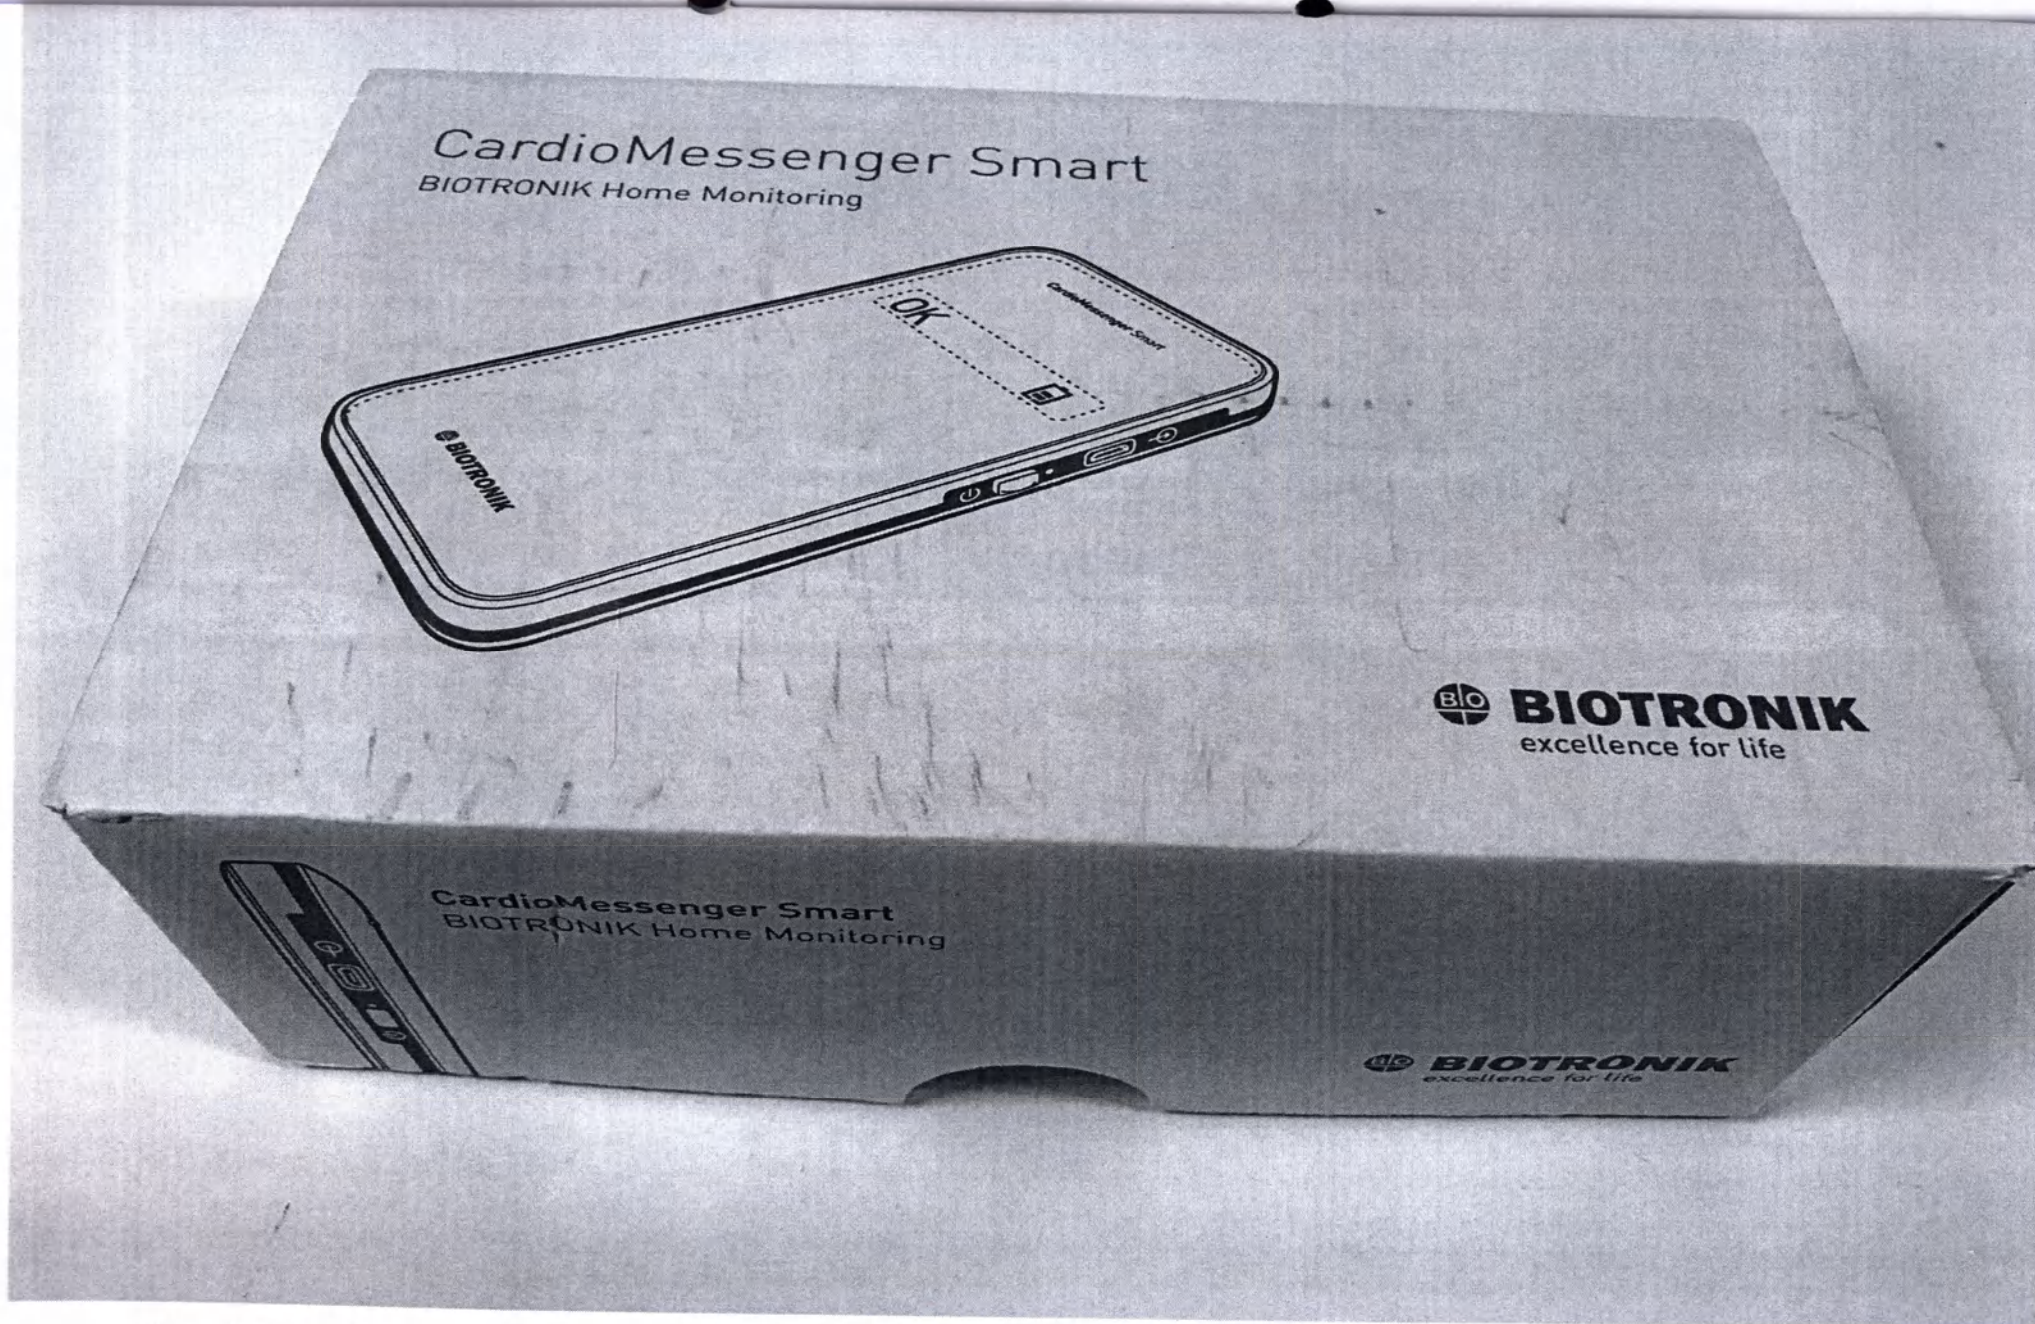


Фото 6. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:
Потребительская упаковка

CardioMessenger Smart 3G


CE

REF 419318

SN 65900109





2017-02

425300 55001

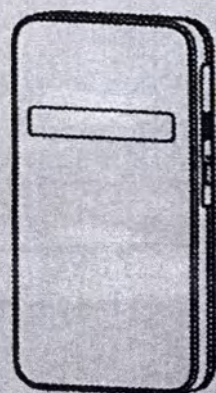

TP2

402-405 MHz



60 °C
140 °F
-20 °C
-4 °F

1060 hPa
15.37 PSI
700 hPa
10.15 PSI

75%
30%

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin - Germany
Tel +49 (0) 30 68905-0
Fax +49 (0) 30 6852804
sales@biotronik.com




CE 0123

CE 0681



BIOTRONIK

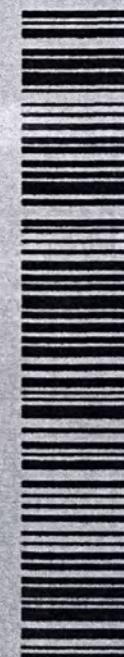

(01)04035479152390(21)65900109

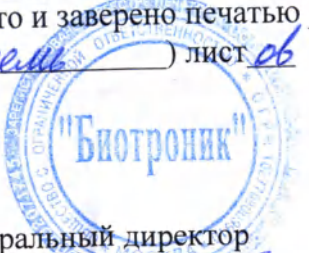
Фото 7. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:
Потребительская упаковка



Фото 8. Устройство контроля физиологических параметров и дистанционной диагностики CardioMessenger Smart 3G:

Потребительская упаковка

Сшито и заверено печатью 8
(Босе) лист 66


"Биотроник"

Генеральный директор
Захарченко Т.Д. Захар