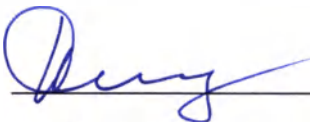


ЗАО «НЕЙРОКОМ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «НЕЙРОКОМ»

 В.В. Дементьенко
« 14 » декабря 2015 г.

АППАРАТ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СНА СОНЯ типа АНС-101

Комплект фотографий

Количество фотографий: 6

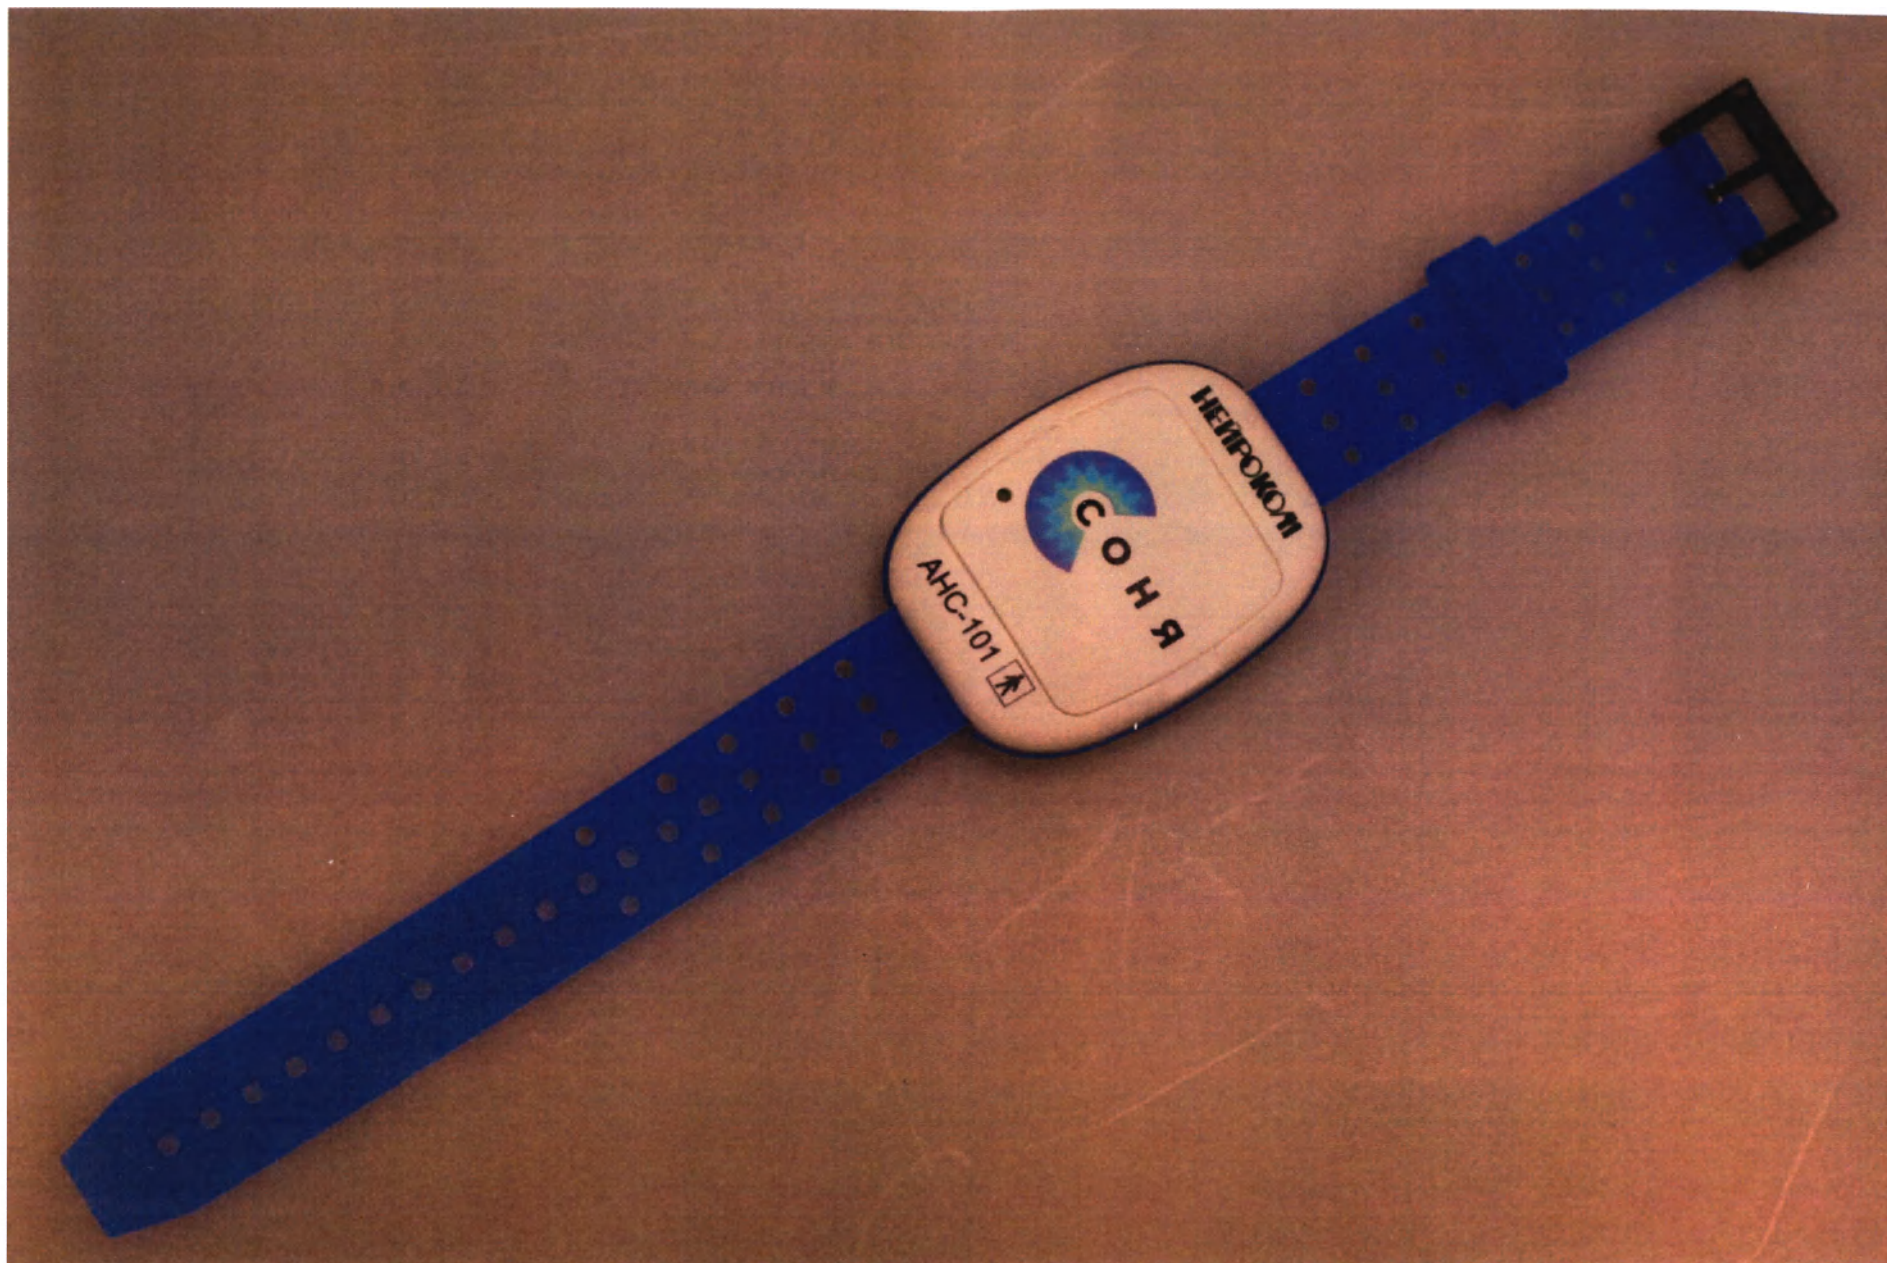


Фото 1. Аппарат СОНЯ. Вид со стороны крышки отсека для элемента питания.

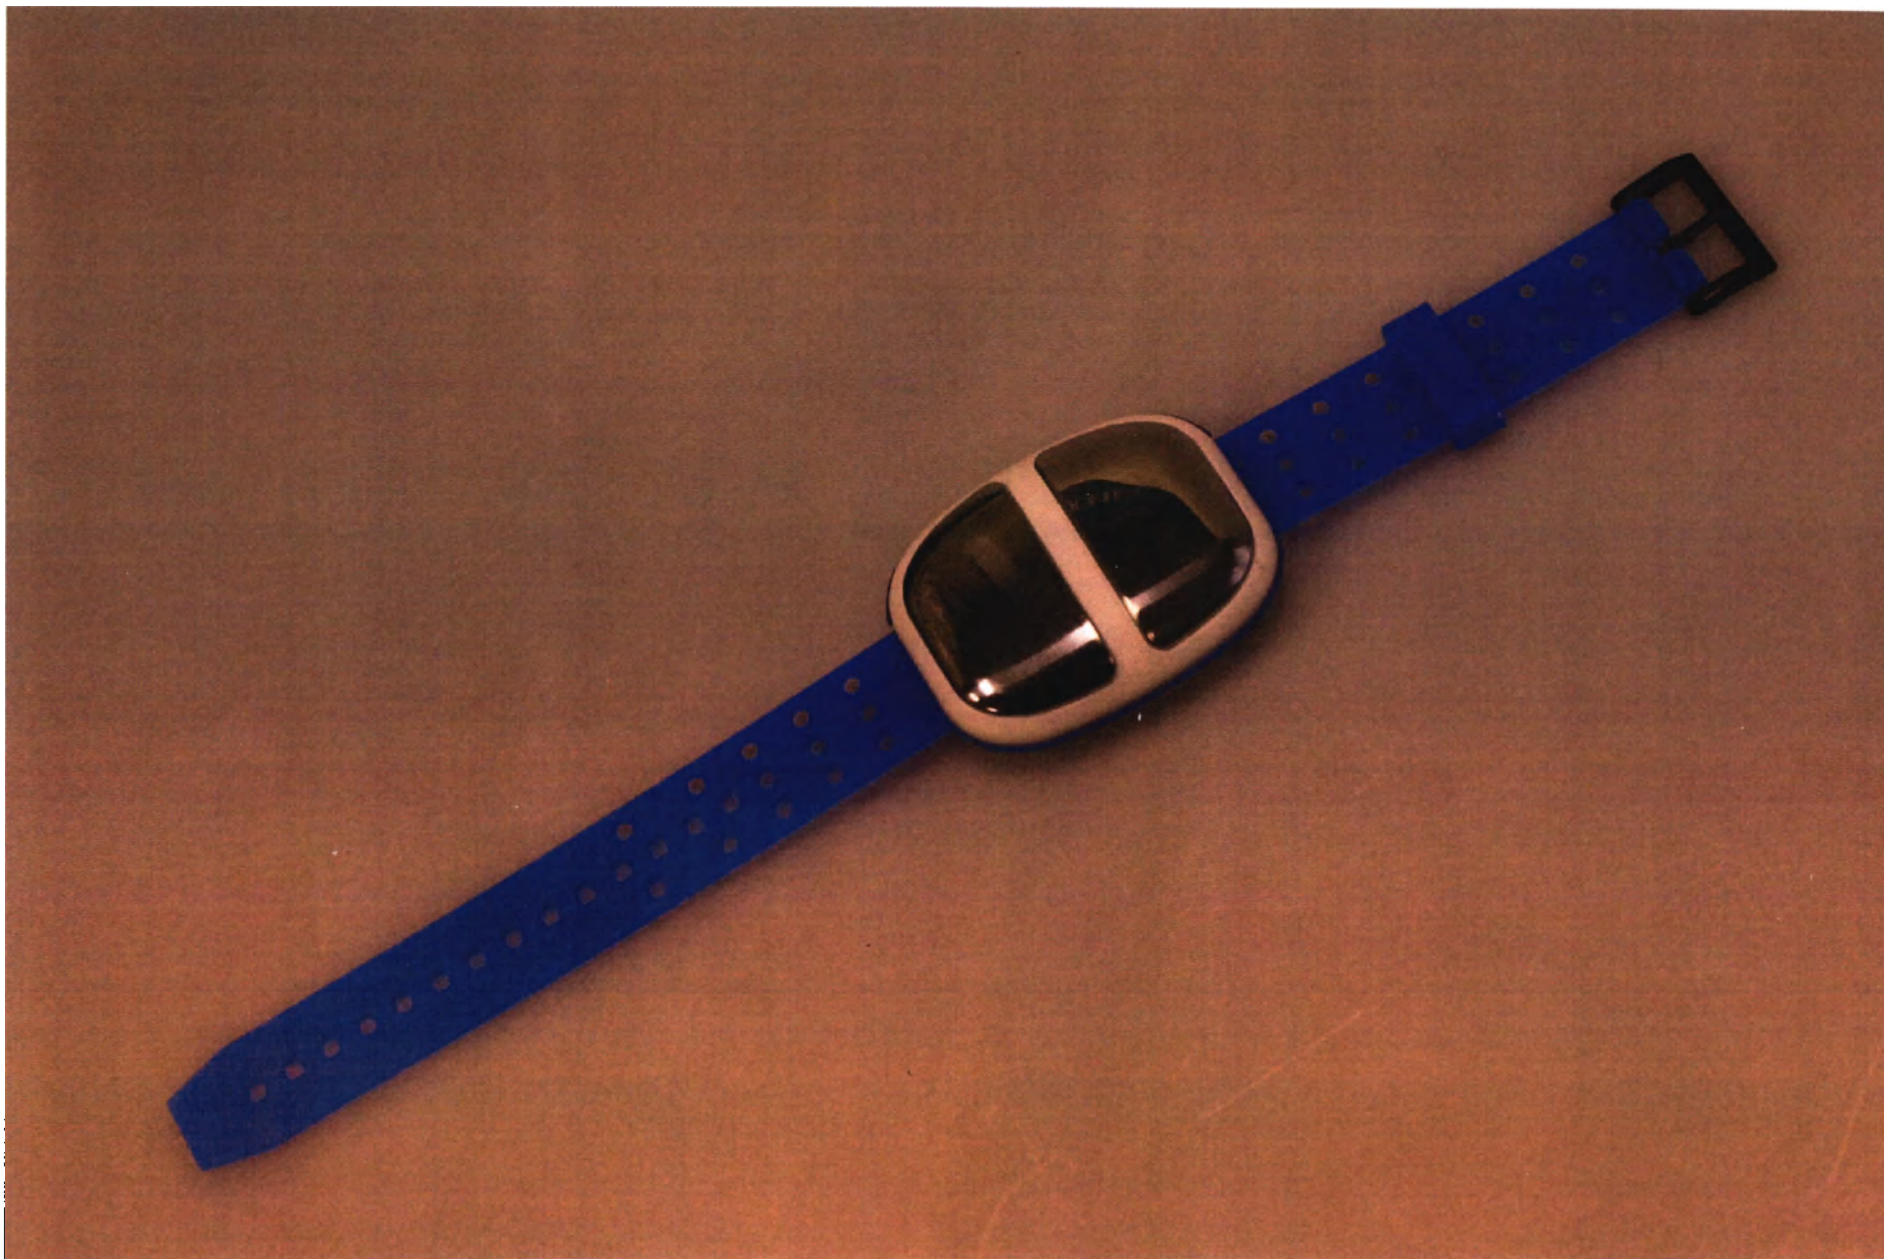


Фото 2. Аппарат СОНЯ. Вид со стороны электродов.



Фото 3. Аппарат СОНЯ. Содержимое потребительской тары.



Фото 4. Аппарат СОНЯ. Потребительская тара с аппаратом СОНЯ.

**Аппарат
для нормализации
сна СОНЯ типа АНС-101**

Серийный номер: 10000046
Месяц и год выпуска: 07. 2016

ТУ 9444-001-26457636-2015
Рег.уд.:
Температура хранения : $\pm 50^{\circ}\text{C}$

Меры безопасности:
перед использованием необходимо
ознакомиться с инструкцией
по применению.

ИНС Инновационные
Нейросистемы
www.ineurosystem.ru

НЕЙРОКОМ
NEUROCOM
Разработано и изготовлено
ЗАО «НЕЙРОКОМ» по заказу
ООО «Инновационные
Нейросистемы»

Тел.: (495) 640-76-71
Факс: (495) 640-76-71
Email: info@neurocom.ru
www.neurocom.ru

Юридический адрес:
119313, г. Москва,
Ленинский проспект, 95



Фото 5. Аппарат СОНЯ. Потребительская тара. Вид снизу.



Фото 6. Аппарат СОНЯ. Транспортная тара.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 7 (семь) листах

Генеральный директор

АО «НЕЙРОКОМ»

В.В. Делеттиенко

