


**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Инструменты к аппарату
для высокочастотной
электрокоагуляции Surgi-Max Plus
для операций на межпозвонковых
дисках»**

Производитель:


Elliquence, LLC

2455 Grand Avenue, Baldwin, New York, 11510, USA

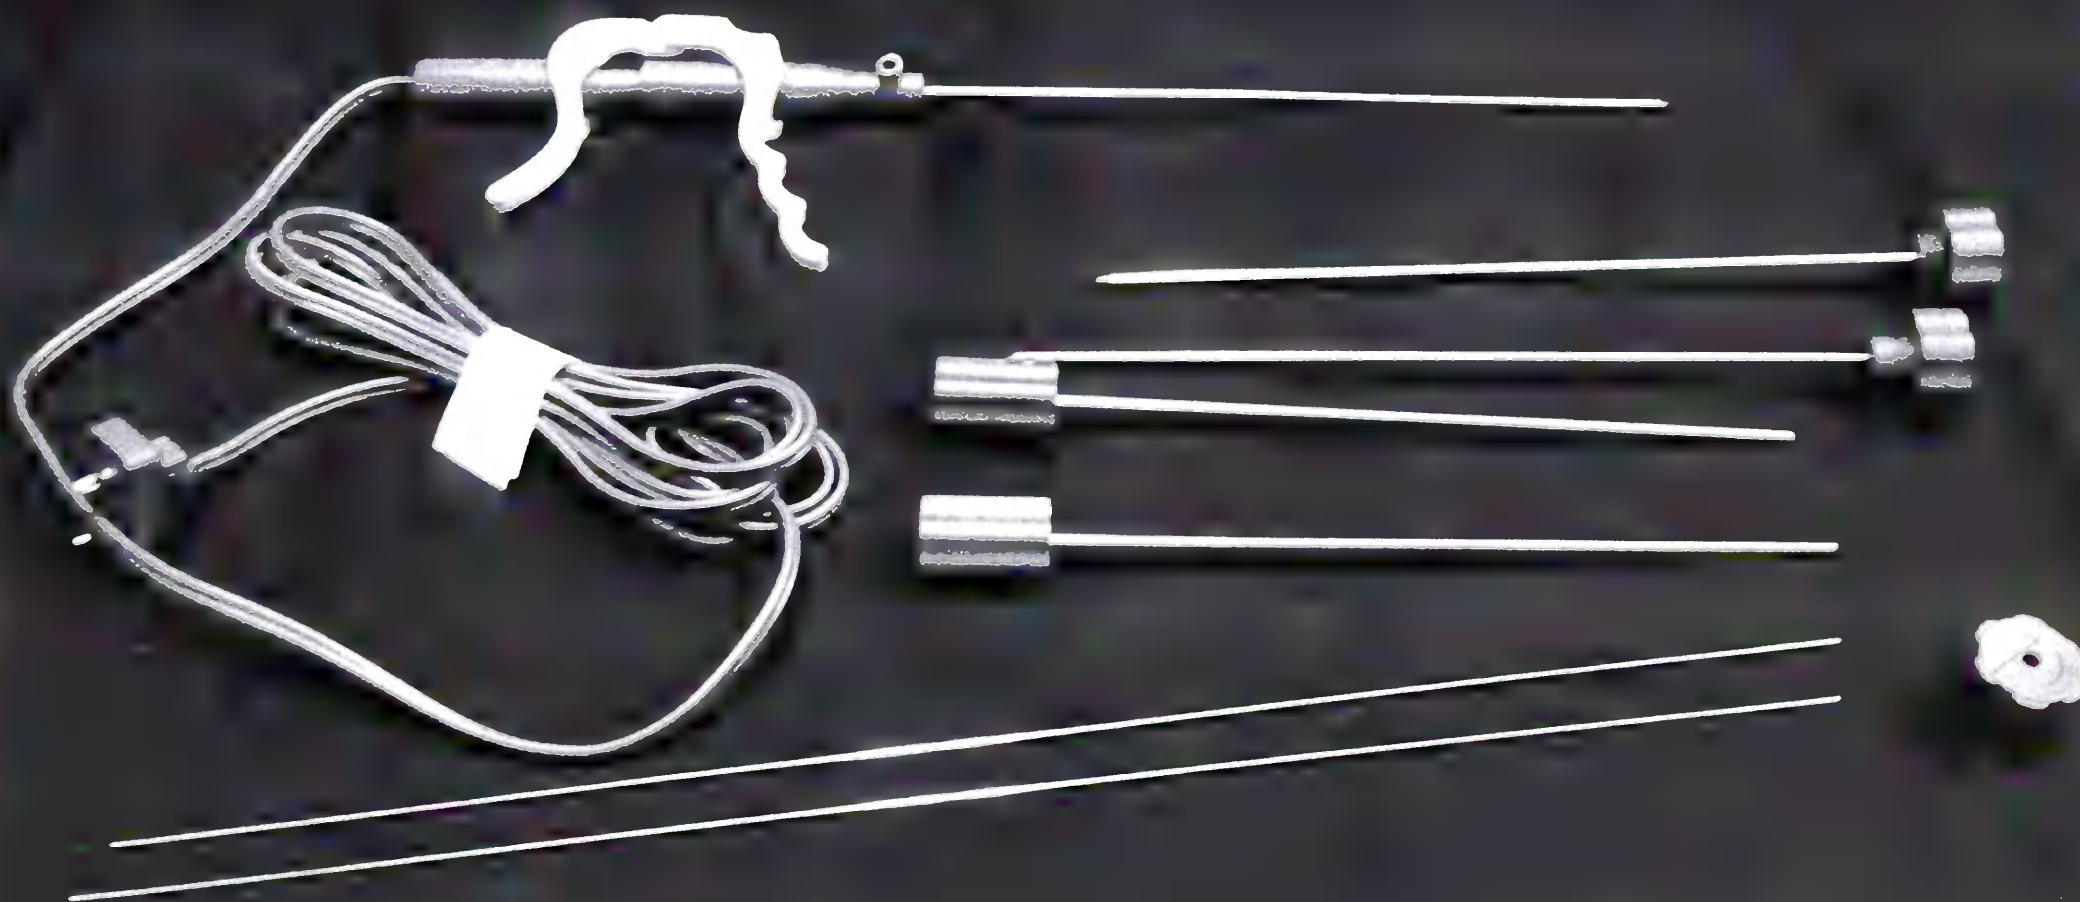

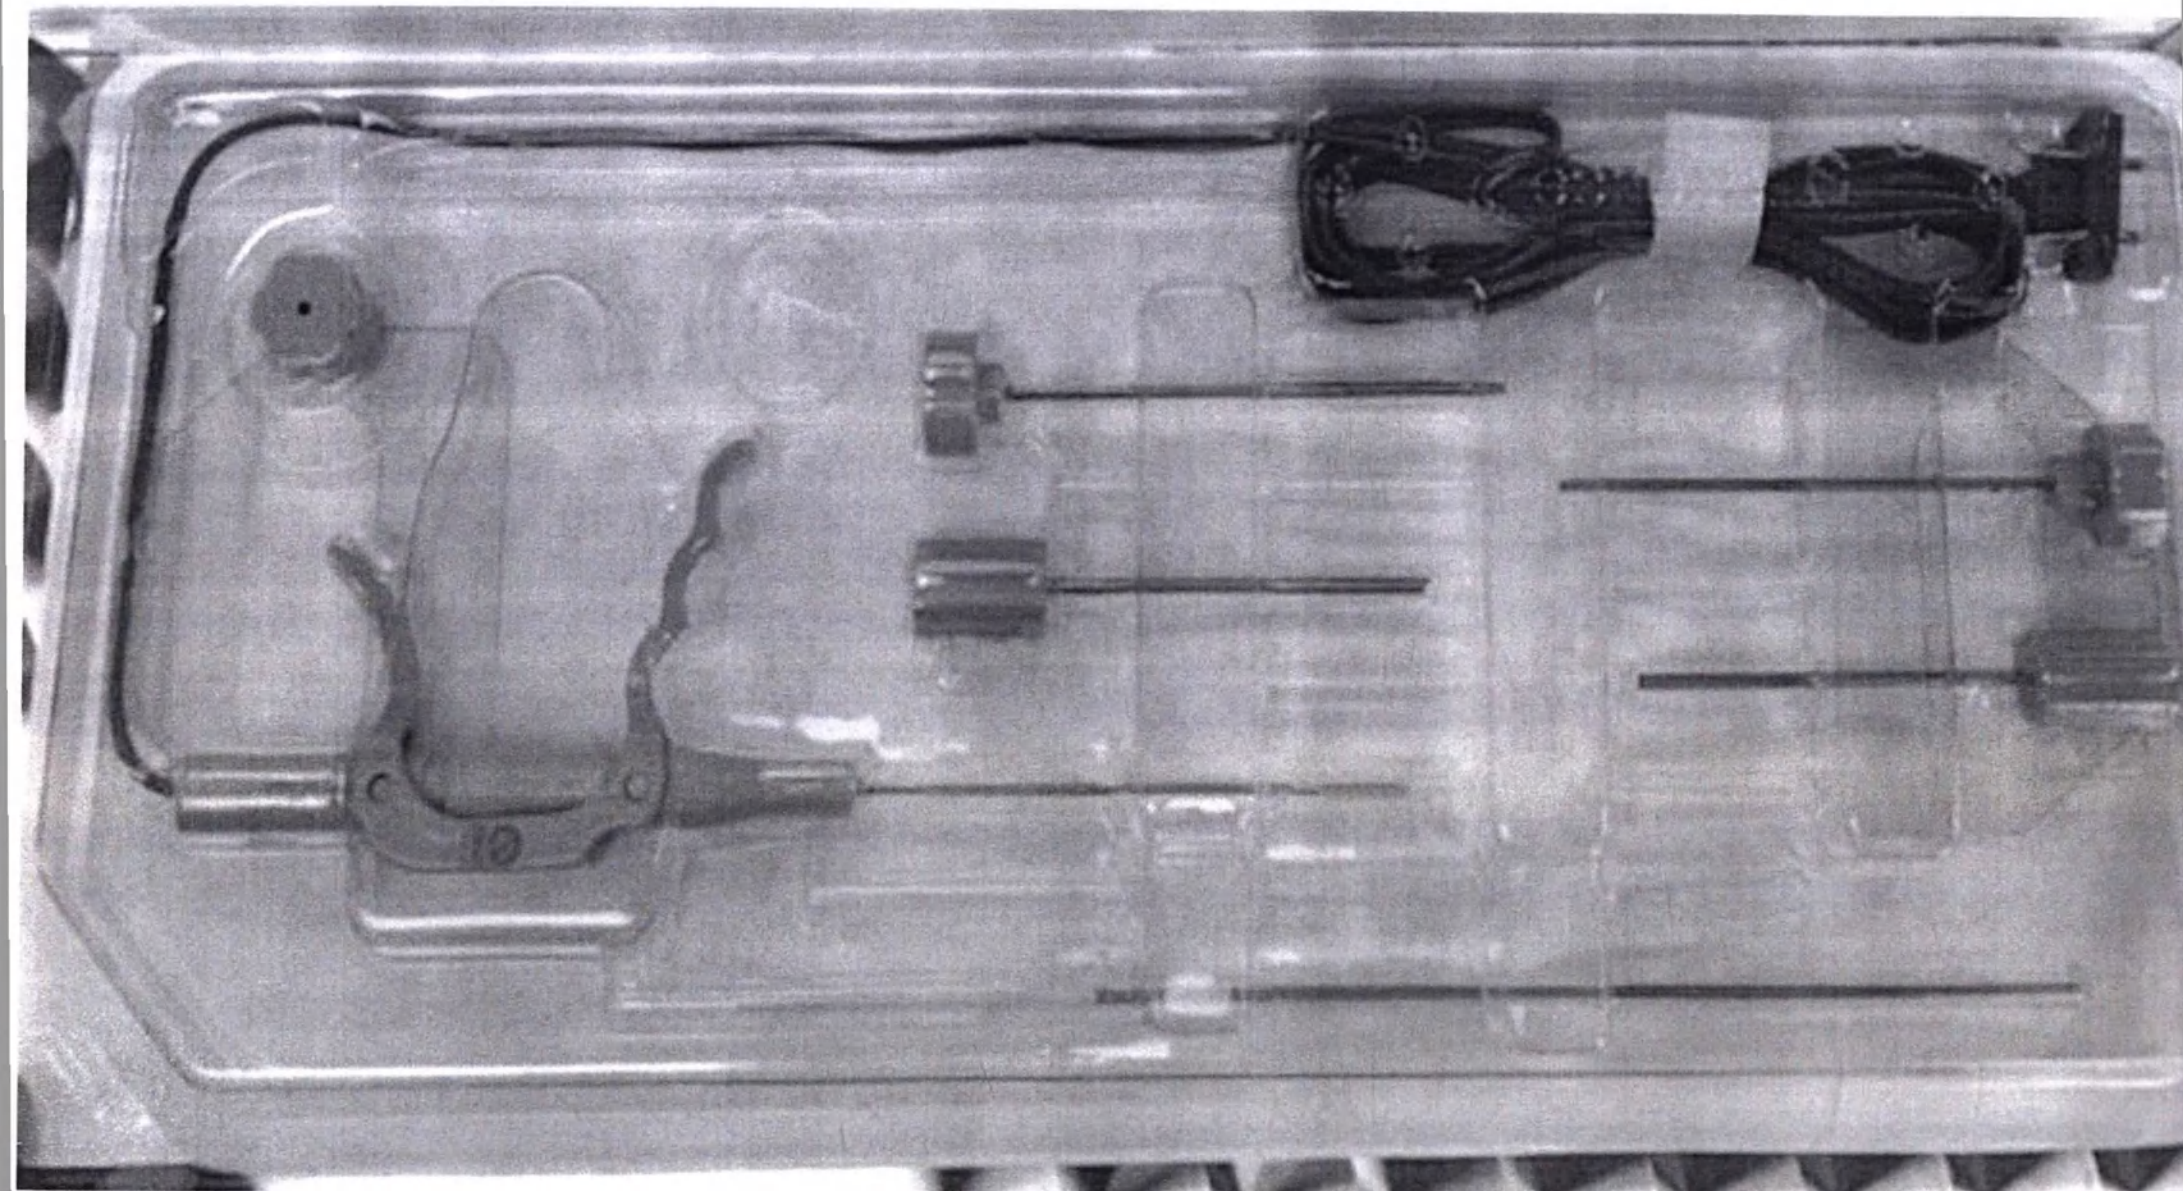


Система Disc-FX, модель DFXM

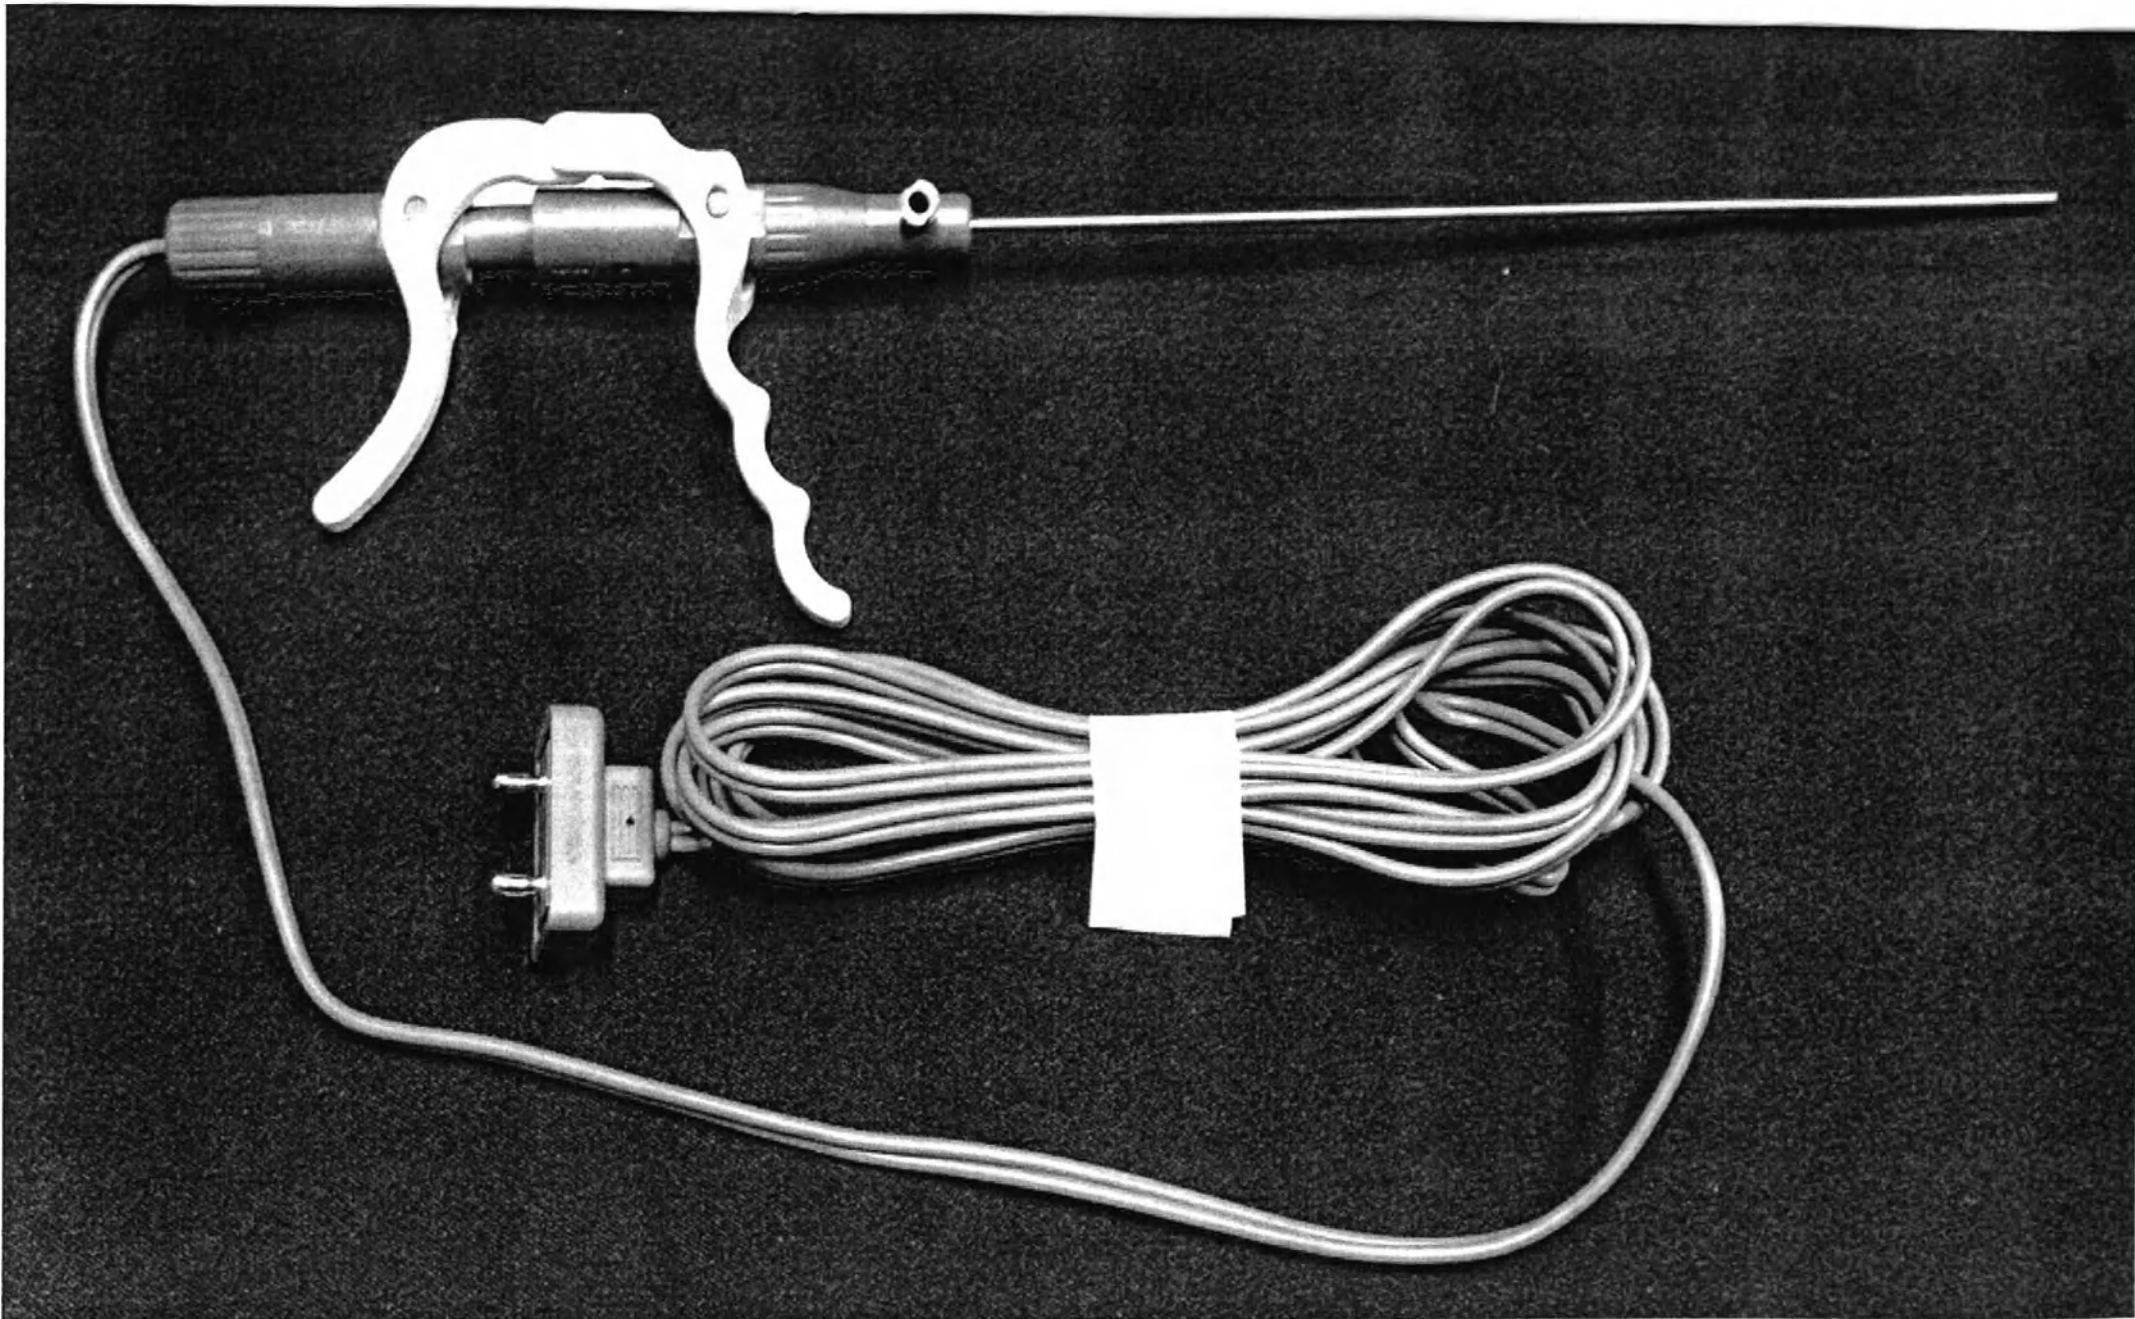


Электрод биполярный Trigger-Flex

Канюльа с прямьм концоу




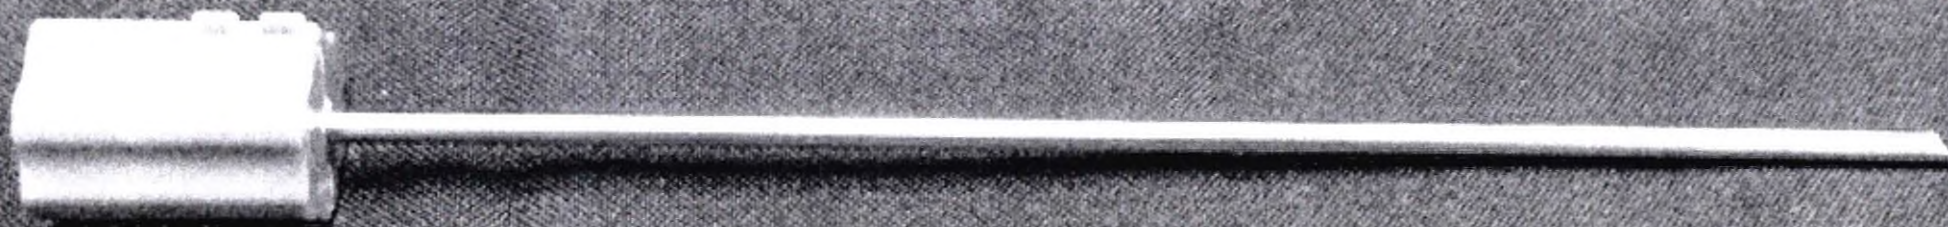

Канюля со скошенным концом

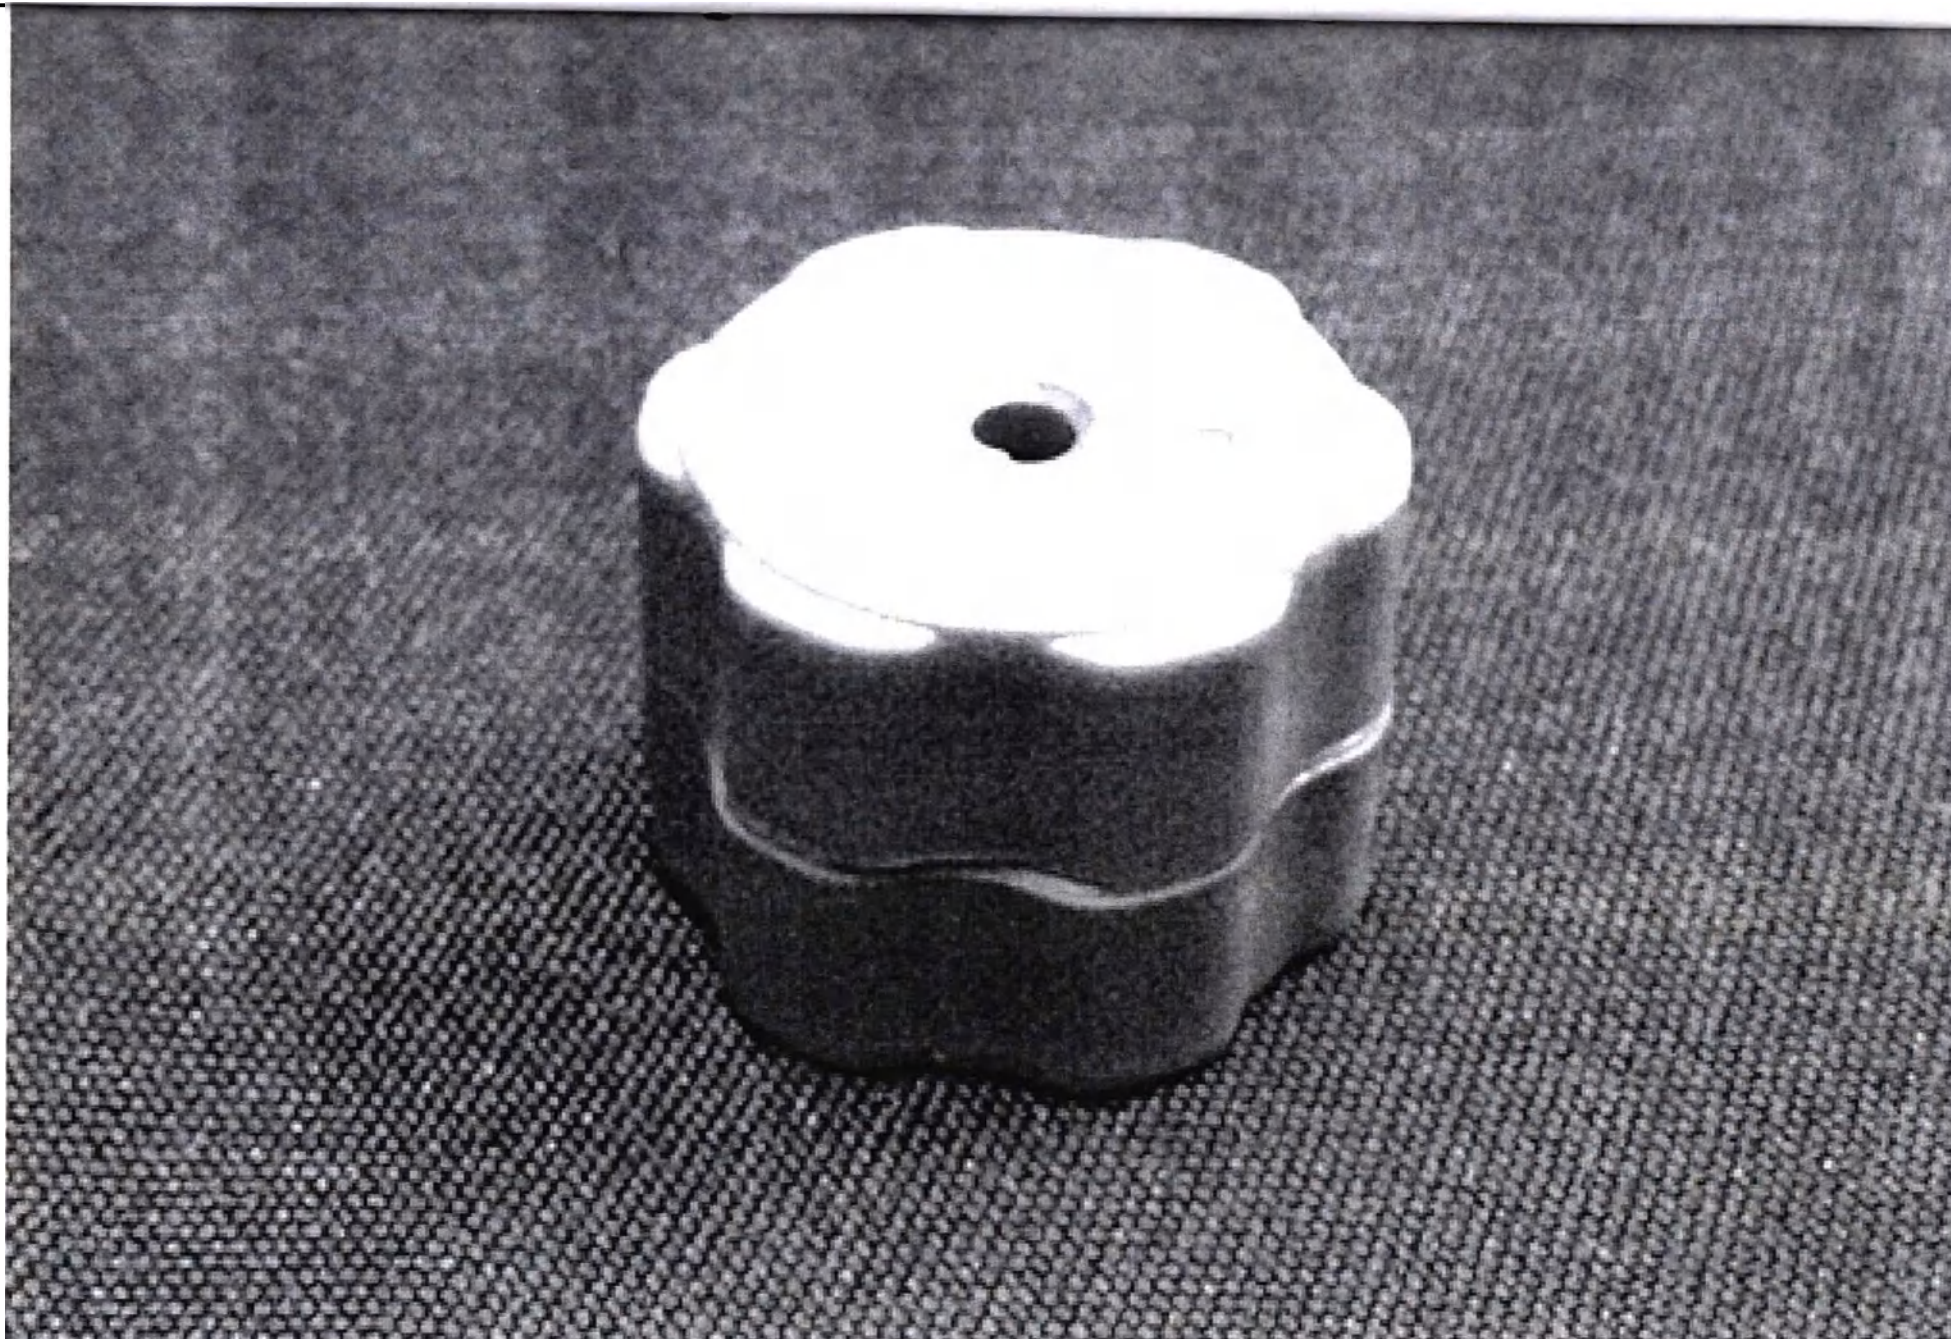


Ограничитель глубины введения канюли

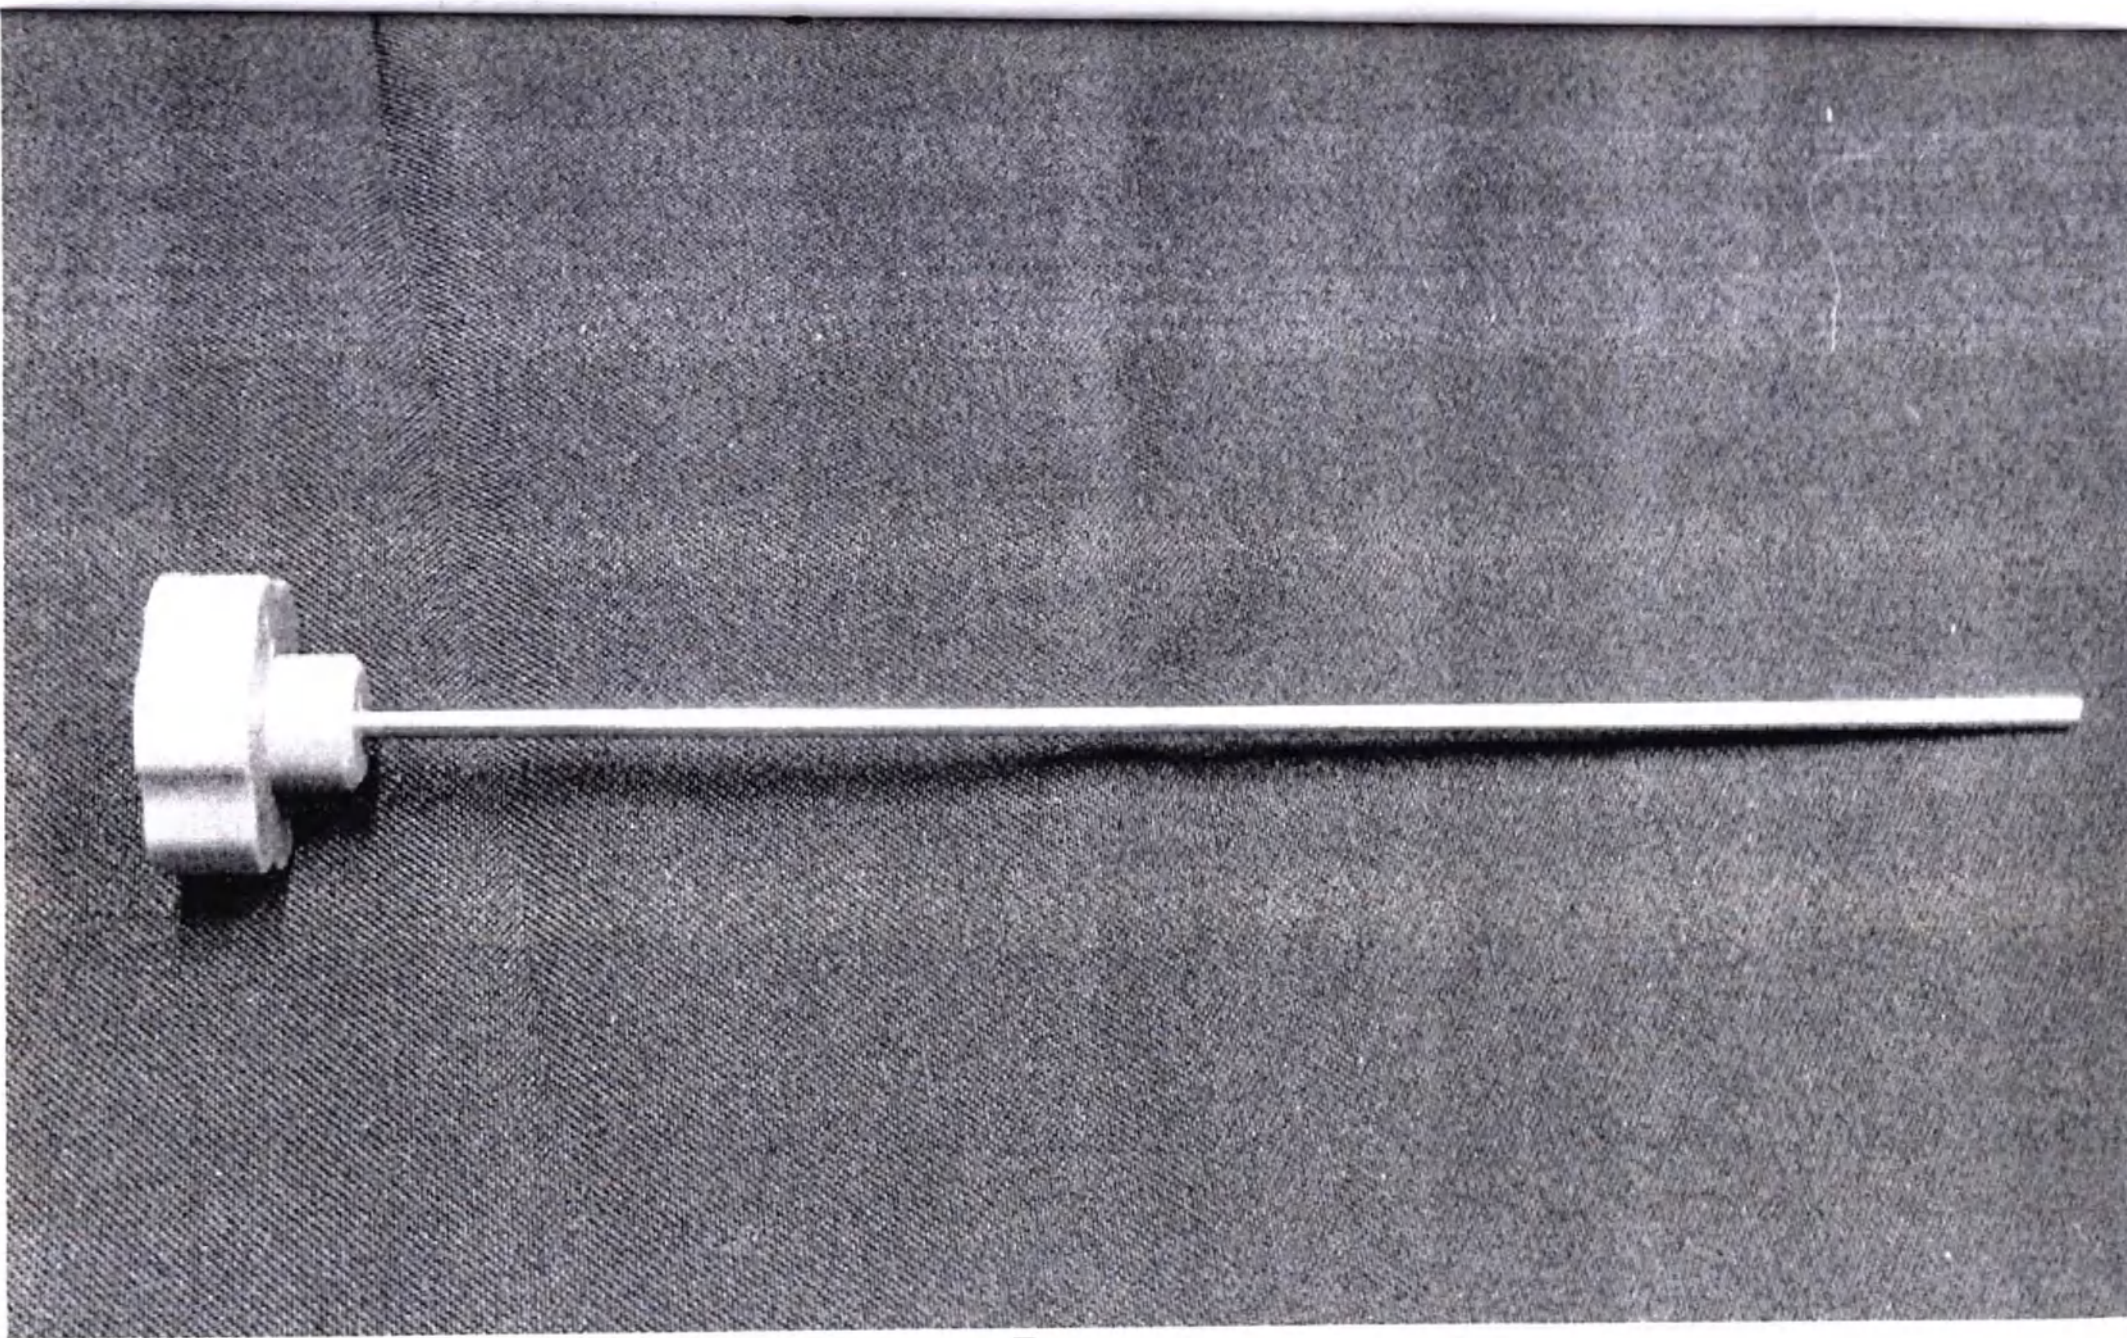


Трепан




Расширитель тканей конический

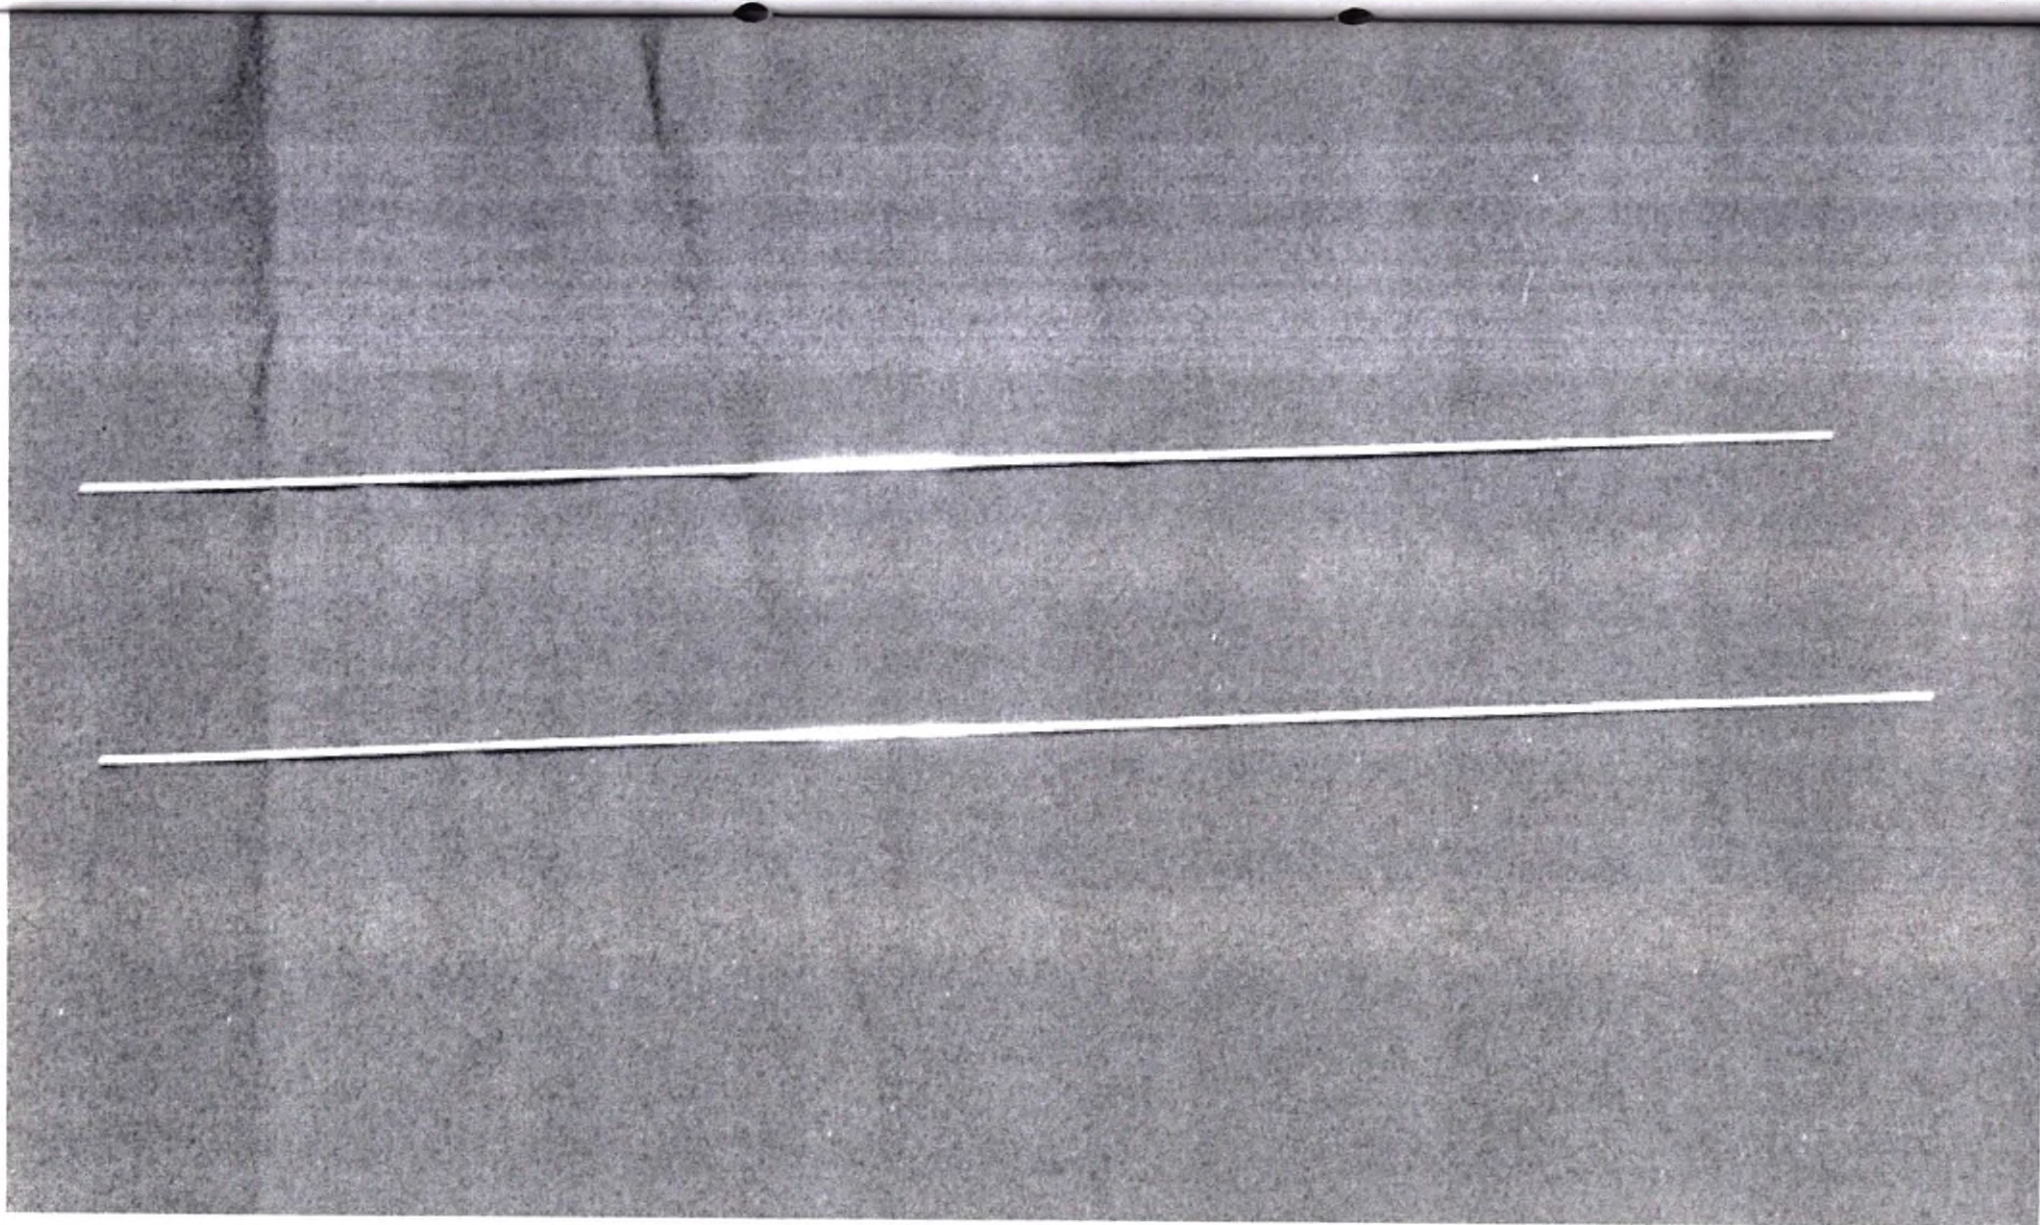

Направитель проволочный тонкий, толстый

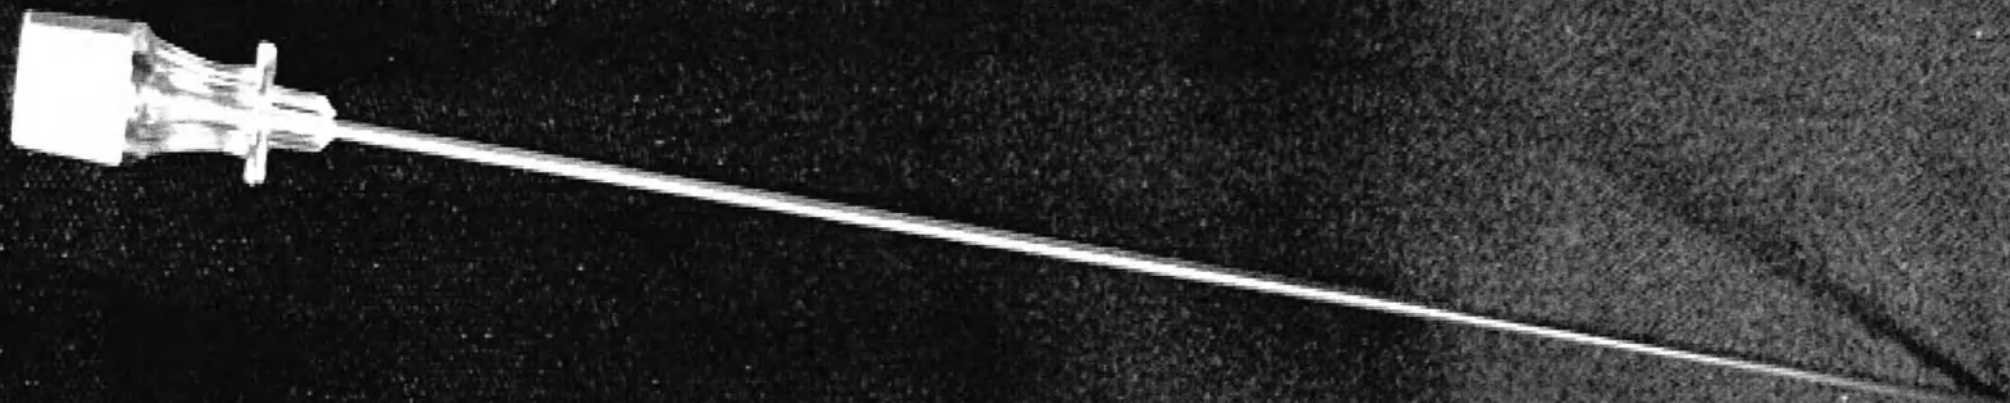

Игла спинальная DFX-N

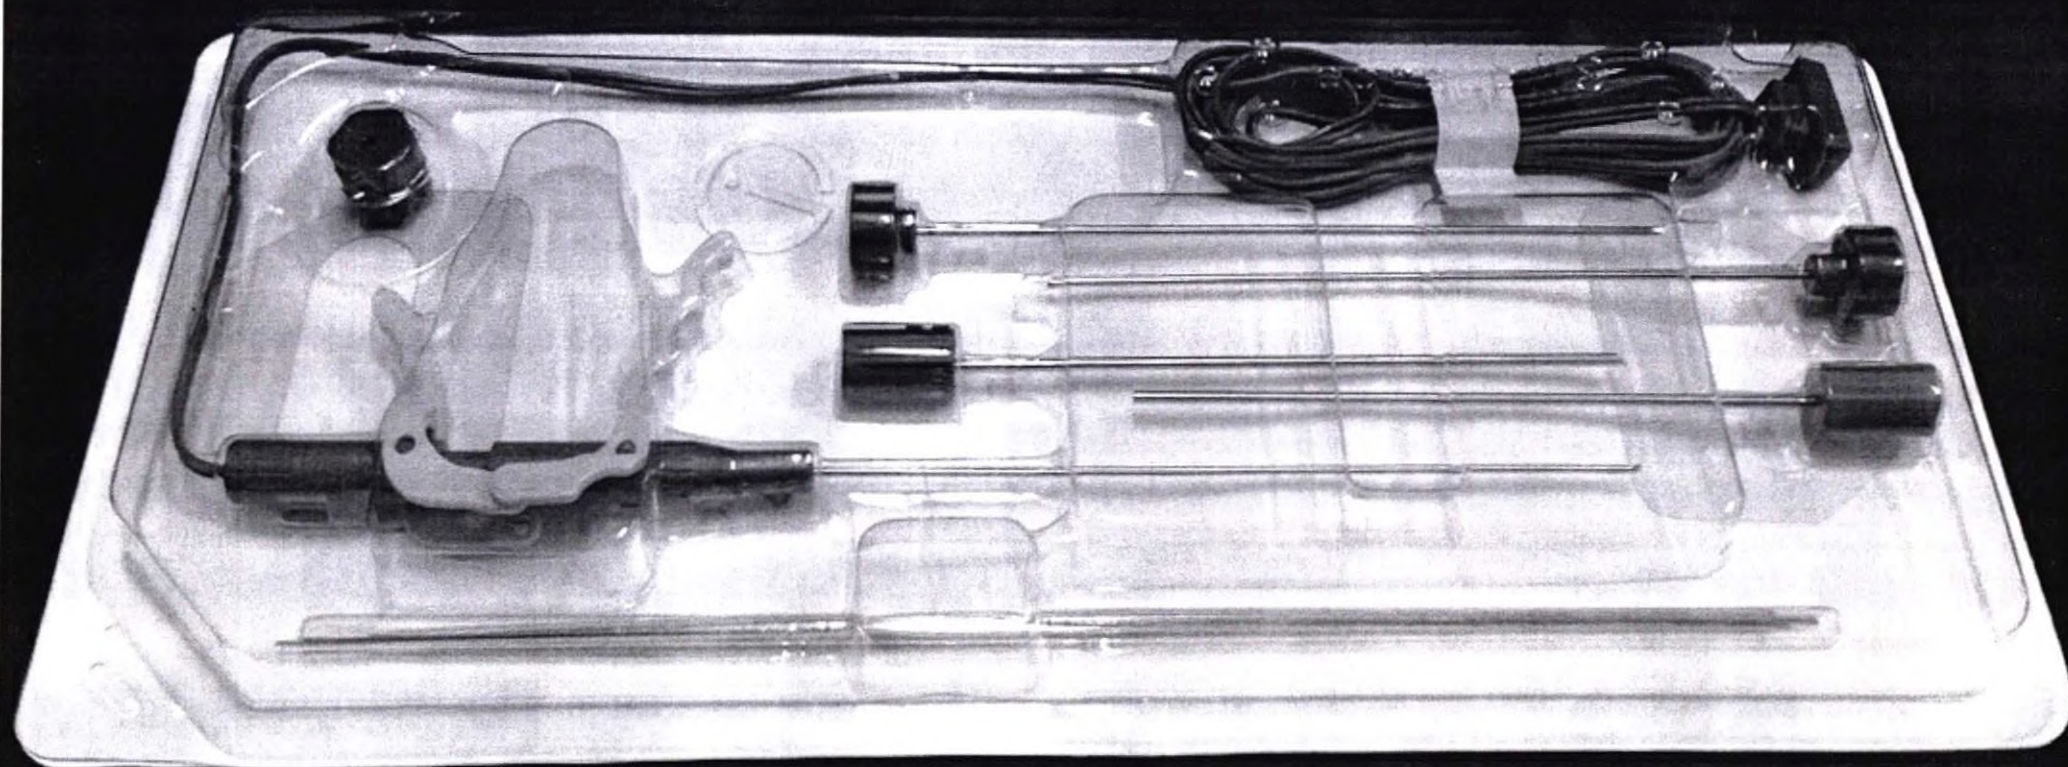

Система Disc-FX, модель DFX, внутренняя упаковка

elliquence
Innovative Medical Solutions

DISC-FX



LOT 140605108ALX
MAY 2019

elliquence, LLC
2450 Grand Avenue
Bridgewater, NJ 08807 U.S.A.
(201) 277-9500 • Fax: (201) 277-9501
www.elliquence.com

EC REP
EMERGEO EUROPE
Lombardstrasse 11
20146 Berlin, Germany
(The Netherlands)

Disc-FX System

REF DFX

Contents:
(1) "Trigger-Pass" System (System) (2) (1) Capsule, Reversed
(2) Capsule, Straight (3) Capsule, Double-Step (4) Capsule, Double-Step
(5) Capsule, Double-Step (6) Capsule, Double-Step
(7) Capsule, Double-Step (8) Capsule, Double-Step

STERILE

Rx

2

2

2

2

2

2

CE
0413
L8 0174 0

Система Disc-FX, модель DFX, внутренняя упаковка

elliquence
Innovative Medical Solutions



LOT 140605108ALX
MAY 2019

elliquence, LLC.
2455 Grand Avenue
Baltimore, NY 11510 U.S.A.
(716) 277-9000 • Fax: (716) 277-9001
www.elliquence.com

EC REP EMERGEO EUROPE
Middelweg 13
5513 BZ, The Hague
The Netherlands

Disc-FX System

REF DFX

Contents

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Trigger-Flex® Border System - 24in | (1) Cervical, Straight |
| (2) Guidewire | (1) Cervical Depth Stop |
| (1) Cervical, Straight | (1) Tapered Clasp |
| | (1) Trayring |

STERILE EO

Rx ONLY

2

2

2

2

2

2


DISCLAIMER:
SINGLE USE DEVICES ARE DESIGNED FOR SINGLE USE ONLY. REUSE OF THE PRODUCT MAY COMPROMISE PRODUCT SAFETY AND THEREFORE COULD CAUSE ADVERSE MAJOR HARM TO THE PATIENT.
CONTENTS GUARANTEED UNLESS OTHERWISE INDICATED. DO NOT REUSE OR REPAIR. DO NOT USE IF PACKAGING IS DAMAGED.
U.S. FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE ONLY ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.

DISC-FX

(414) 0846334000004 (422) 054163
(51) 00846334000691 (210) 81816
(17) 190500 (10) 140605108ALX11

CE
0413
L 0378 0

Система Disc-FX, модель DFX, внешняя упаковка

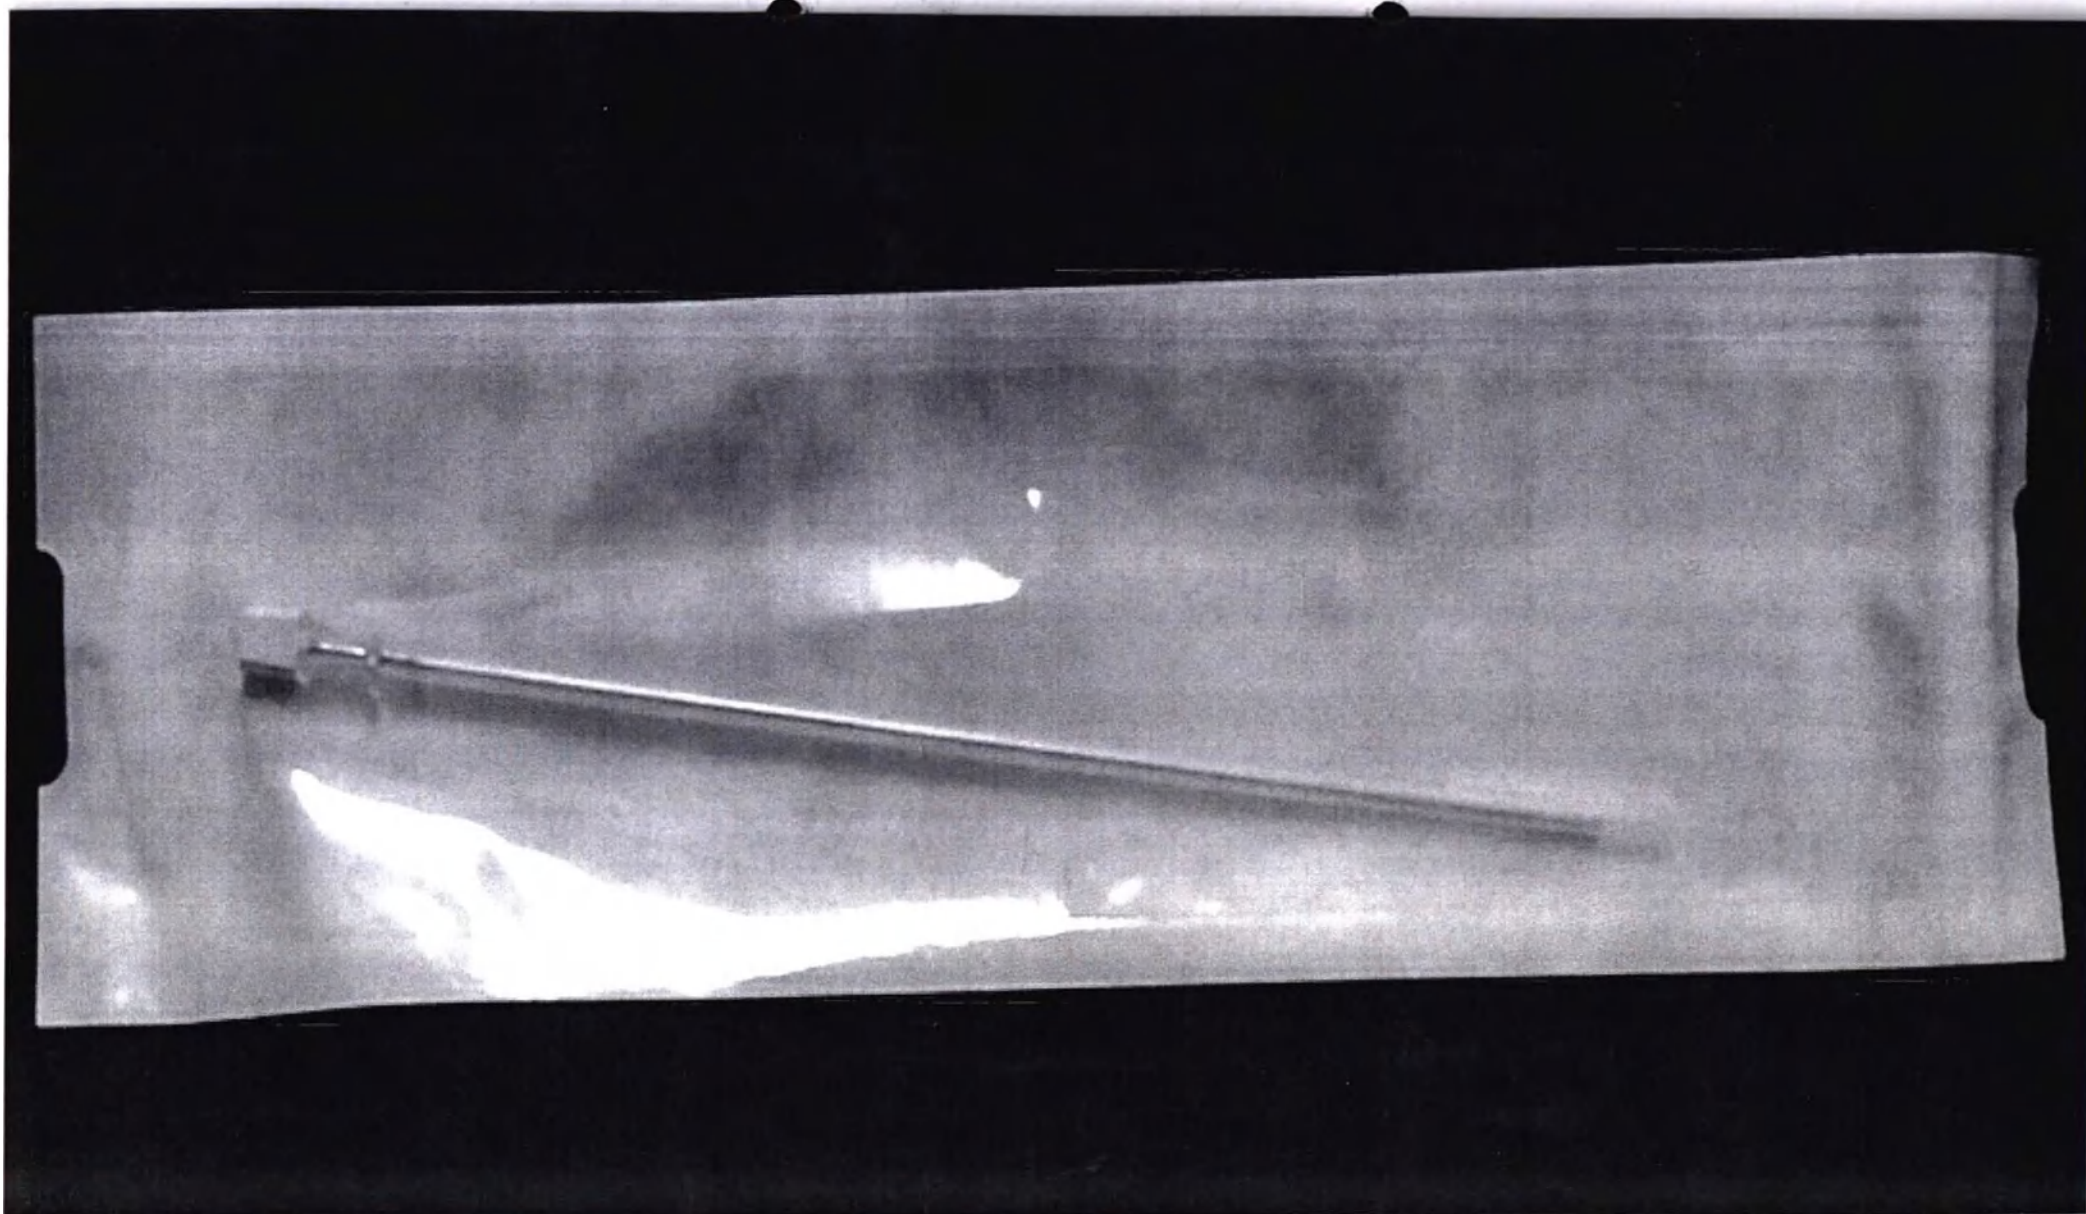

Игла спинальная DFX-N, внутренняя упаковка

ellicquence

Innovative Marketing Solutions

Spine Needle

REF DFX-N6

Contents: Ten (10) Spine Needles, 16G x 8"

STERILE

Rx only

②

②

(over)



LOT S340BD

01-2020

[illegible]

10/10/1971
 10/10/1971
 10/10/1971
 10/10/1971
 10/10/1971

EC REP

ENERGO EUROPE
Unterstrass 17,
2513 Hilti - Im Hofen
Thun, Switzerland

CE
0413

Игла спинальная DFX-N, модели DFX-N6, внешняя упаковка

Проект этикетки для России:

Инструменты к аппарату для высокочастотной электрокоагуляции Surgi-Max Plus для операций на межпозвонковых дисках. Система Disc-FX.



140605108ALX

REF DFX

Регистрационное удостоверение

№*** от **.*.***



май 2019



стерилизовано
этиленоксидом



Elliquence, LLC
(«Элликвенс, ЭлЭлСи»)
2455 Grand Avenue, Baldwin,
New York, 11510, USA

Rx
ONLY



Внимание! Инструменты поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Запрещена повторная стерилизация и повторное использование. Повторное использование даже после рестерилизации может подвергнуть пациента риску инфицирования. Гарантирована стерильность в неоткрытой упаковке. В случае повреждения упаковки запрещается использовать. Федеральный закон США ограничивает продажу данного устройства только врачу или по заказу врача.

CE
0413

Инструменты к аппарату для высокочастотной электрокоагуляции Surgi-Max Plus для операций на межпозвонковых дисках. Система Disc-FX.



140605109ALX

REF DFXM

Регистрационное удостоверение

№*** от **.*.***



май 2019



стерилизовано
этиленоксидом



Elliquence, LLC
(«Элликвенс, ЭлЭлСи»)
2455 Grand Avenue, Baldwin,
New York, 11510, USA

Rx
ONLY



Внимание! Инструменты поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Запрещена повторная стерилизация и повторное использование. Повторное использование даже после рестерилизации может подвергнуть пациента риску инфицирования. Гарантирована стерильность в неоткрытой упаковке. В случае повреждения упаковки запрещается использовать. Федеральный закон США ограничивает продажу данного устройства только врачу или по заказу врача.

CE
0413

**Инструменты к аппарату для высокочастотной электрокоагуляции
Surgi-Max Plus для операций на межпозвонковых дисках. Игла спинальная DFX-N.**



S340BD

REF DFX-N6

Регистрационное удостоверение
№*** от **.*.***



01-2020



стерилизовано
этиленоксидом



Elliquence, LLC
(«Элликвенс, ЭлЭлСи»)
2455 Grand Avenue, Baldwin,
New York, 11510, USA

Rx
ONLY



Внимание! Инструменты поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Запрещена повторная стерилизация и повторное использование. Повторное использование даже после рестерилизации может подвергнуть пациента риску инфицирования. Гарантирована стерильность в неоткрытой упаковке. В случае повреждения упаковки запрещается использовать. Федеральный закон США ограничивает продажу данного устройства только врачу или по заказу врача.

CE
0413

**Инструменты к аппарату для высокочастотной электрокоагуляции
Surgi-Max Plus для операций на межпозвонковых дисках. Игла спинальная DFX-N.**



S350BD

REF DFX-N8

Регистрационное удостоверение
№*** от **.*.***



01-2020



стерилизовано
этиленоксидом



Elliquence, LLC
(«Элликвенс, ЭлЭлСи»)
2455 Grand Avenue, Baldwin,
New York, 11510, USA

Rx
ONLY



Внимание! Инструменты поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Запрещена повторная стерилизация и повторное использование. Повторное использование даже после рестерилизации может подвергнуть пациента риску инфицирования. Гарантирована стерильность в неоткрытой упаковке. В случае повреждения упаковки запрещается использовать. Федеральный закон США ограничивает продажу данного устройства только врачу или по заказу врача.

CE
0413

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов

Генеральный директор ООО «СМТраст»  Колыванов М.В.

М.П.

