

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ЗАО НПП «МедИнж»


С. В. Евдокимов

« 04 » февраля 2019 г.


Фотографические изображение маркировки упаковки медицинского изделия:

«Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл, «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ», производства компании ЗАО НПП «МедИнж»

2019 год

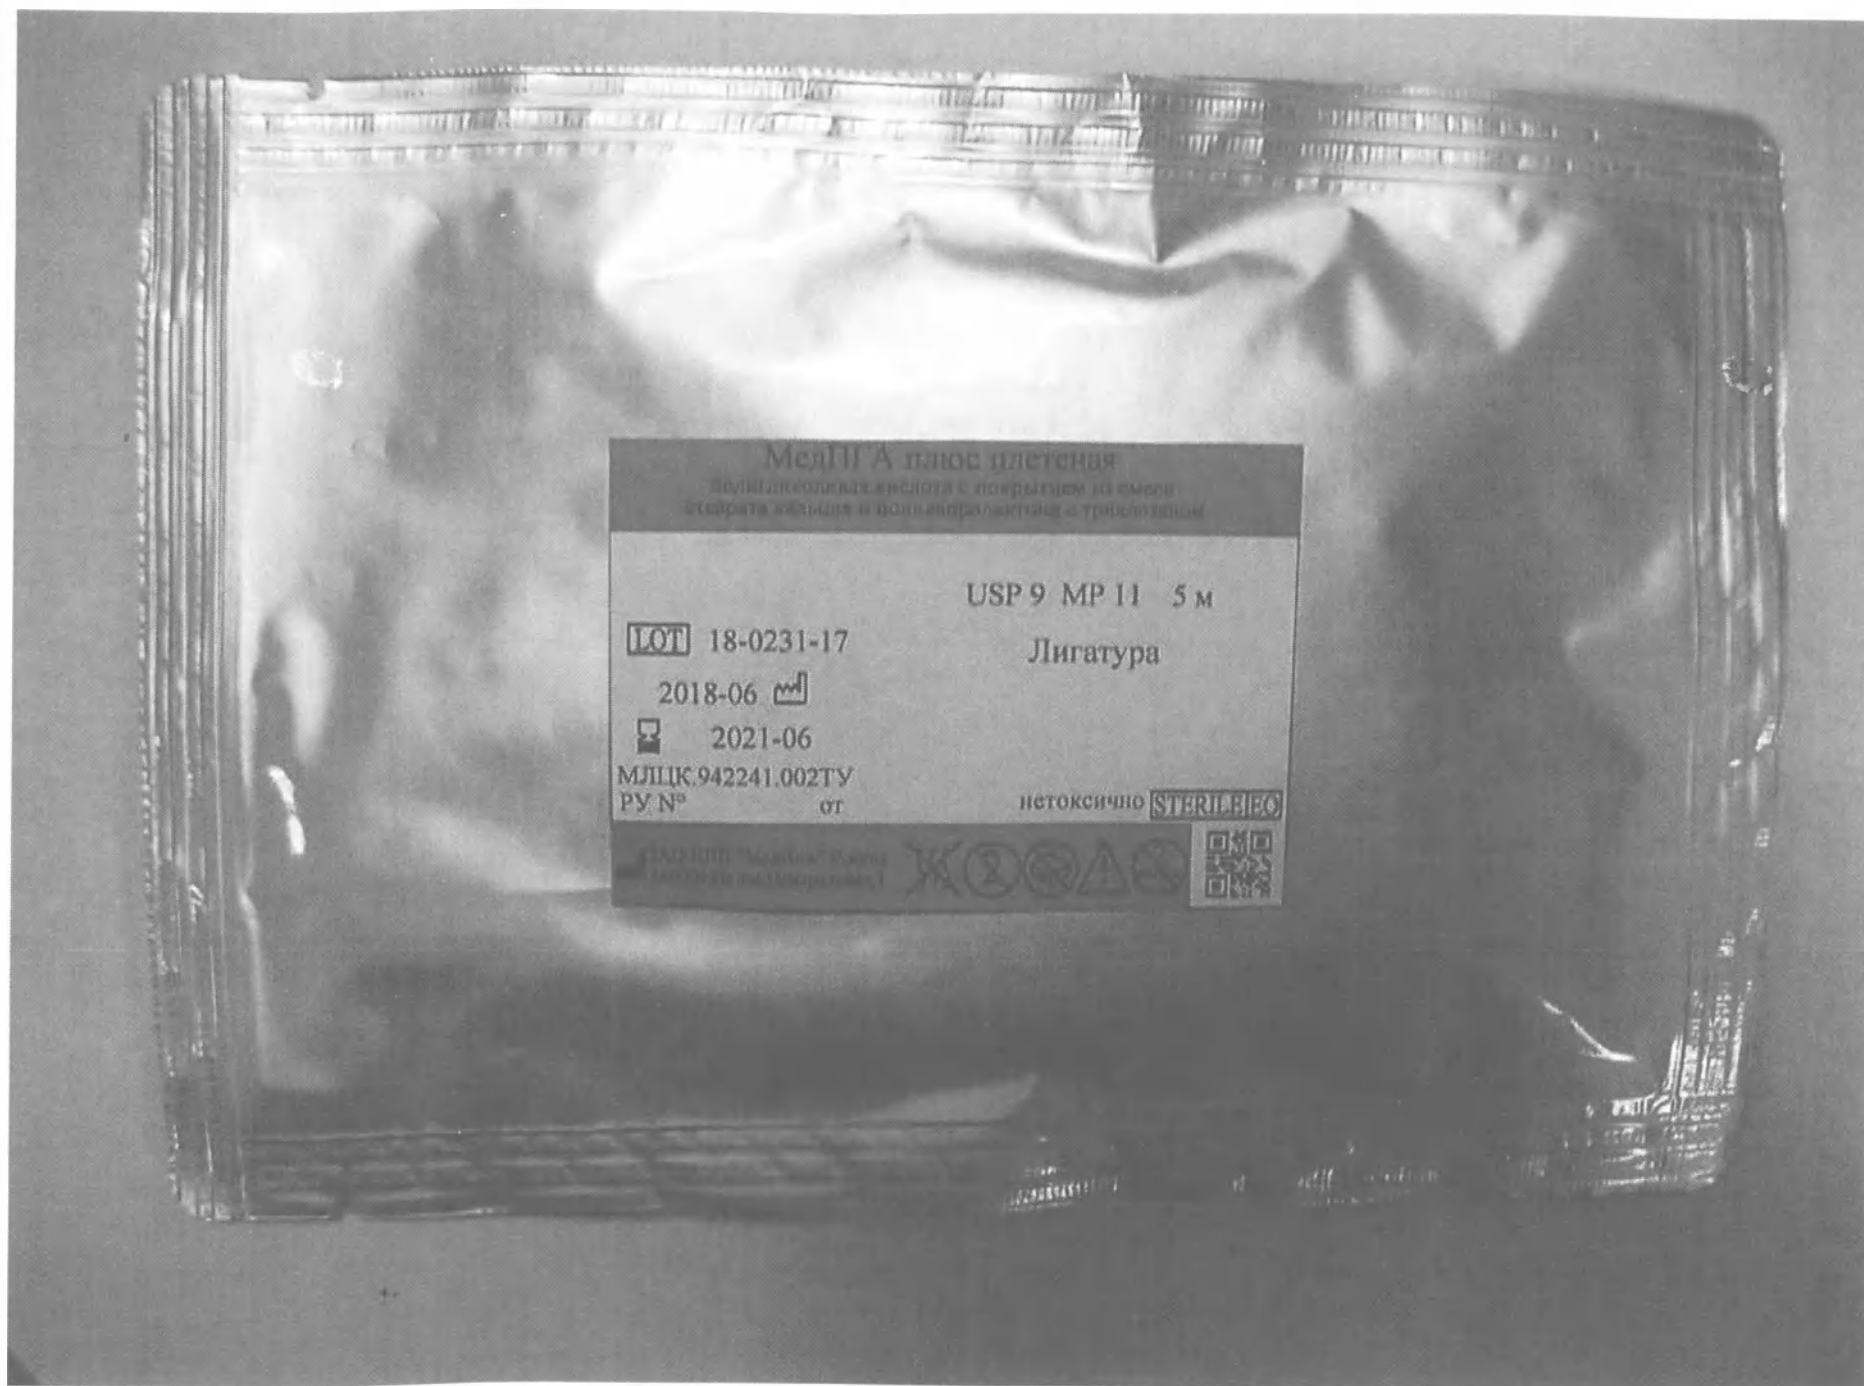

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

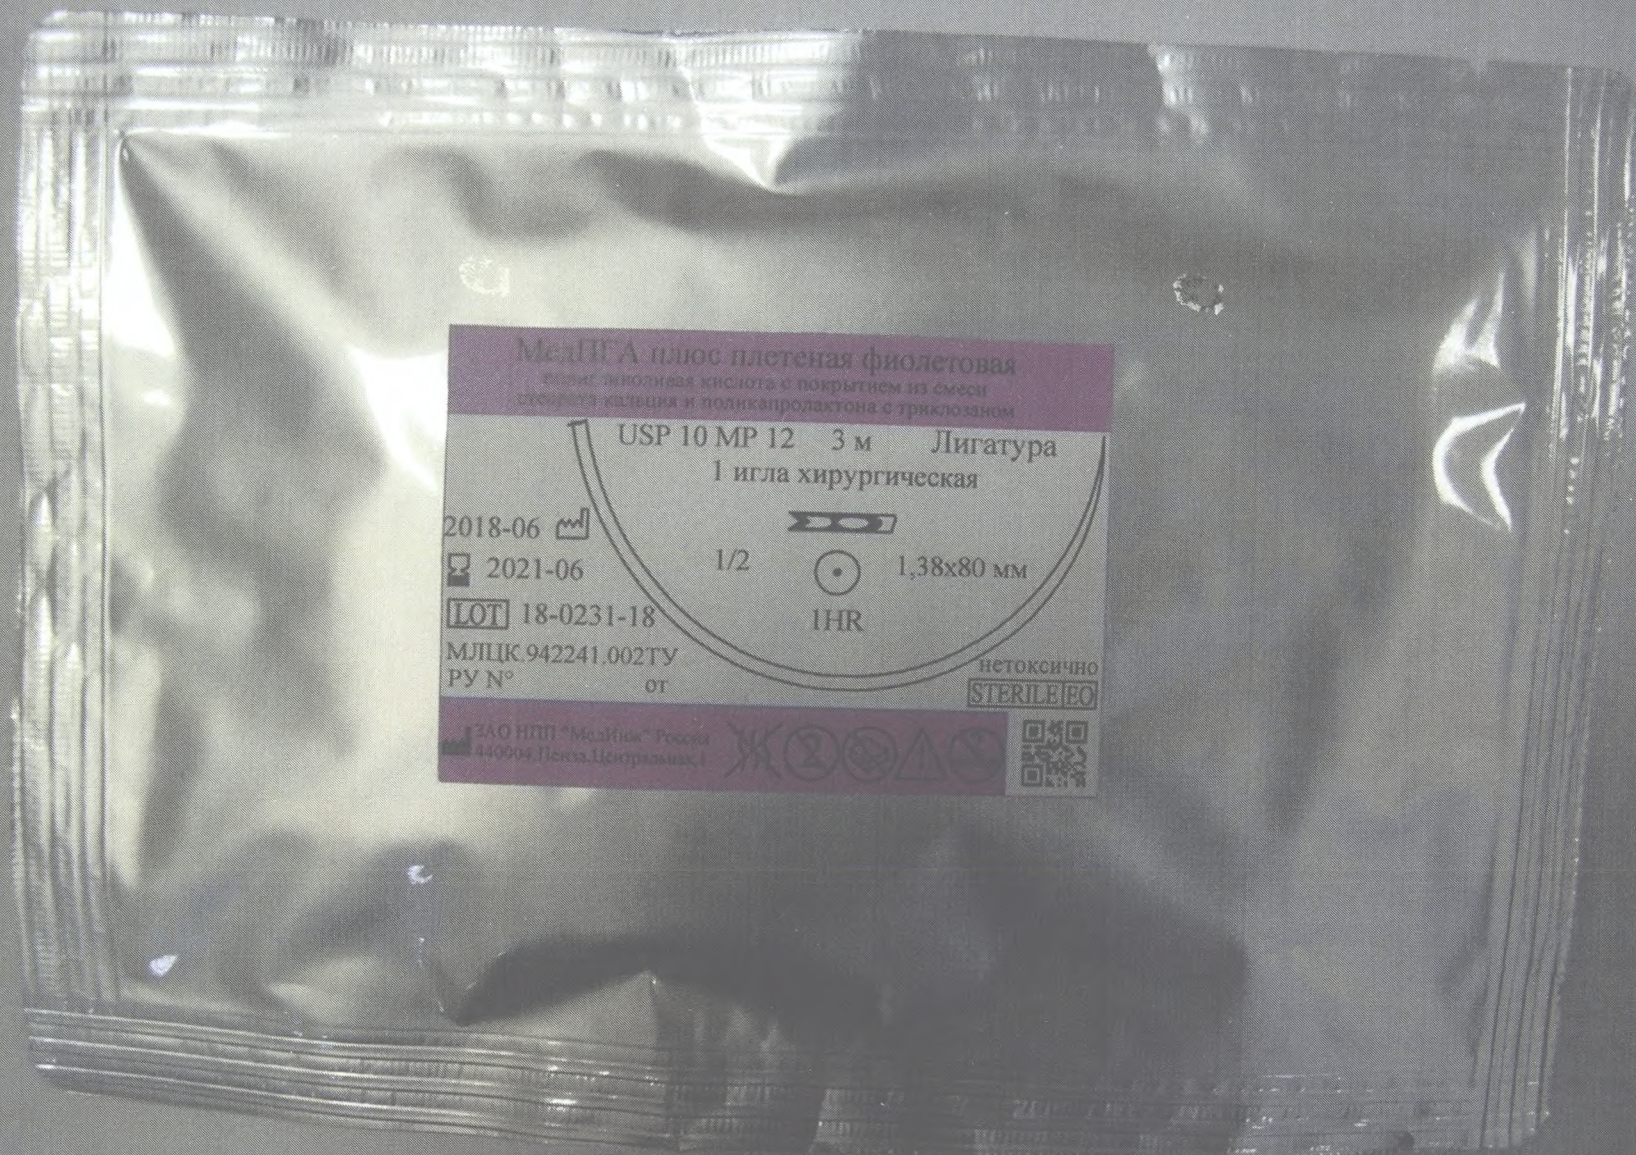

МедПГА плюс плетеная фиолетовая
 полигликолиновая кислота с покрытием из смеси
 стеарата кальция и поликапролактона с триклозаном

USP 10 MP 12 3 м Лигатура
 1 игла хирургическая

2018-06 2021-06 1/2 1,38x80 мм

LOT 18-0231-18 IHR

МЛЦК 942241.002ТУ
 РУ N° от

нетоксично
 STERILE PO

ЗАО НПФ «МедИнж» Россия
 440004 Пенза, Центральная

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

МедПГА 910 плюс плетеная фиолетовая
 полигликолид лактид с покрытием из смеси стеарата кальция
 и полигликолид лактида 30/70 с триклозаном

USP 2-0 MP 3 5 м 1 игла хирургическая

Лигатура

LOT 18-0231-01


2018-04 

 2021-04

МЛЦК.942241.002ТУ

РУ N° от

1/2  0,45x25 мм

 1HQ


НЕТОКСИЧНО

STERILE EO


ЗАО НПФ "МедИнж" Россия
 440004, Пенза, Центральная, 1

Вариант маркировки упаковки медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

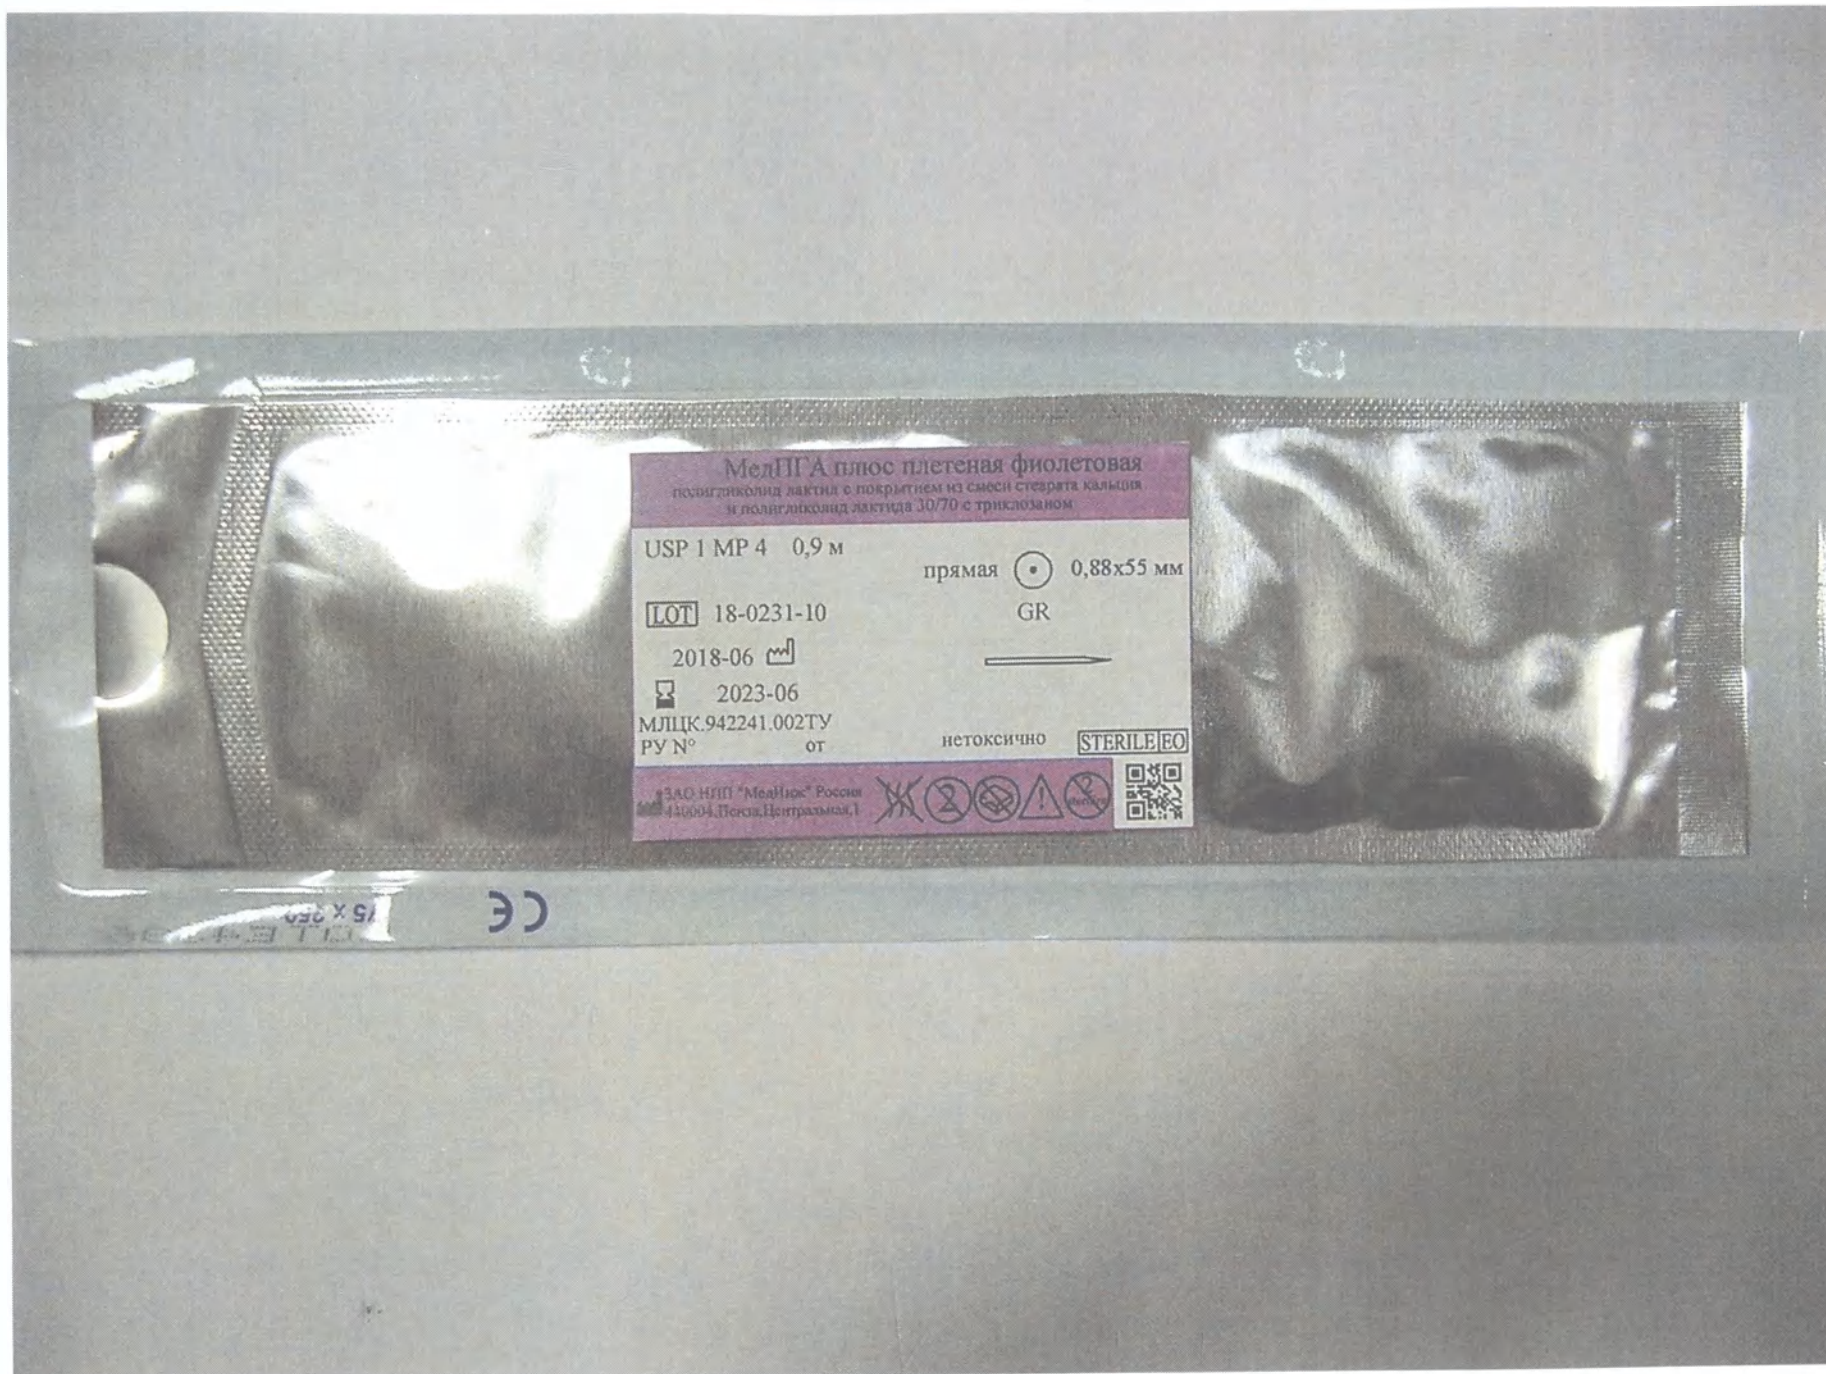

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

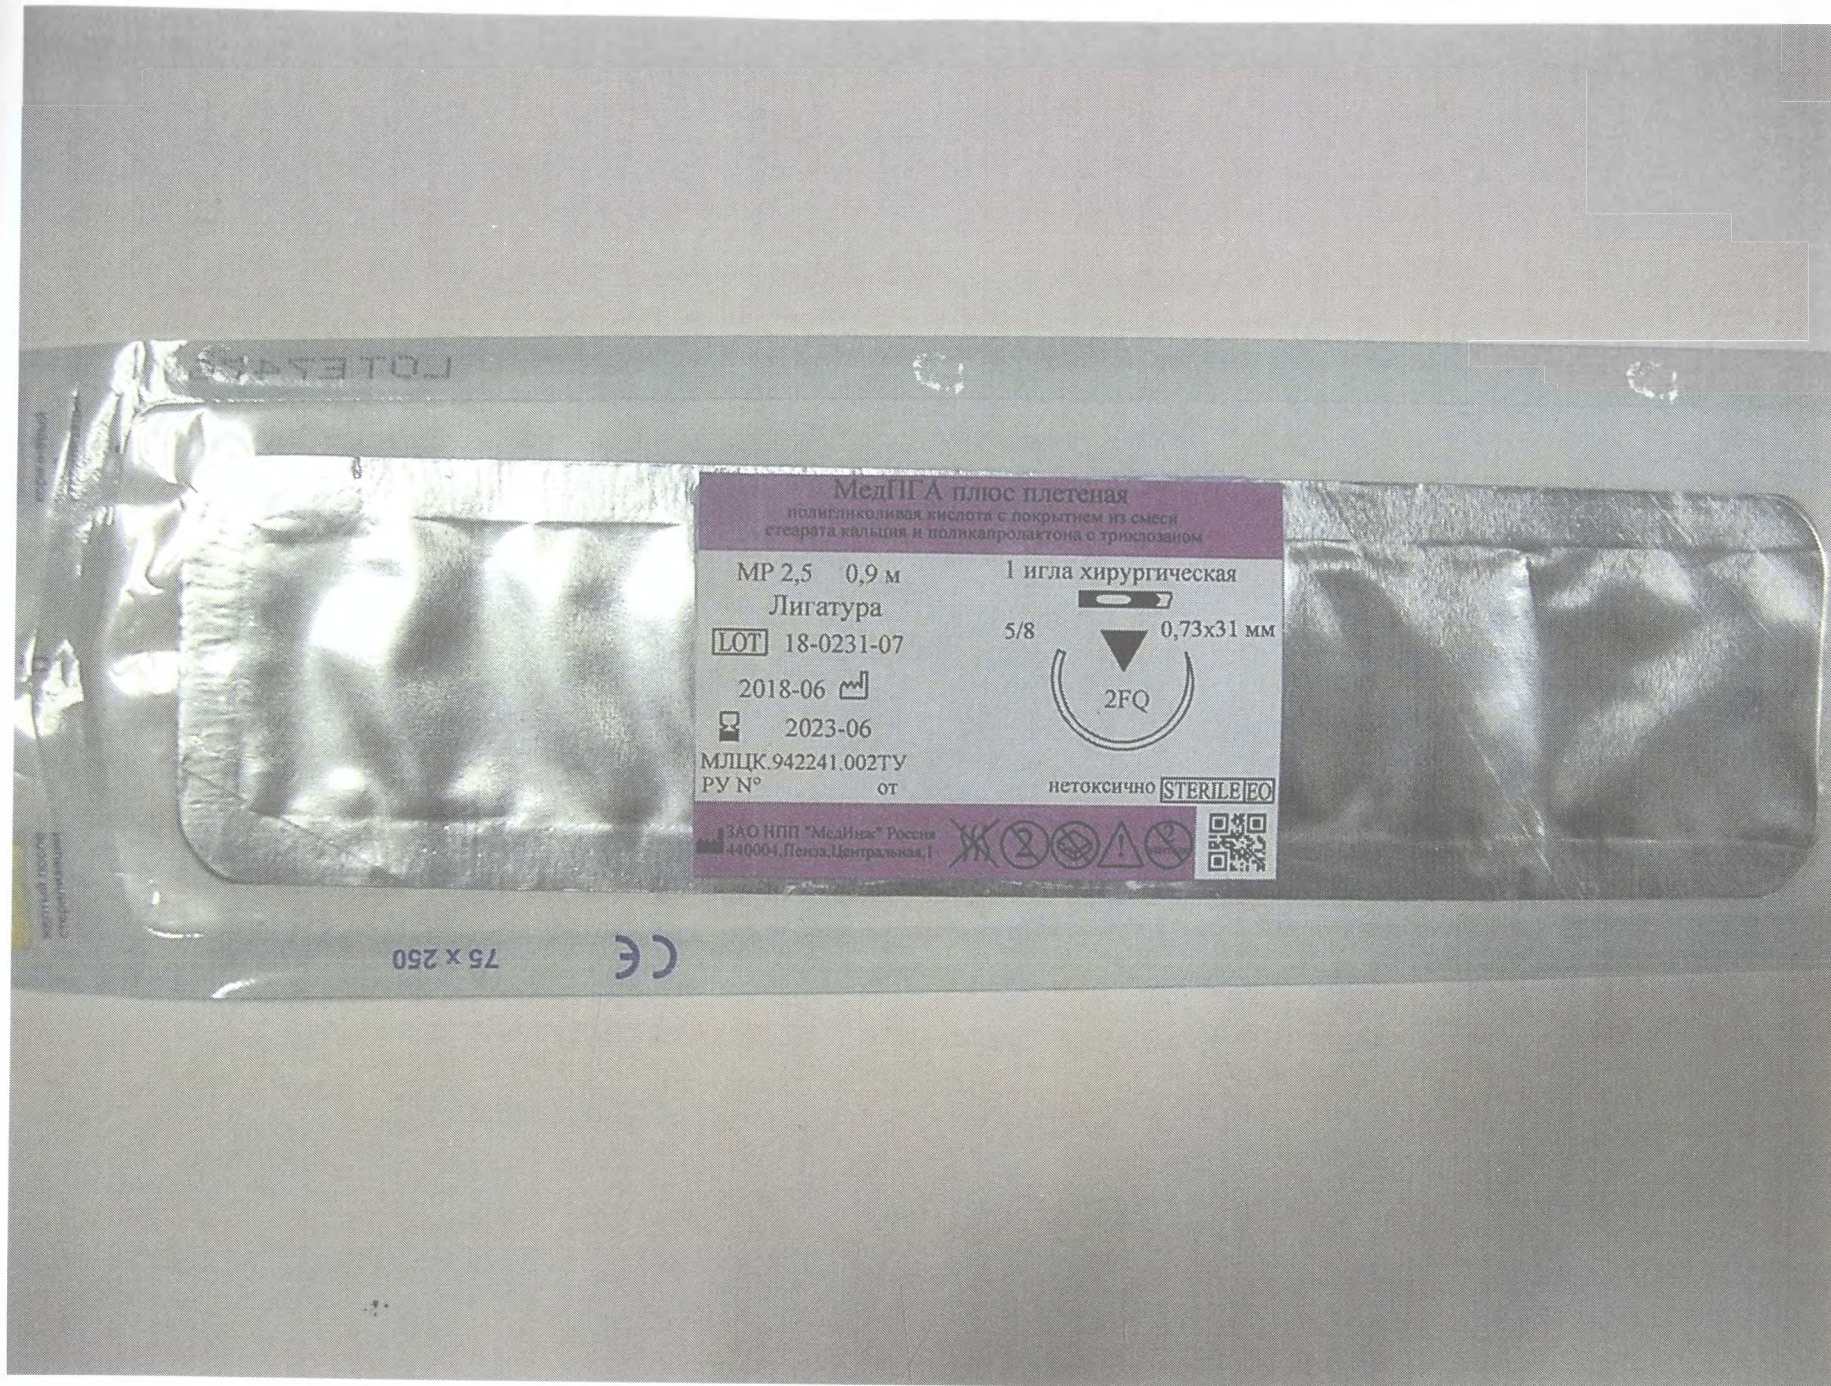

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

ПАР

коричневый
после
стерилизации

EO

желтый после
стерилизации

МедПГА плюс плетеная фиолетовая
полигликолиновая кислота с покрытием из смеси
стеарата кальция и поликапролактона с триклозаном

USP 6 MP 8 0,9 м

LOT 18-0231-14

2018-06

2023-06

МЛЦК.942241.002ТУ

РУ N°

от

1/2 1,20x48 мм



HA


нетоксично

STERILE EO

ЗАО НПП "МедИнж" Россия
440004 Пенза, Центральная, 1



75 x 250



Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

желтый
после
стерилизации

ГОЛ В 2322 60X120

МедПГА 910 плюс плетеная фиолетовая
полигликолид лактид с покрытием из смеси стеарата кальция
и полигликолид лактида 30/70 с триклозаном

USP 5 - 0 MP 1 2x0,9 м

LOT 18-0231-22

2018-06 

 2023-06


МЛЦК.942241.002ТУ

РУ № от

5/8



0,68x19 мм



нетоксично

STERILE EO

ЗАО НПП "МедИнж" Россия
440004, Пенза, Центральная, 1



Не применять, если упаковка повреждена

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ



Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

Не применять, если упаковка повреждена

МедПГА 910 плетеная

полигликолид лактид с покрытием из смеси стеарата кальция
и полигликолид лактида 30/70 с триклозаном

USP 7 - 0 MP 0,5 0,9 м

LOT 18-0231-21


2018-06

2023-06

МЛЦК.942241.002ТУ

РУ N° от

3/8 0,33x15 мм



нетоксично

STERILE EO

ЗАО НПП "МедИнж" Россия
440004, Пенза, Центральная, 1



желтый
после
стерилизации

EO

021X03 2525 8 TOL

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

МАТЕРИАЛ ШОВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ,
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТЕРИЛЬНЫЙ,
С ИГЛАМИ И БЕЗ ИГЛ

«МЕДИНЖ»

МЛЦК.942241.002 ТУ

РУ _____ ОТ _____

Комплектация изделия

МедПГА плюс плетеная фиолетовая
полигликоливая кислота с покрытием из смеси
стеарата кальция и поликапролактона с триклозаном

USP 2-0 MP 3 5м

20 ШТ

Лигатура

2018-04



2021-04

LOT

18-0231-03



МедИнж

440006, Тбилиси, ул. Центральная, д.1
т/ф 2913, факс/факс: (9412) 38-09-40,
(9412) 38-09-59, (9412) 39-47-63
E-mail: info@medinj.ru
http://www.medinj.ru

НЕТОКСИЧНО

STERILE

EO



Вариант маркировки групповой тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

МАТЕРИАЛ ШОВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ,
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СТЕРИЛЬНЫЙ,
С ИГЛАМИ И БЕЗ ИГЛ

«МЕДИНЖ»

МЛЦК.942241.002 ТУ

РУ _____ ОТ _____

Комплектация изделия

МедПГА плюс плетеная фиолетовая
полигликоливая кислота с покрытием из смеси
стеарата кальция и поликапролактона с триклозаном

USP 2-0 MP 3 5м

20 ШТ

Лигатура

2018-04

2021-04

LOT

18-0231-03



МедИнж
440004, Пенза, ул. Центральная, д.3
а/я 2912, тел./факс (8412) 38-09-64,
(8412) 38-09-59, (8412) 93-47-43
E-mail: medinj@yandex.ru
http://www.medinzh.ru

нетоксично

STERILE

EO



Вариант маркировки групповой тары медицинского изделия «Материал шовный хирургический рассасывающийся, с антибактериальным покрытием, стерильный, с иглами и без игл «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942241.002 ТУ

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

12 ЛИСТОВ

ВЛ

