

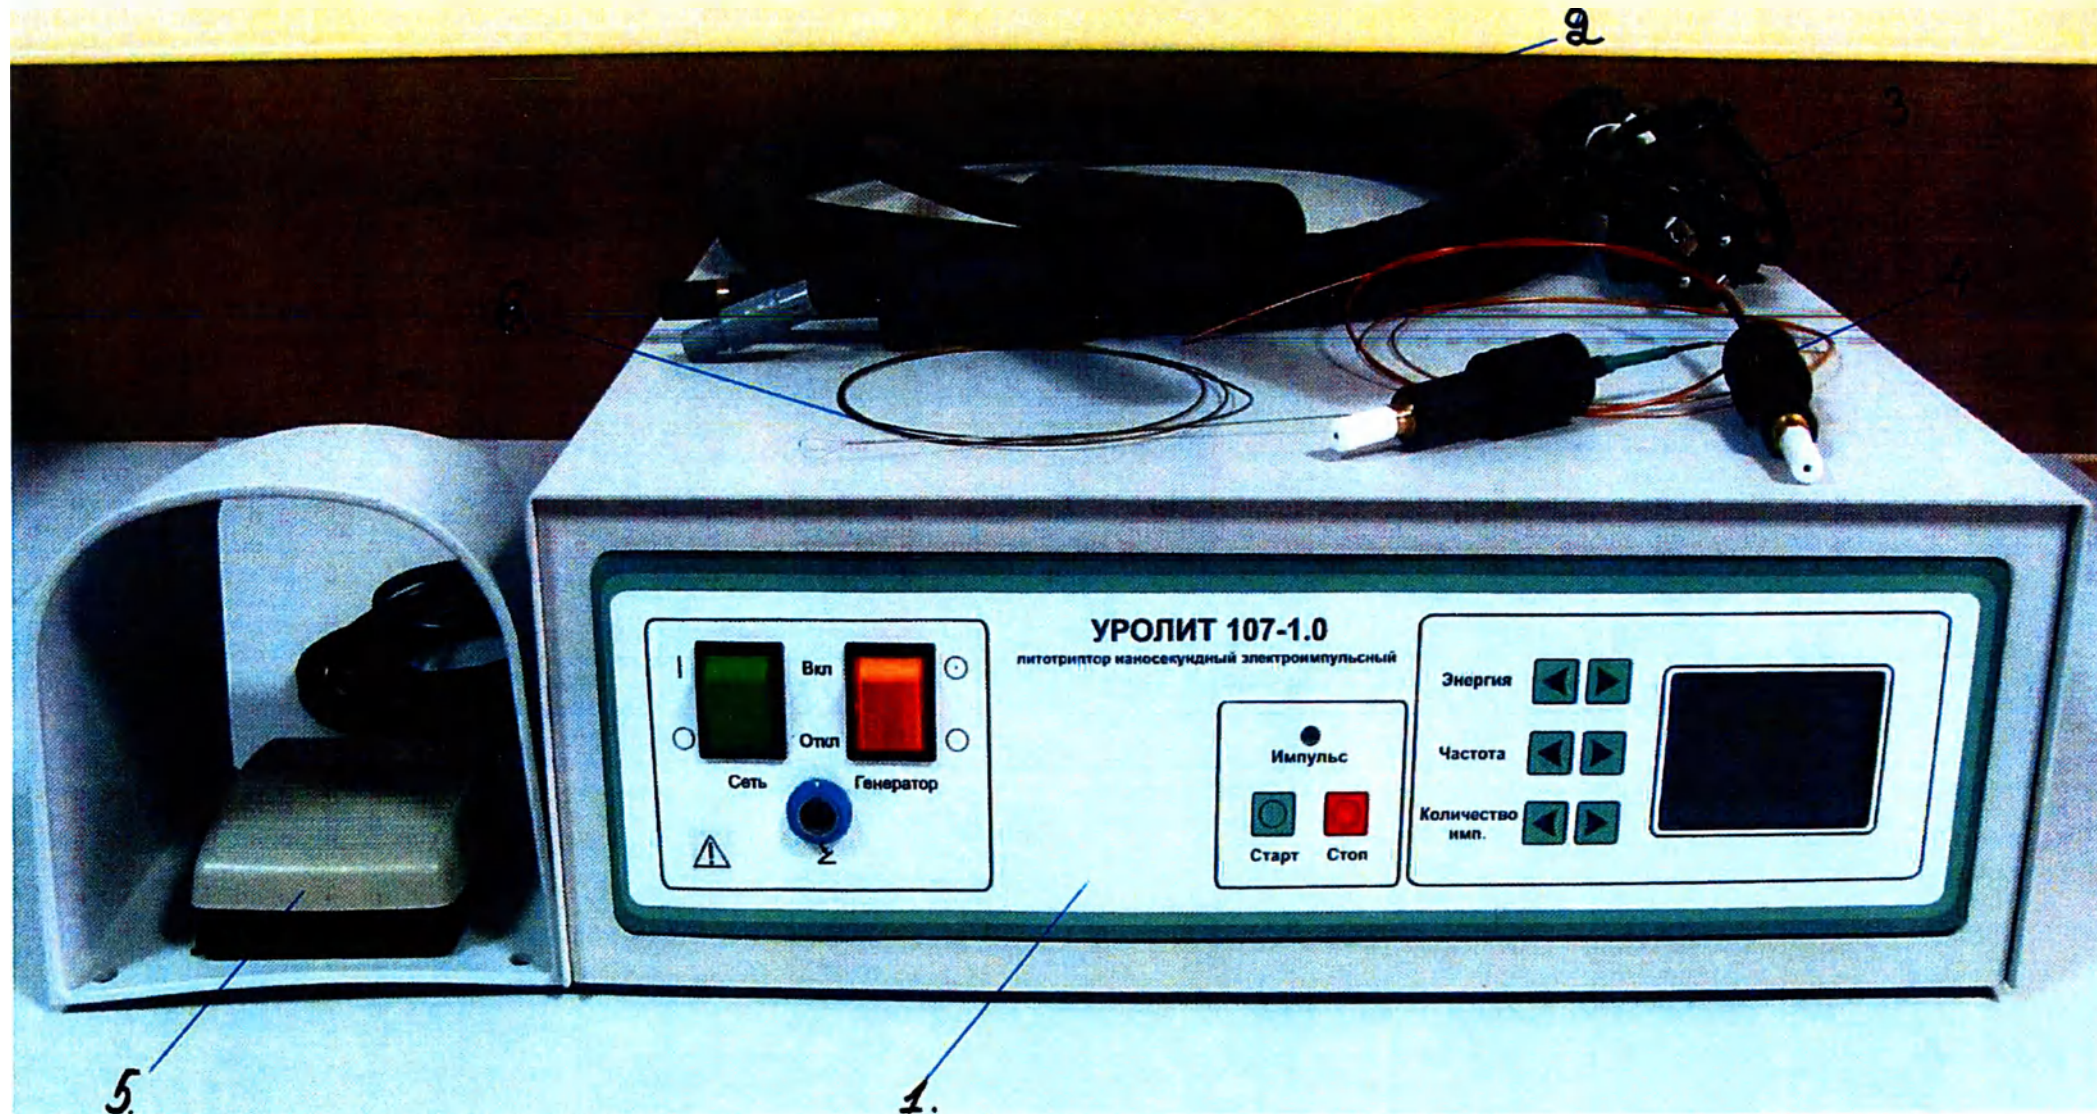


Фото 1. Литотриптор наносекундный электроимпульсный «Уролит-107» по ТУ 9442-001-36280340-2015, модель:

«Уролит-107-1.0» - для лечения мочекаменной болезни.

Общий Вид: 1-генератор импульсов, 2- передающий кабель, 3 – сетевой кабель, 4 – зонд для литотрипсии, 5 - педаль управления, 6 - нитиноловый зонд-экстрактор

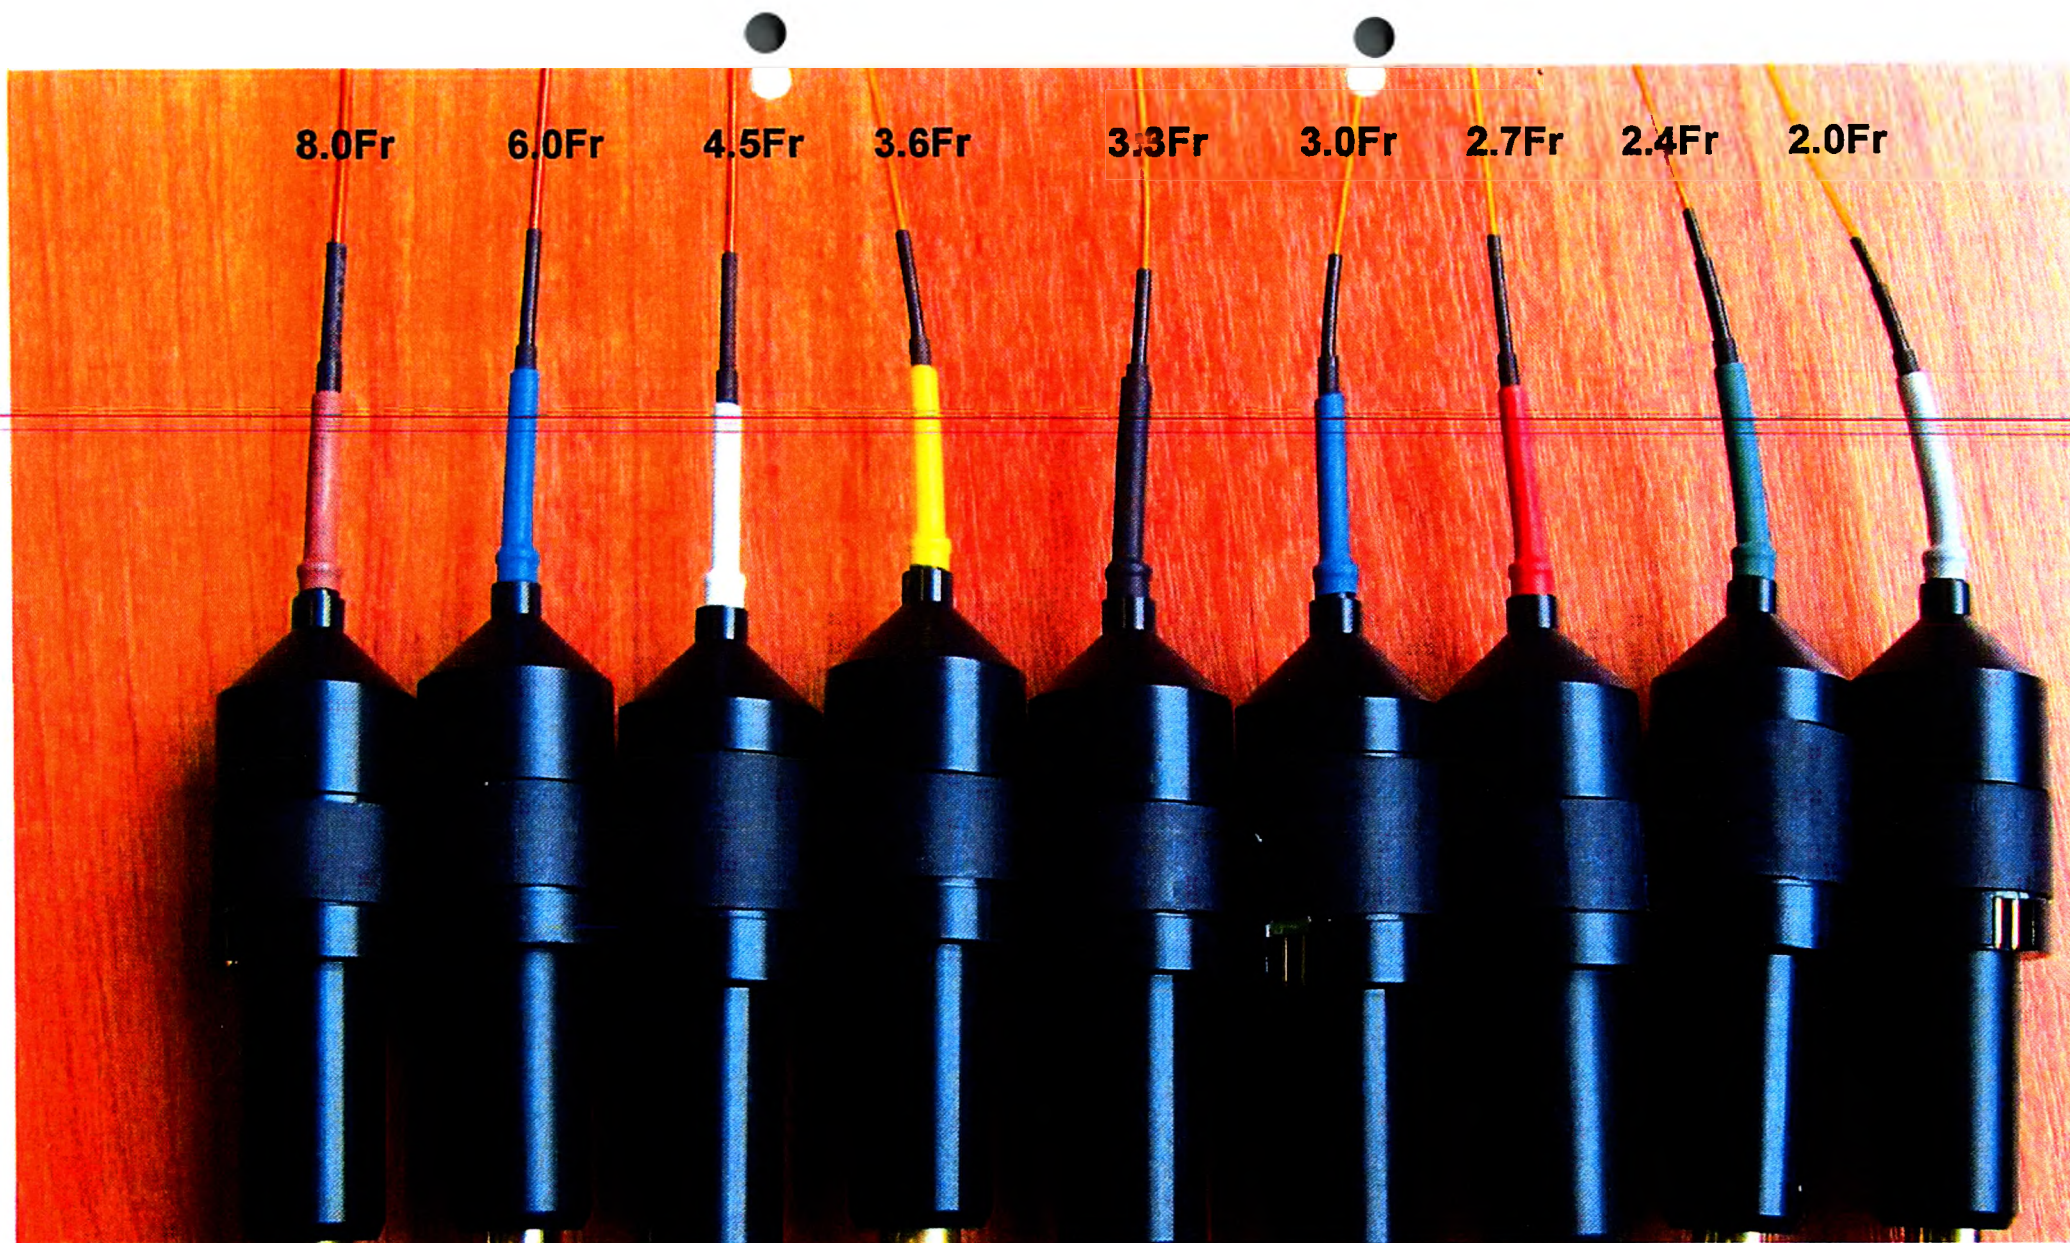


Фото 2. Литотриптор наносекундный электроимпульсный «Уролит-107» по ТУ 9442-001-36280340-2015, модель:
«Уролит-107-1.0» - для лечения мочекаменной болезни
Зонды для литотрипсии (все исполнения).



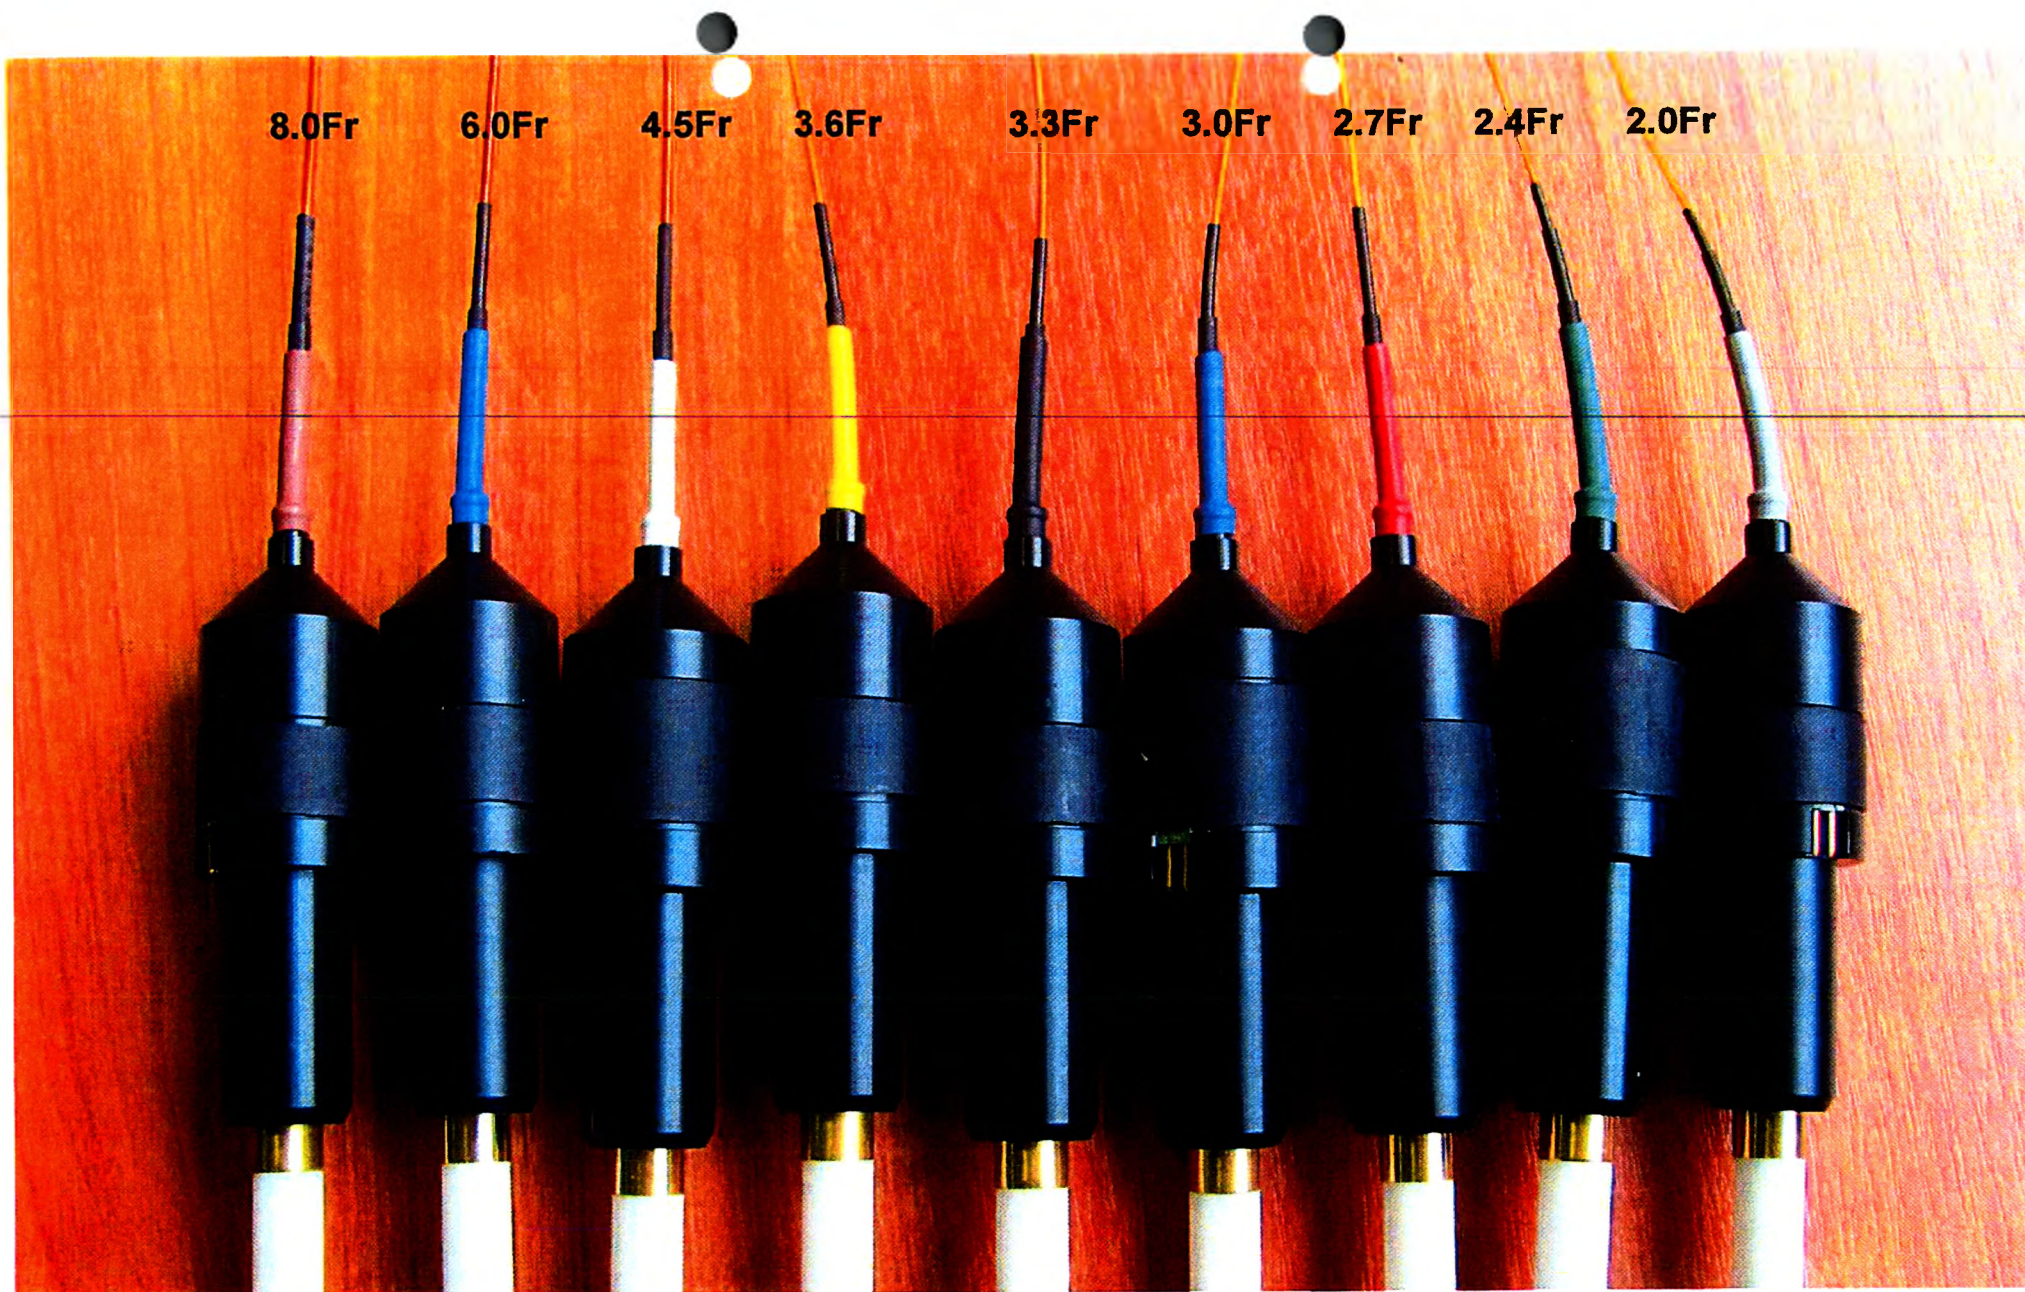


Фото 4. Литотриптор наносекундный электроимпульсный «Уролит-107» по ТУ 9442-001-36280340-2015, модель:
«Уролит-107-0.5» - для лечения желчекаменной болезни
Зонды для литотрипсии (все исполнения).

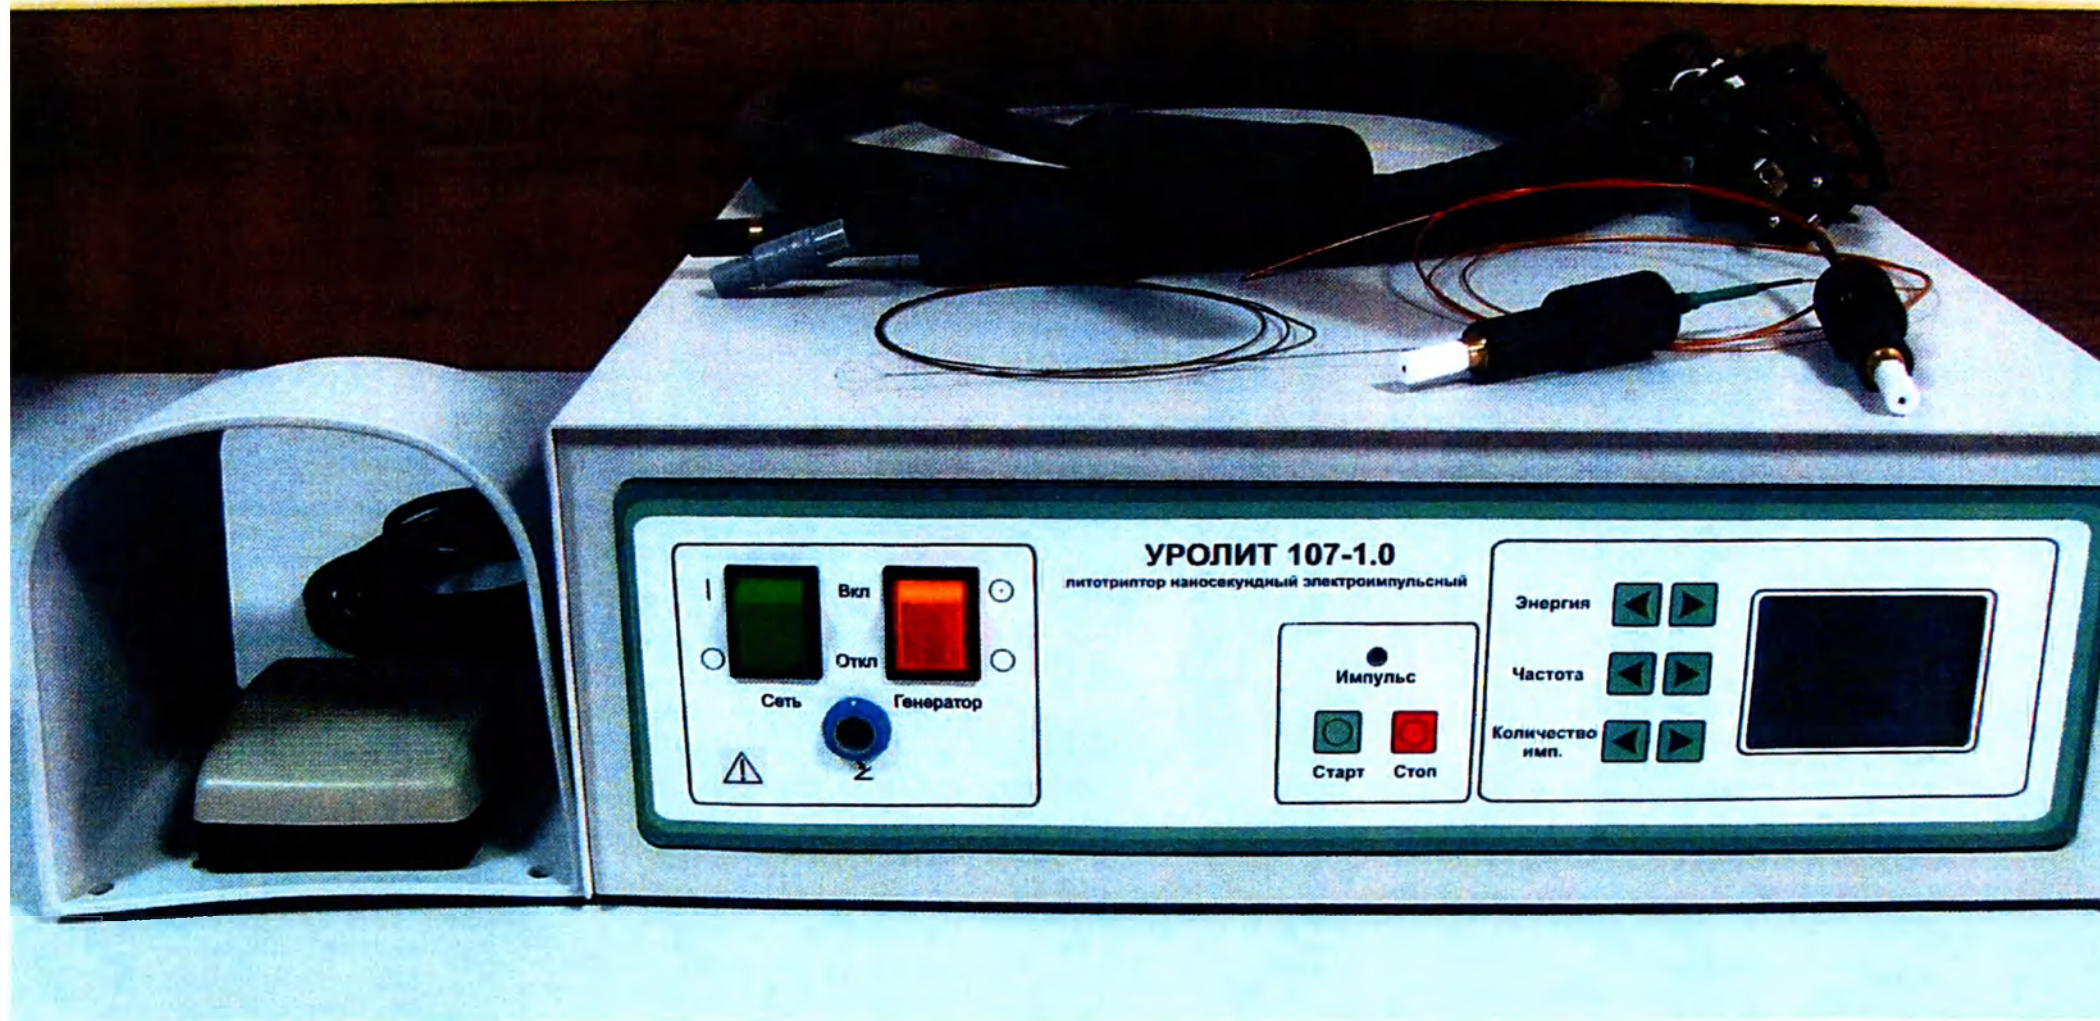


Литотриптор наносекундный электроимпульсный «Уролит-107-1.0»

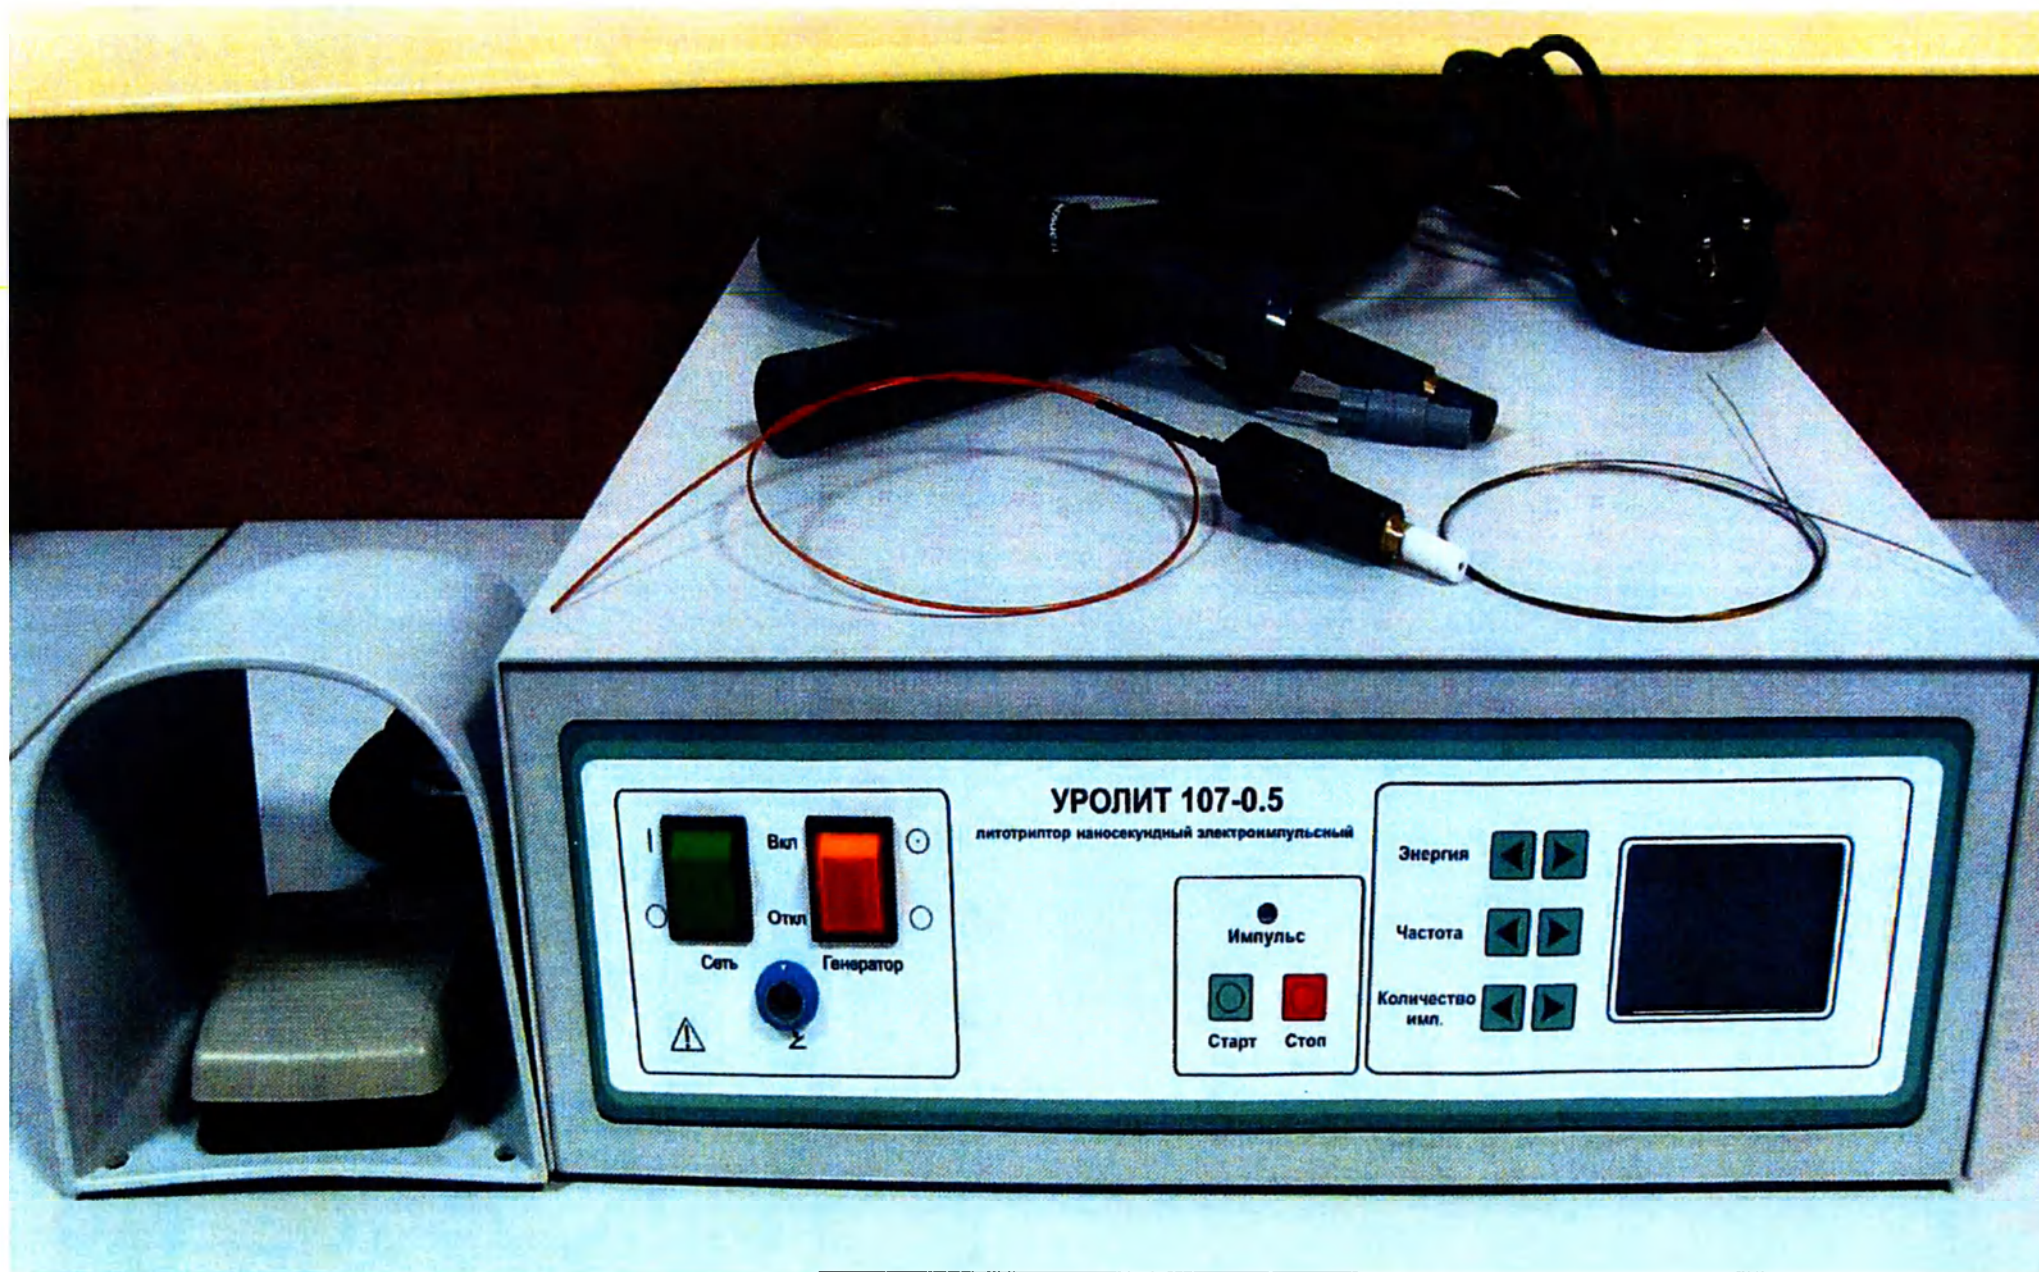


Литотриптор наносекундный электроимпульсный «Уролит-107-0.5»




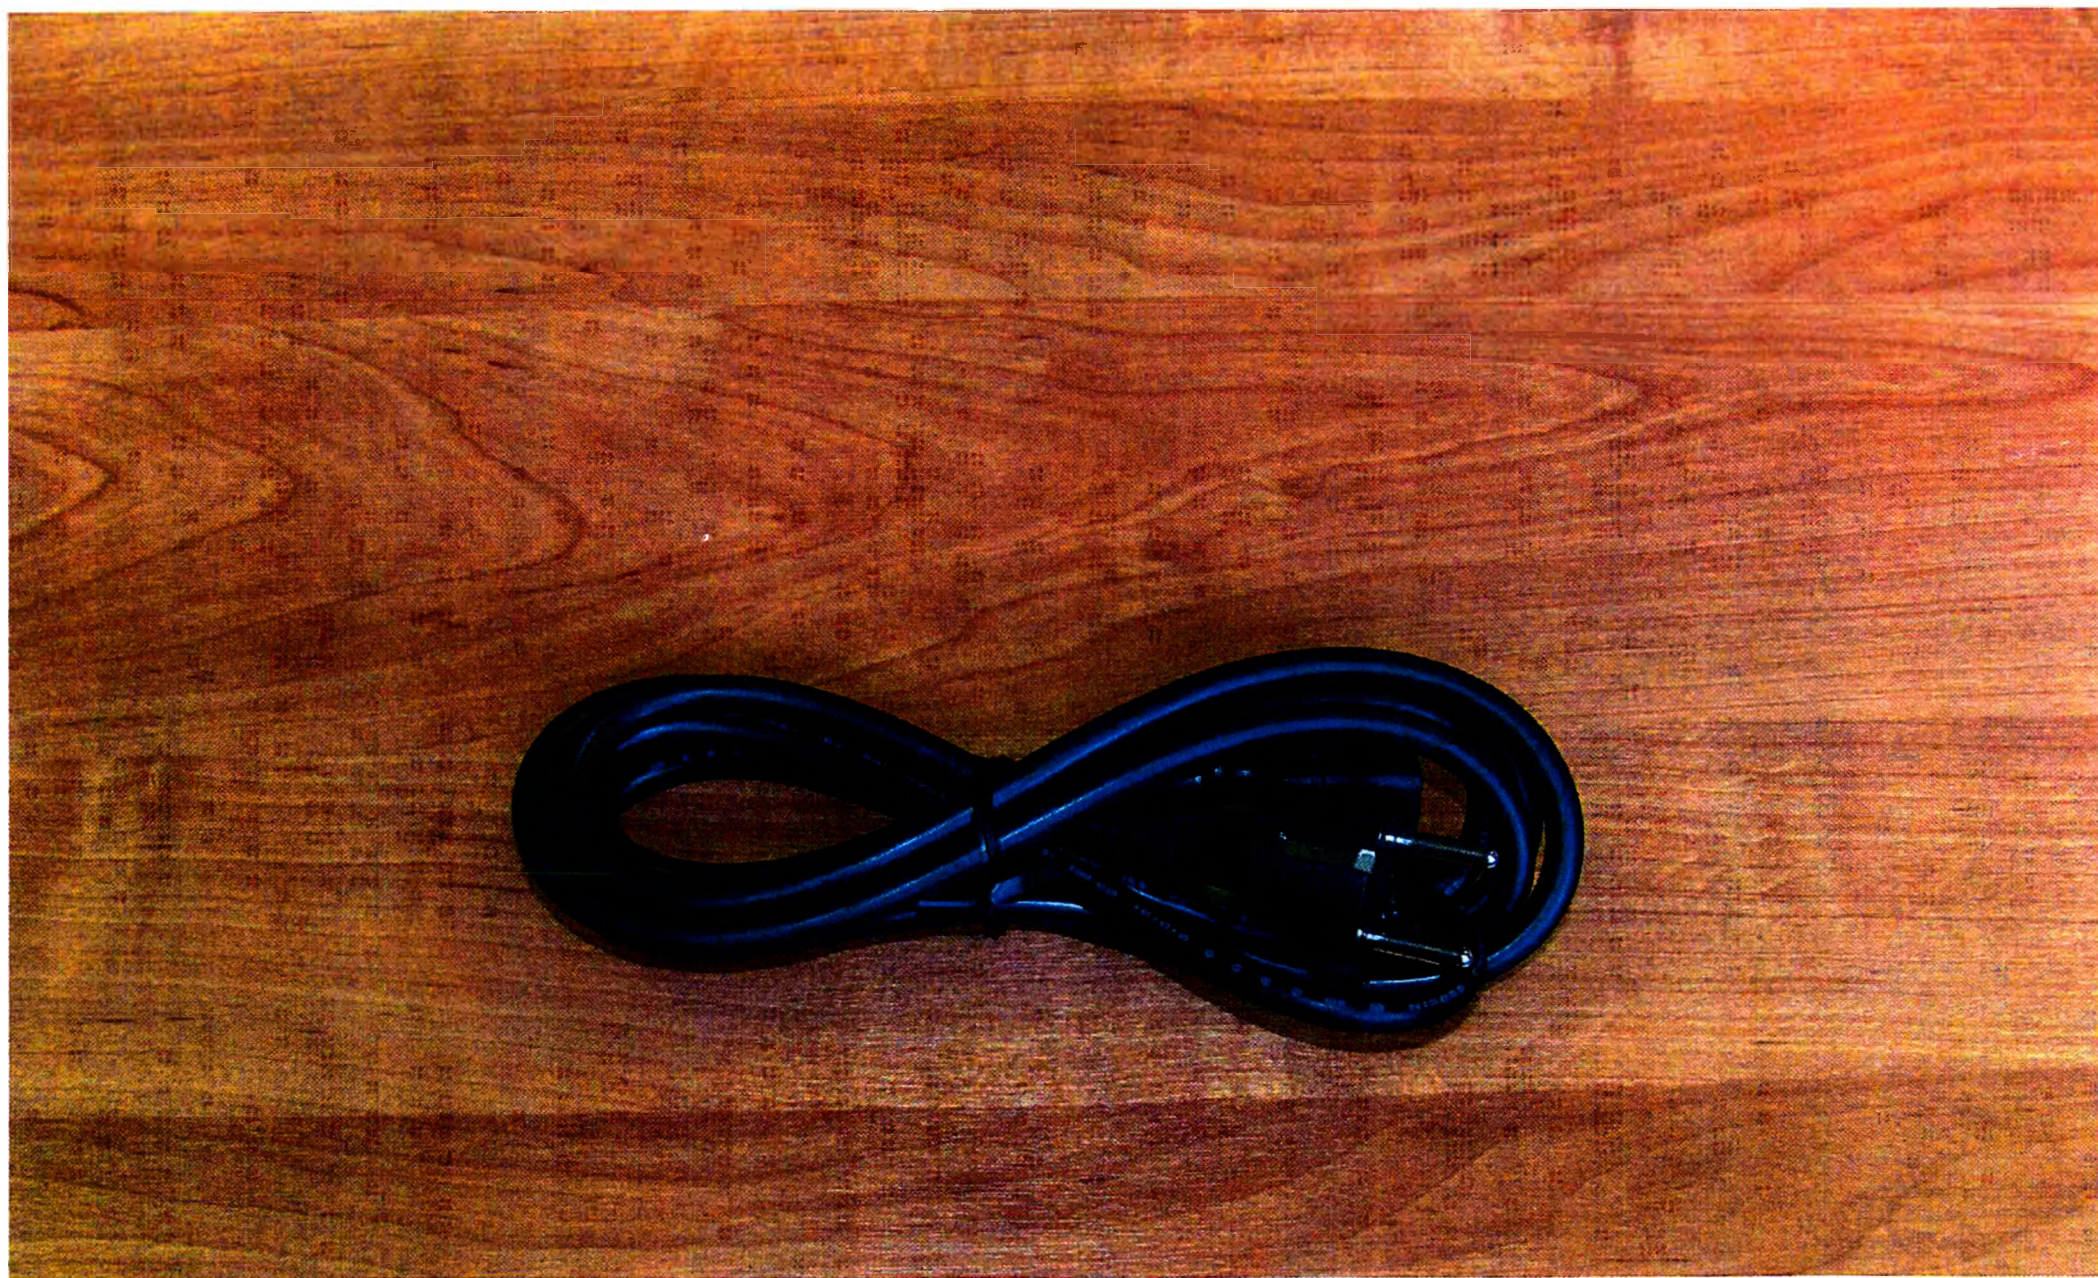


СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ.

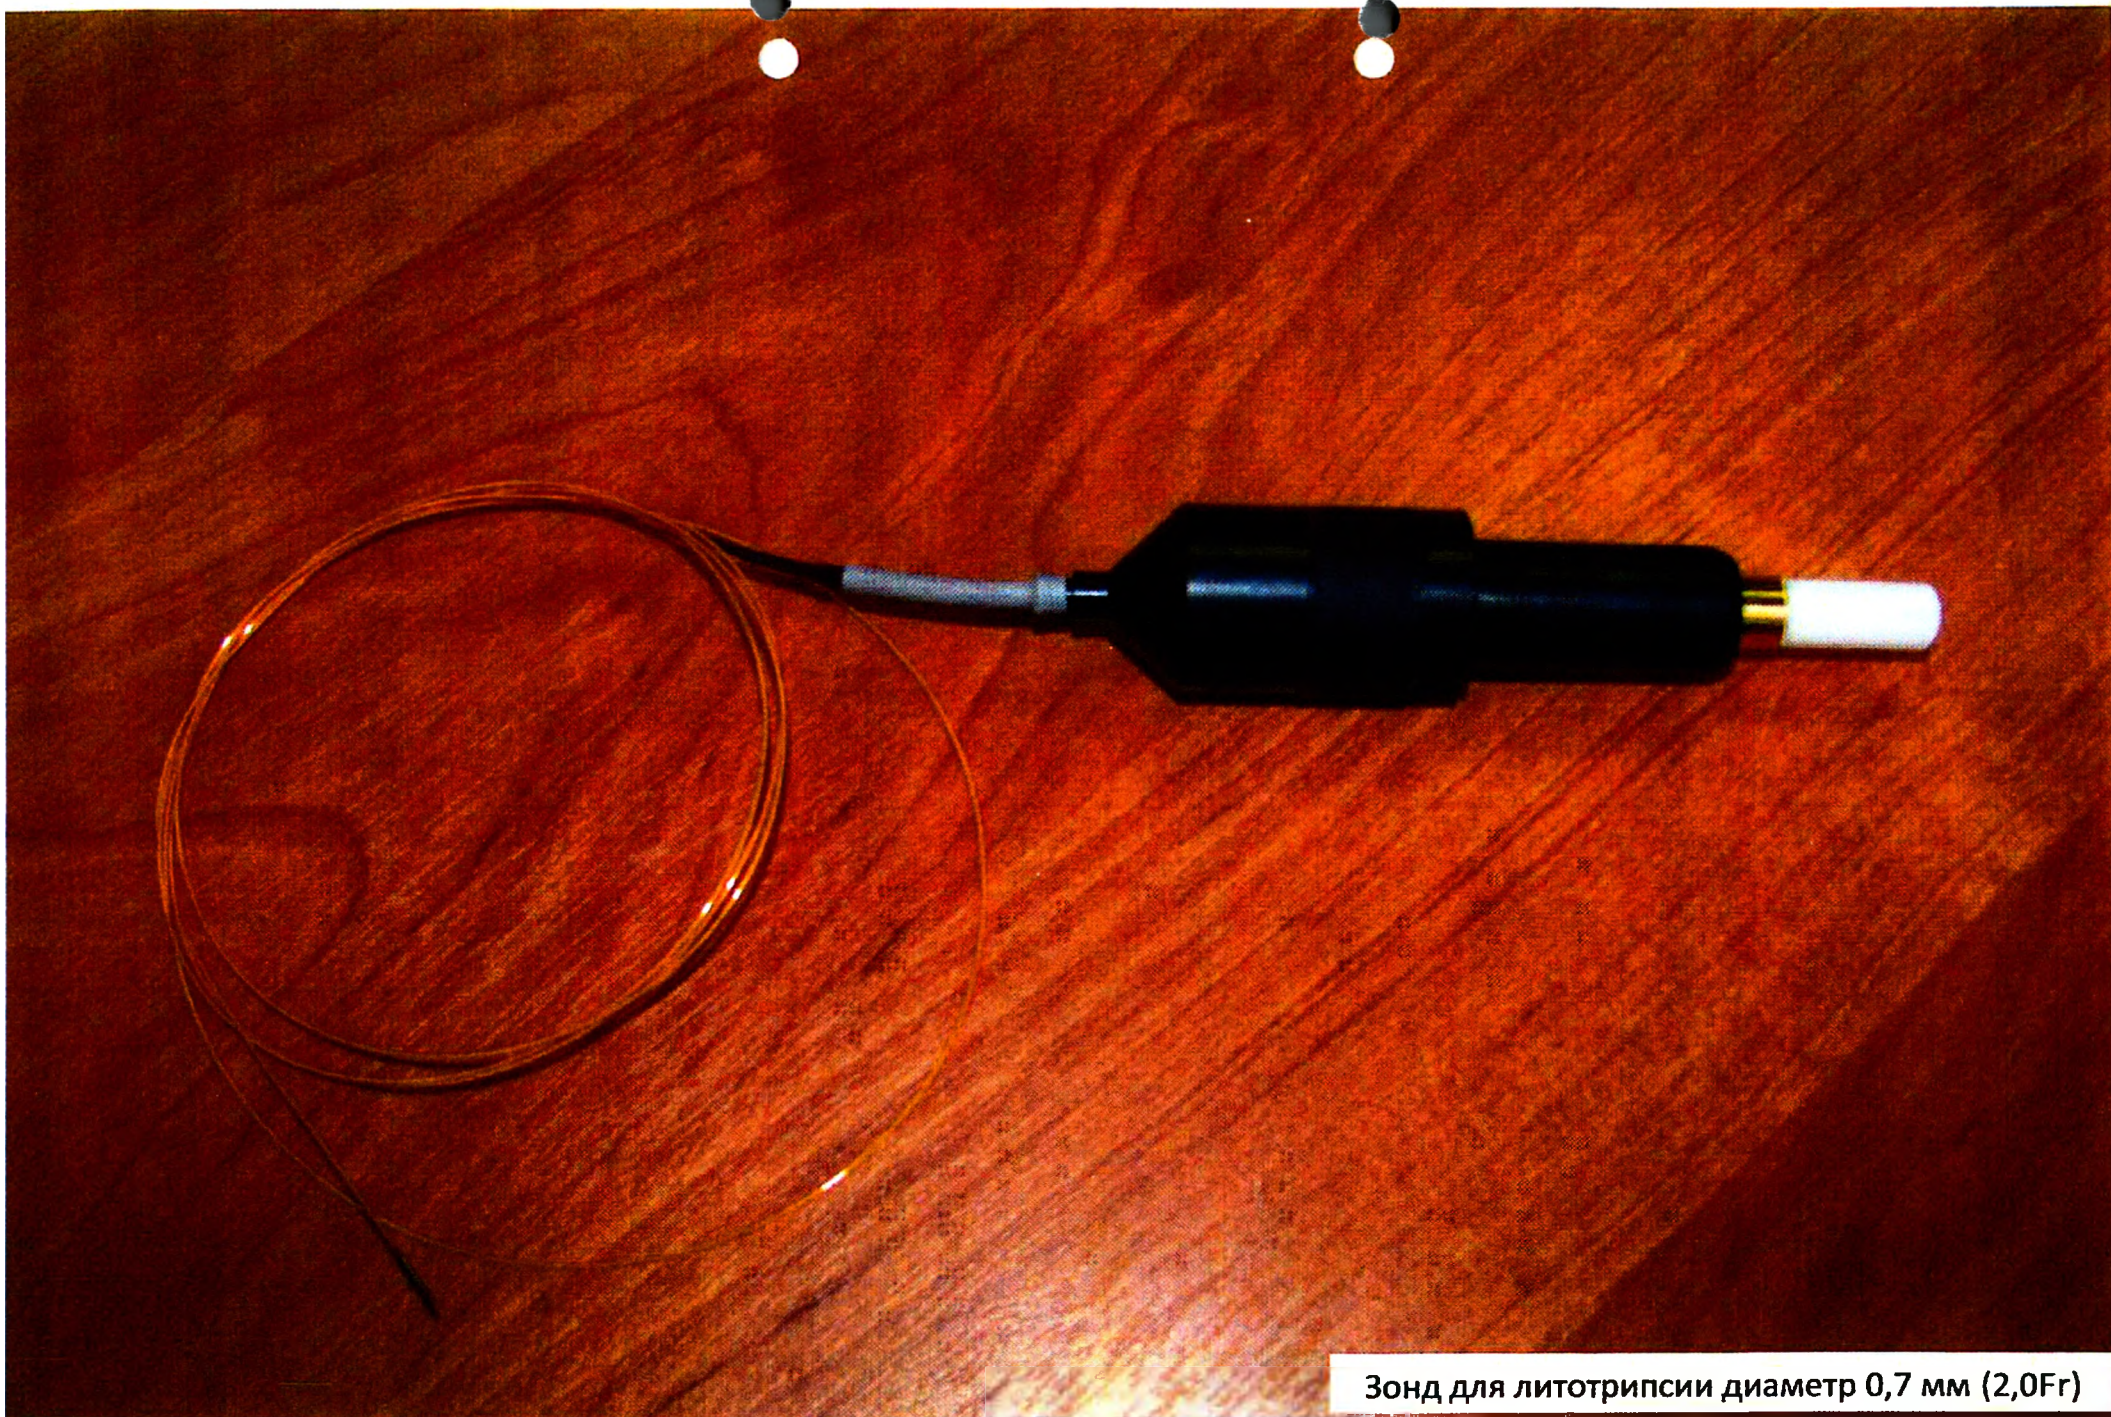

Зонд для литотрипсии диаметр 0,7 мм (2,0Fr)

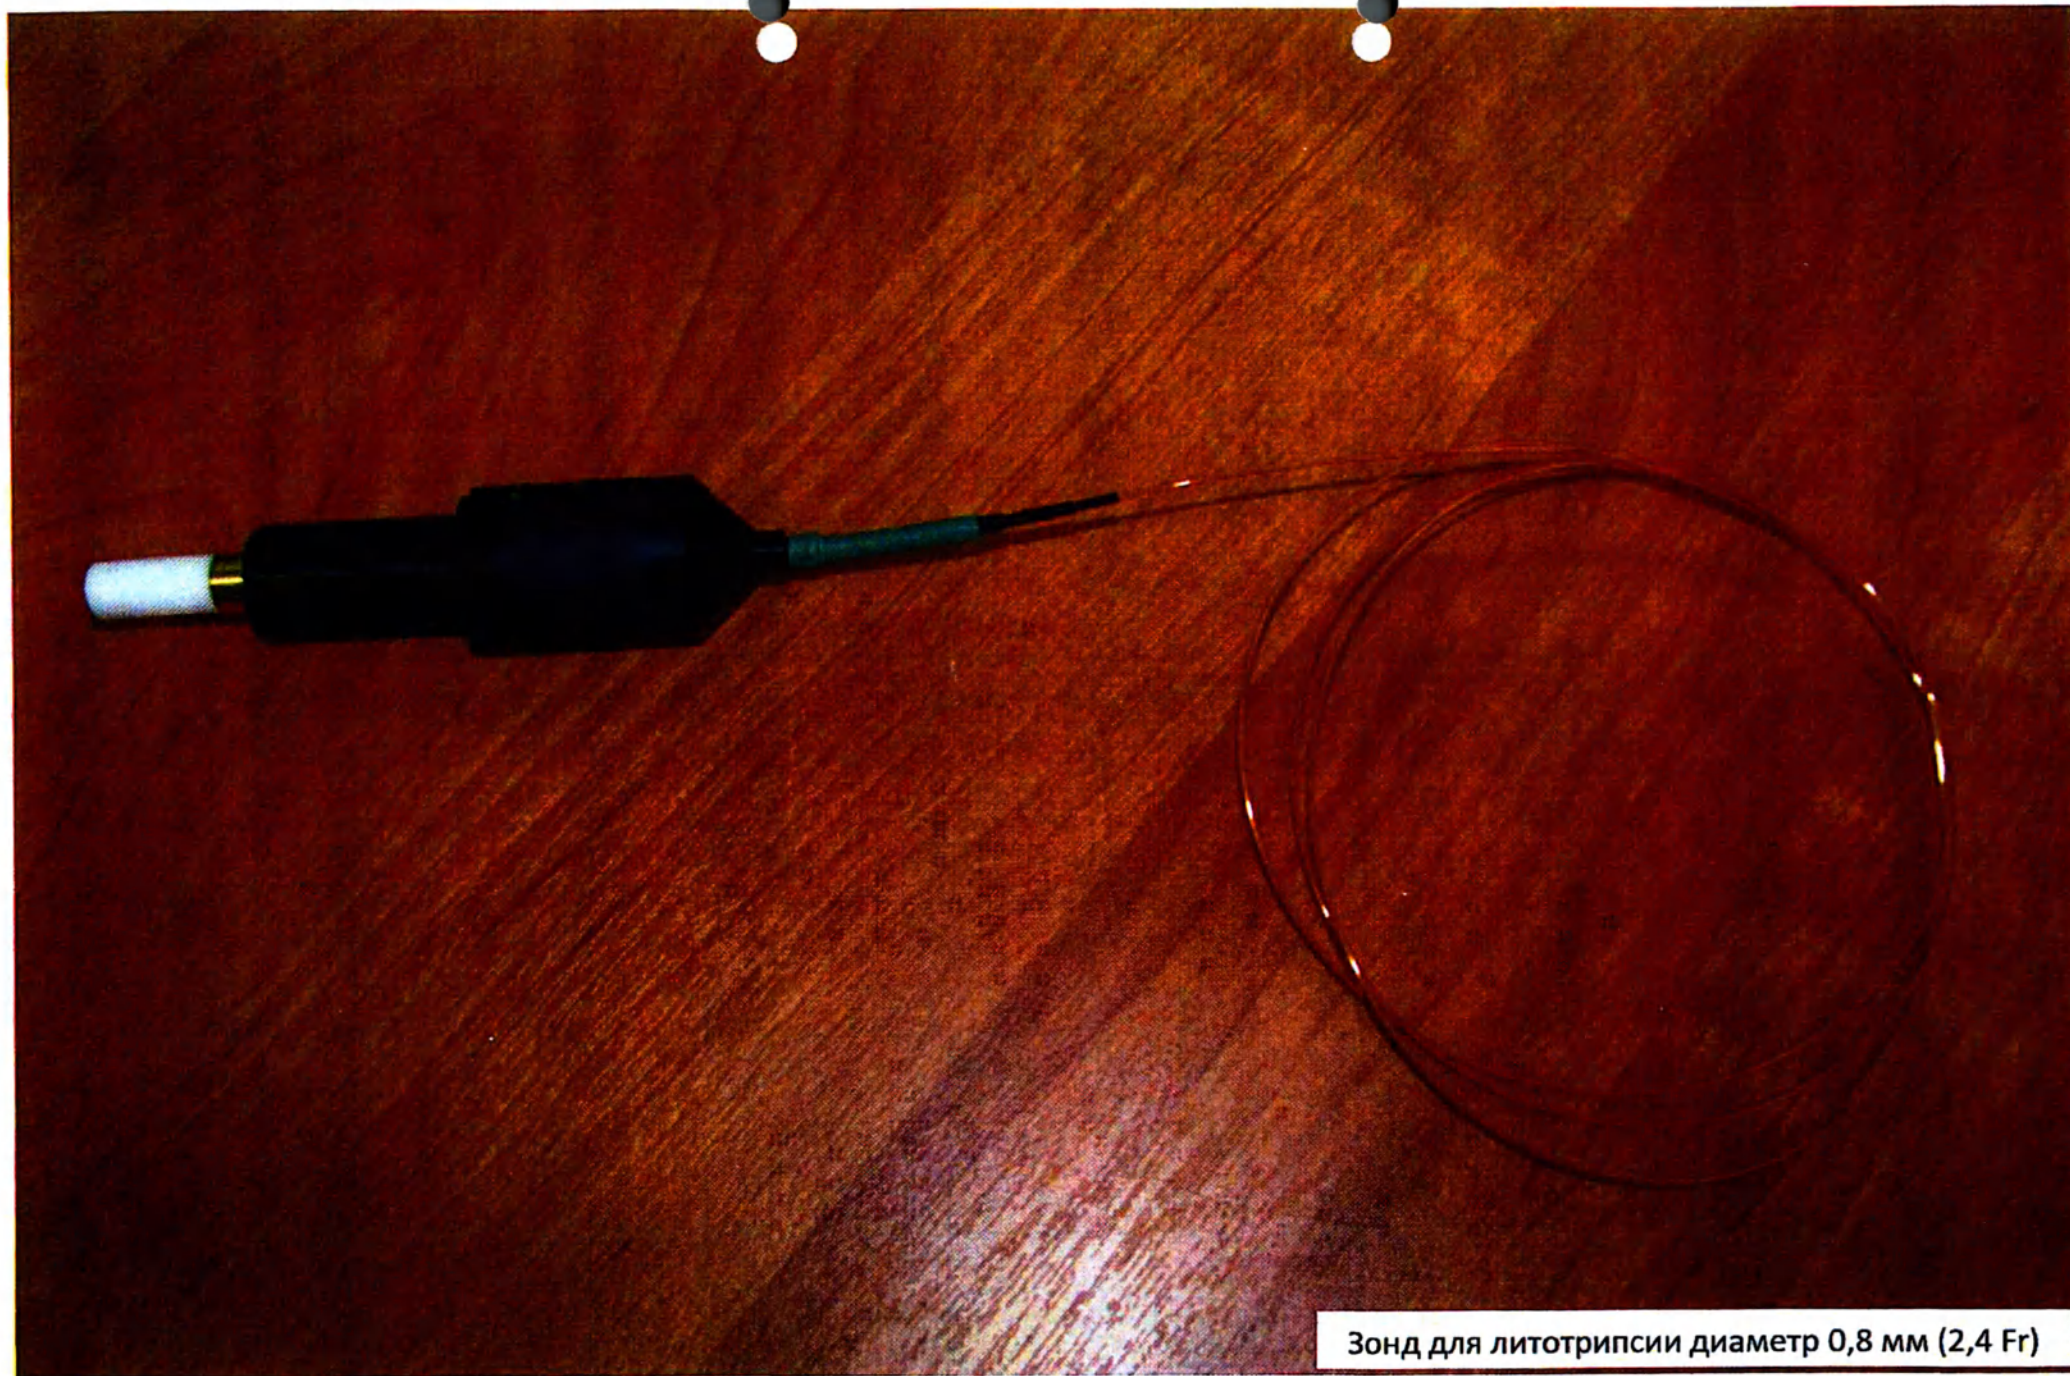



Зонд для литотрипсии диаметр 0,8 мм (2,4 Fr)

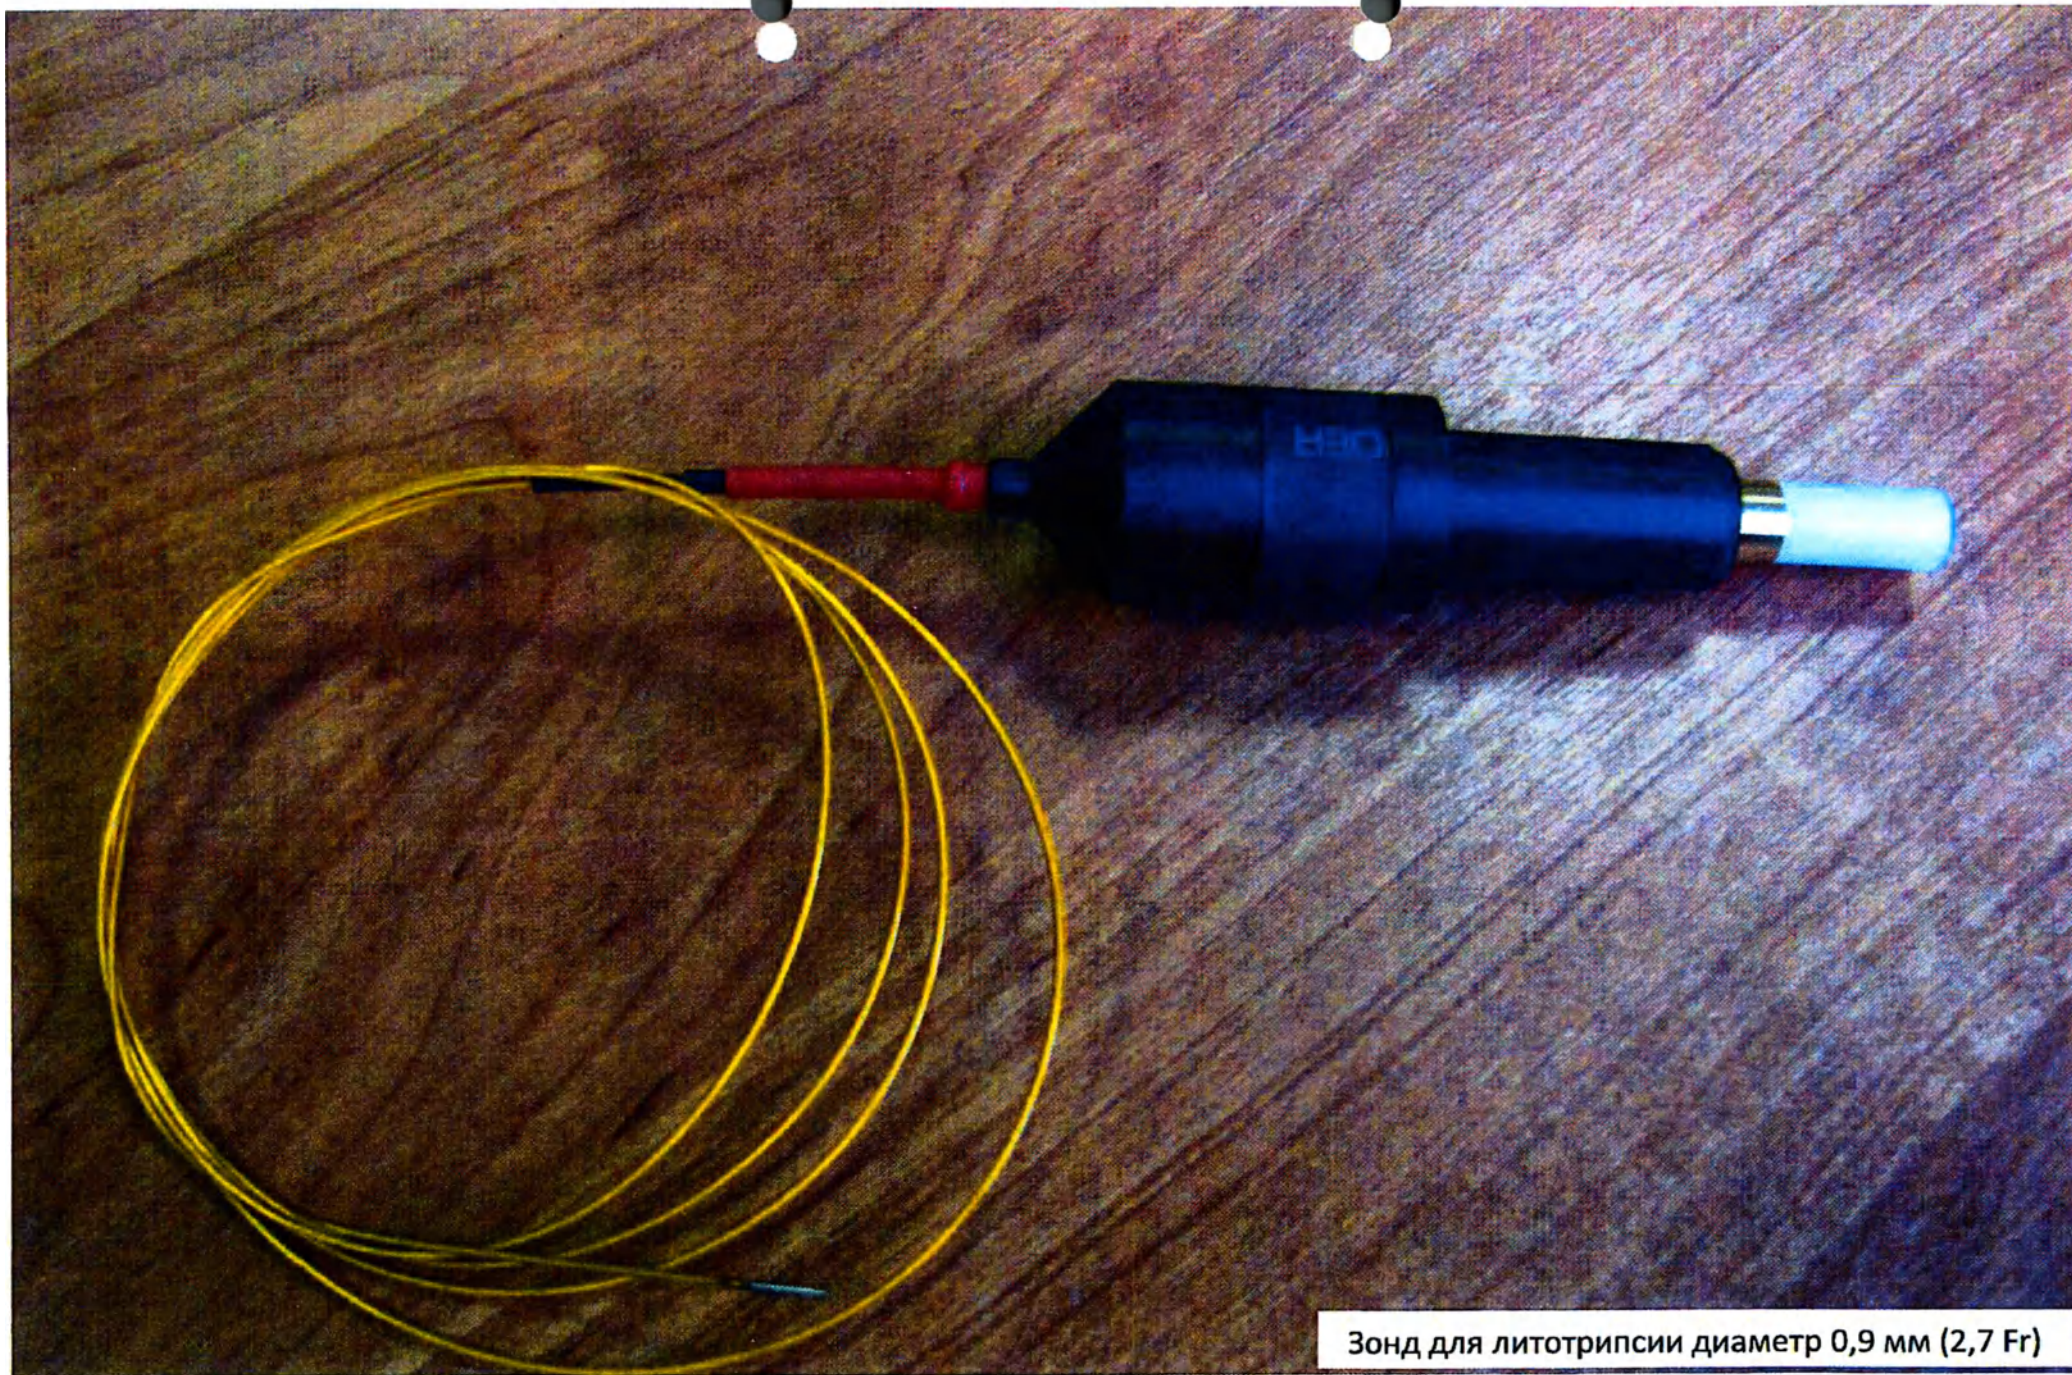


Зонд для литотрипсии диаметр 0,9 мм (2,7 Fr)

Зонд для литотрипсии диаметр 1,0 мм (3,0 Fr)

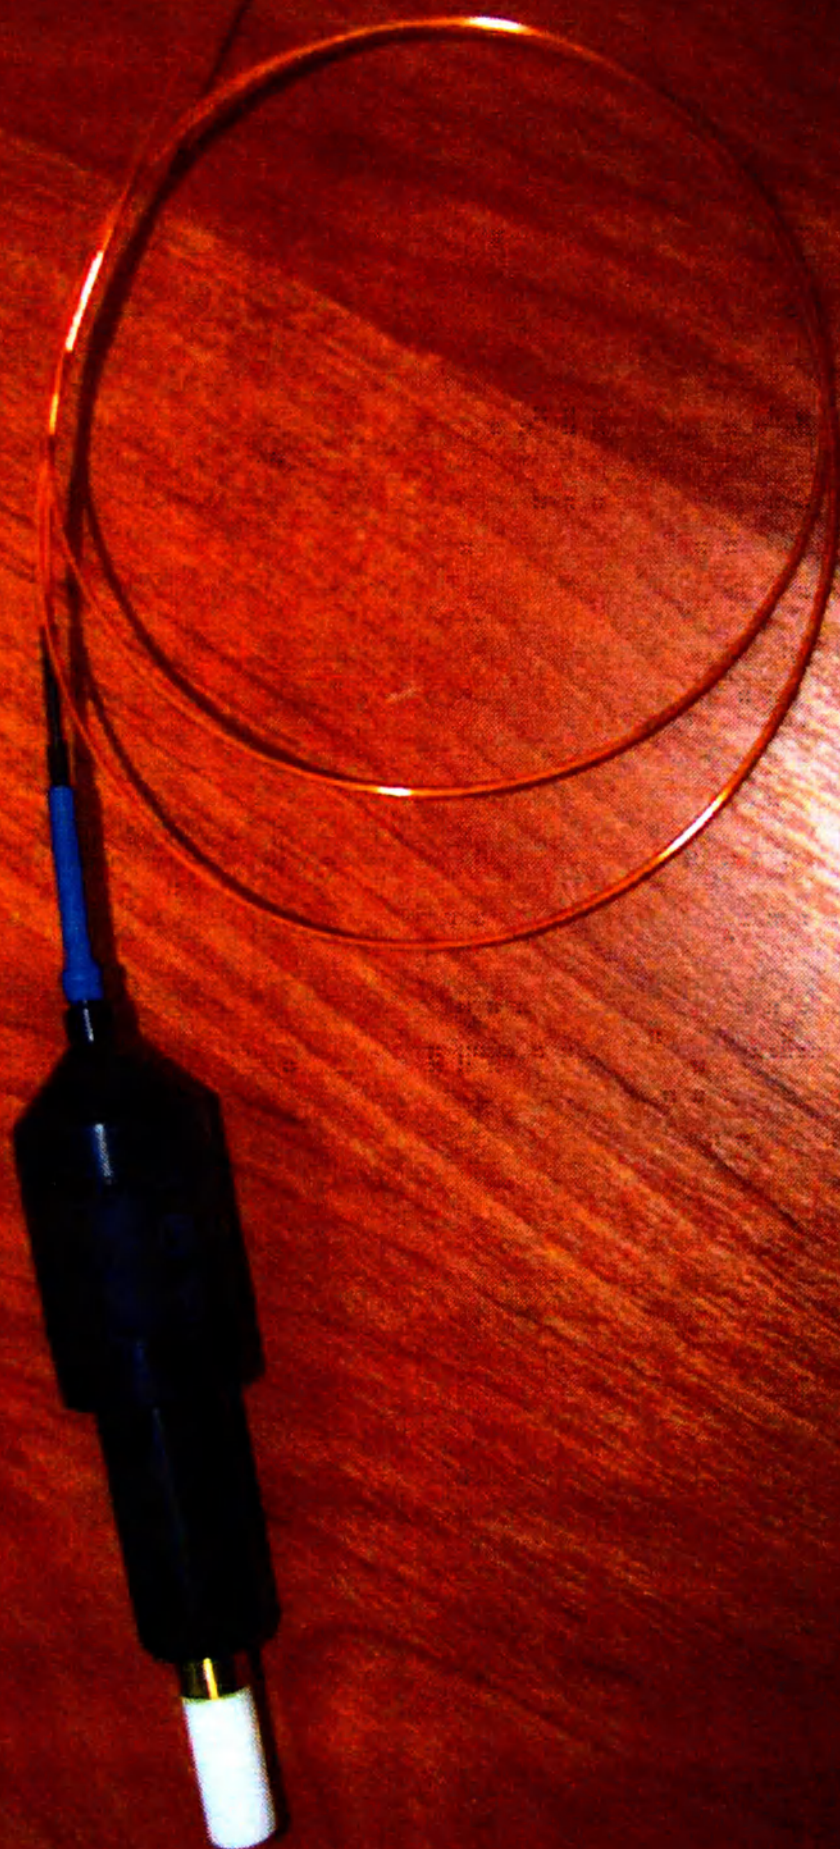


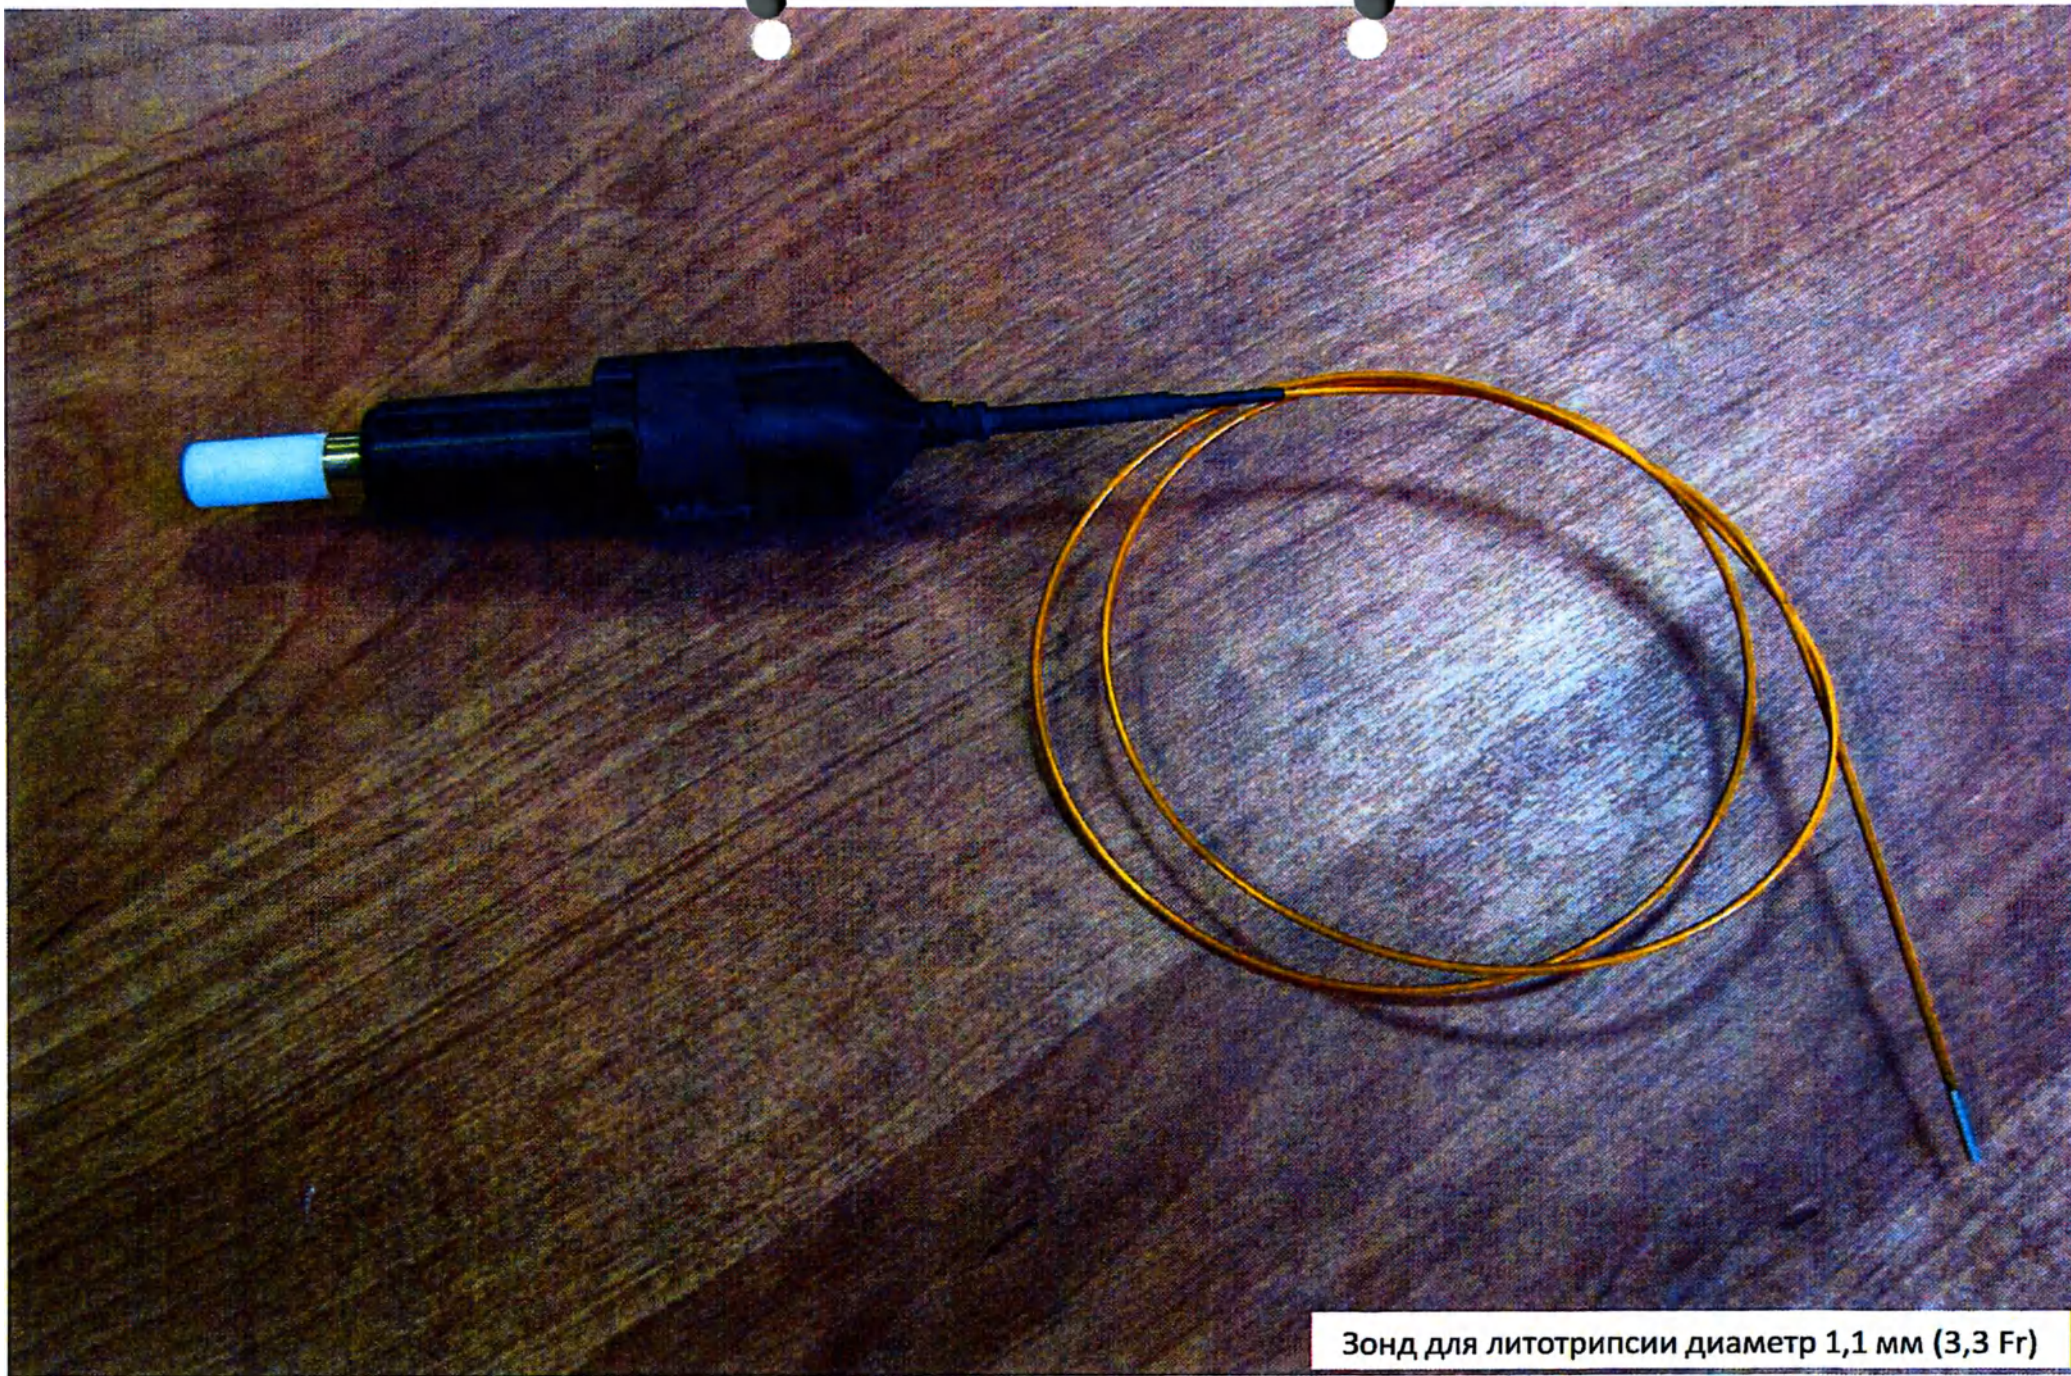


Зонд для литотрипсии диаметр 1,1 мм (3,3 Fr)

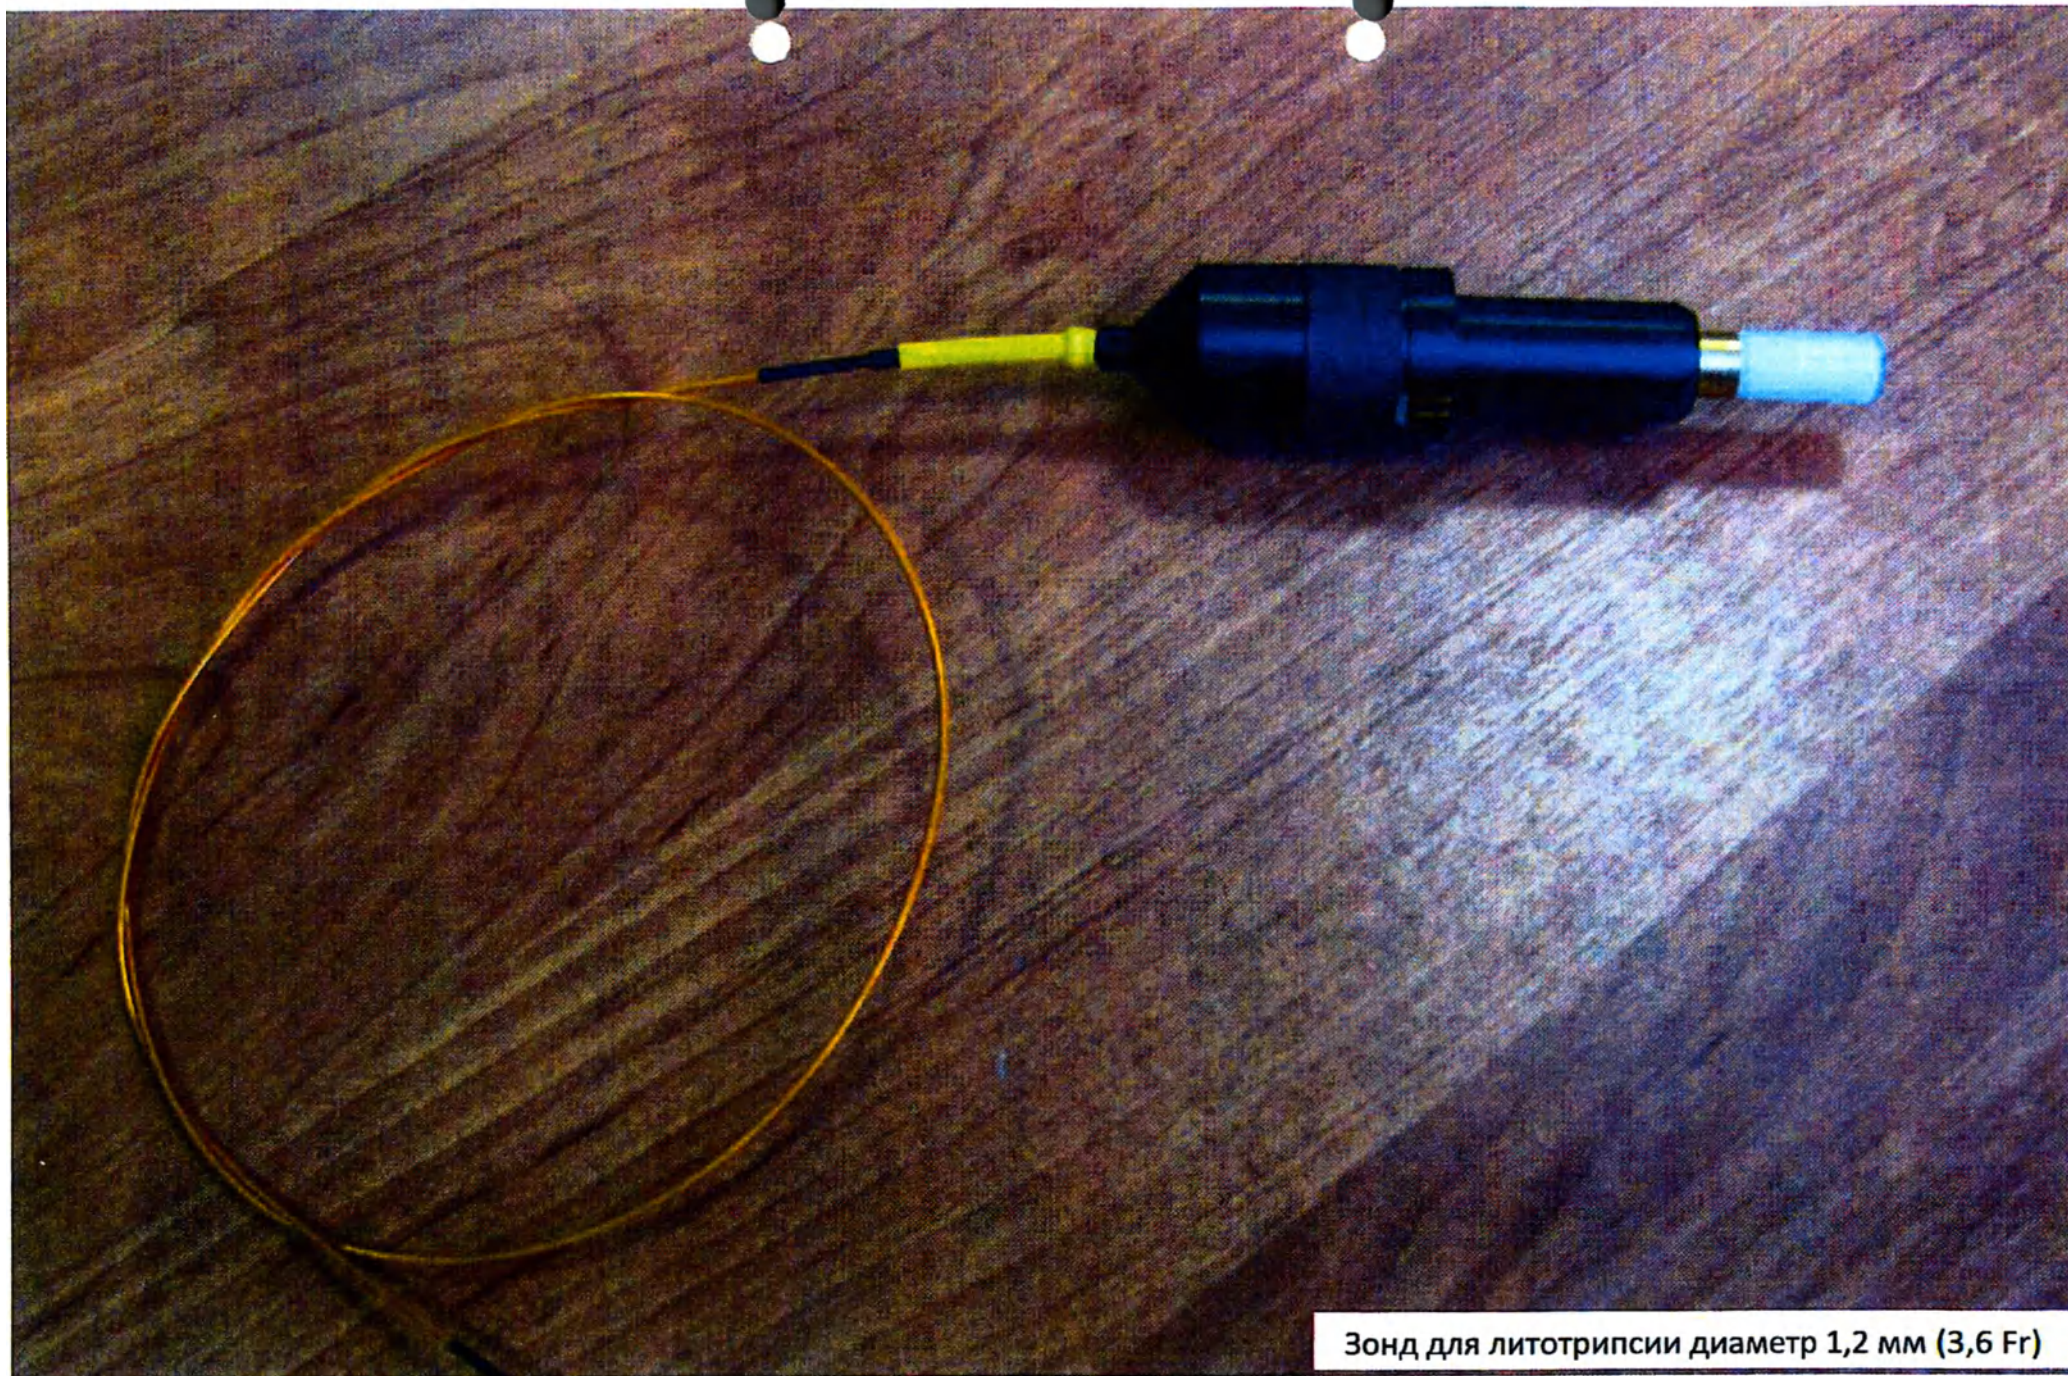

Зонд для литотрипсии диаметр 1,2 мм (3,6 Fr)

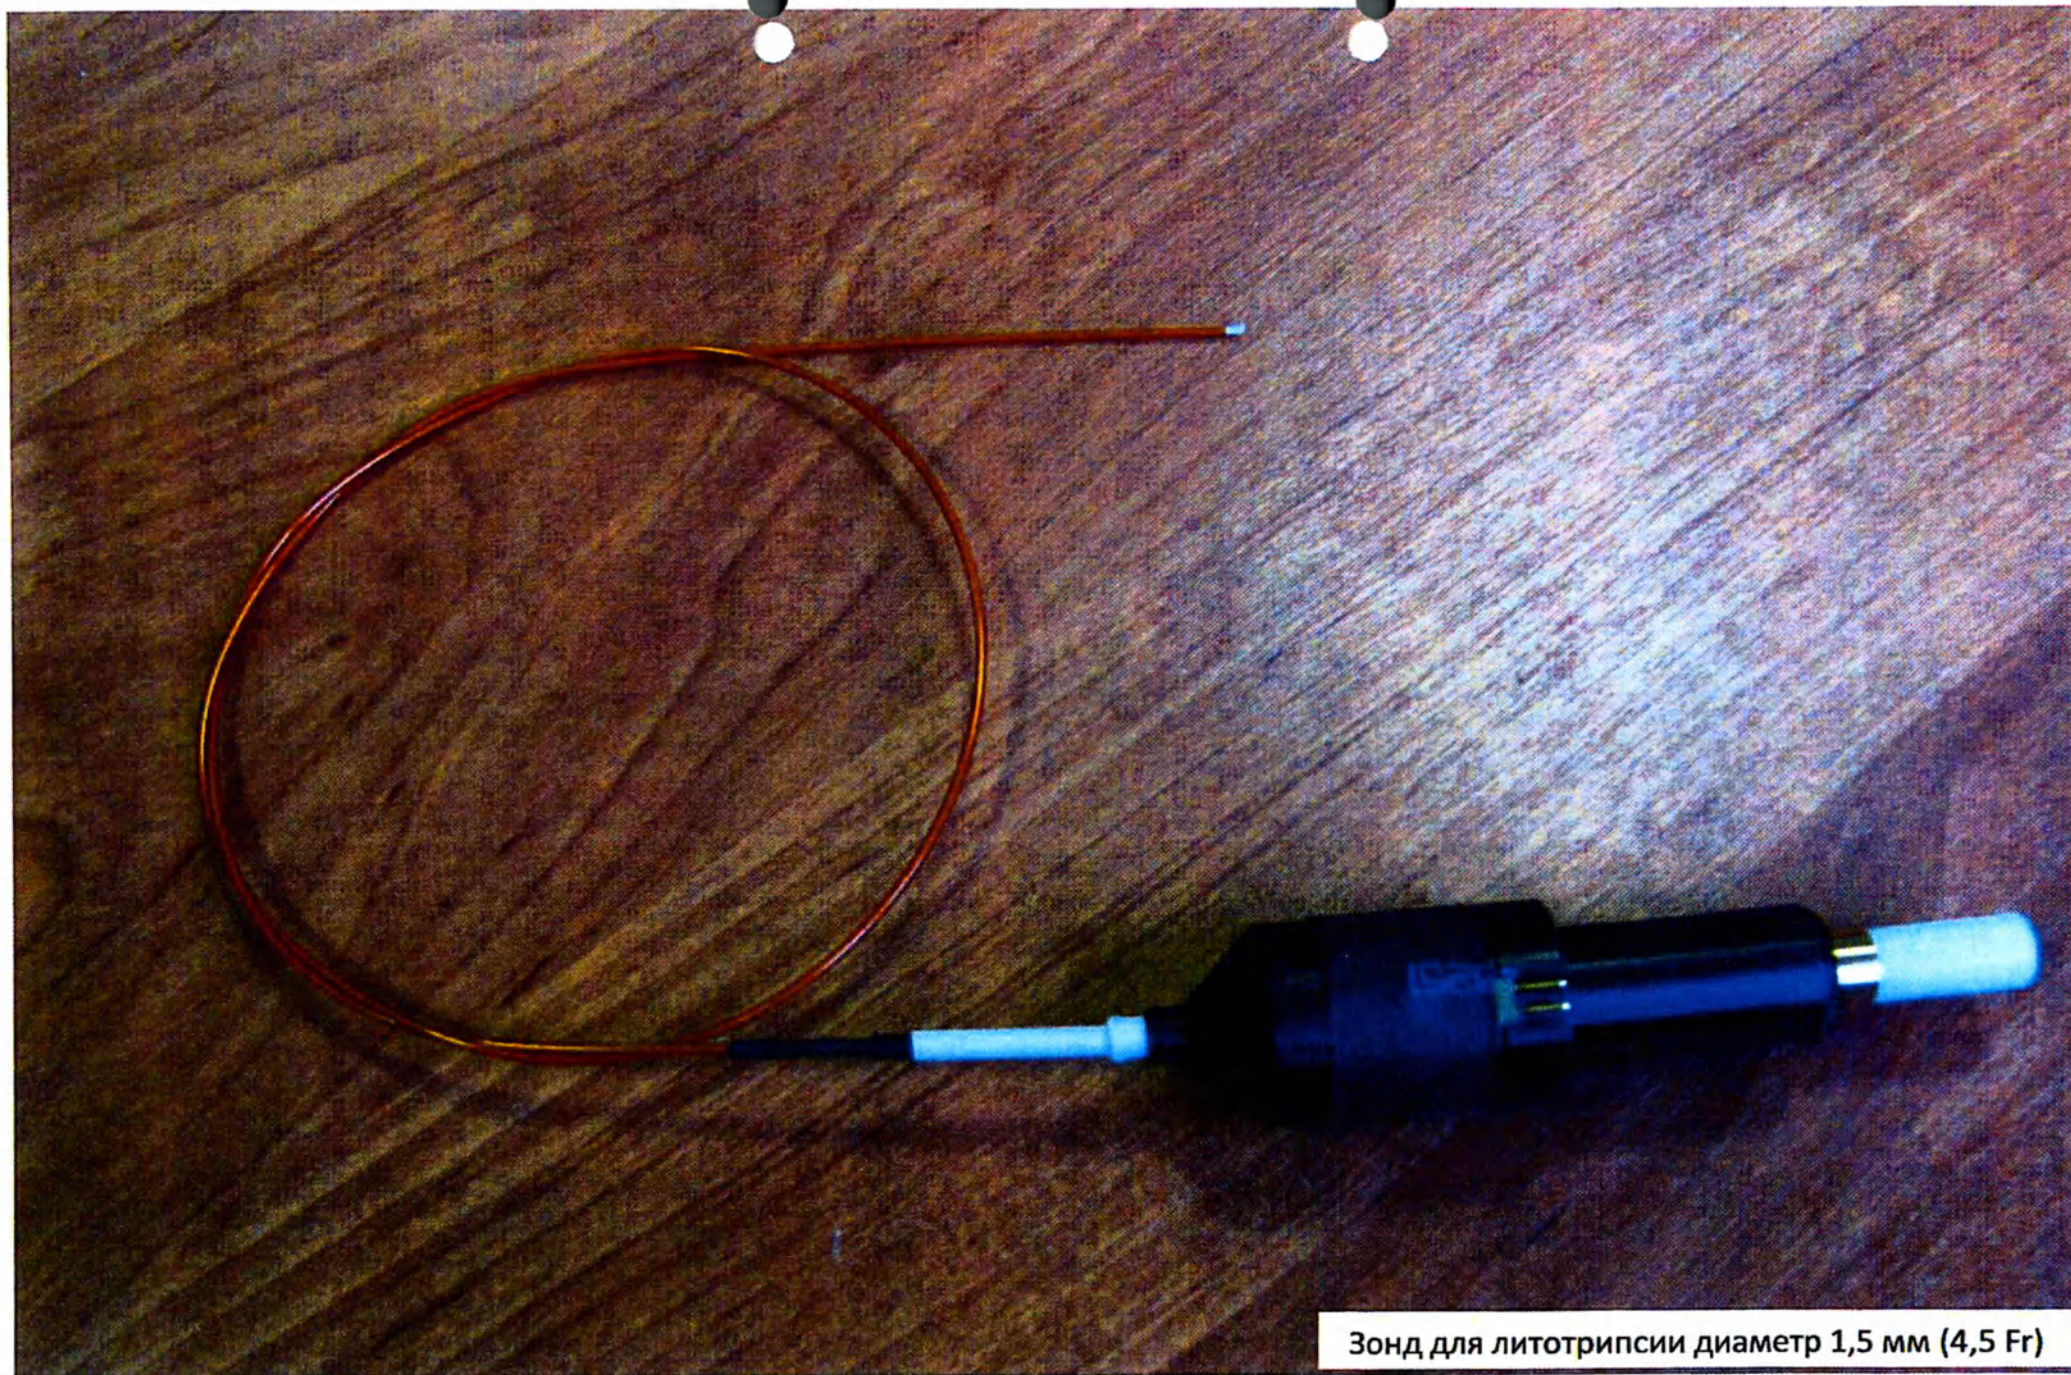


Зонд для литотрипсии диаметр 1,5 мм (4,5 Fr)

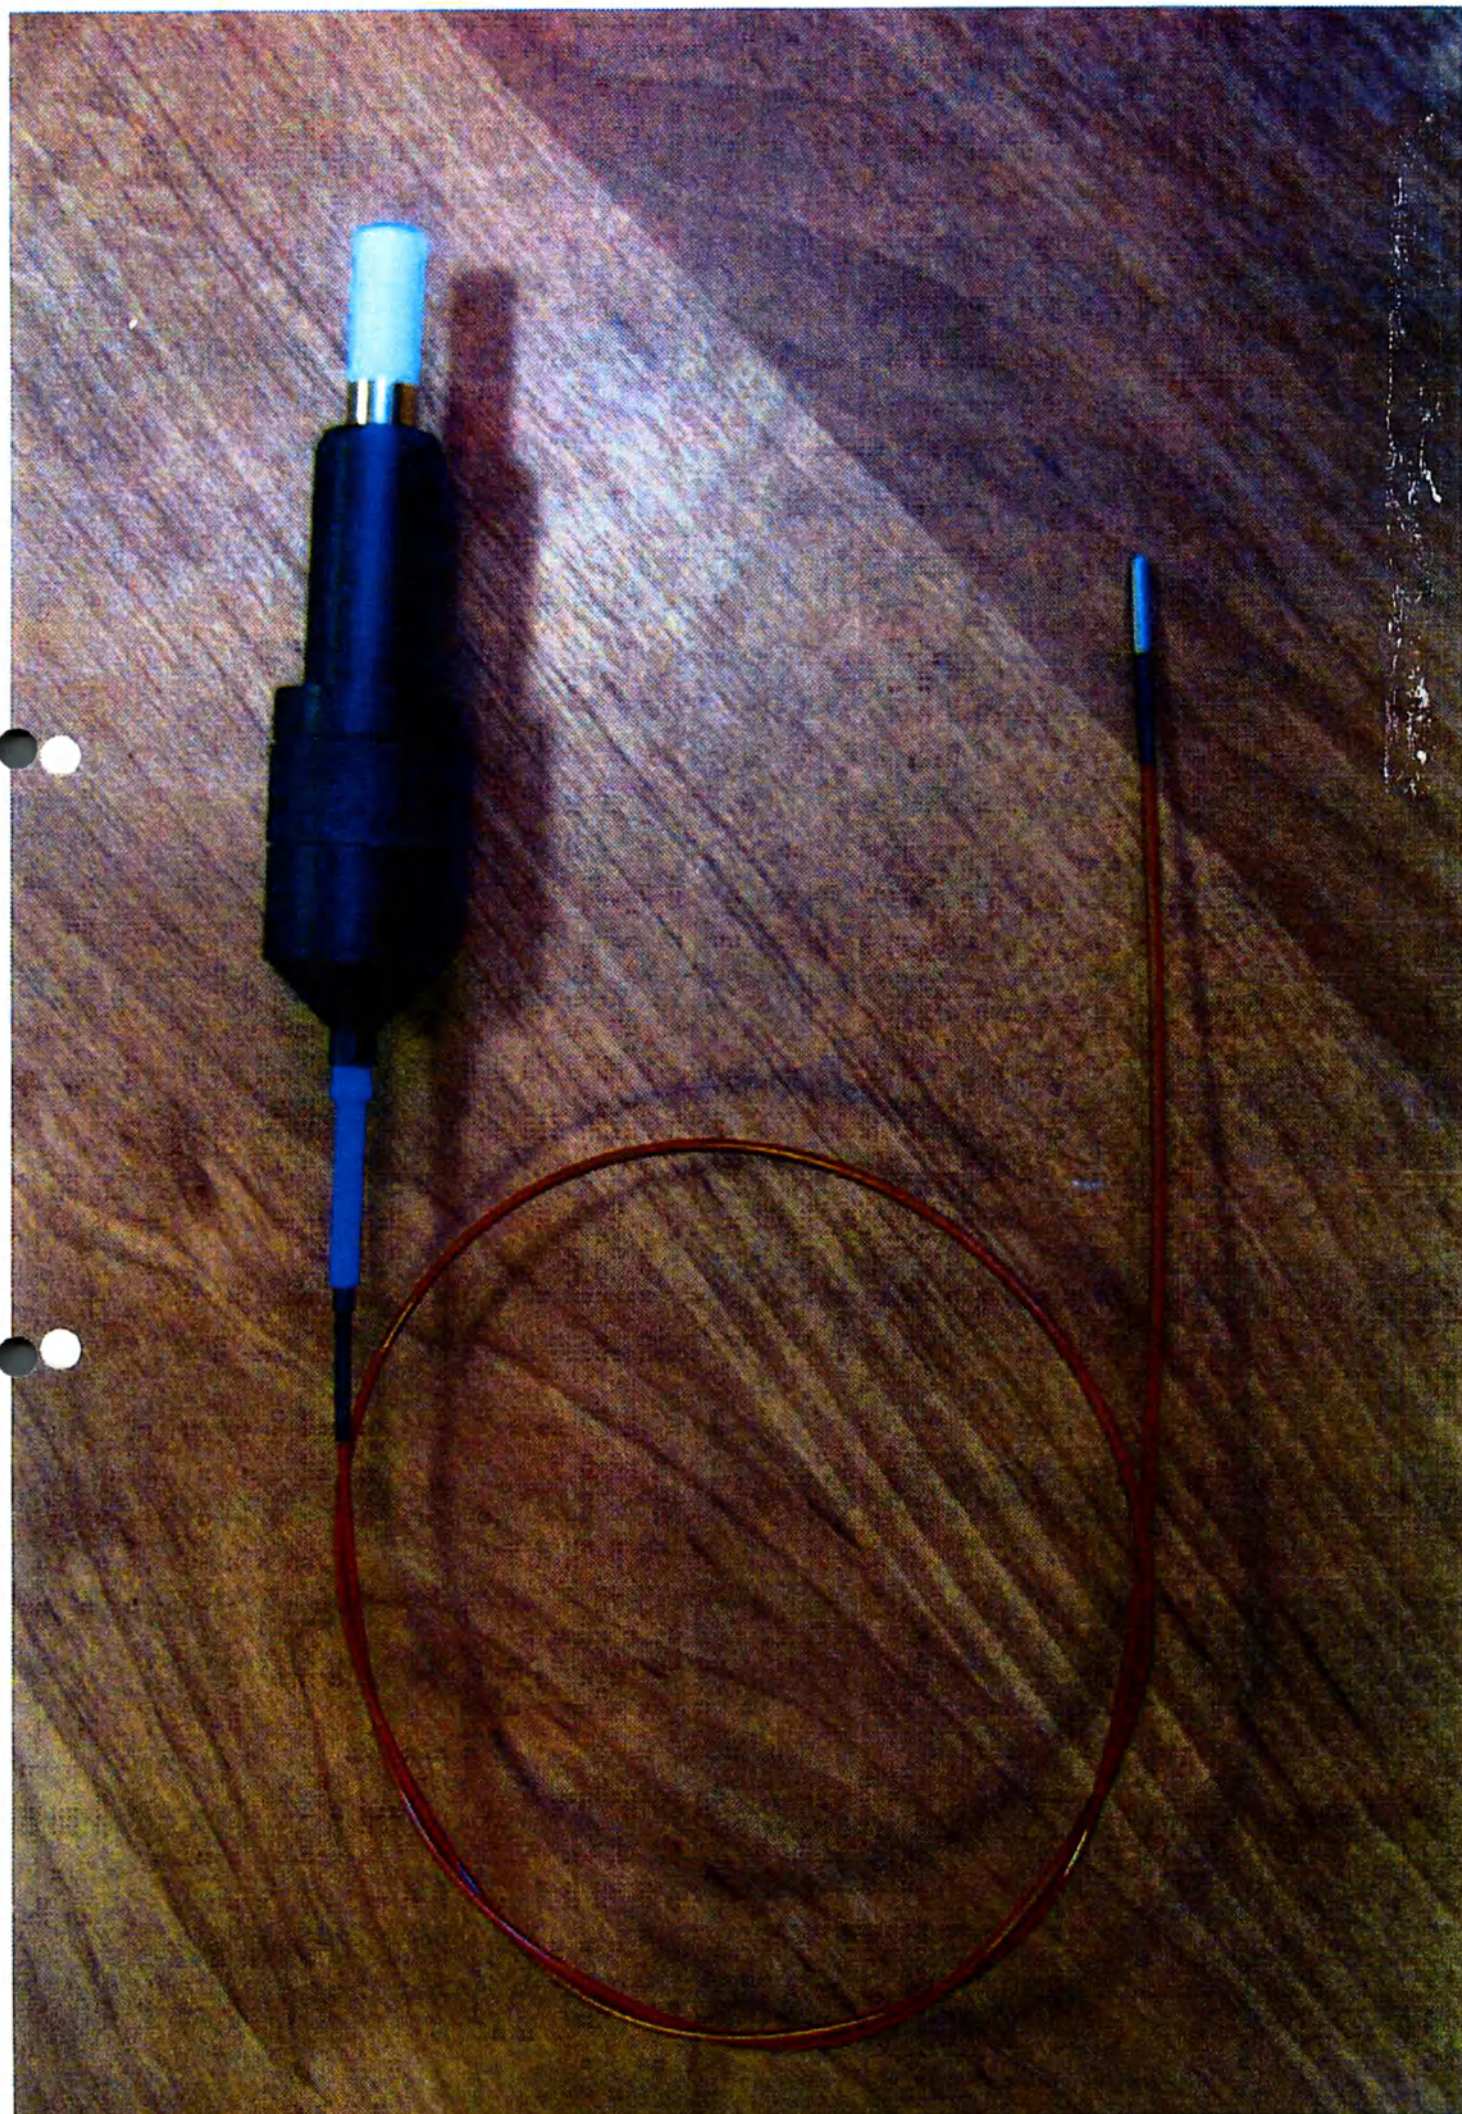





ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

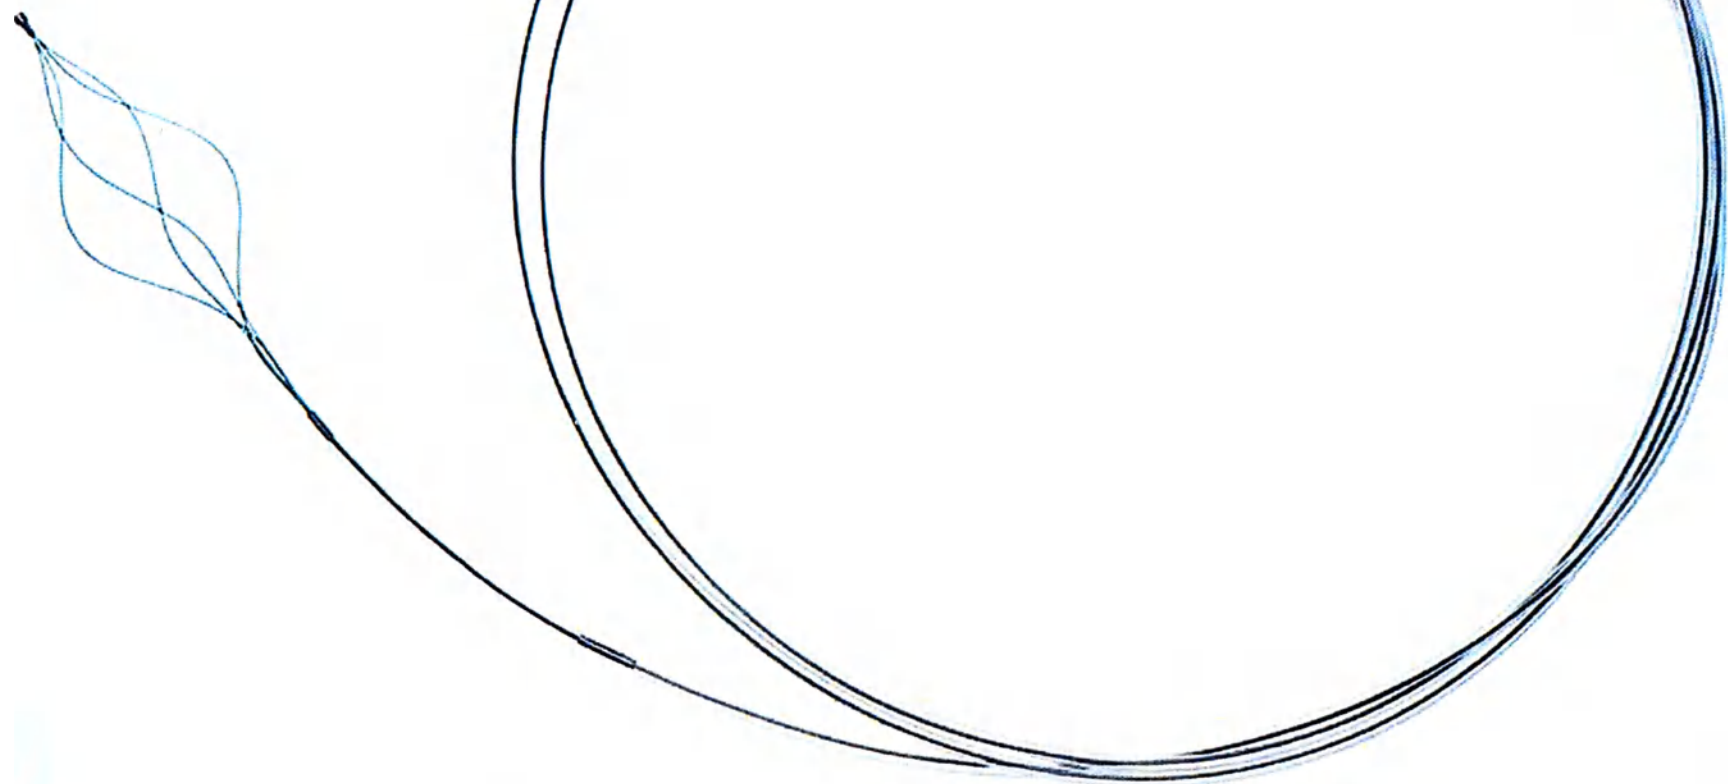

Нитиновый зонд-экстрактор