




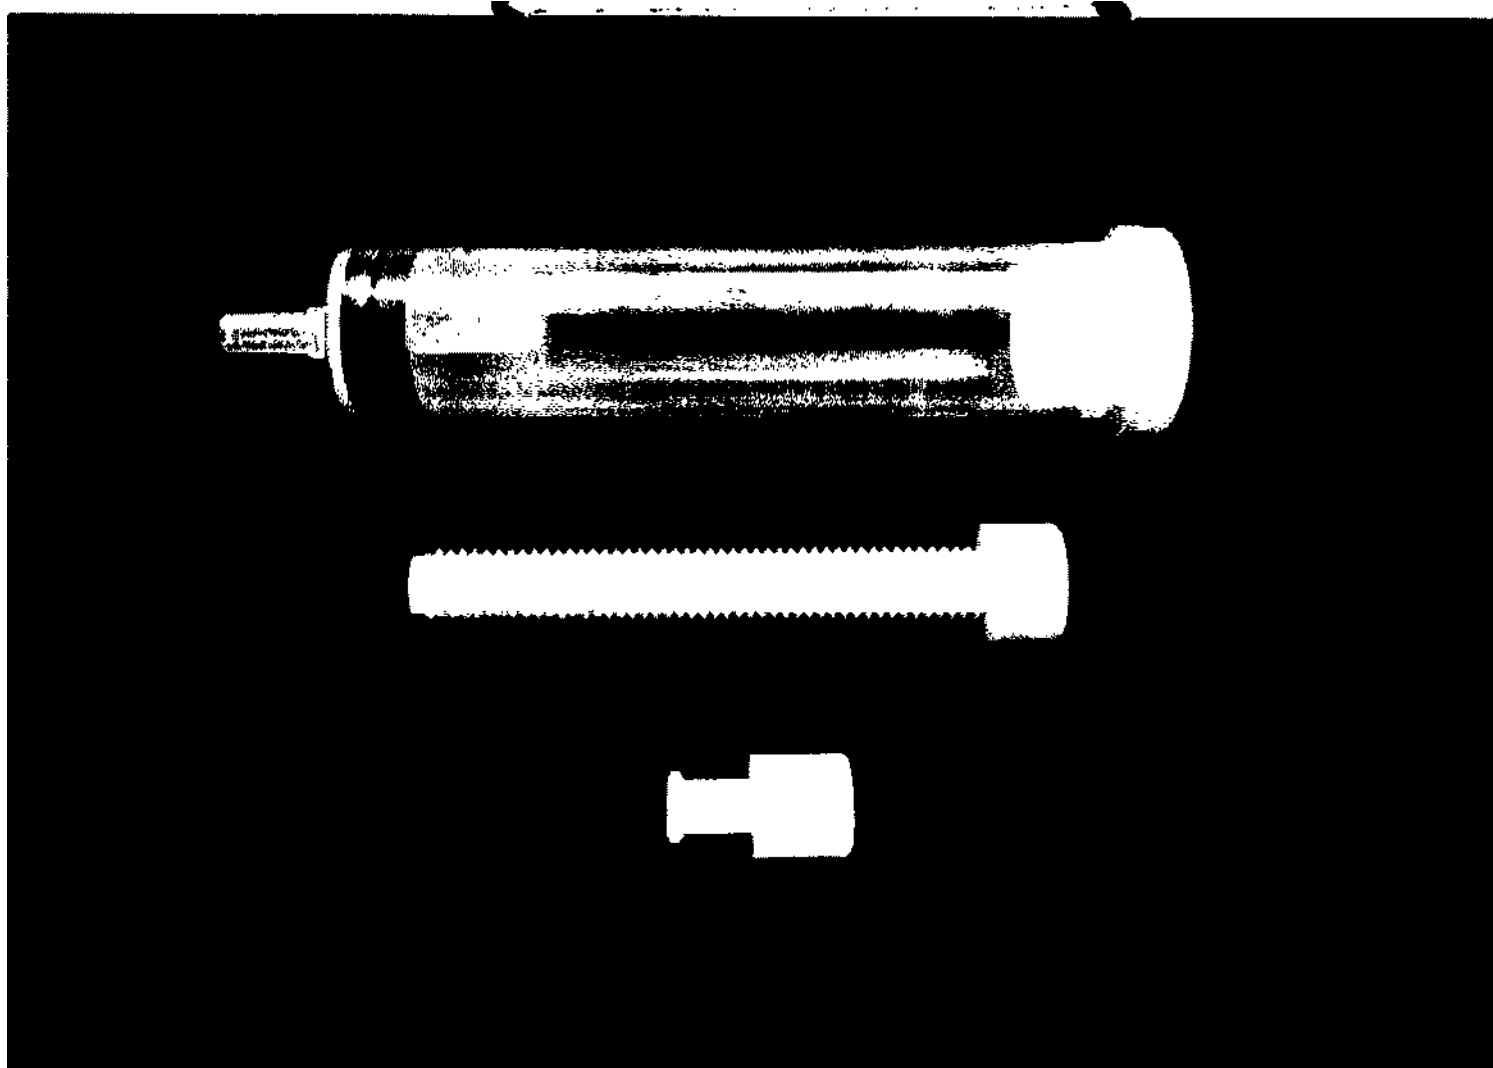


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника.

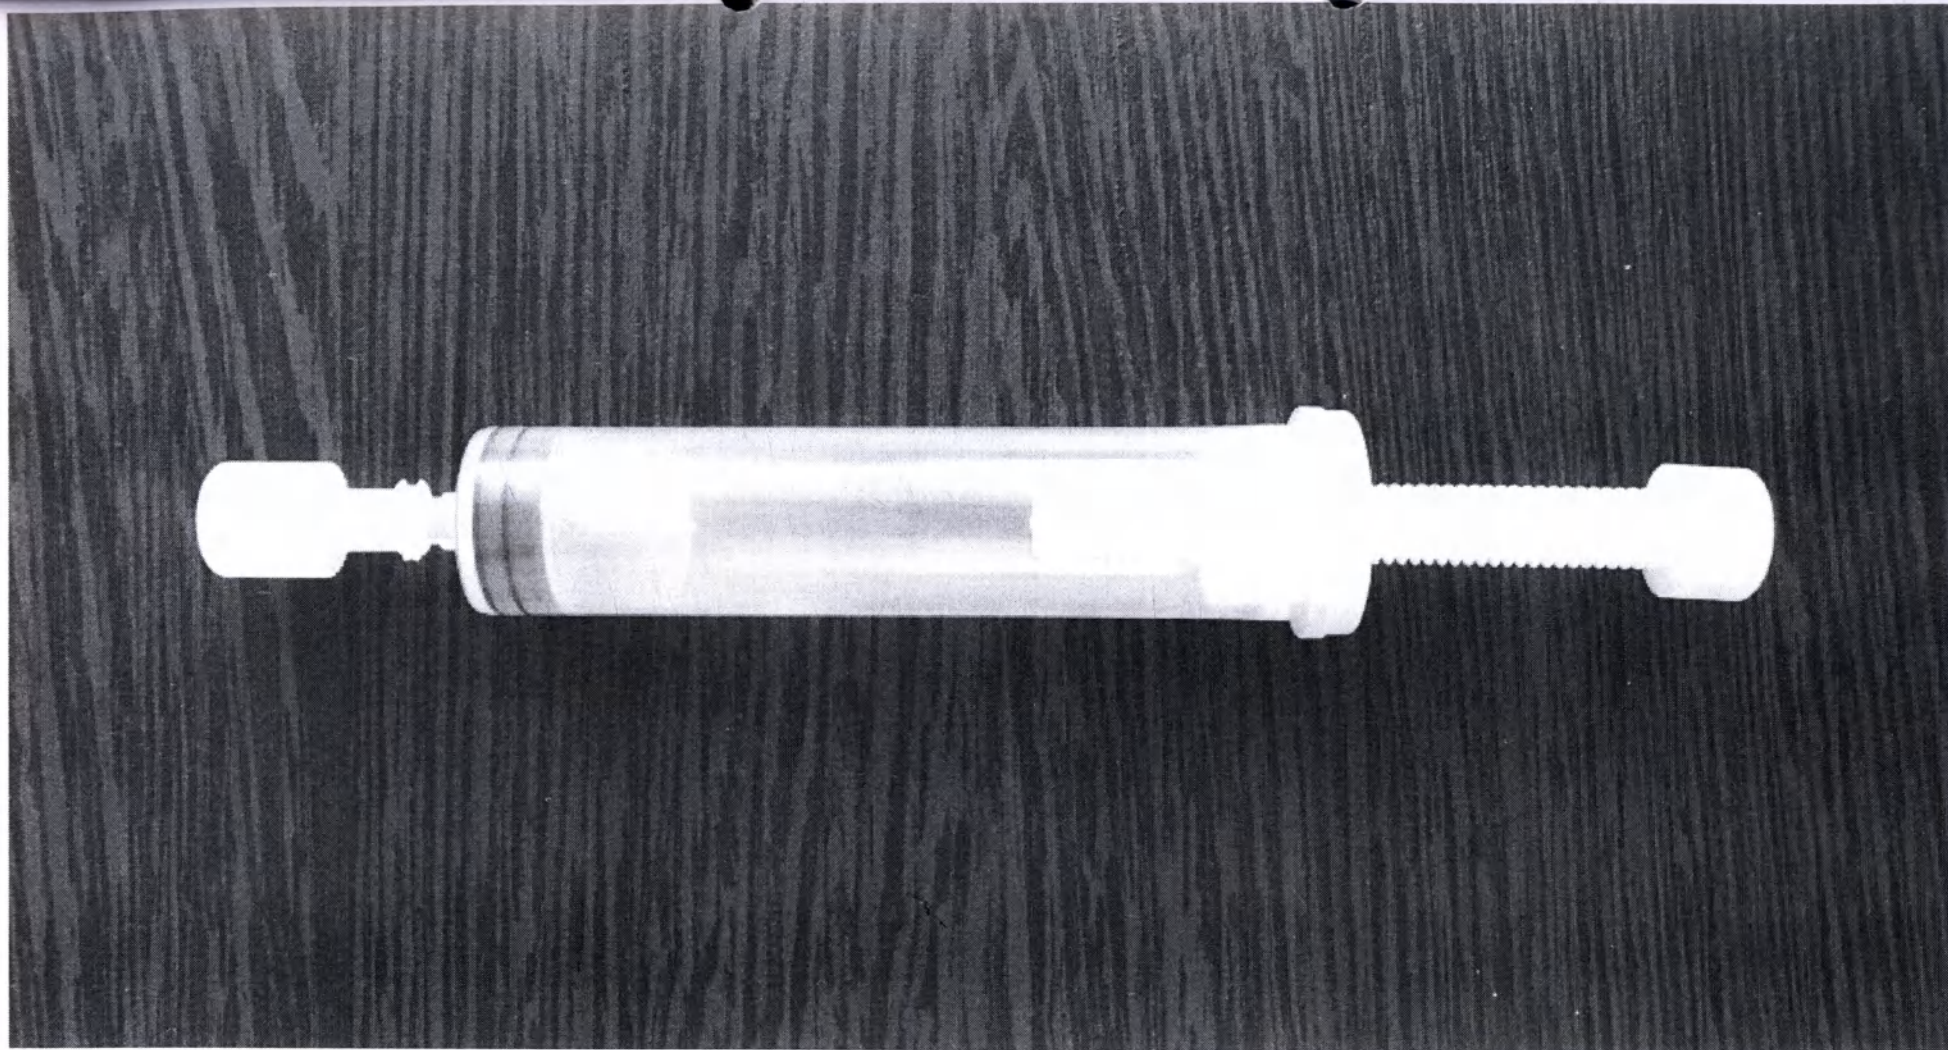


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника в сборном виде

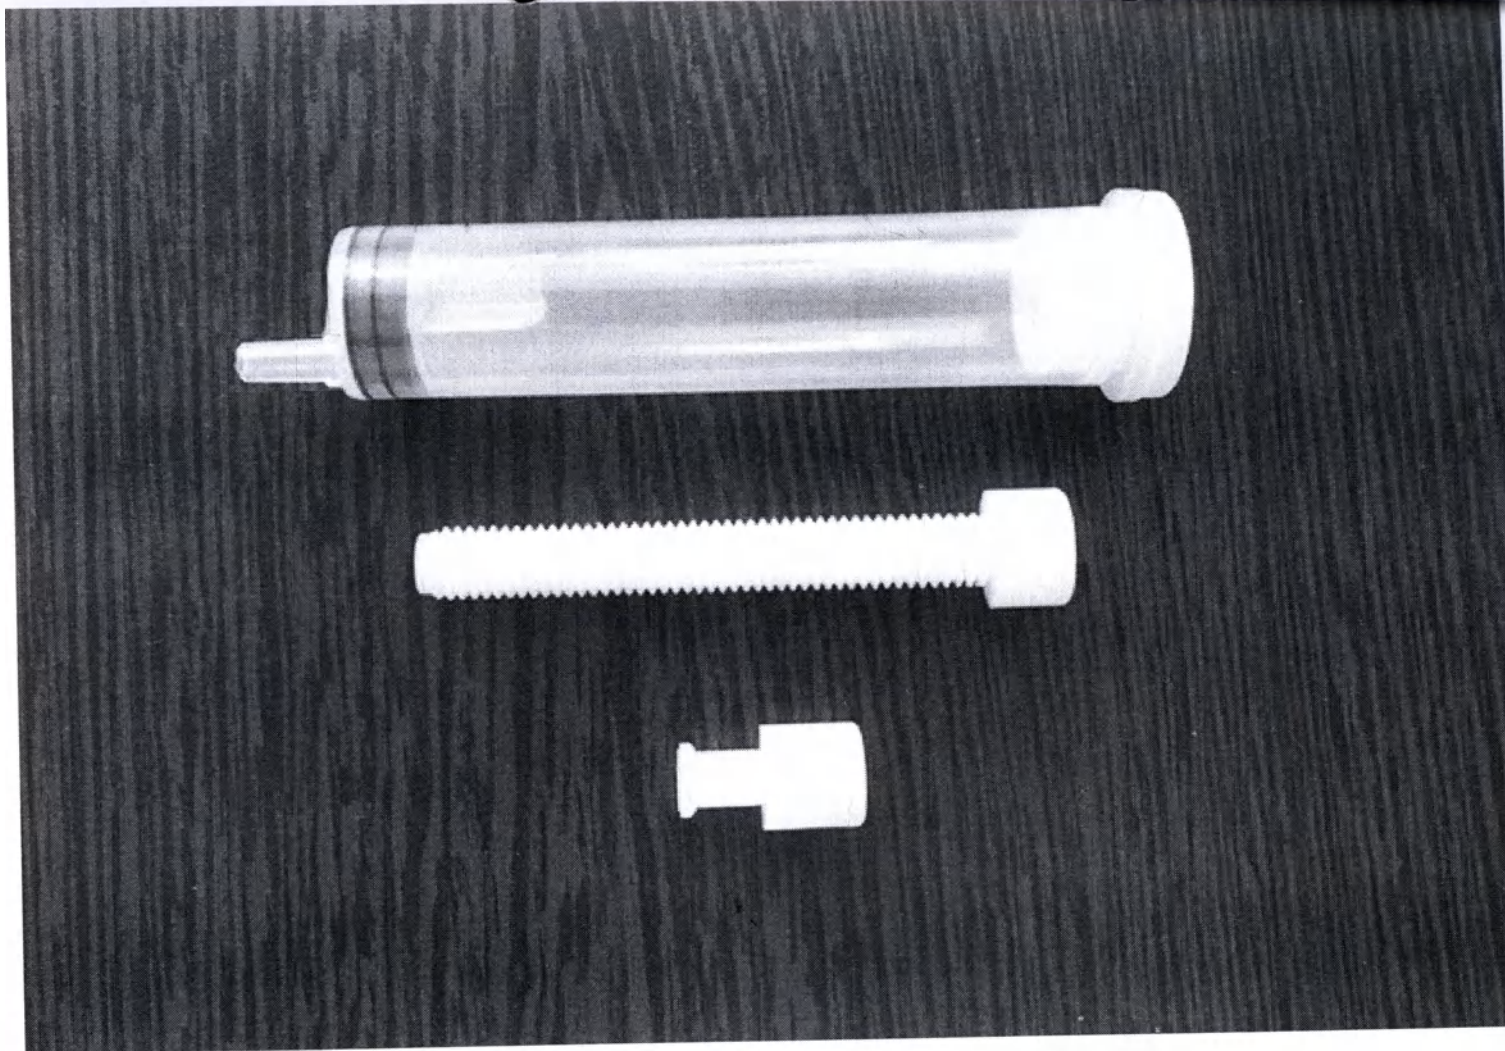


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника.

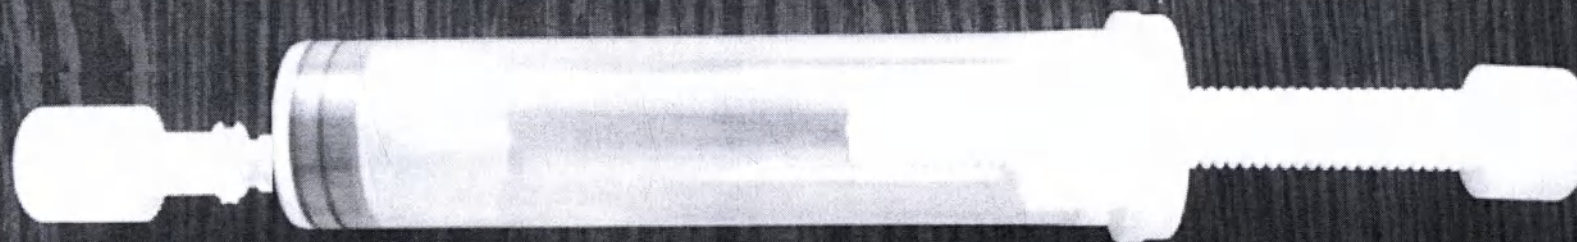


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника в сборном виде

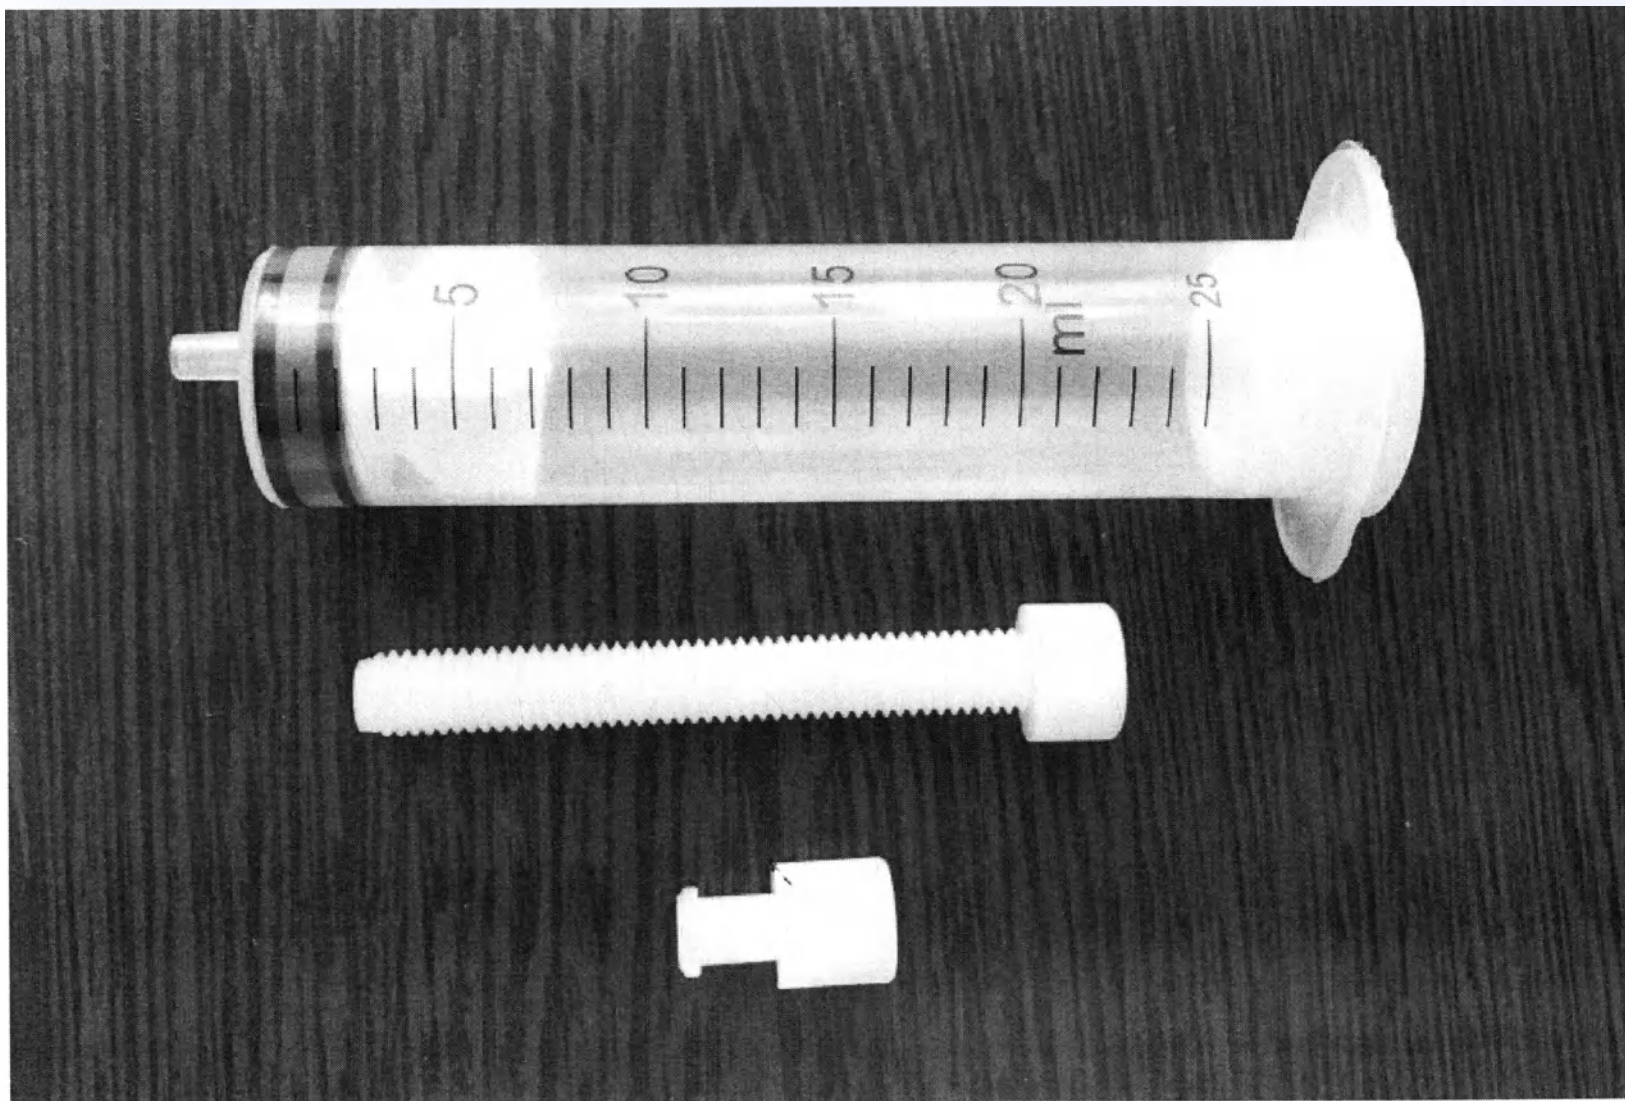


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника

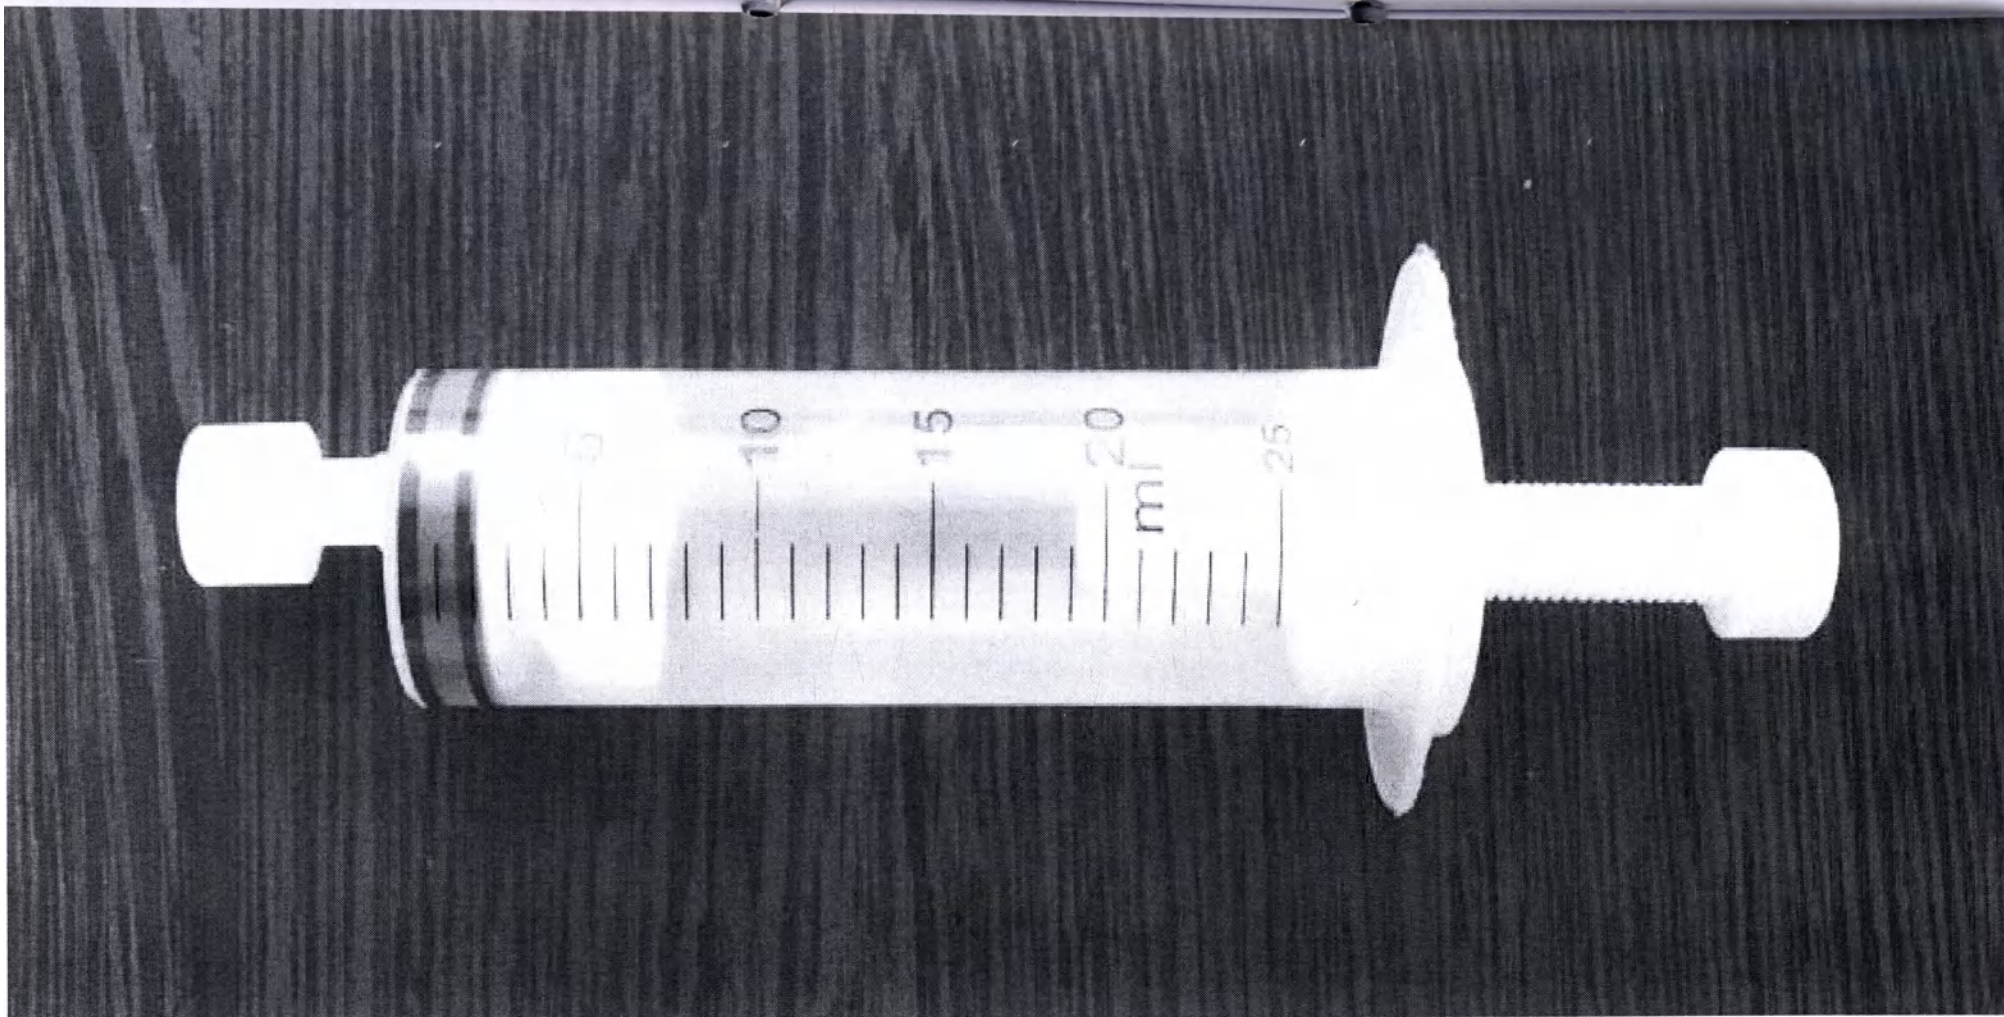


Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника

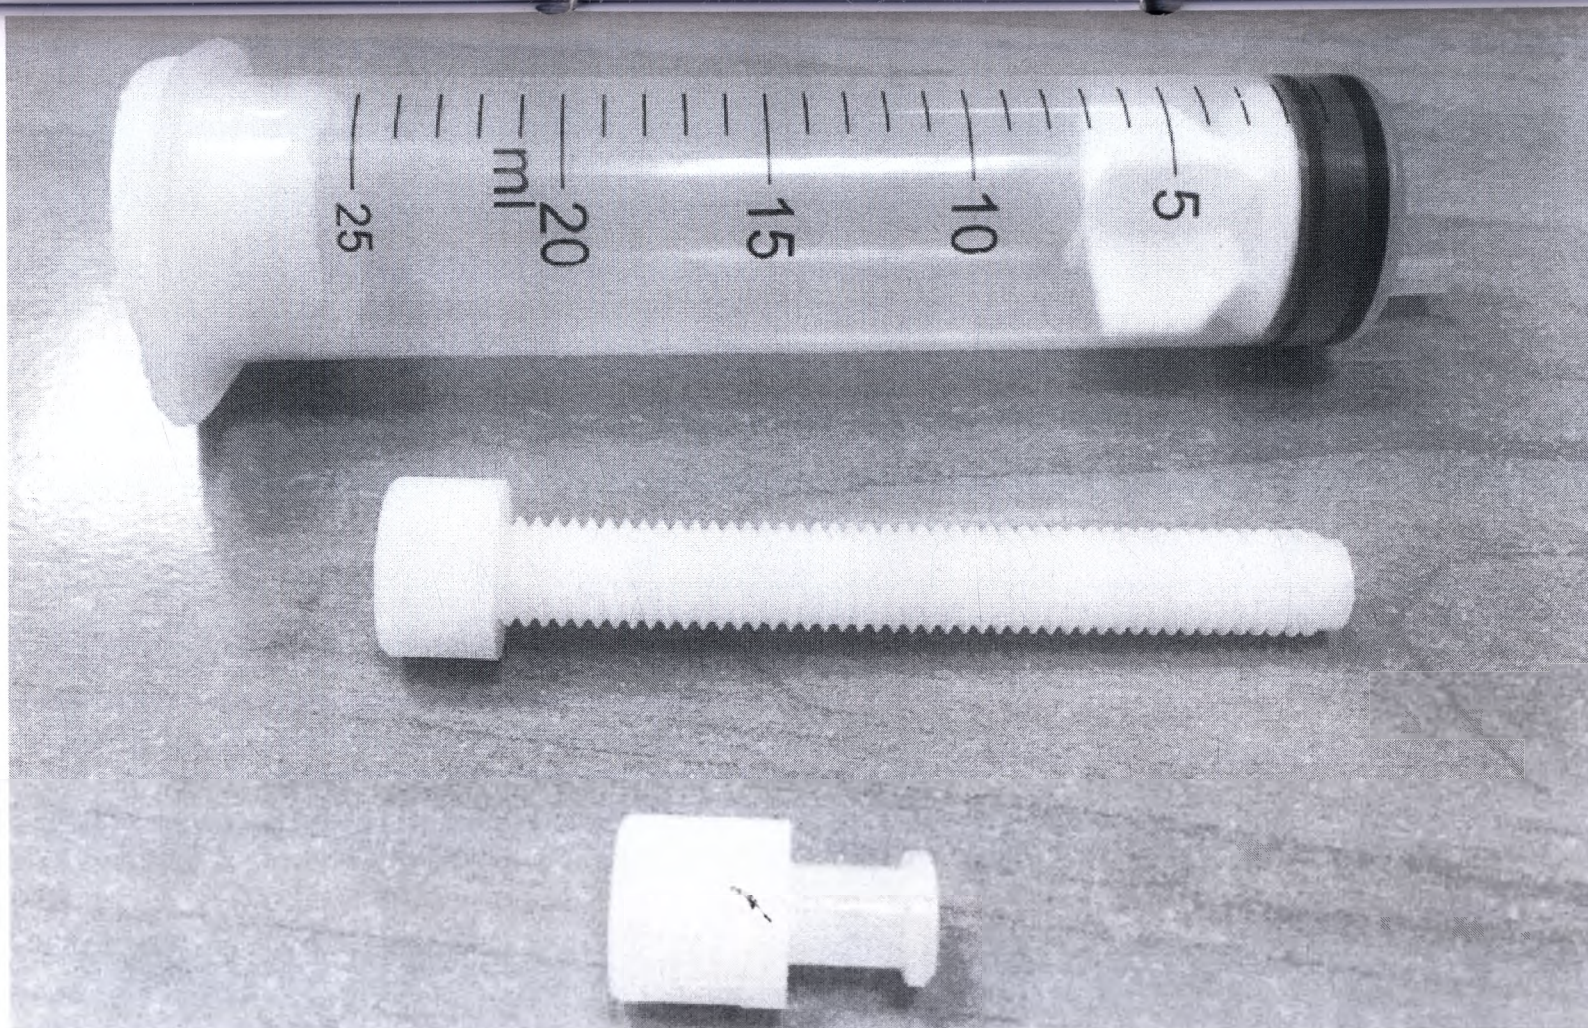

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника

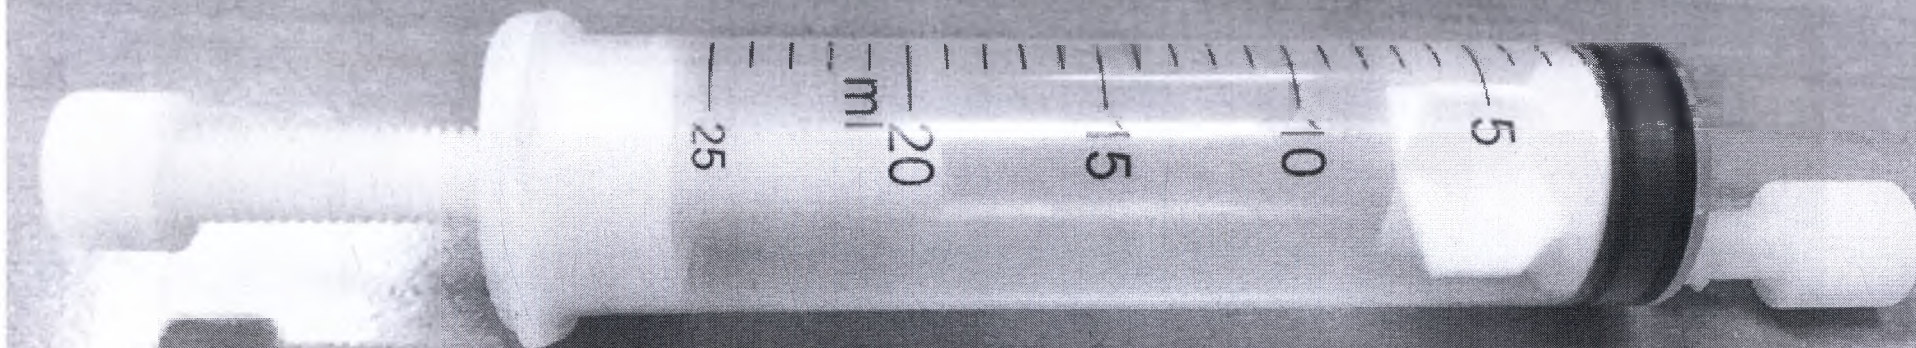

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника, в сборе

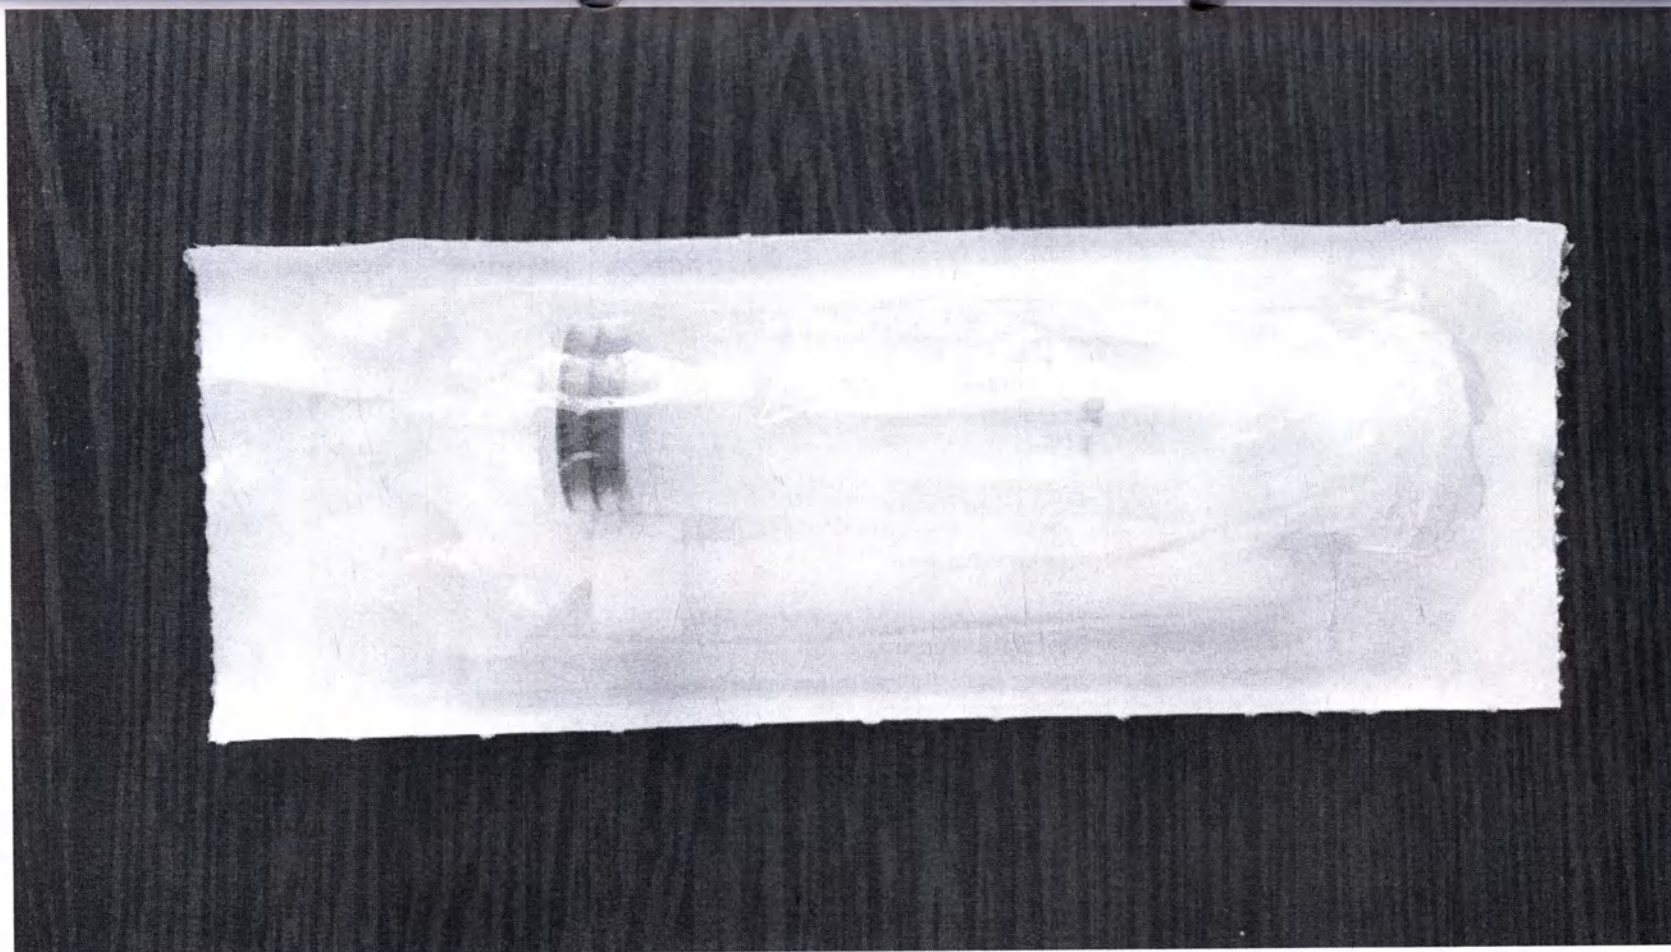

Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника в потребительской упаковке

Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@tribolog.com.



Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO



Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
концентрическим расположением наконечника

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121670

РУ

Дата стерилизации 12.2016

Годен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Общий вид медицинского изделия Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника л в потребительской упаковке



Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника в потребительской упаковке

Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com



Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE

EO



Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апиrogenно.

Серия 121657

РУ _____

Дата стерилизации 12.2016


Годеи до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника в потребительской упаковке

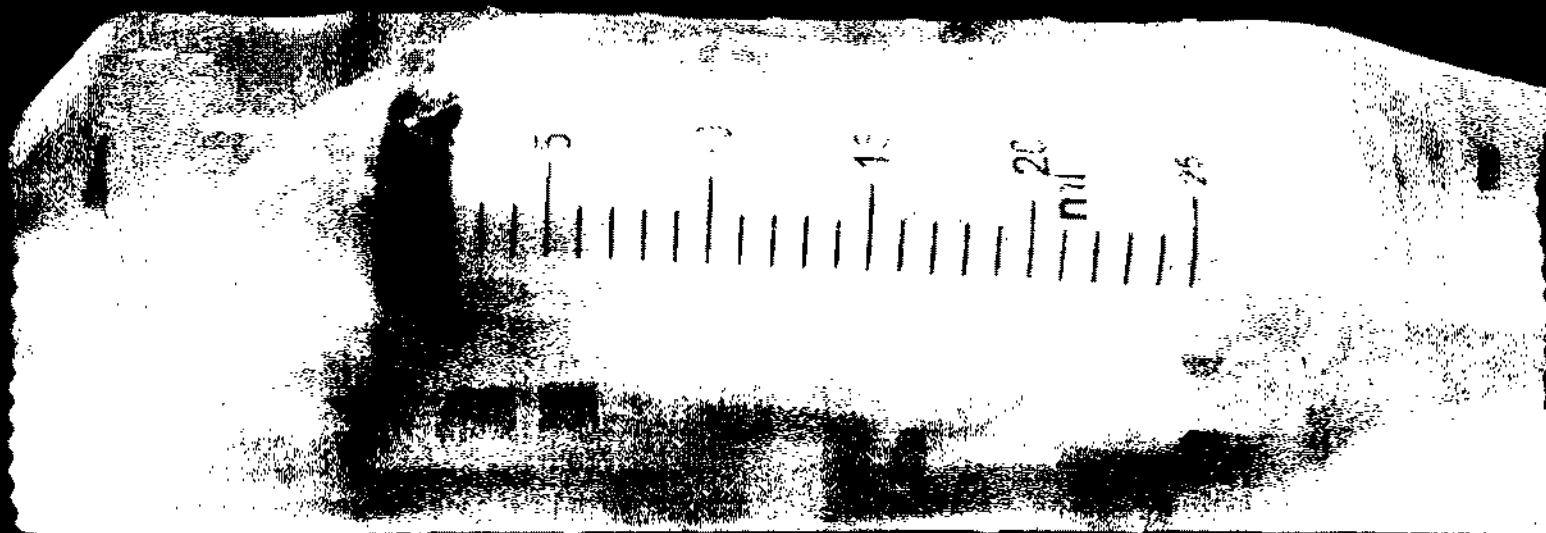

Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника

Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@triholog.com.
Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru



Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
концентрическим расположением наконечника

Наконечник типа «Луер»

Серия 121670

Дата стерилизации 12 2016

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1 7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C


Хранить в недоступном для детей месте.

Стерильно, апиrogenно.

РУ _____

Годен до 12.21

Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника в потребительской упаковке

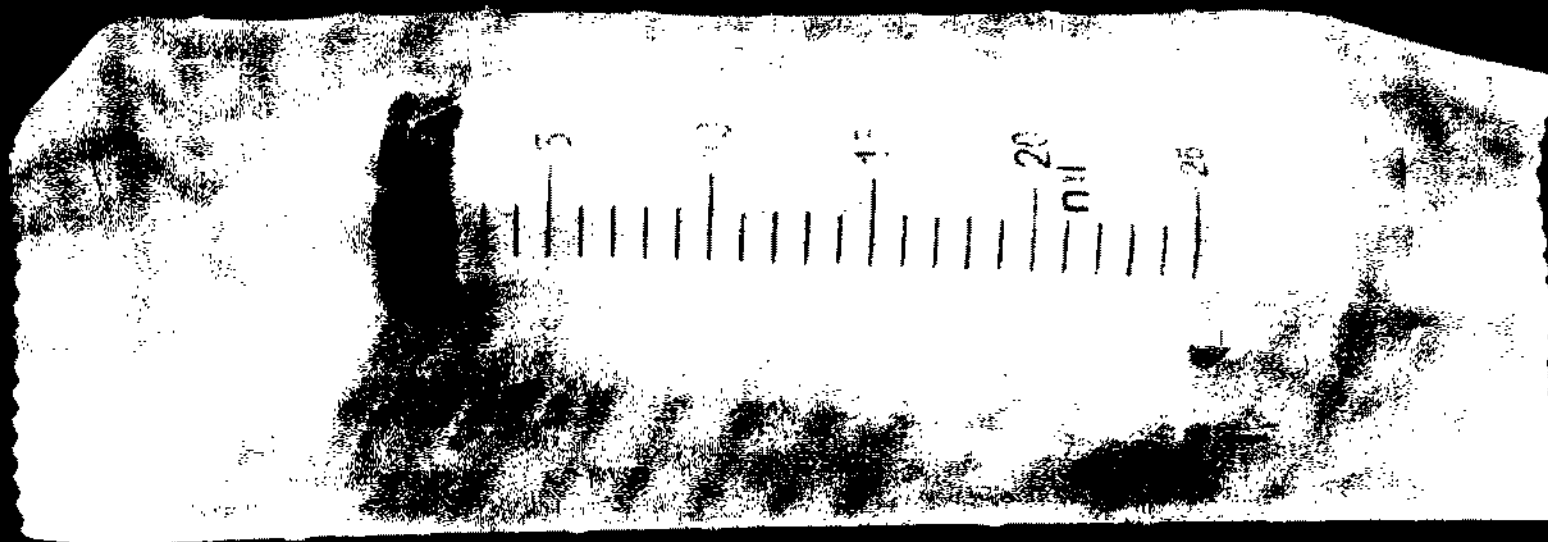

Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника

 Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@iriholog.com

Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE

EO



Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121657

РУ

Дата стерилизации 12 2016


Годен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.


Общий вид медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника в потребительской упаковке

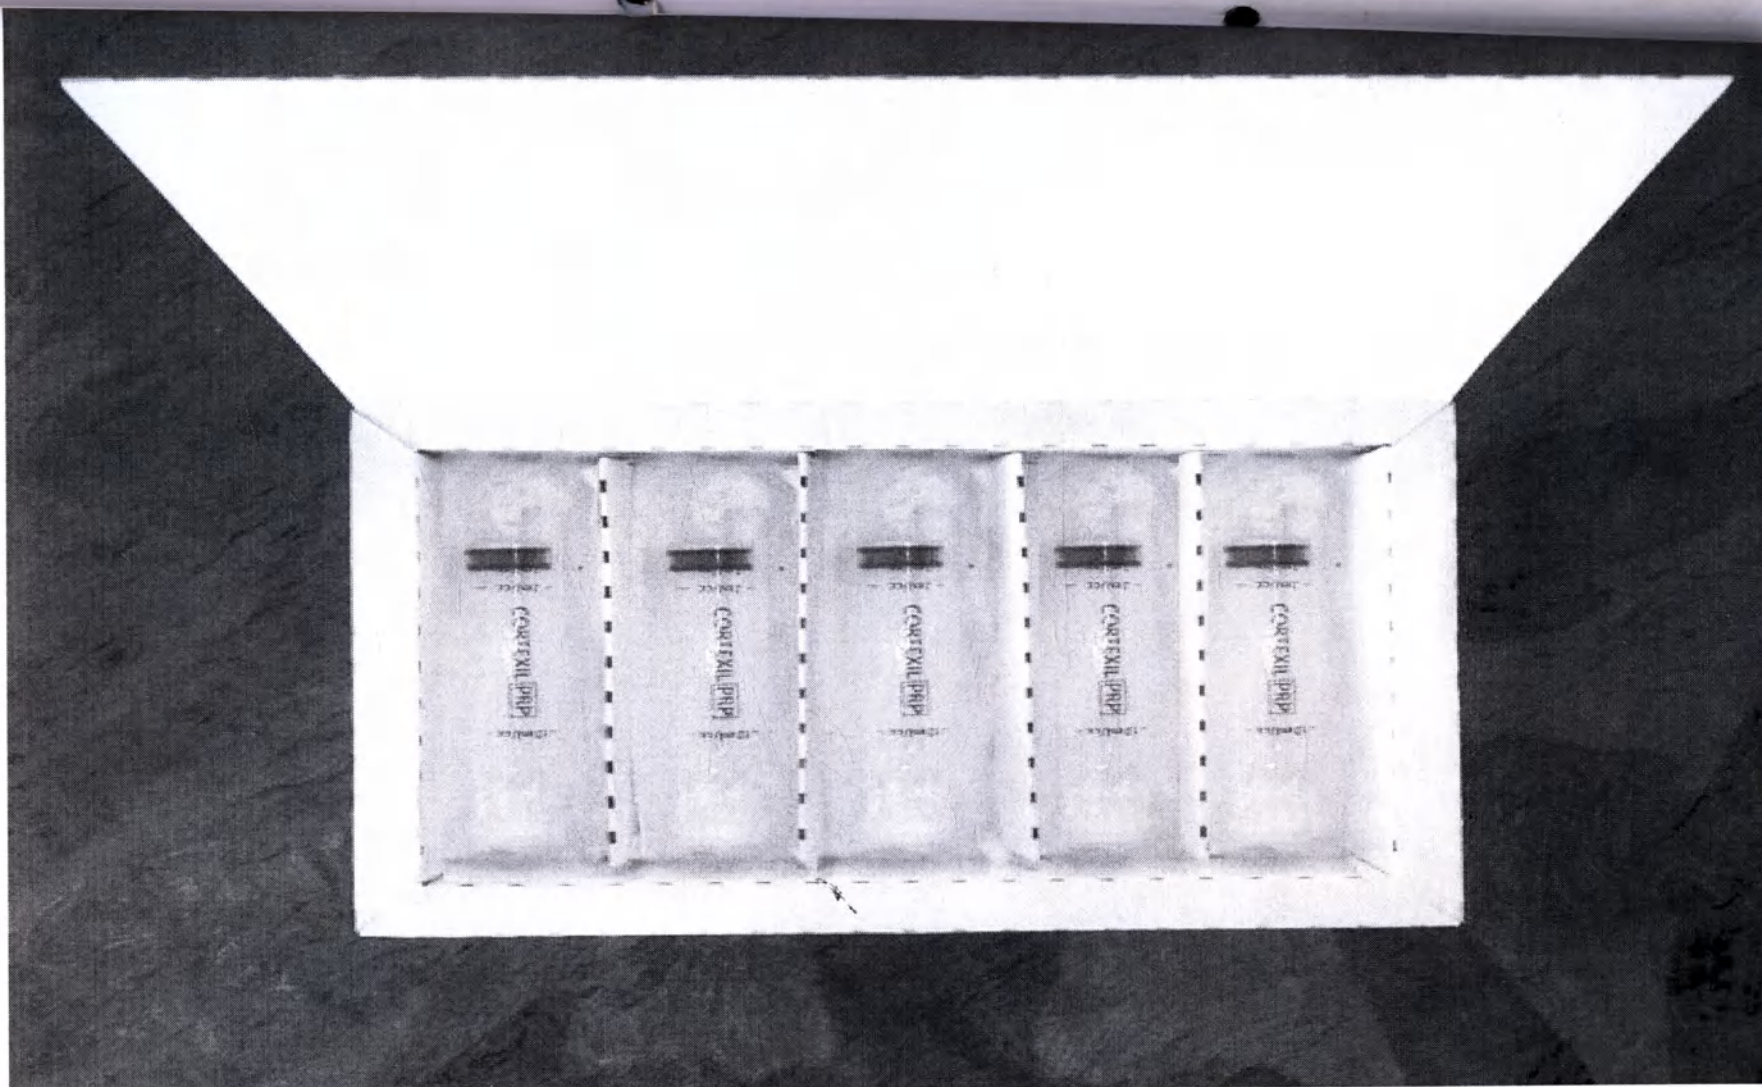

Общий вид групповой упаковки медицинского изделия: 1) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника. 2) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника. 3) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника. 4) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника.

CORTEXIL

10 шприц-пробирок

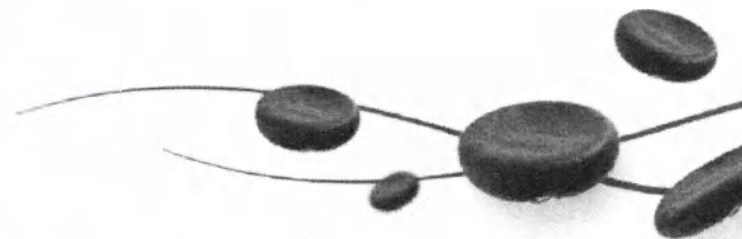

Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия: 1) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника. 2) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с эксцентрическим расположением наконечника. 3) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с концентрическим расположением наконечника. 4) Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с эксцентрическим расположением наконечника.

CORTEXIL

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная
CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ)
по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл,
с концентрическим расположением наконечника
Тип наконечника: luer


Хранить в недоступном для детей месте. Изделие должно храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5С до +40С.
Использованное изделие относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

Стерилизовано 09.18
Годен до 09.23

ТУ 32.50.50-001-76853870-2018,
Патент: XXXX, XXXX, XXXX
СЕРИЯ 00-0000-0000
Регистрационное удостоверение №0000000-0000000, выдано 20.09.2018

Стерильно, апиrogenно, нетоксично!

Производитель: ООО «Стерин», Московская обл., г. Луховицы, ул. Пушкина 8 км. Тел.: (495) 972-34-92, (495) 221-08-63
Держатель Регистрационного удостоверения, торговой марки, патентов: ООО «Бионет-Плюс»,
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 343,
тел.: +7(8652)75-06-22, e-mail: info@triholog.com

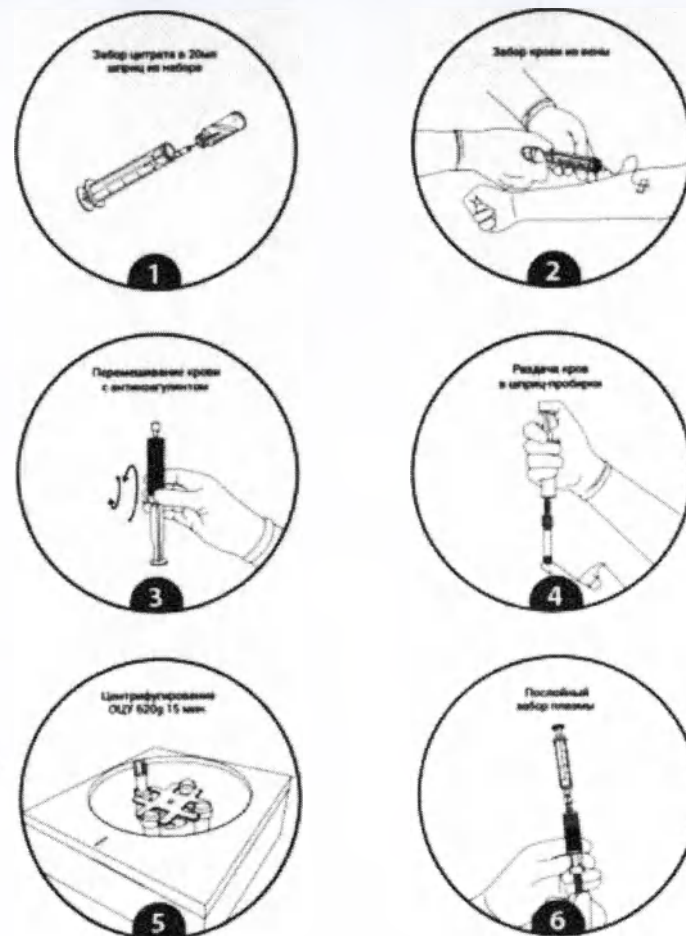

Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника



Общий вид транспортной упаковки медицинского изделия: Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с концентрическим расположением наконечника

Сшито и заверено печатью 10
(двадцать) лист 06



УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

Ю. Г. Башкатов

2018 г.

Проекты этикеток

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная
CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, 20 мл

Этикетка групповая

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO

Тип наконечника _____ Количество _____

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ
32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл,

с концентрическим расположением наконечника.

«Не использовать при нарушении потребительской упаковки»

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

«Недопустимо применение в случае нарушения целостности потребительской тары».

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Партия _____

Годен _____

РУ _____

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO

Тип наконечника _____ Количество _____

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ
32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл,

с эксцентрическим расположением наконечника.

«Не использовать при нарушении потребительской упаковки»

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

«Недопустимо применение в случае нарушения целостности потребительской тары».

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Партия _____

Годен _____

РУ _____

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO

Тип наконечника _____ Количество _____

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ
32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл,

с концентрическим расположением наконечника.

«Не использовать при нарушении потребительской упаковки»

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

«Недопустимо применение в случае нарушения целостности потребительской тары».

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от +5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Партия _____

Годен _____

РУ _____

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO

Тип наконечника _____ Количество _____

Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL (КОРТЕКСИЛ) по ТУ
32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл,
с эксцентрическим расположением наконечника.

«Не использовать при нарушении потребительской упаковки»

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

«Недопустимо применение в случае нарушения целостности потребительской тары».

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Партия _____

Годен _____


ру _____



Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@triholog.com.

Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru



**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
концентрическим расположением наконечника**

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121670

РУ _____

Дата стерилизации 12.2016

Годен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C


Хранить в недоступном для детей месте.



Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@triholog.com.

Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru



**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника**

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121670

РУ _____

Дата стерилизации 12.2016

Годен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Хранить в недоступном для детей месте.



Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@triholog.com.

Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO



**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
концентрическим расположением наконечника**

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121670

РУ _____

Дата стерилизации 12.2016

Гожен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5⁰С до +40⁰С

Хранить в недоступном для детей месте.



Разработчик: ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22,
bp@triholog.com.

Производитель: ООО «Стерин», 140500, Московская область, г. Луховицы,
ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

STERILE EO



**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника**

Наконечник типа «Луер»

Стерильно, апирогенно.

Серия 121670

РУ _____

Дата стерилизации 12.2016

Гожен до 12.21

Класс отходов «Б», утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5⁰С до +40⁰С

Хранить в недоступном для детей месте.

Этикетка транспортная

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

 **Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

Место производства: 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км

**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
концентрическим расположением наконечника**

Стерильно, апирогенно

Партия _____ Дата стерилизации _____ Количество _____
Годен до _____
РУ _____

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от - 50°C до +50°C



STERILE EO

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

 **Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

Место производства: 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км

**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 10 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника**

Стерильно, апирогенно

Партия _____ Дата стерилизации _____ Количество _____
Годен до _____
РУ _____

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от - 50°C до +50°C



STERILE EO

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

 **Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

Место производства: 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км

**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
концентрическим расположением наконечника**

Стерильно, апирогенно

Партия _____ Дата стерилизации _____ Количество _____

Годен до _____
РУ _____

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от - 50°C до +50°C



STERILE EO

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «БИОНЕТ-ПЛЮС»
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, (8652) 94 00 42, 75 06 22, bp@triholog.com.

 **Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стерин», 140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, (495)972-34-92, 221-08-63, sterin10@yandex.ru

Место производства: 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км

**Шприц-пробирка полимерная центрифужная, стерильная CORTEXIL
(КОРТЕКСИЛ) по ТУ 32.50.50-001-76853870-2018 объемом 20 мл, с
эксцентрическим расположением наконечника**

Стерильно, апирогенно

Партия _____ Дата стерилизации _____ Количество _____

Годен до _____
РУ _____

Условия хранения по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от + 5°C до +40°C

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от - 50°C до +50°C



STERILE EO

Сшито и заверено печатью

(*акт*) лист *06*



Генеральный директор
ООО «БИОНЕТ-ПЛЮС»

Башкатов Ю.Г.