


Фотоизображения медицинского изделия


**Набор для проведения
общехирургических процедур
Matoset, стерильный
под товарным знаком matorat
по ТУ 32.50.50-042-11736425-2017**

2. Общий вид составляющих Набора для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-042-11736425-2017, производства ООО «Белла», Россия.


- 2.1. Салфетки перевязочные марлевые 8 сложений,
Салфетки перевязочные марлевые 12 сложений,
Салфетки перевязочные марлевые 16 сложений

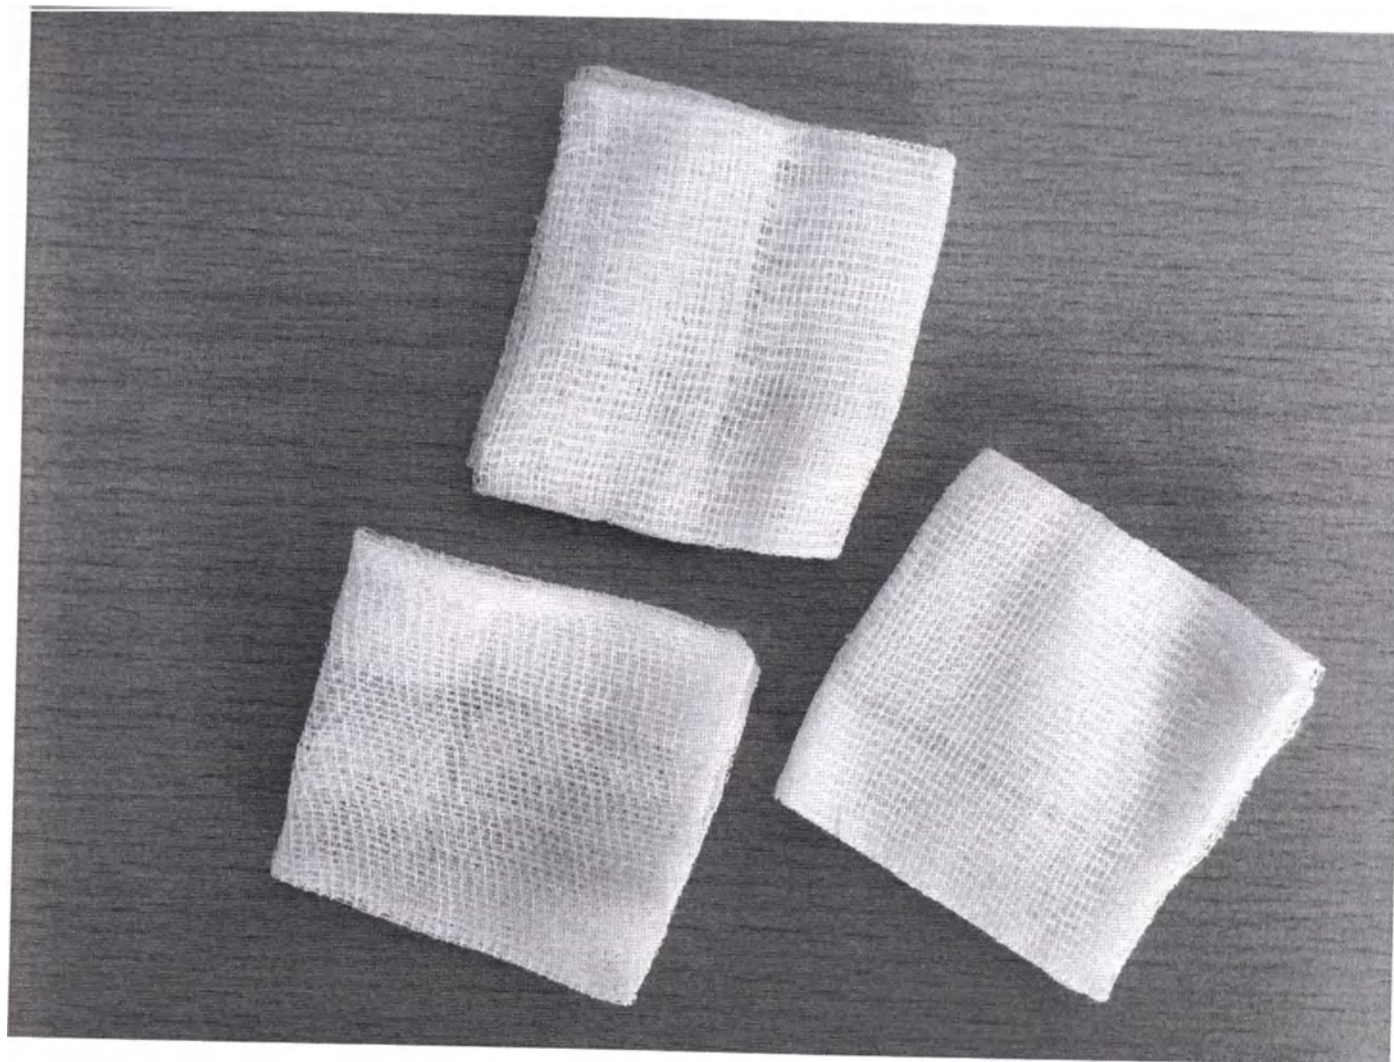


- 2.2. Салфетки перевязочные марлевые с рентгеноконтрастной нитью 8 сложений,
Салфетки перевязочные марлевые с рентгеноконтрастной нитью 16 сложений

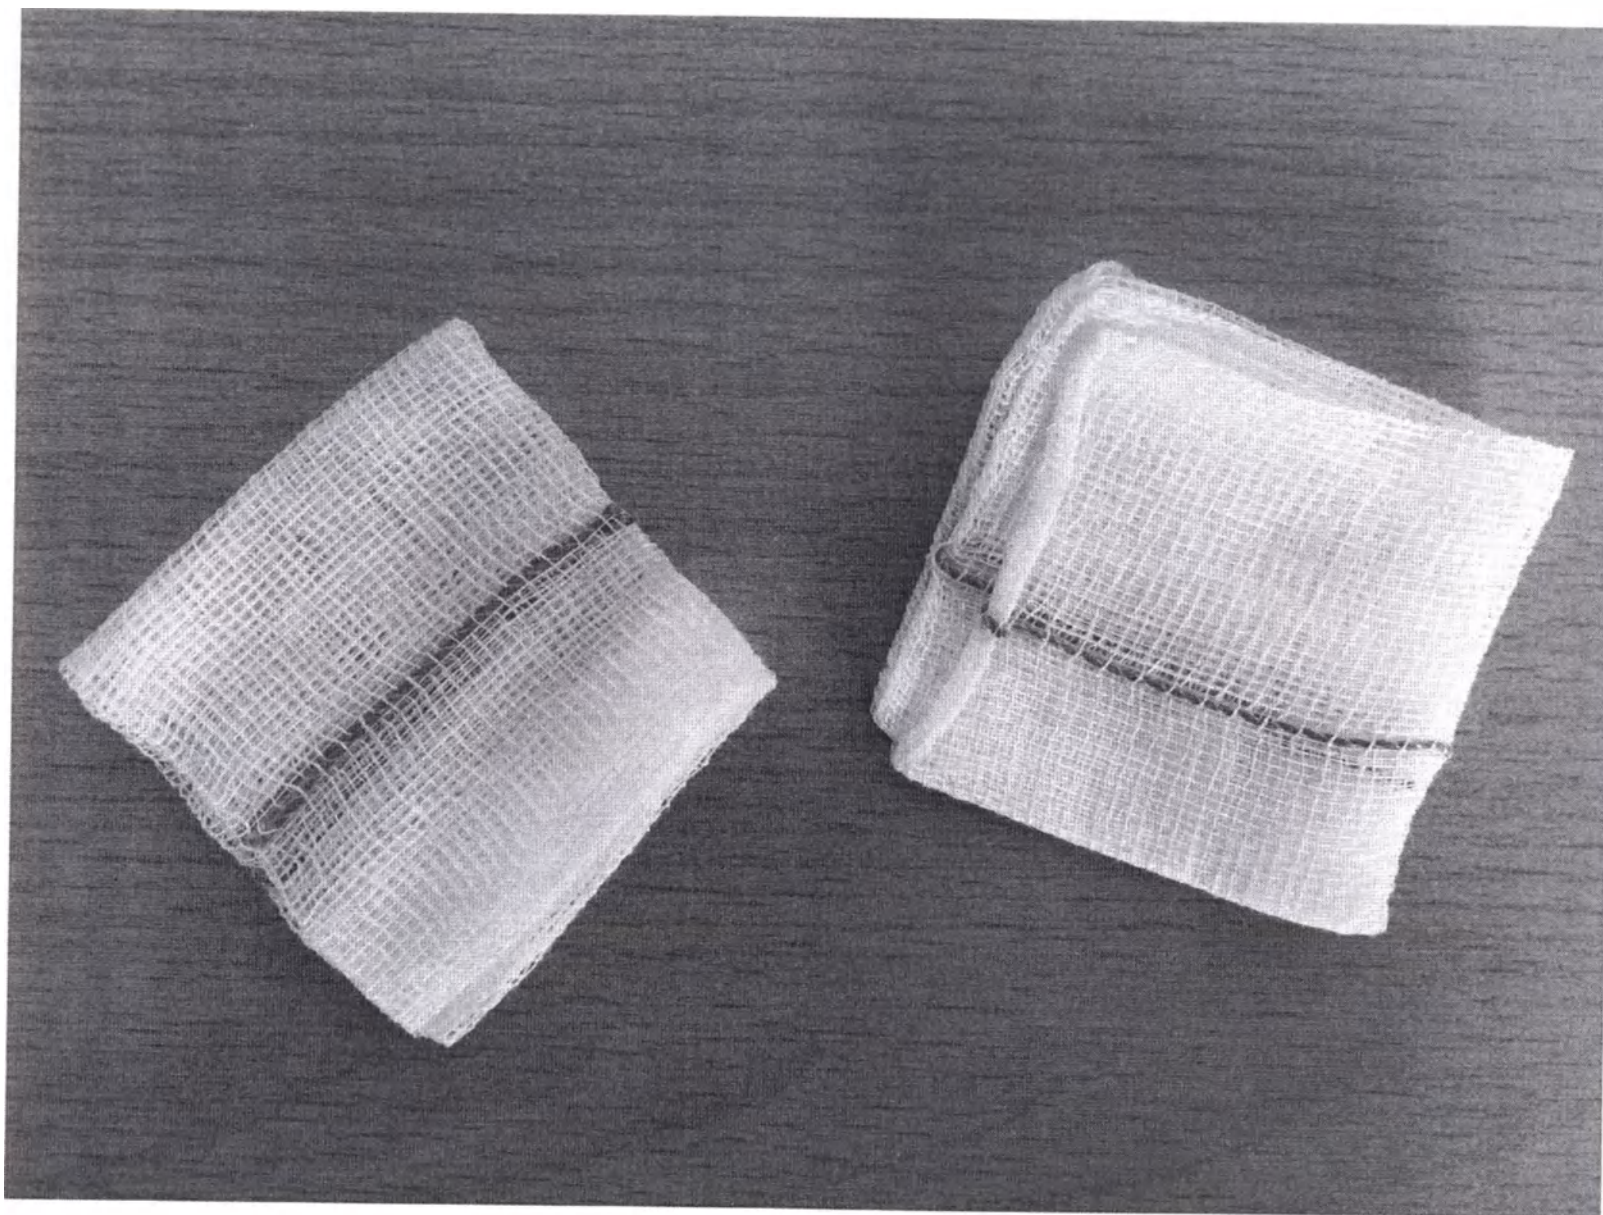


2.3. Салфетки перевязочные из нетканого материала 4 сложения

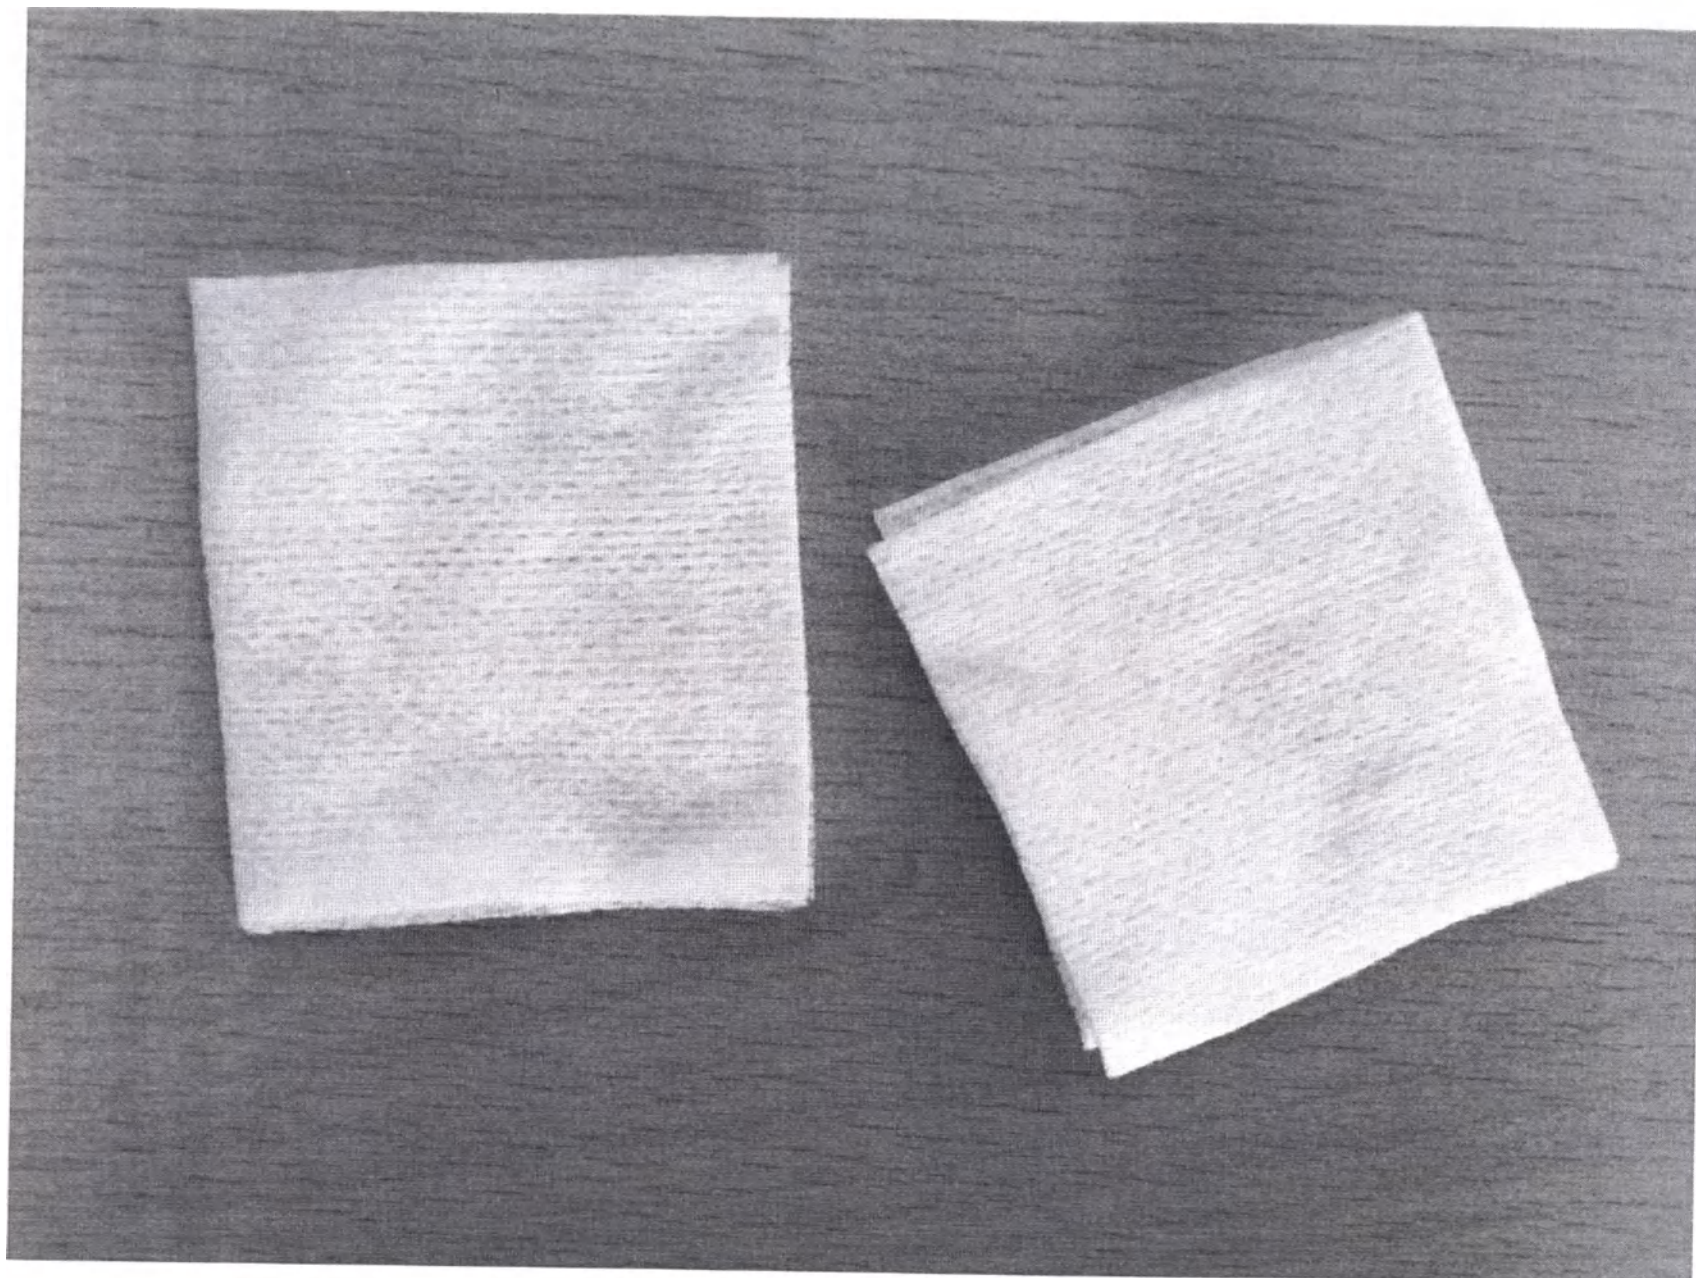


2.4. Салфетки перевязочные из нетканого материала с надрезом в форме «Y» 4 сложения

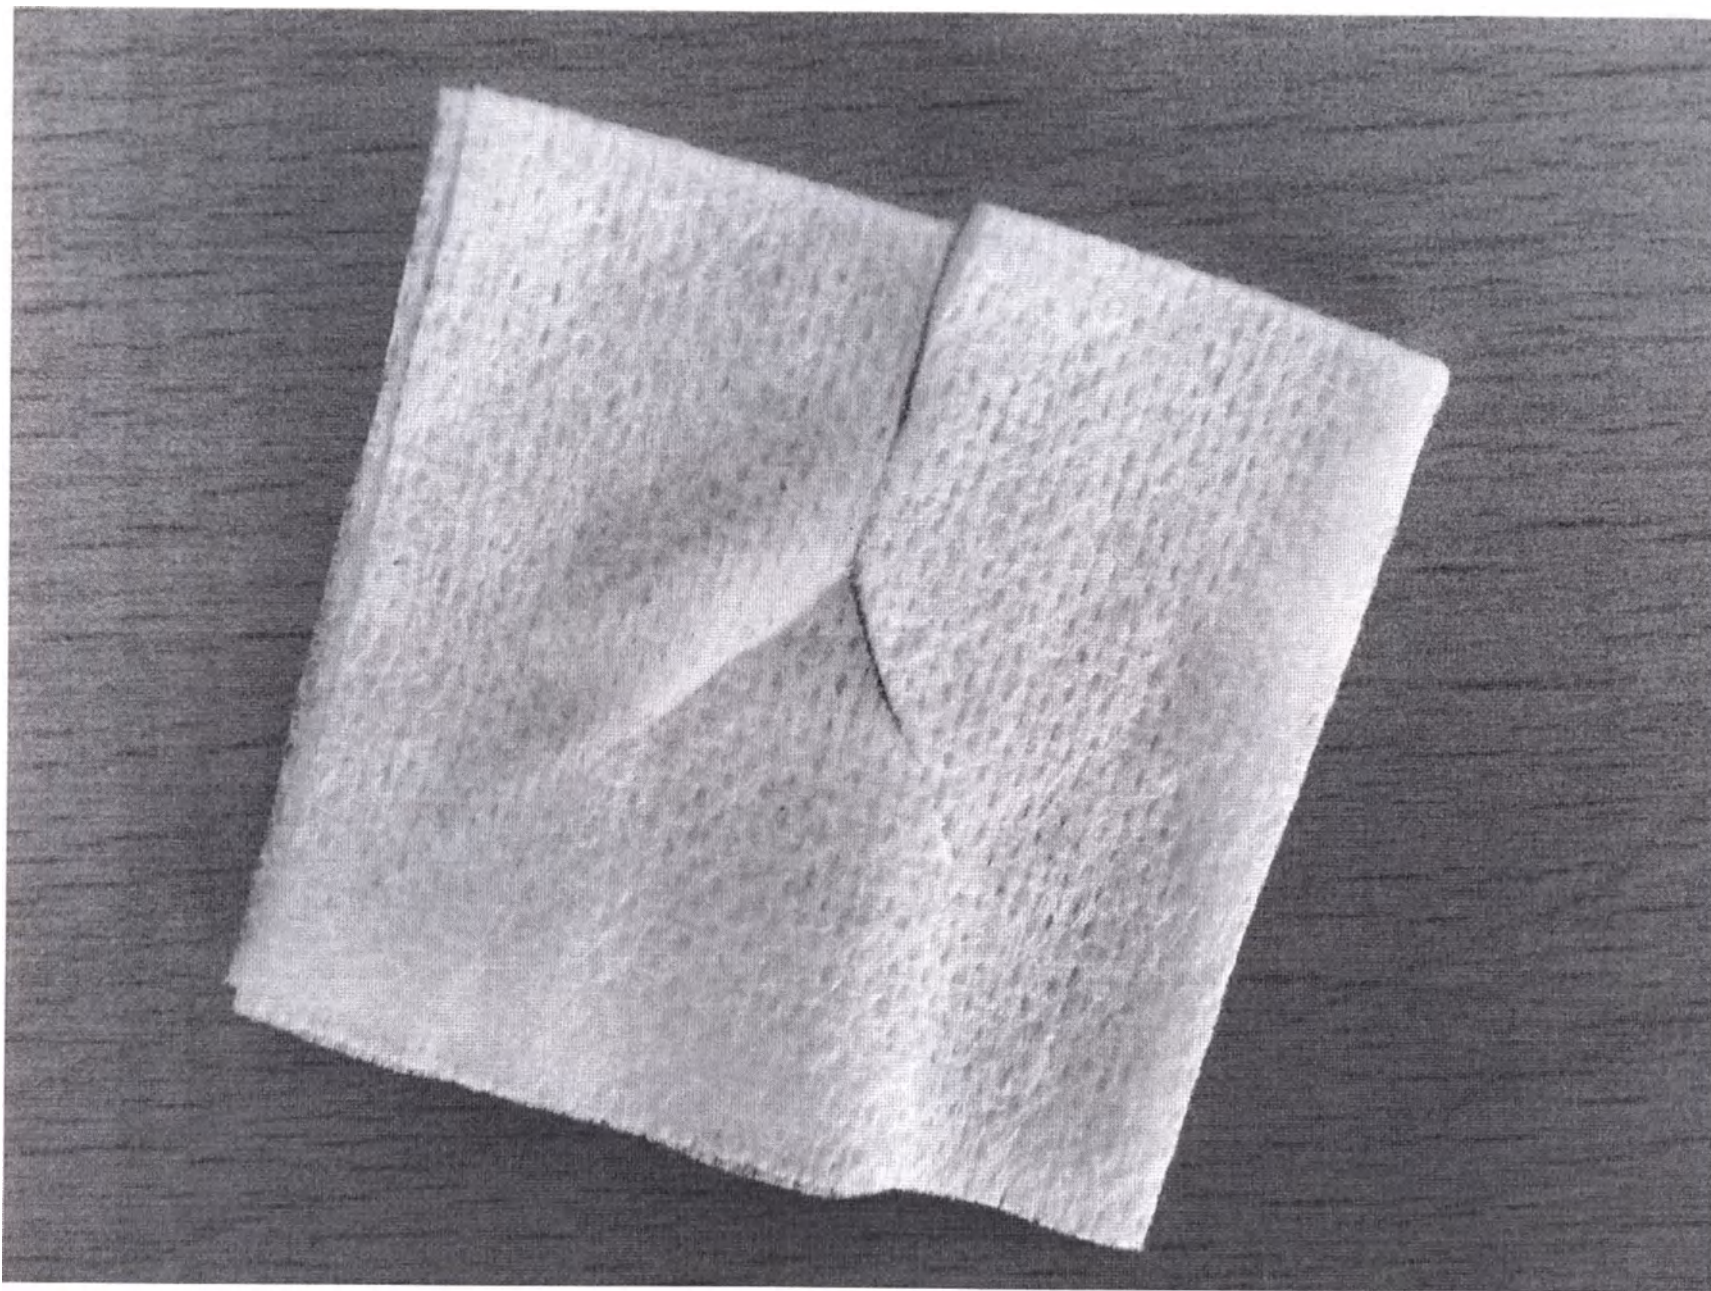


- 2.5. Тупферы из марлевых отрезов: форма шарика,
Тупферы из марлевых отрезов: форма треугольника

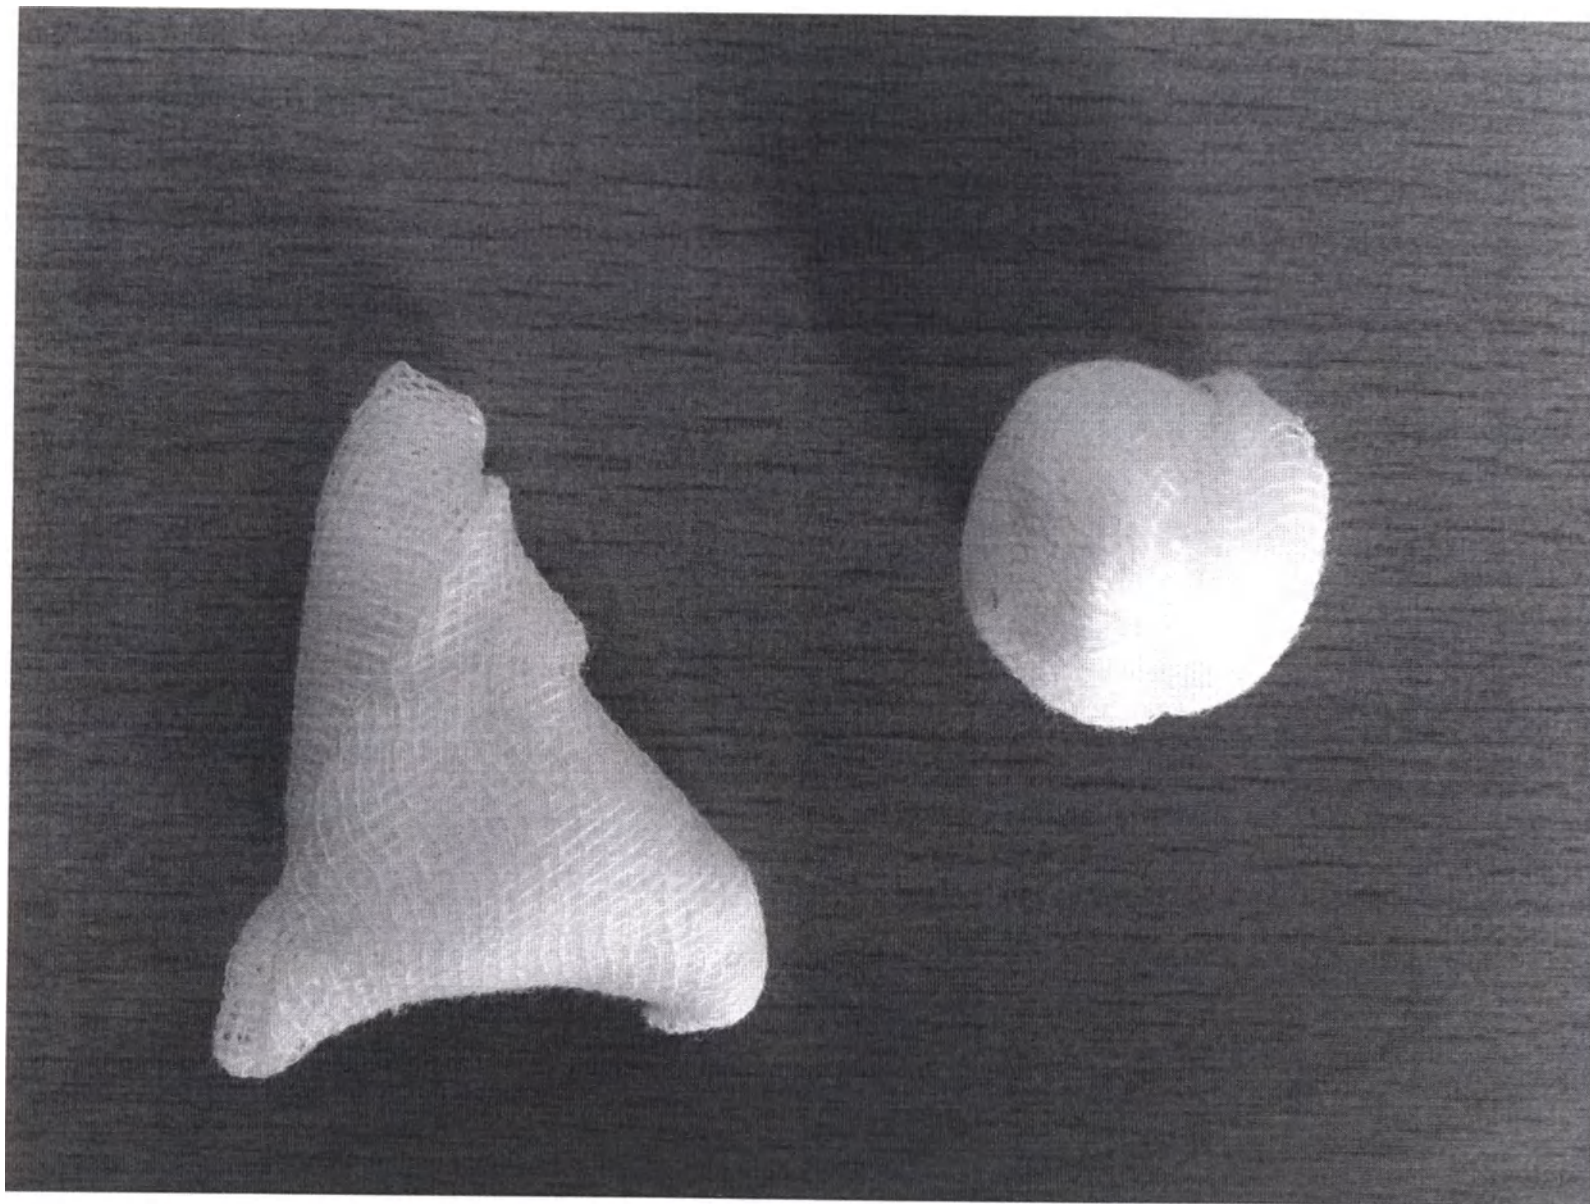


- 2.6. Тупферы из марлевых отрезов с рентгеноконтрастной нитью: форма фасольки,
Тупферы из марлевых отрезов с рентгеноконтрастной нитью: форма усика,
Тупферы из марлевых отрезов с рентгеноконтрастной нитью: форма треугольника,
Тупферы из марлевых отрезов с рентгеноконтрастной нитью: форма шарика

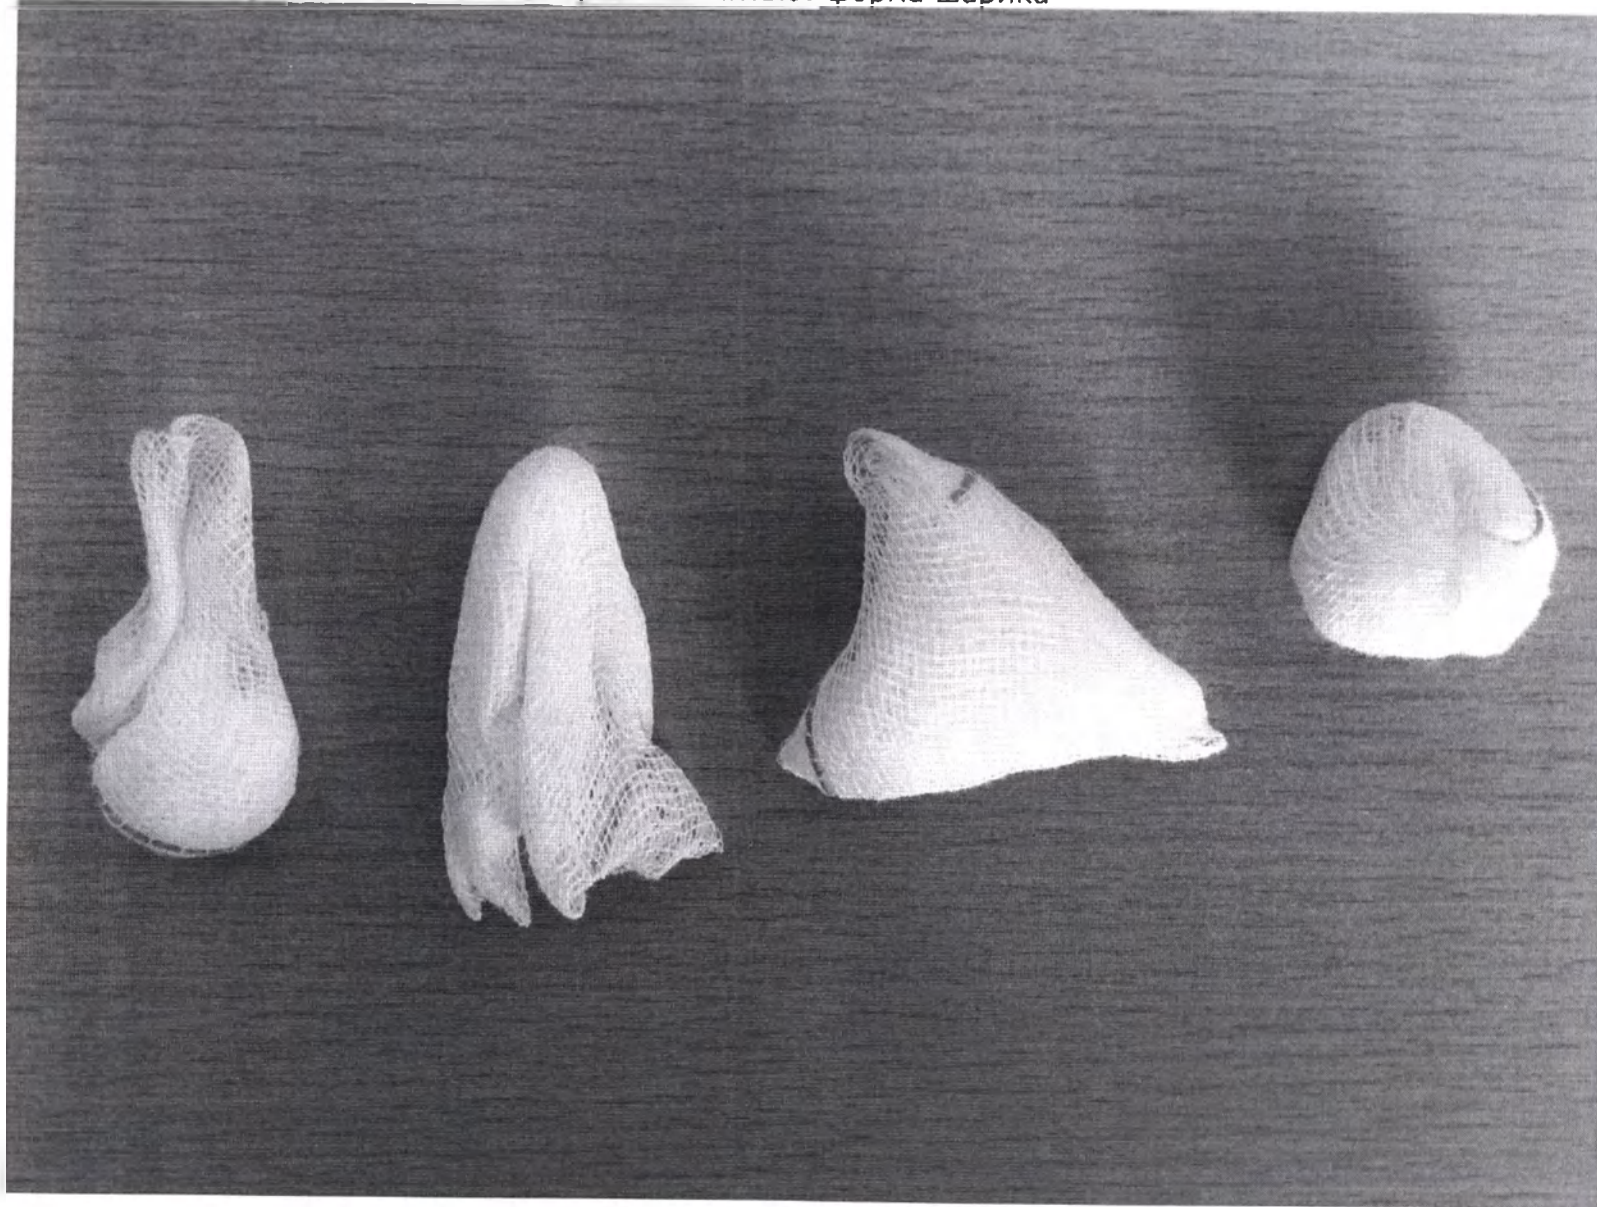


2.7. Операционные салфетки с рентгеноконтрастной нитью и фиксатором: Abdoma (Абдома) 2-слойные

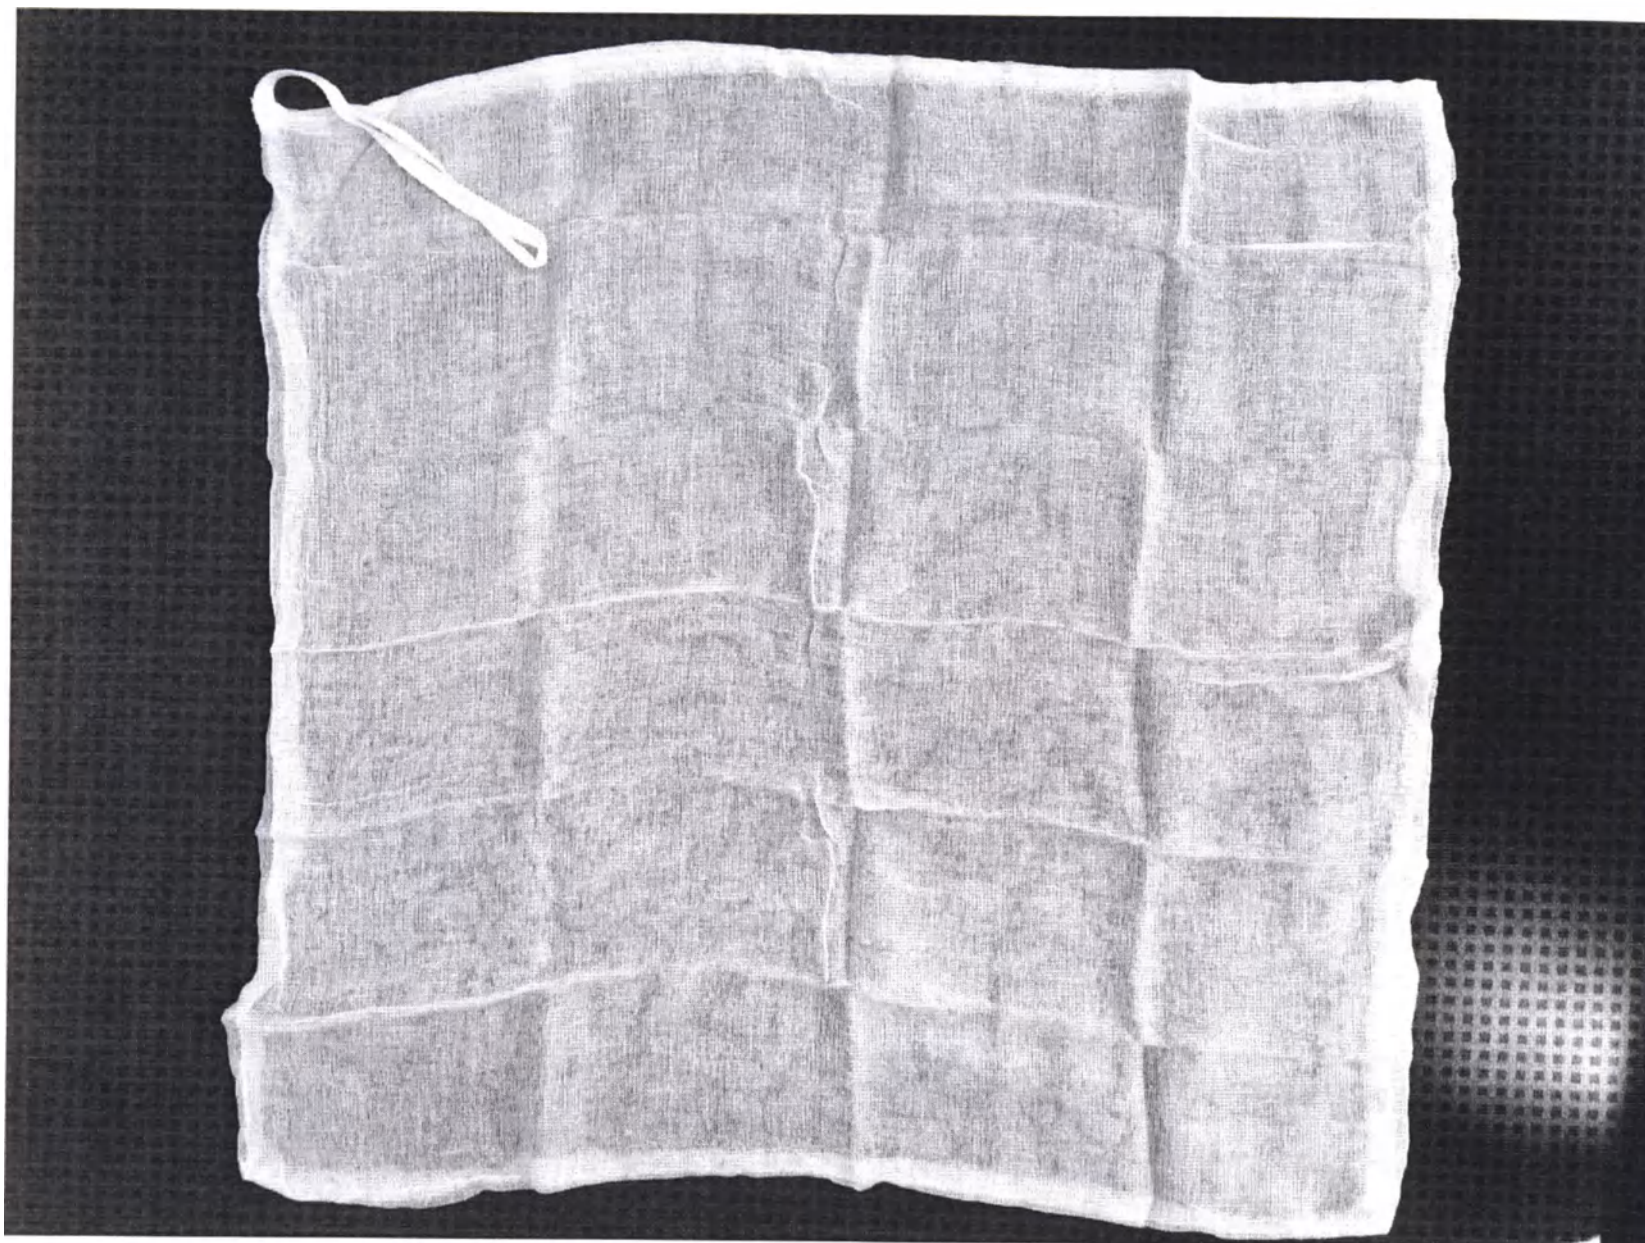


2.8. Операционные салфетки с рентгеноконтрастной нитью и фиксатором: Abdoma (Абдома) 4-слойные

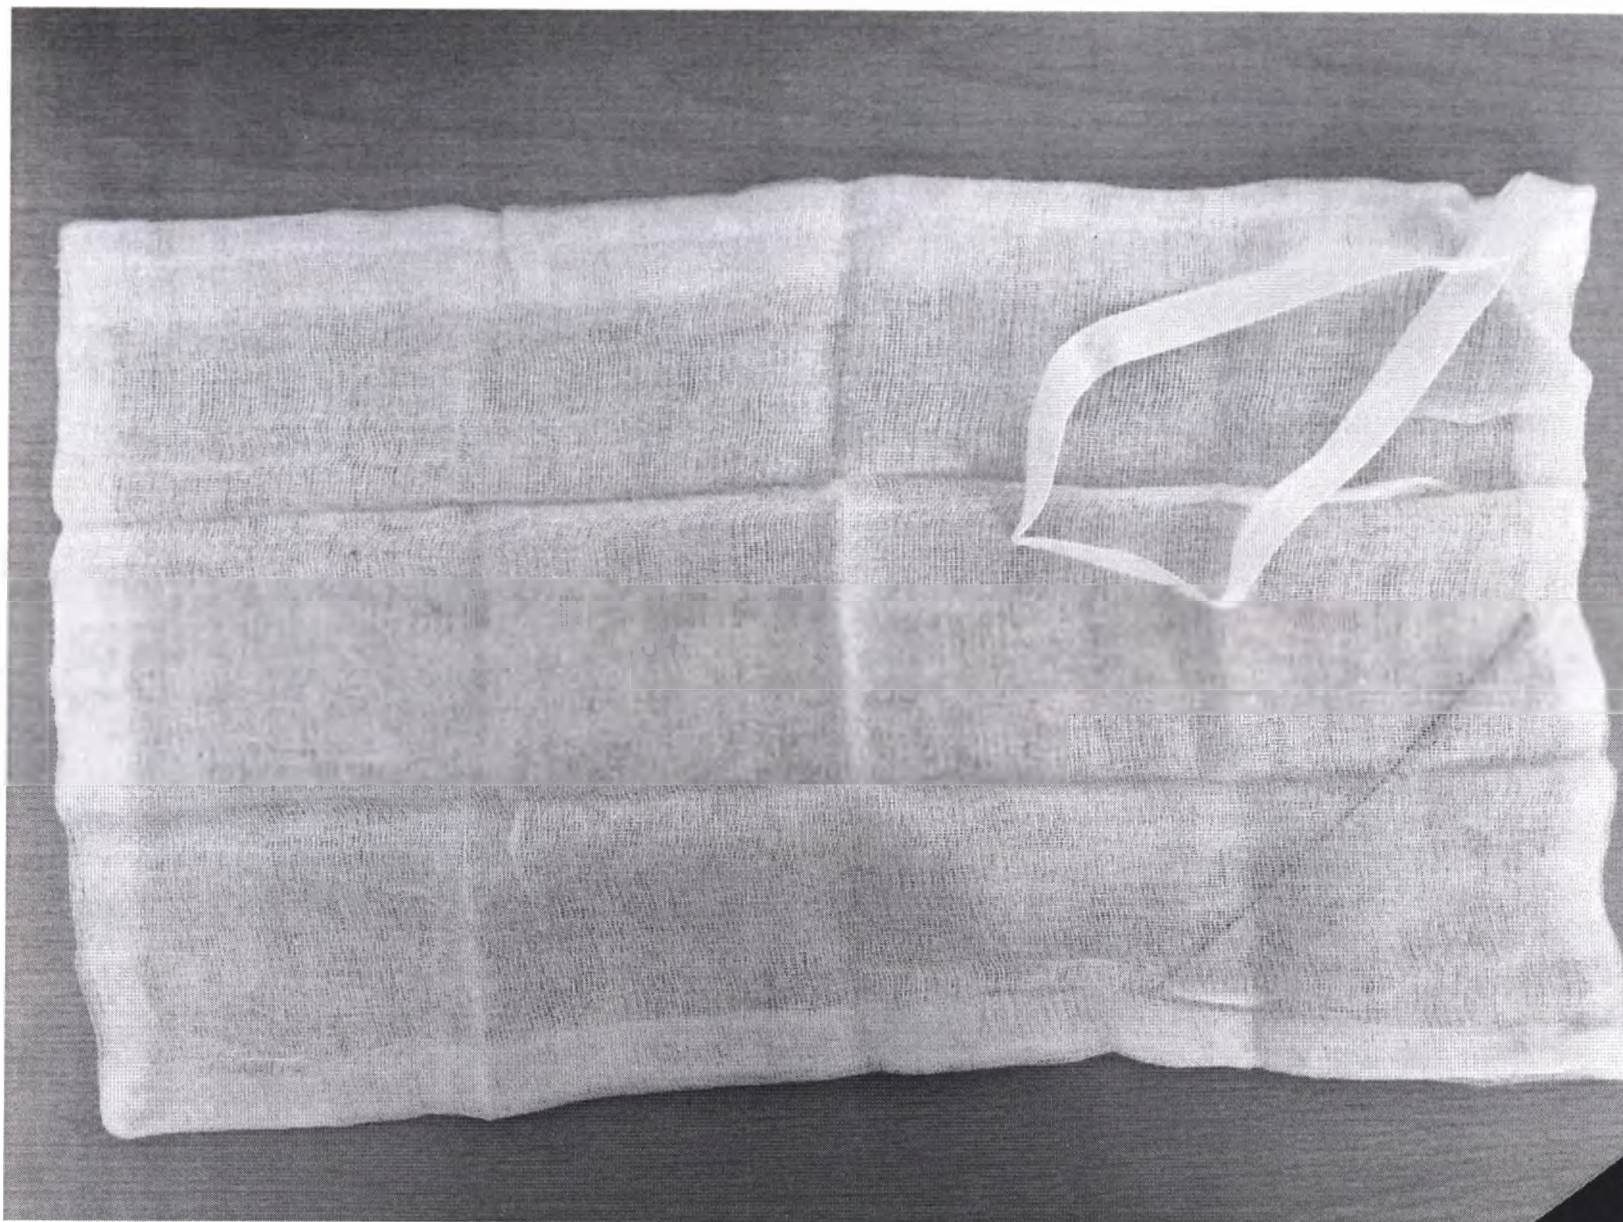


2.9. Операционные салфетки с рентгеноконтрастной нитью и фиксатором: Abdoma (Абдома) 6-слойные

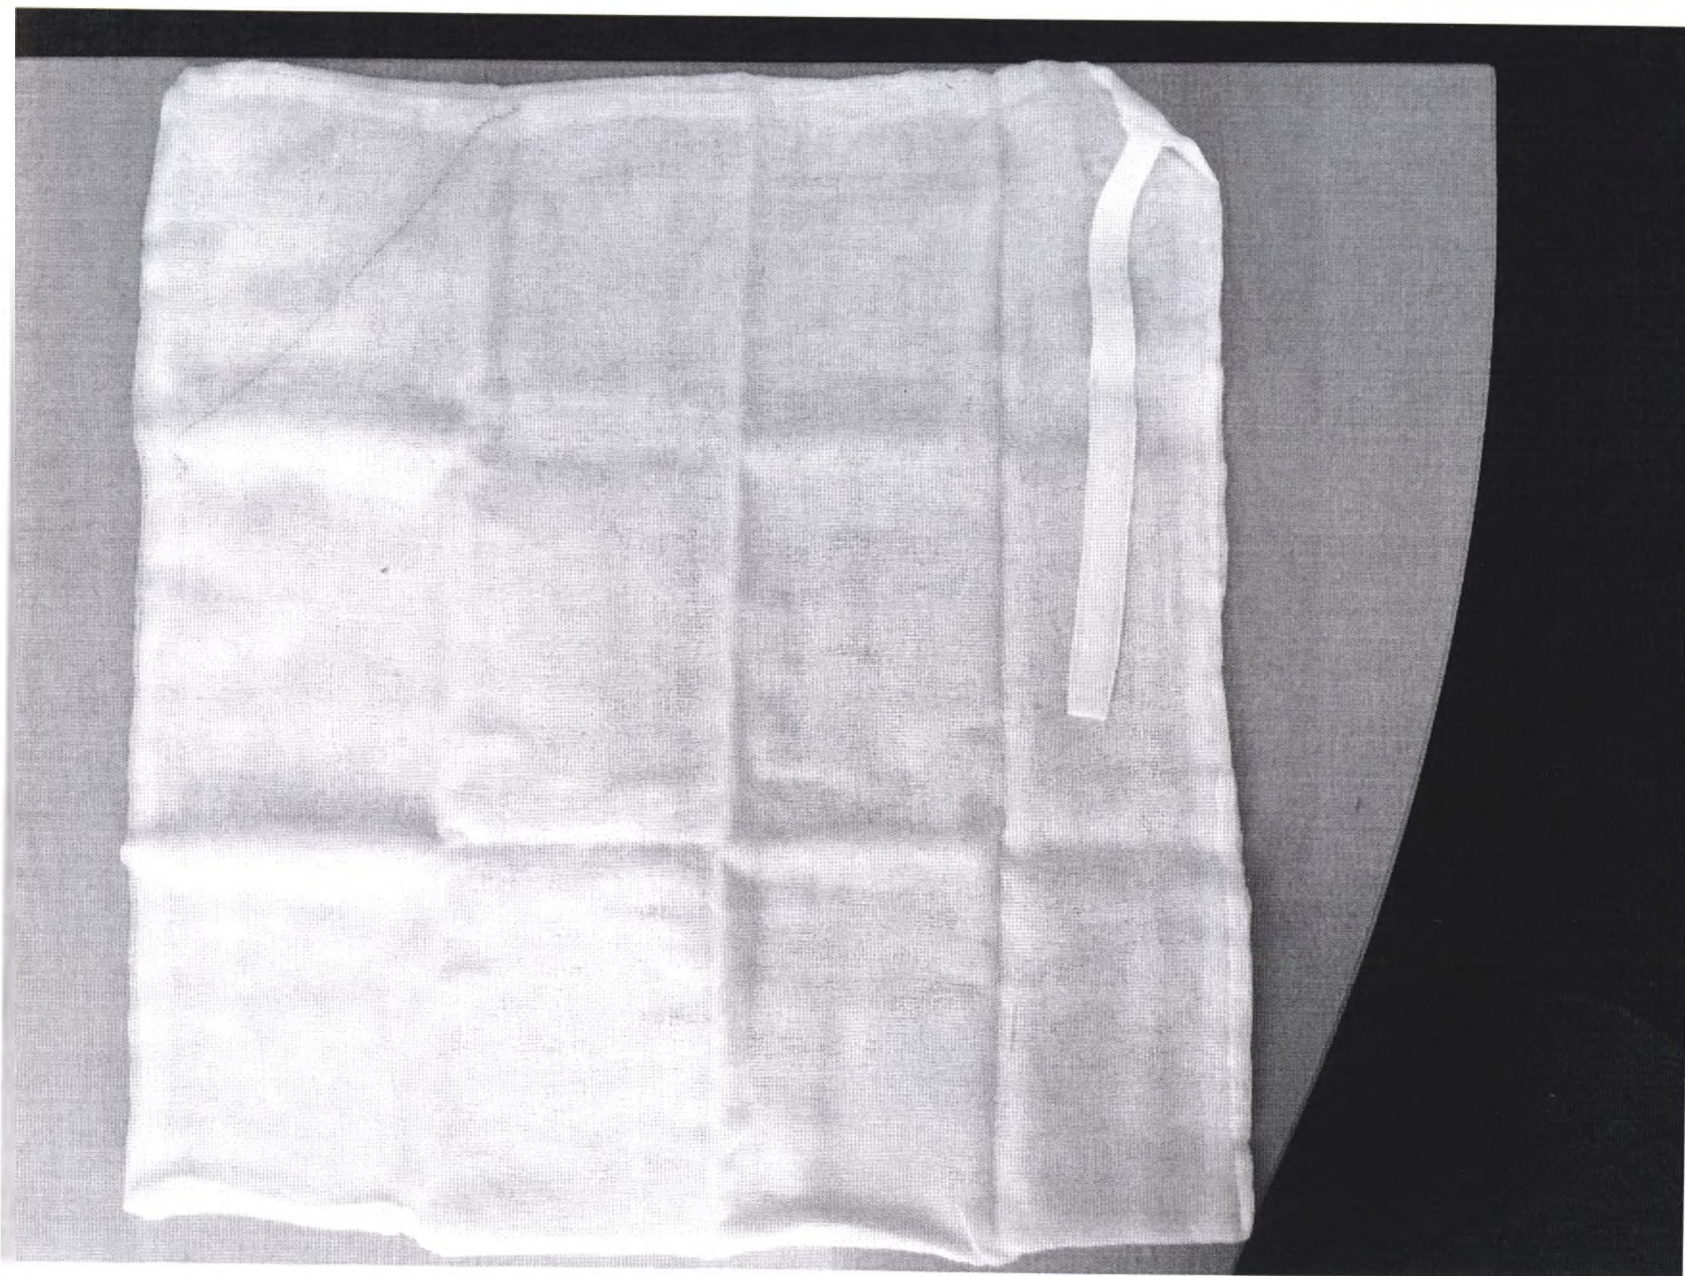


2.10. Операционные салфетки с рентгеноконтрастной нитью: Abdoma (Абдома) 4-слойные

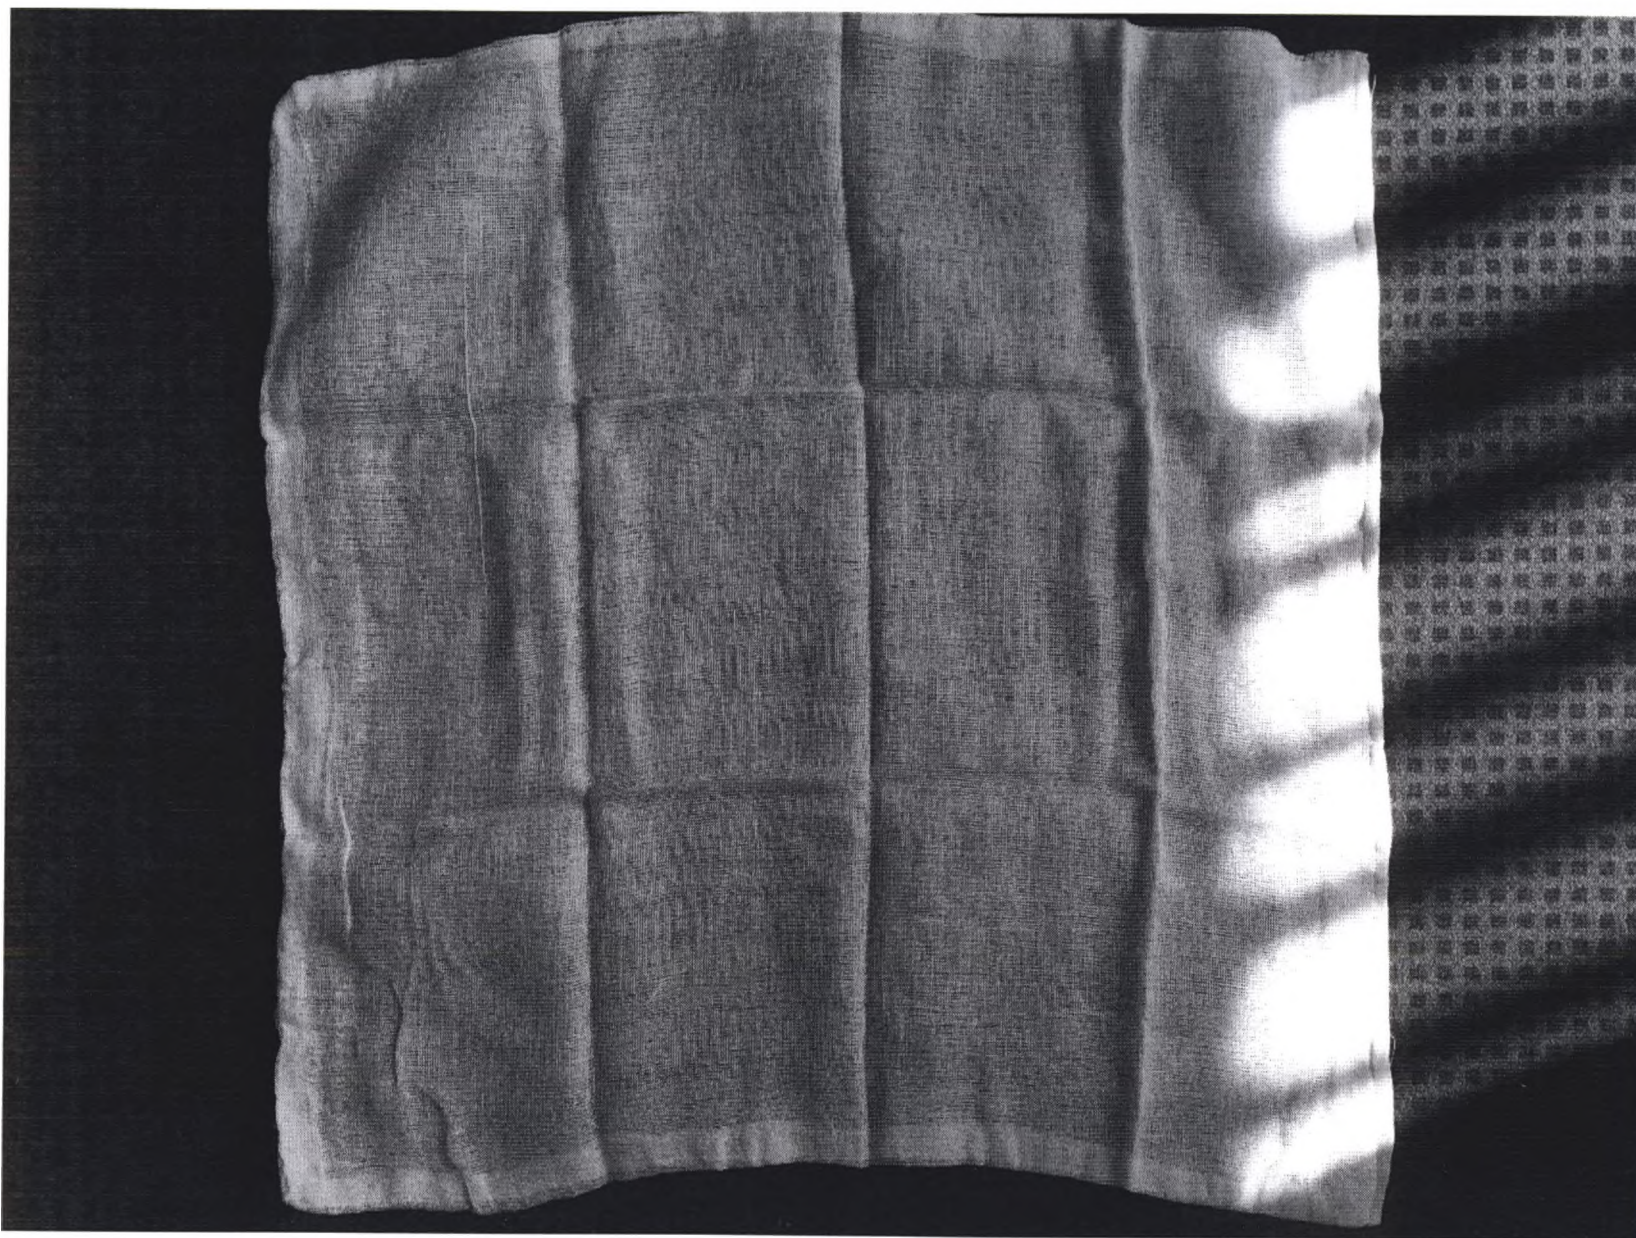


2.11. Сетоны марлевые 4-слойные

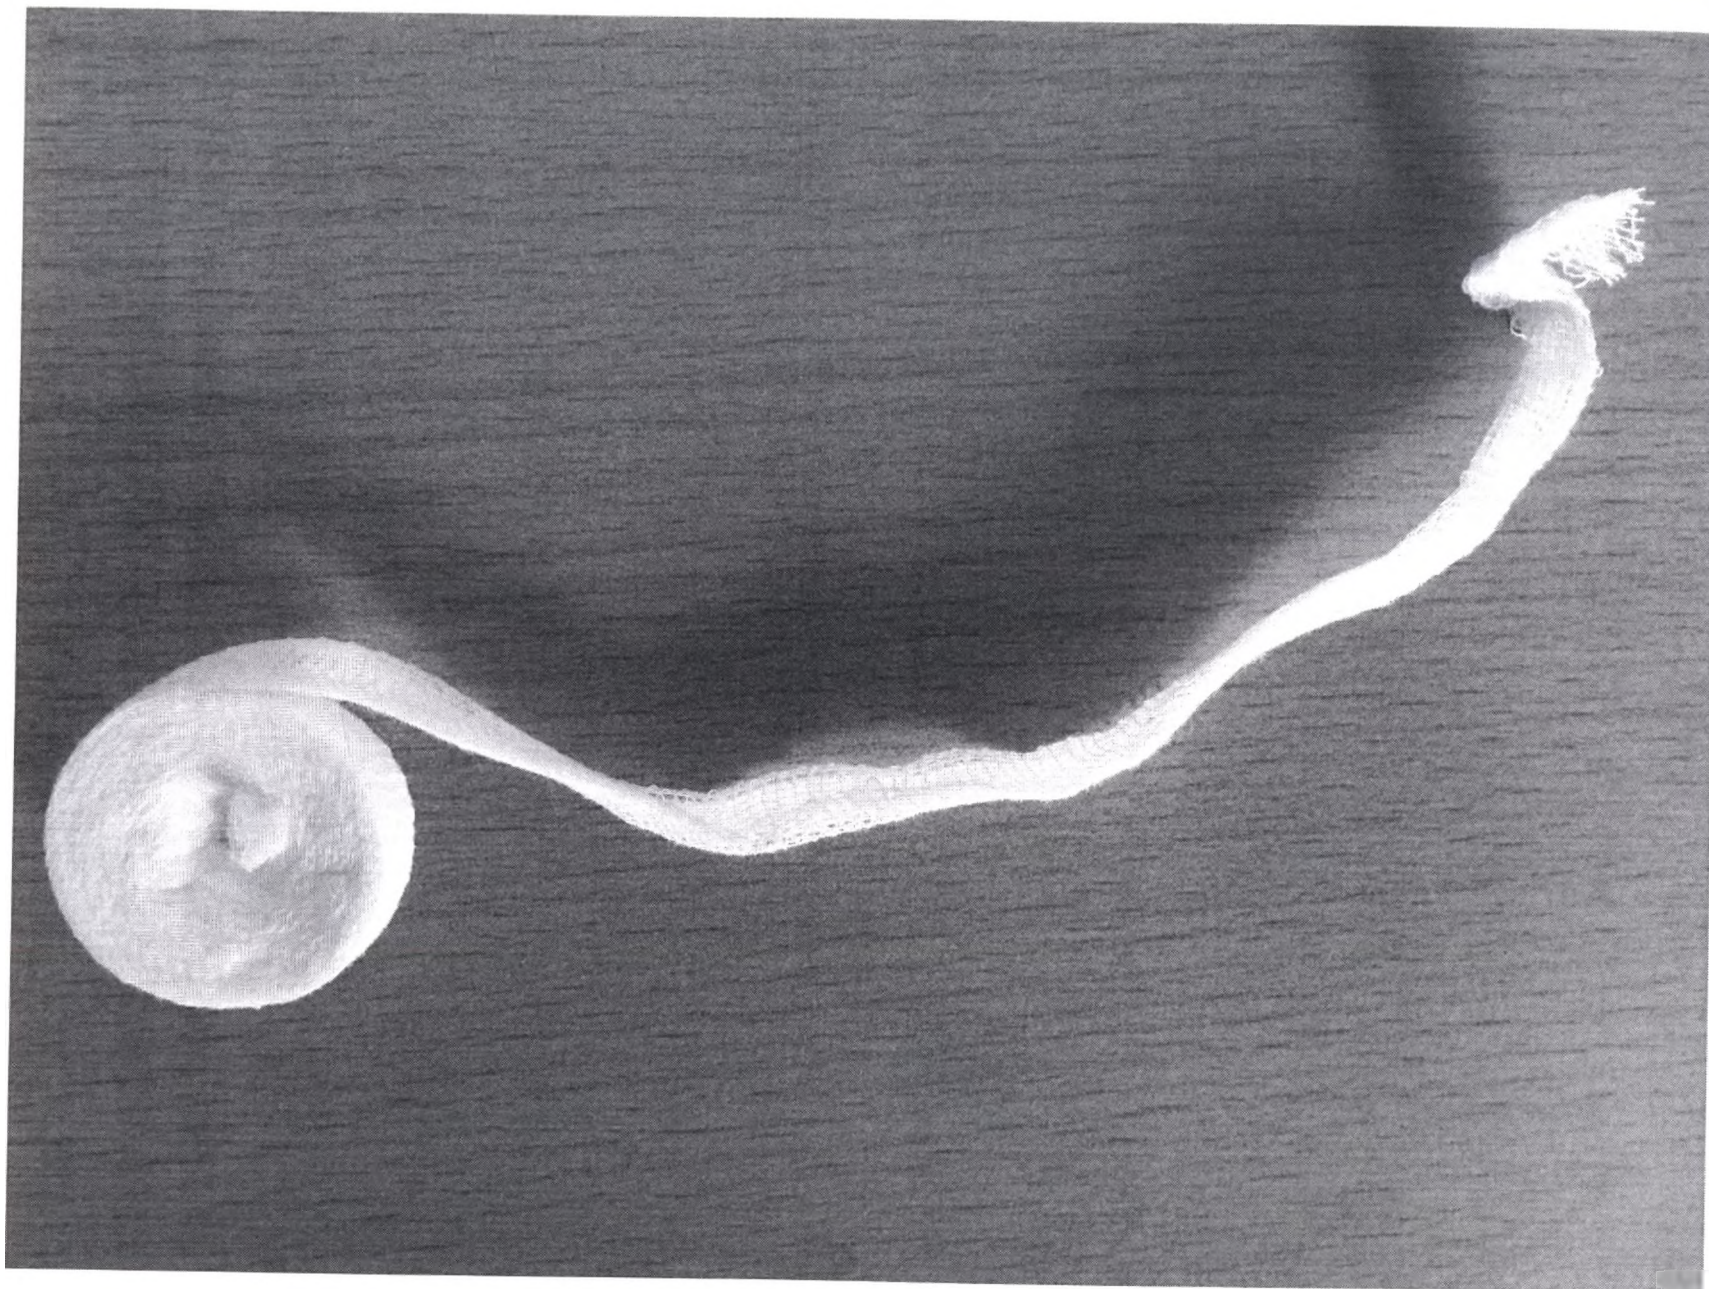


2.12. Сетоны марлевые с рентгеноконтрастной нитью 4-слойные

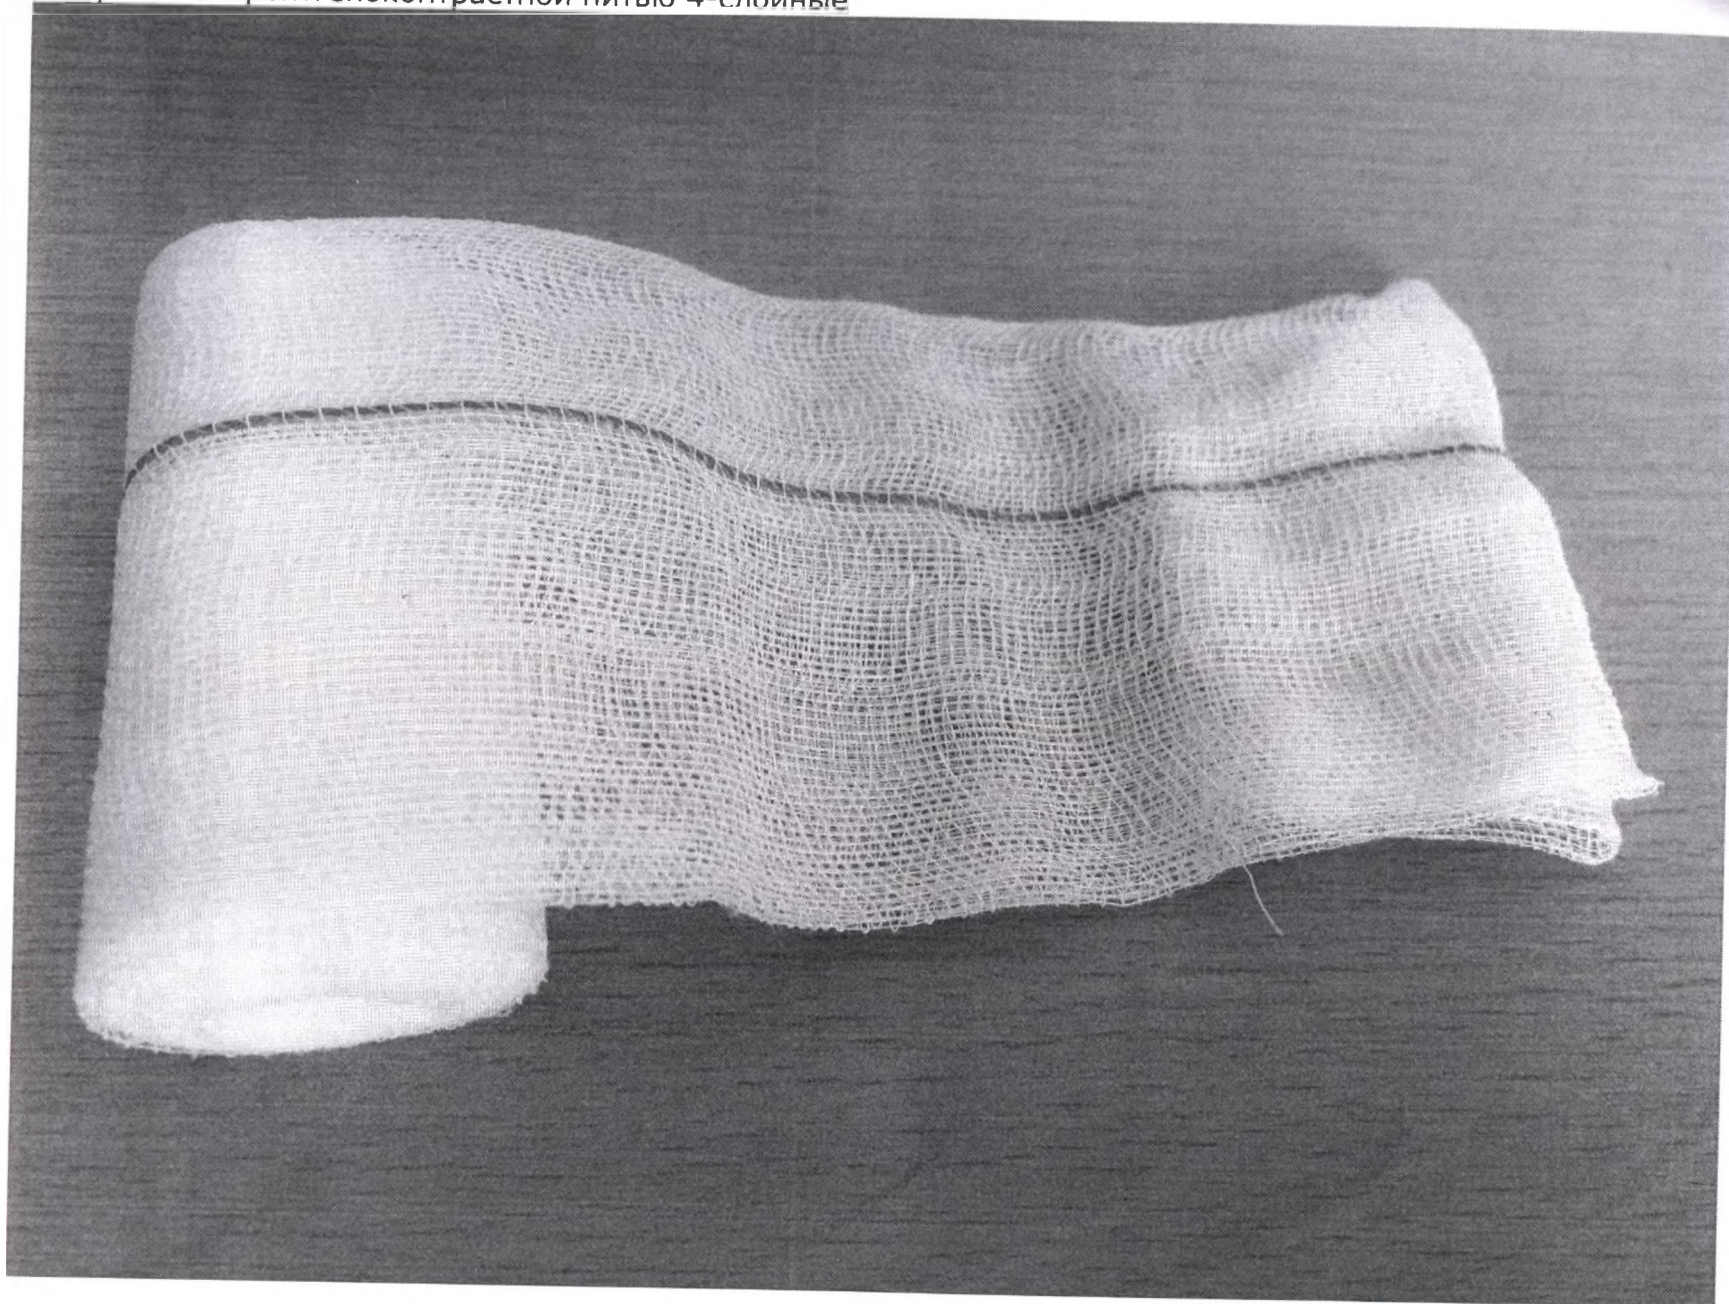


3/293
29.06.2018

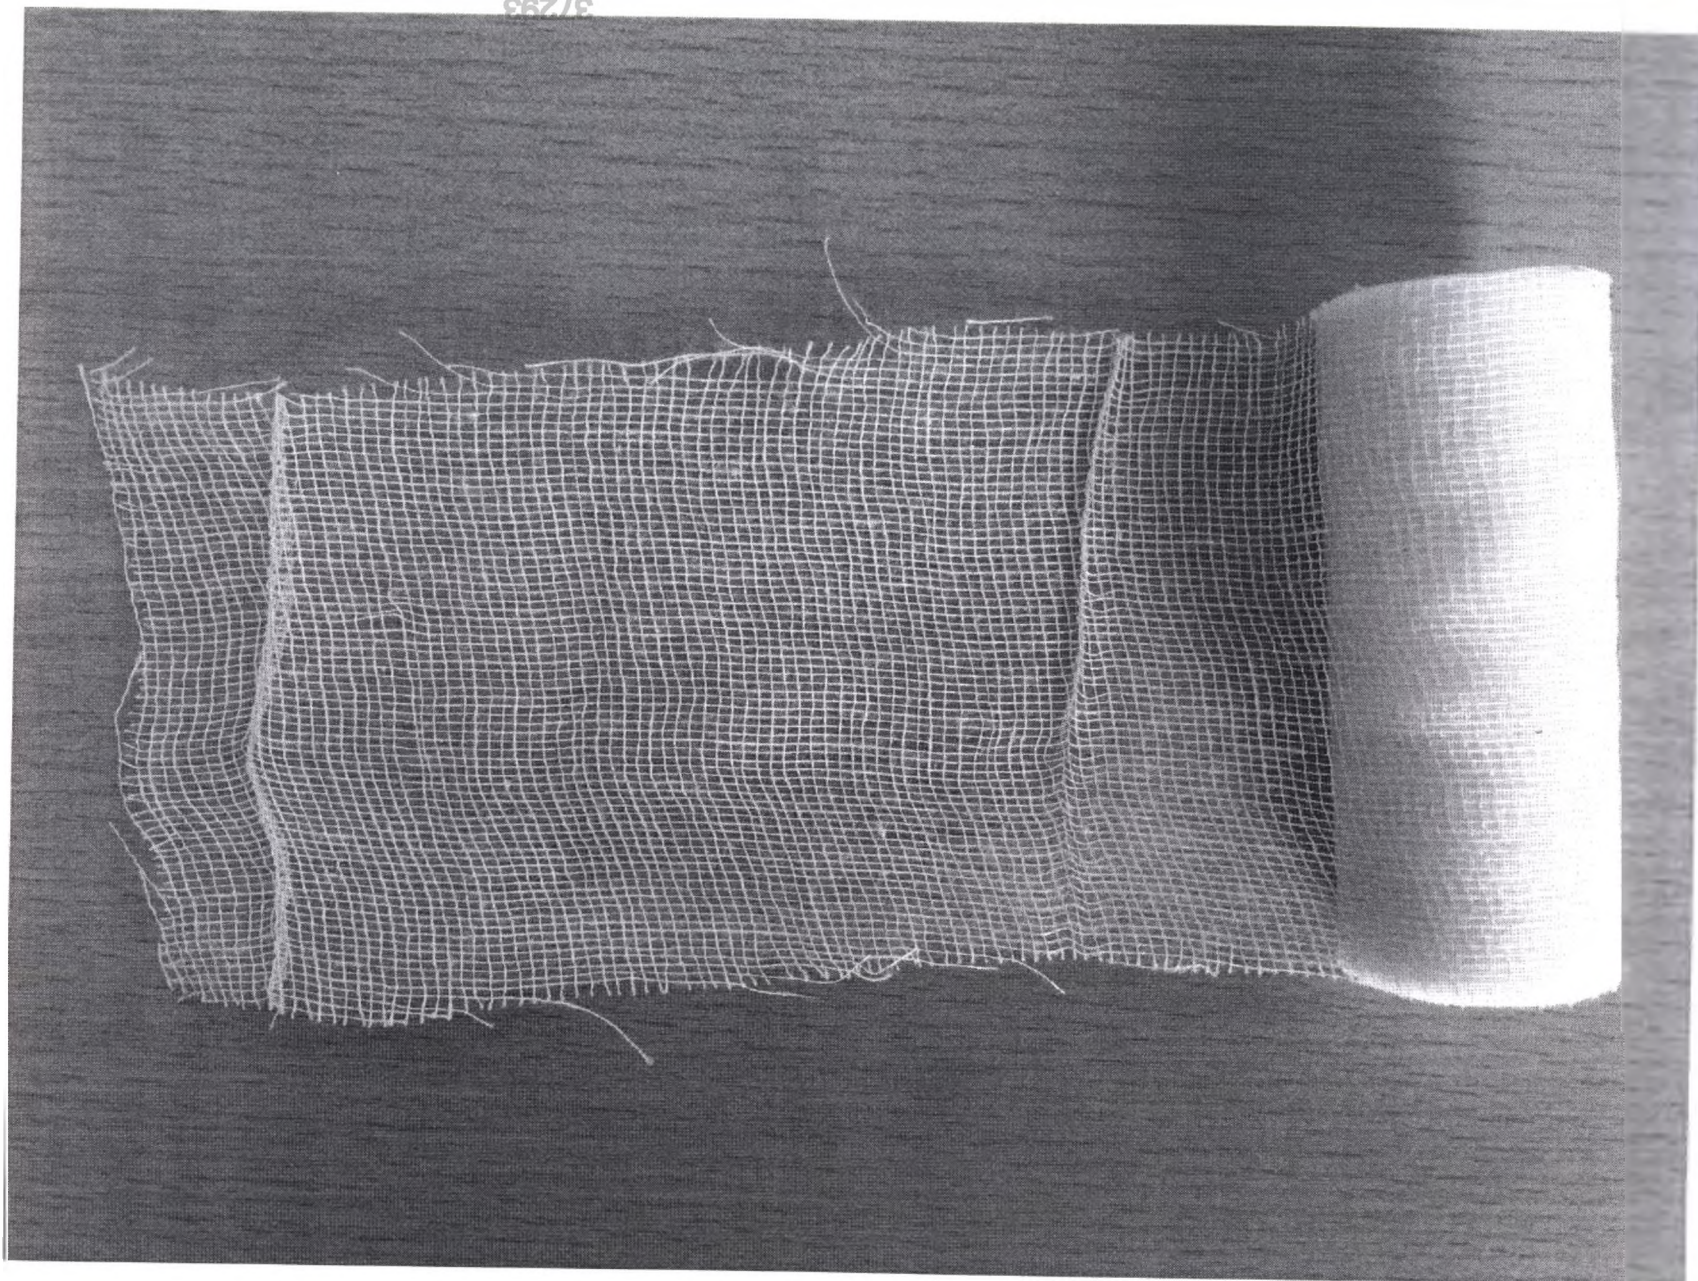


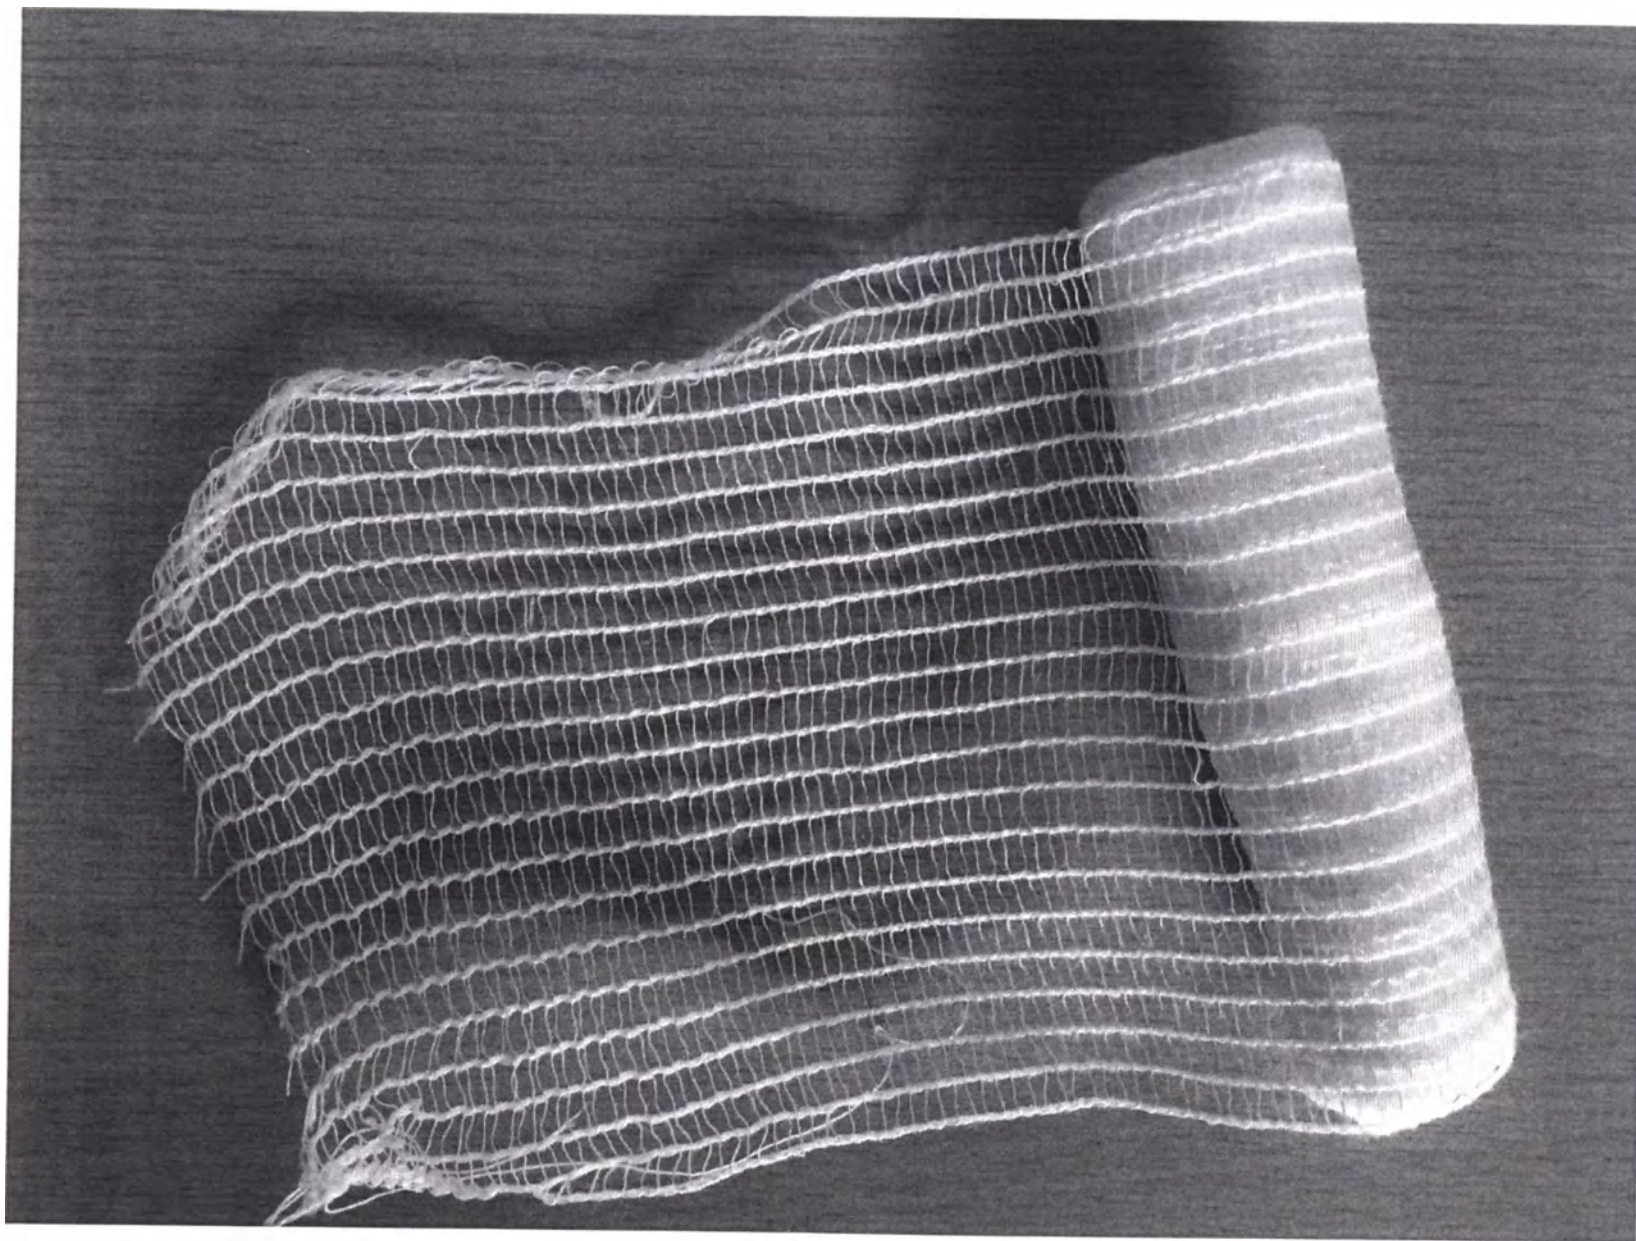


2.14. Тампон для тампонады

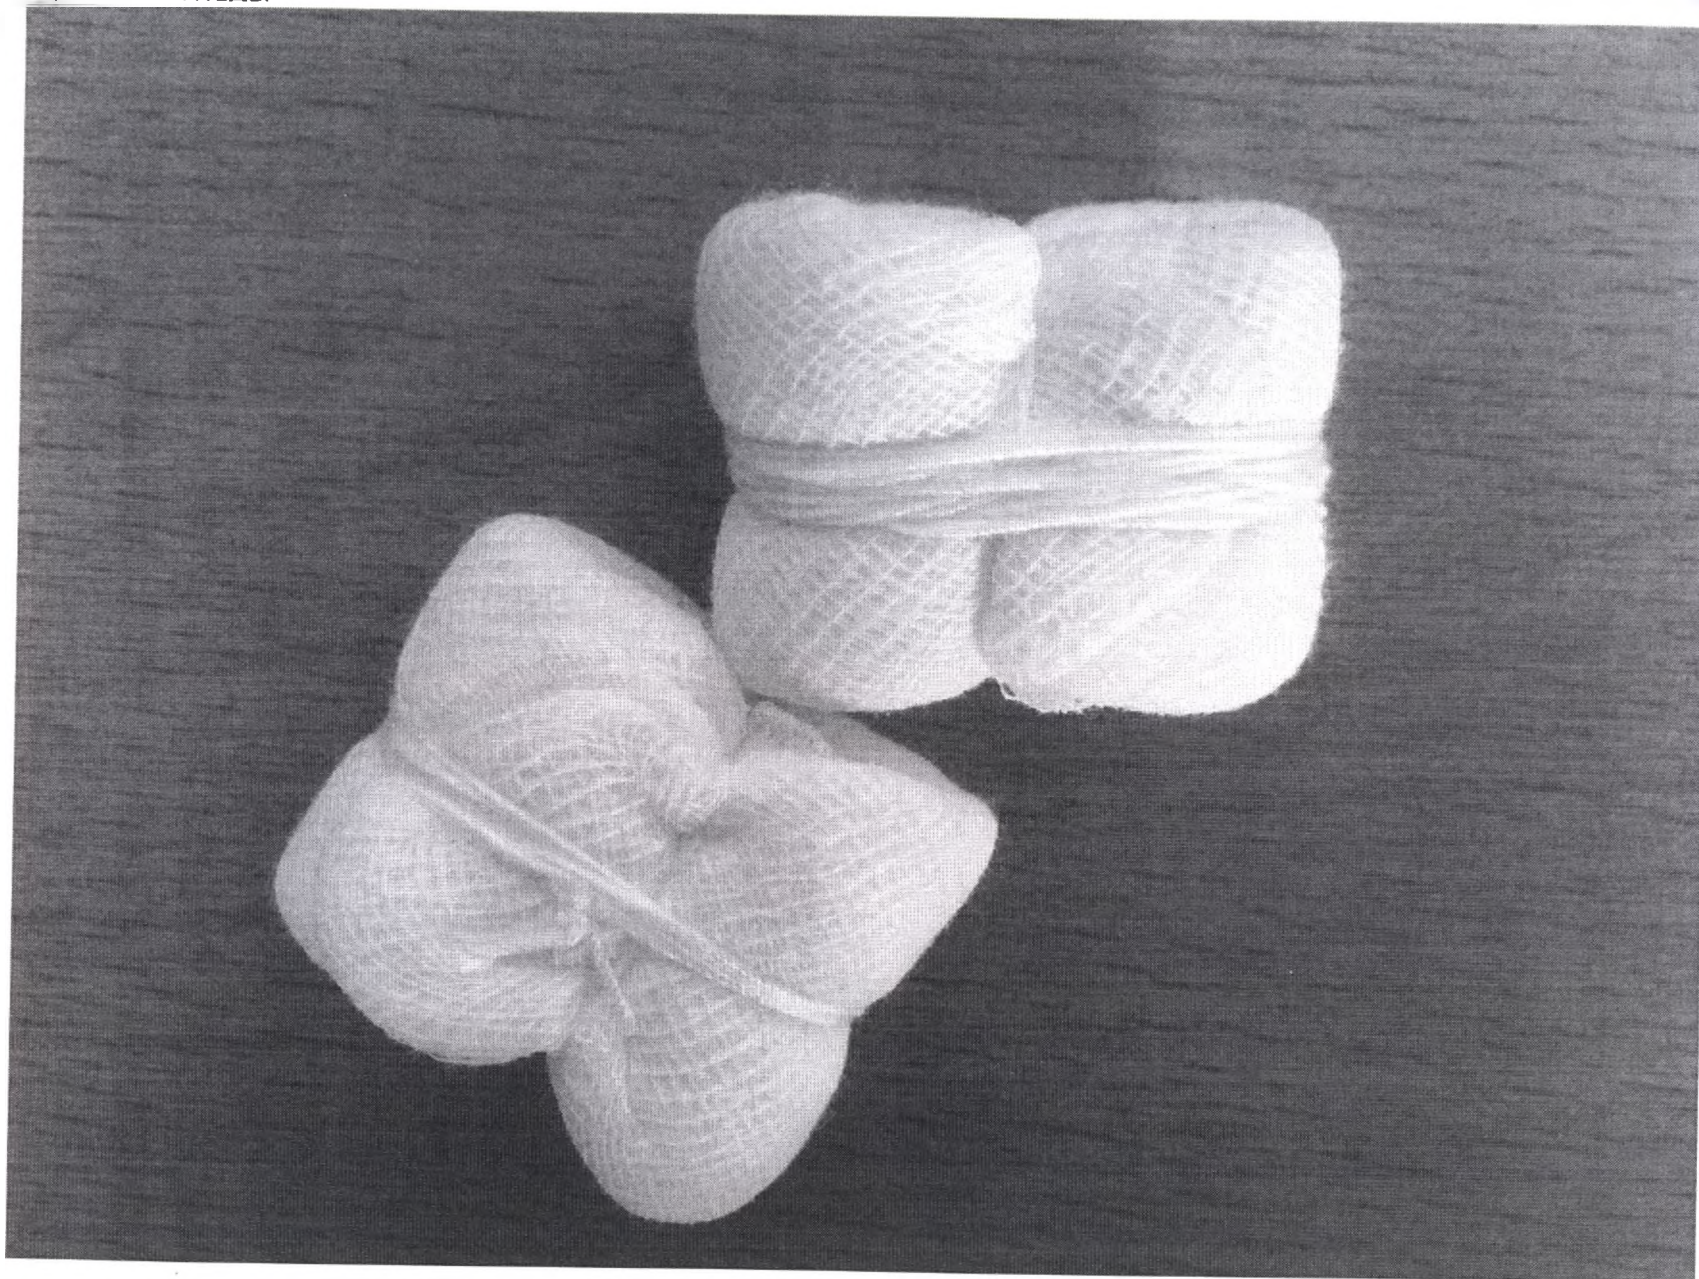


2.15. Салфетка из нетканого материала

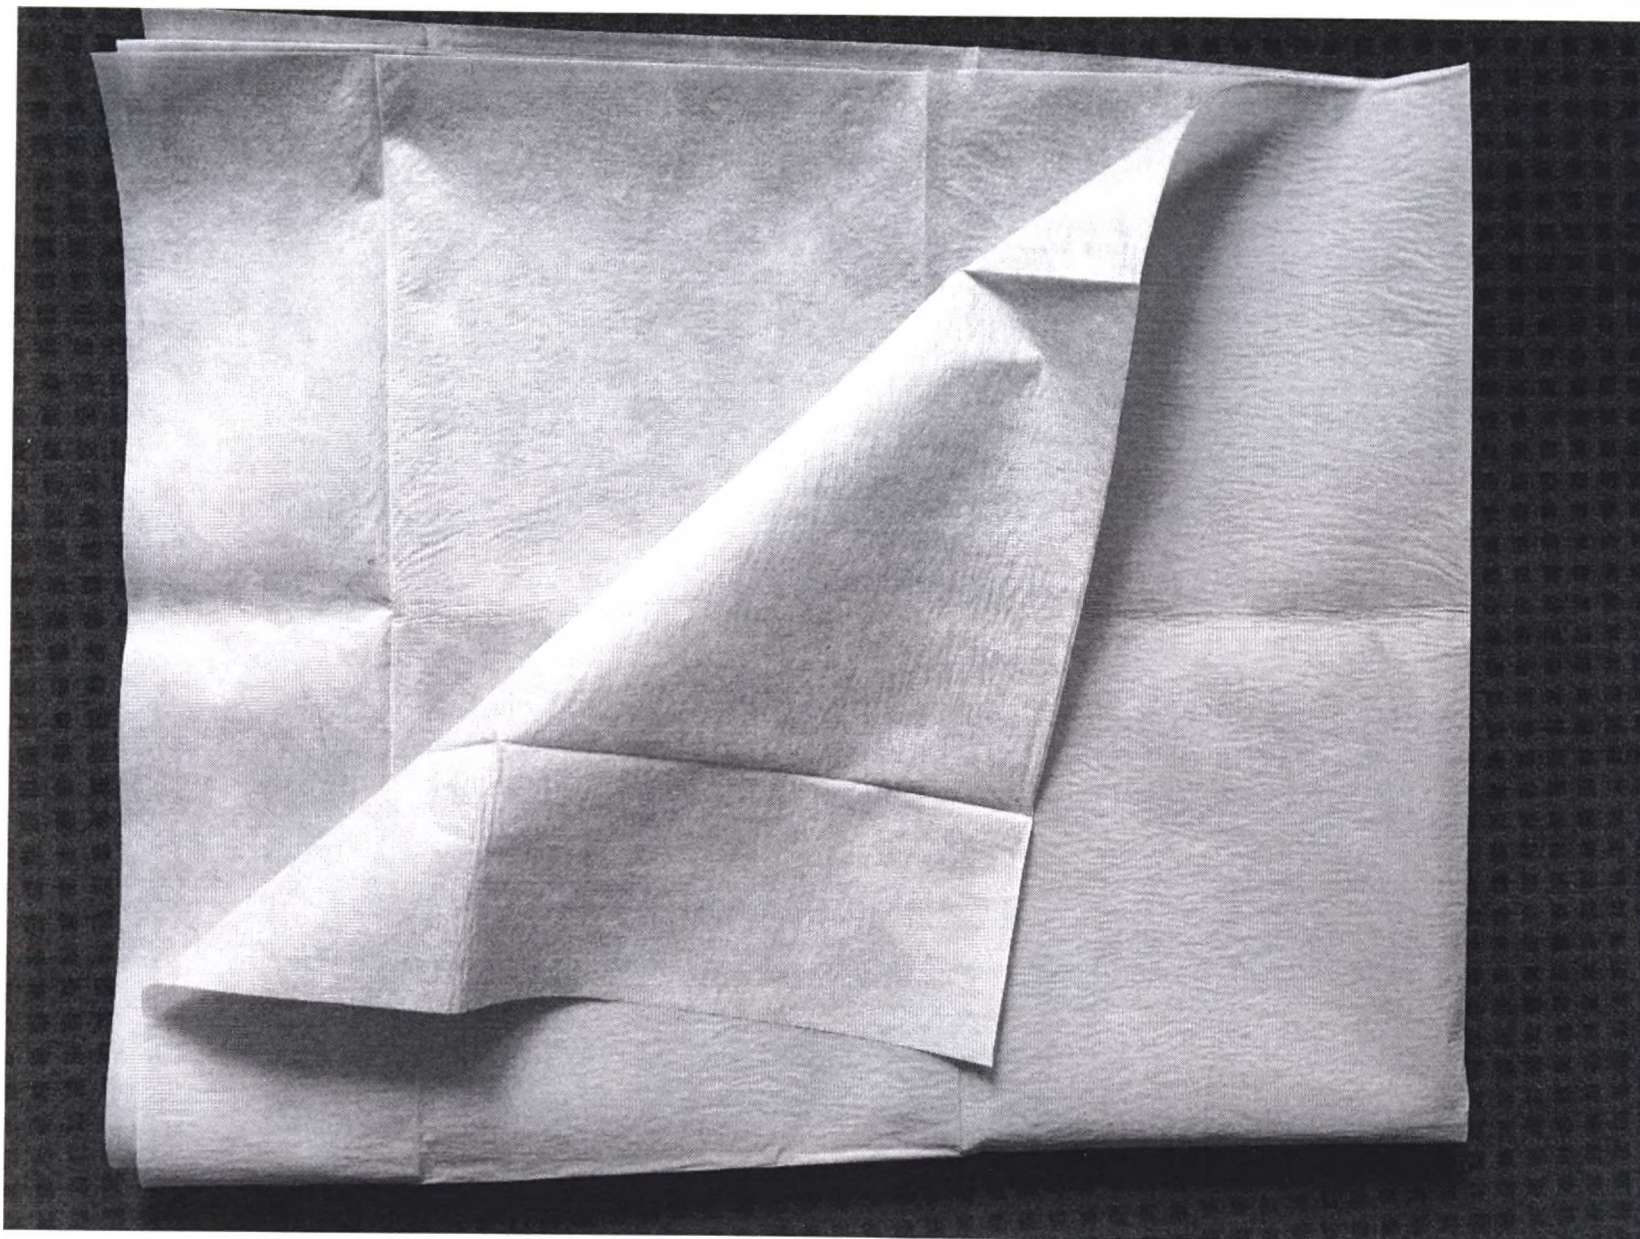


3. Общий вид Набора для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильного под товарным знаком matorat по ту 32.50.50-042-11736425-2017 в потребительской упаковке (бумажно-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

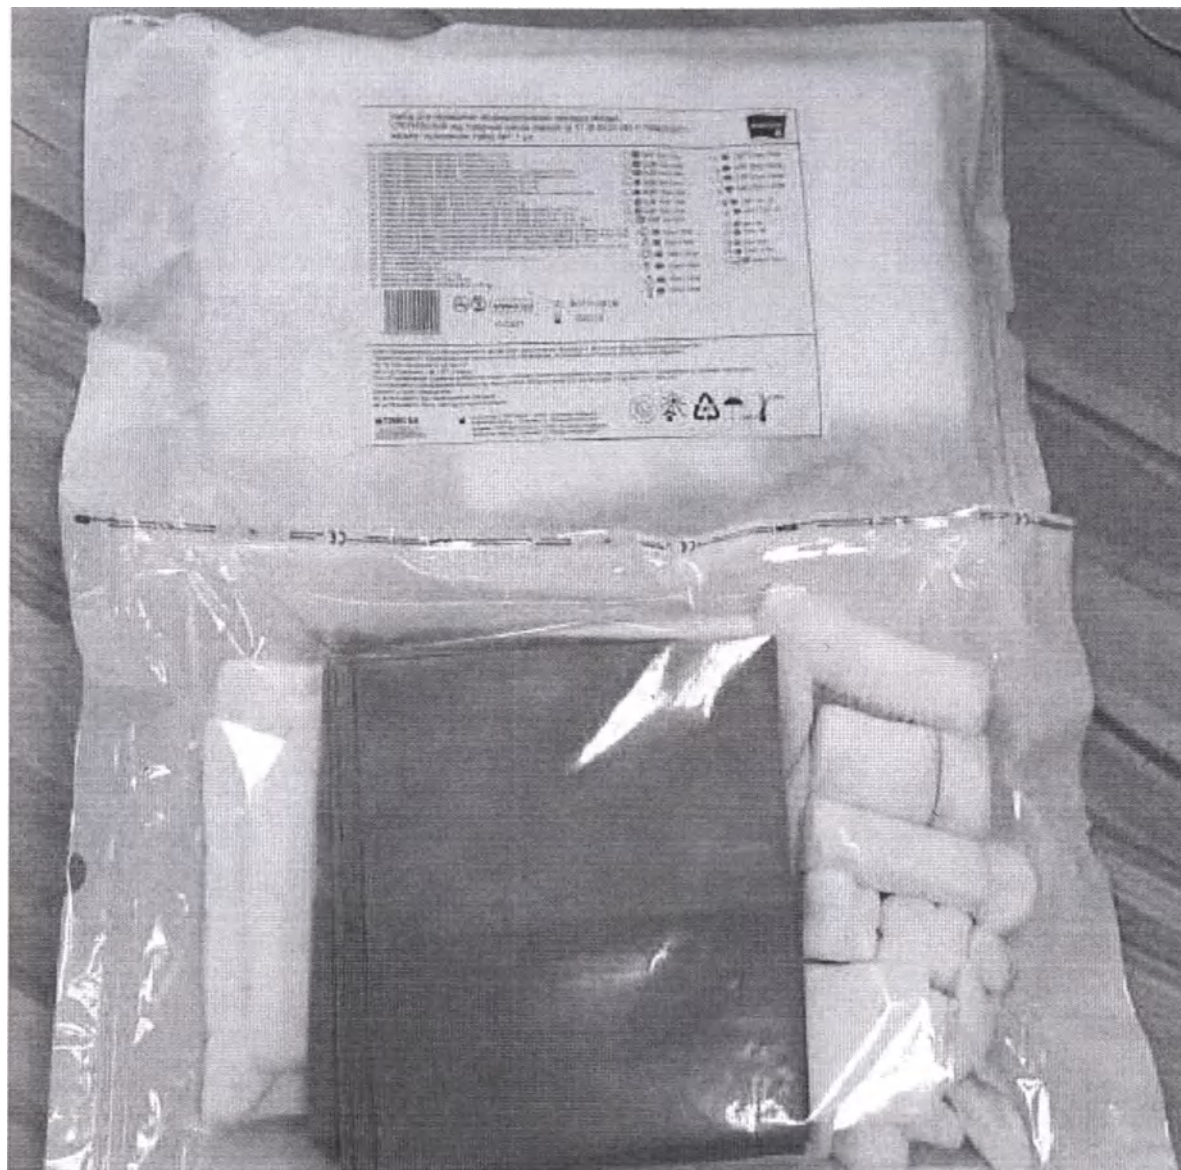

4. Общий вид Набора для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-042-11736425-2017 в потребительской упаковке (блистерная упаковка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

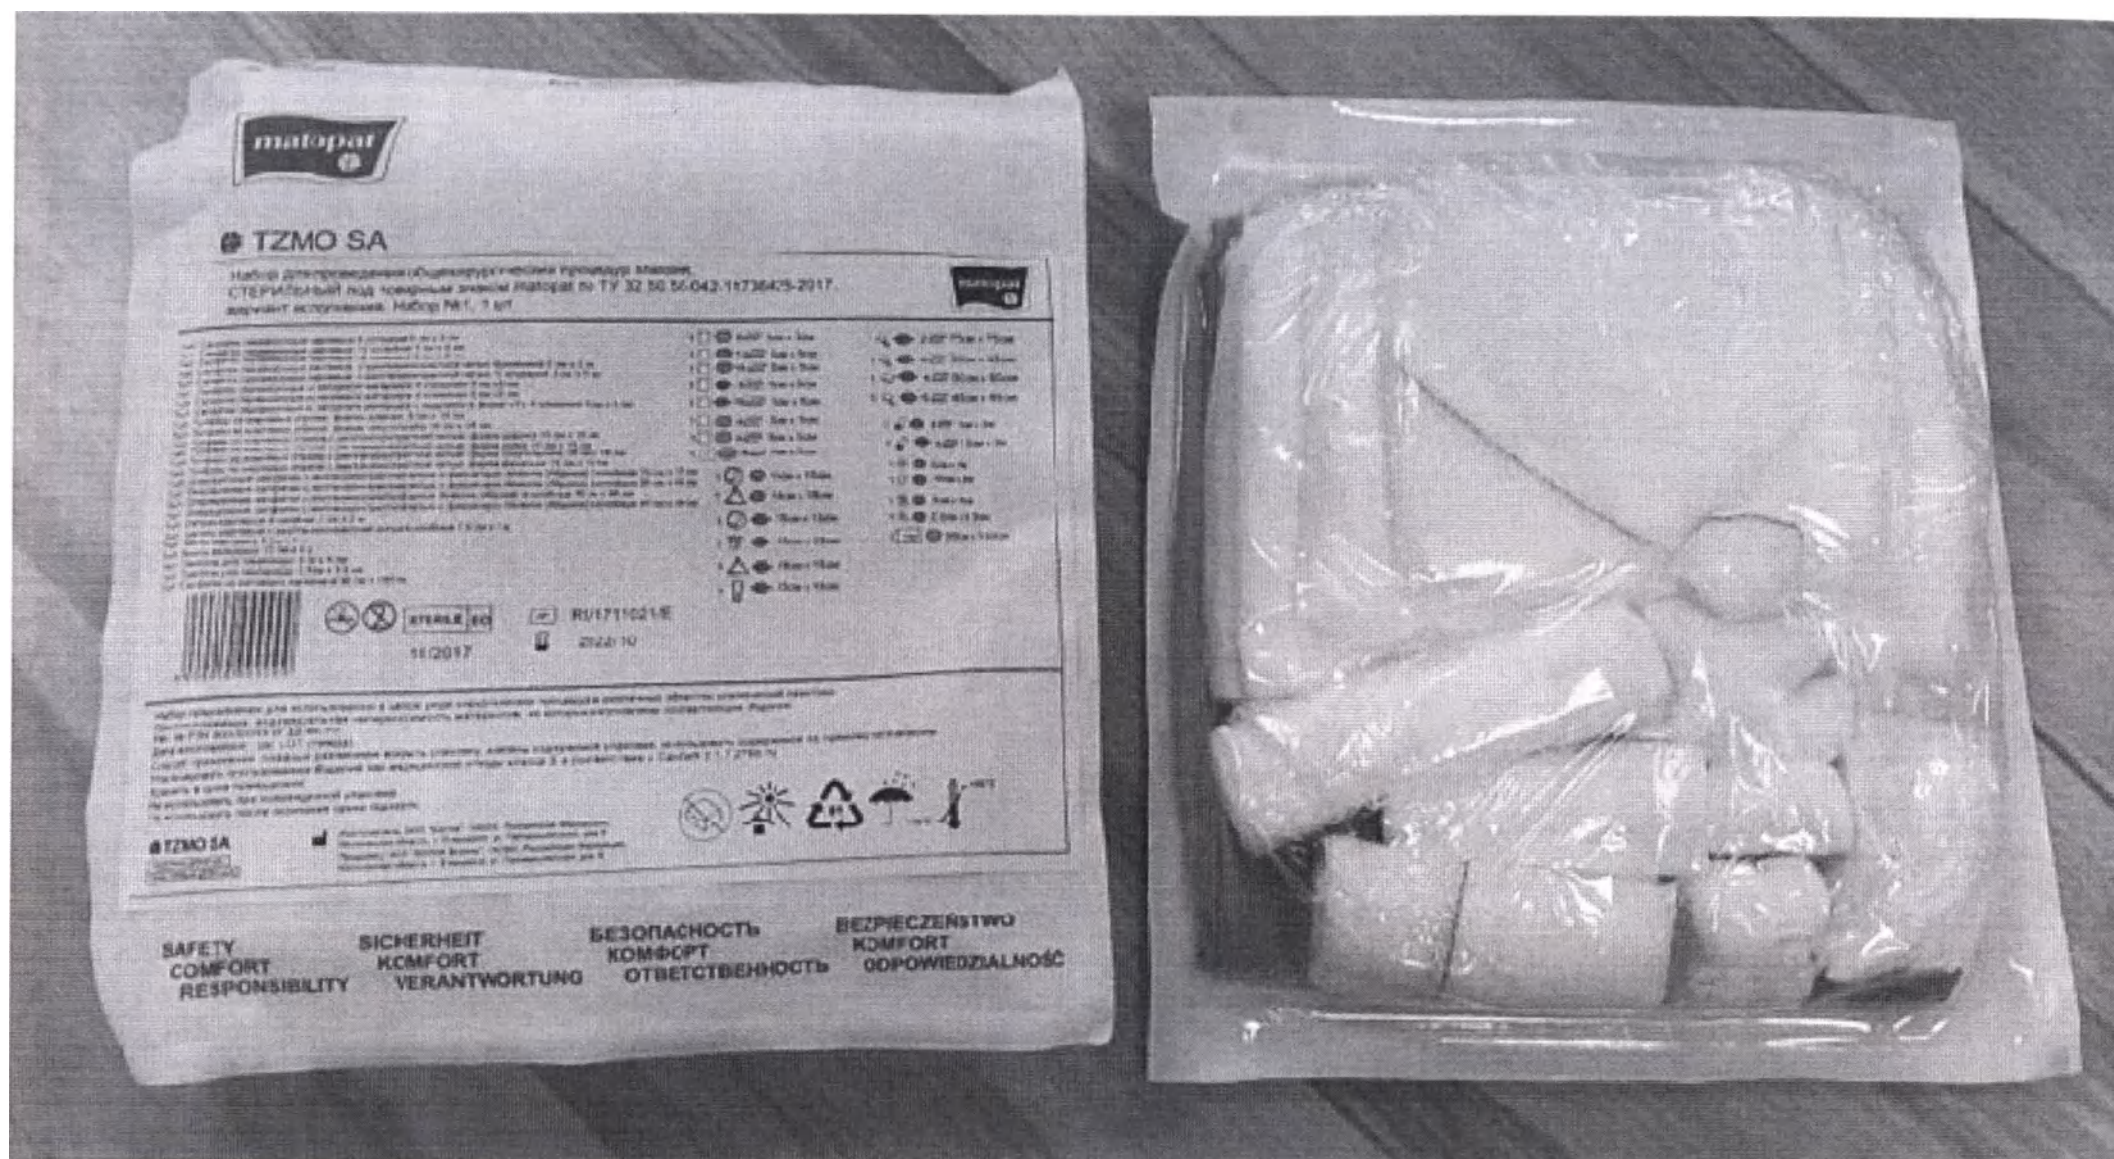

5. Общий вид Набора для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-042-11736425-2017 в транспортной упаковке, производства ООО «Белла», Россия.

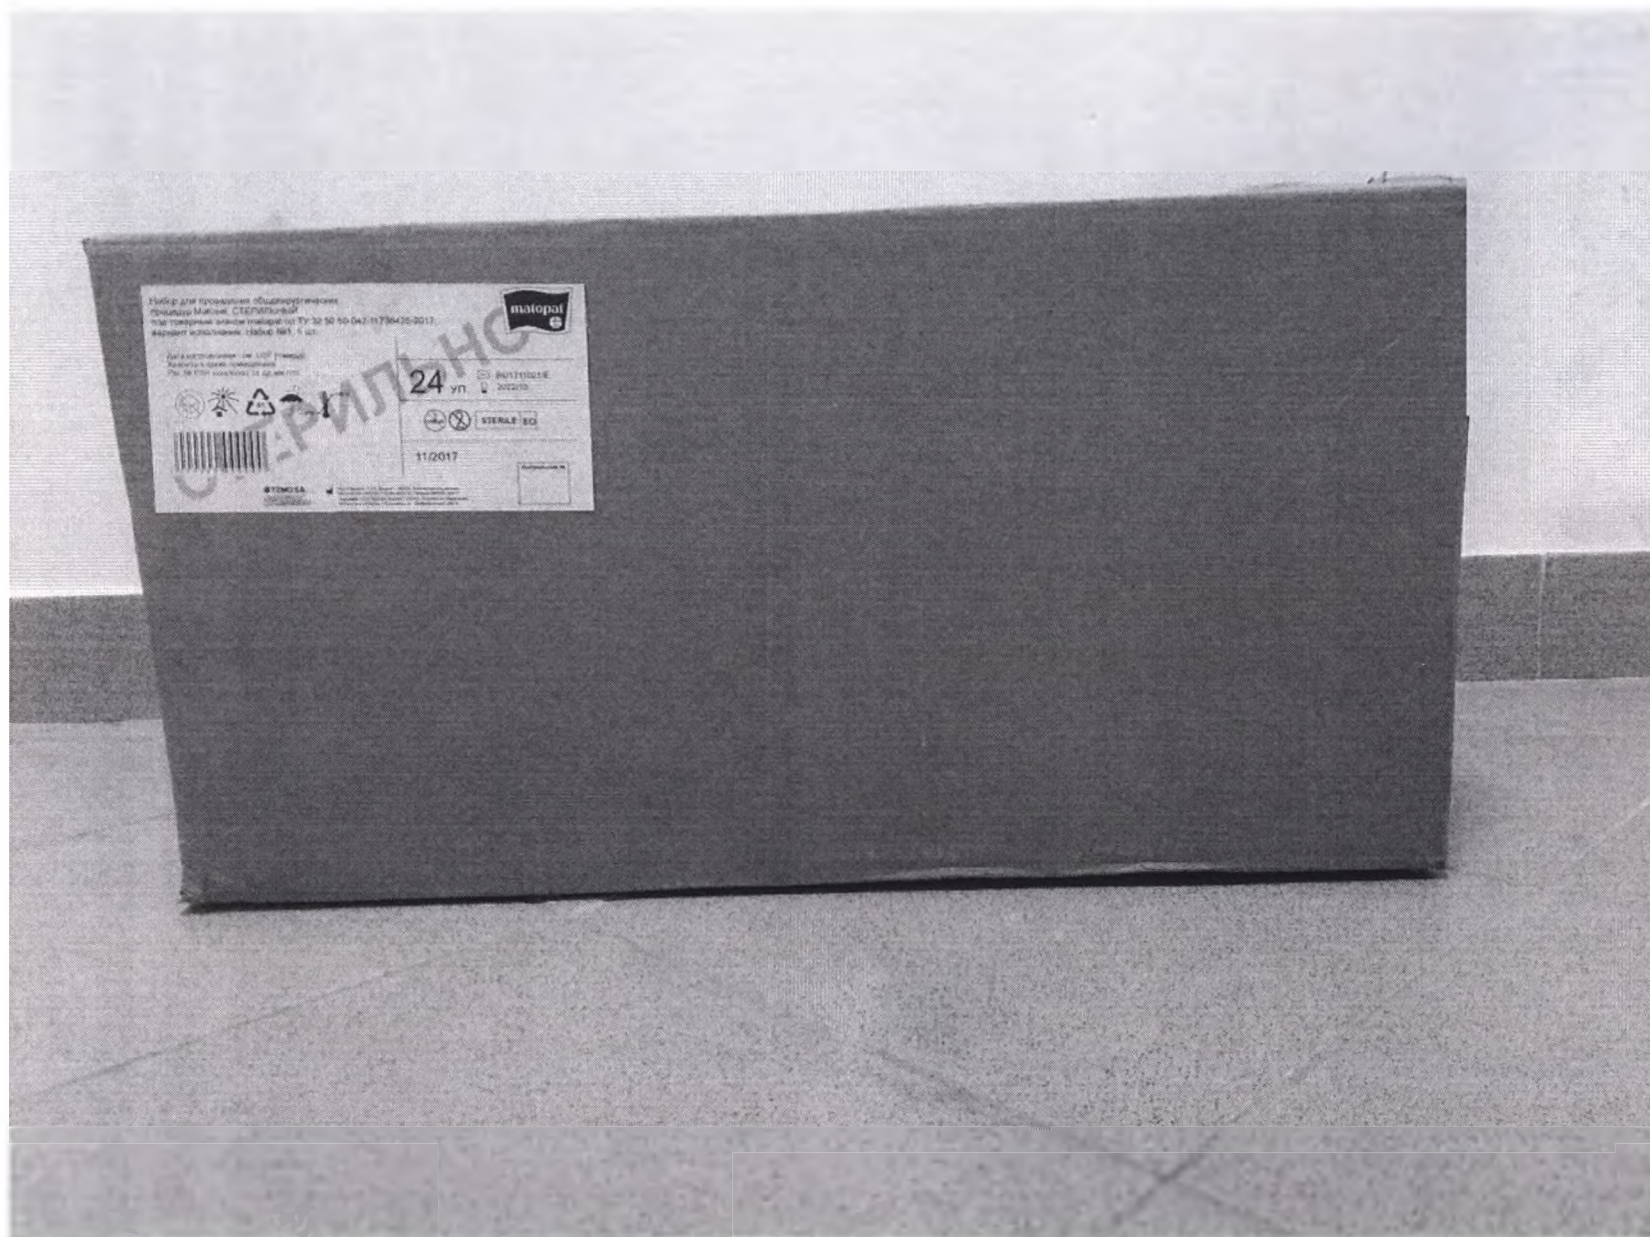



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(подпись) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Белла»

М.К. Ковальчик

«22» июня 2018 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

**Набор для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильный
под товарным знаком matopat**

- товарный знак изготовителя



- наименование Изделия: _____;
- вариант исполнения Изделия;
- ТУ 32.50.50-042-11736425-2017;
- состав Изделия: _____;
- графический символ «стерилизация оксидом этилена»;
- символ «Не стерилизовать повторно»;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT): _____;
- дата изготовления;
- срок годности;
- дата стерилизации: месяц/год;
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +10°C до +35°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код Изделия (при наличии);

- артикул Изделия (при наличии);
- способ применения: плавным движением вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки, использовать содержимое по прямому назначению;
- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделие;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- указания по утилизации: «Использованное медицинское Изделие утилизировать как медицинские отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10»;
- «Изготовитель: ООО «Белла», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».



Всего прочито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
_____ М.К. Ковальчик