


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»


Гвоздев А.Р.
17 августа 2018 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения:
глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH,
билирубина,
уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче
Уриполиан-ХN»**

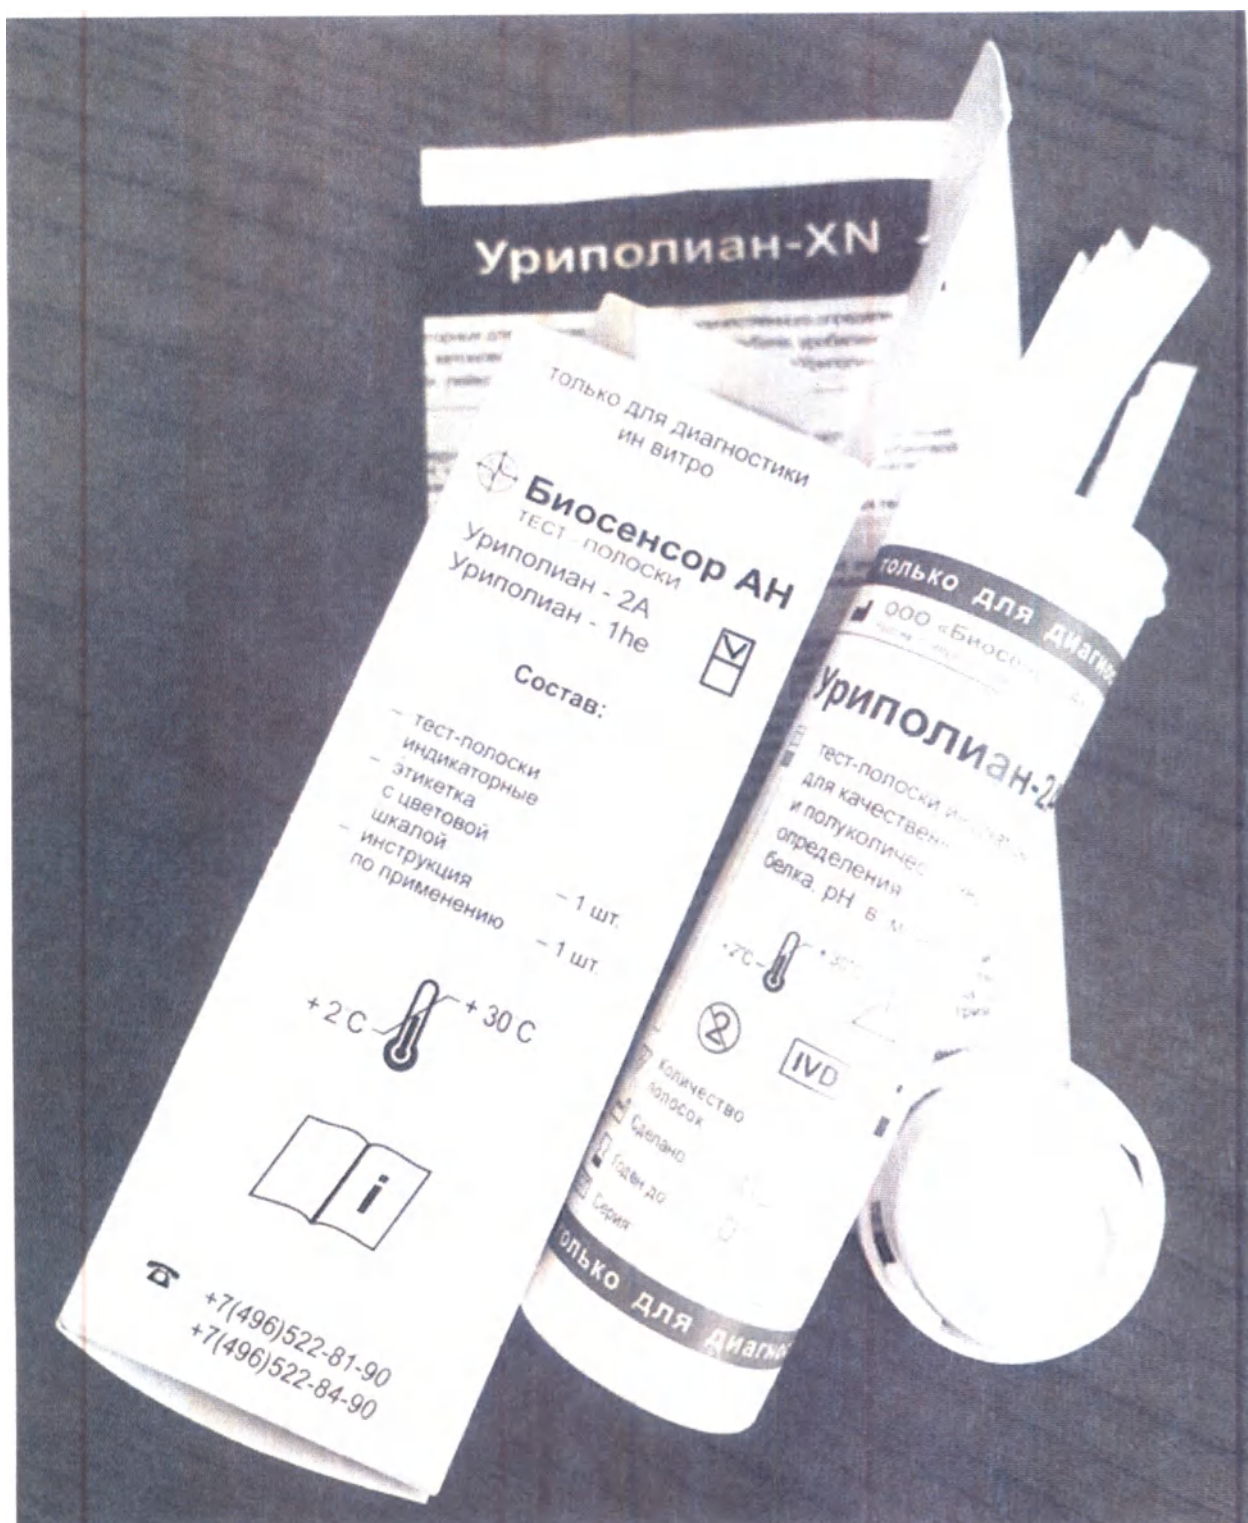

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

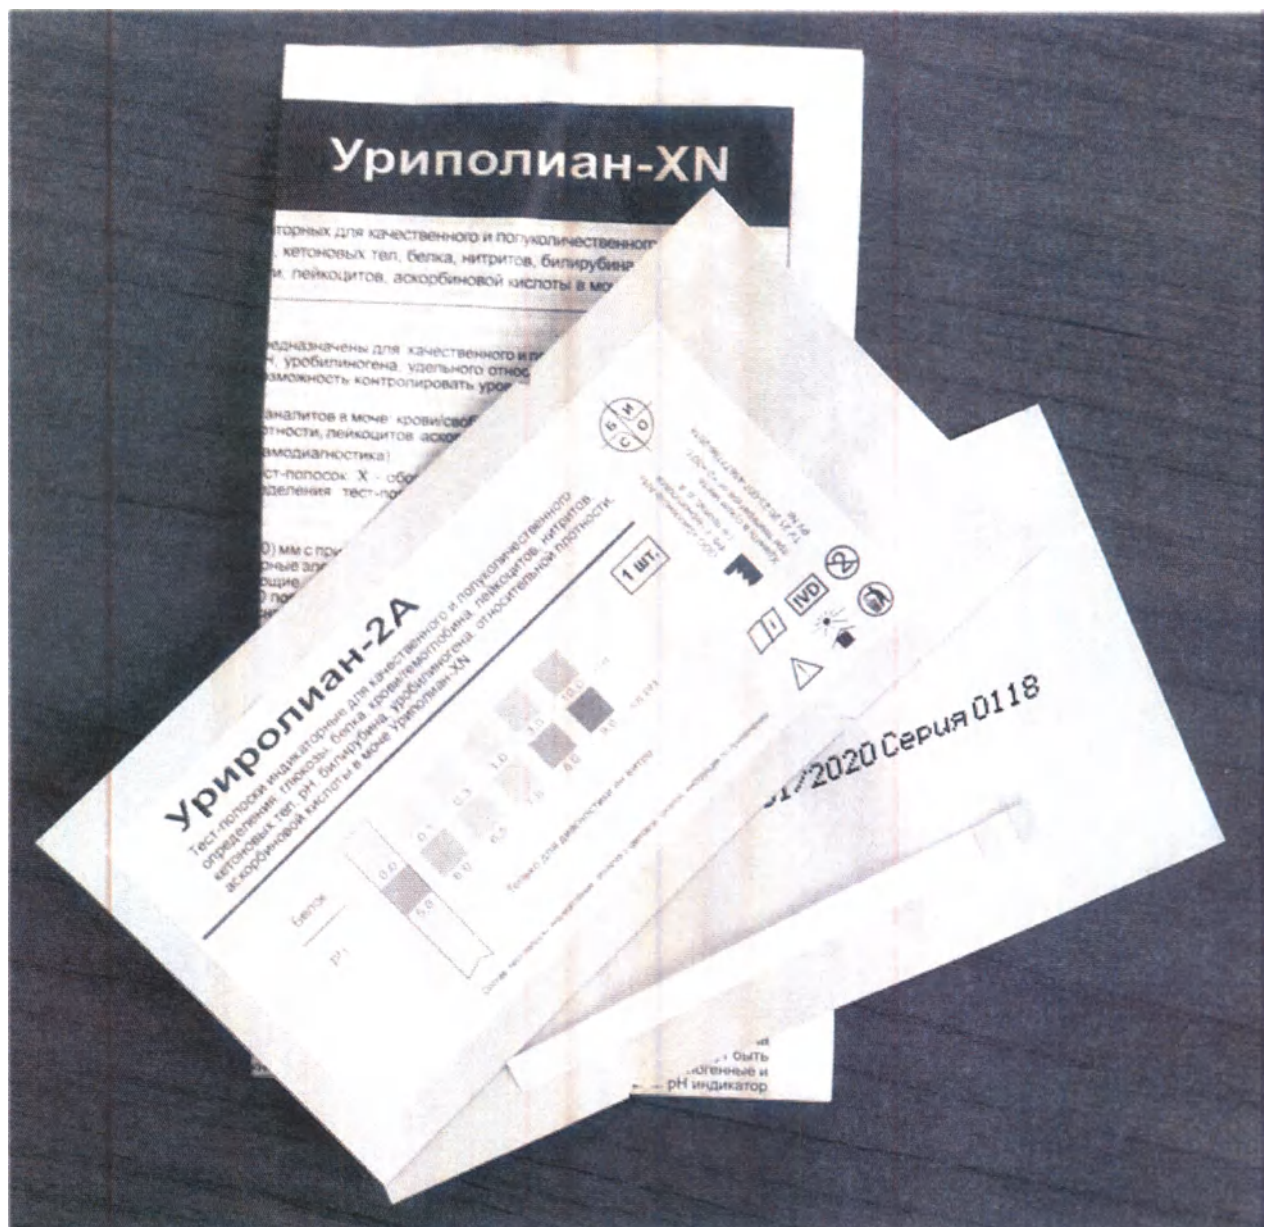

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

Уриполиан-2А

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН

Белок

pH

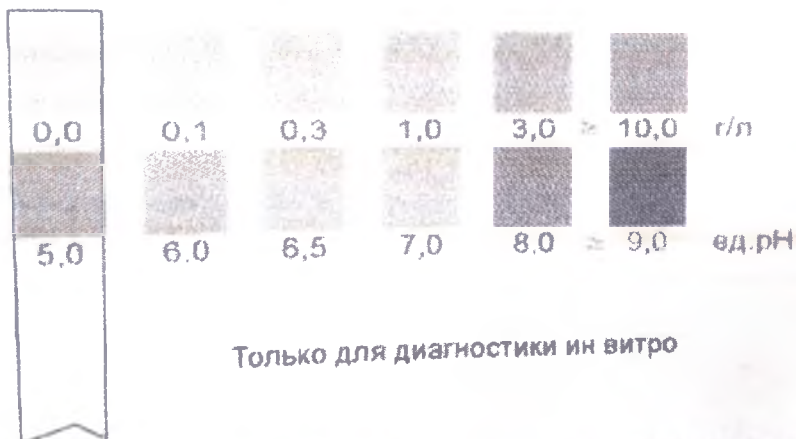

1 шт.

Только для диагностики ин витро

Состав: тест-полоски индикаторные, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению



ООО «Биосенсор АН»
РФ г. Черноголовка
1-й проезд д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30 °C

ТУ 21 20 23-007-4587786-2018
РУ №




Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




2020 Серия 0118

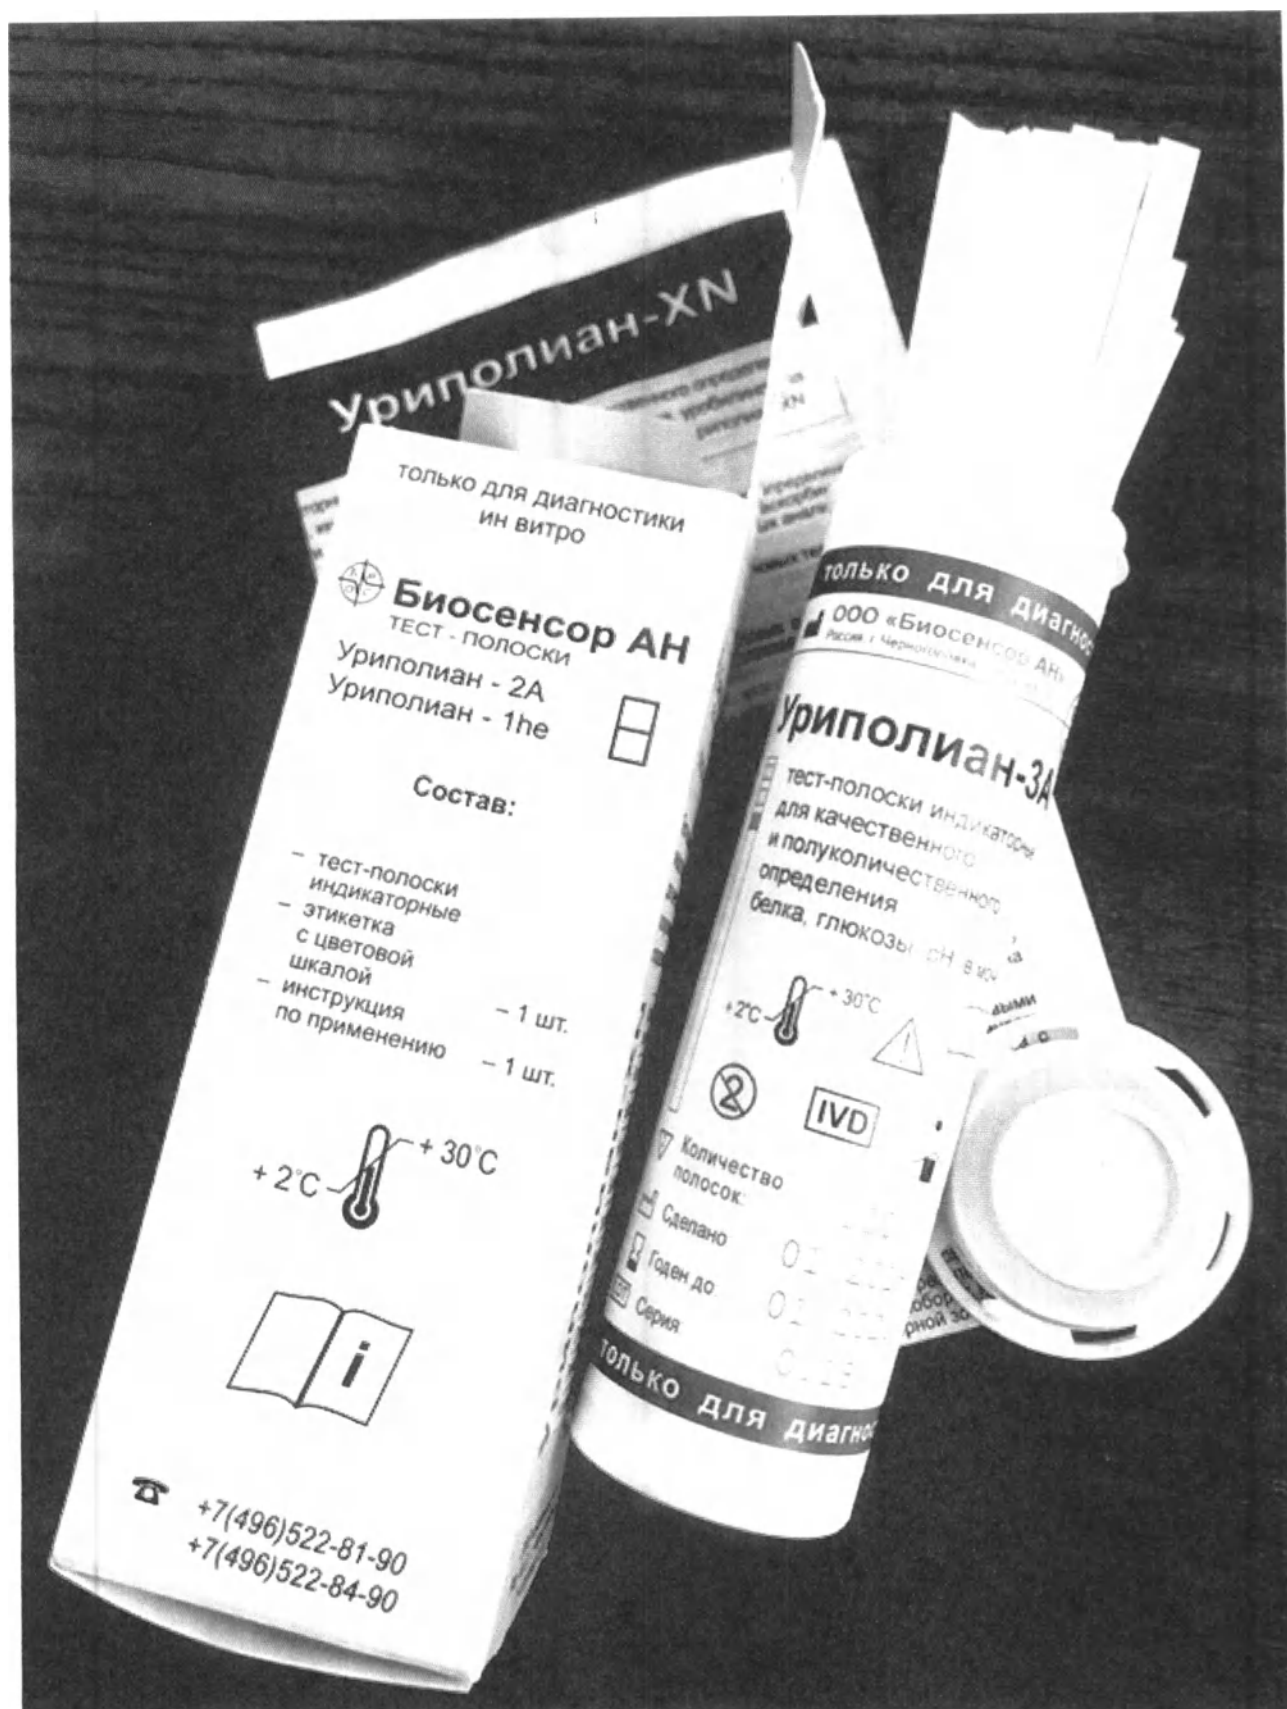

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

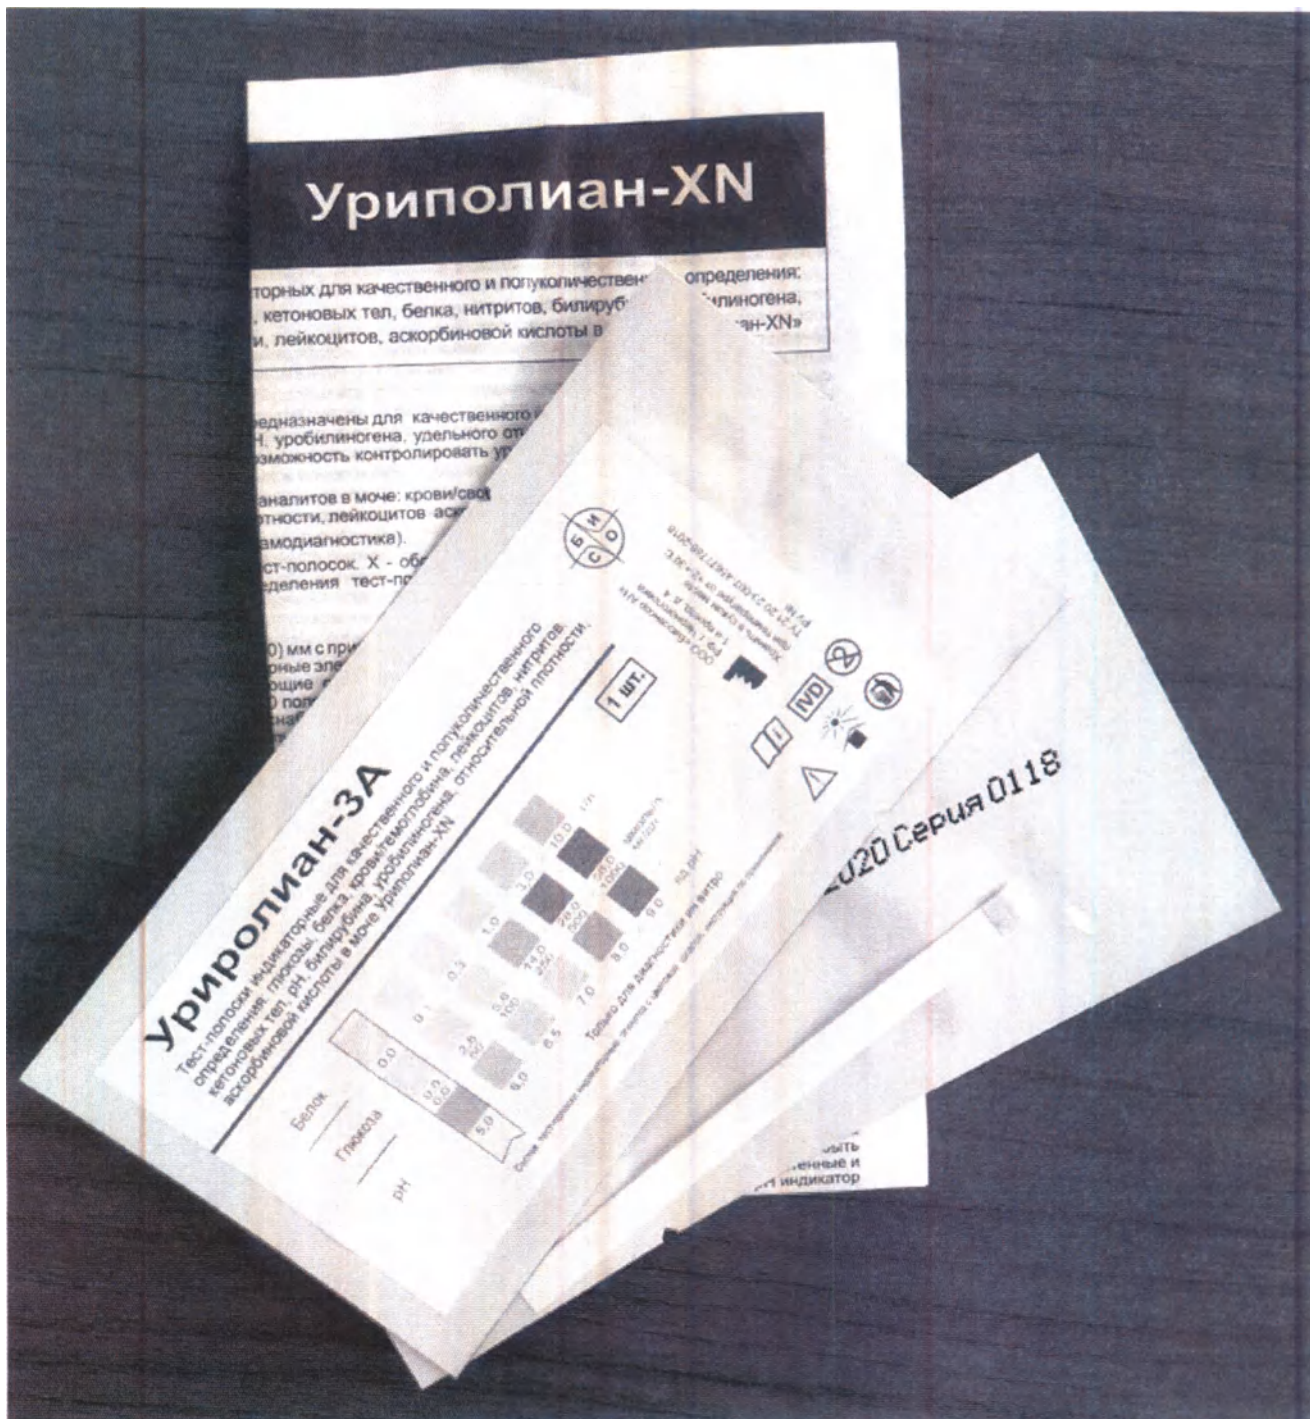

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Уриролиан-3А

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН

Белок	0,0	0,1	0,3	1,0	3,0	10,0	г/л
Глюкоза	0,0	2,8	5,6	14,0	28,0	56,0	ммоль/л
	0,0	50	100	250	500	1000	ммоль/л
pH	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	ед pH

1 шт.

Только для диагностики in vitro

Состав: тест-полоски индикаторные, этикетка с цветовым шаблоном, инструкция по применению



ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30 °C

ТУ 21 20 23-007-4567786-2018
РФ №



А.Р. Гвоздев


(Handwritten signature)

Директор ООО «Биосенсор АН»



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

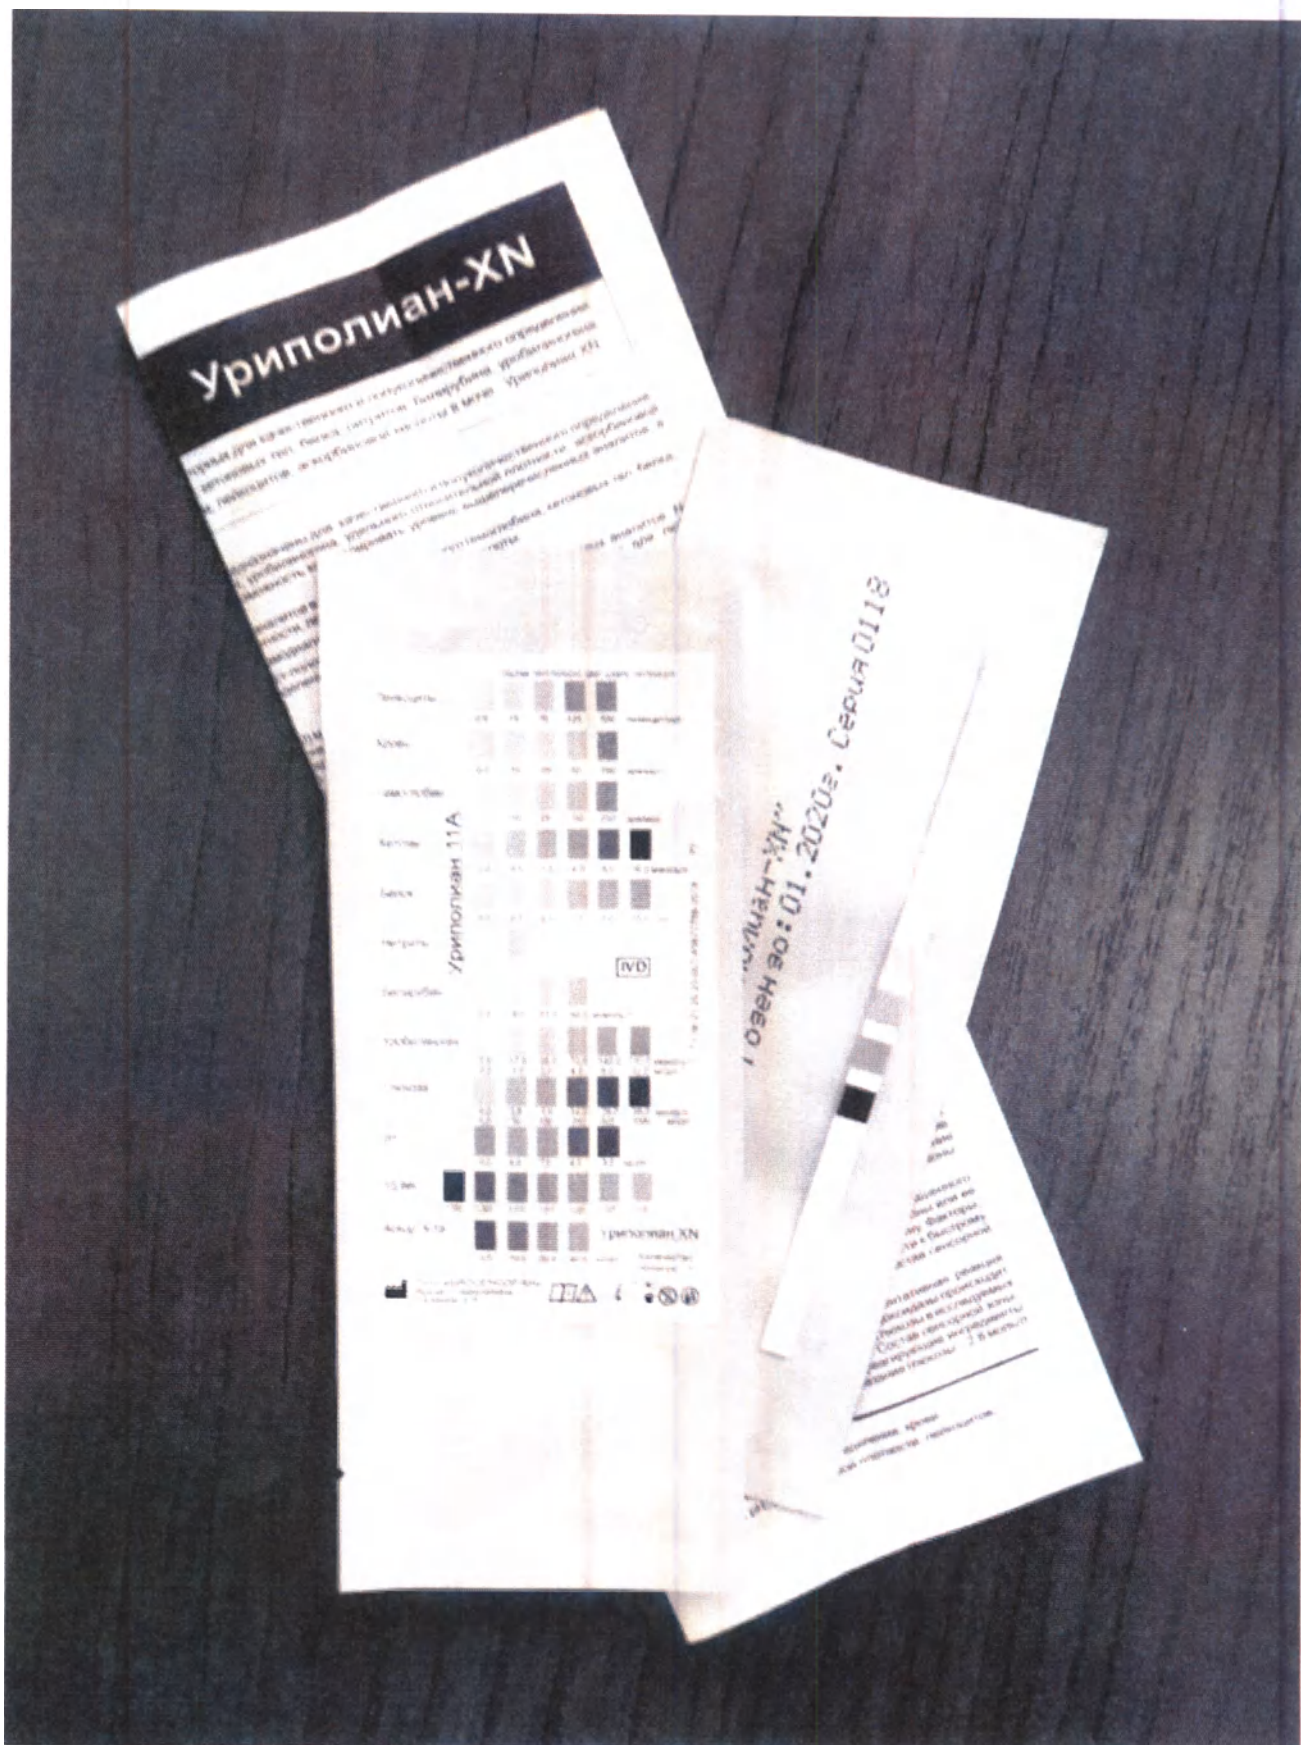

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

качество...
удельного отно...
повышать уровень выш...

гемоглобина, кето...
эритроцитов, N

Лейкоциты

Кровь

Гемоглобин

Кетоны

Белок

Нитриты


Билирубин

Уробилиноген

Глюкоза


Уриполиан 11A

Состав: тест-полоски, цвет. шкала, инструкция

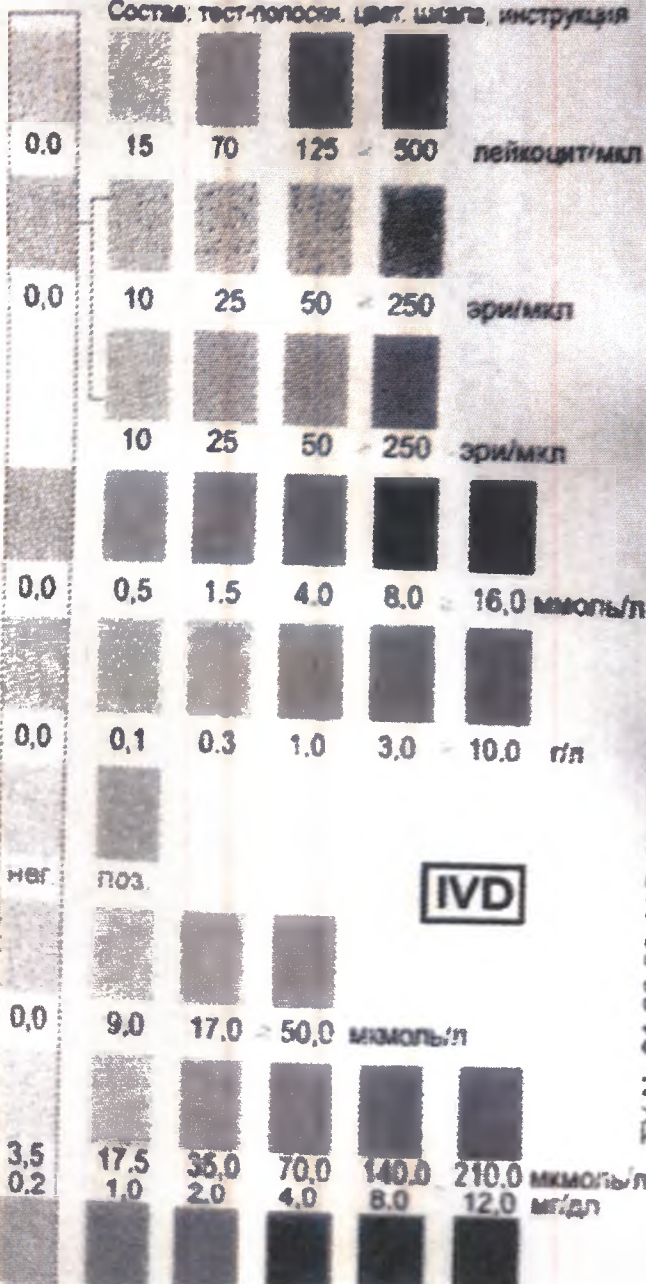

Директор ООО «Биосенсор АН»


А.Р. Гвоздев

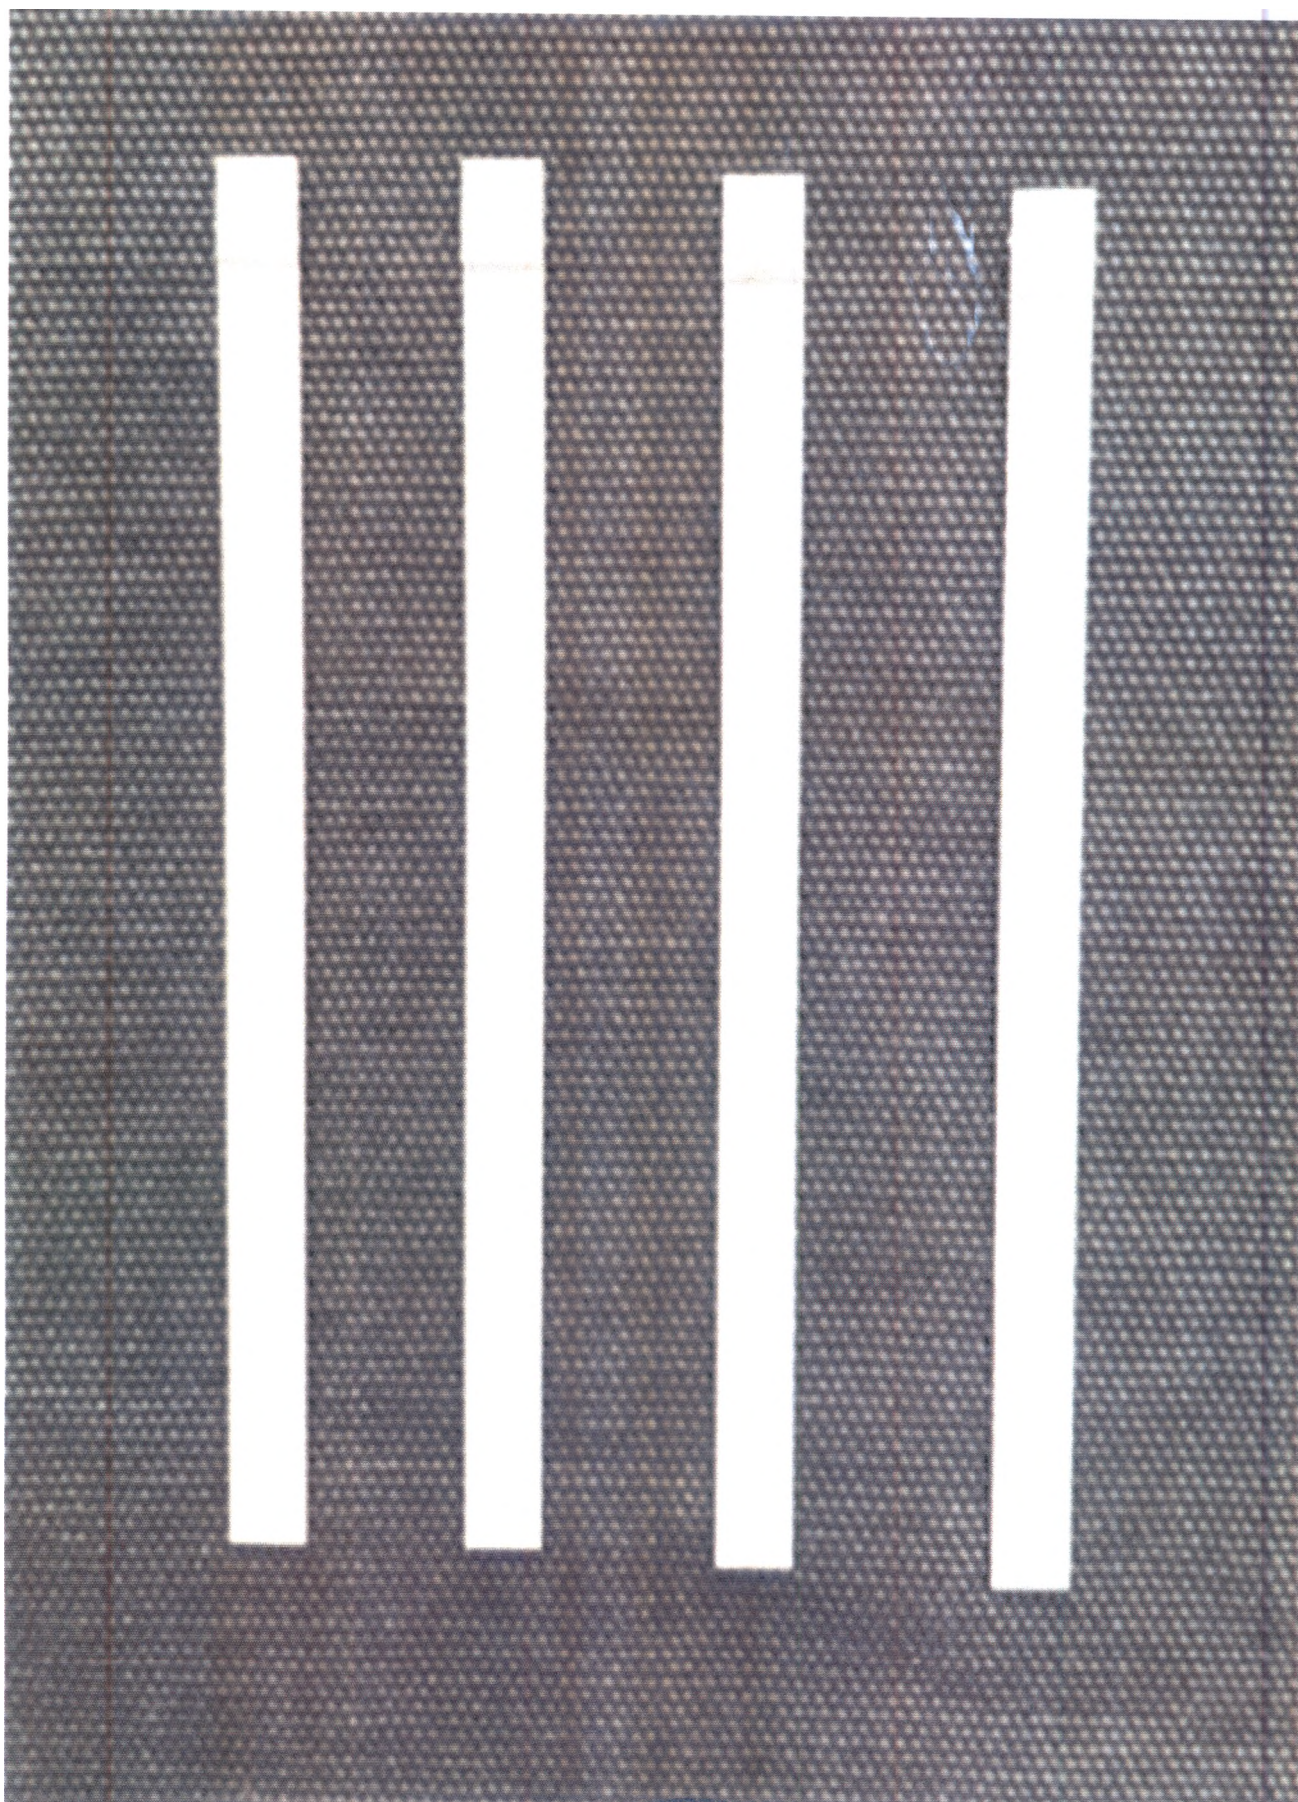

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

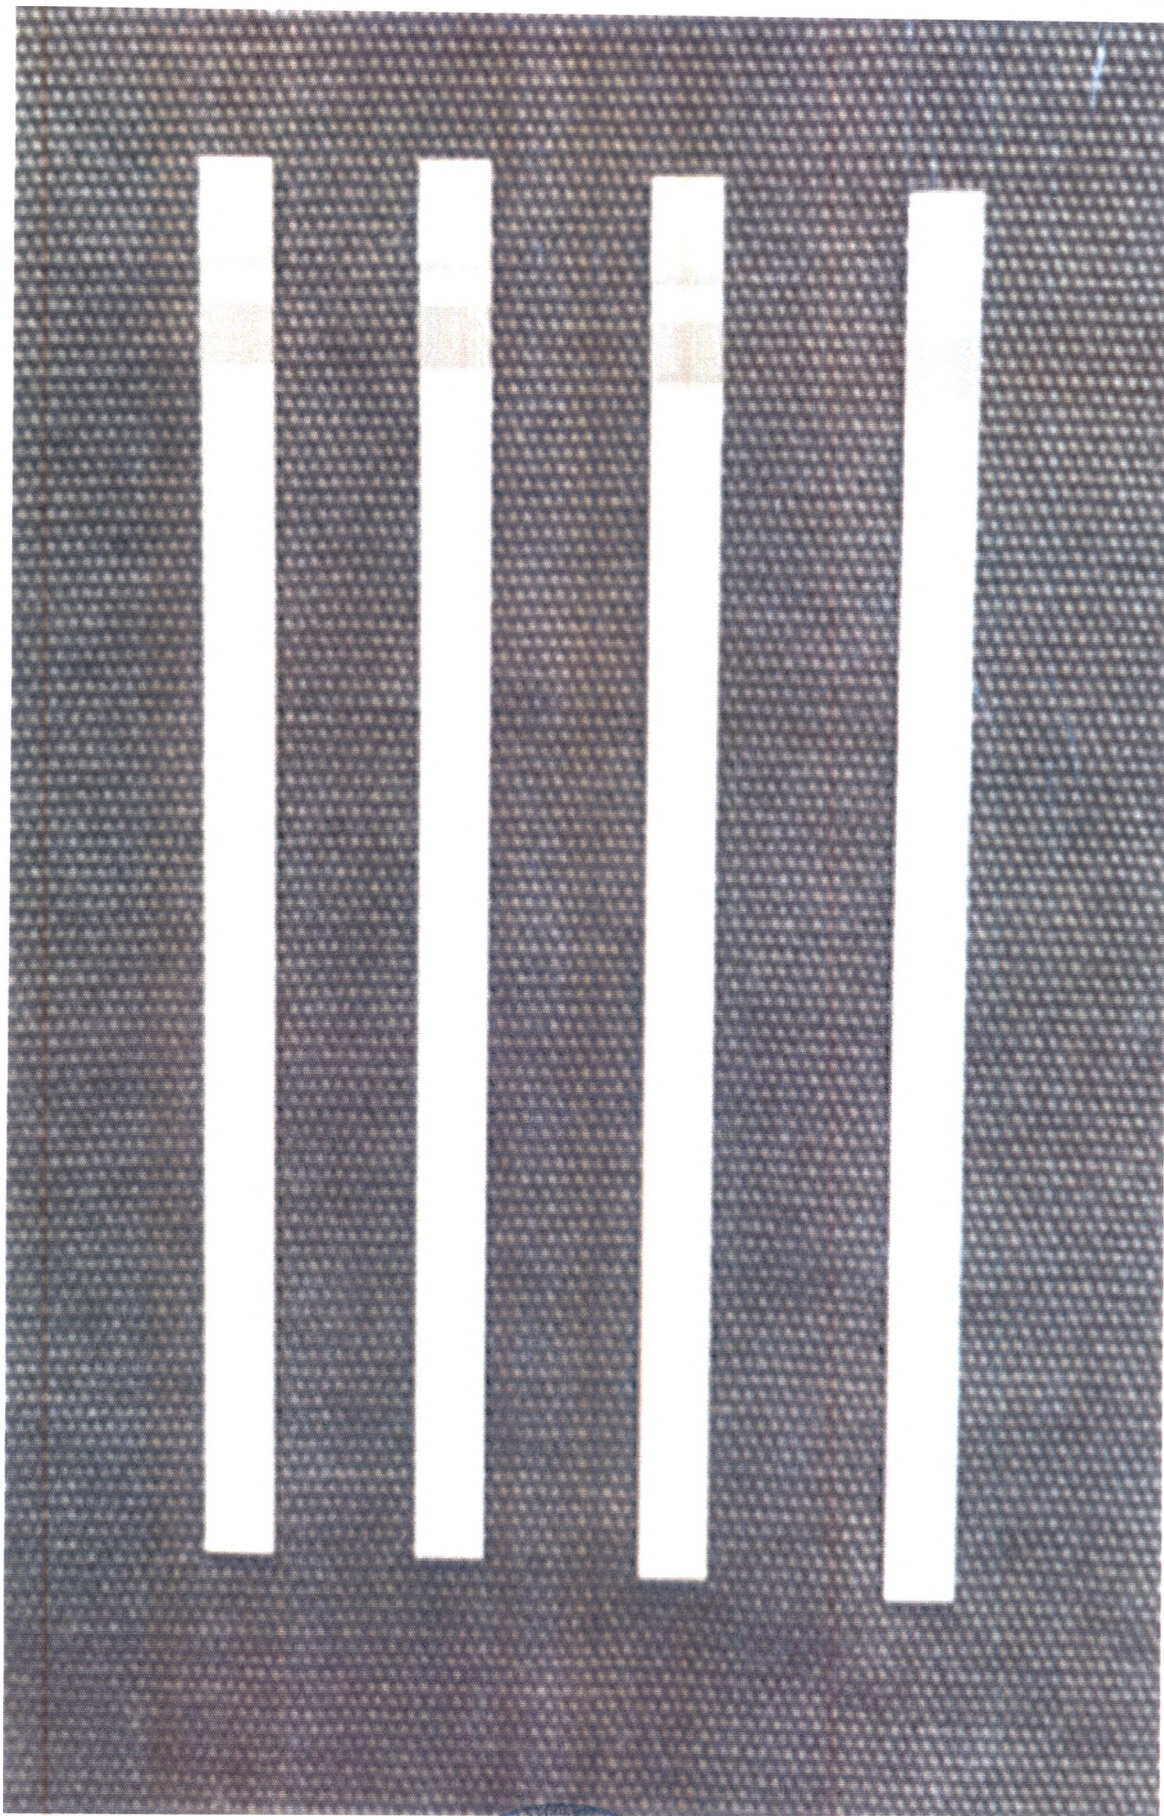

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



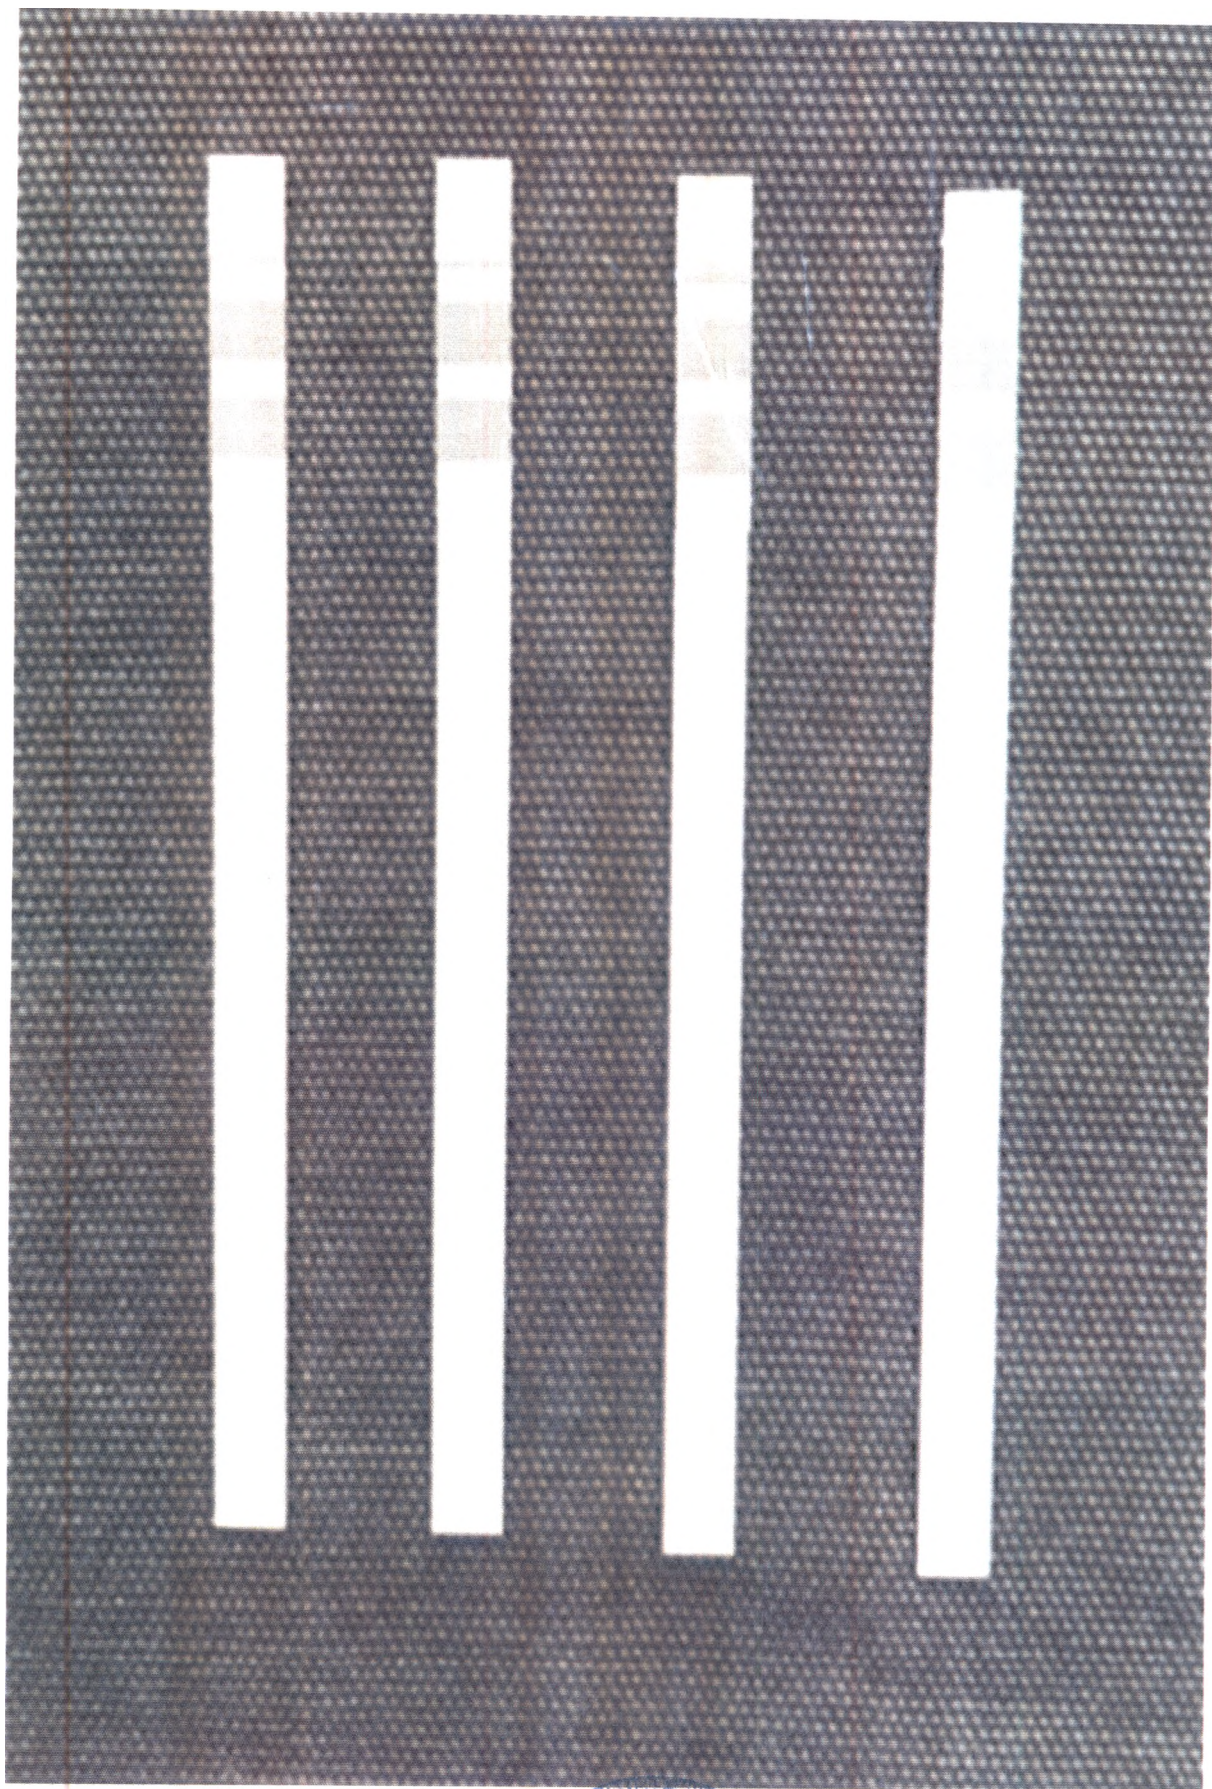


Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев




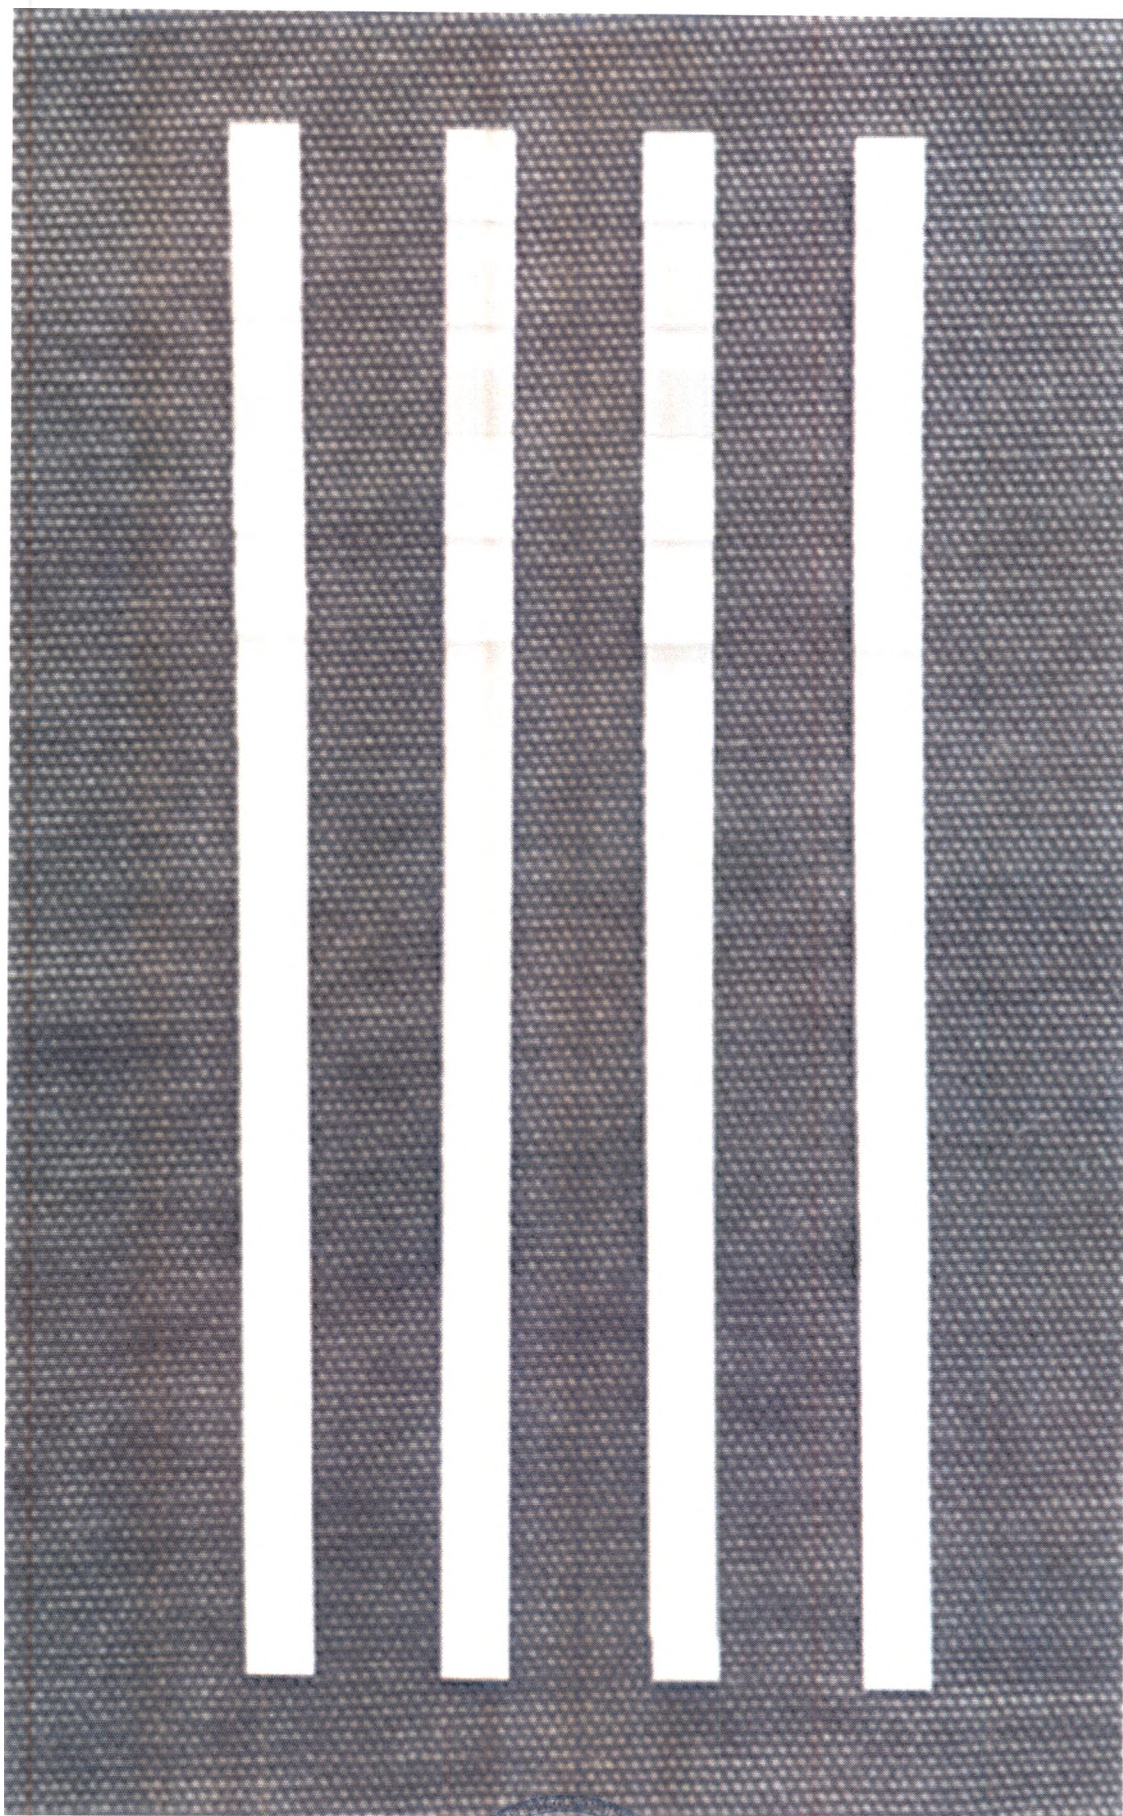

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

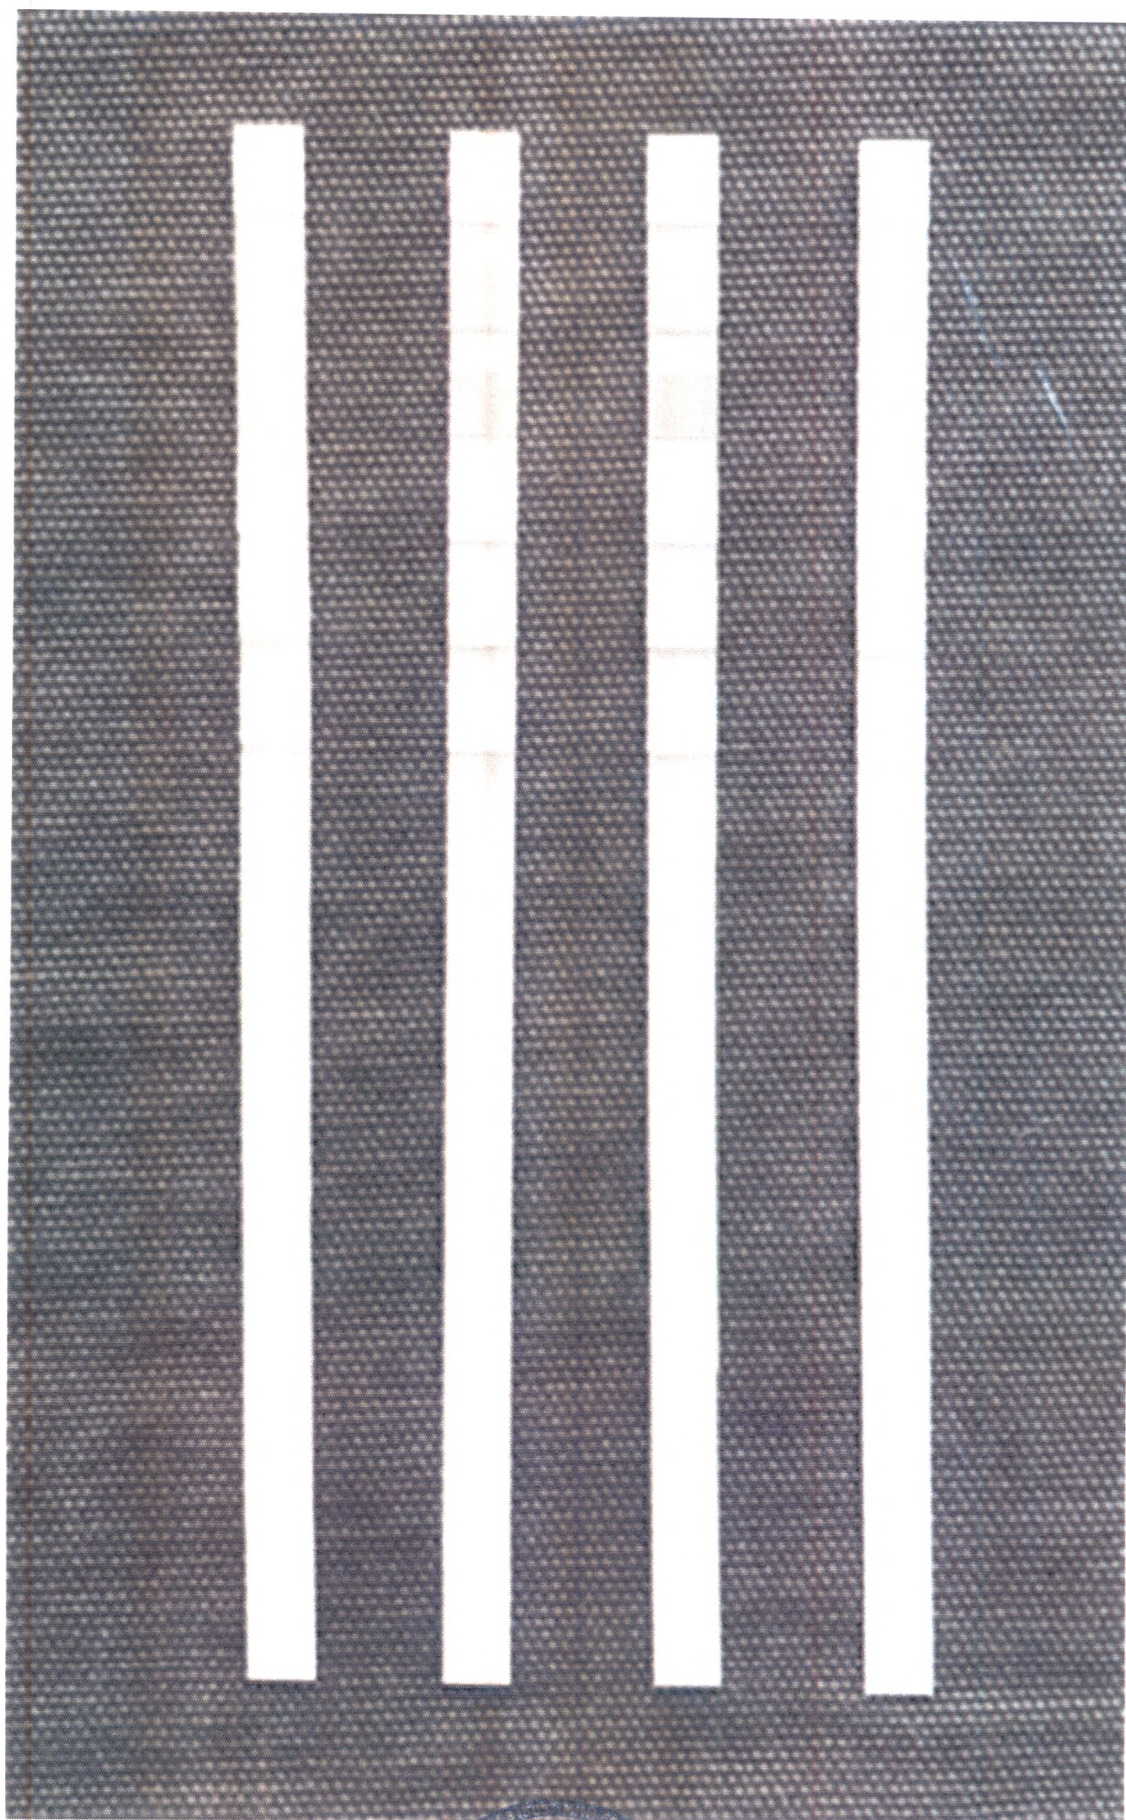

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




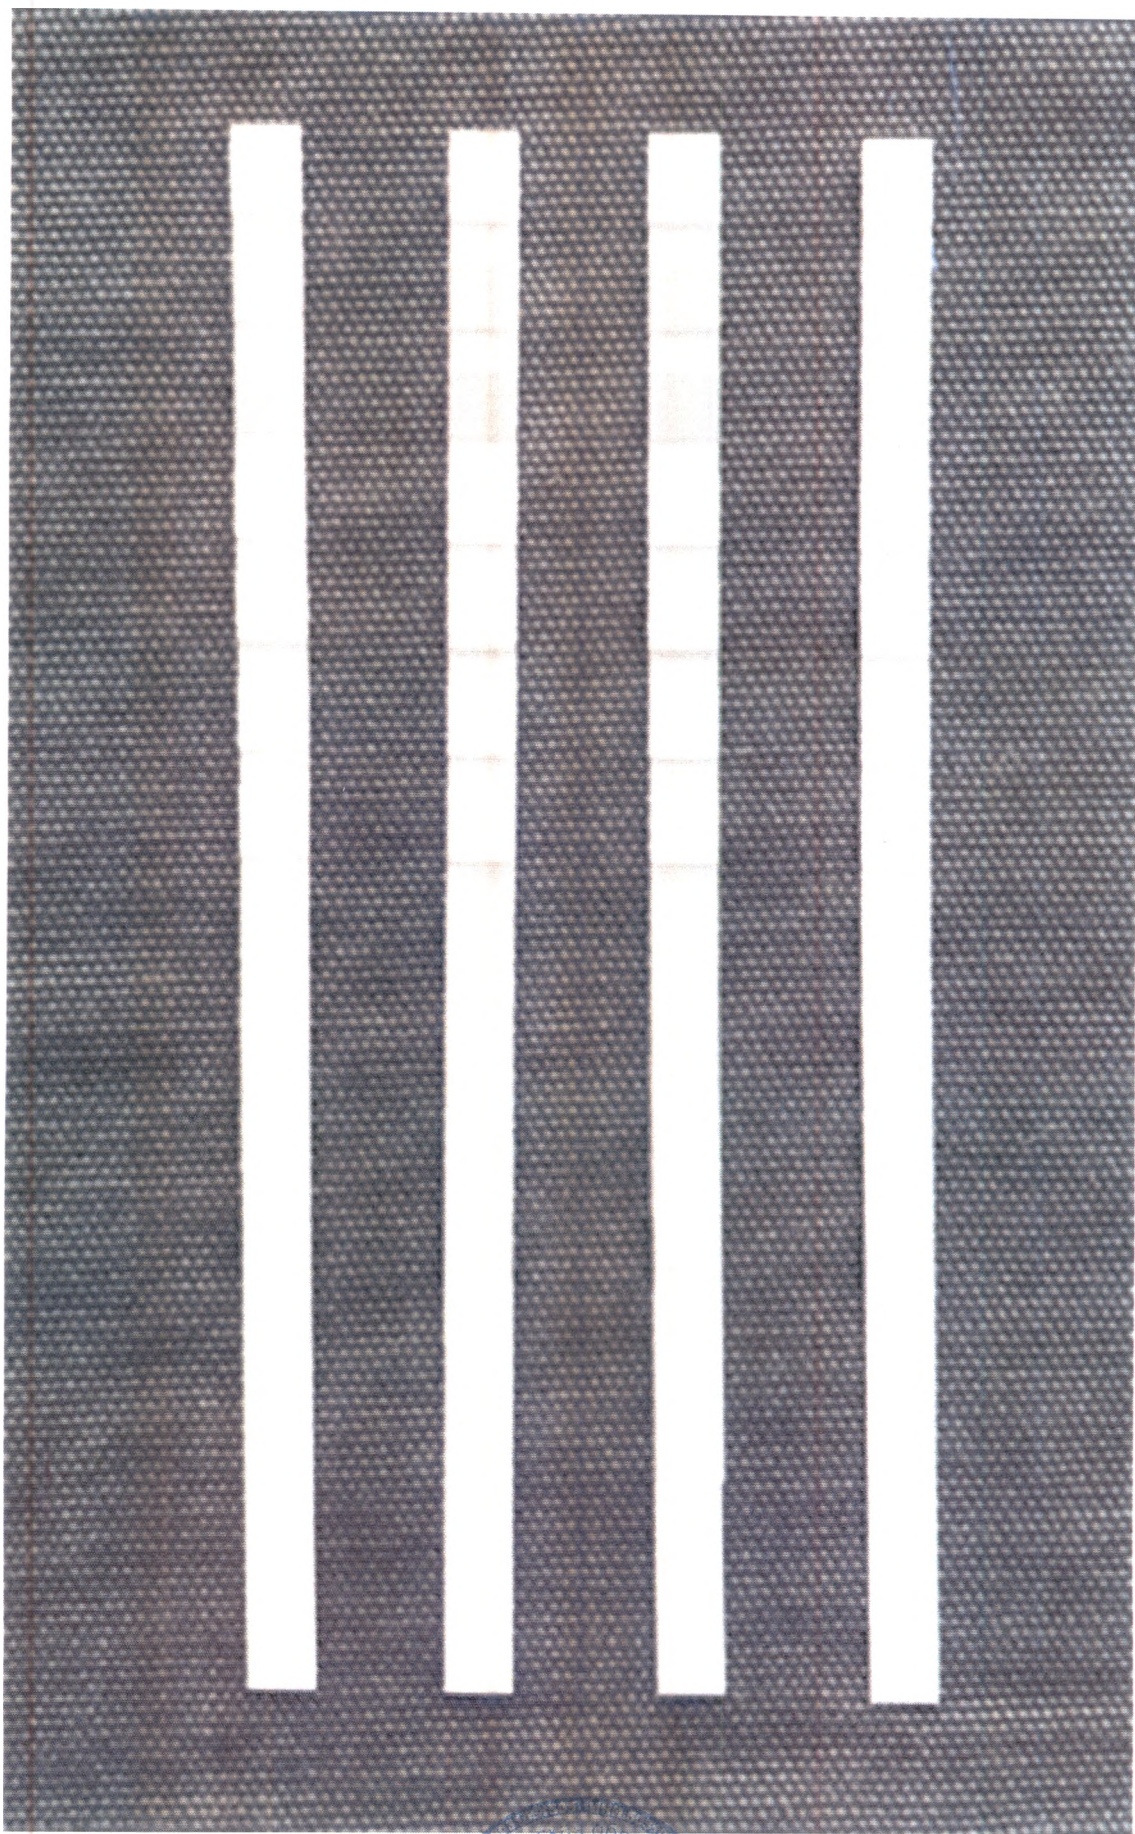

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




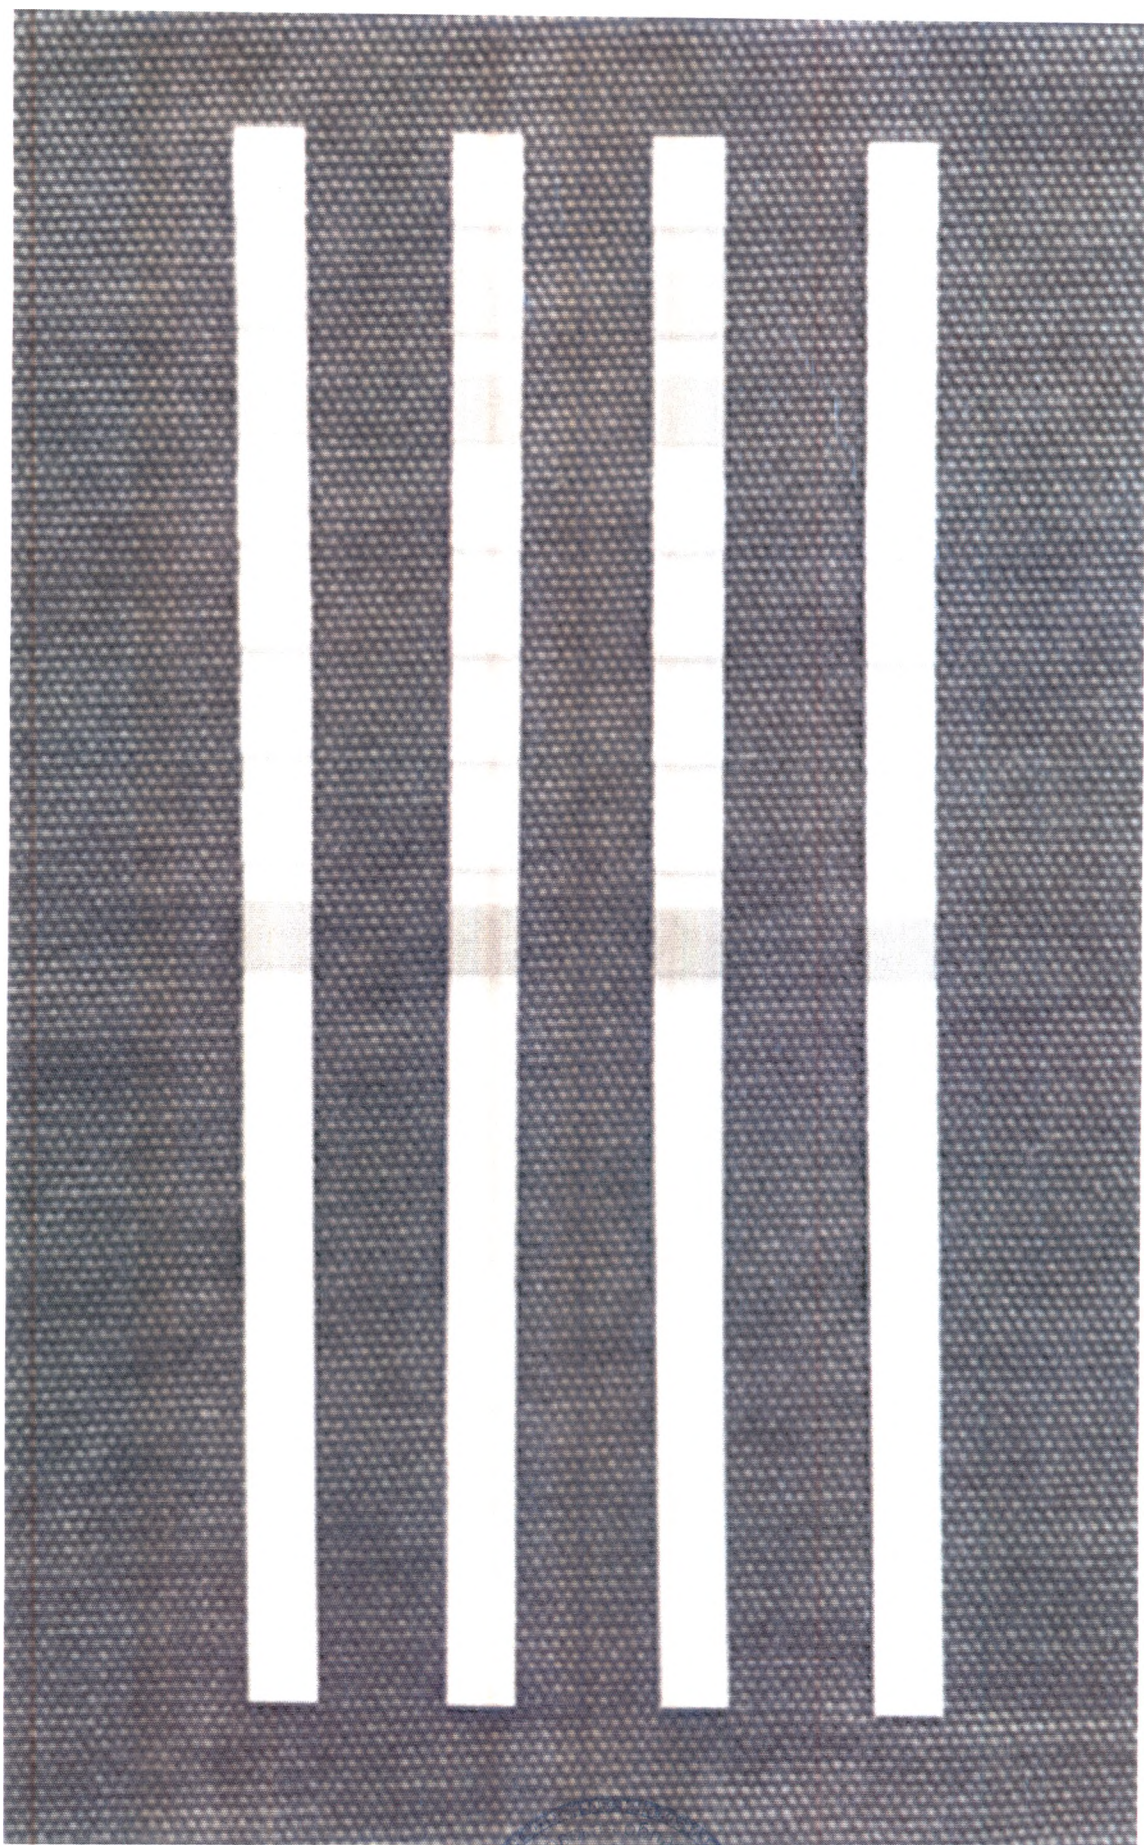

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




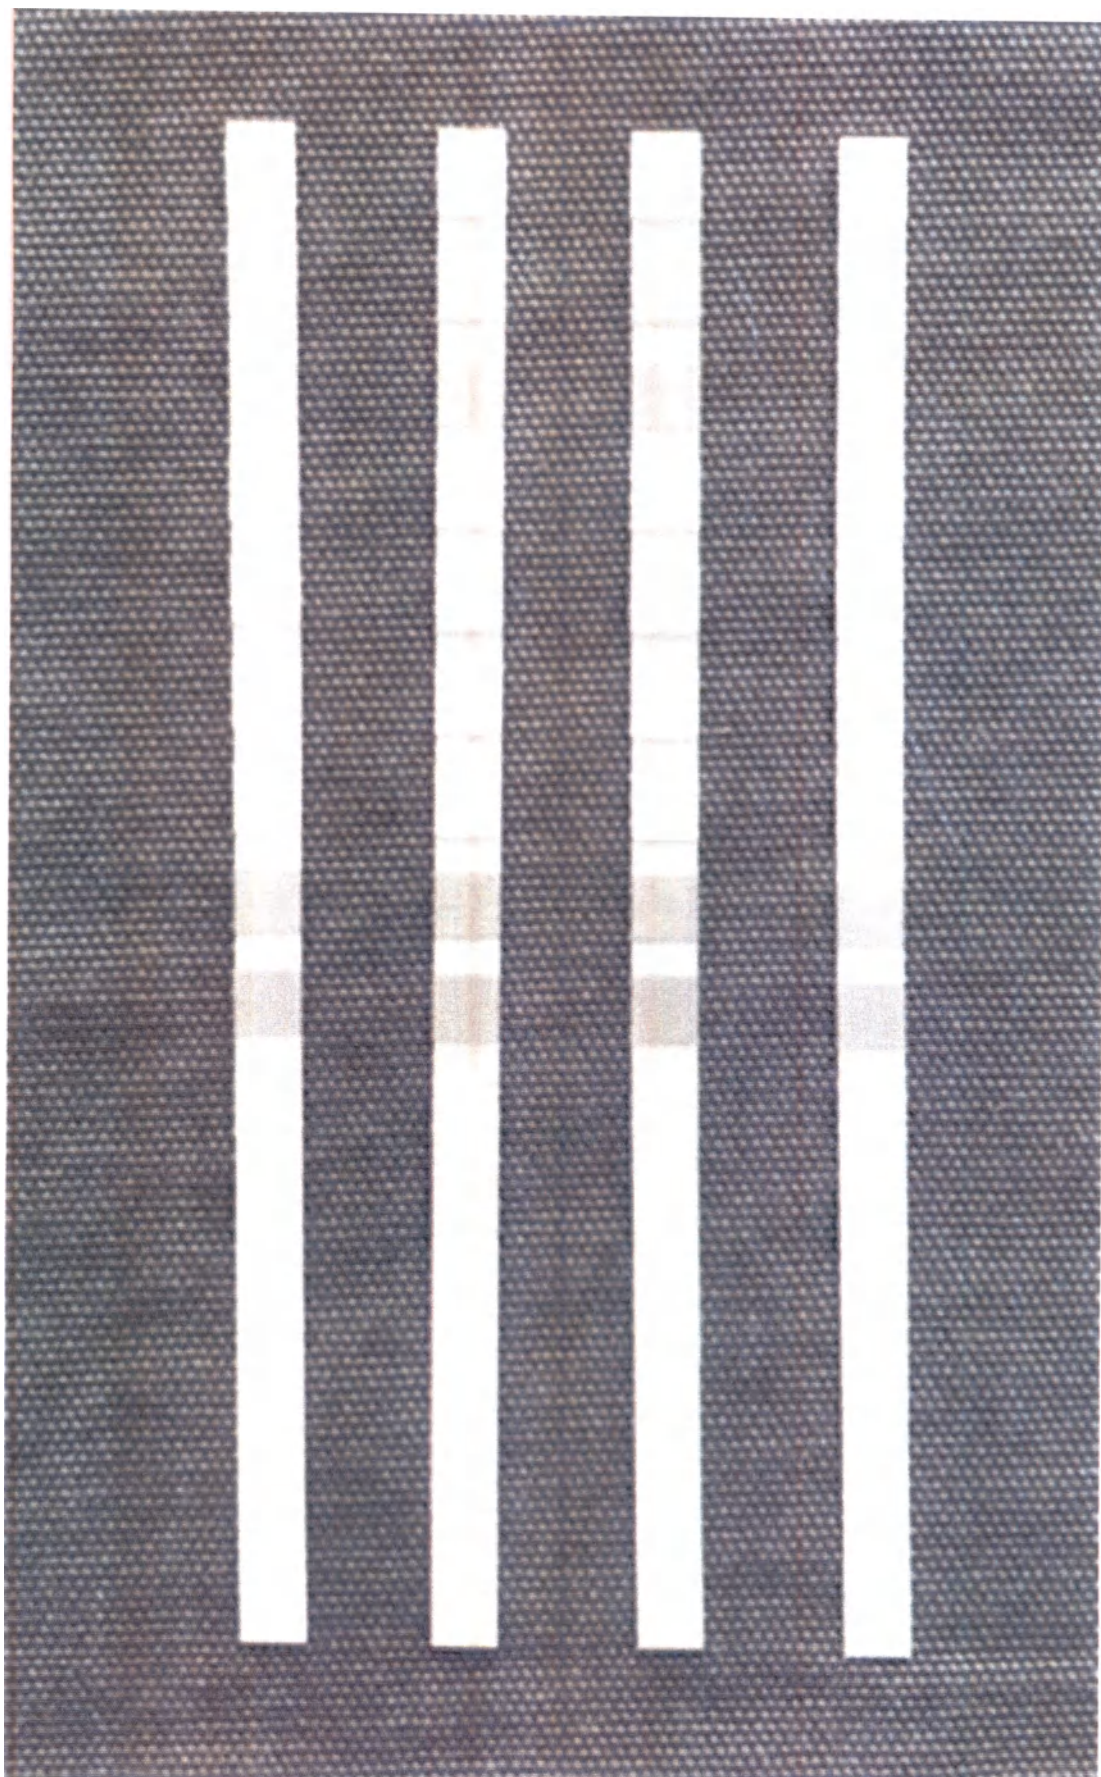

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

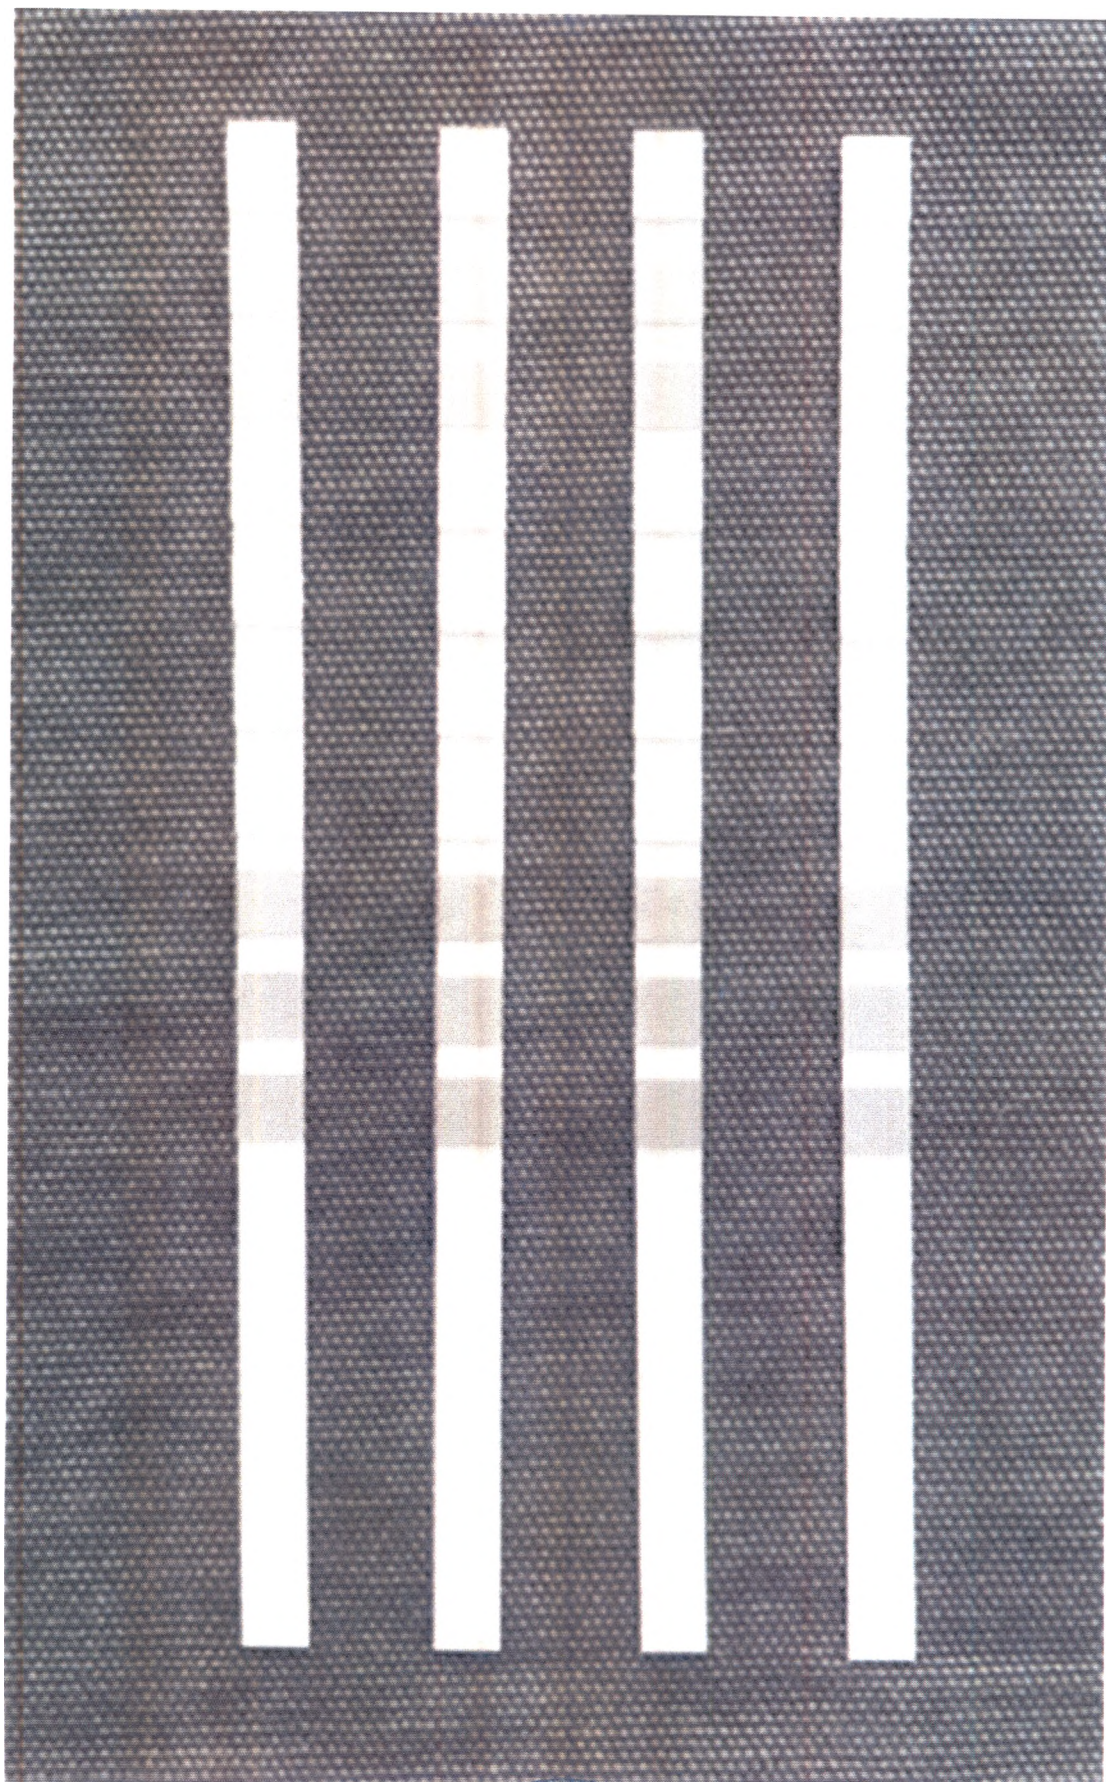

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



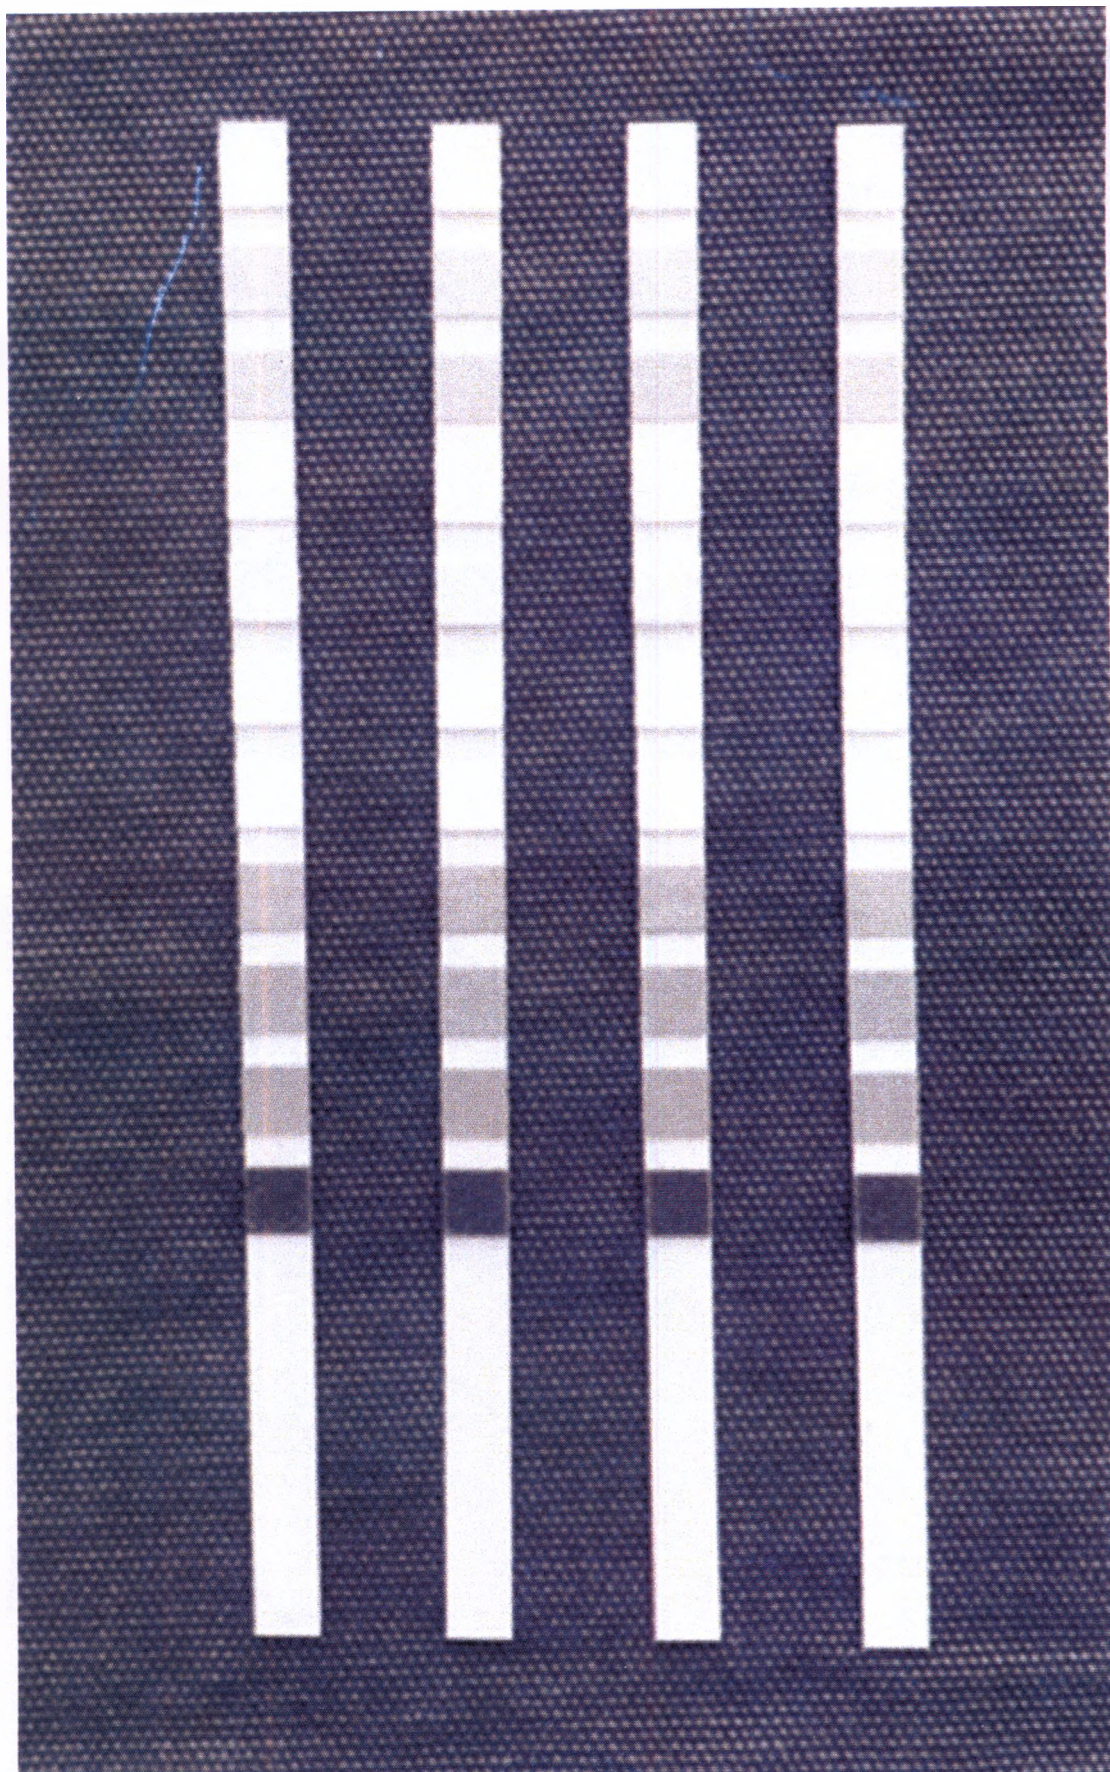

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

сиренко 21 мс
дир. ООО "Бюджет АН"

Петров А.Р.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.
07 мая 2018 г.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения:
глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, рН, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче
Уриполиан-ХN»**




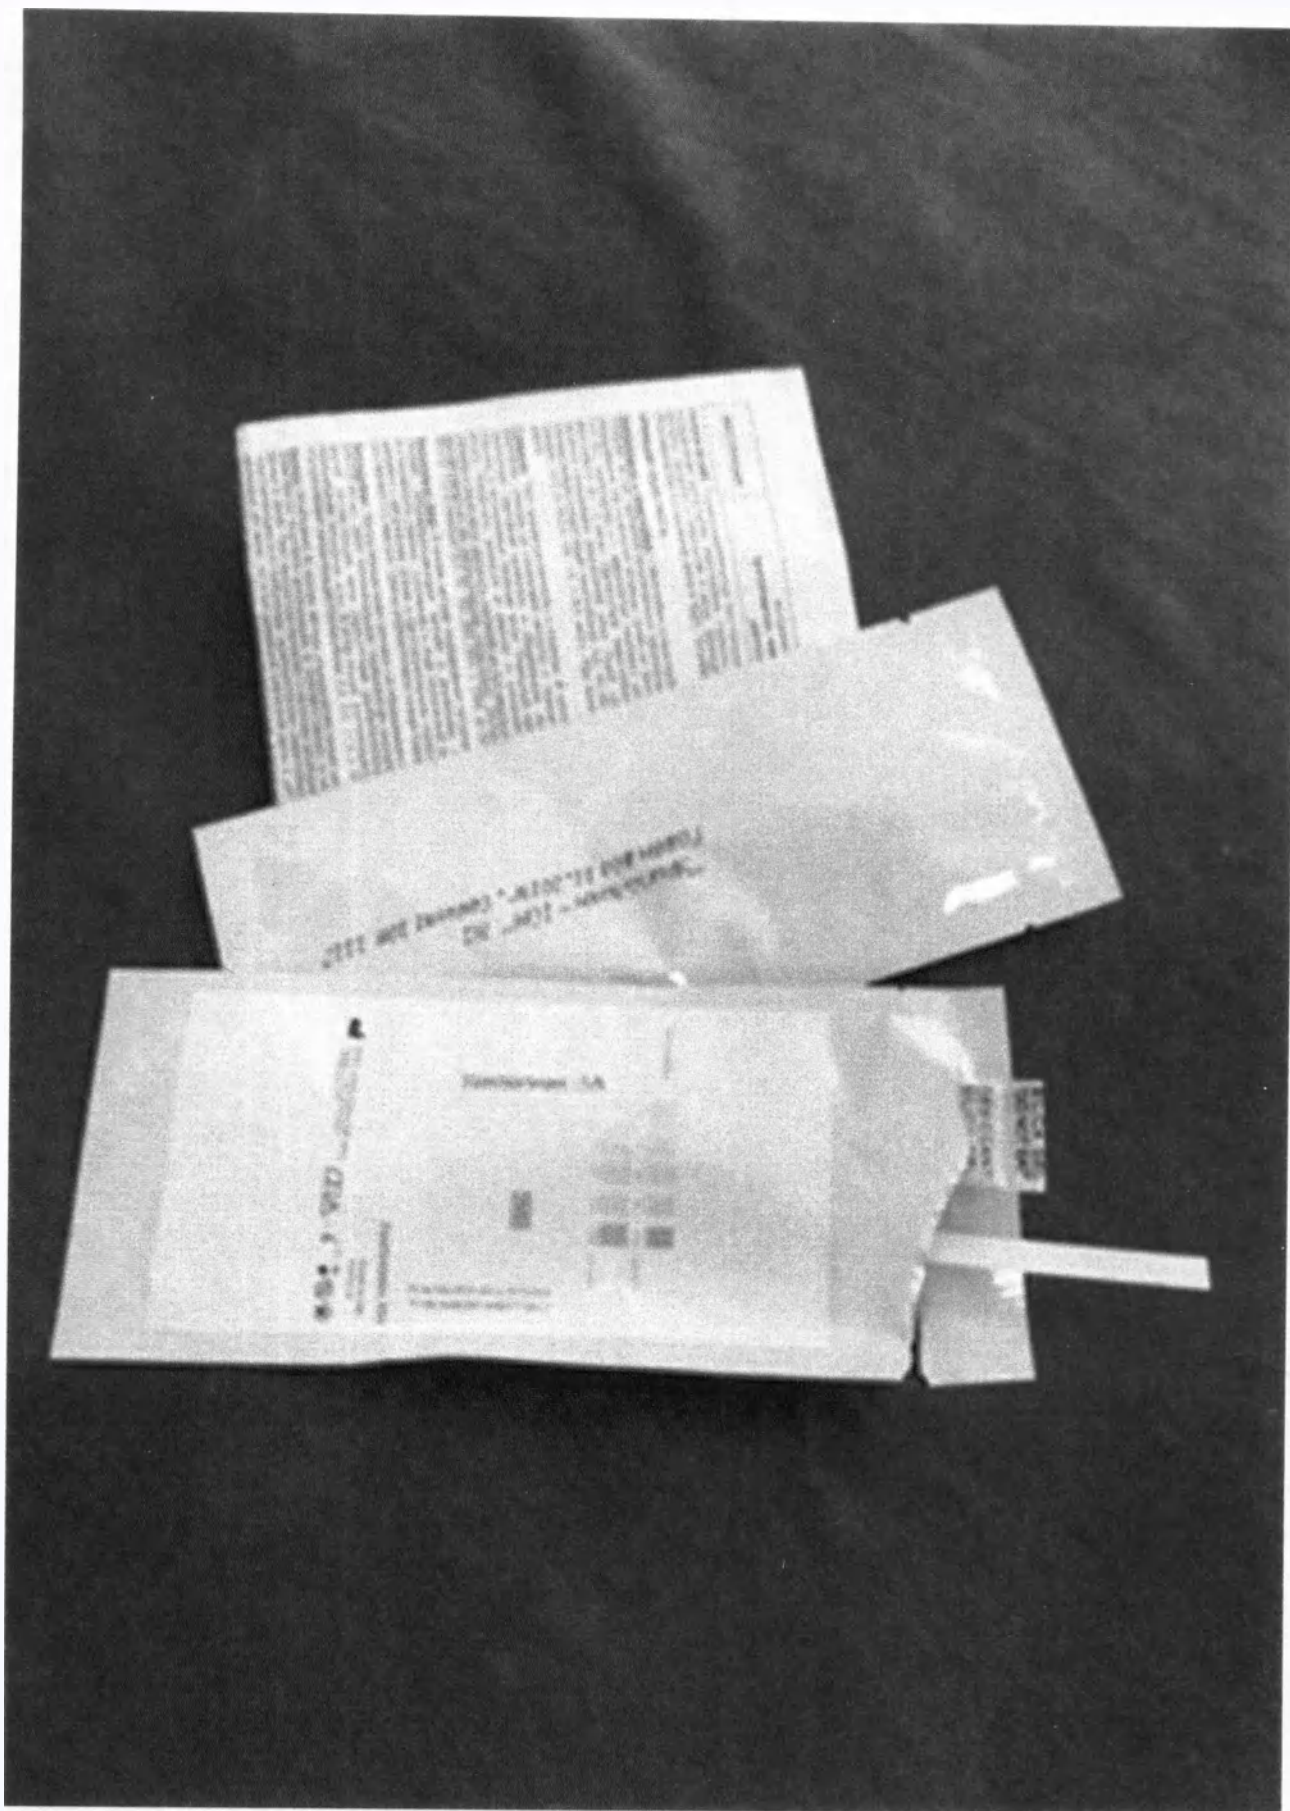





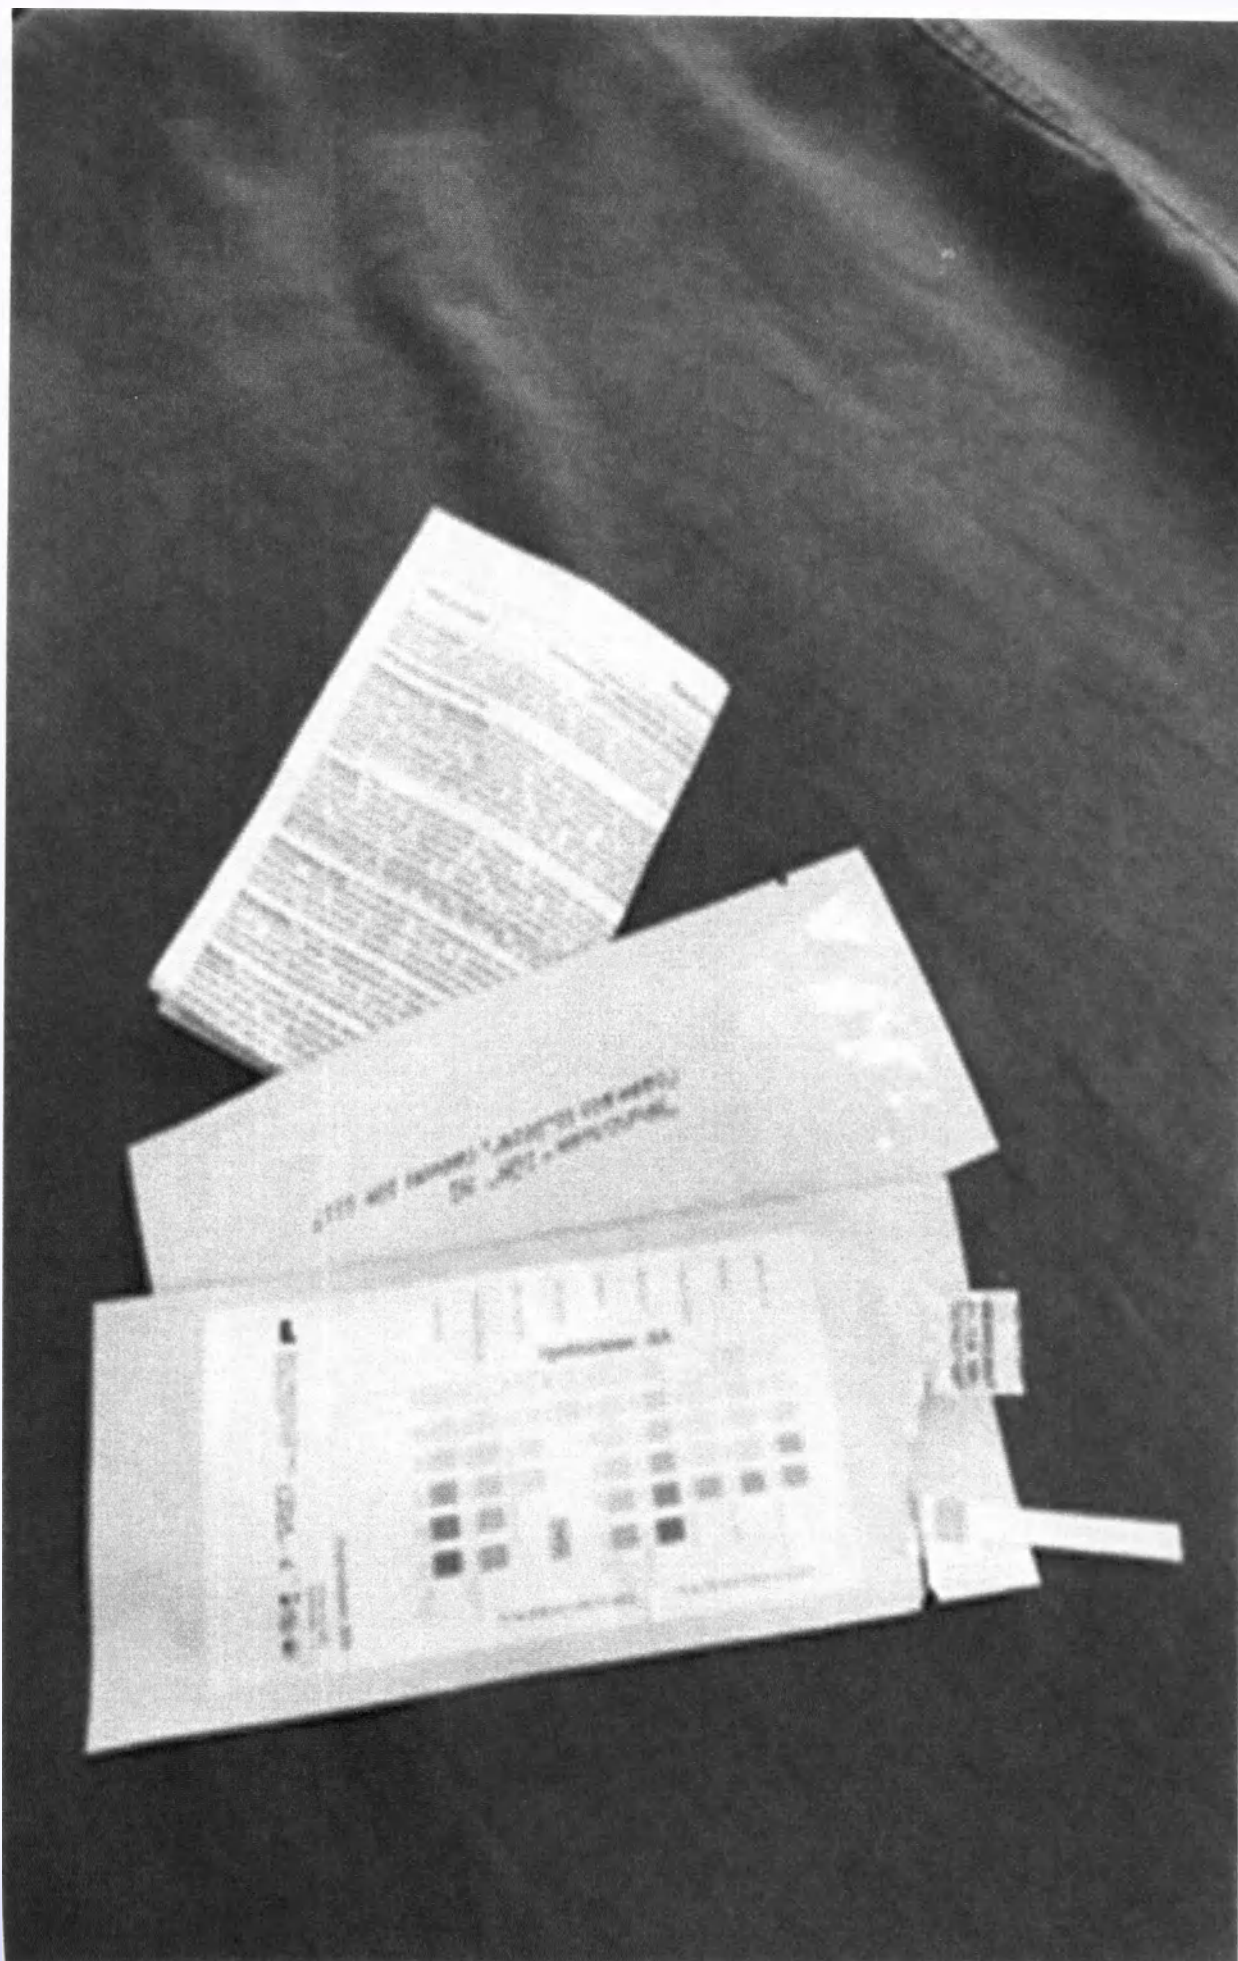





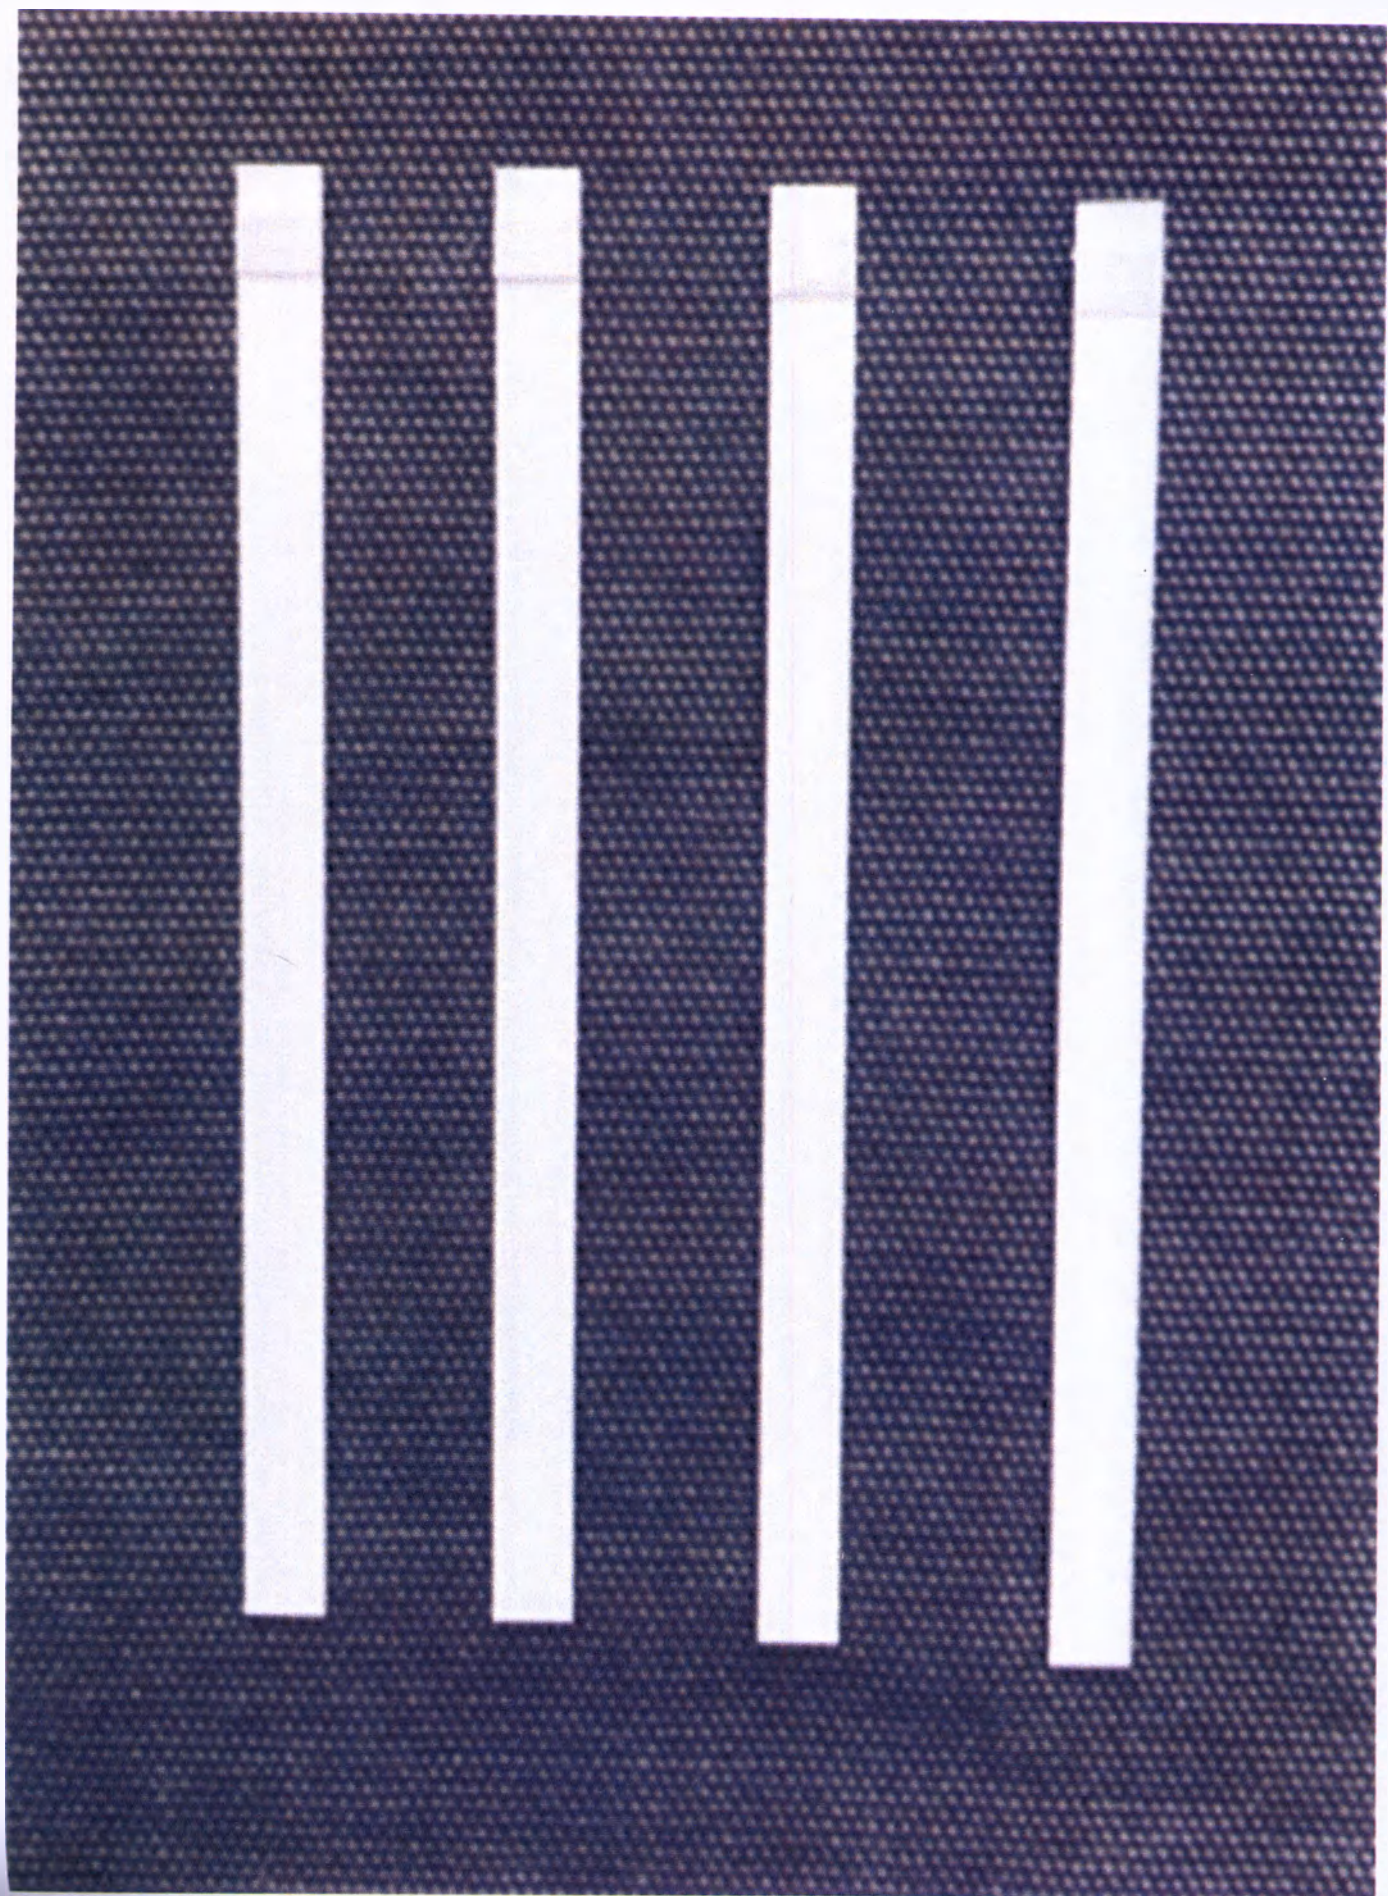


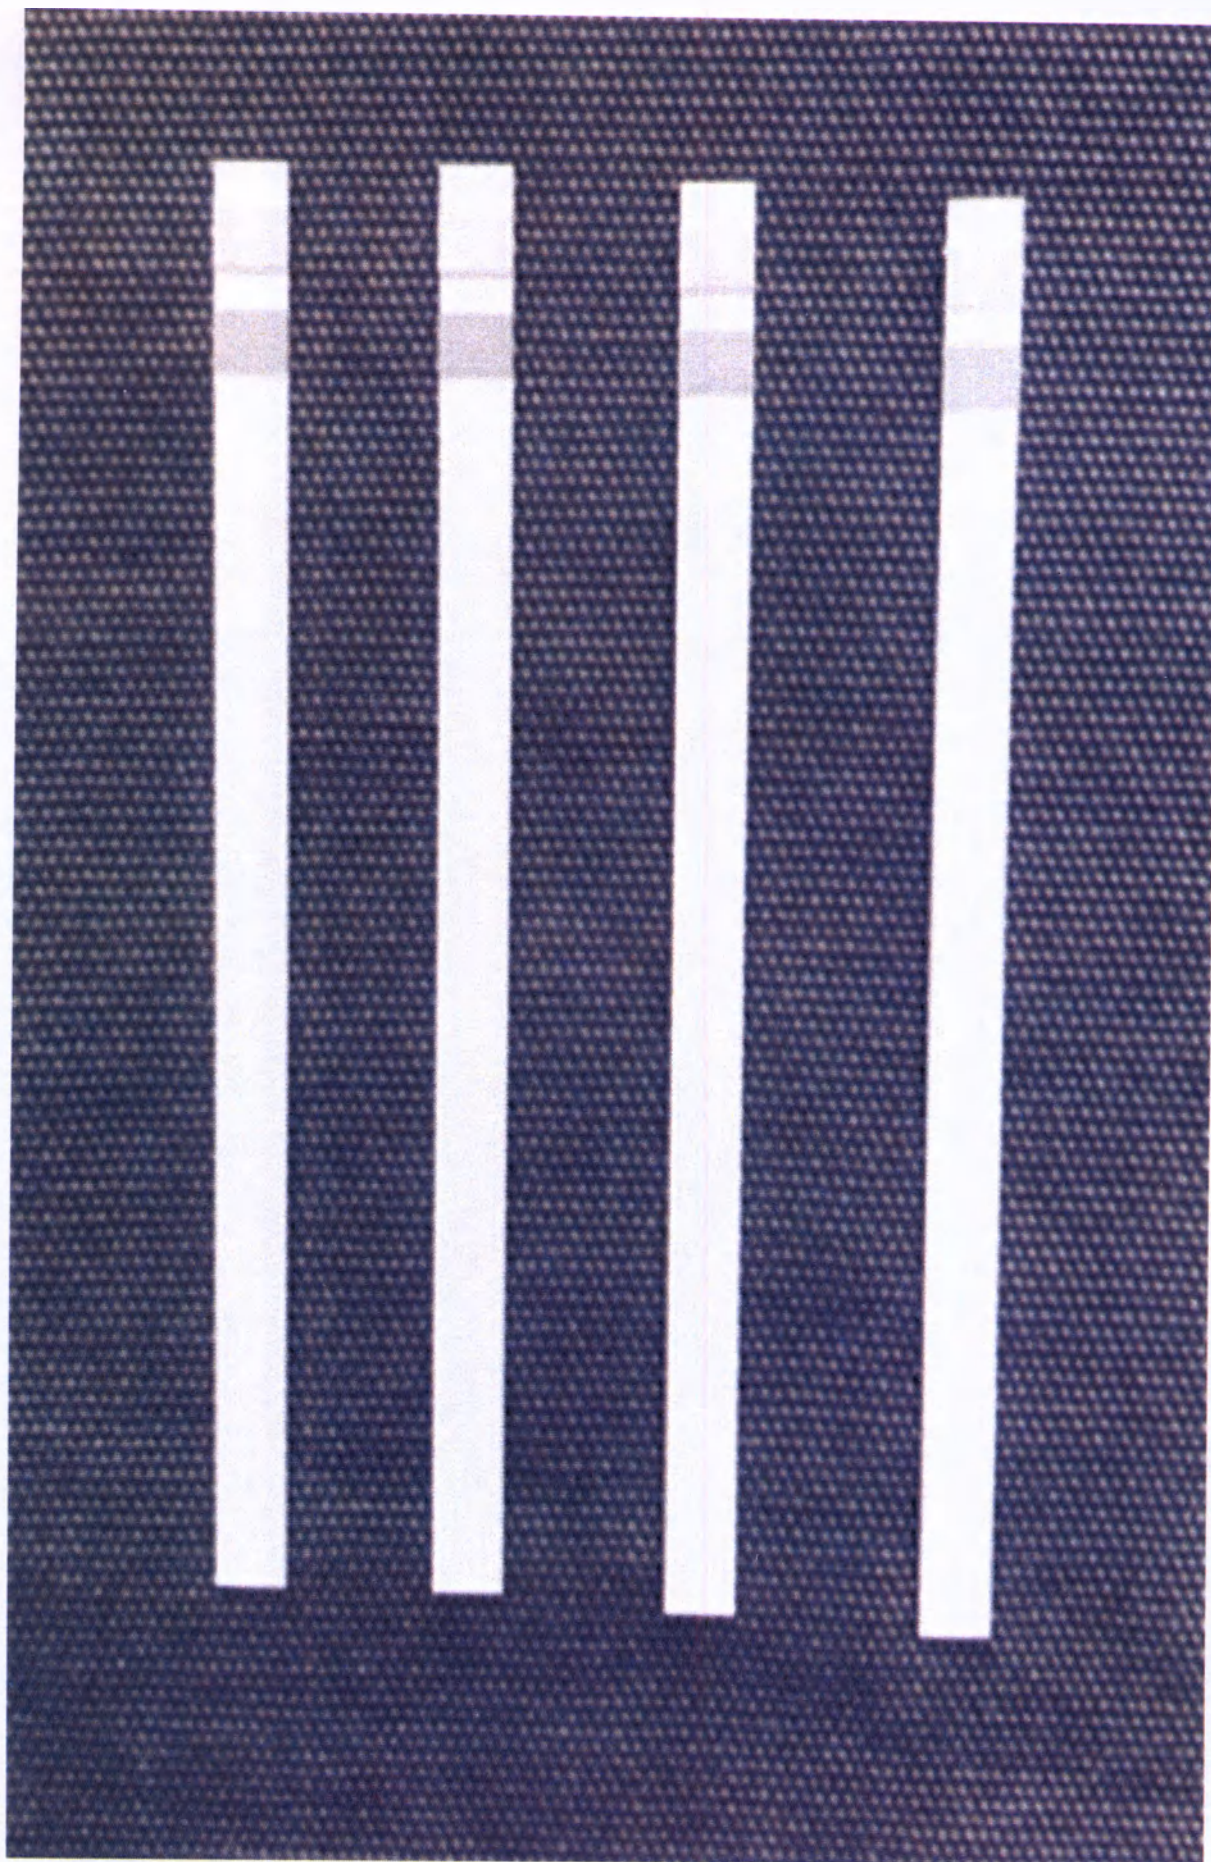


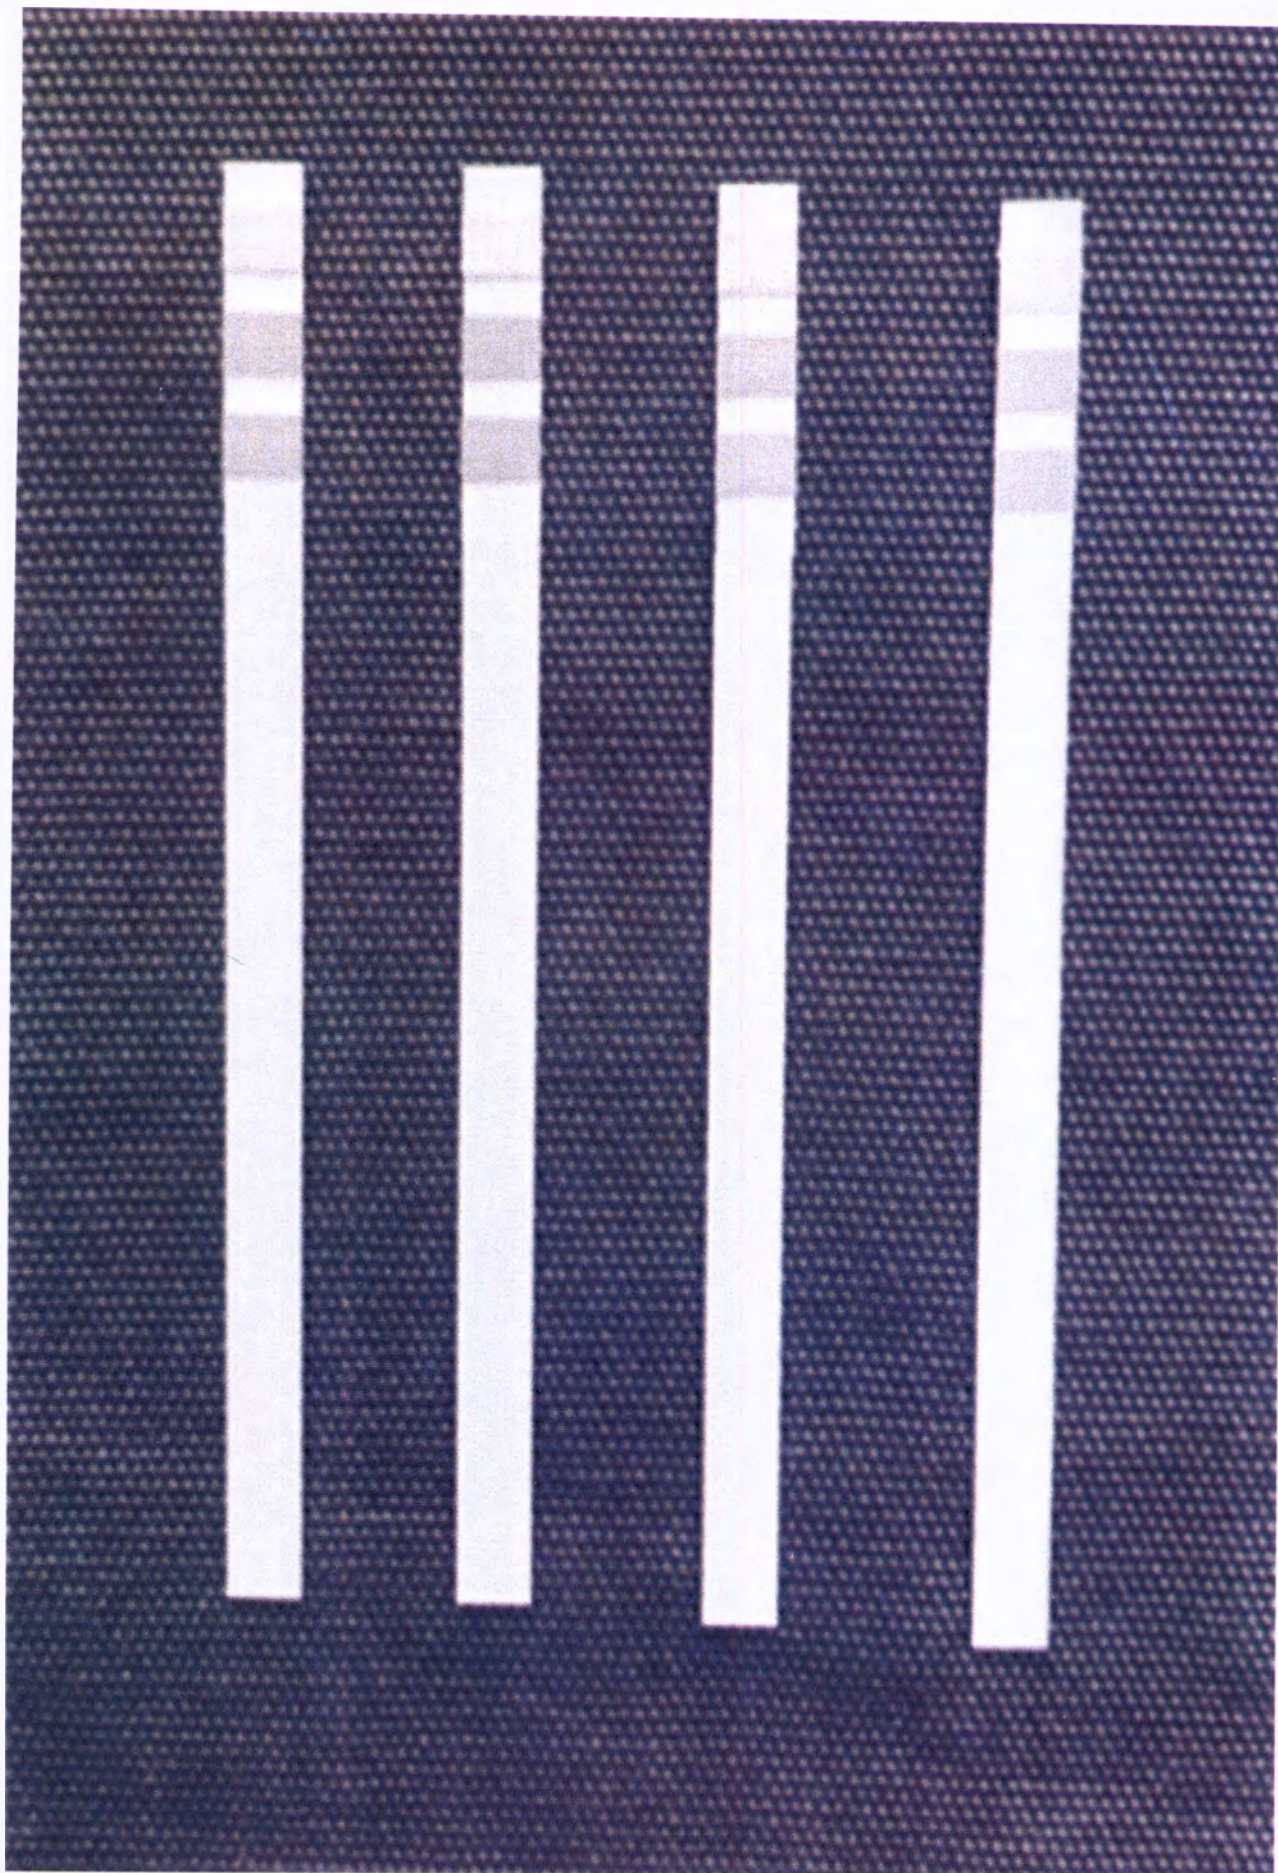


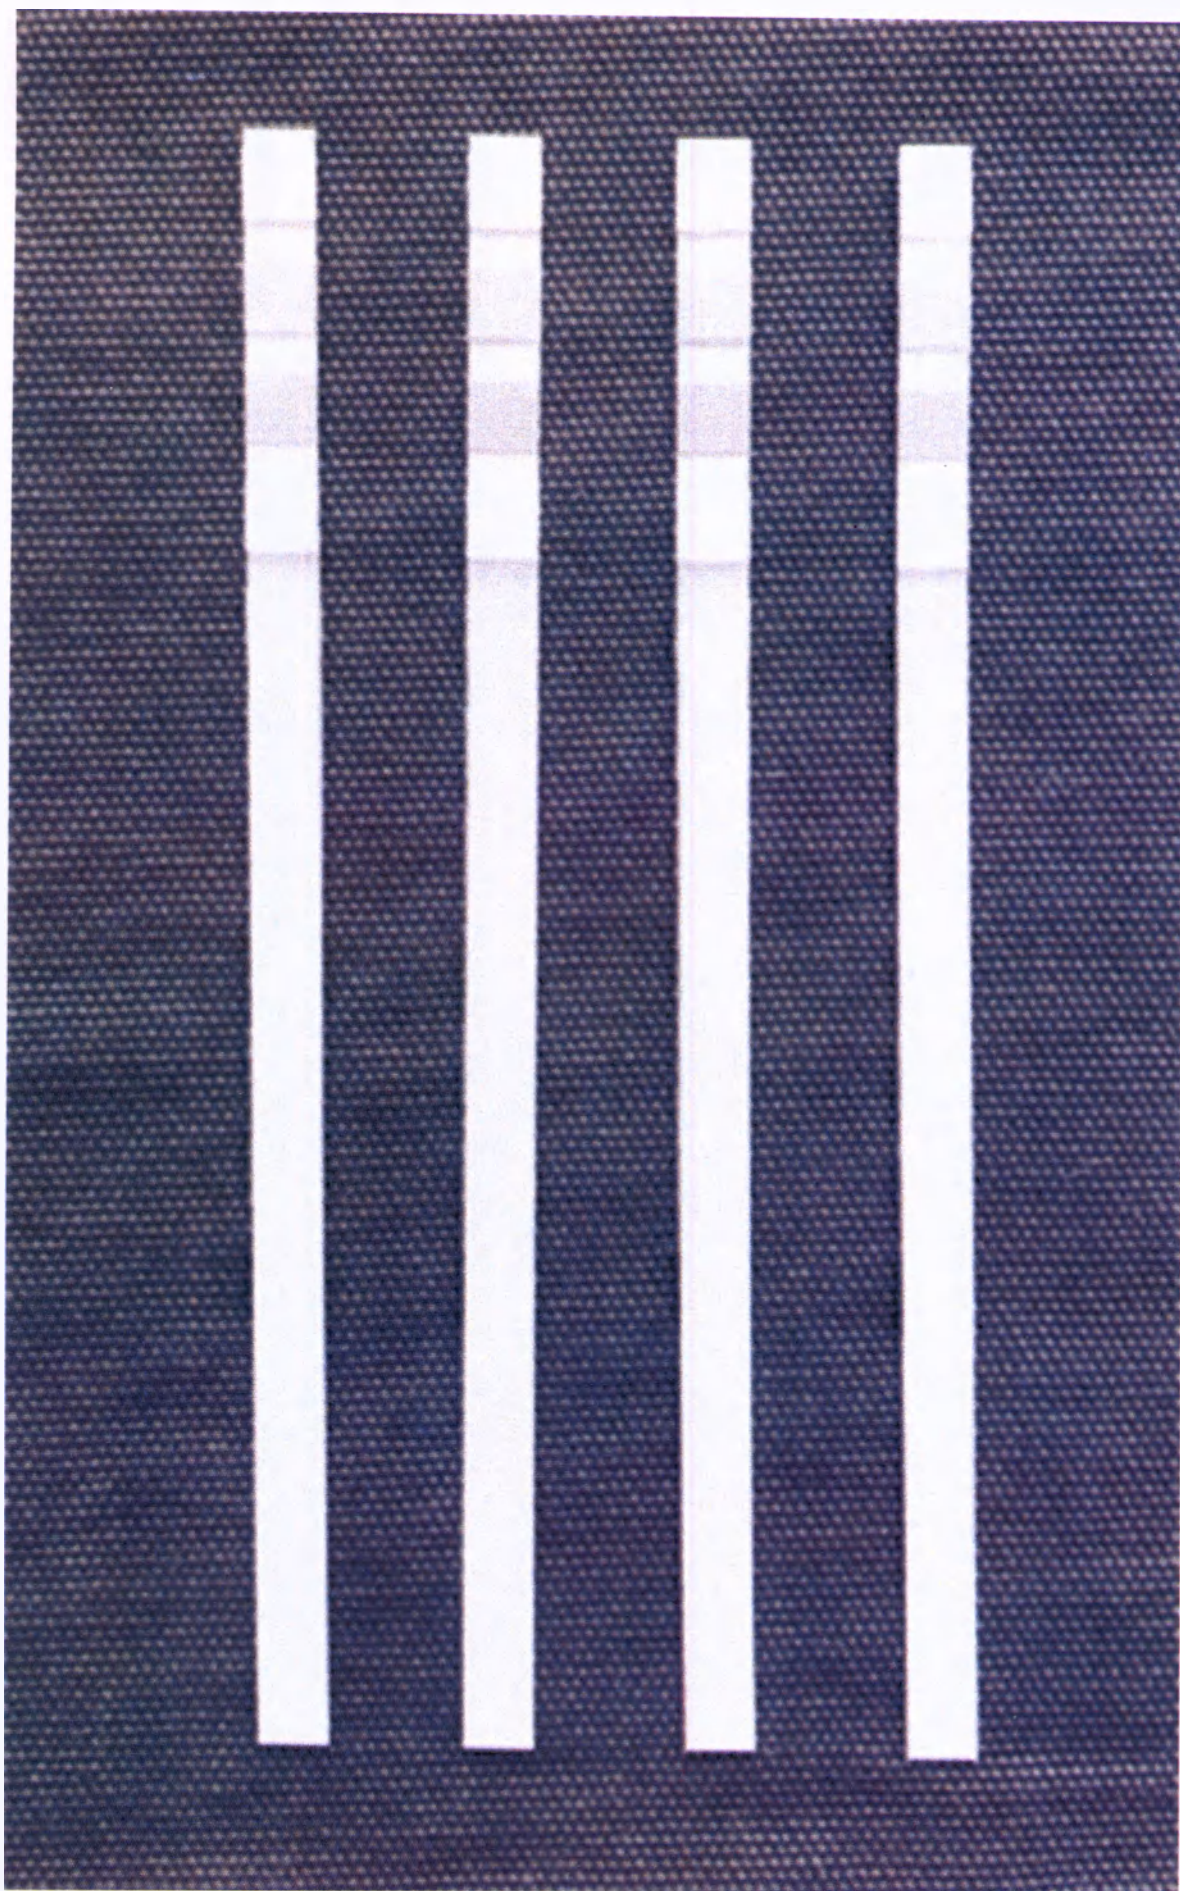


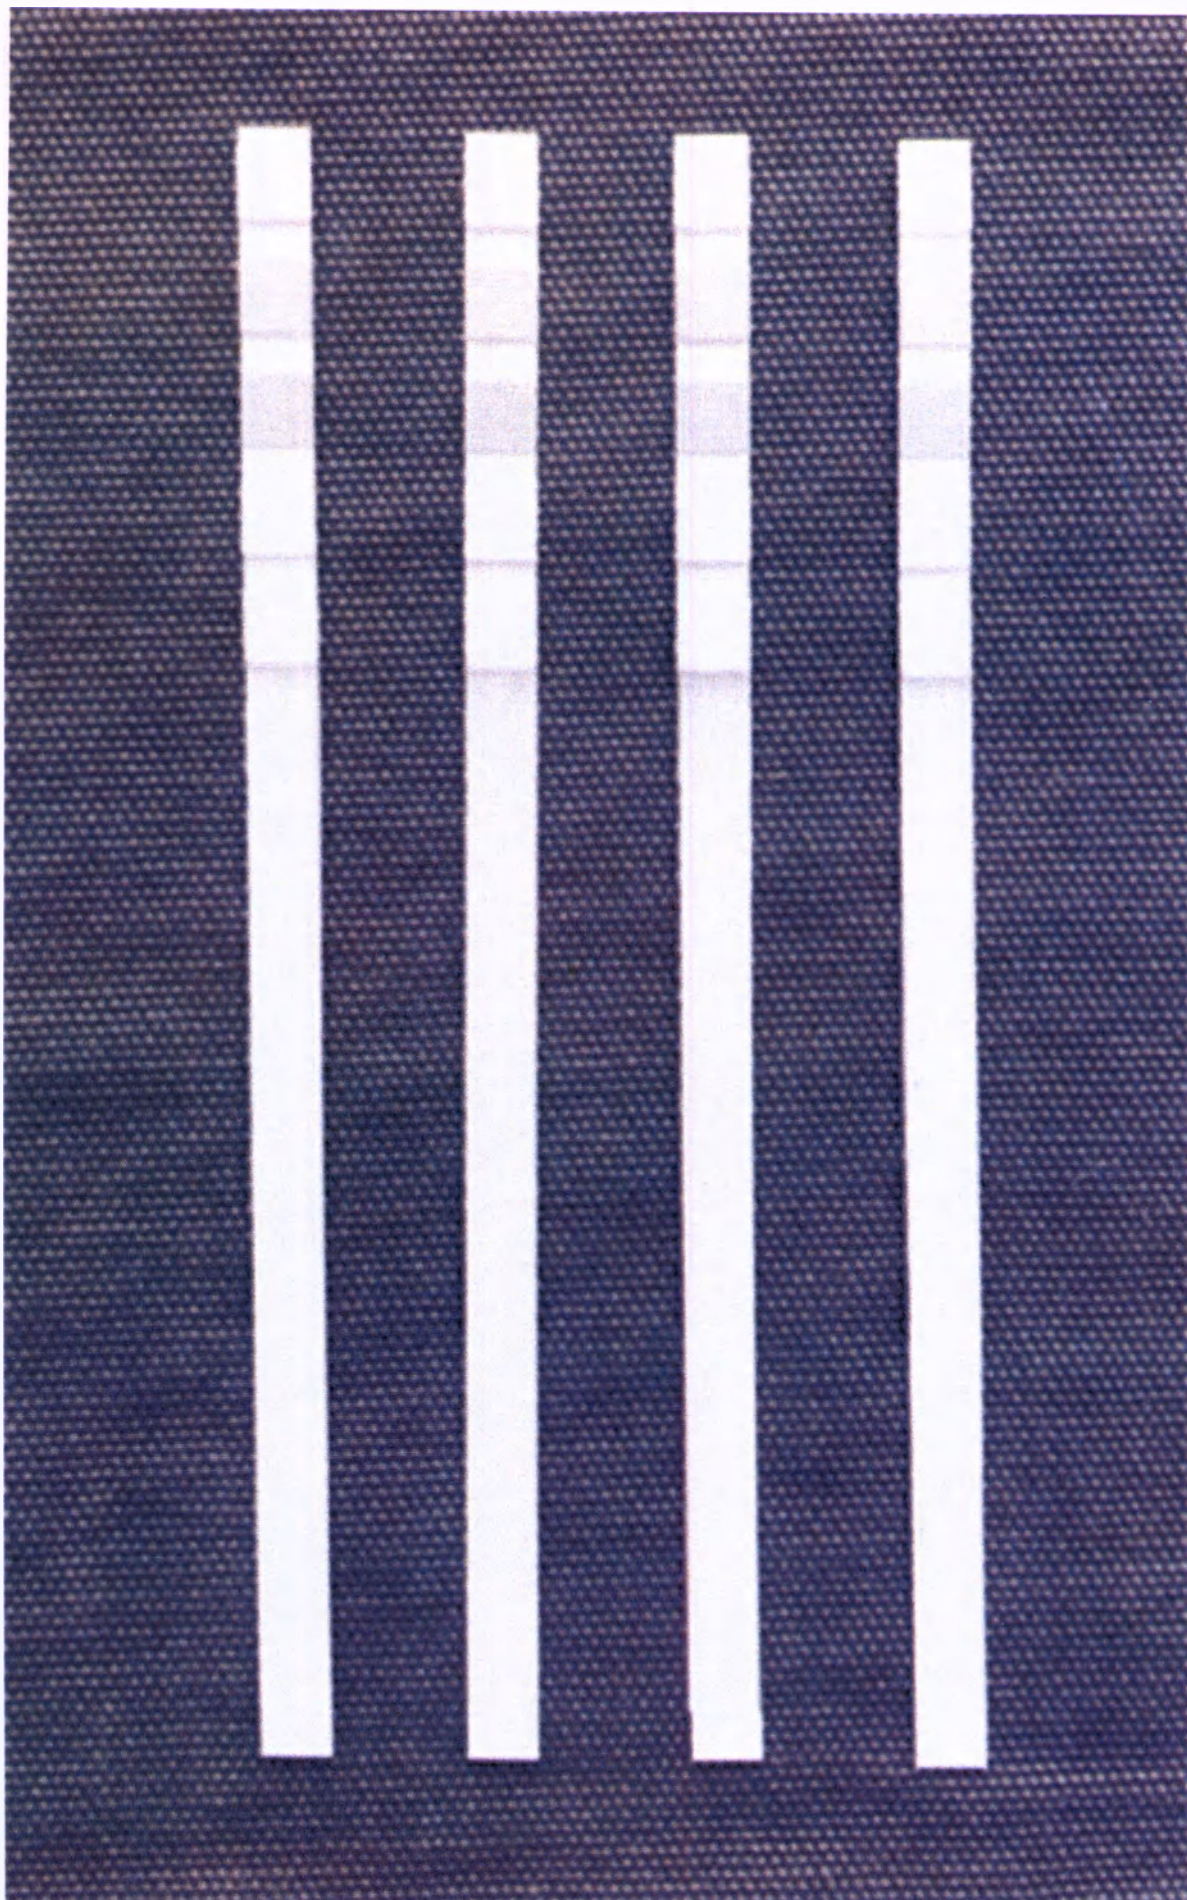


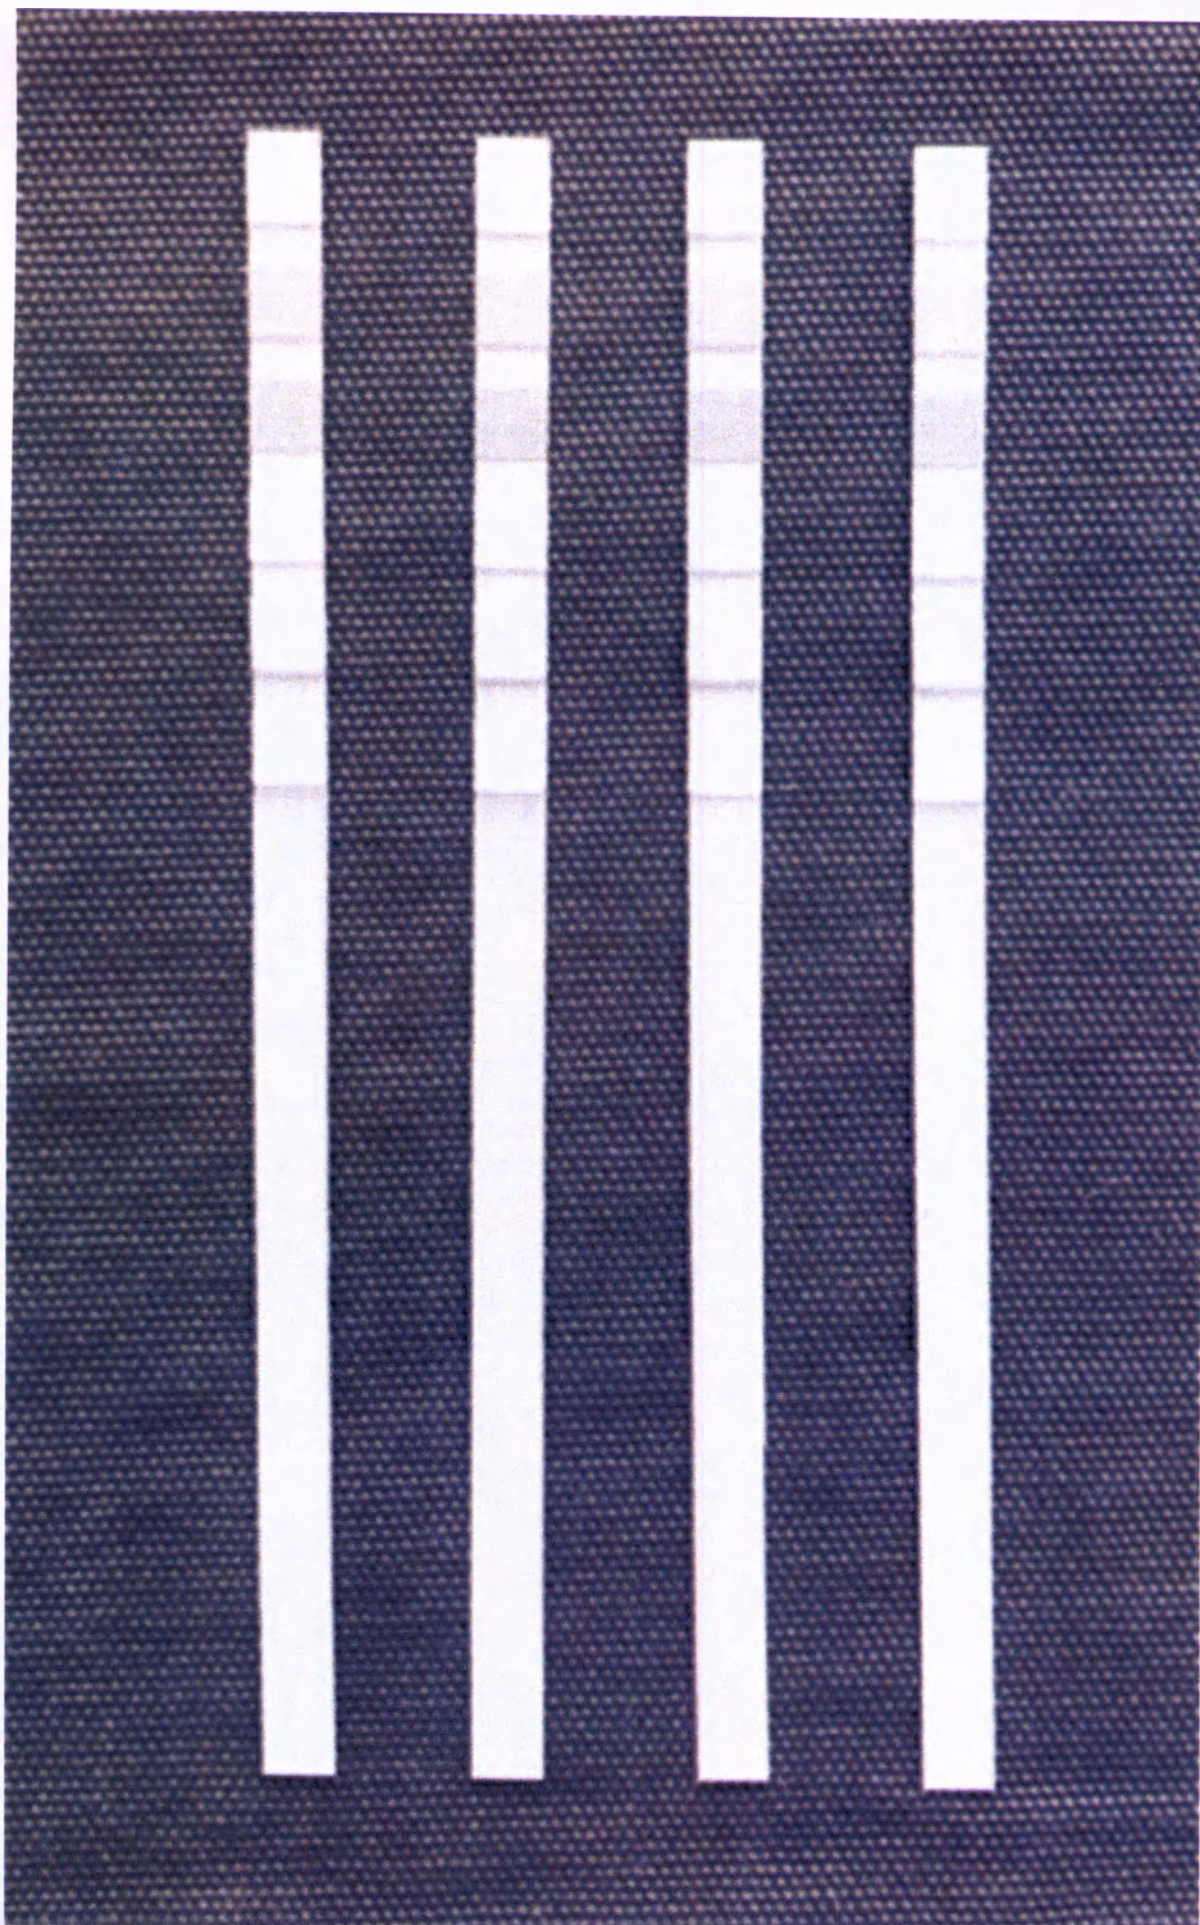


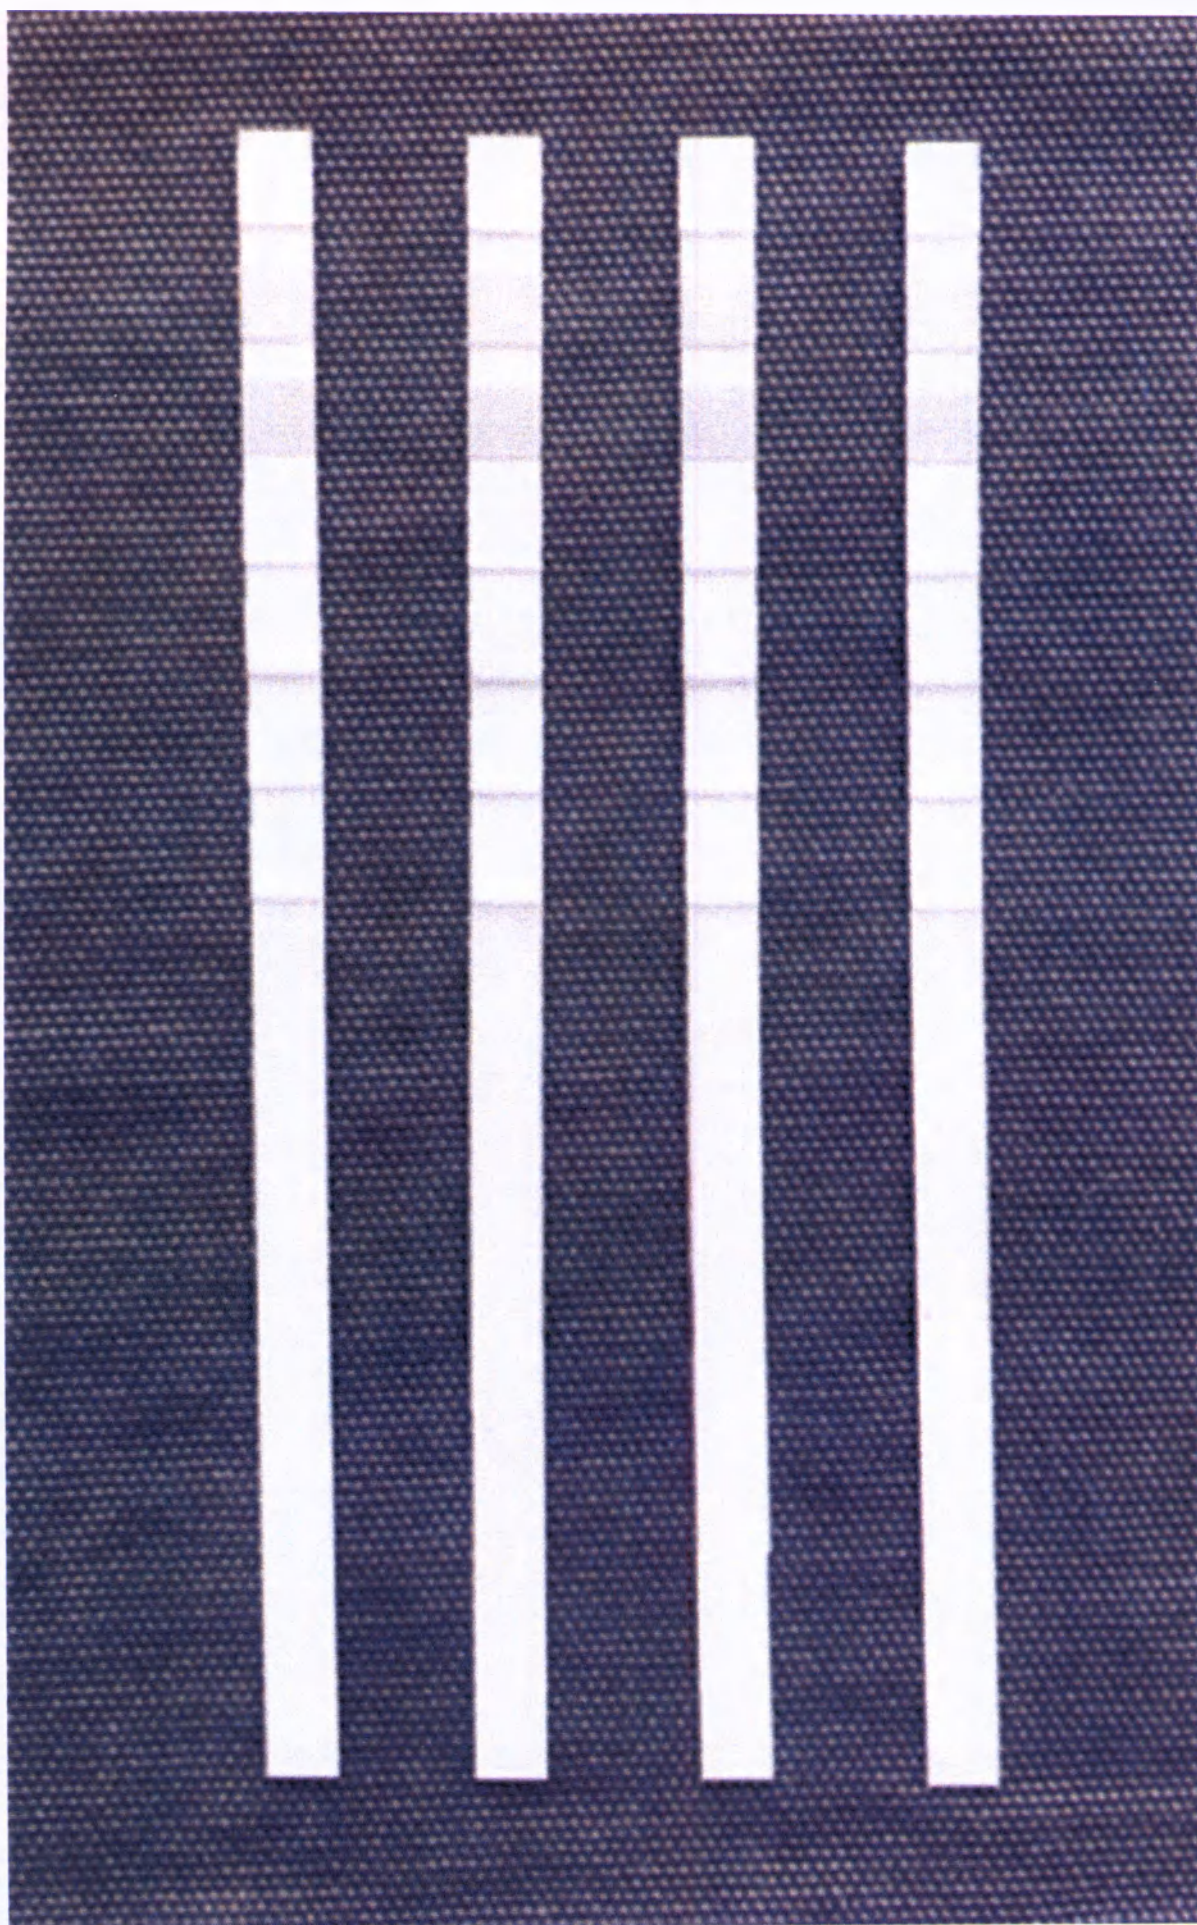

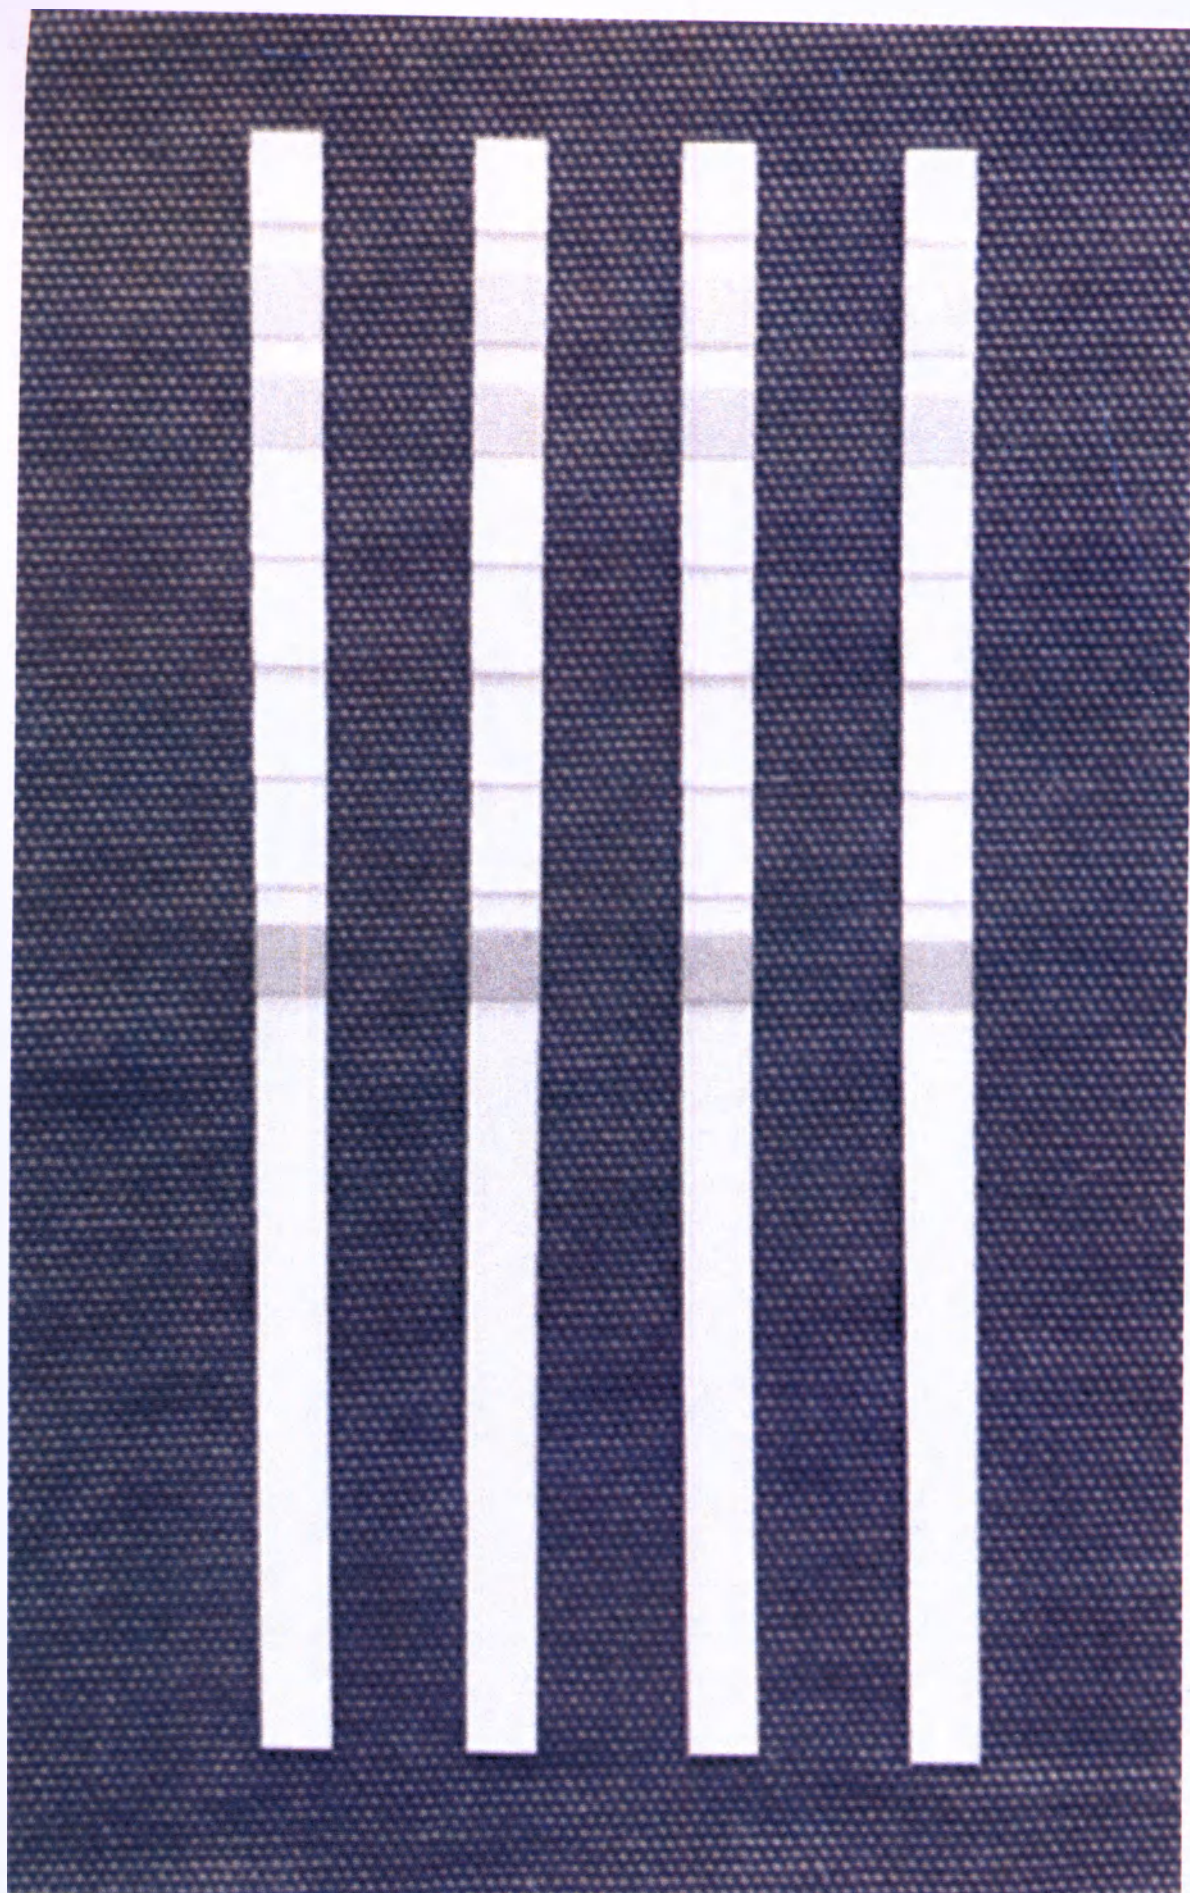

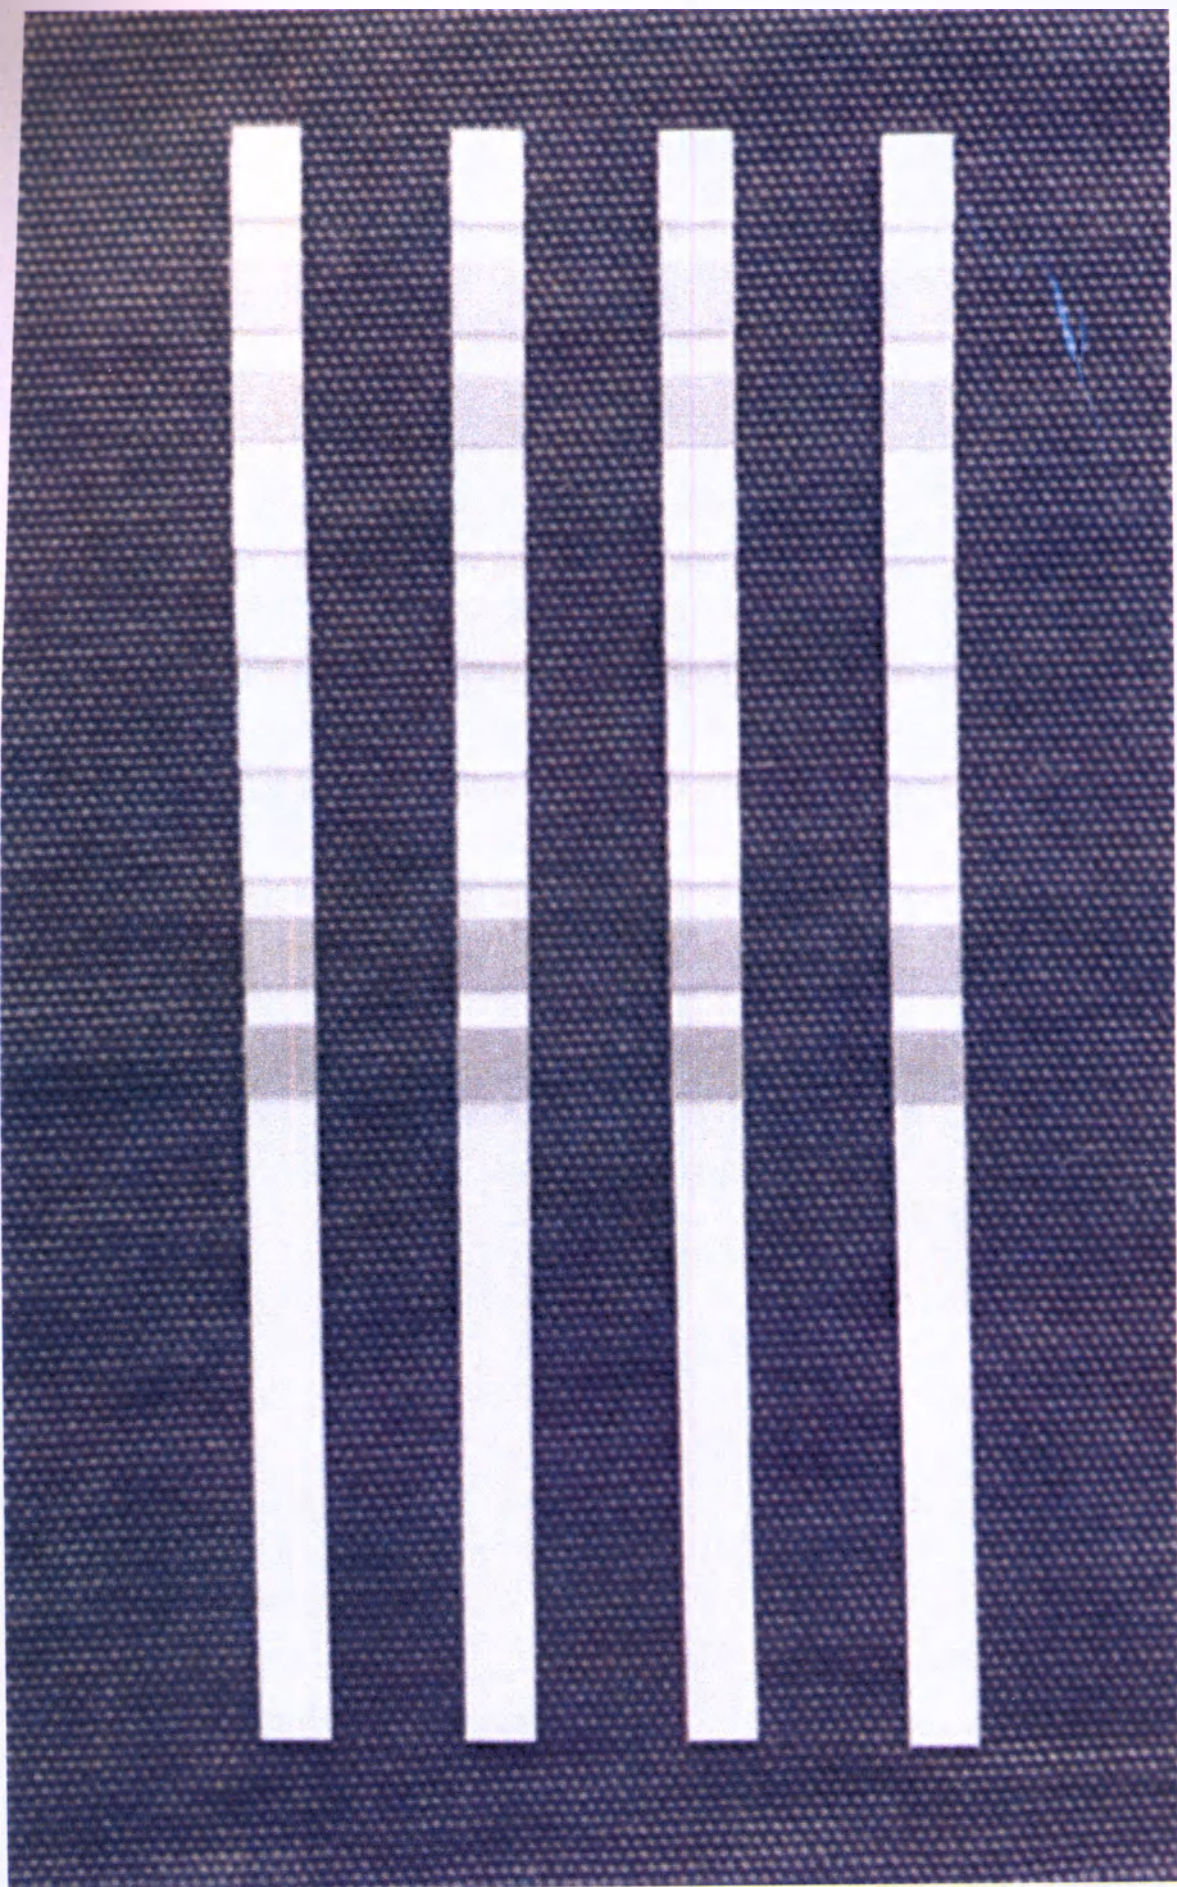

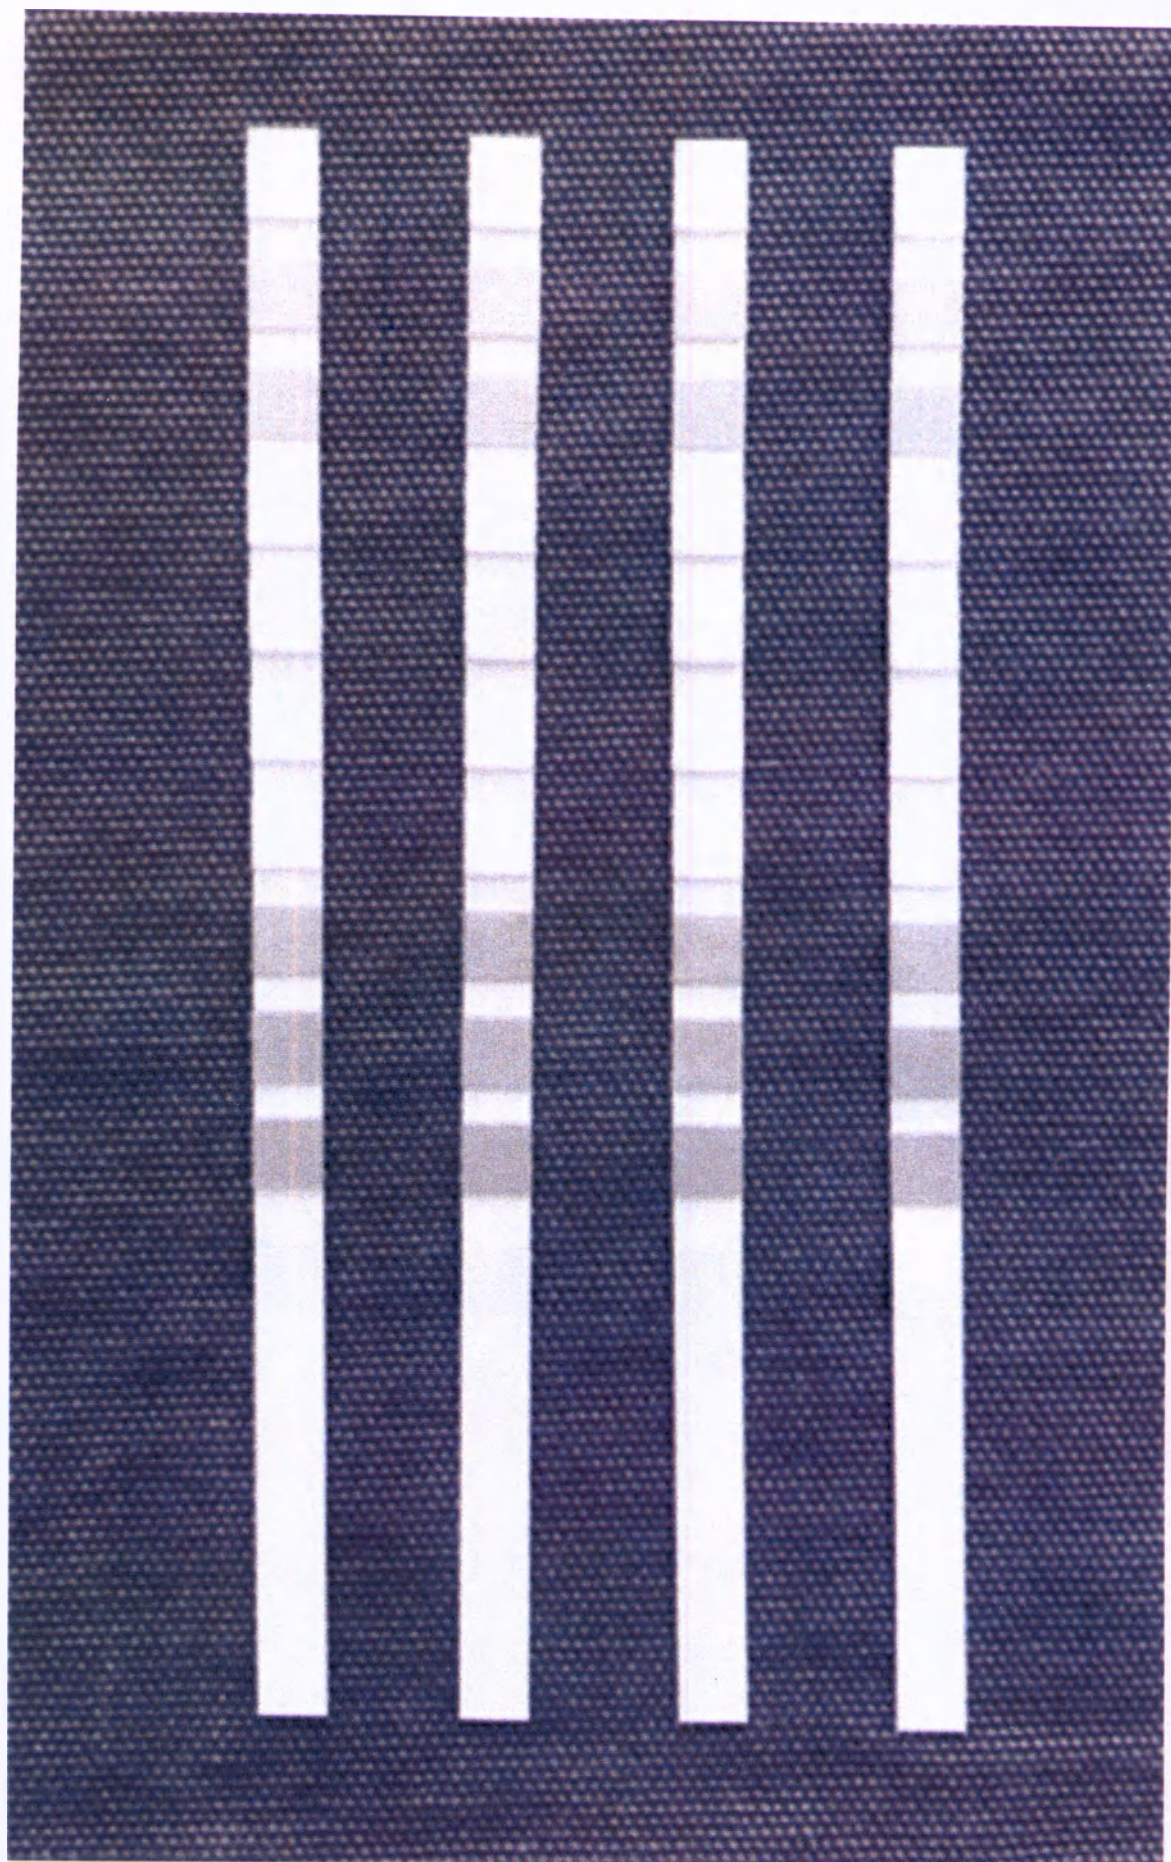

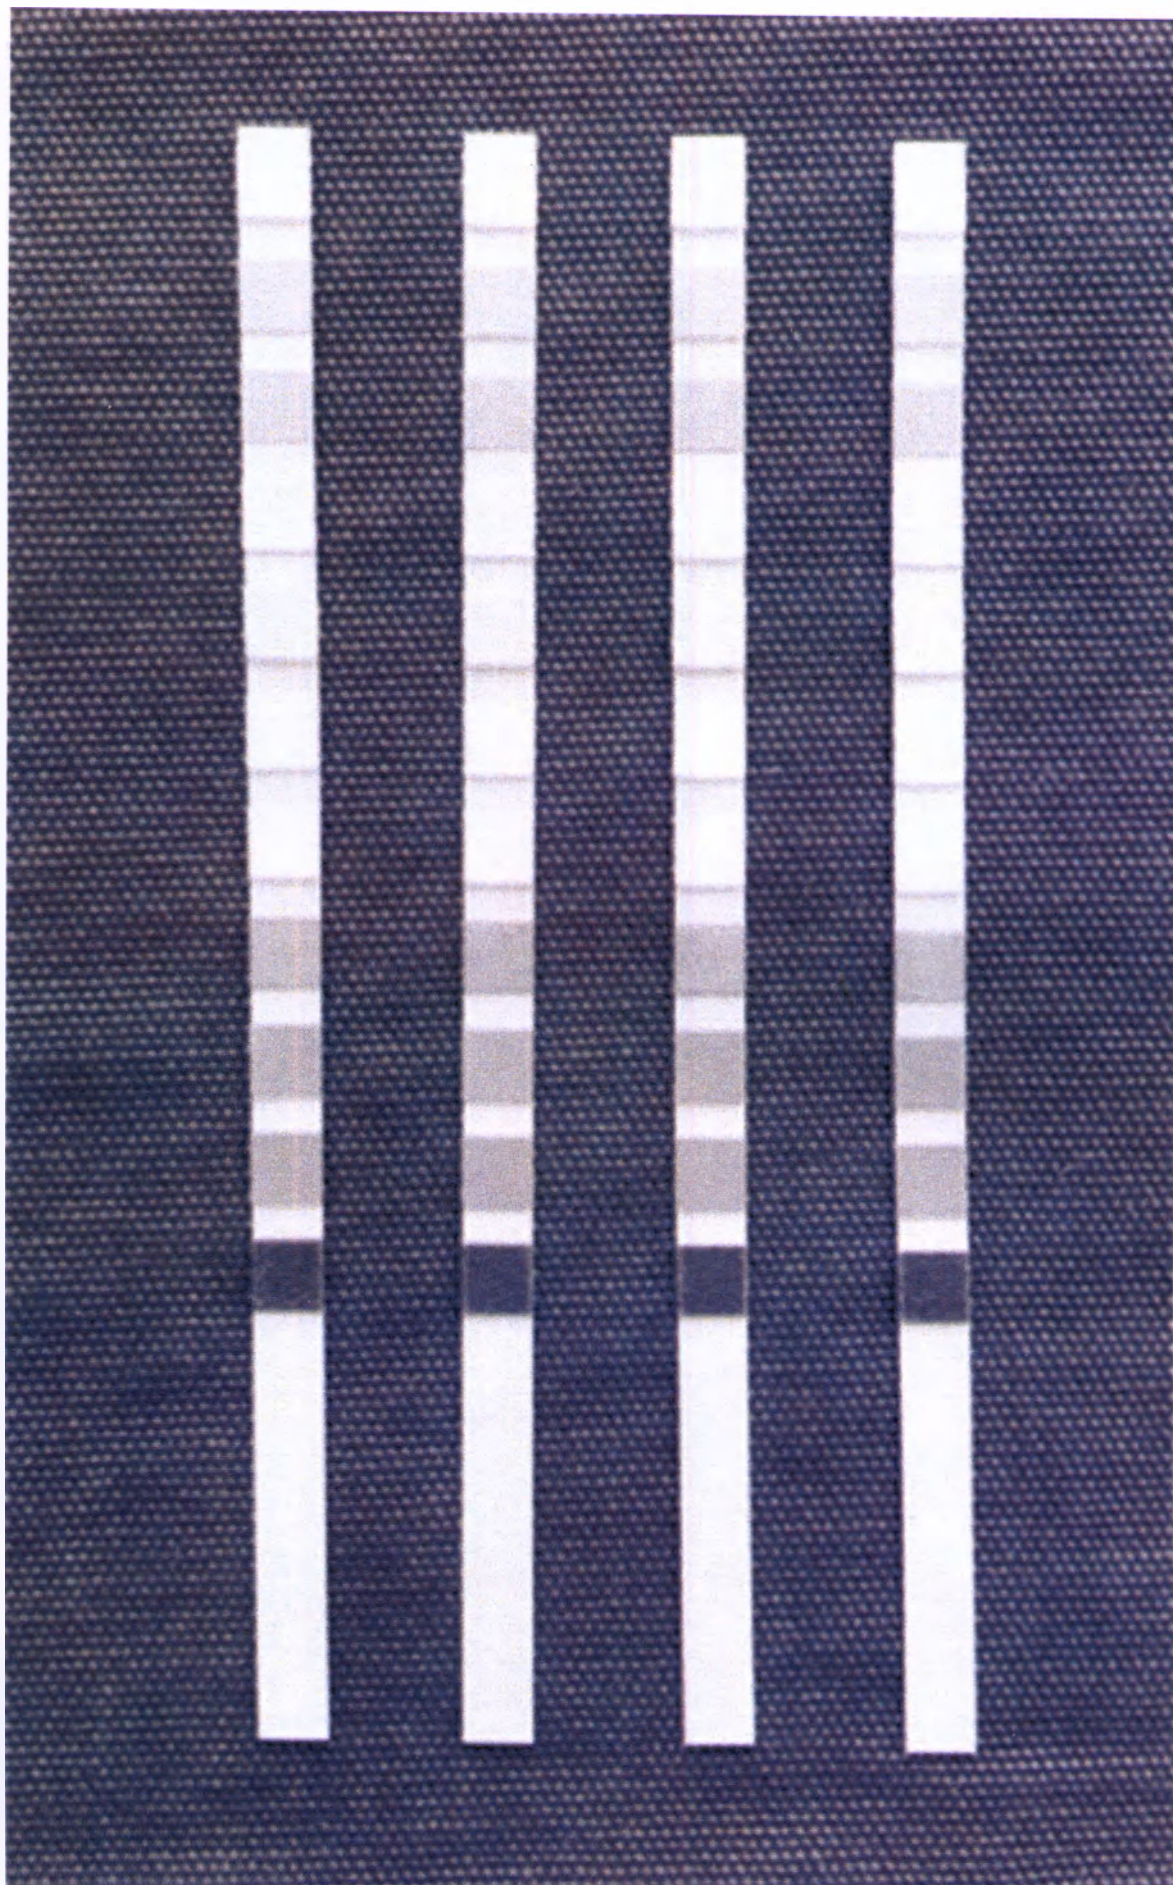

Сиренко 18 марта
Дир. ООО «Биосенсор»
Ан




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»


Гвоздев А.Р.
17 августа 2018 г.
М.П. 

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения:
глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH,
билирубина,
уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче
Уриполиан-ХN»**

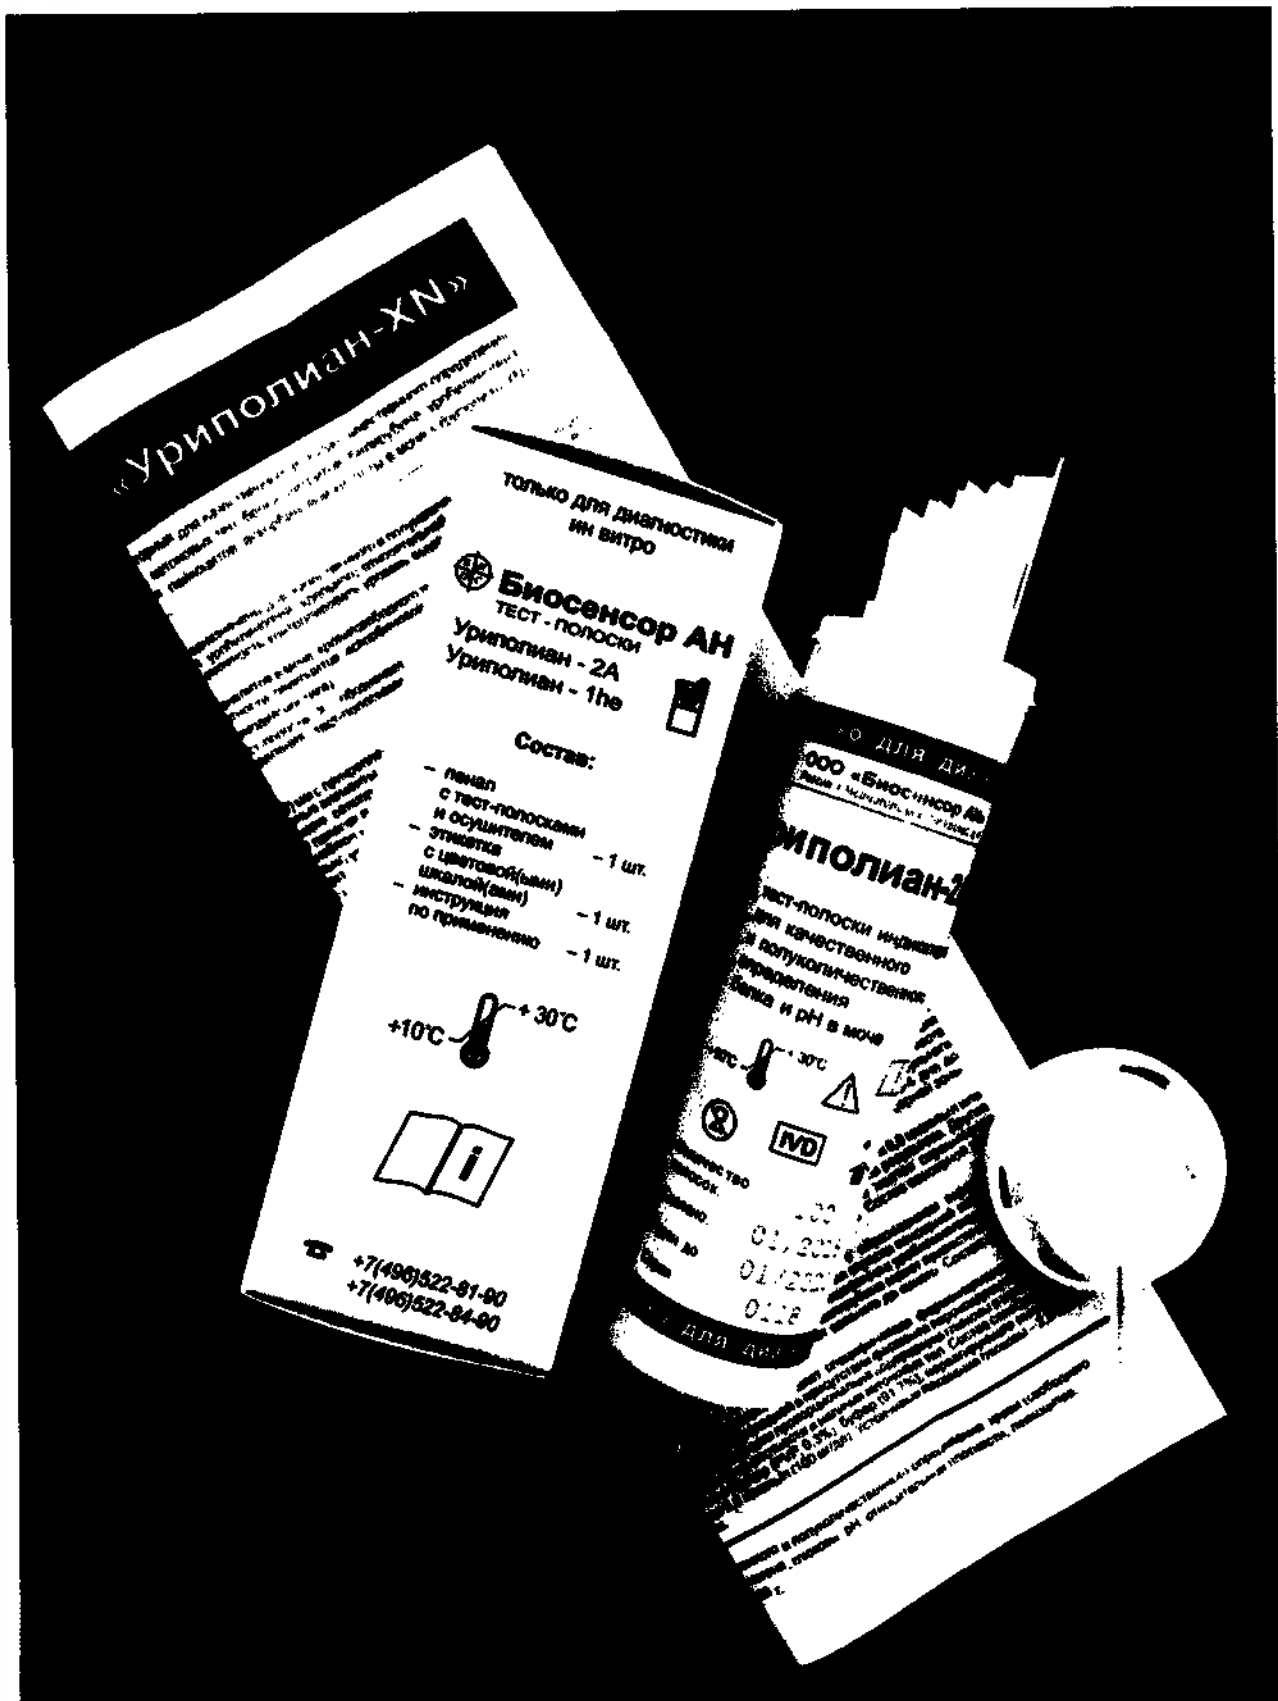

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



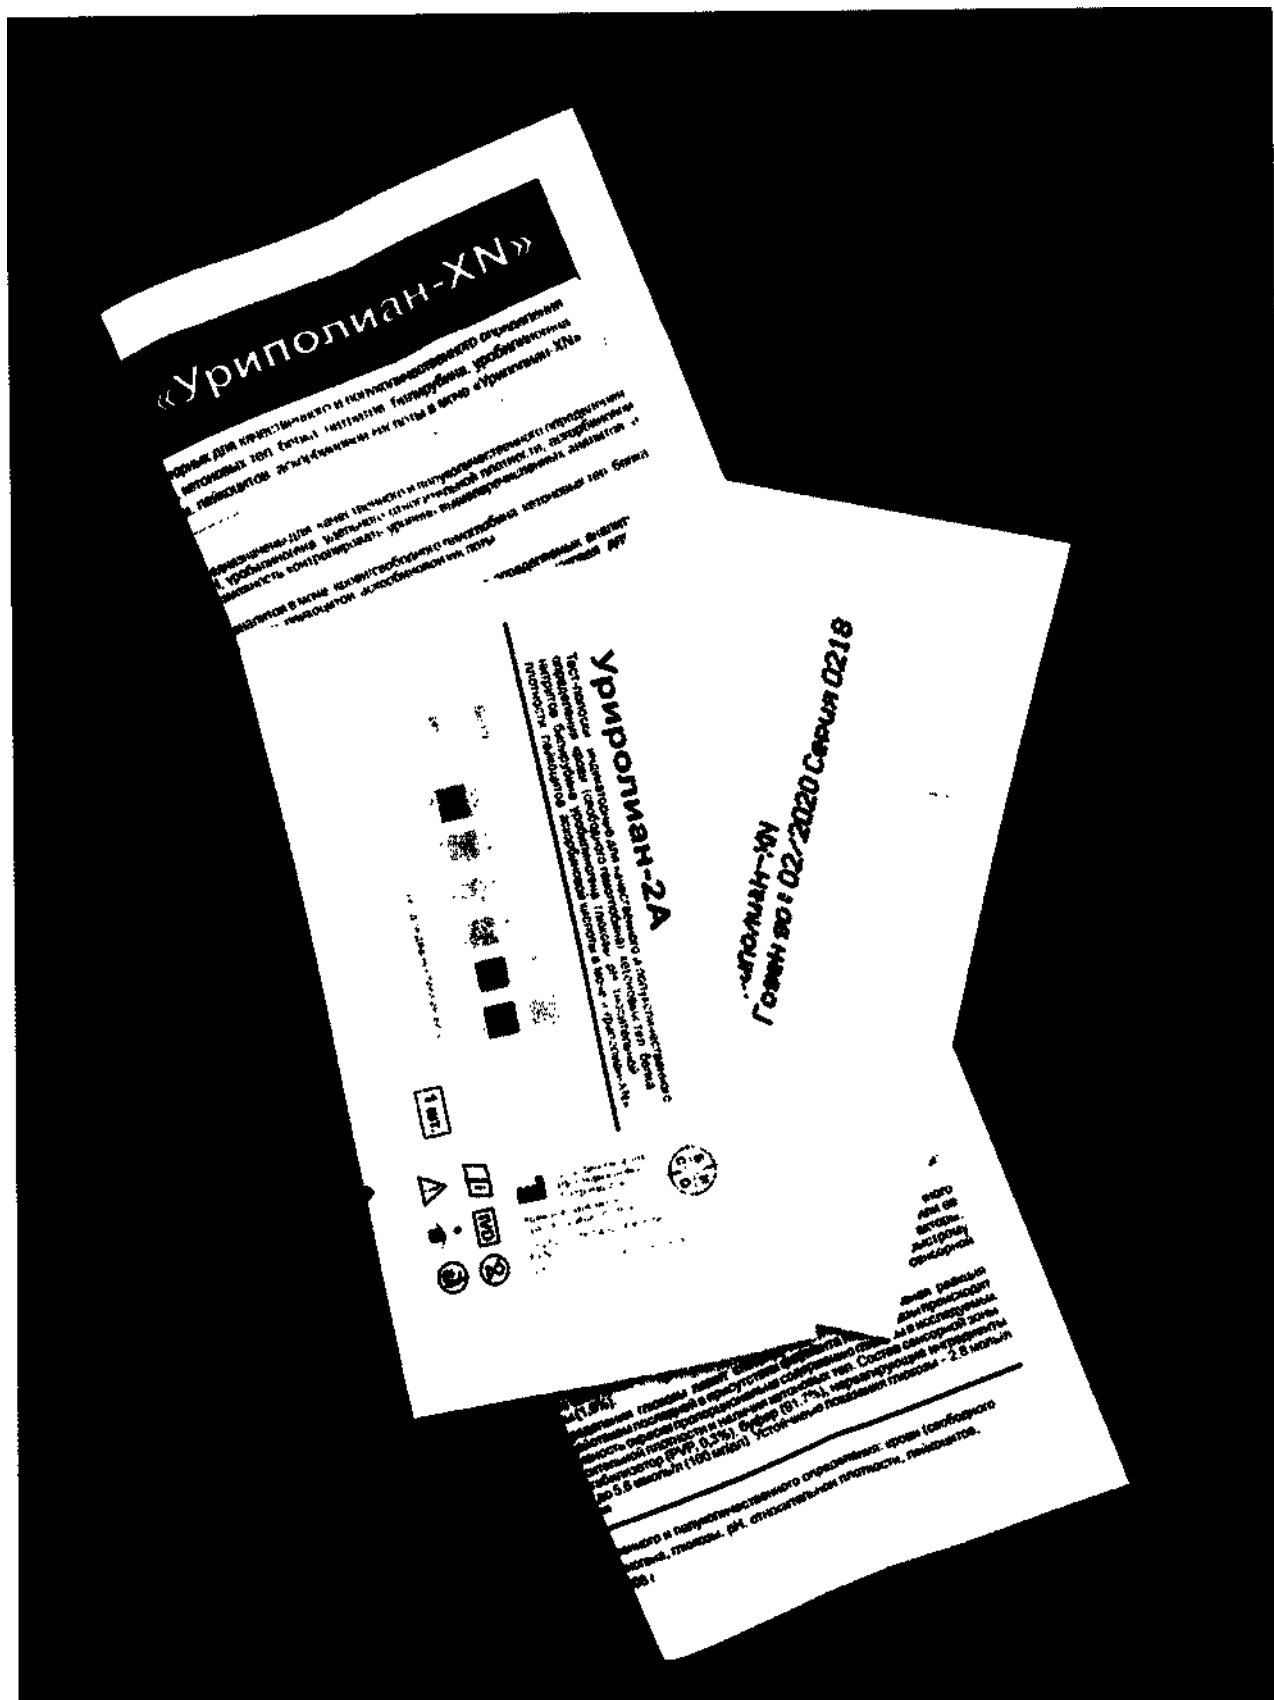


Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев


иан-2А

ые для качественного и полуколичественного
одного гемоглобина), кетоновых тел, белка,
обилиногена, глюкозы, pH, тносительной
скорбиновой кислоты в моче «Уриполиан-ХН»

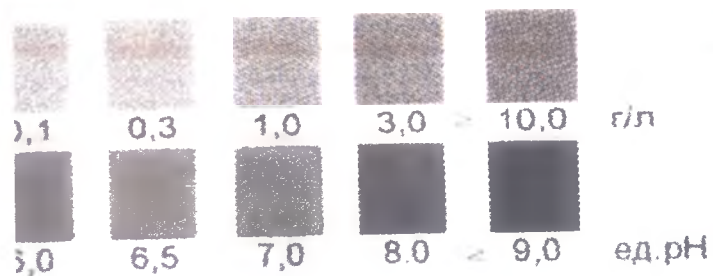

Только для диагностики ин витро

1 шт.

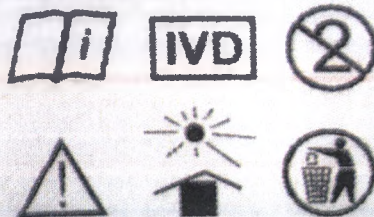

ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4

Хранить в сухом месте
при температуре от +10...+30°C

ТУ 21.20.23-007-45677786-2018


РУ №

Состав: тест-полоски, цвет. шкала, инструкция

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

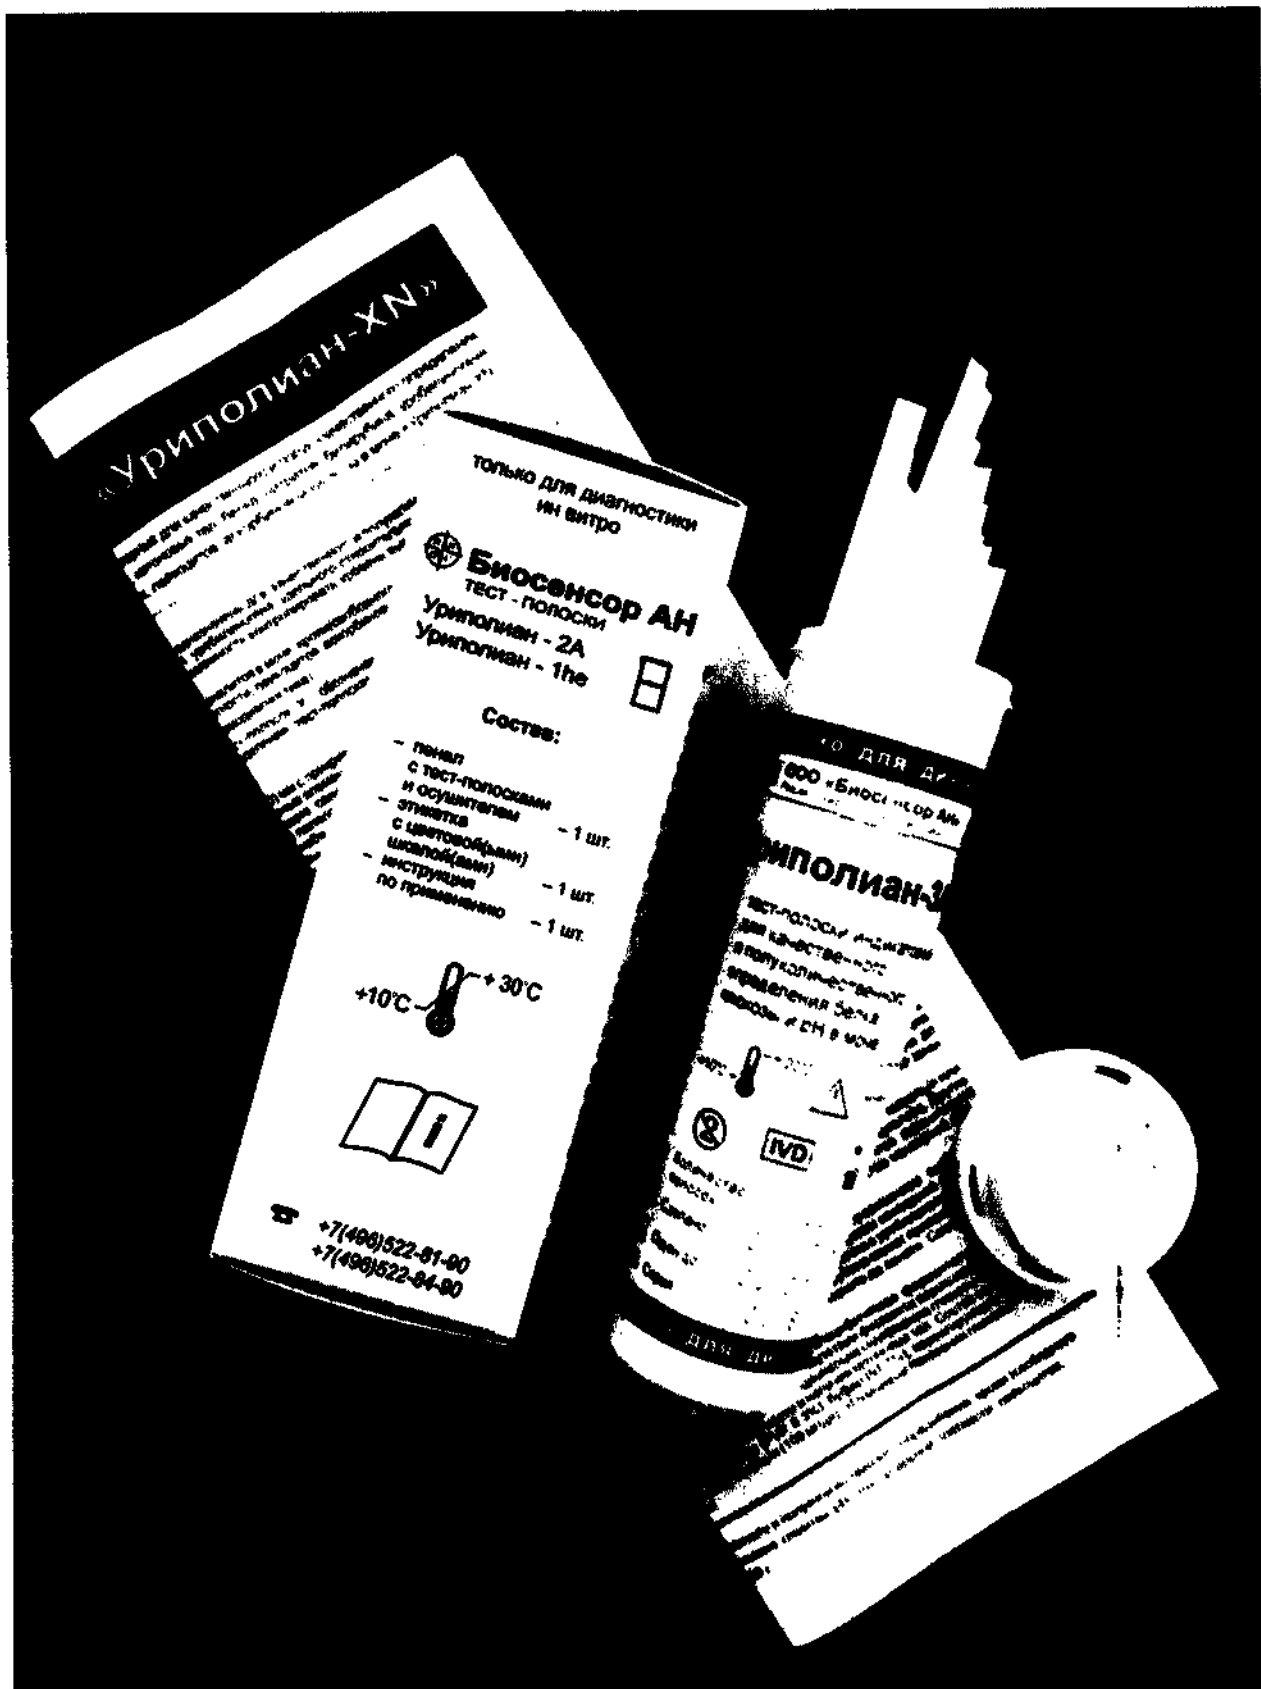

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Уриполиан-3А

Индикаторные для качественного и полуколичественного определения (свободного гемоглобина), кетоновых тел, белка, мочевой кислоты, уробилиногена, глюкозы, pH, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче «Уриполиан-ХН»

0,1	0,3	1,0	3,0	≥ 10,0	г/л
2,8	5,6	14,0	28,0	≥ 56,0	ммоль/л
50	100	250	500	≥ 1000	мг/дл
6,0	6,5	7,0	8,0	≥ 9,0	ед. pH

1 шт.

Только для диагностики ин витро



ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +10...+30°C

ТУ 21.23-007-45677786-2018

РУ №

Состав: тест-полоски, цвет. шкала, инструкция



Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

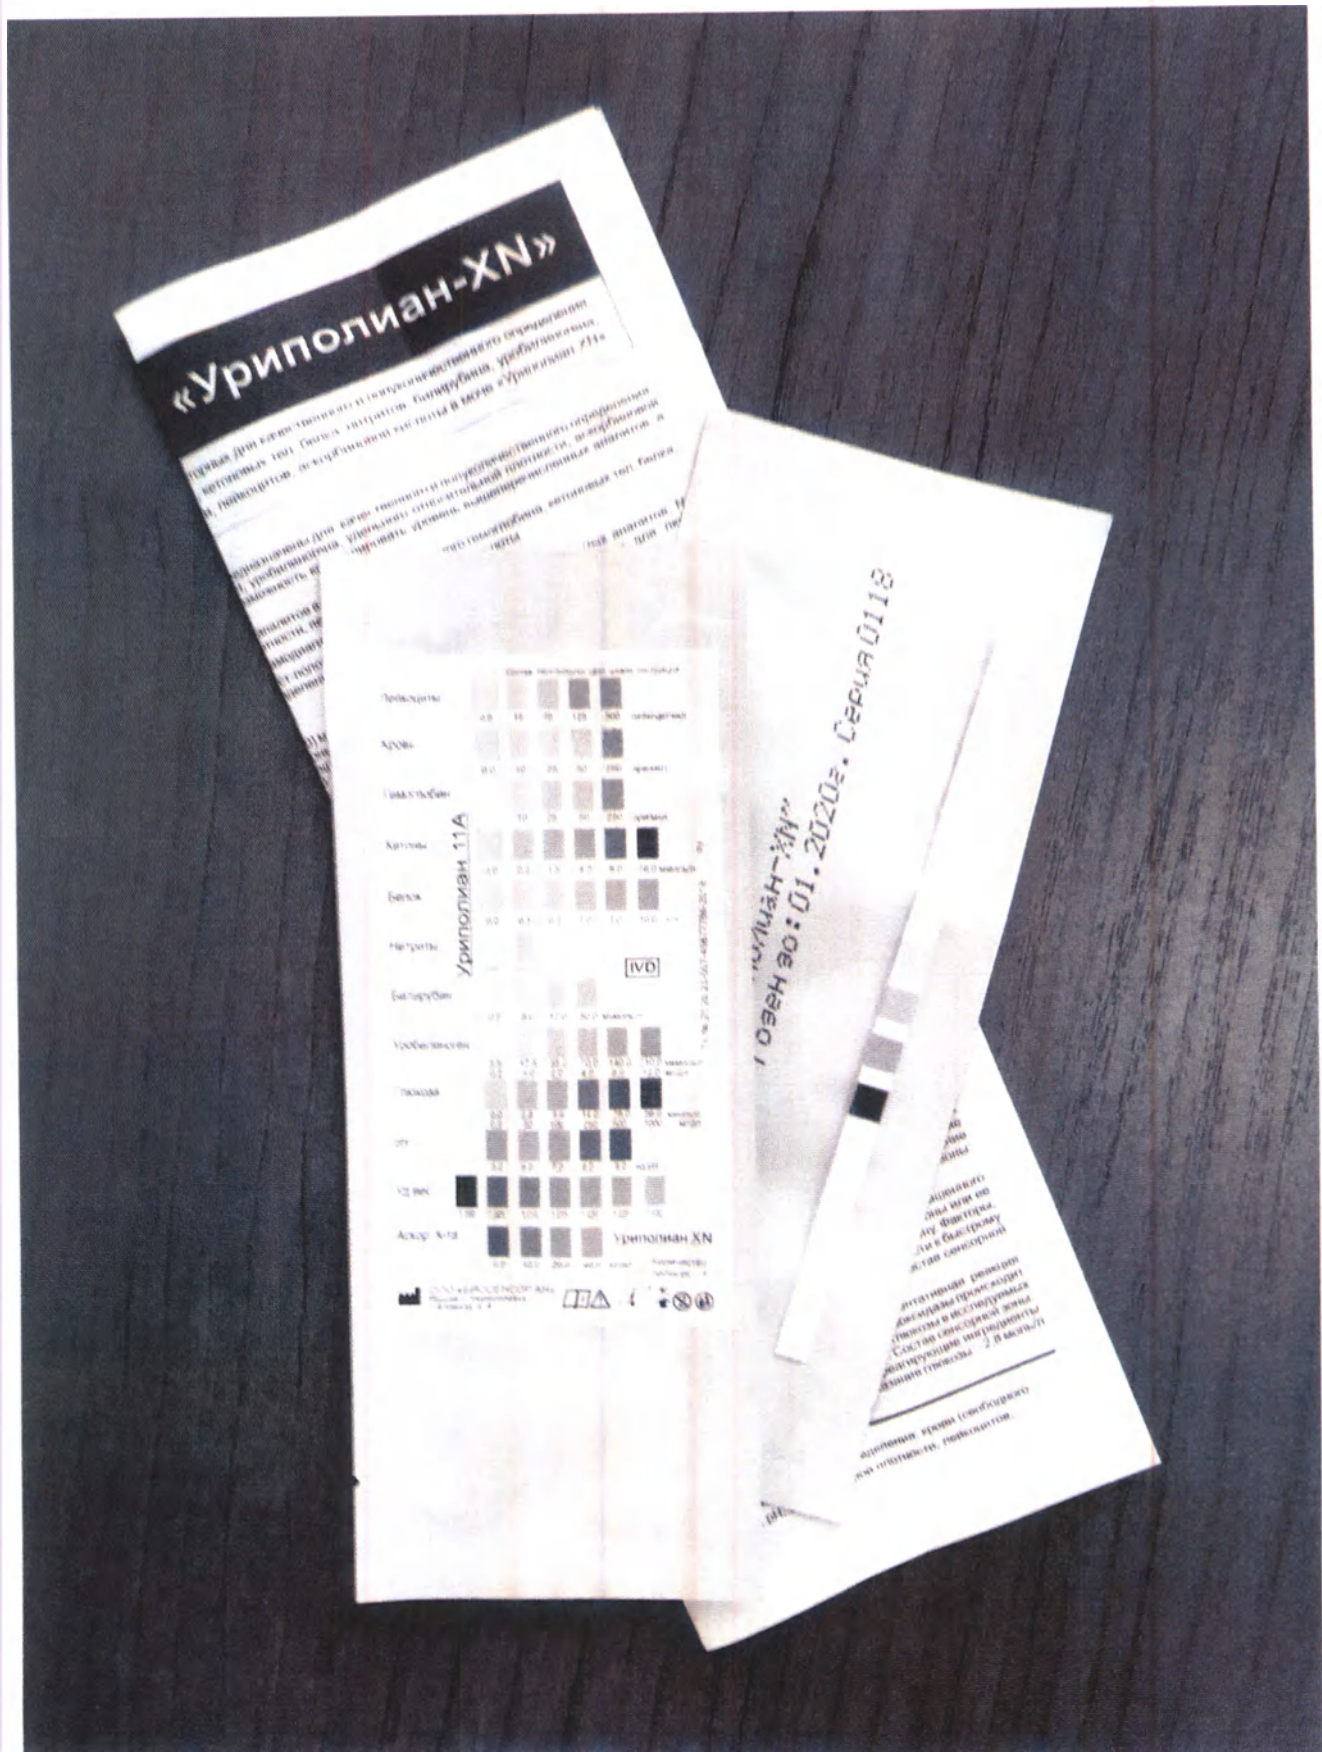

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

качество...
удельного отно...
повышать уровень выш...

гемоглобина, кето...

эритроцитов, N...

Состав: тест-полоски, цвет. шкала, инструкция

Уриполиан 11А

Лейкоциты	0.0	15	70	125	500	лейкоцит/мкл
Кровь	0.0	10	25	50	250	эри/мкл
Гемоглобин		10	25	50	250	эри/мкл
Кетоны	0.0	0.5	1.5	4.0	8.0	16.0 ммоль/л
Белок	0.0	0.1	0.3	1.0	3.0	10.0 г/л
Нитриты	нег.	поз.				
Билирубин	0.0	9.0	17.0	50.0		ммоль/л
Уробилиноген	3.5	17.5	35.0	70.0	140.0	210.0 ммоль/л
Глюкоза	0.2	1.0	2.0	4.0	8.0	12.0 мг/дл


IVD

ТУ № 21.20.23-007-45677786-2018

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

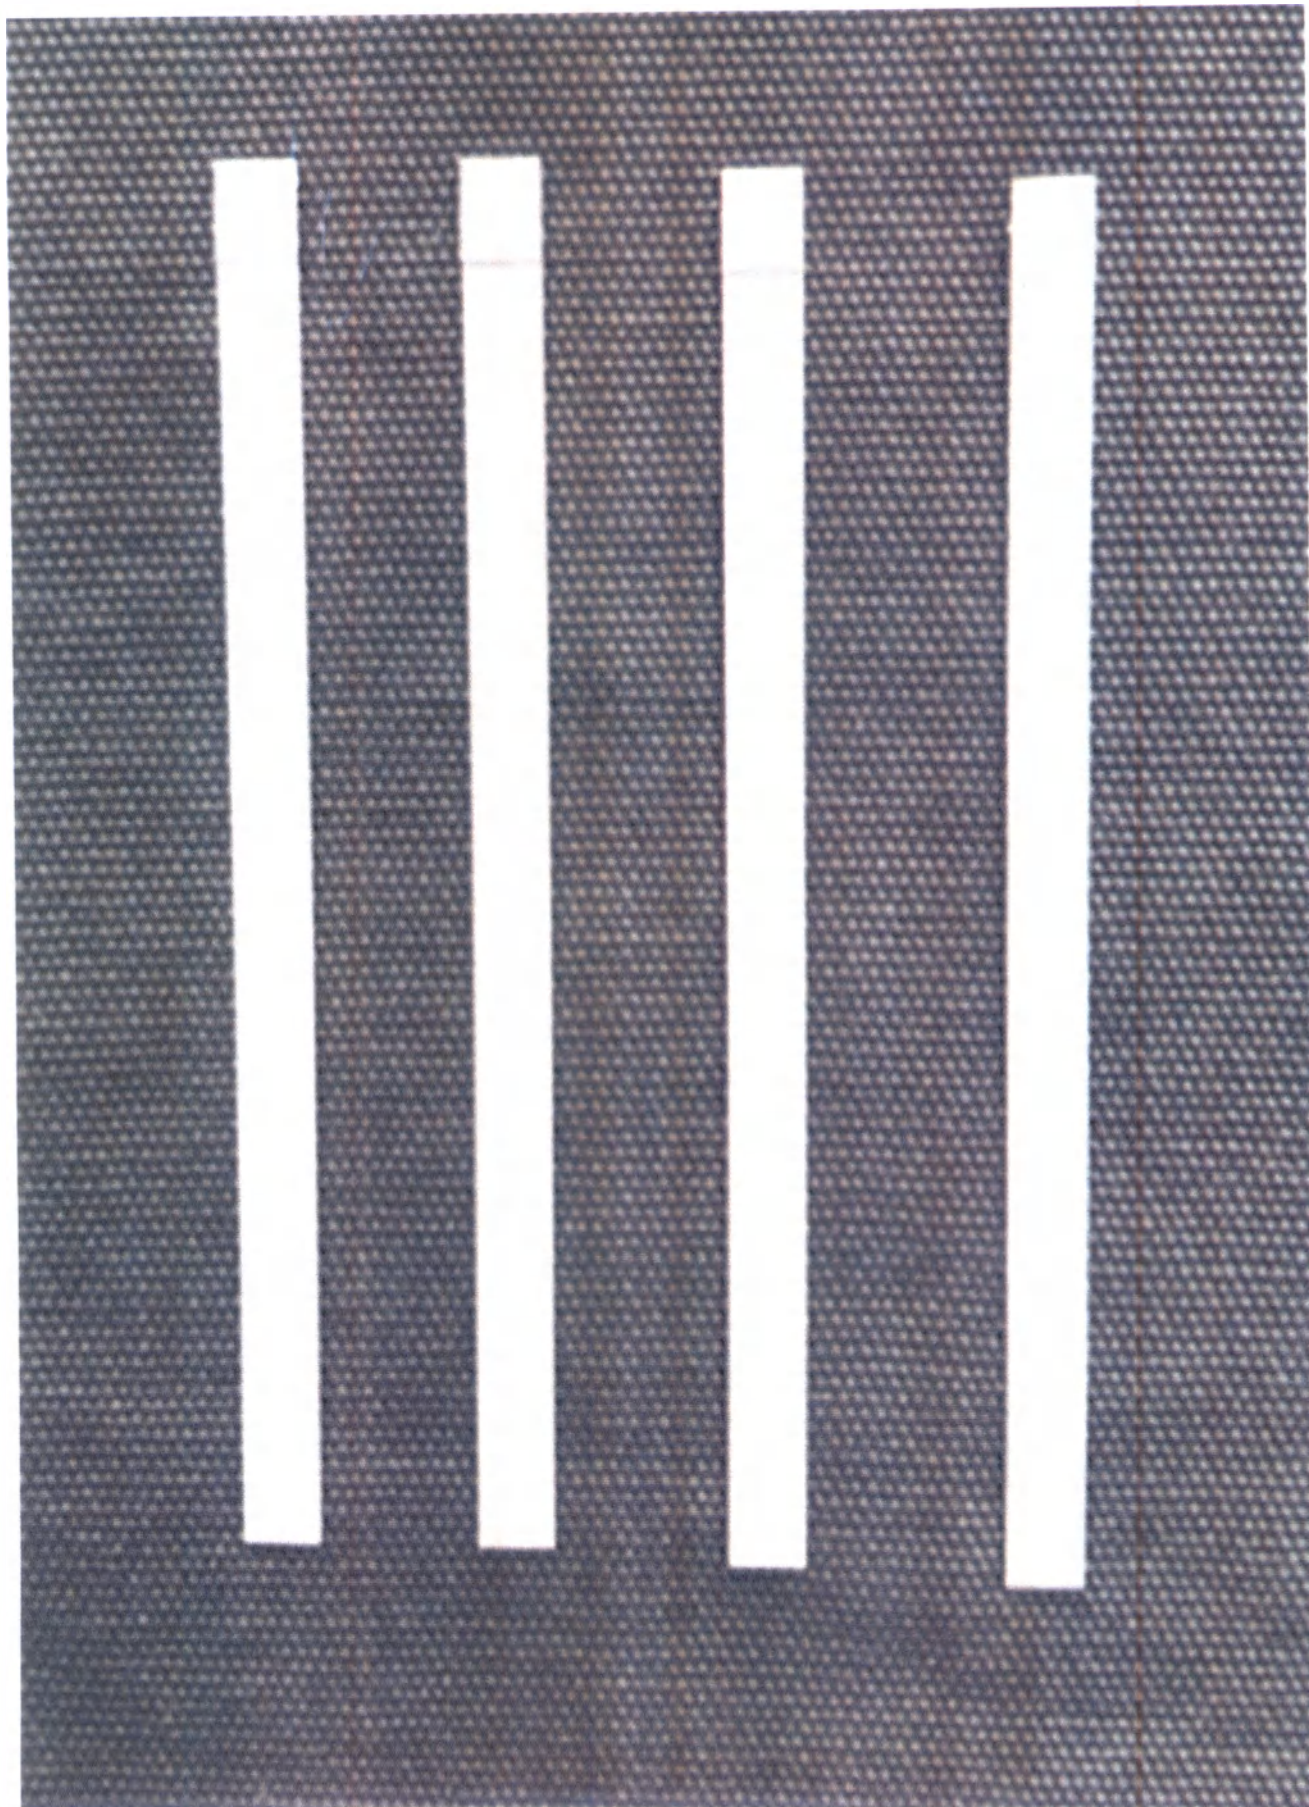

Директор ООО «Биосенсор АН»


А.Р. Гвоздев

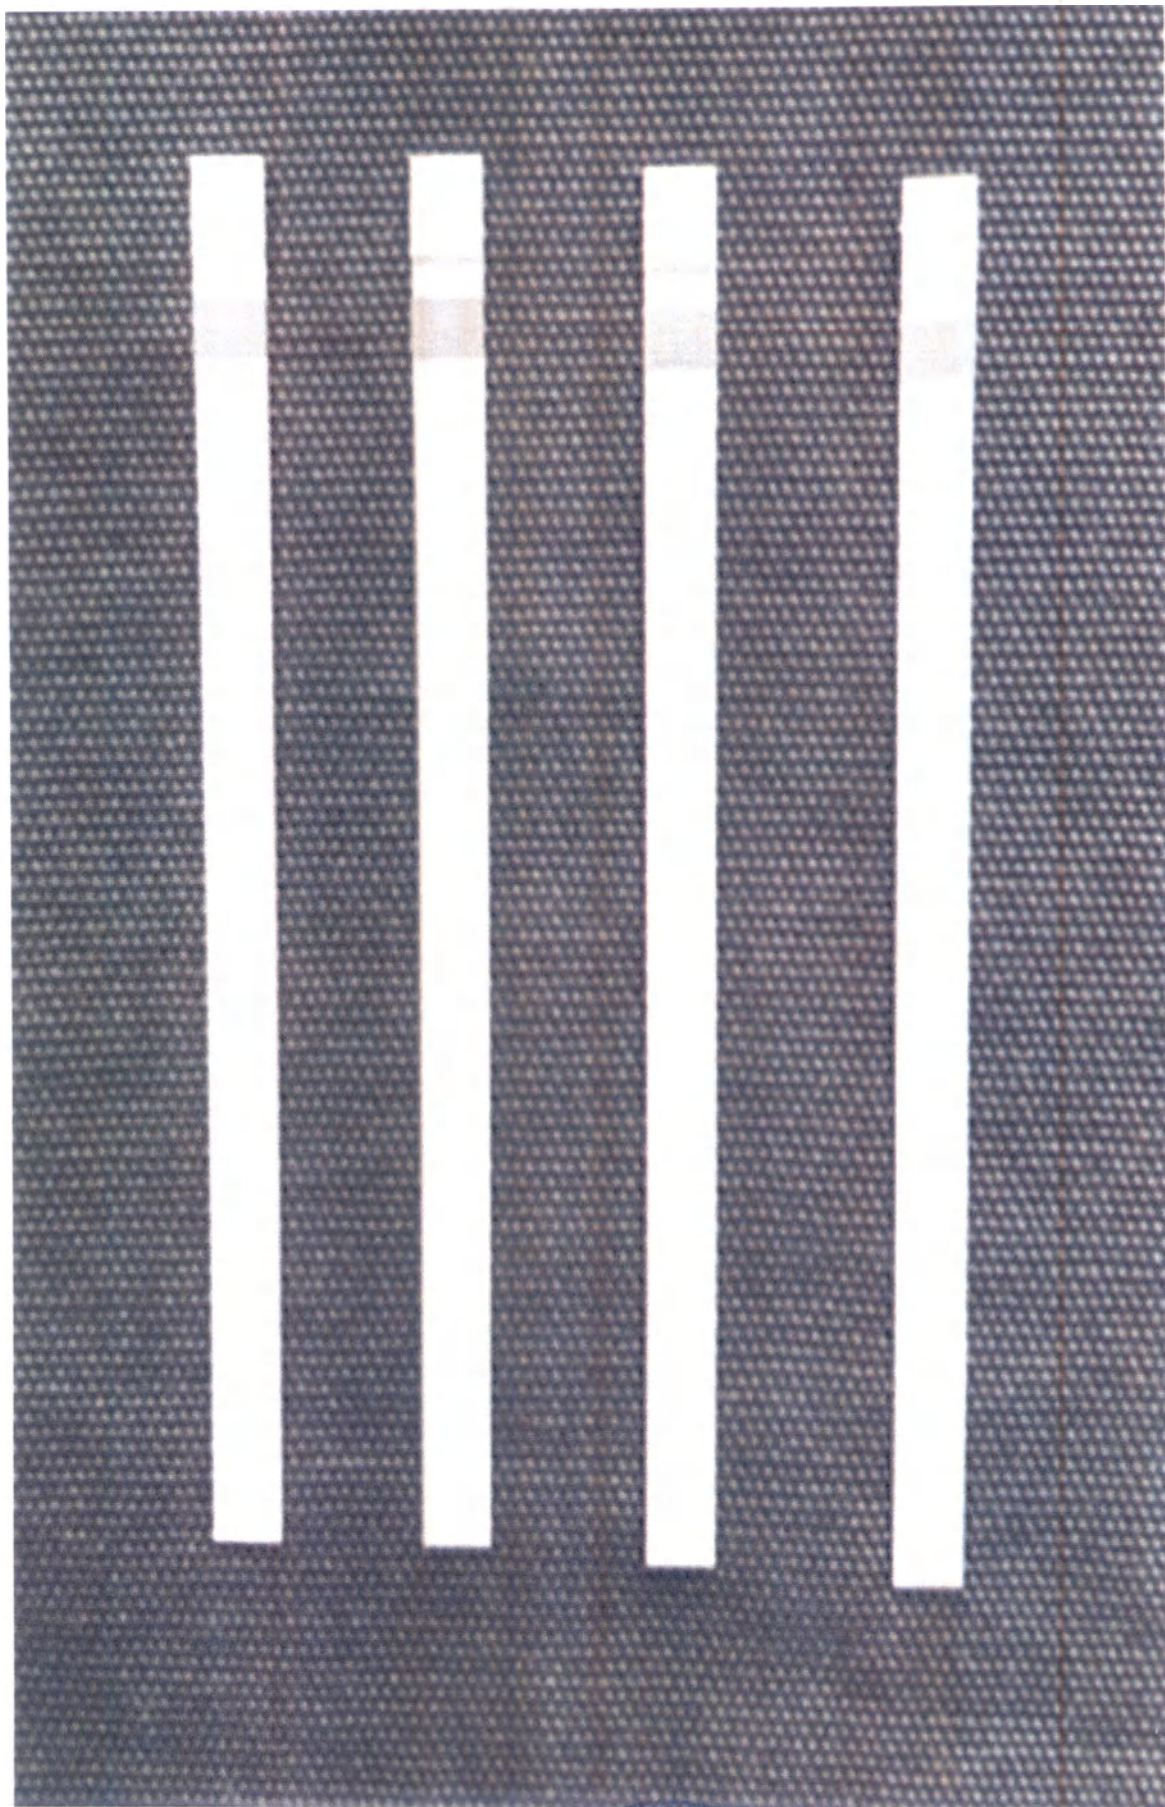

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

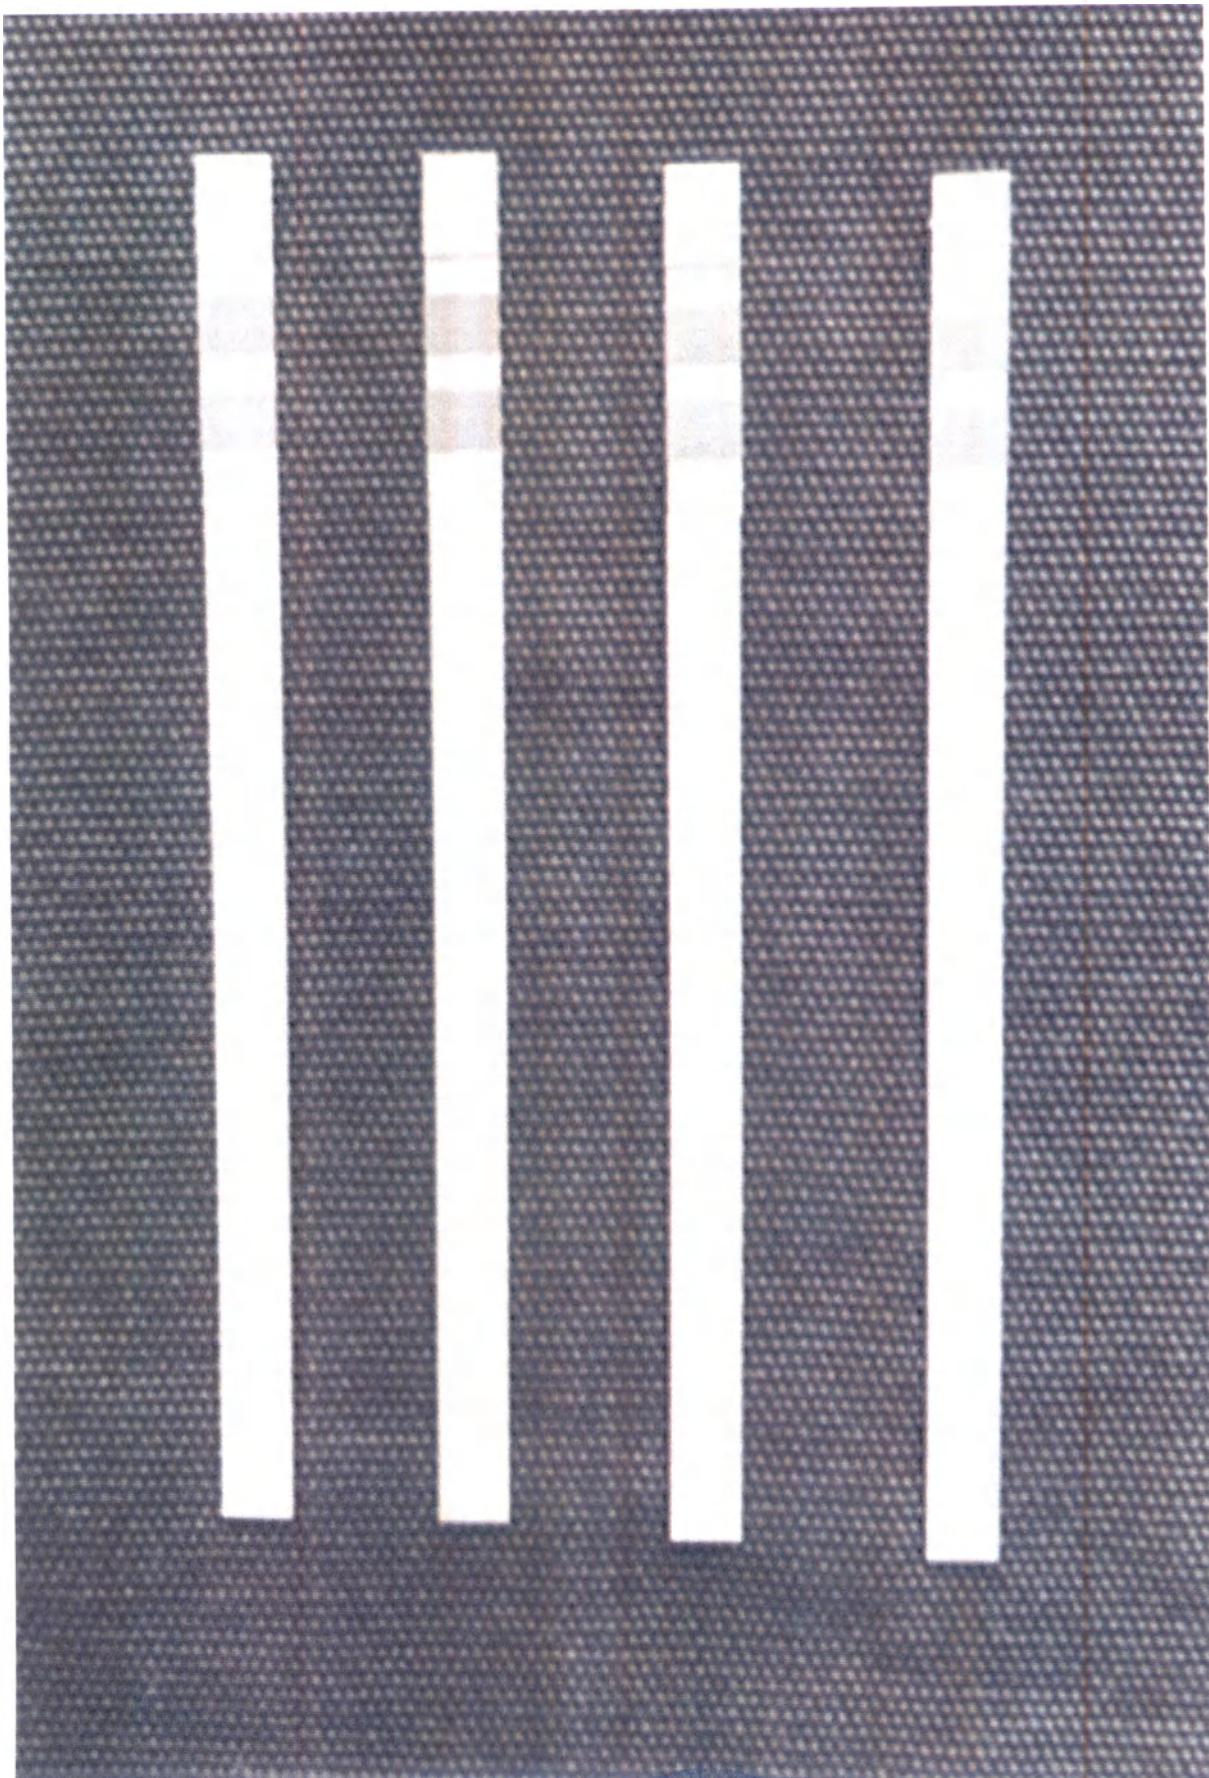

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

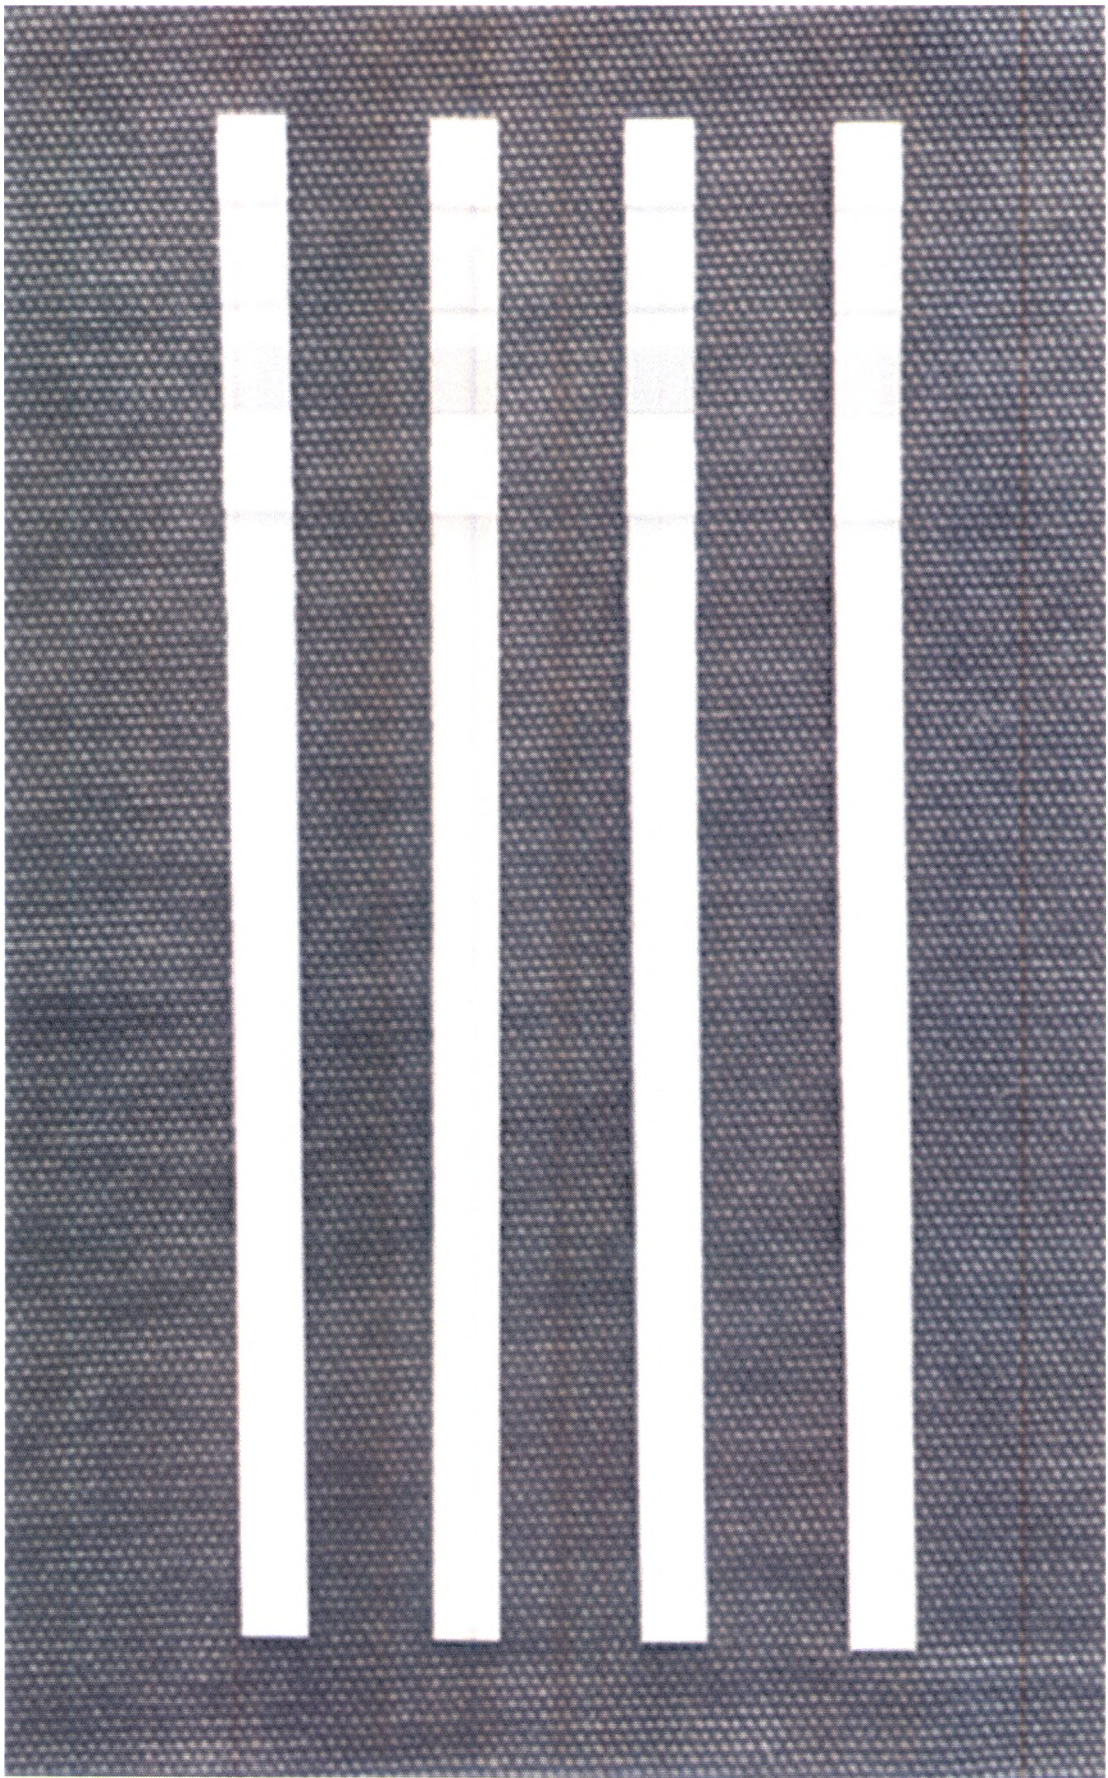

Директор ООО «Биосенсор АН»


А.Р. Гвоздев

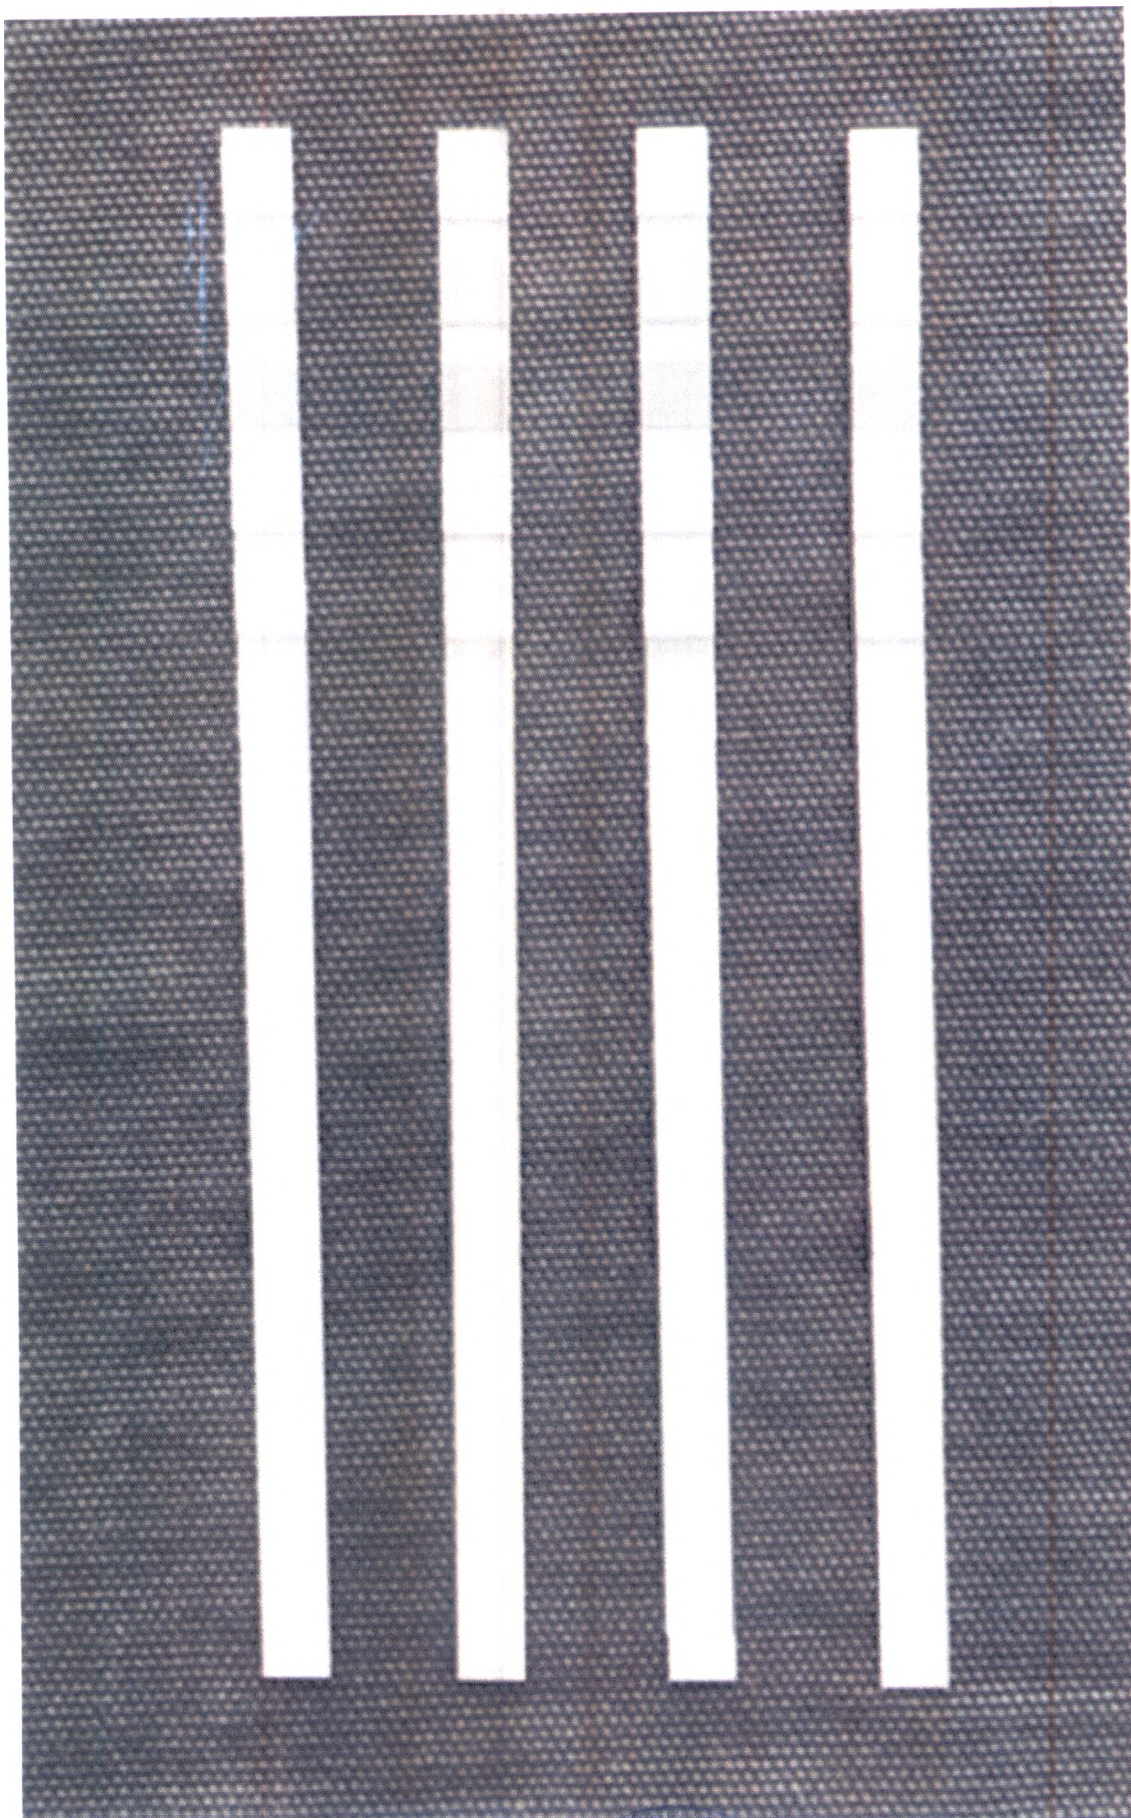

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

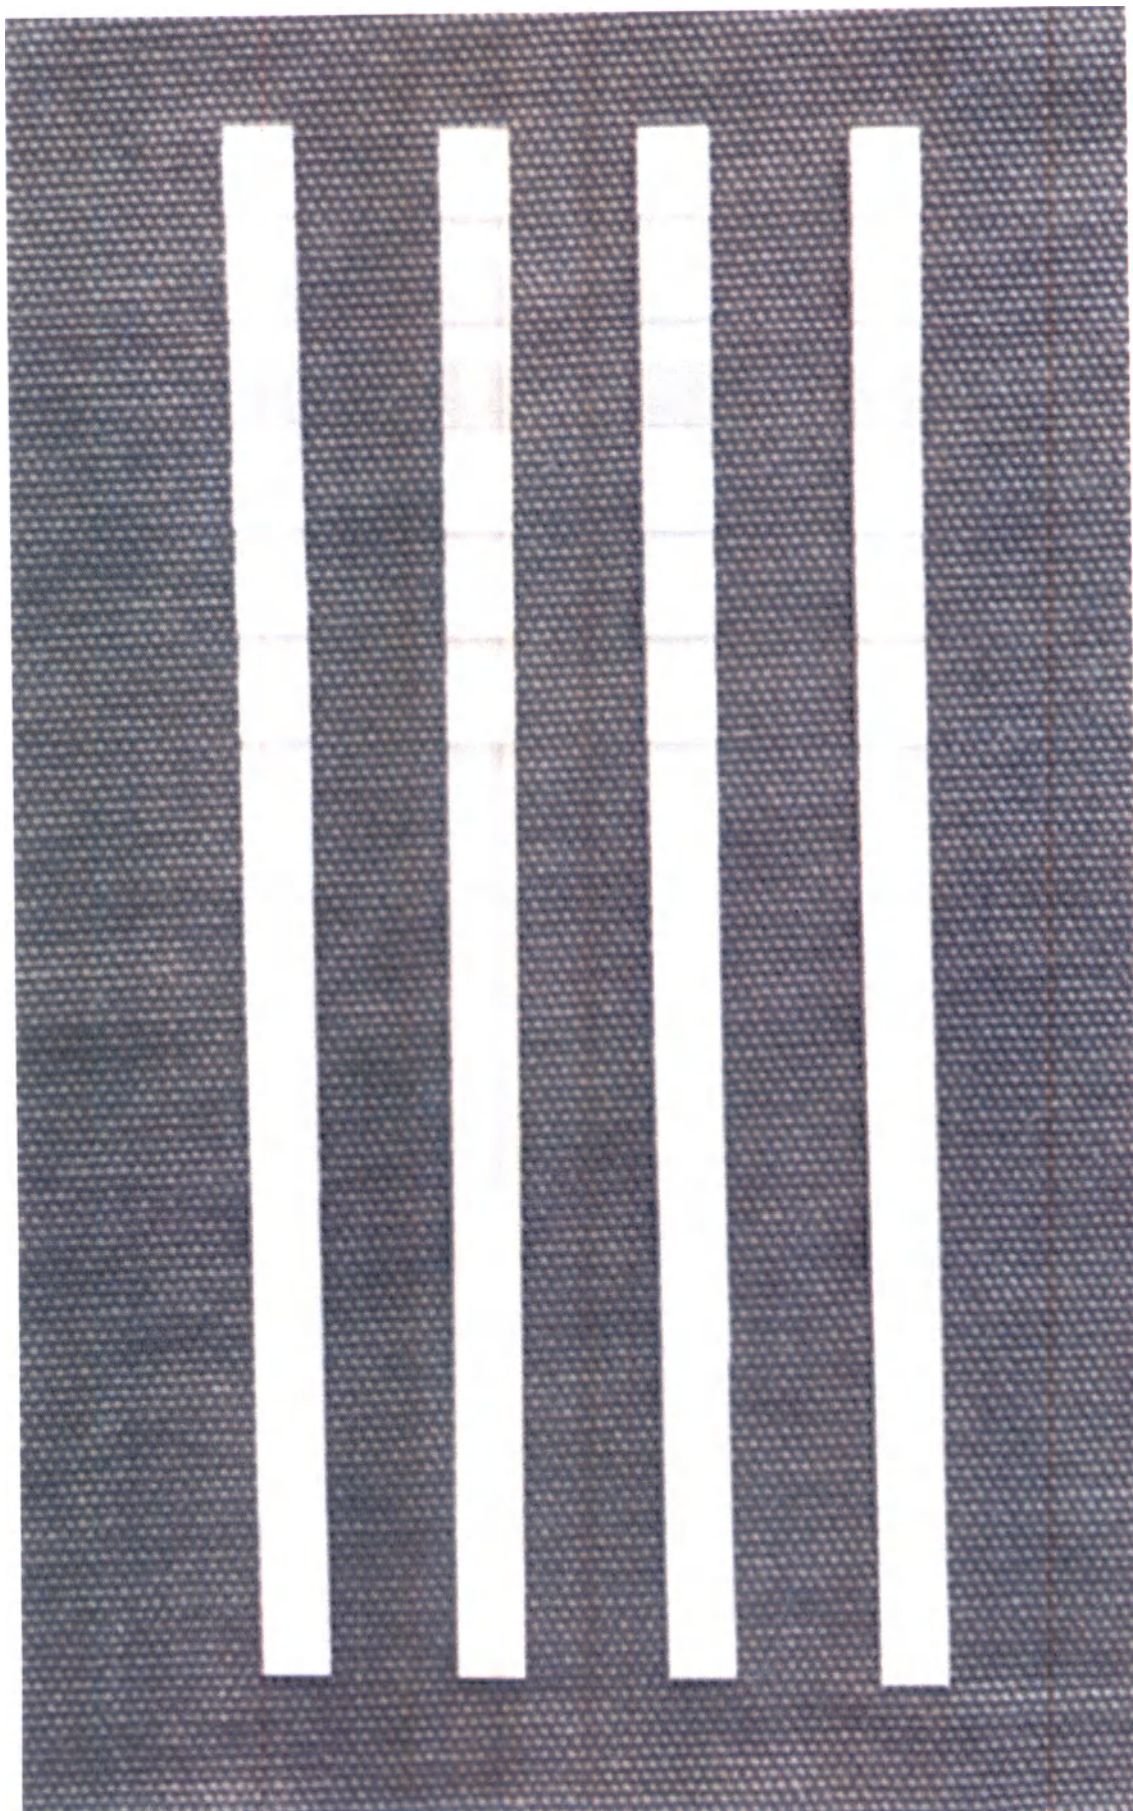

Директор ООО «Биосенсор АН»


А.Р. Гвоздев

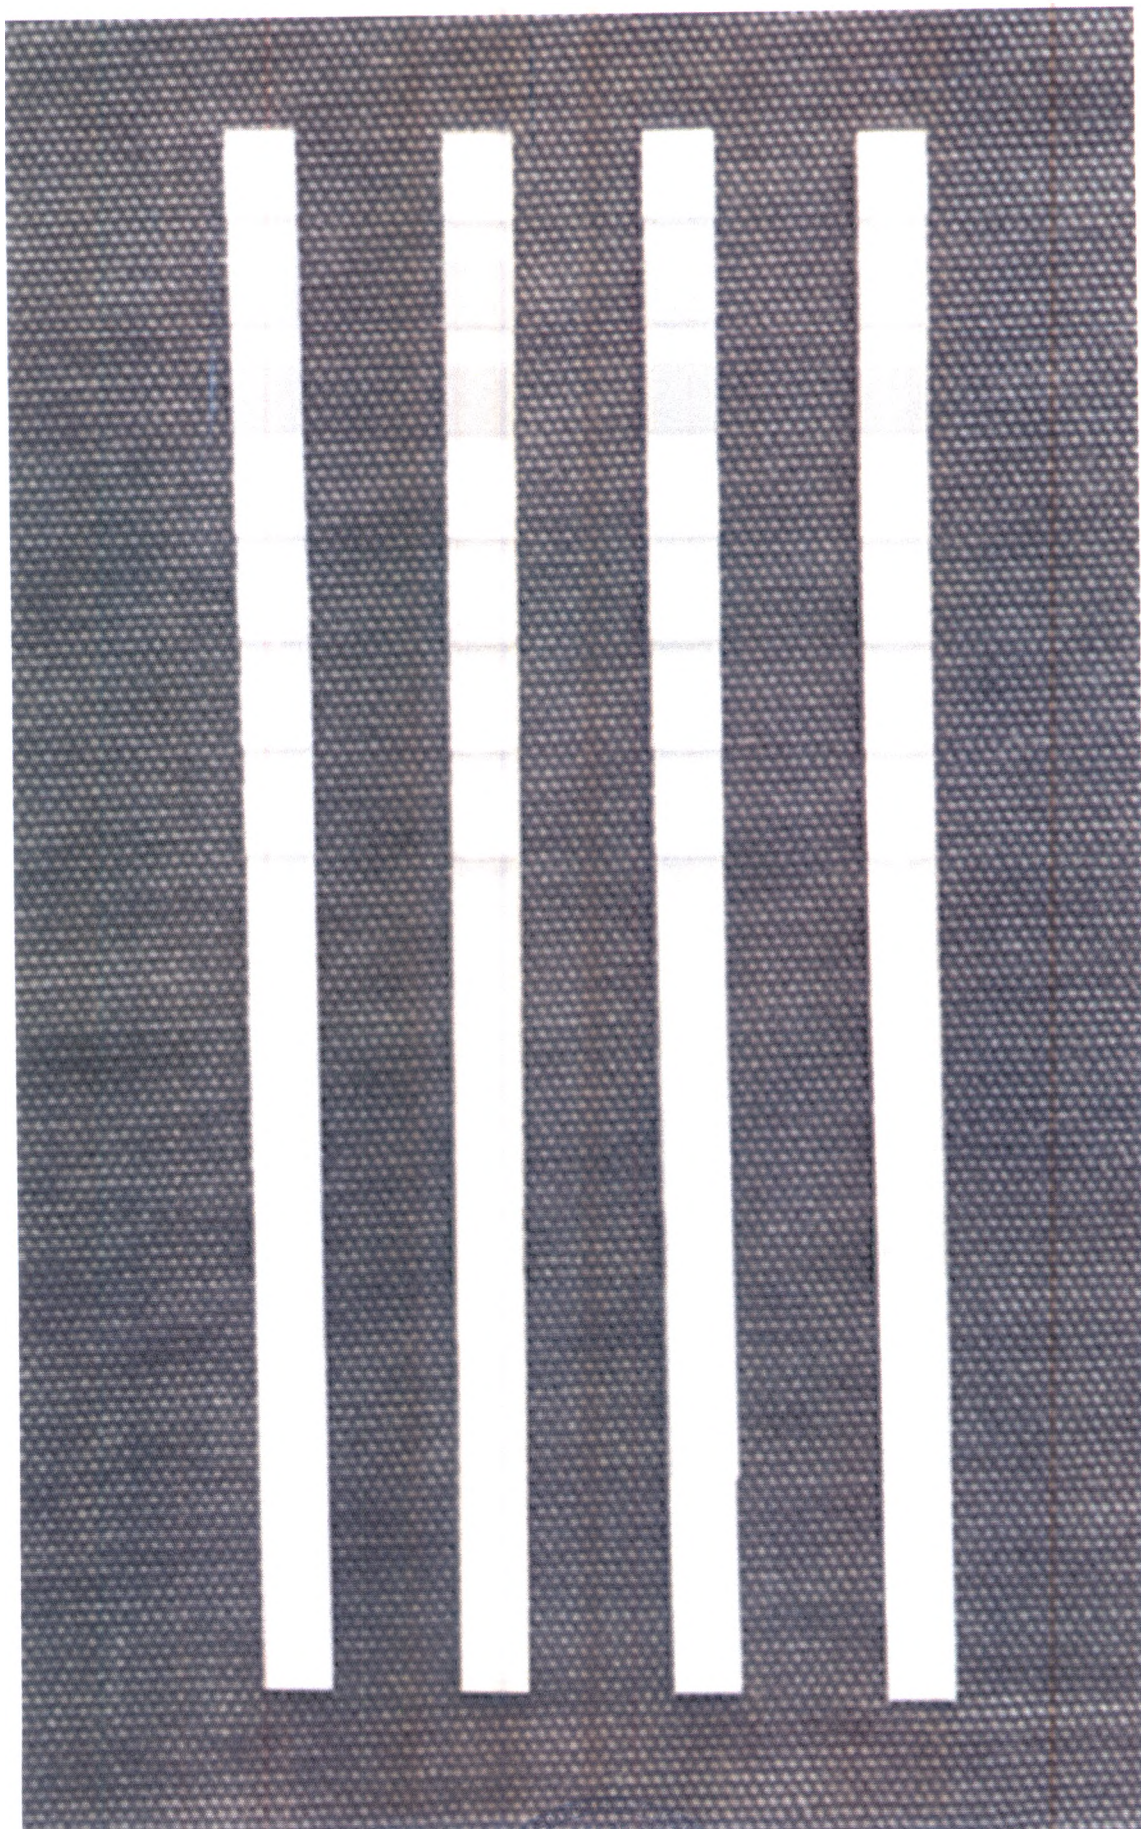


Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

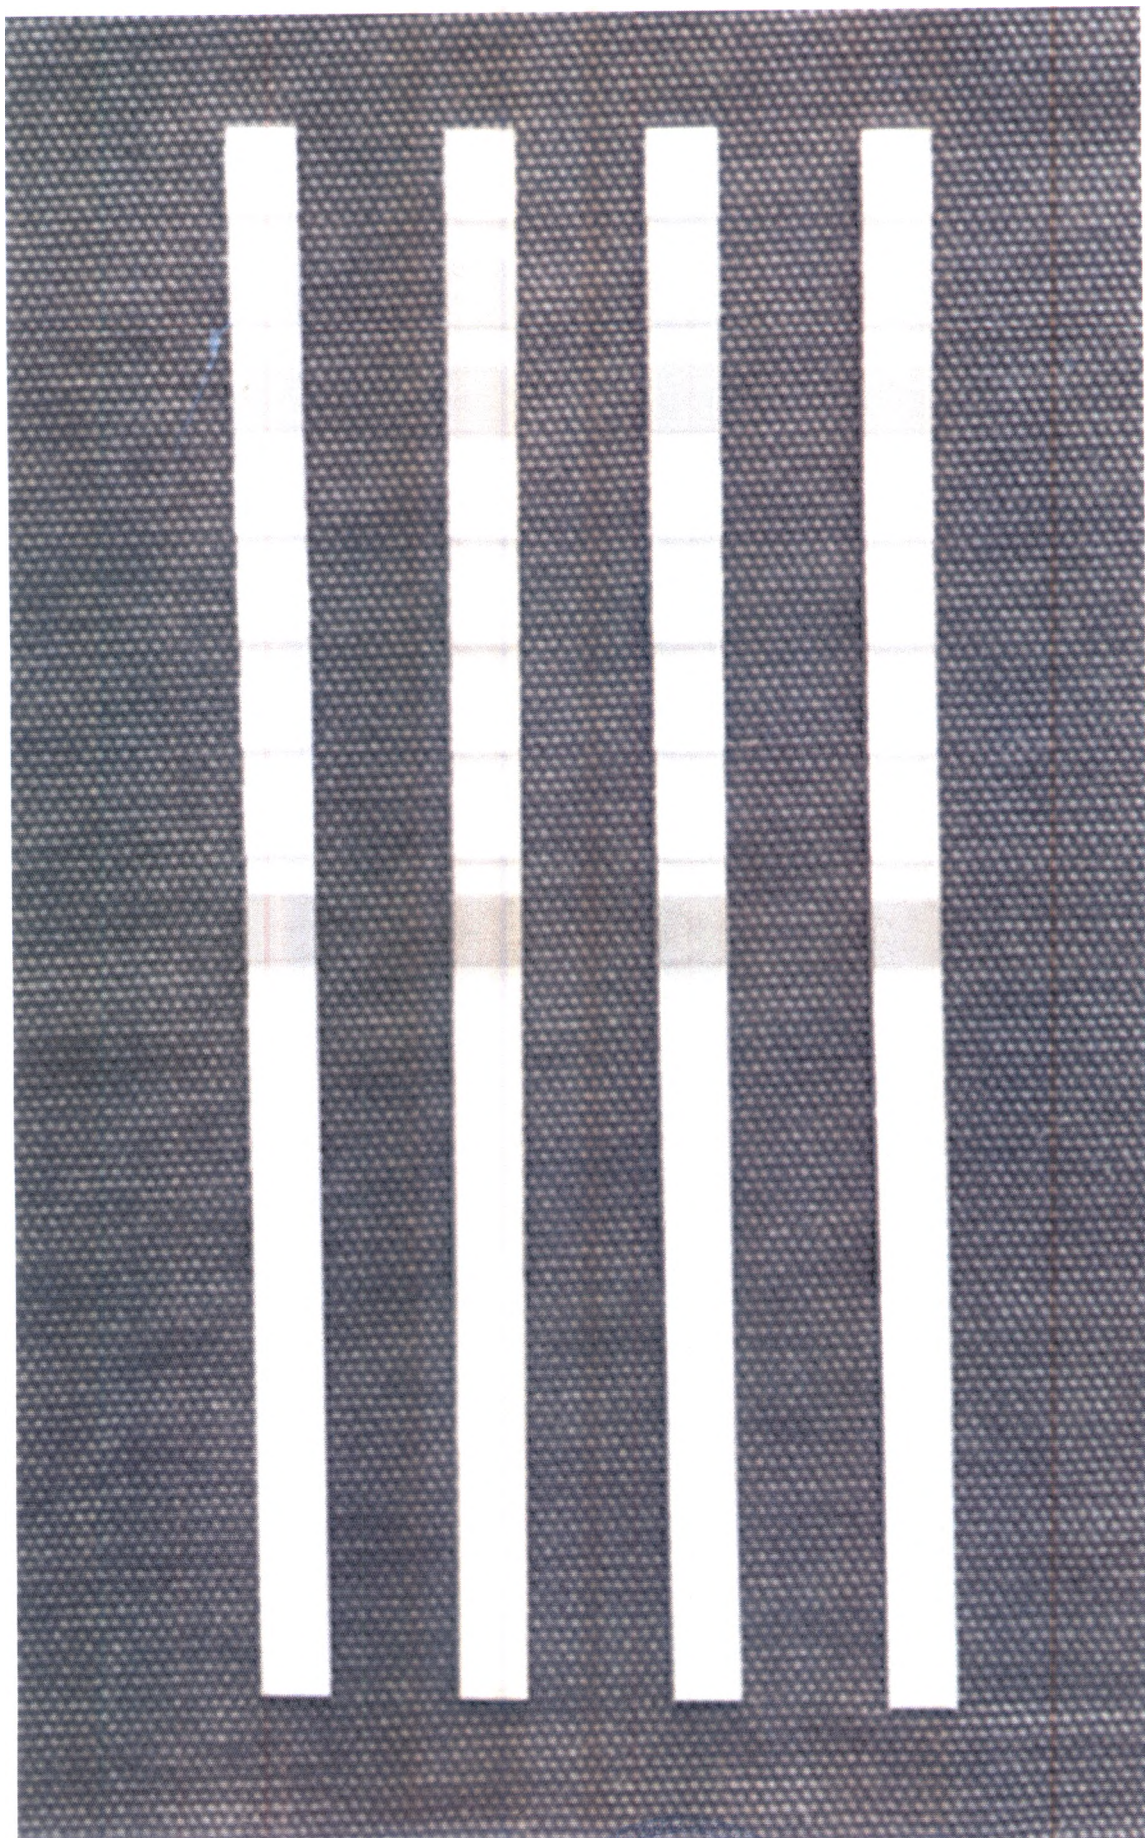

Директор ООО «Биосенсор АН»

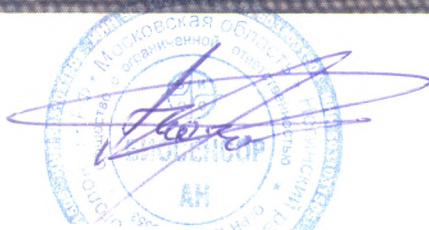


А.Р. Гвоздев

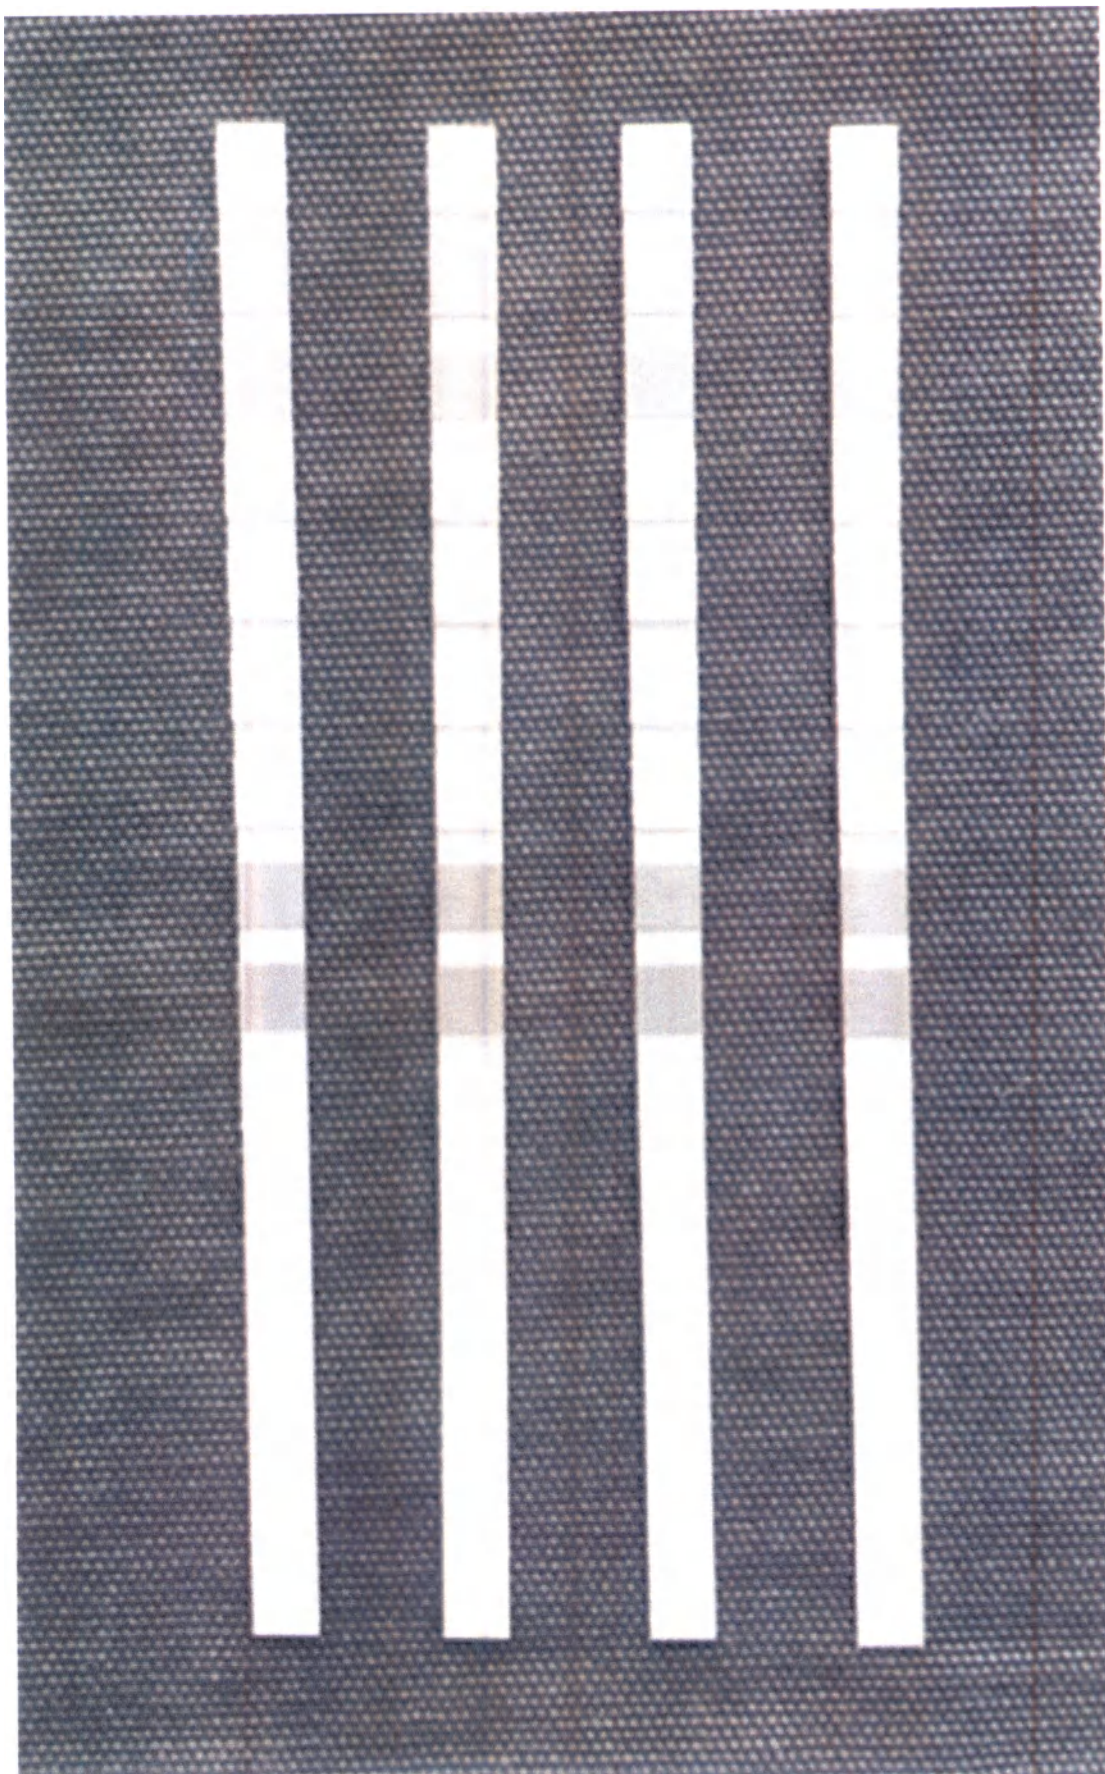

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

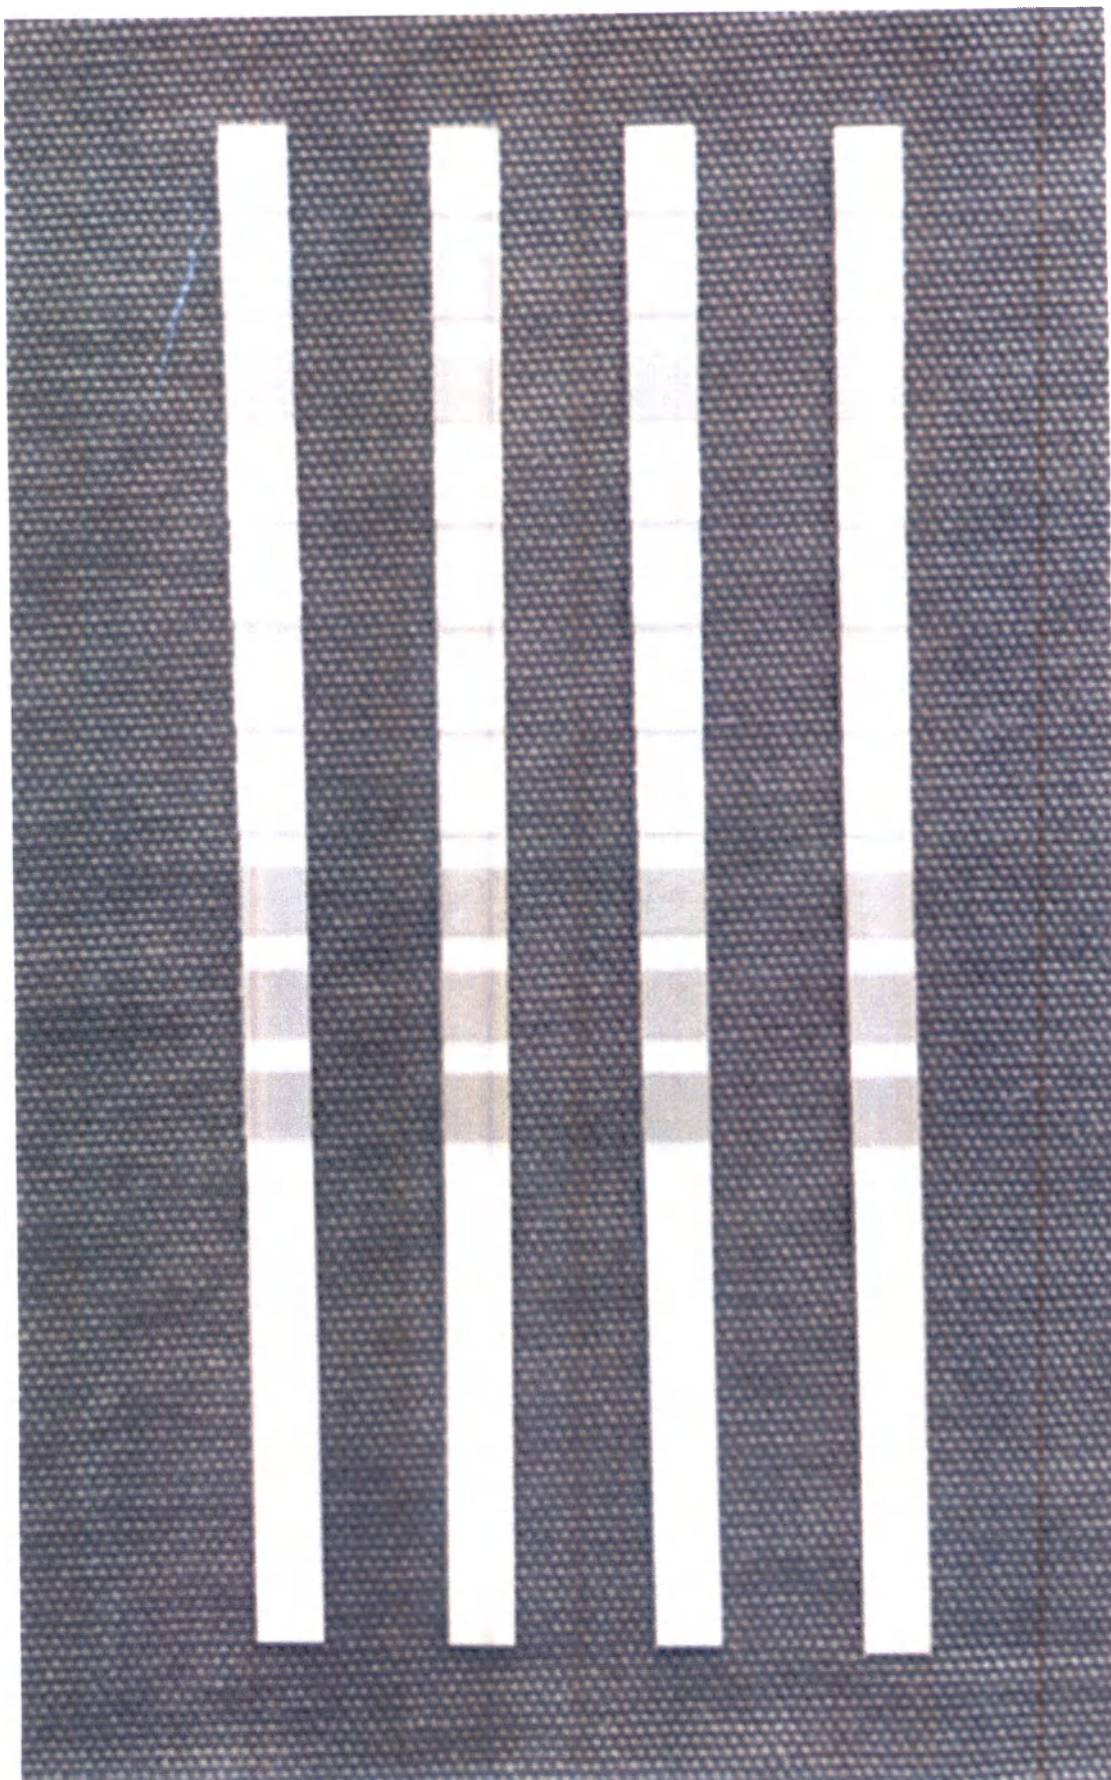

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

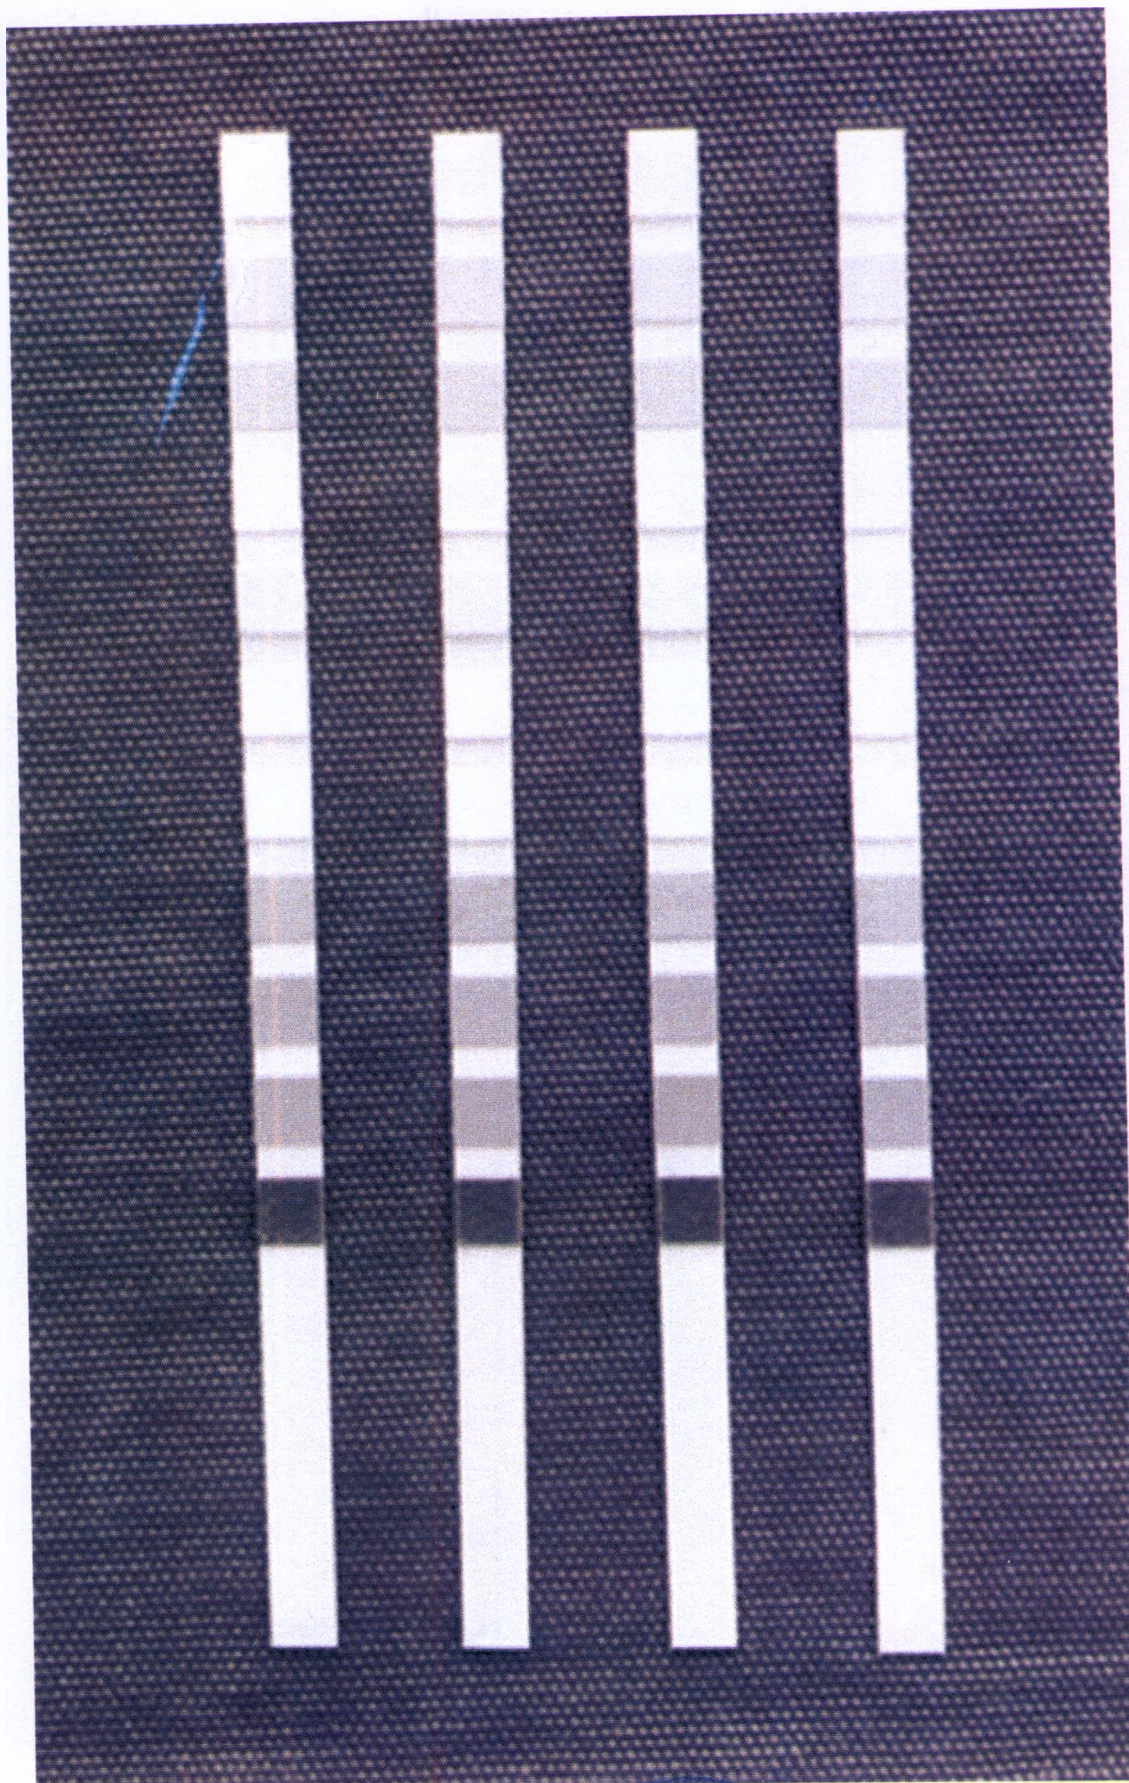

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Сиренко 20 июля
Оур. ООО "Биосенсор АН"

Полковник

