

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор ООО «Биосенсор АН»


 Гвоздев А.Р.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения белка в моче УРИБЕЛ

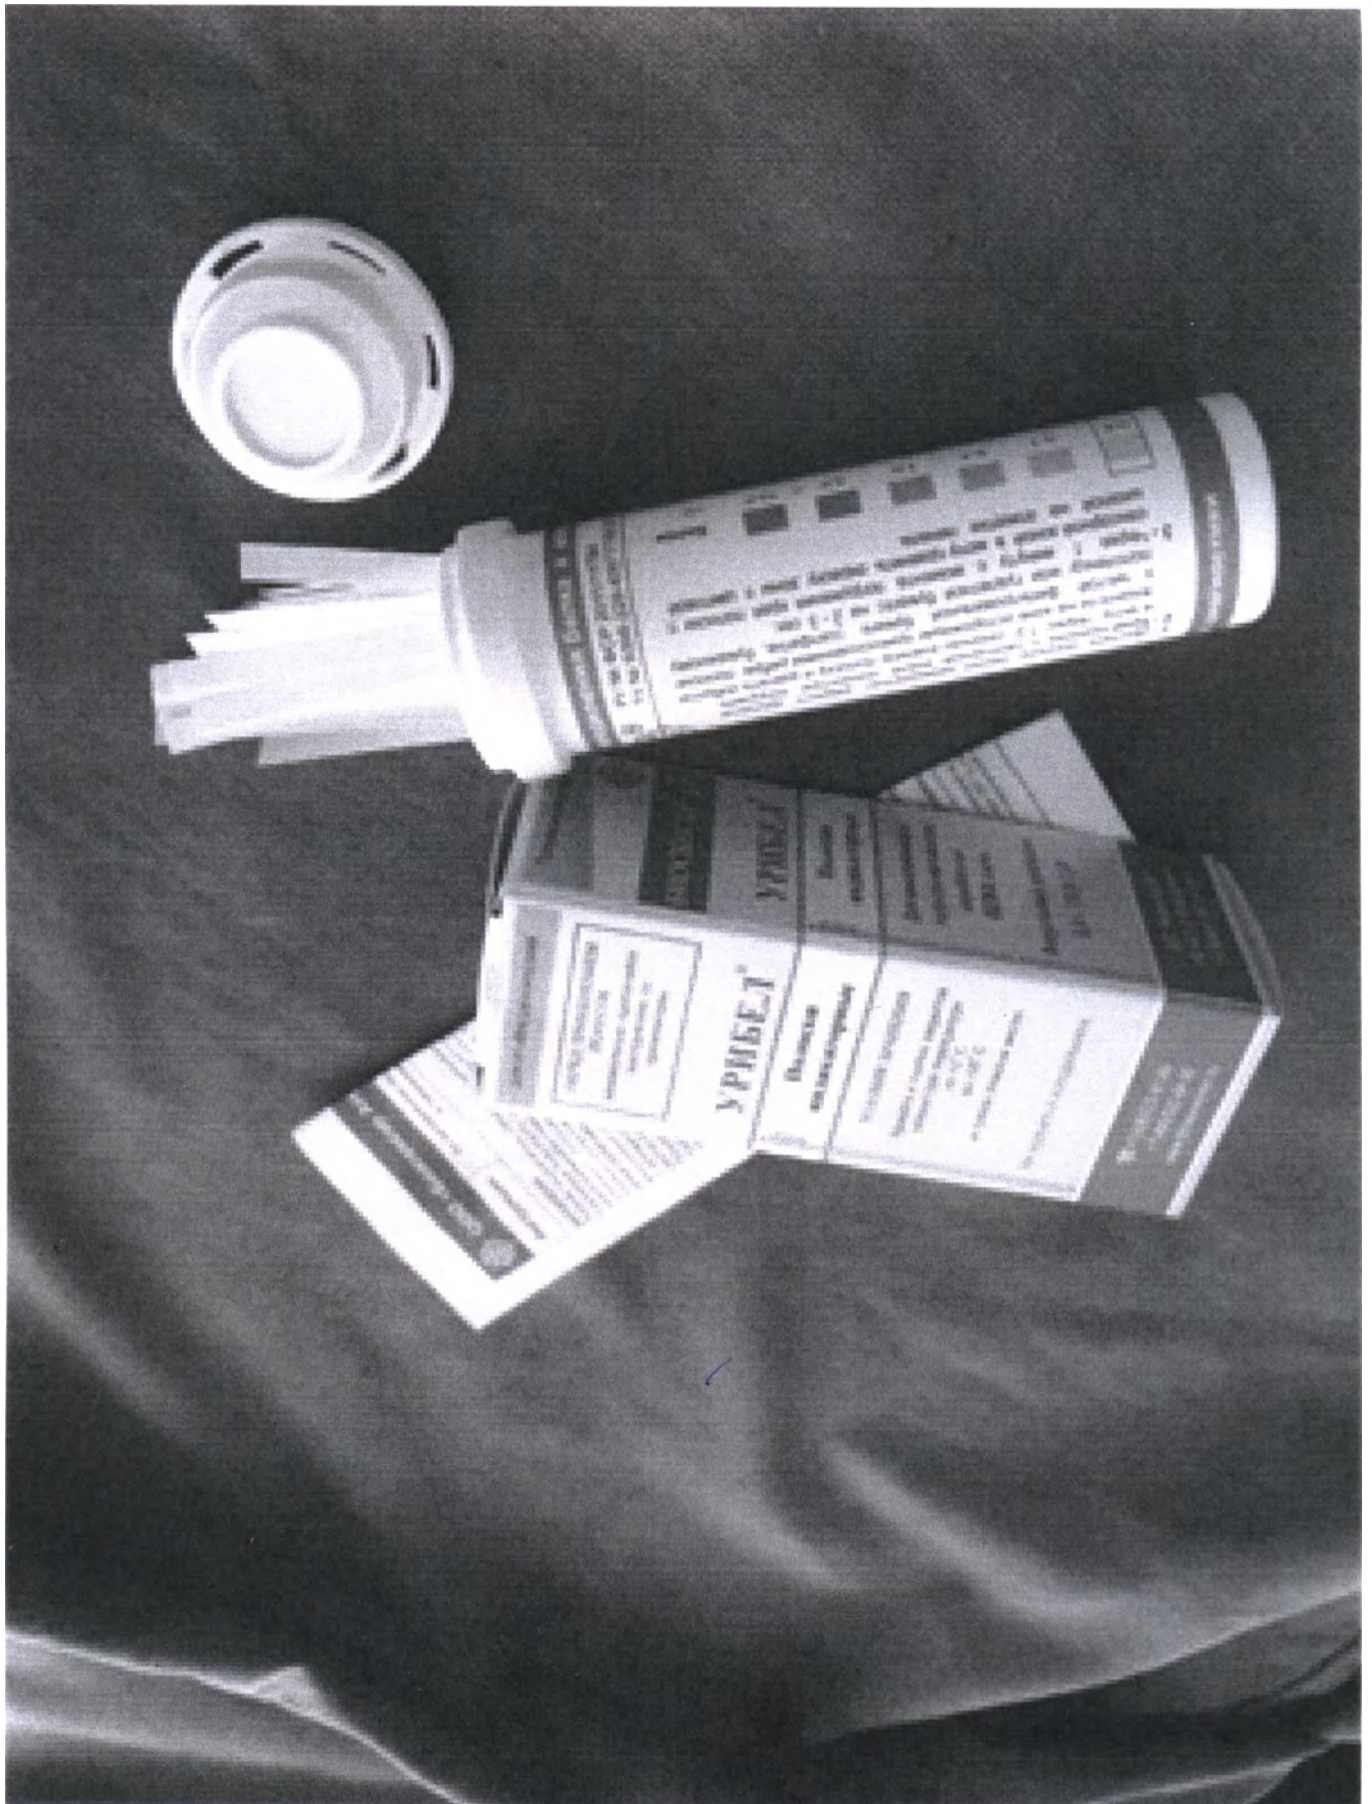

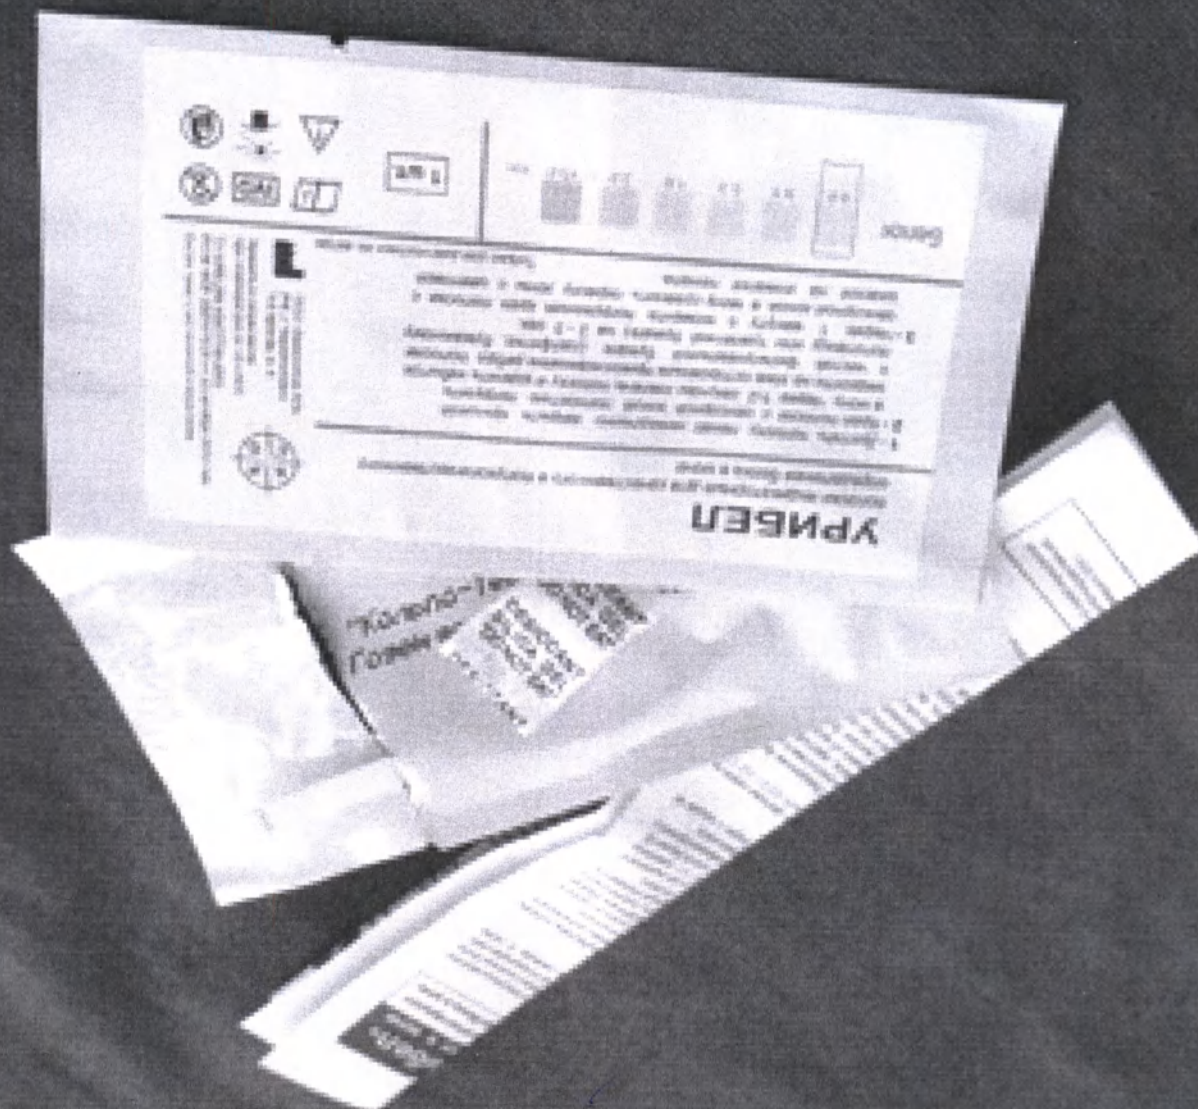

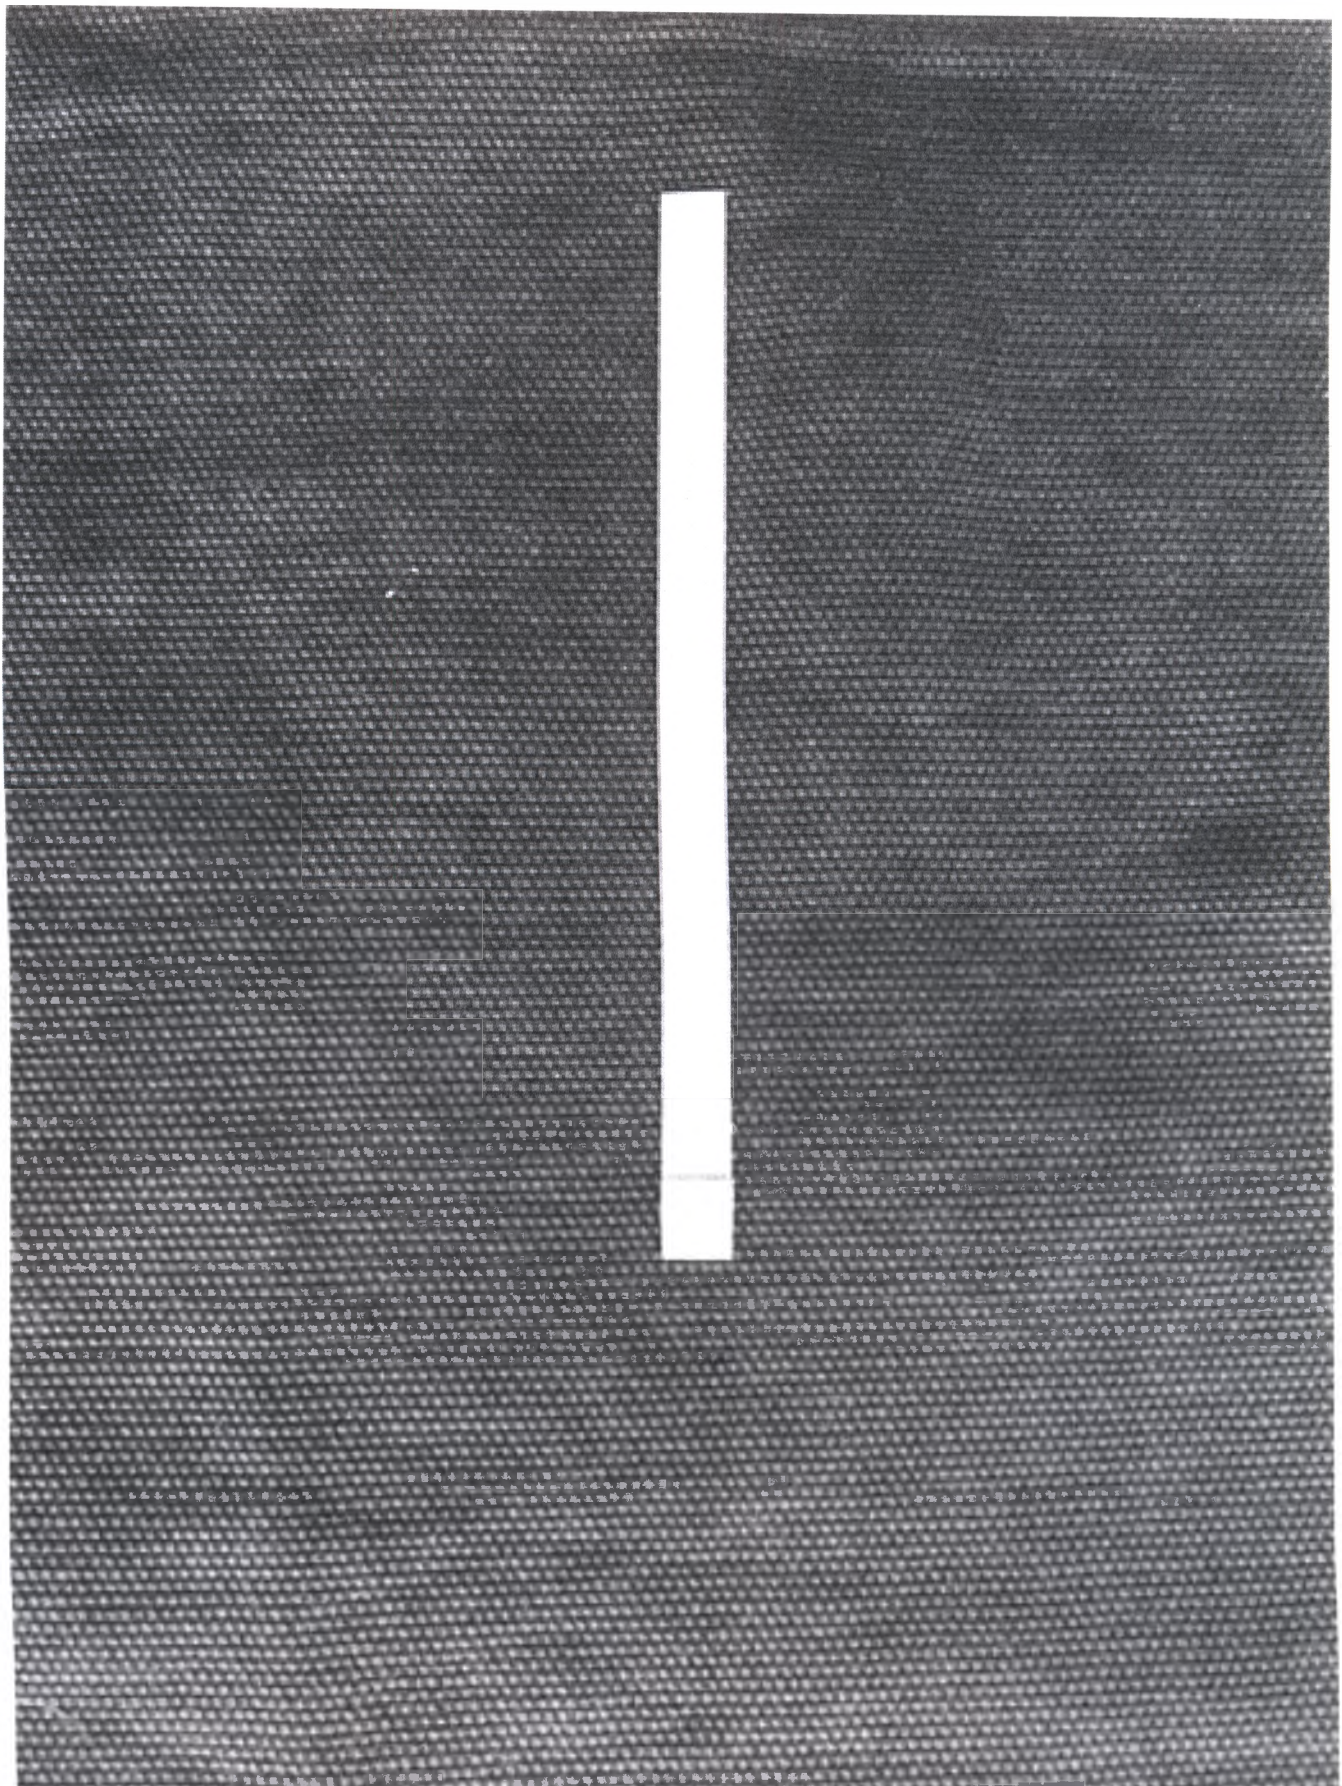


серию 4 листа
Фир. ООО "Биосенсор АН"
Ионов Д.Р.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»

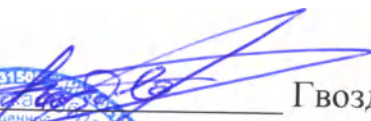
Гвоздев А.Р.
«07» января 2018 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в моче
УРИГЛЮК-1

только для диагностики ин витро



ТУ 21.20.23-229-45677786-2018

ПУ № _____ от _____ г.

IVD

**ПОЛОСКИ ИНДИКАТОРНЫЕ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКА В МОЧЕ
УРИБЕЛ**

Состав:

- полоски индикаторные – _____
- этикетка с цветовой шкалой – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.;



Количество полосок: _____



Сделано: 01.2018



Годен до: 01.2020



Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»

Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4

Моча



+2+30°C



Цветовая шкала со значениями

УРИБЕЛ

УРИБЕЛ

Цветовая шкала со значениями

IVD

Количество полосок: 1

Сделано: 01.2018

Годен до: 01.2020

Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»


Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4



+2+30°C



ПУ № _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-229-45677786-2018

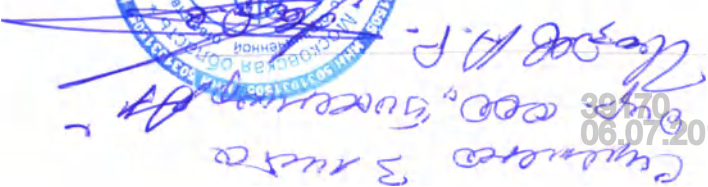

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

17 августа 2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения белка в моче УРИБЕЛ



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

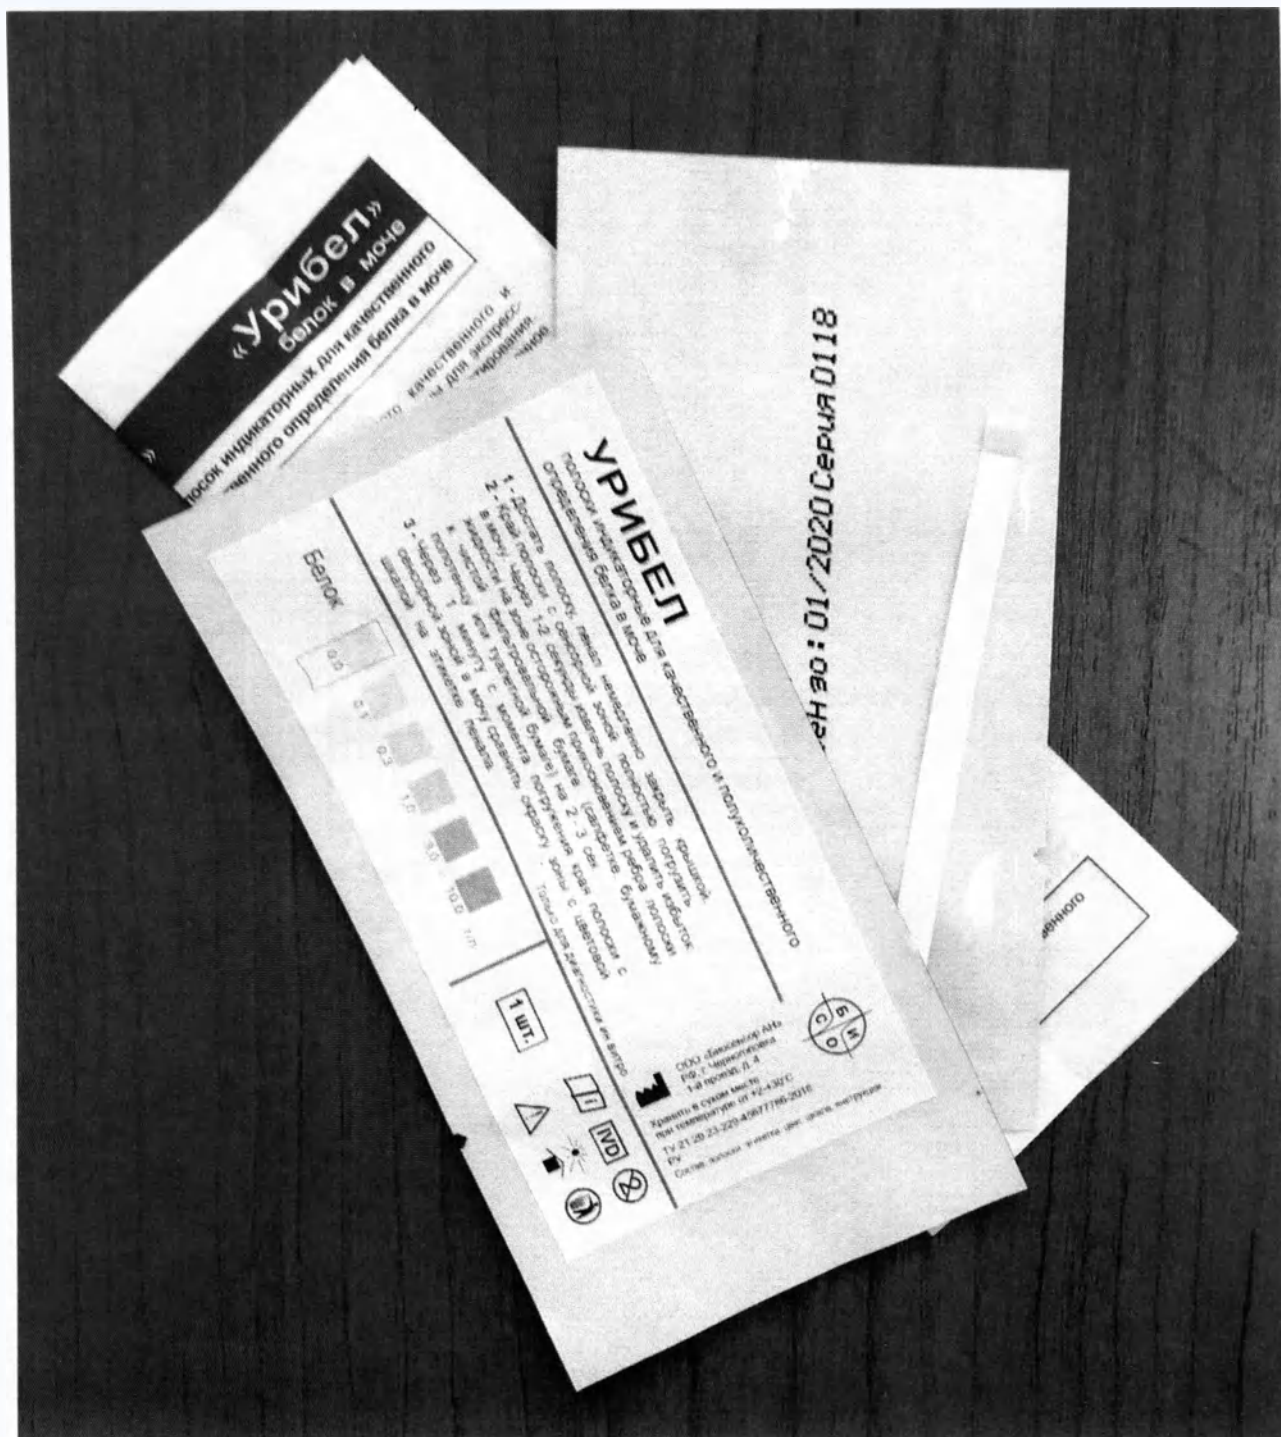

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

толуколичественного

ть крышкой.
погрузить
удалить избыток
и ребра полоски
этке, бумажному
вк.

края полоски с
ны с цветовой

Только для диагностики ин витро



ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30°C

ТУ 21.20.23-229-45677786-2018
РФ


Состав: полоски, этикетка, цвет. шкала, инструкция

г/л

1 шт.



Директор ООО «Биосенсор АН» А.Р. Гвоздев

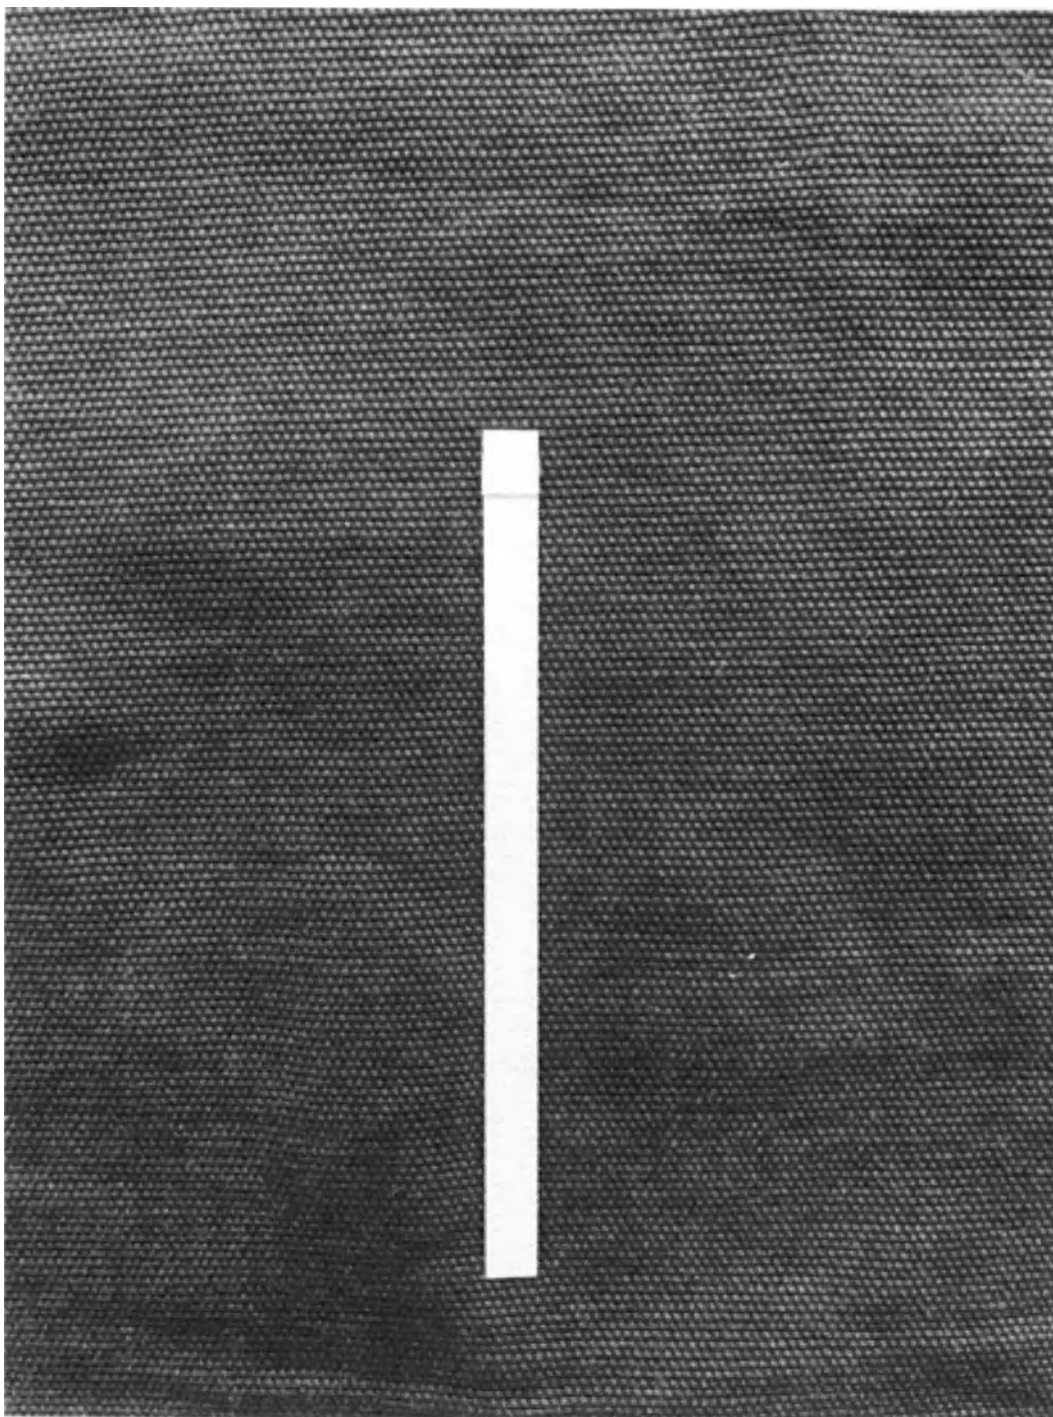

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

сиреню 5 листов
дир. ООО, Биосенсор АН

[Handwritten signature]

