

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Монитор фетальный Corometrics, модель 259cx
с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ


Директор департамента регистрации и сертифицикации
Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»



С.Б. Парахина

1.Монитор фетальный Corometrics 259cx

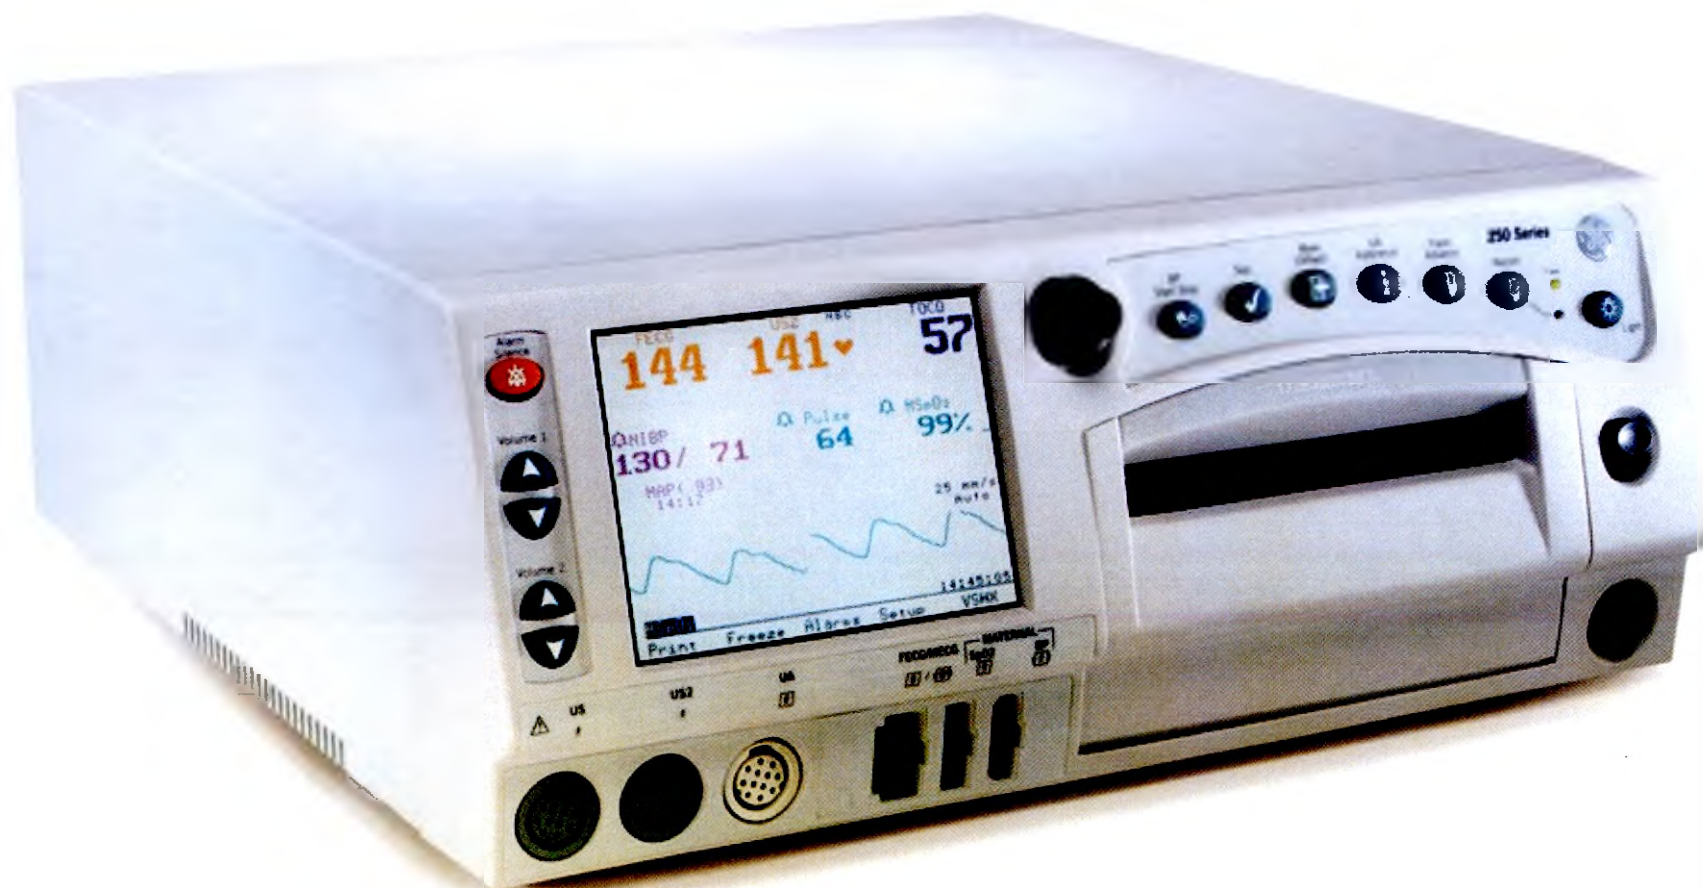




Монитор фетальный Corometrics МОДЕЛЬ 259CX



REF 2036400-002



SN SDJ16360001PAS

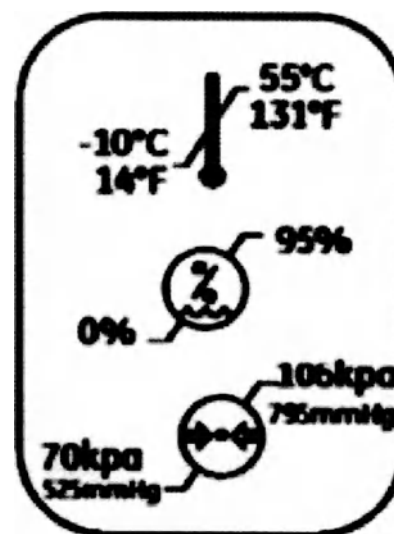

Rx ONLY U.S.



Wipro GE Healthcare Private Limited
No: 4 Kodugodi Industrial Area
Bangalore-560 067 Karnataka, INDIA.
Сделано в Индии



GE Medical Systems SCS
283 Rue De la Miniere,
78530 BUC, FRANCE

1000000X-100X Rev A

REF COROMETRICS 259CX

SN SDJ16160001PAS



2016-05-18



EAC



Wipro GE Healthcare Private Limited

No.4 Kadugodi Industrial Area Bangalore.560 067 Karnataka,INDIA.

Сделано в Индии

2089854-001 Rev B

2. Кабель питания




GE Healthcare

Corometrics™ Монитор серии 250сх Руководство по эксплуатации



Монитор Corometrics серии 250сх
Russian
2036946-015 F (paper)
© 2009 General Electric Company.
Все права защищены.

Принадлежности: 1. Датчик ультразвуковой типа "кнопка"

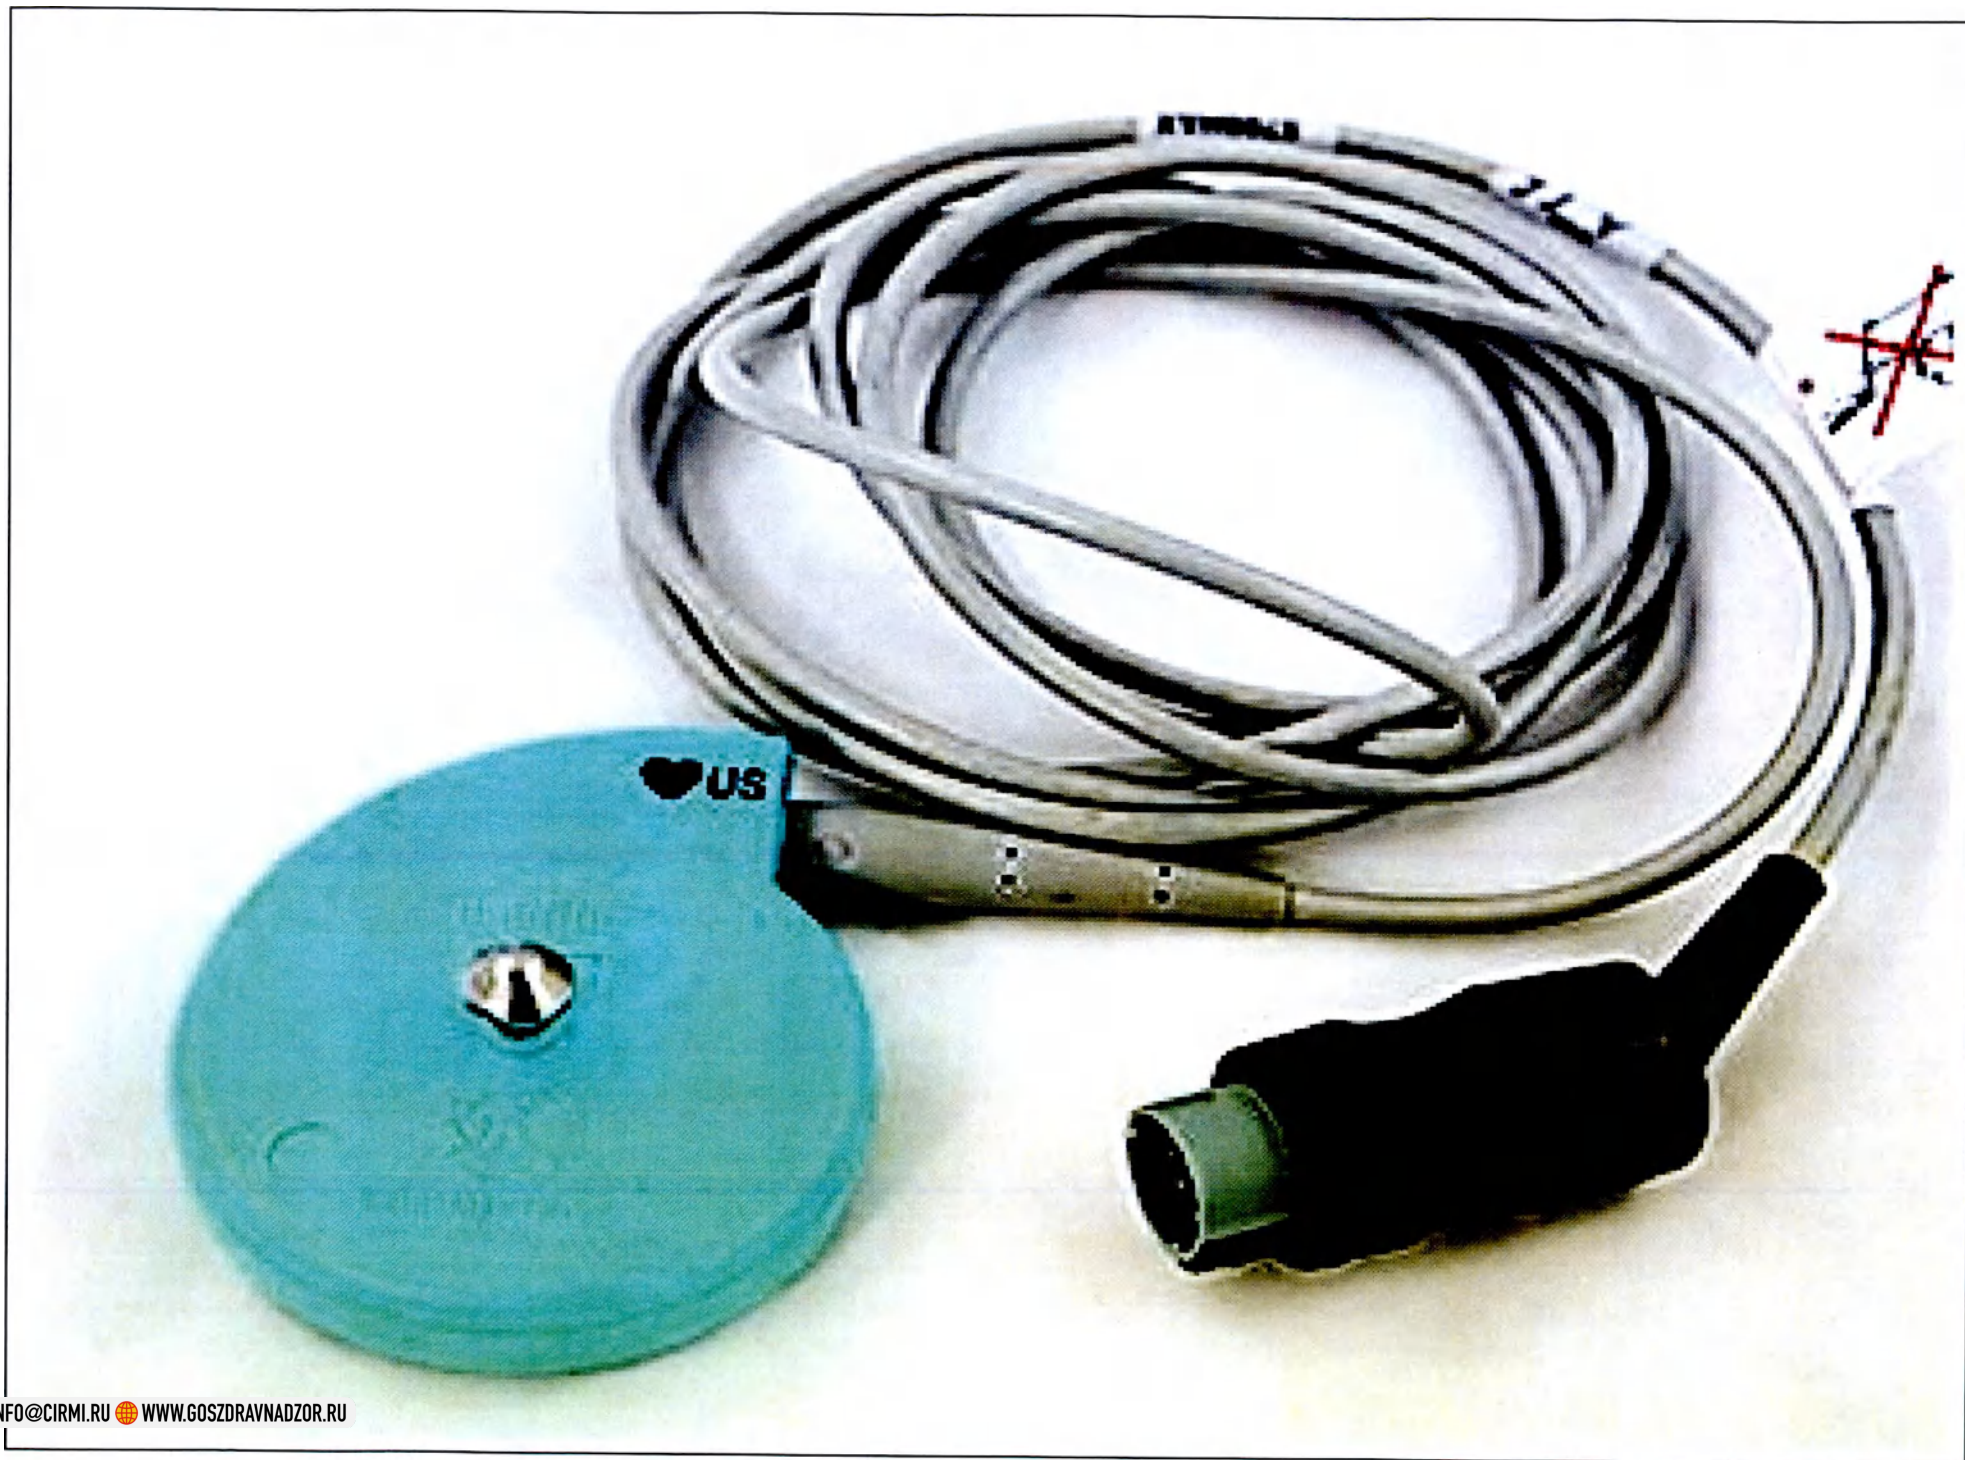

Принадлежности: 2. Датчик ультразвуковой типа " петля "



Принадлежности: 3. ТОСО датчик типа "кнопка"



Принадлежности: 4. ТОСО датчик типа "петля"




Принадлежности: 5. Ремни фиксирующие для датчиков







Принадлежности: 7. Чехлы для температурного датчика

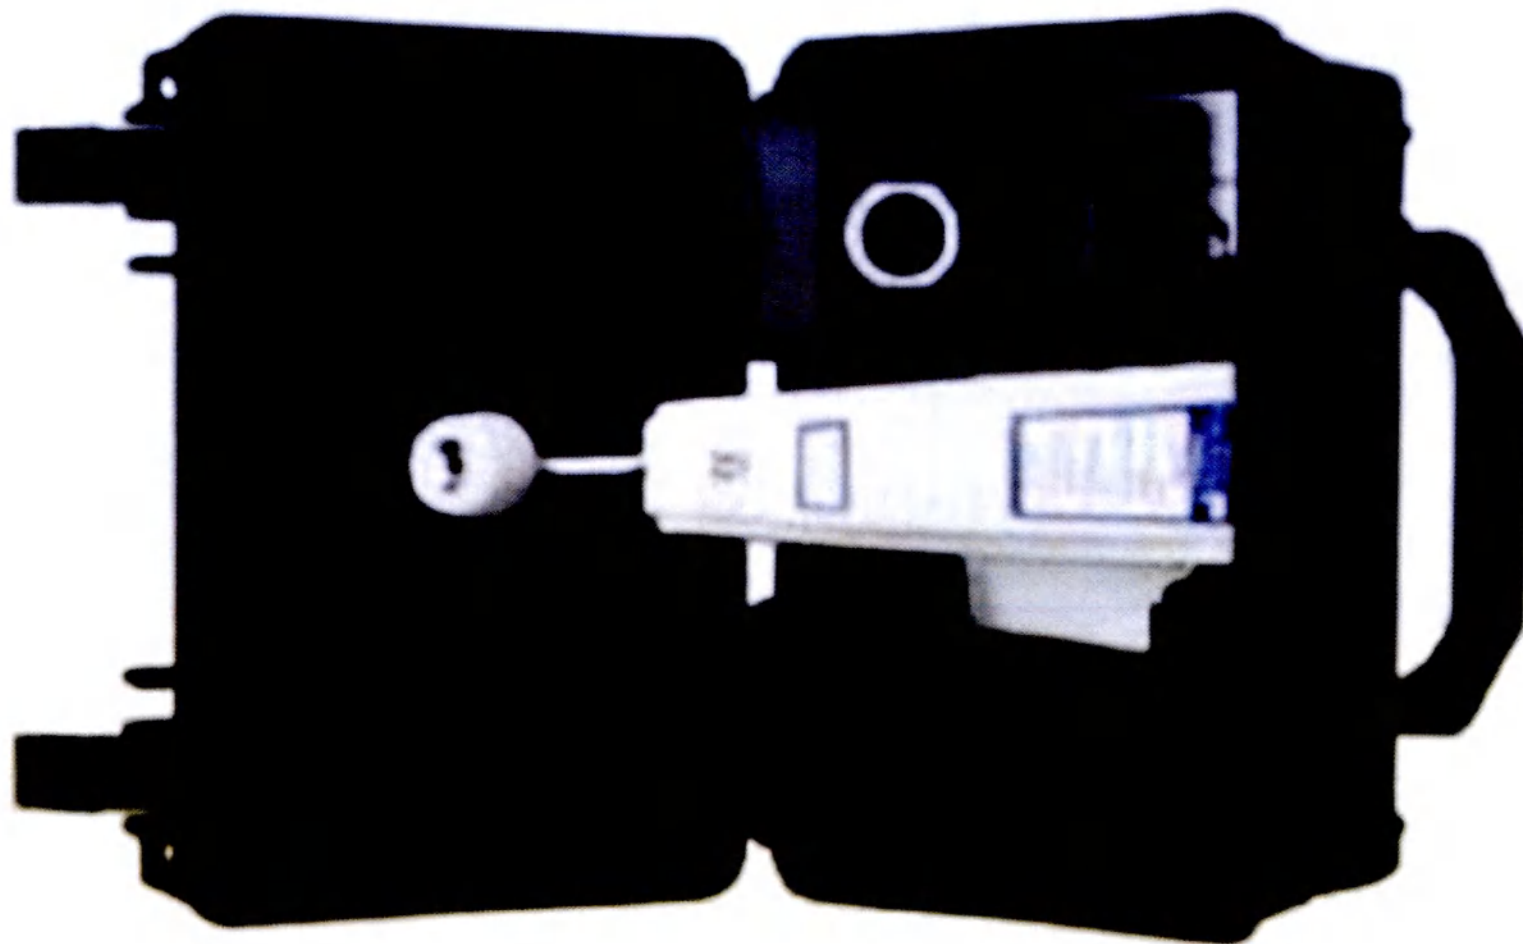




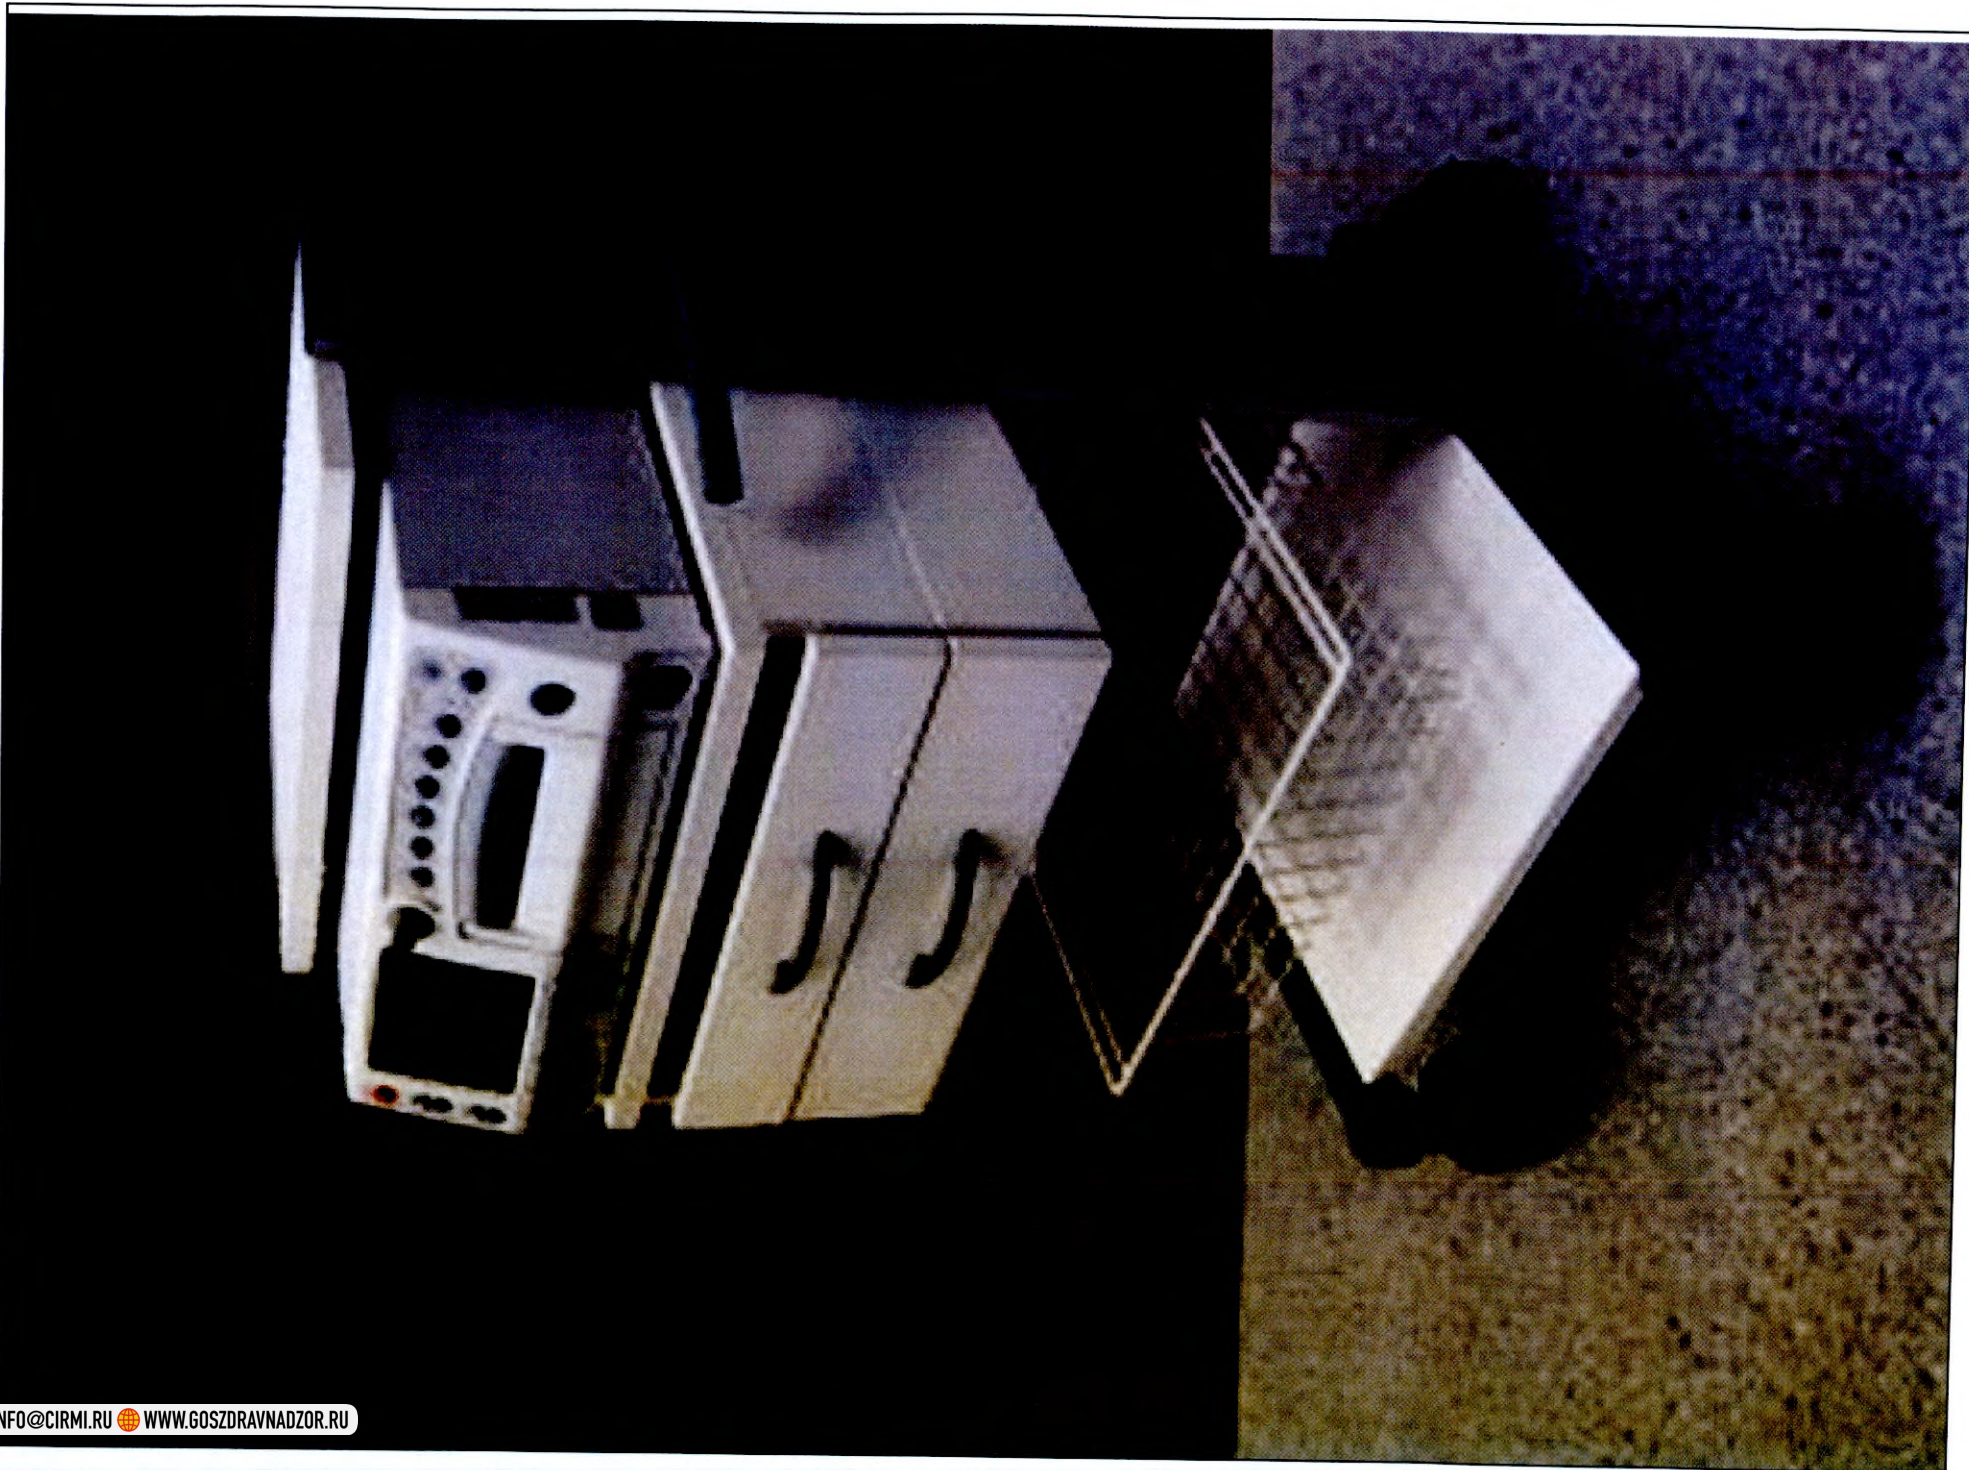


Принадлежности: 10. Крепление настенное

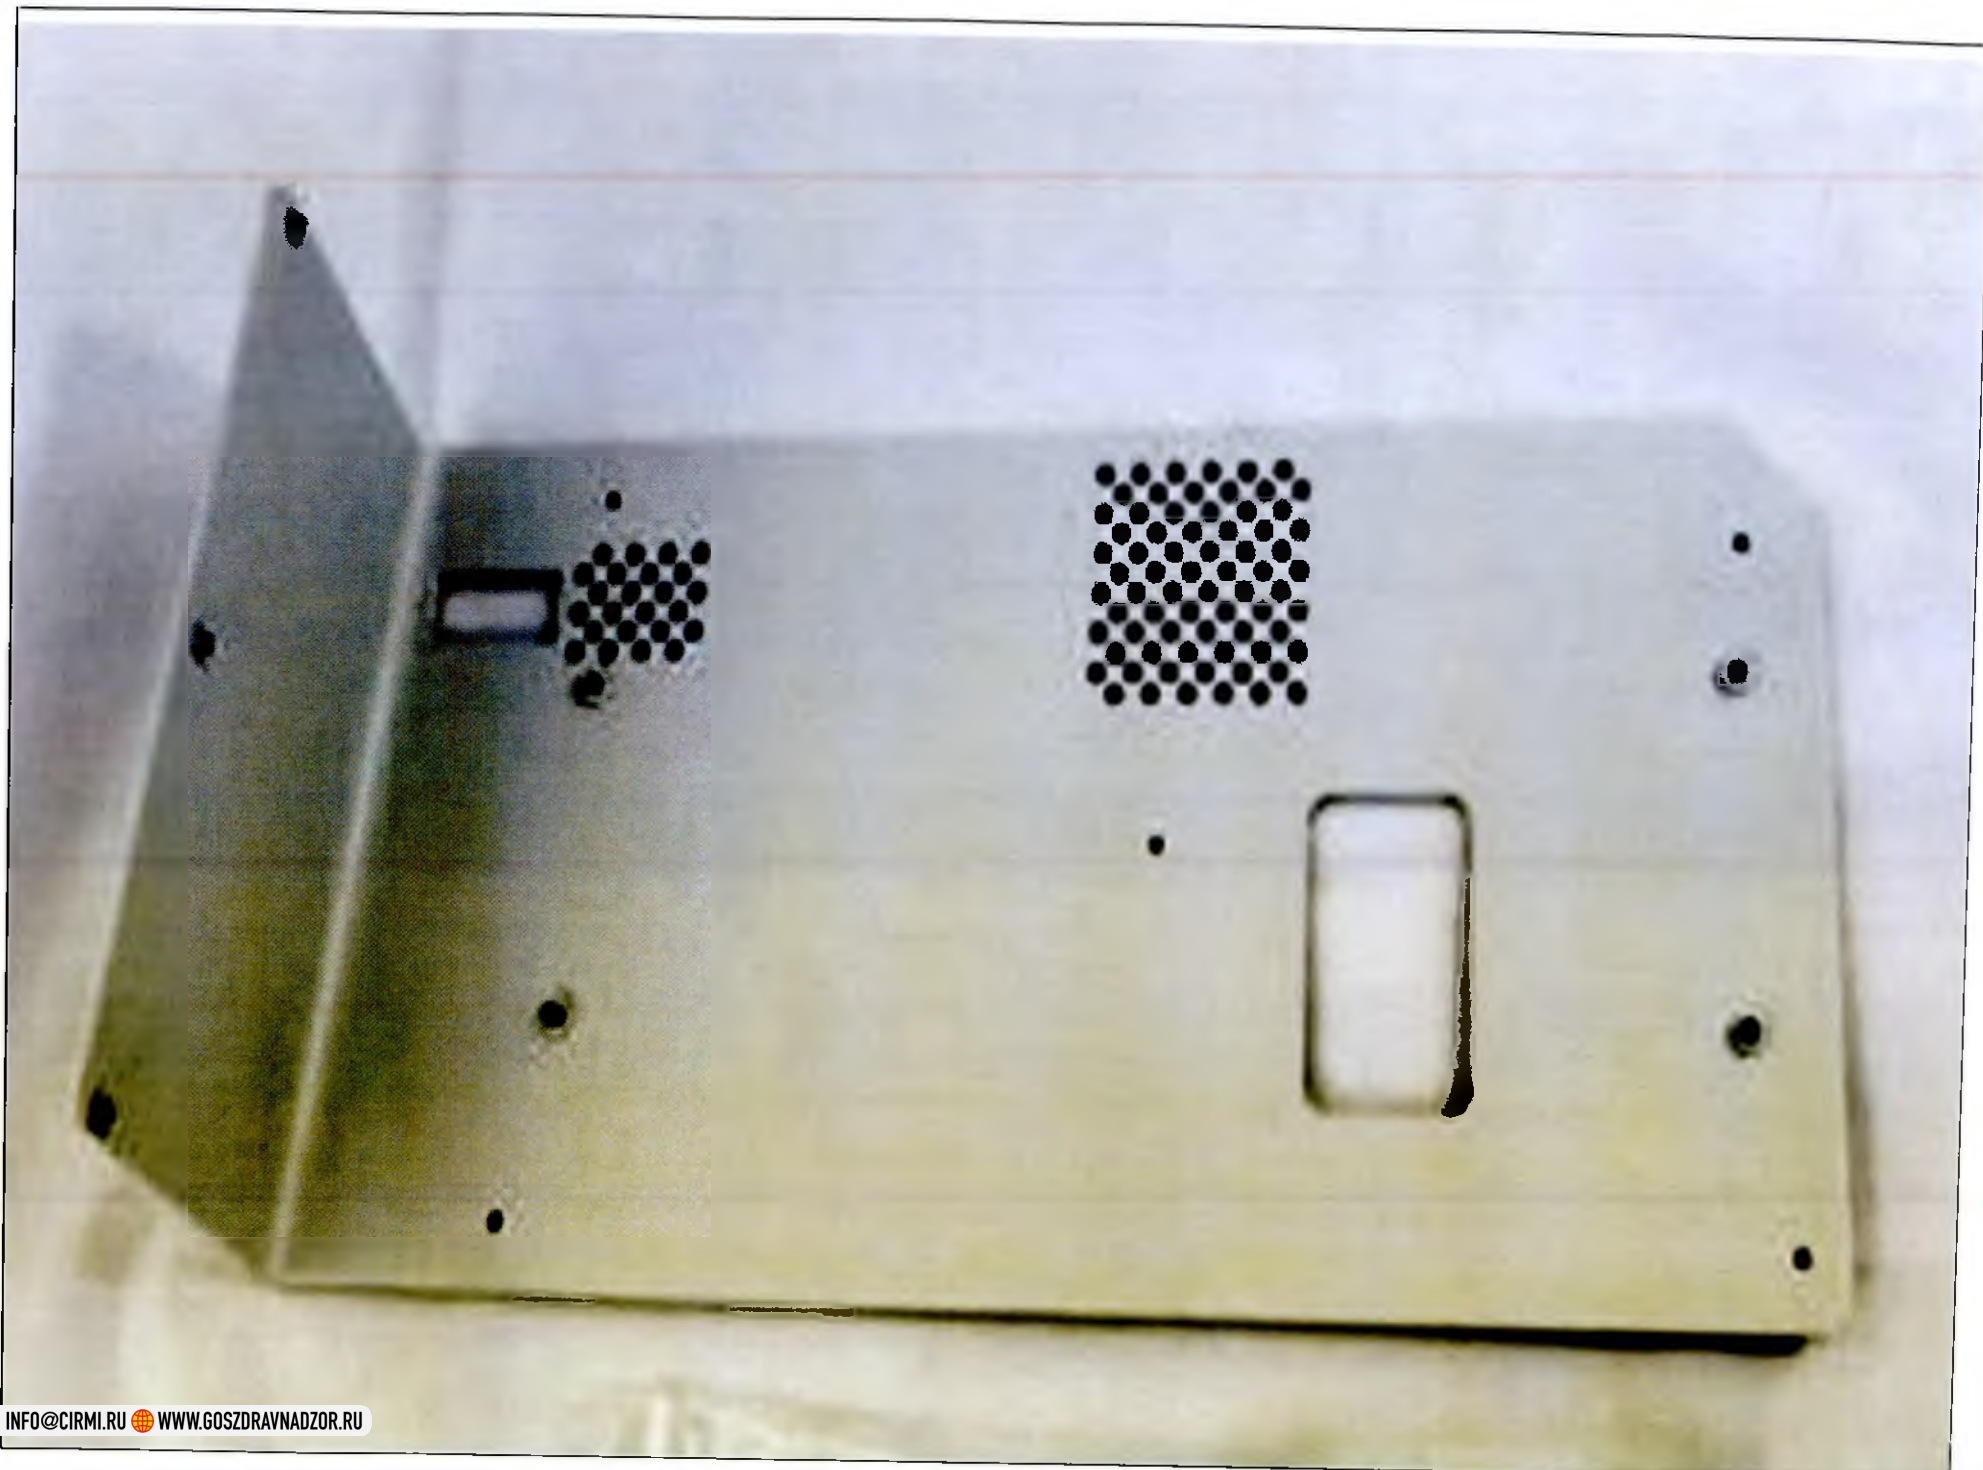

Принадлежности: 11. Приспособление крепежное

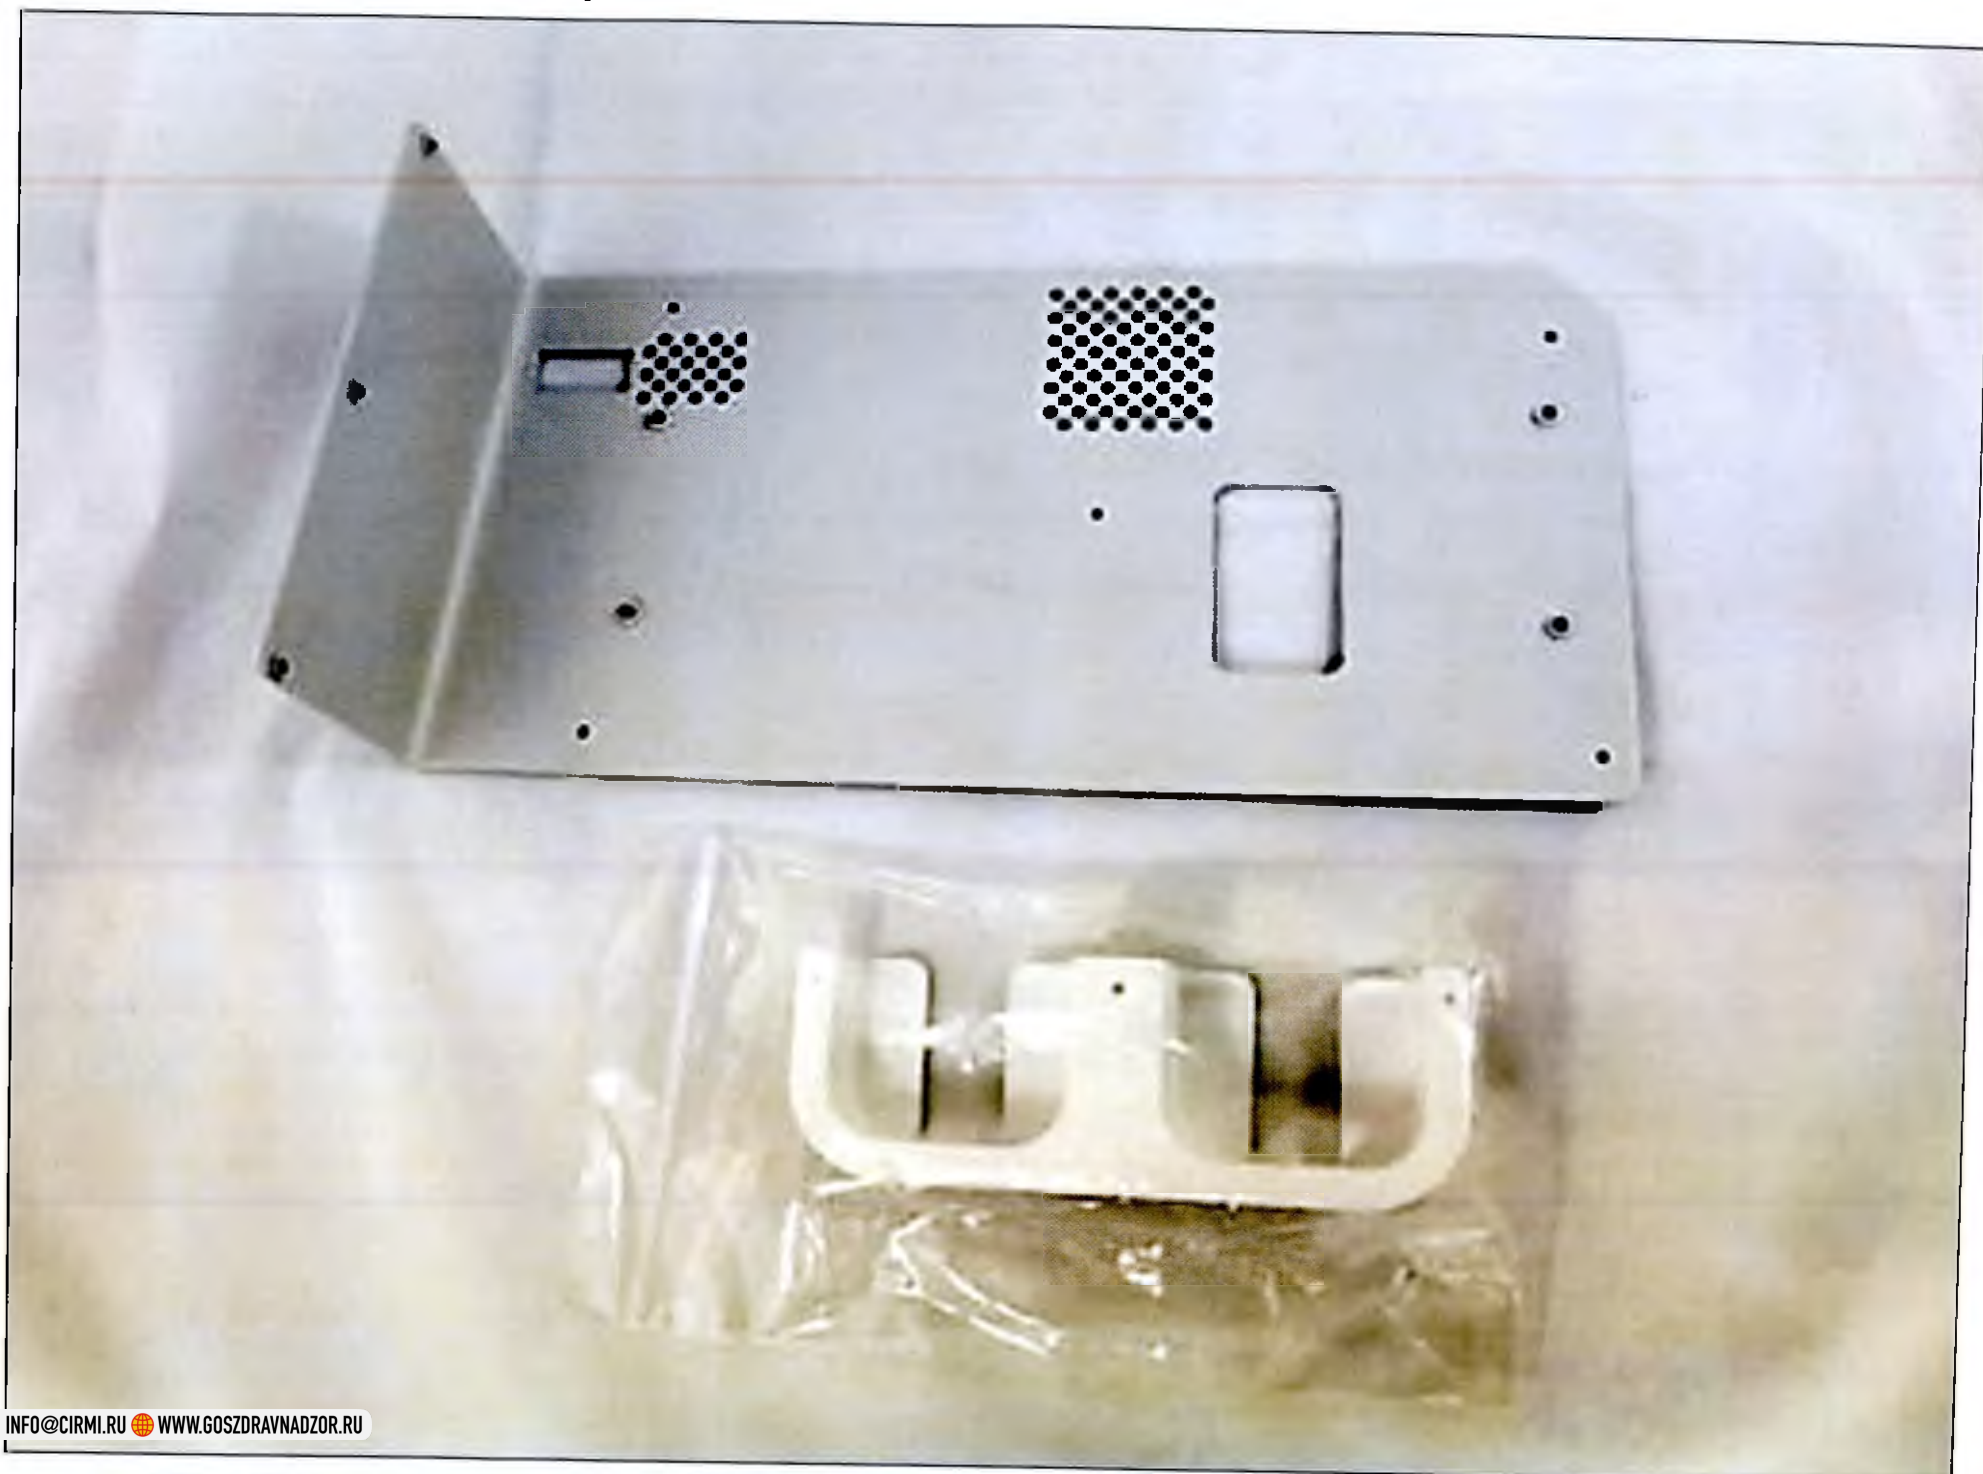

Принадлежности: 12. Держатель адаптера

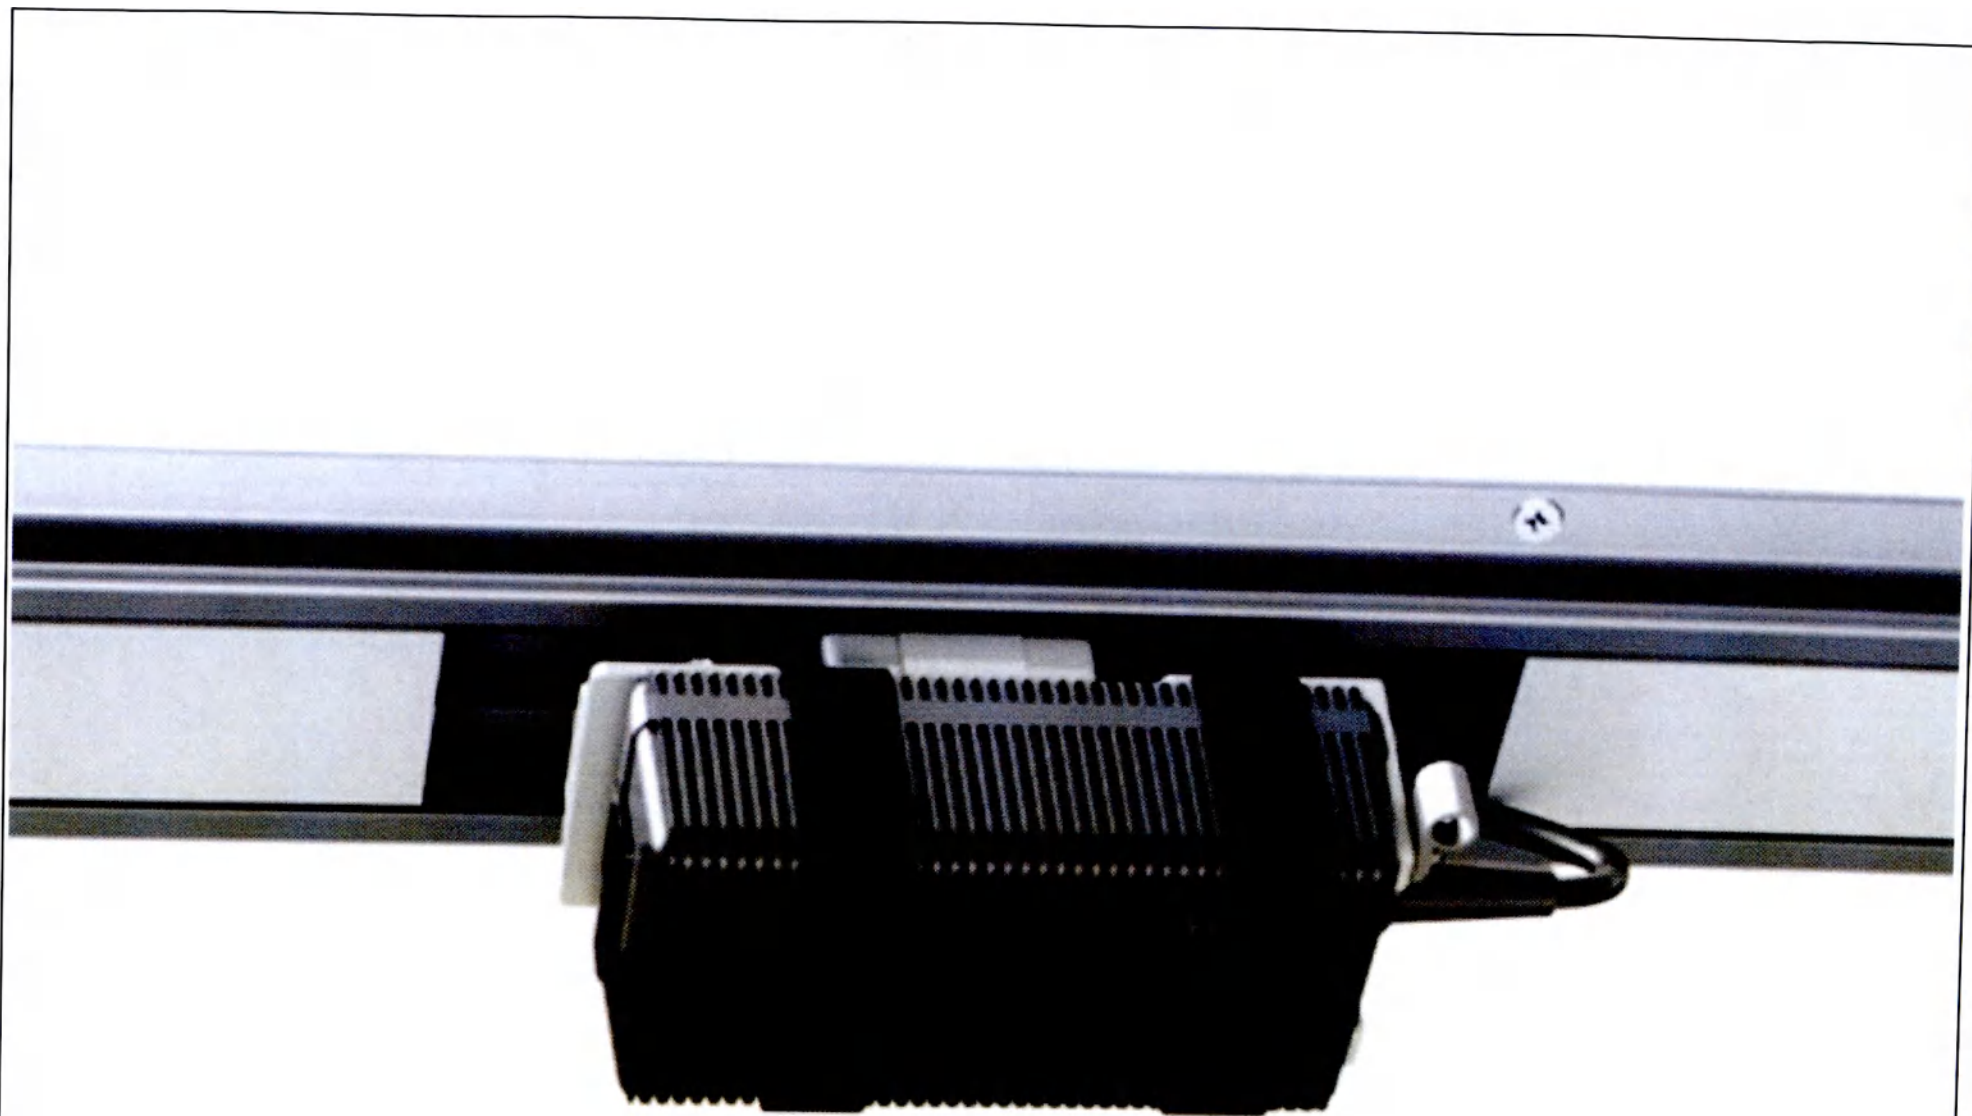


Принадлежности: 13. Кабель для мониторинга ЭКГ матери




Принадлежности: 14. Кабель связи с ПК




Принадлежности: 15. Кабель для датчиков сатурации

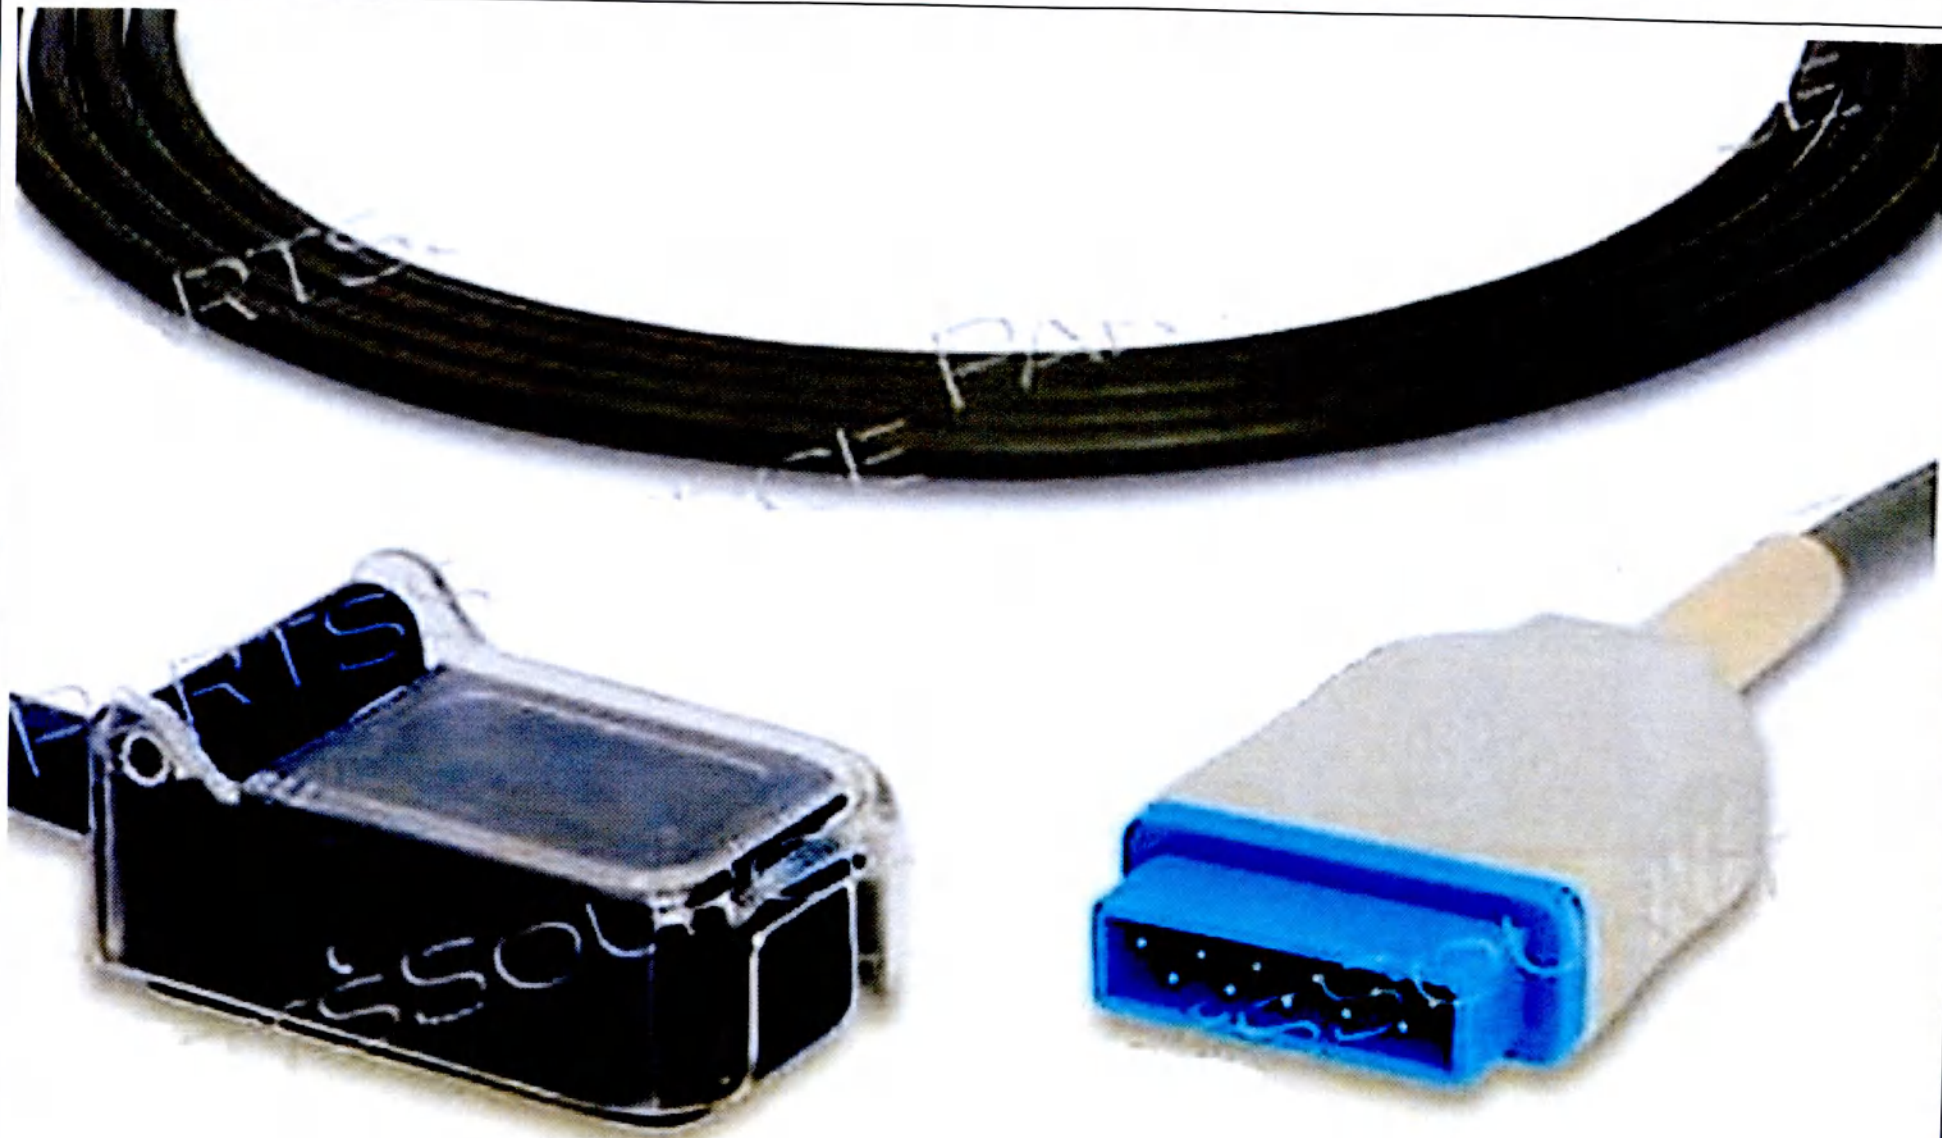


Принадлежности: 16. Кабель соединительные

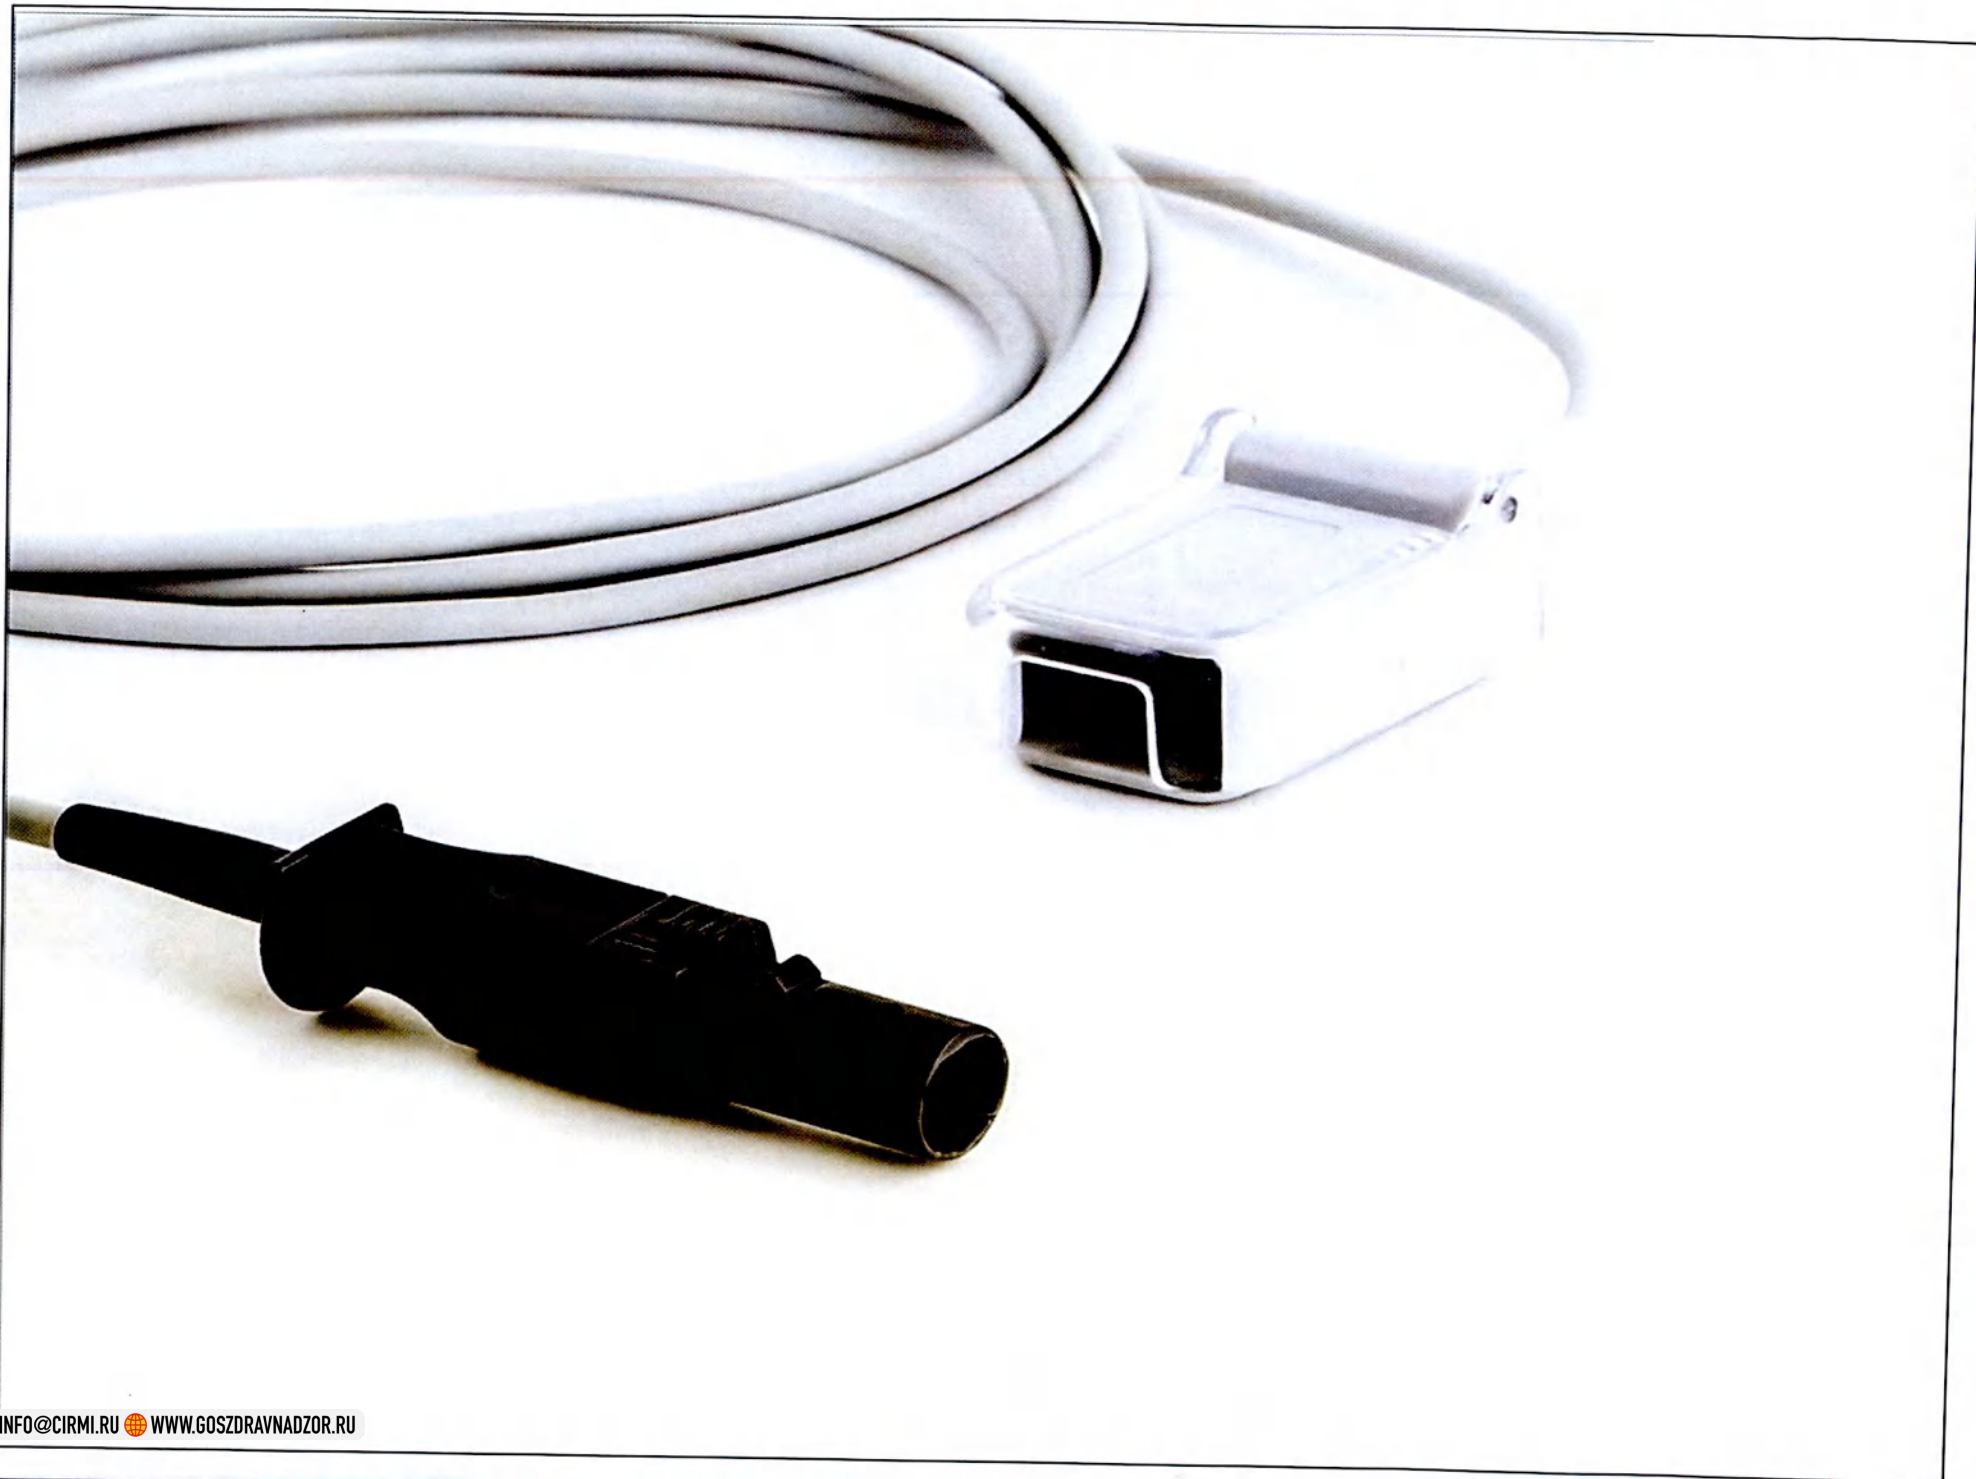



Принадлежности: 17. Кабель для мониторинга ЭКГ плода и матери

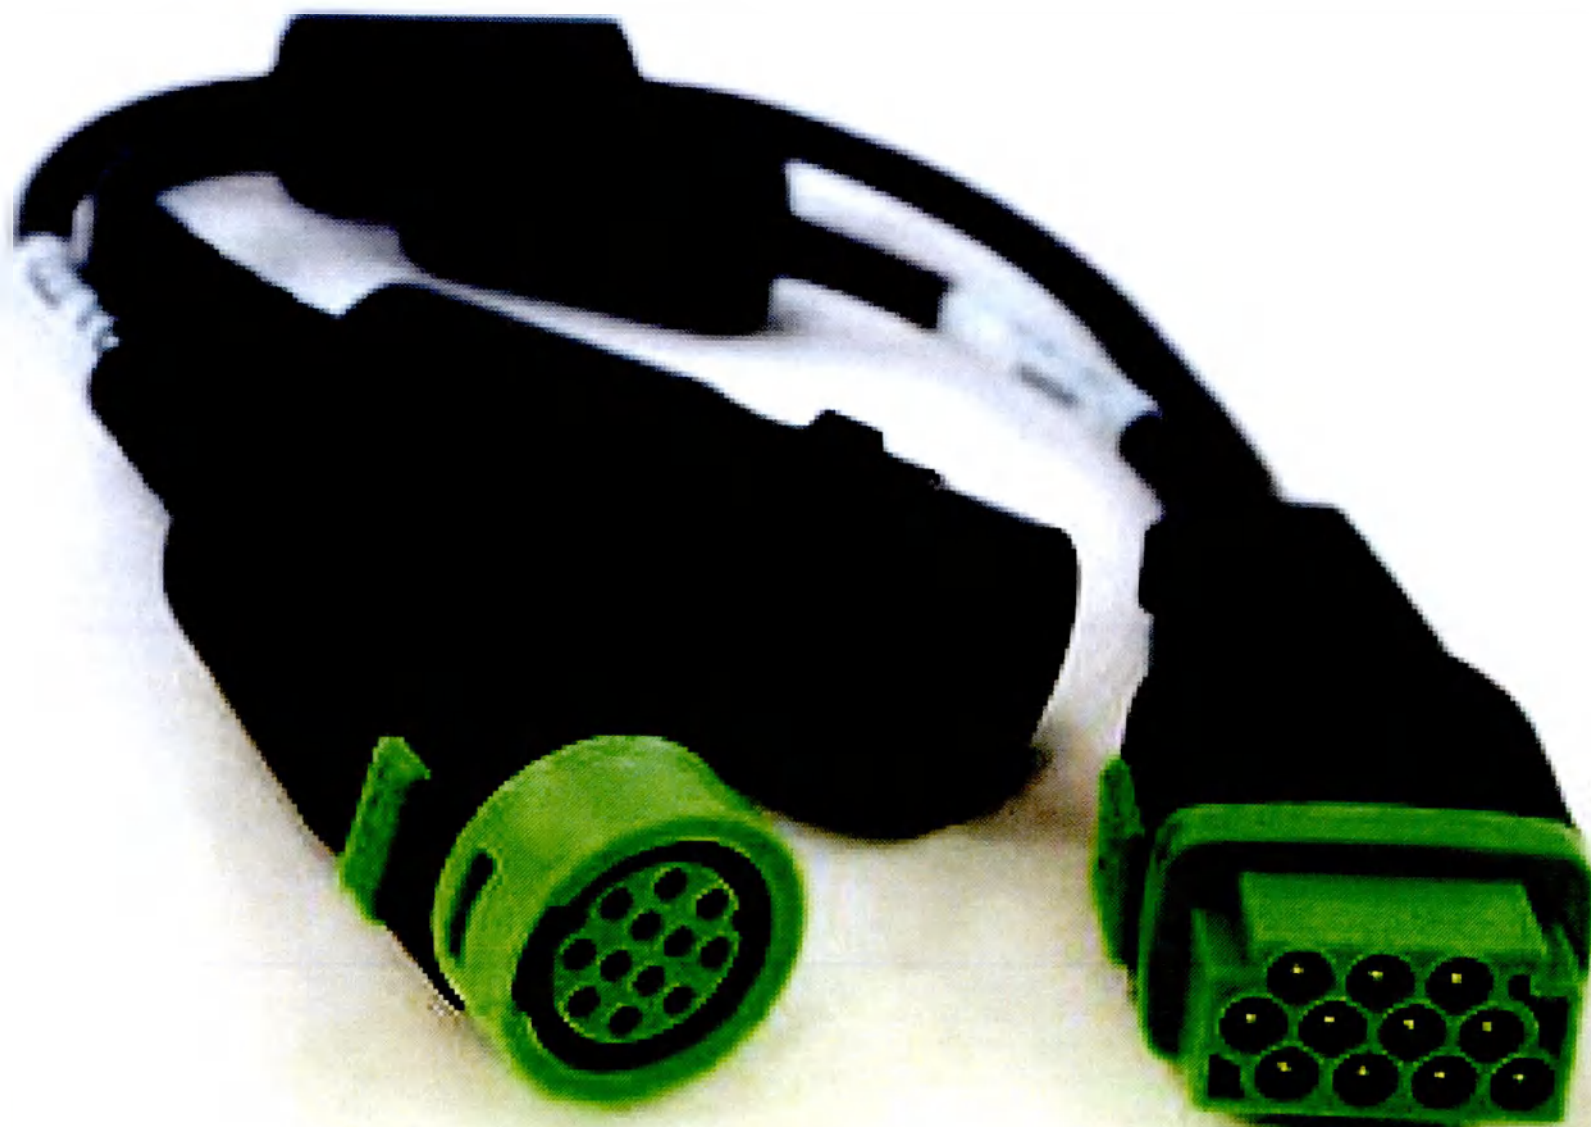


Принадлежности: 18. Переходник для мониторинга ЭКГ плода

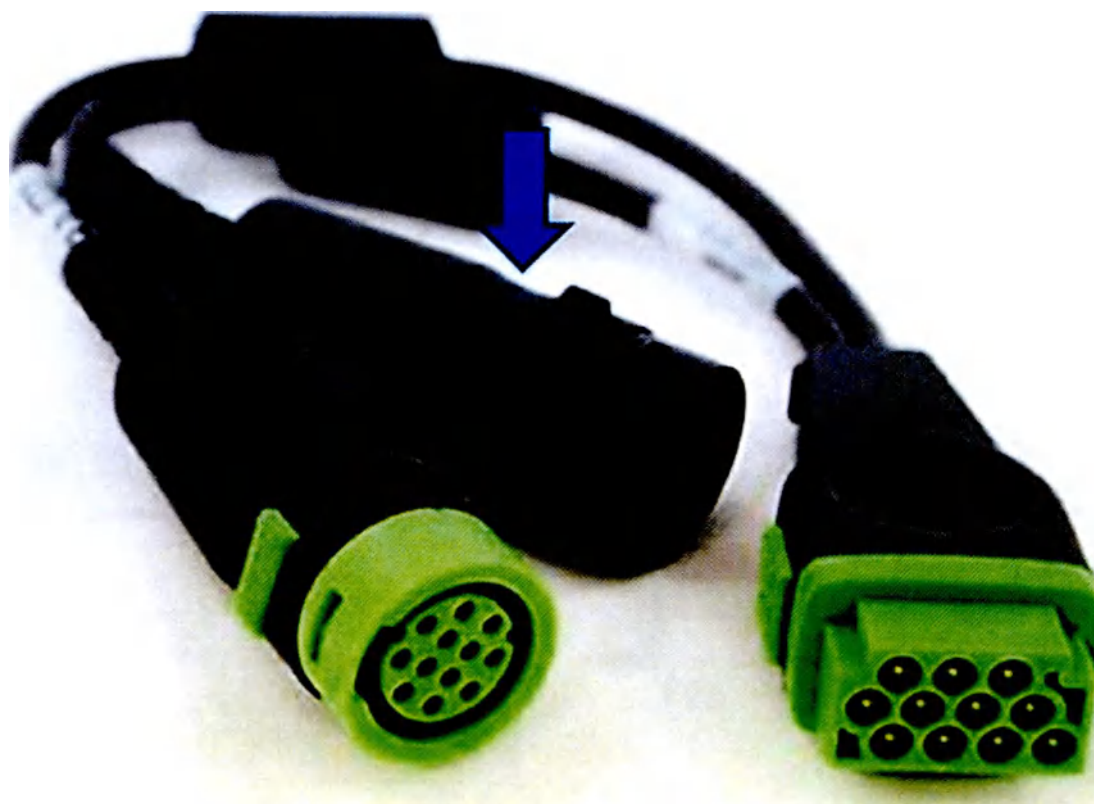


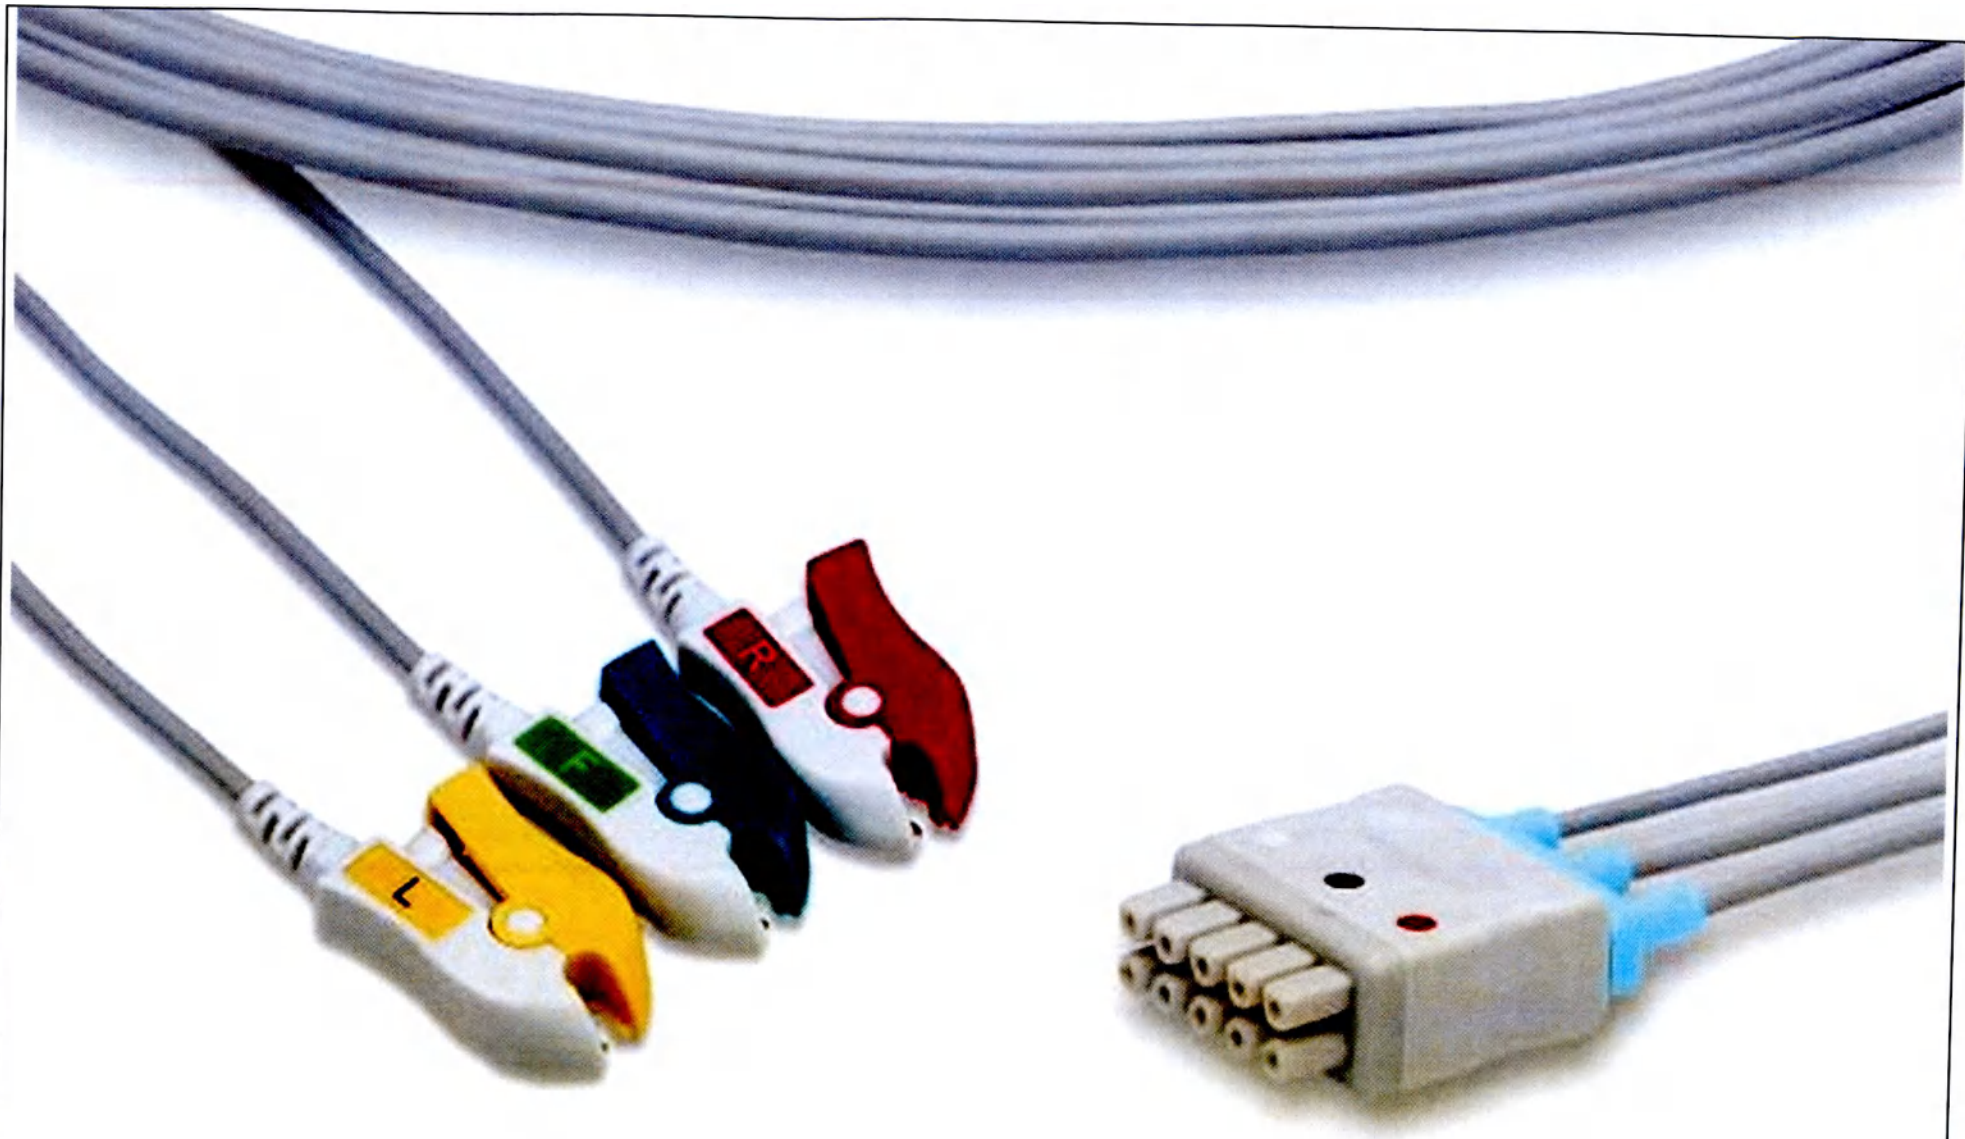

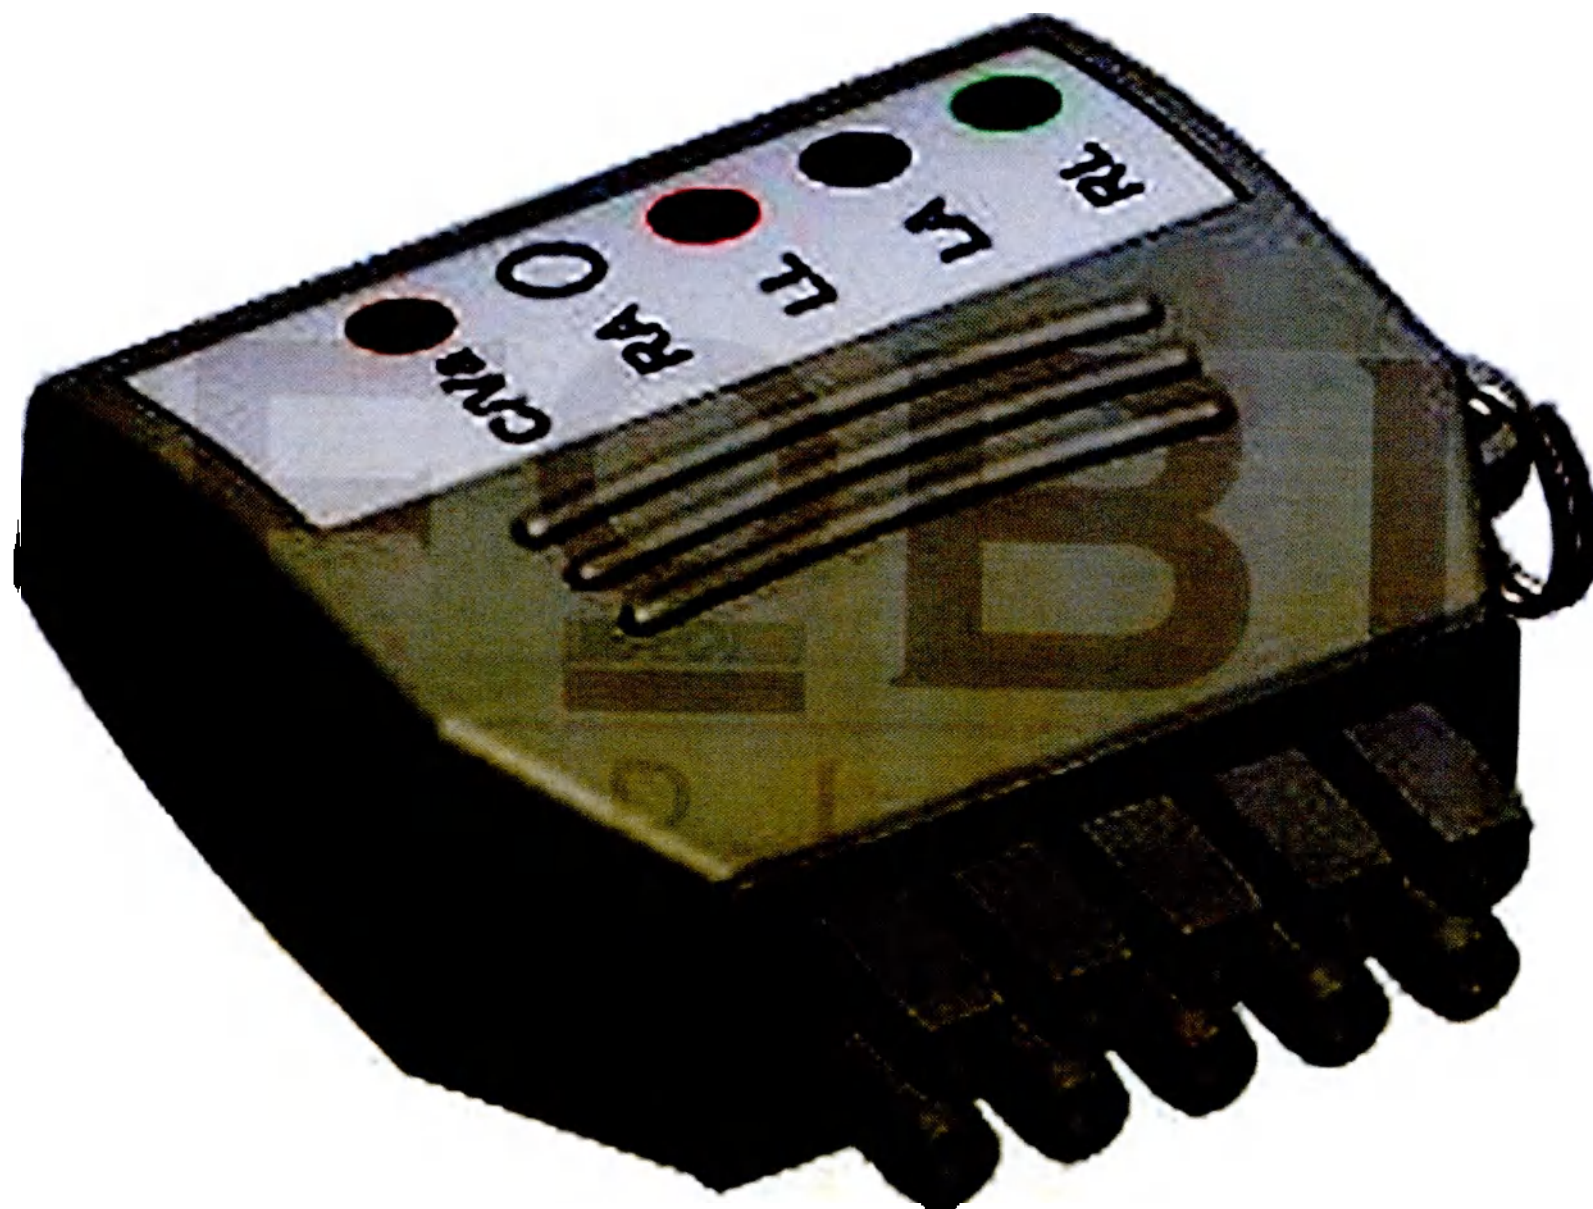



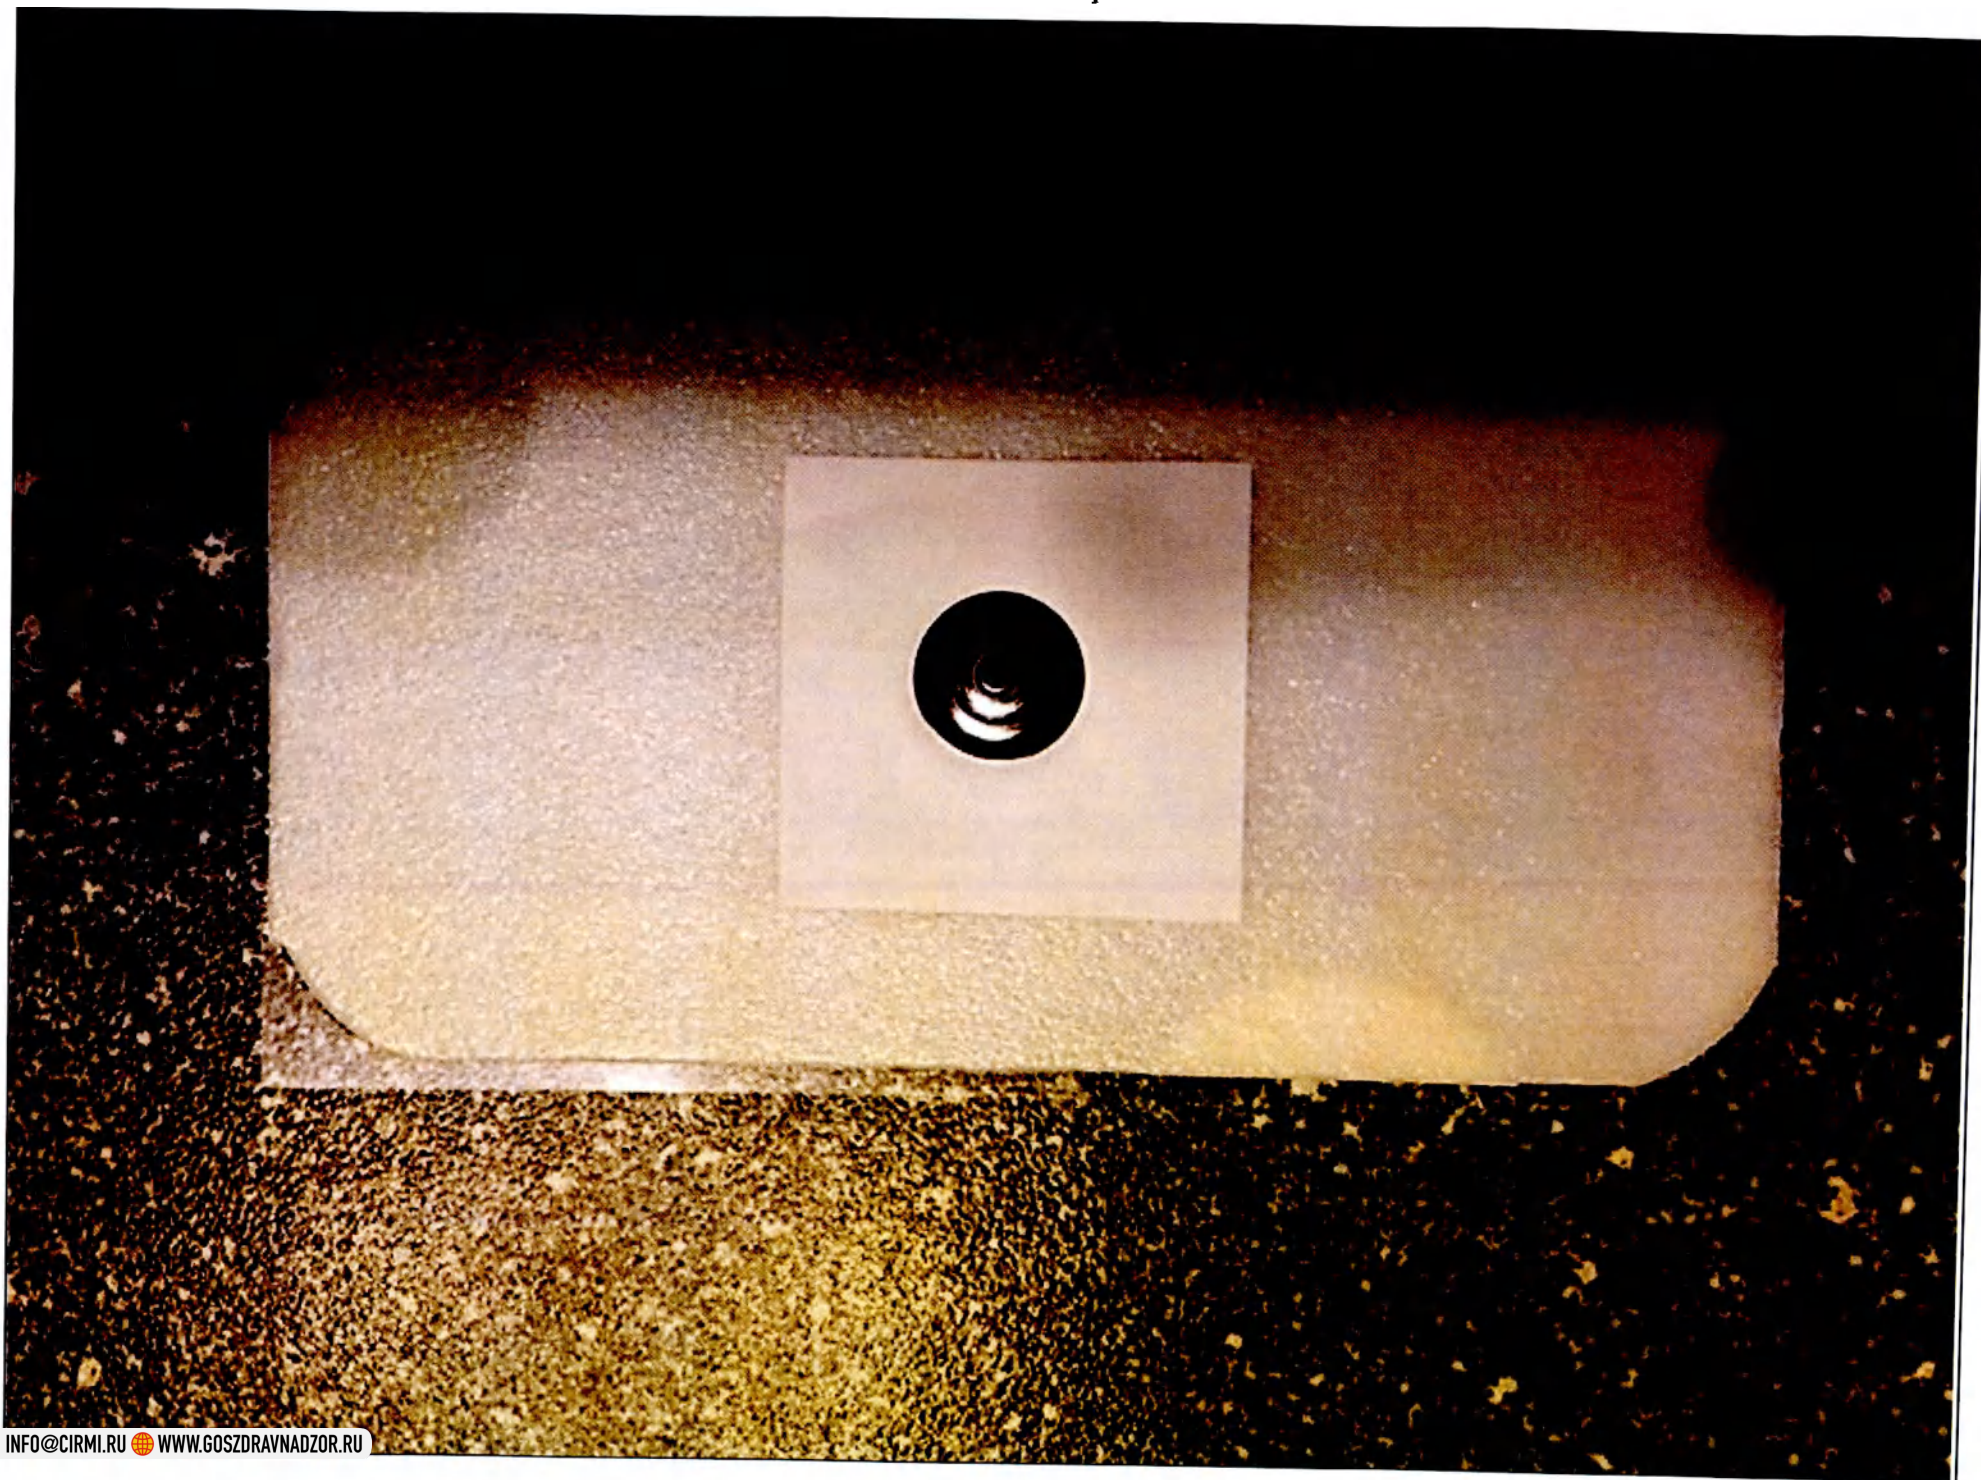


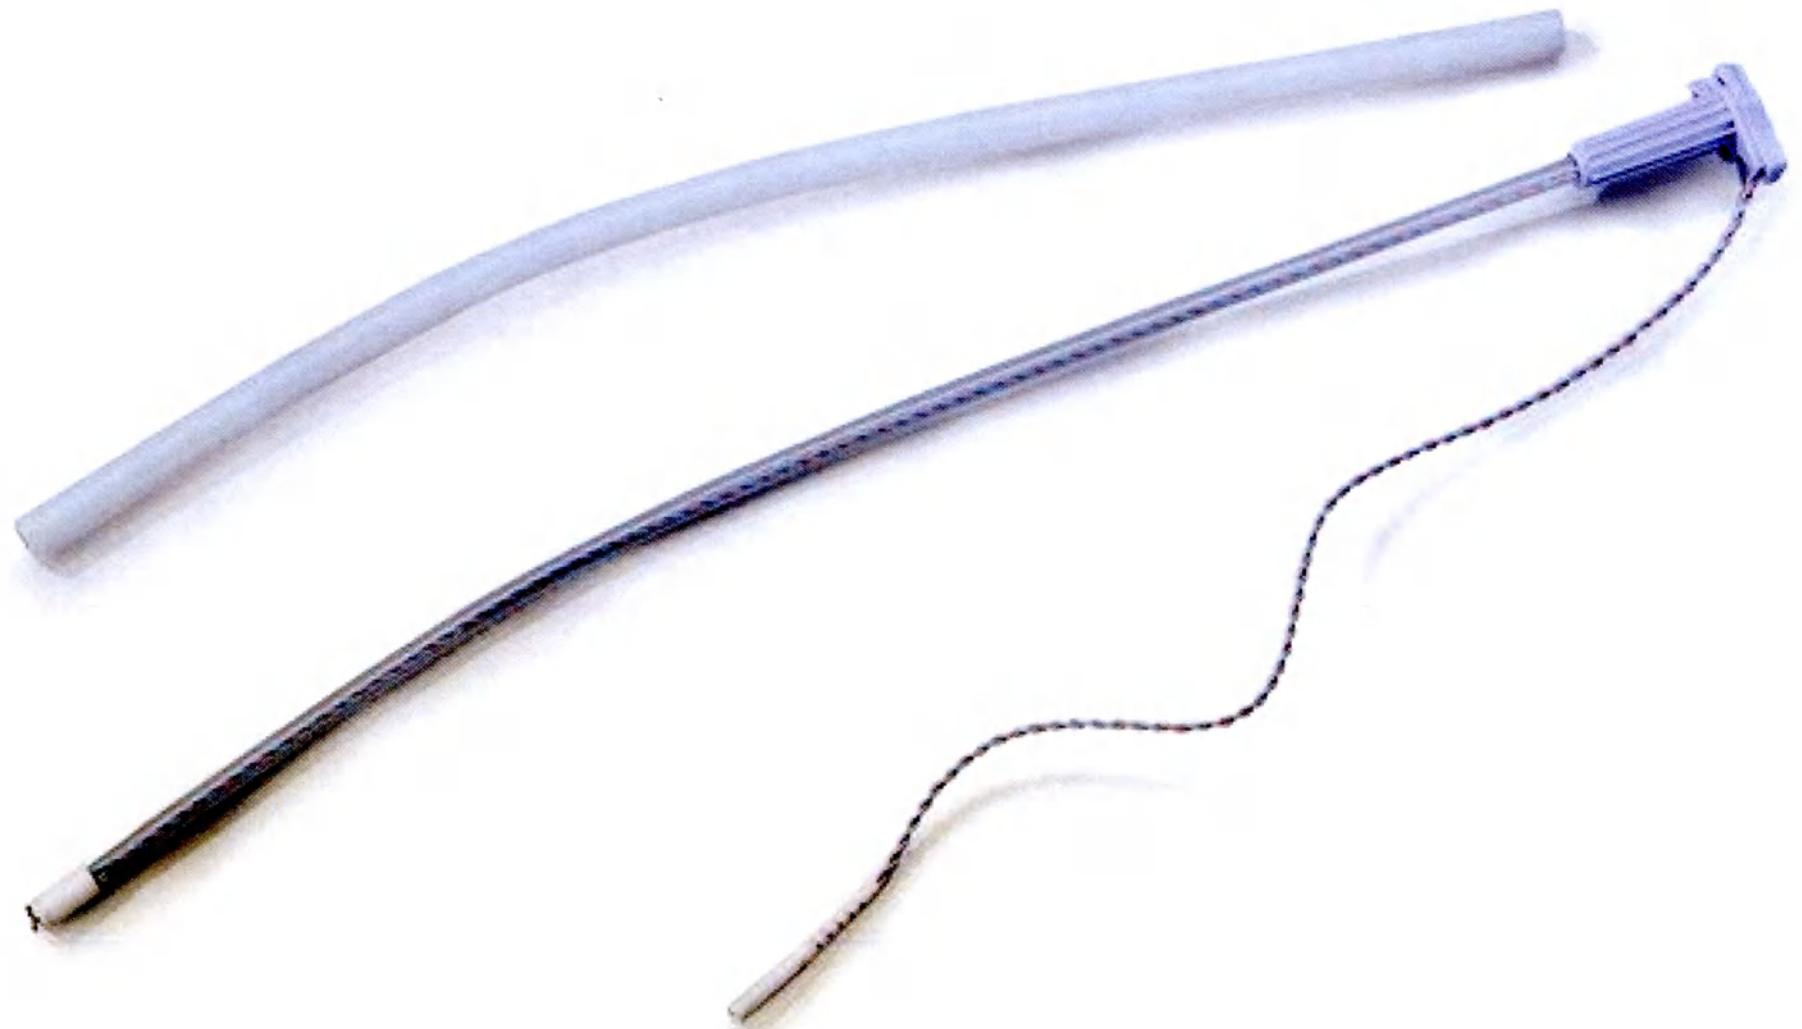




Принадлежности: 25. Кабель для измерения внутриматочного давления




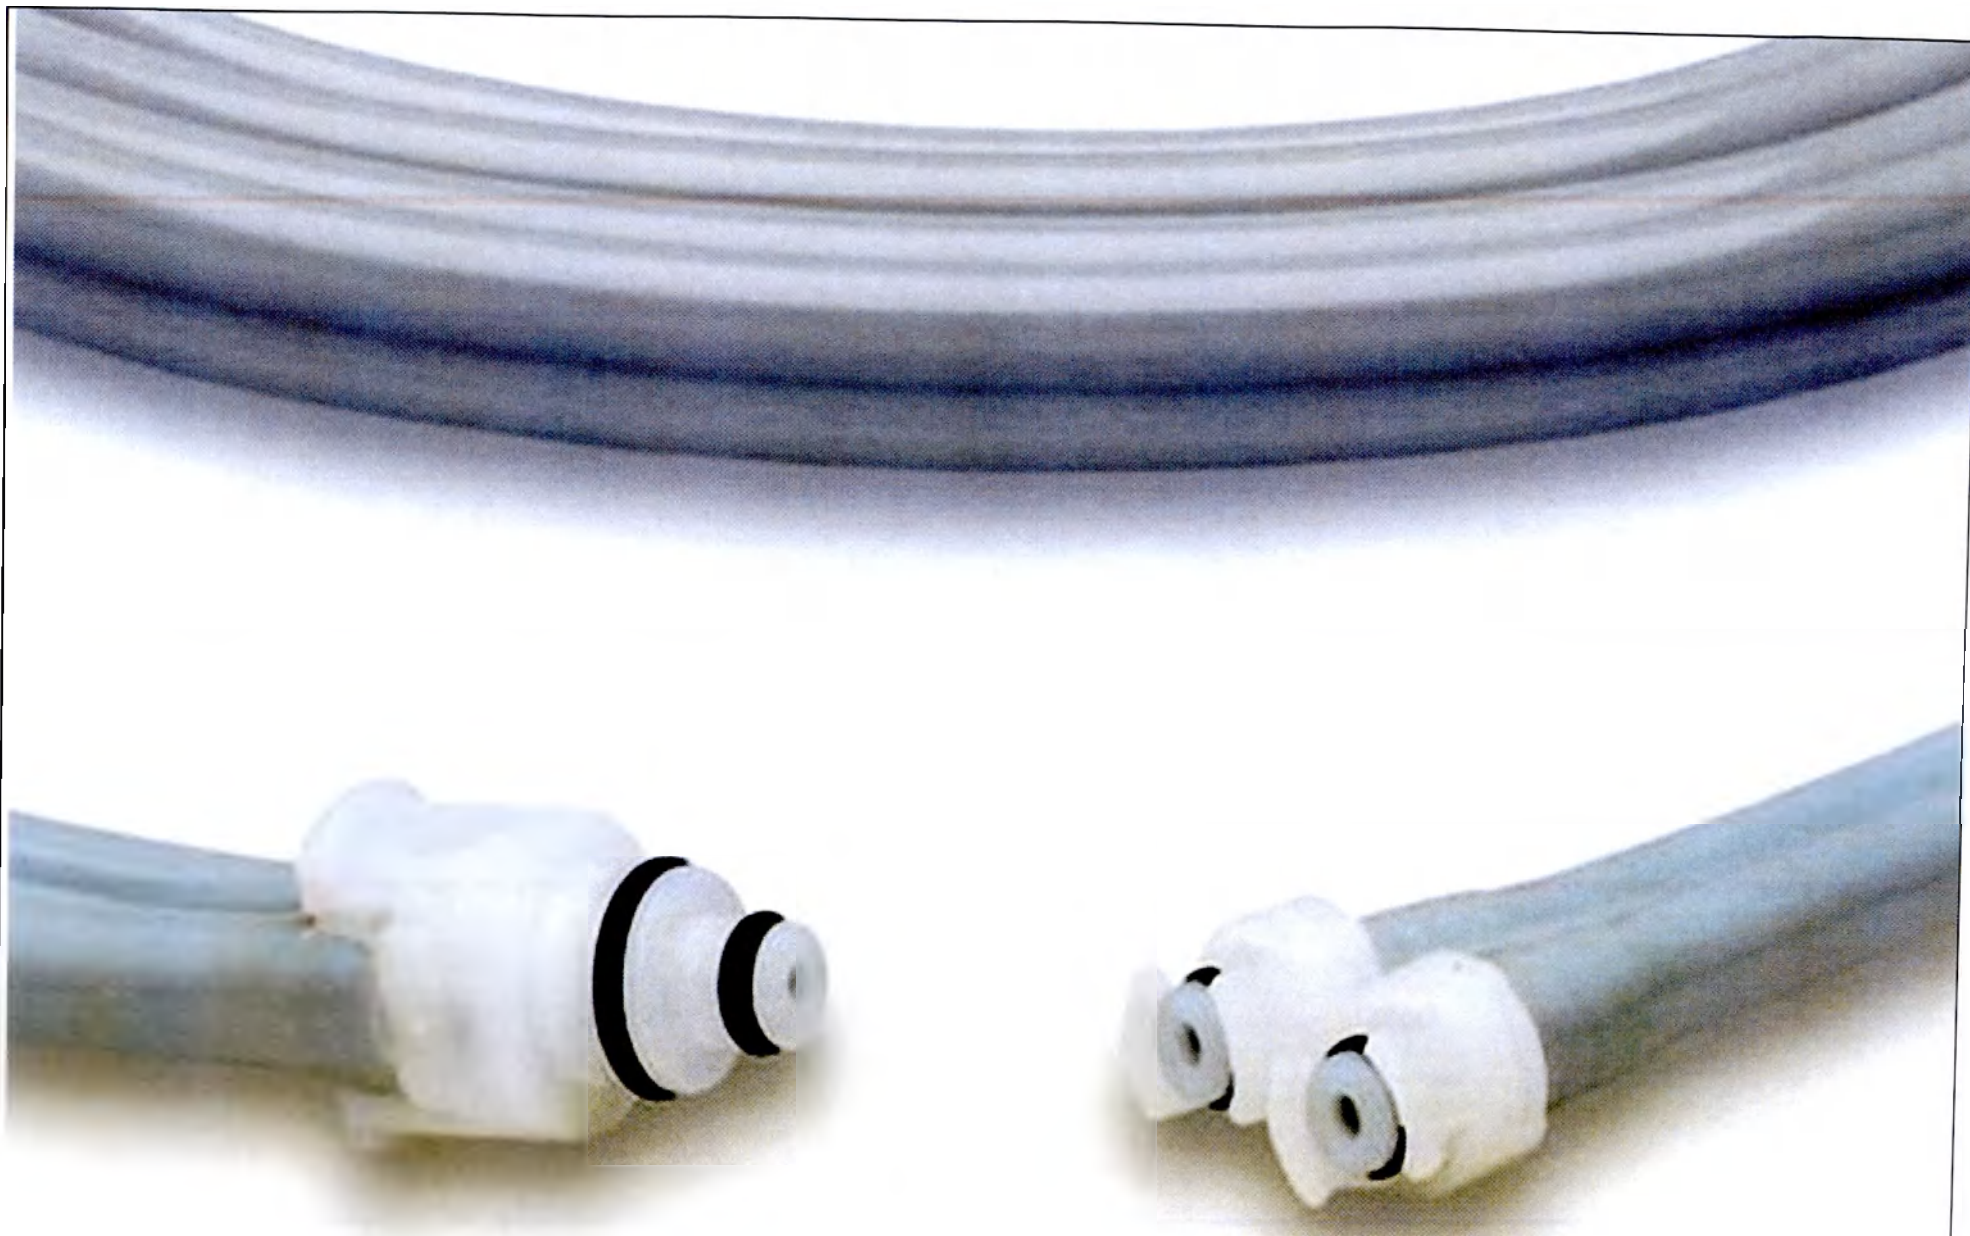





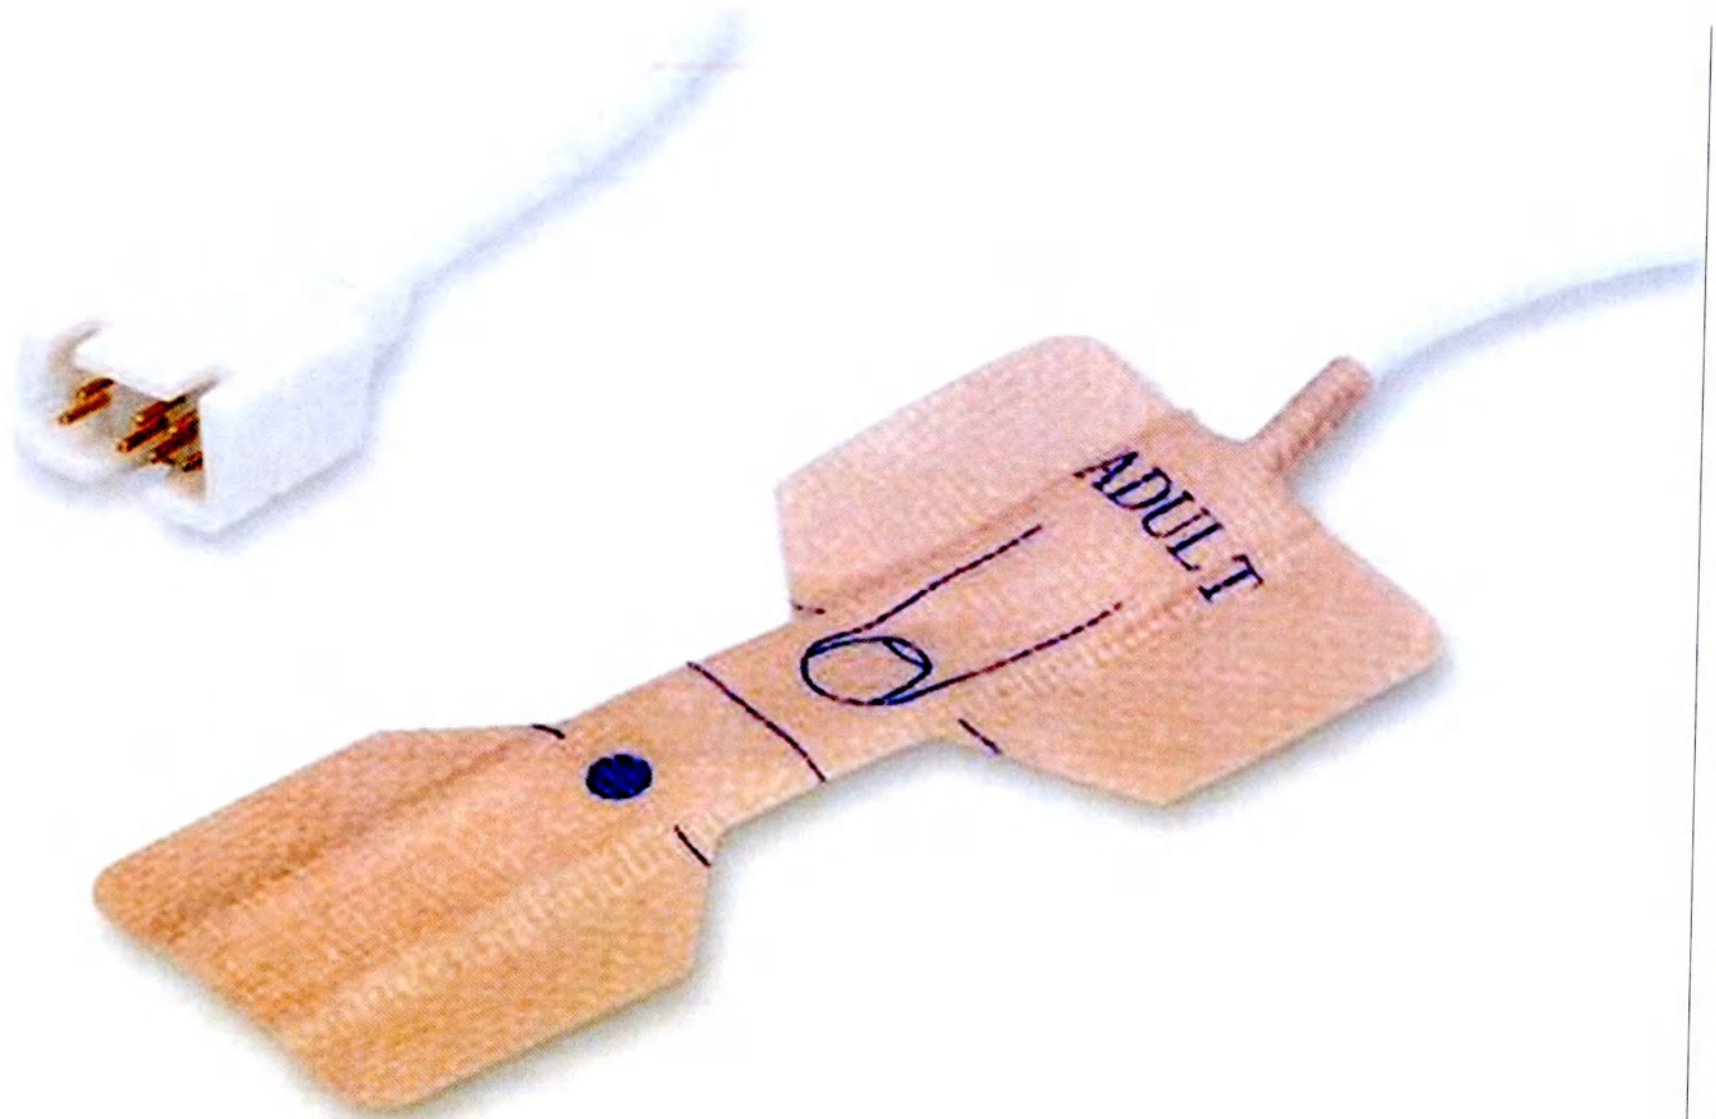


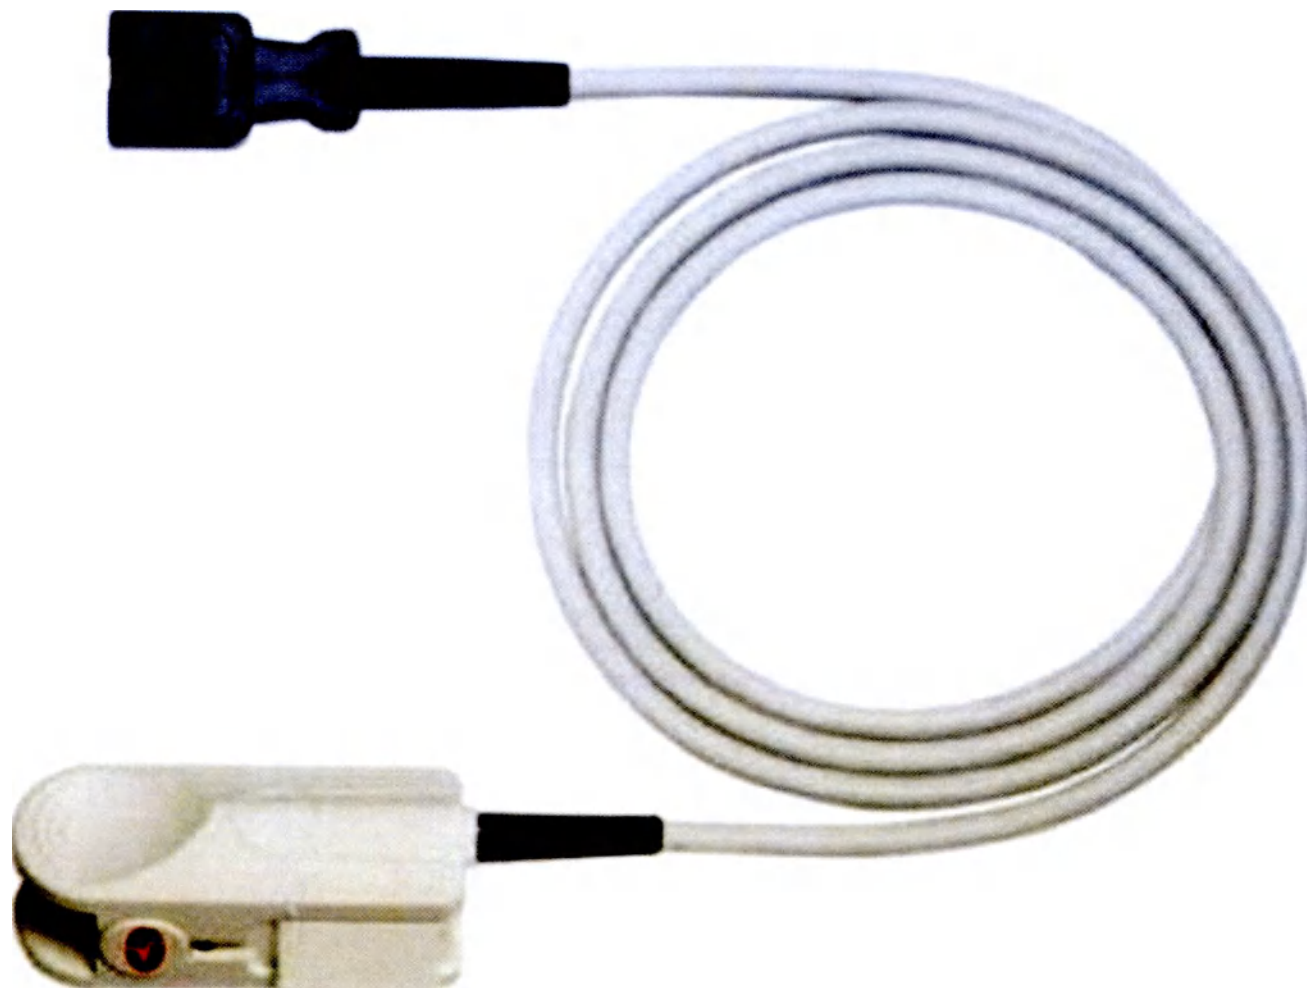









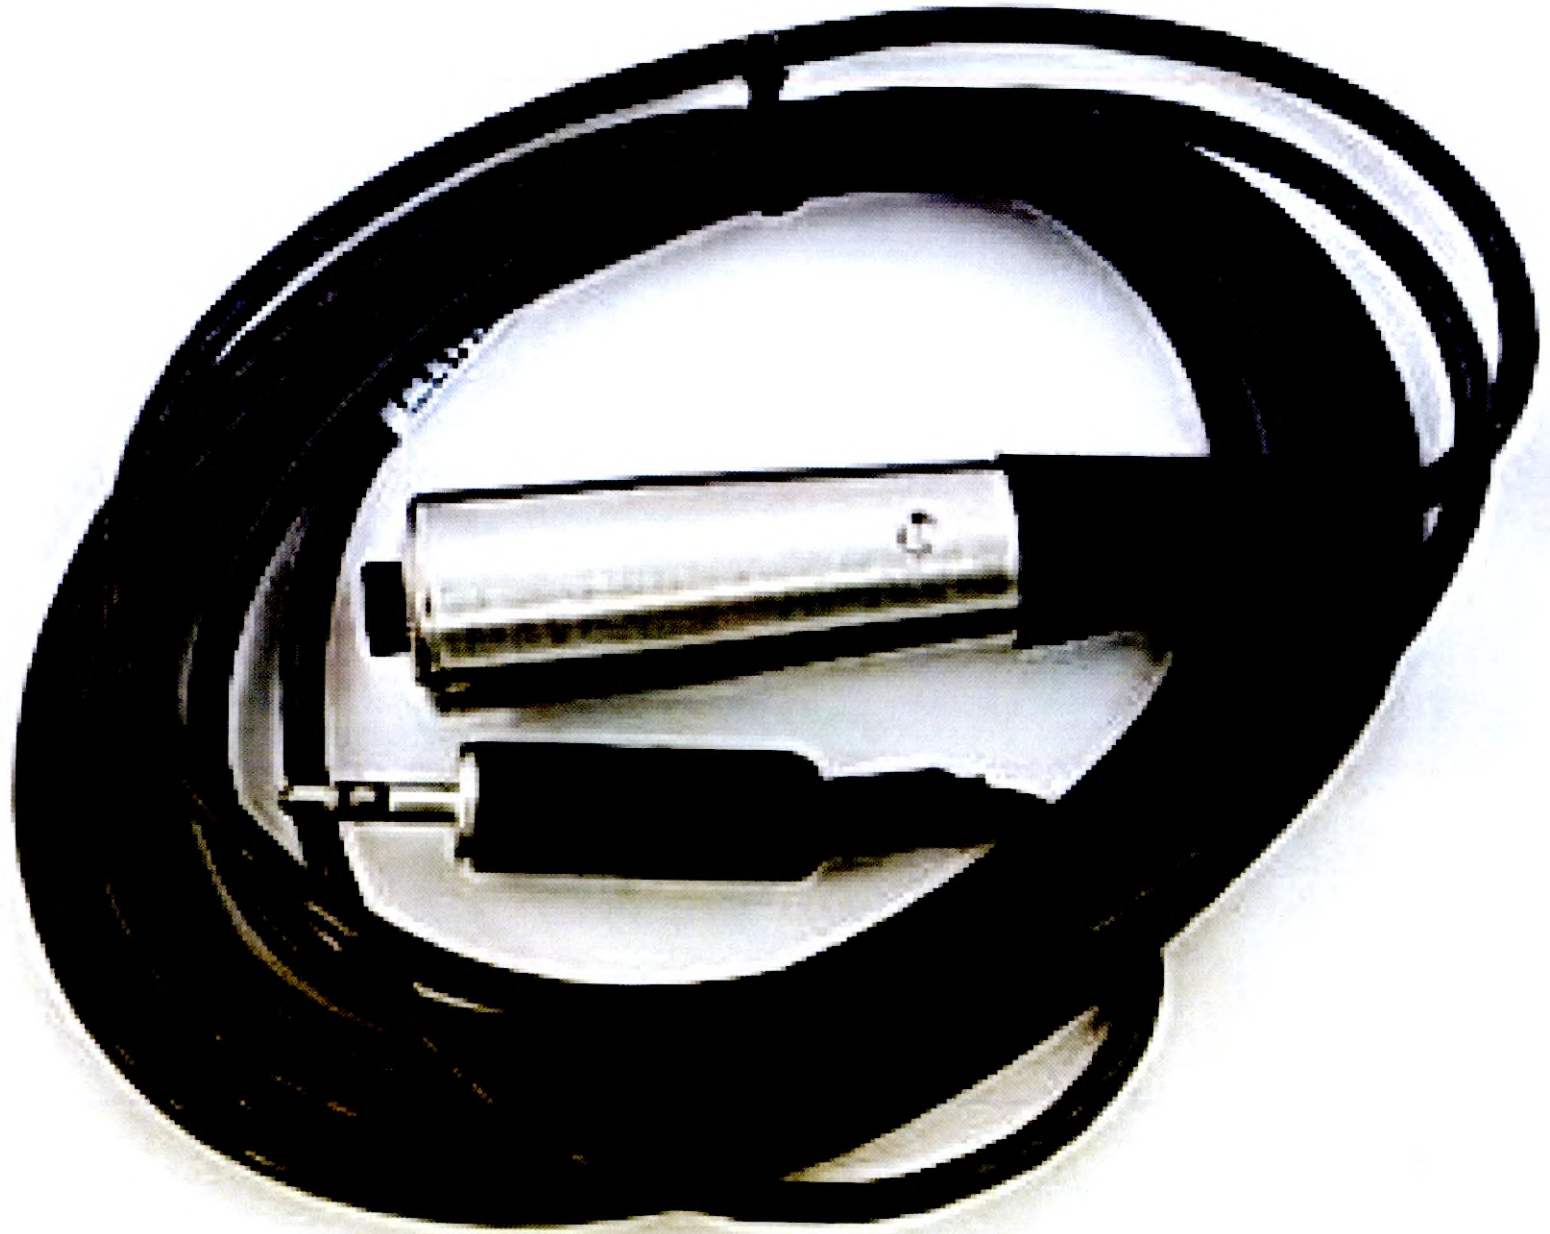

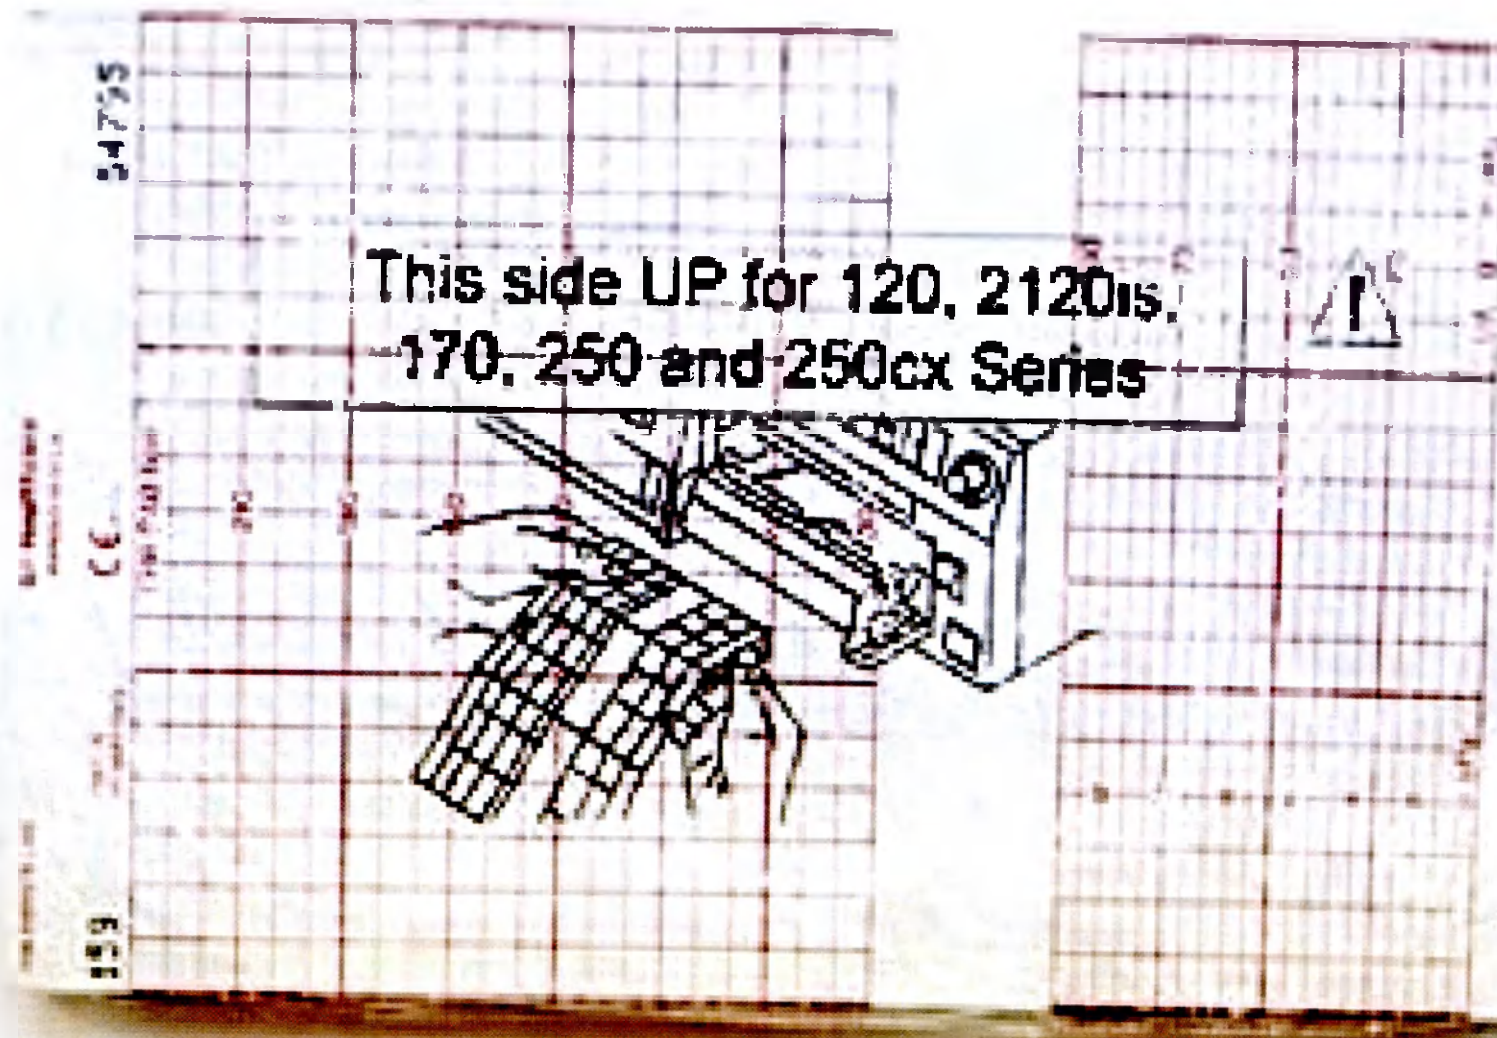

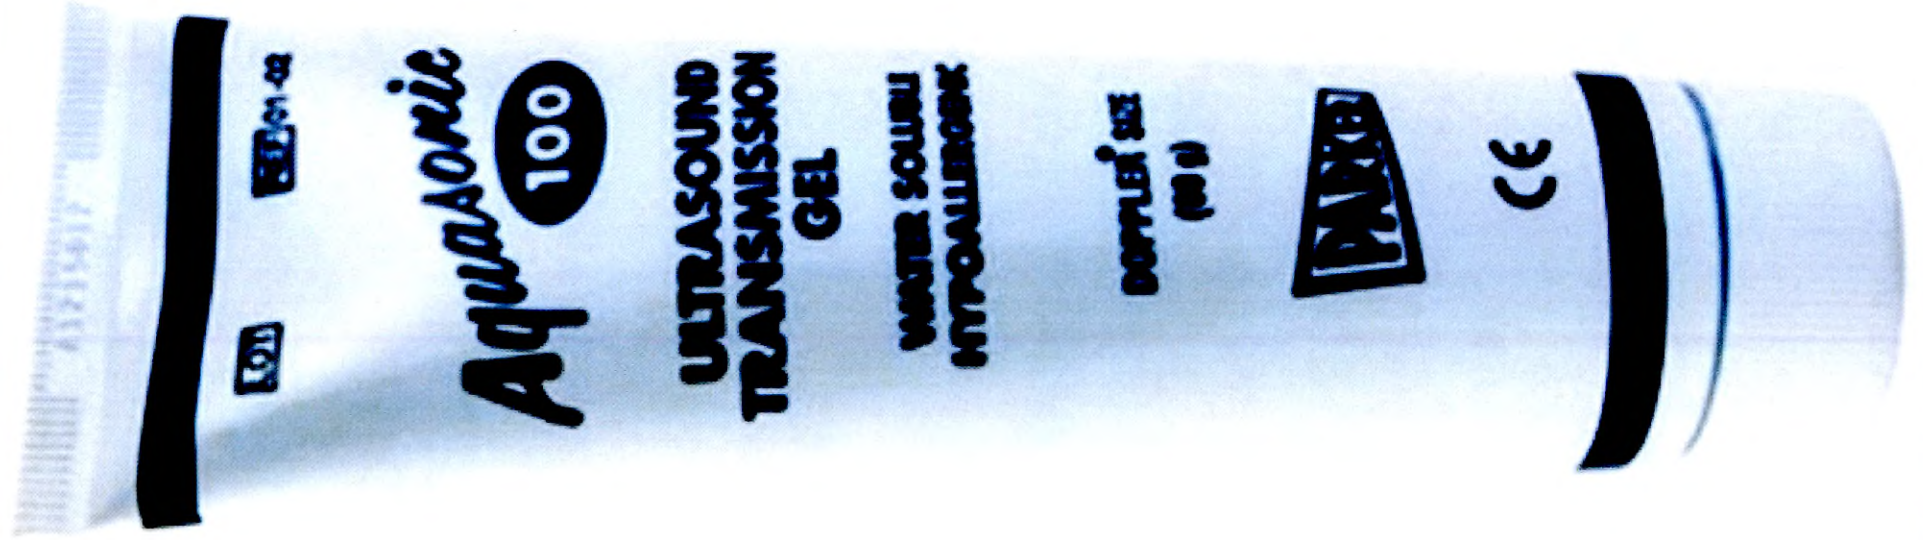












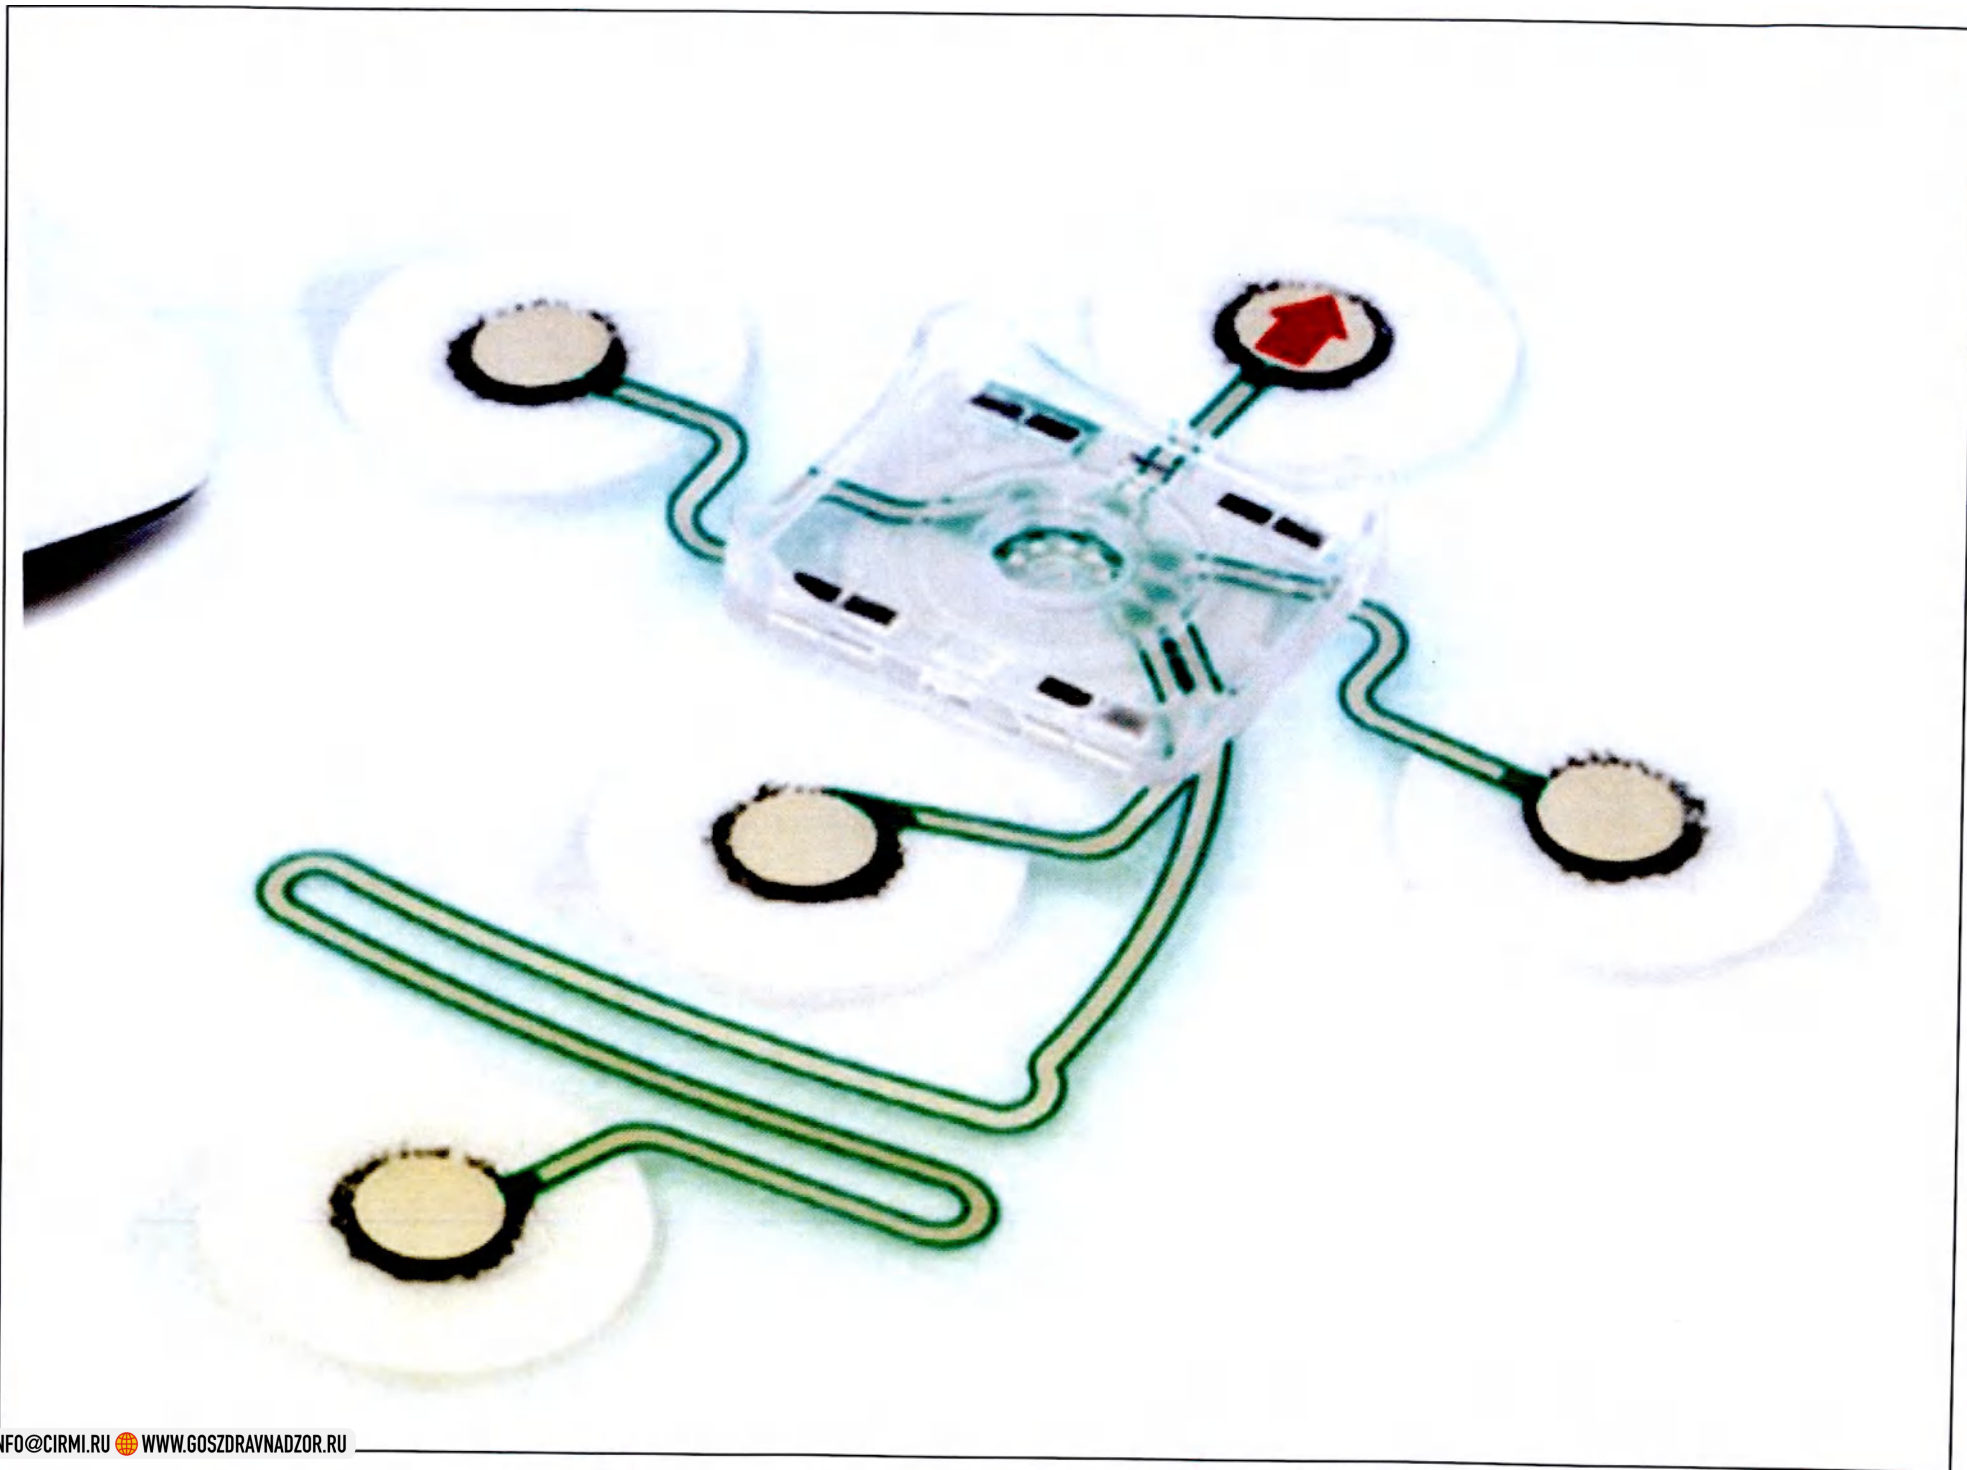


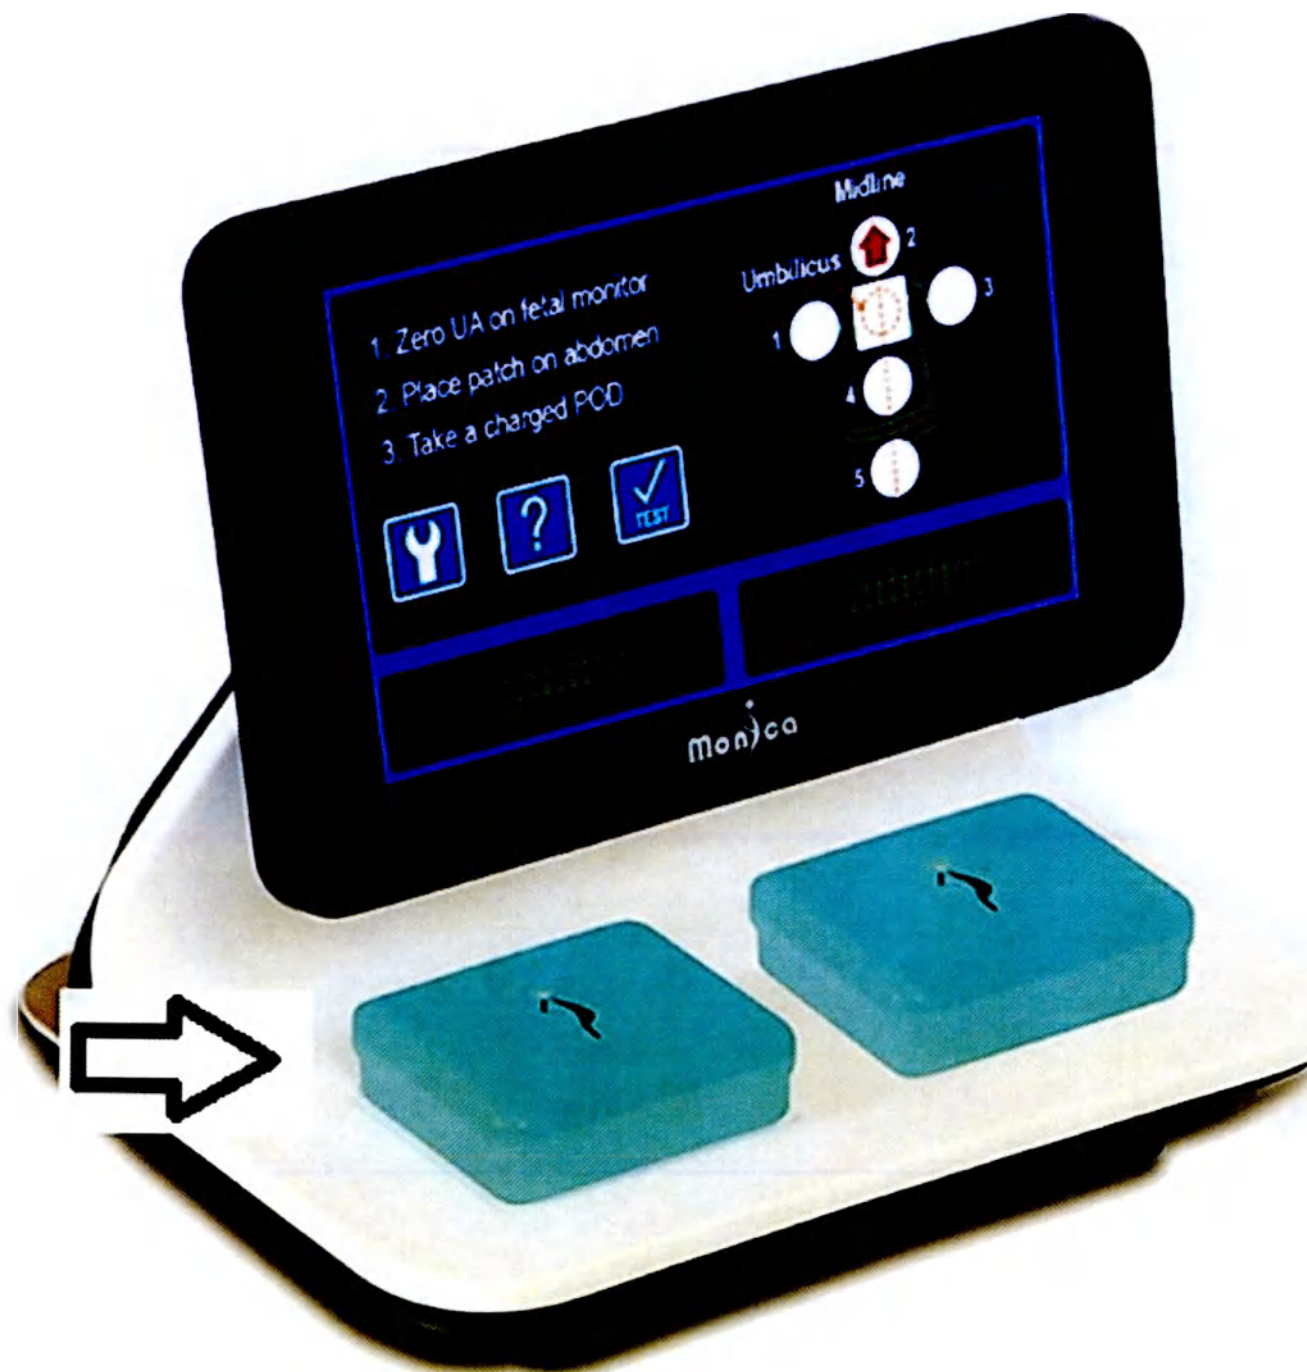


Monica Novii Wireless Patch System Operation and Maintenance Manual

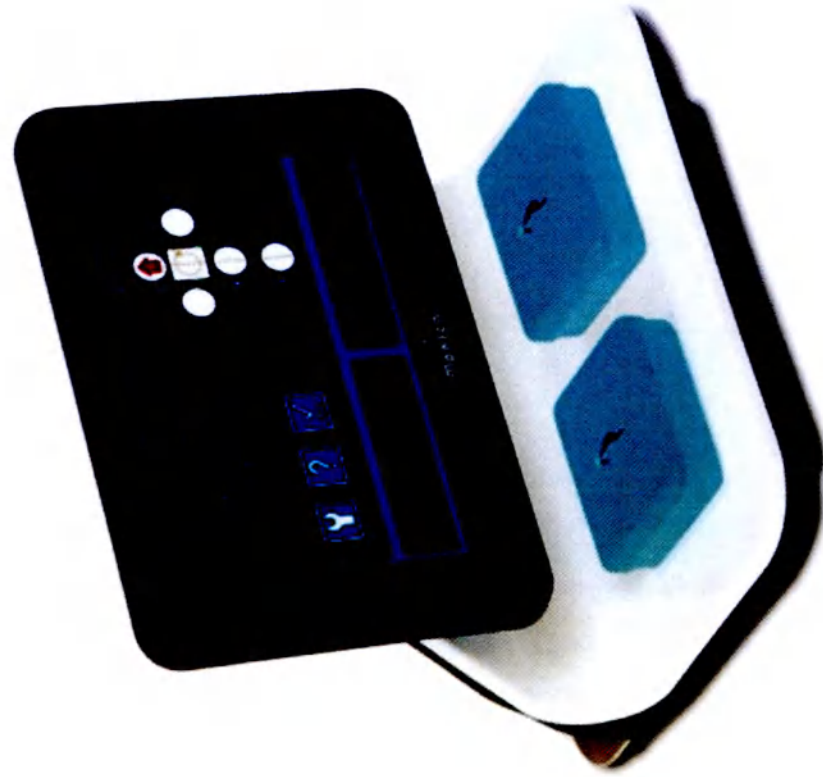



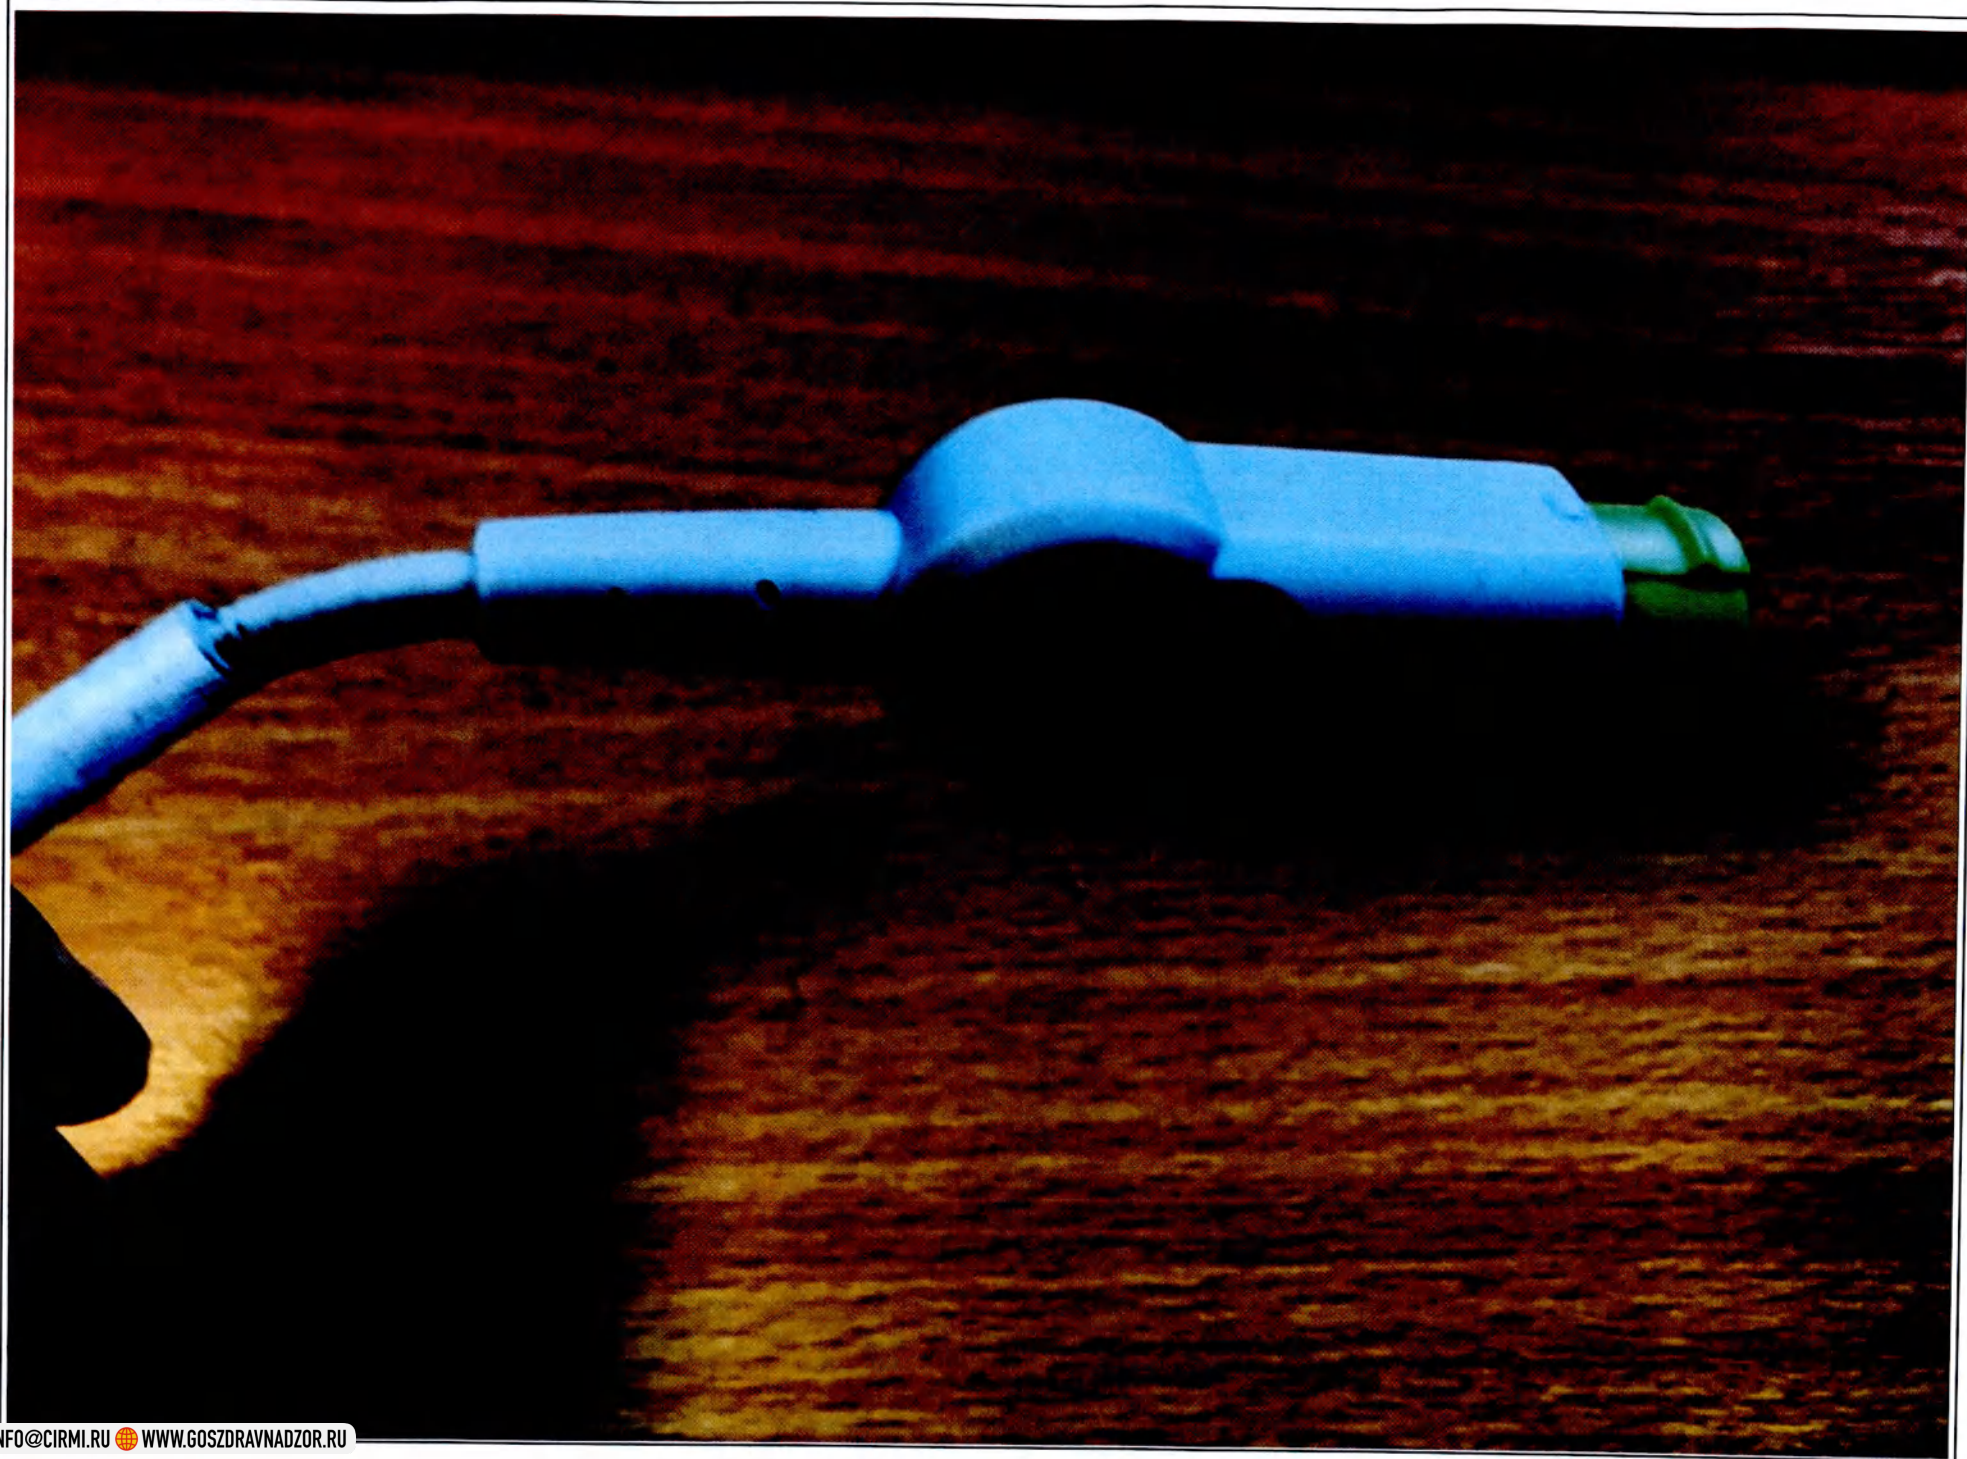

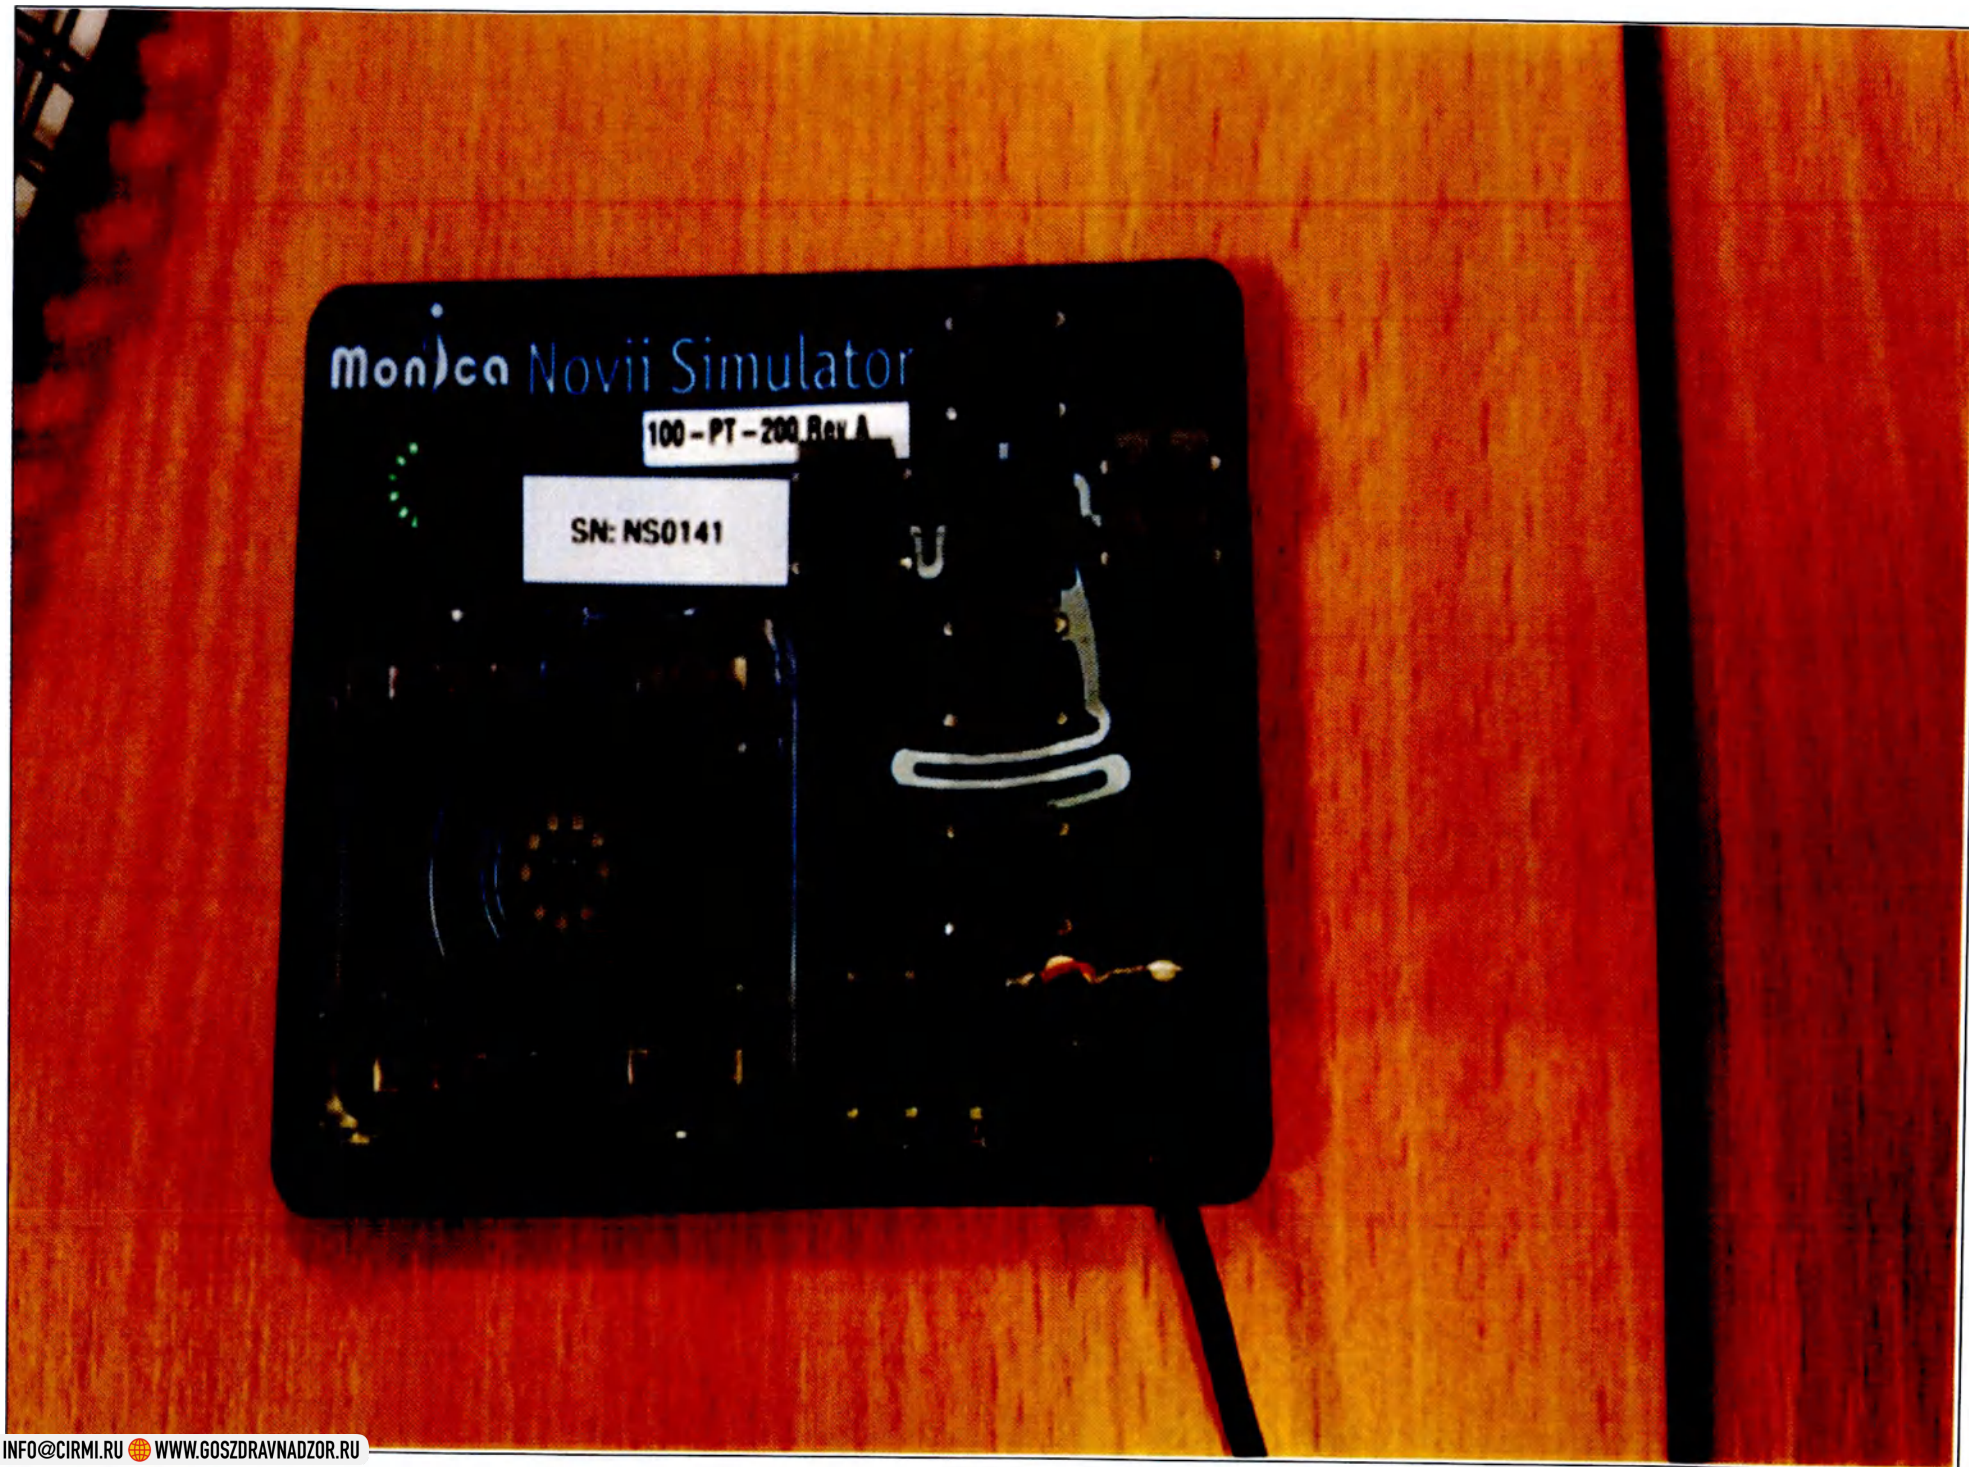





Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 25 листа (ов)

Директор департамента регистрации и
Сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



Тарахина С. Б.