

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий – Индивидуальный
предприниматель ООО "Дентекс"



А.В. Завалюк

**Фотографические изображения
на медицинское изделие
«Аппарат лазерный эрбиевый стоматологический LiteTouch с
принадлежностями»**

2018


Оглавление


Аппарат лазерный эрбиевый стоматологический LiteTouch с принадлежностями:	3
I. Аппарат лазерный эрбиевый стоматологический LiteTouch , в составе:	3
- Аппликатор лазерный	4
- Блок основной	6
- Ножной переключатель	12
- Кейс для лазерного аппликатора	15
- Инструмент для разборки наконечника	17
- Кабель питания	19
- Комплект насадок	22
- Угловой наконечник	25
- Очки защитные	29
- Перемычка дистанционной блокировки	32
- Руководство по эксплуатации	34
- Трубка воздушная	35
II. Принадлежности:	37
- Держатель насадок	38
- Зеркала выходные	40
- Знак лазерной опасности	42
- Кольца уплотнительные	43
- Палочки для очистки зеркал выходных	44
- Смазка силиконовая для колец уплотнительных	46
- Фиксатор кабеля питания	48
- Емкость для наполнения водой от панели управления	49

Аппарат лазерный эрбиевый стоматологический LiteTouch с принадлежностями:


I. Ошибка! Источник ссылки не найден., в составе:


- Аппликатор лазерный;

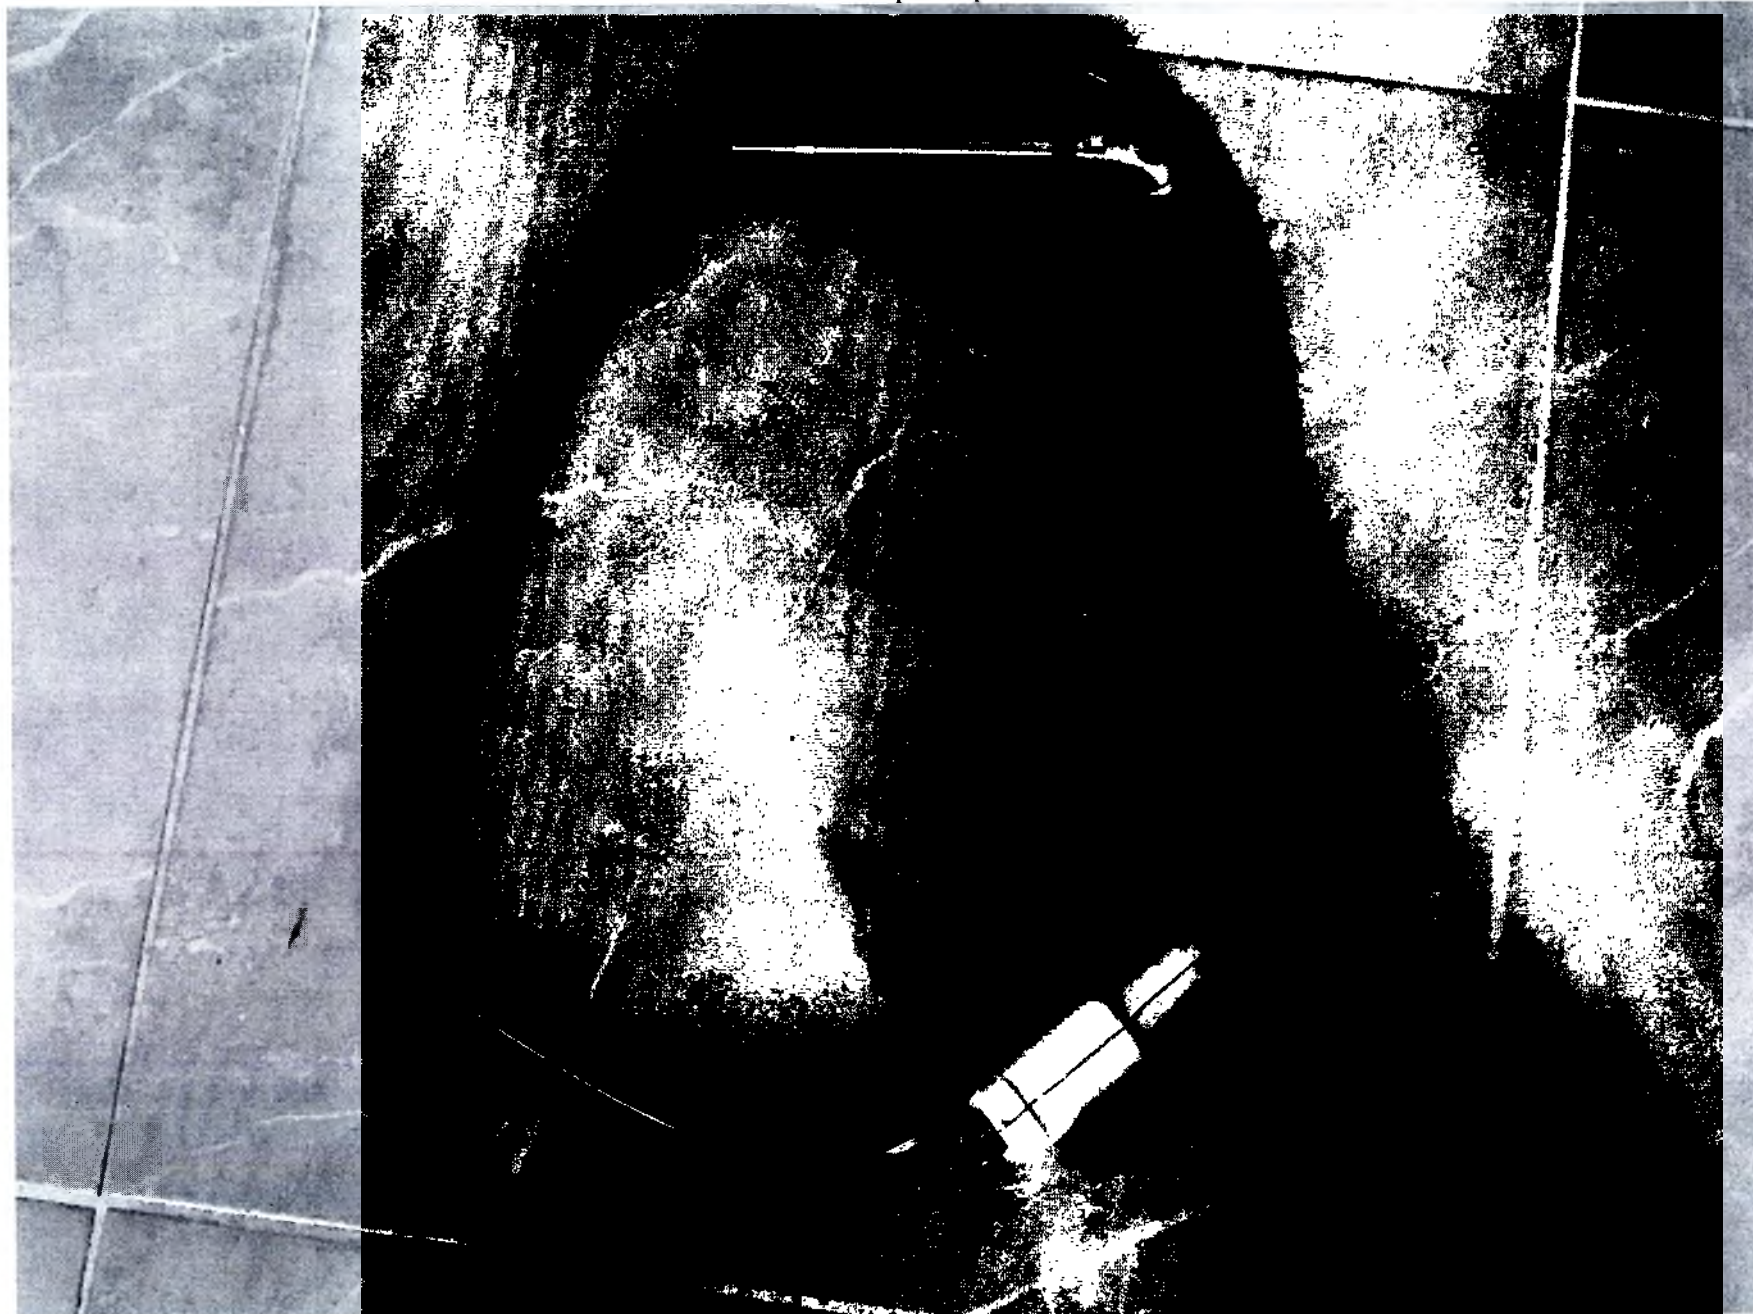


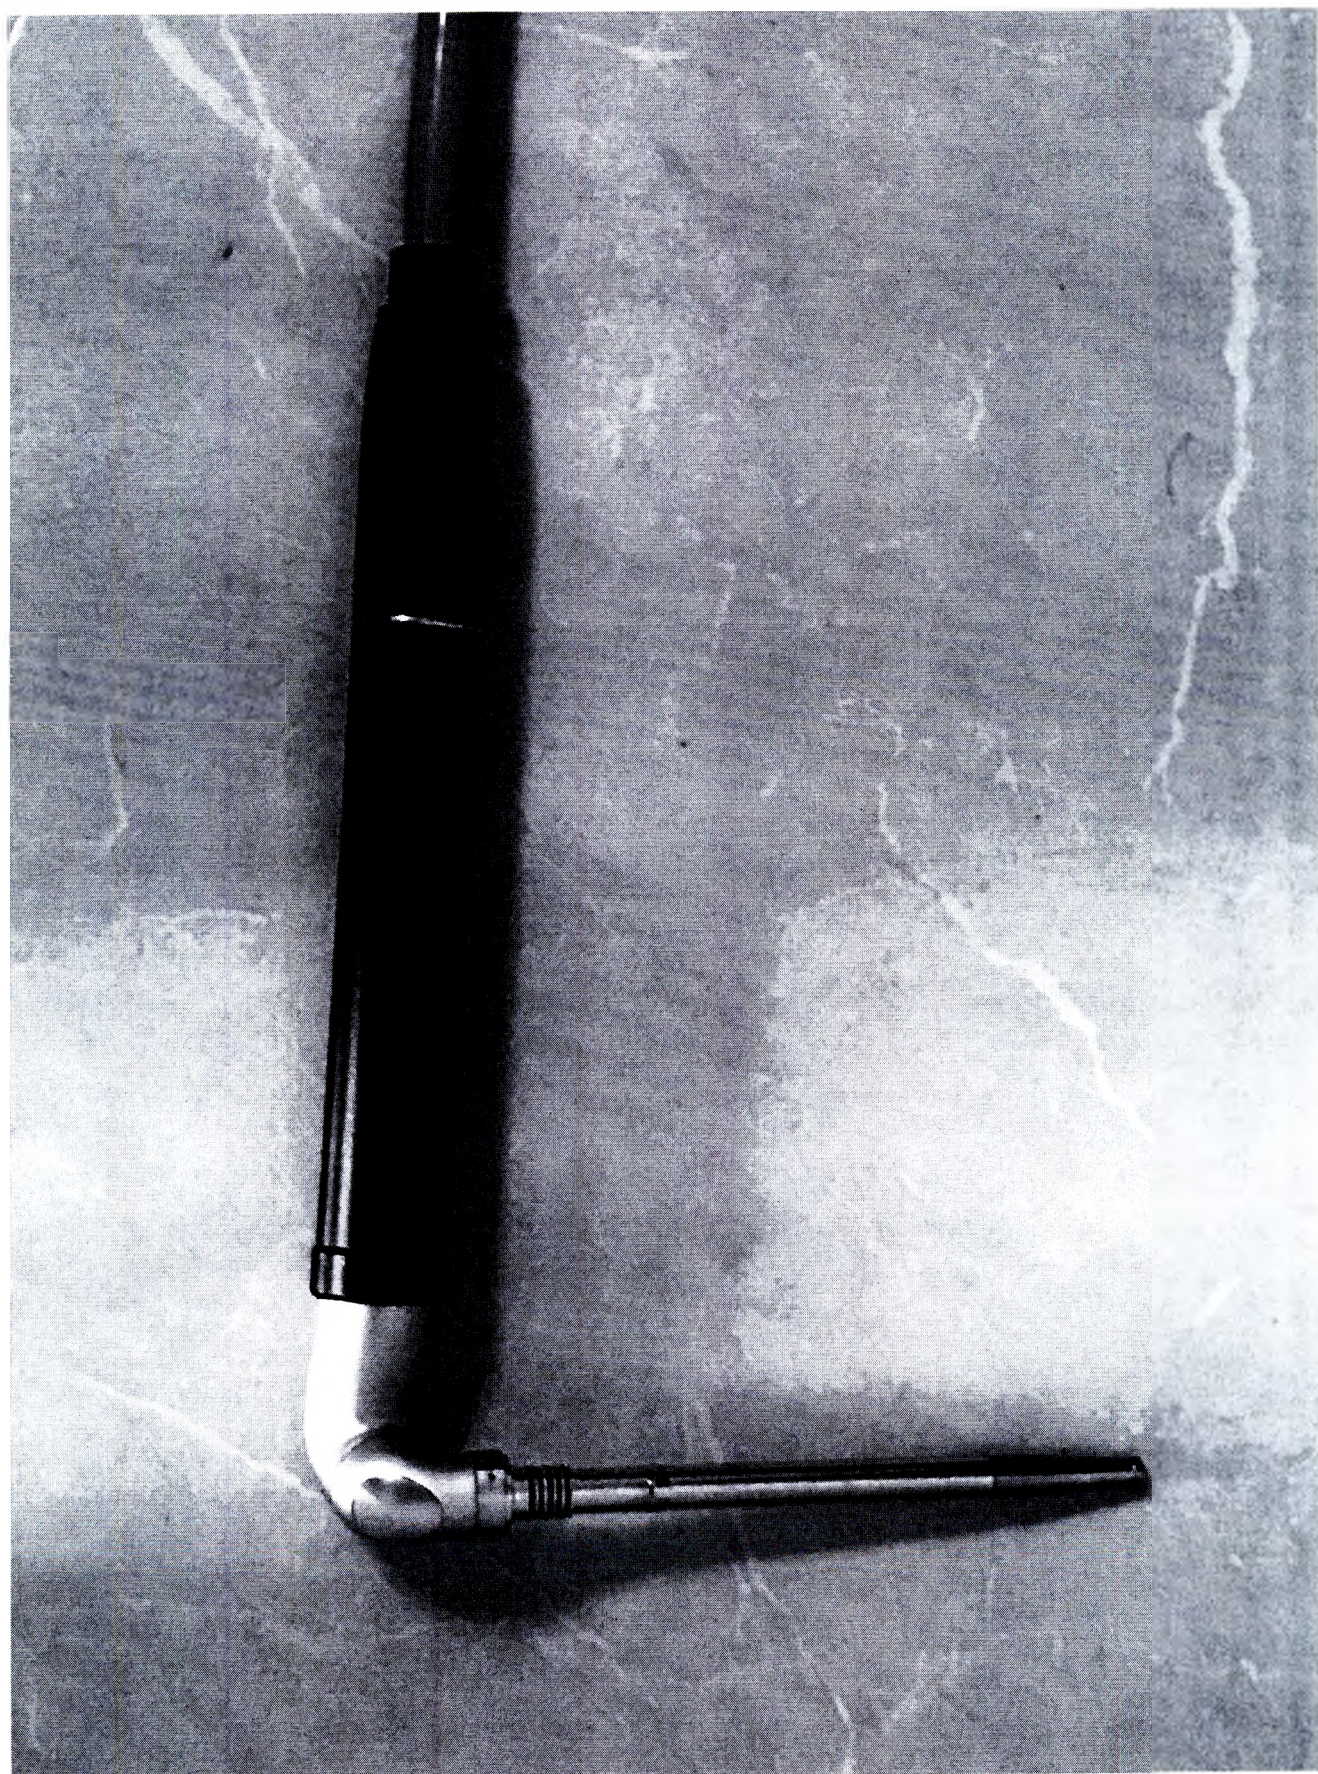


- Блок основной

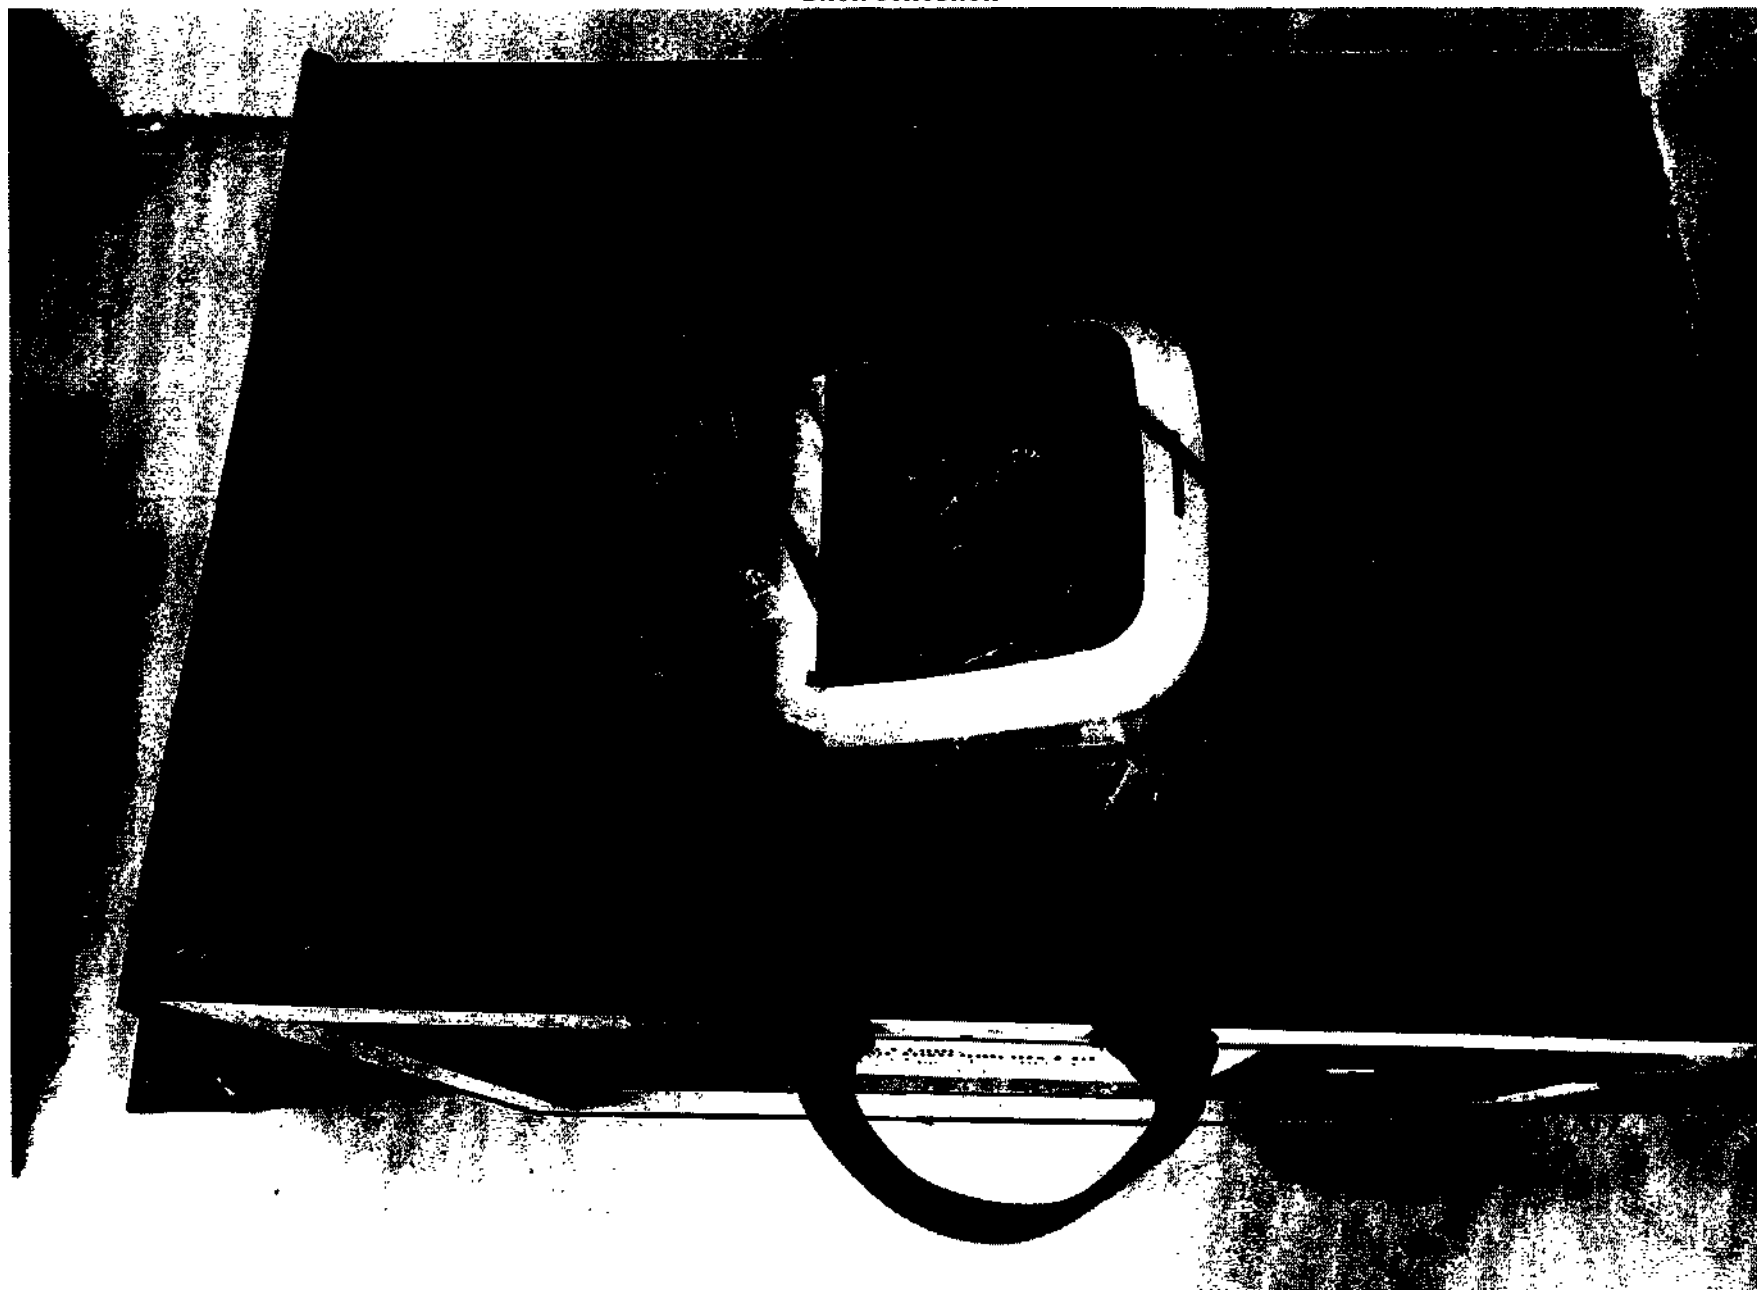

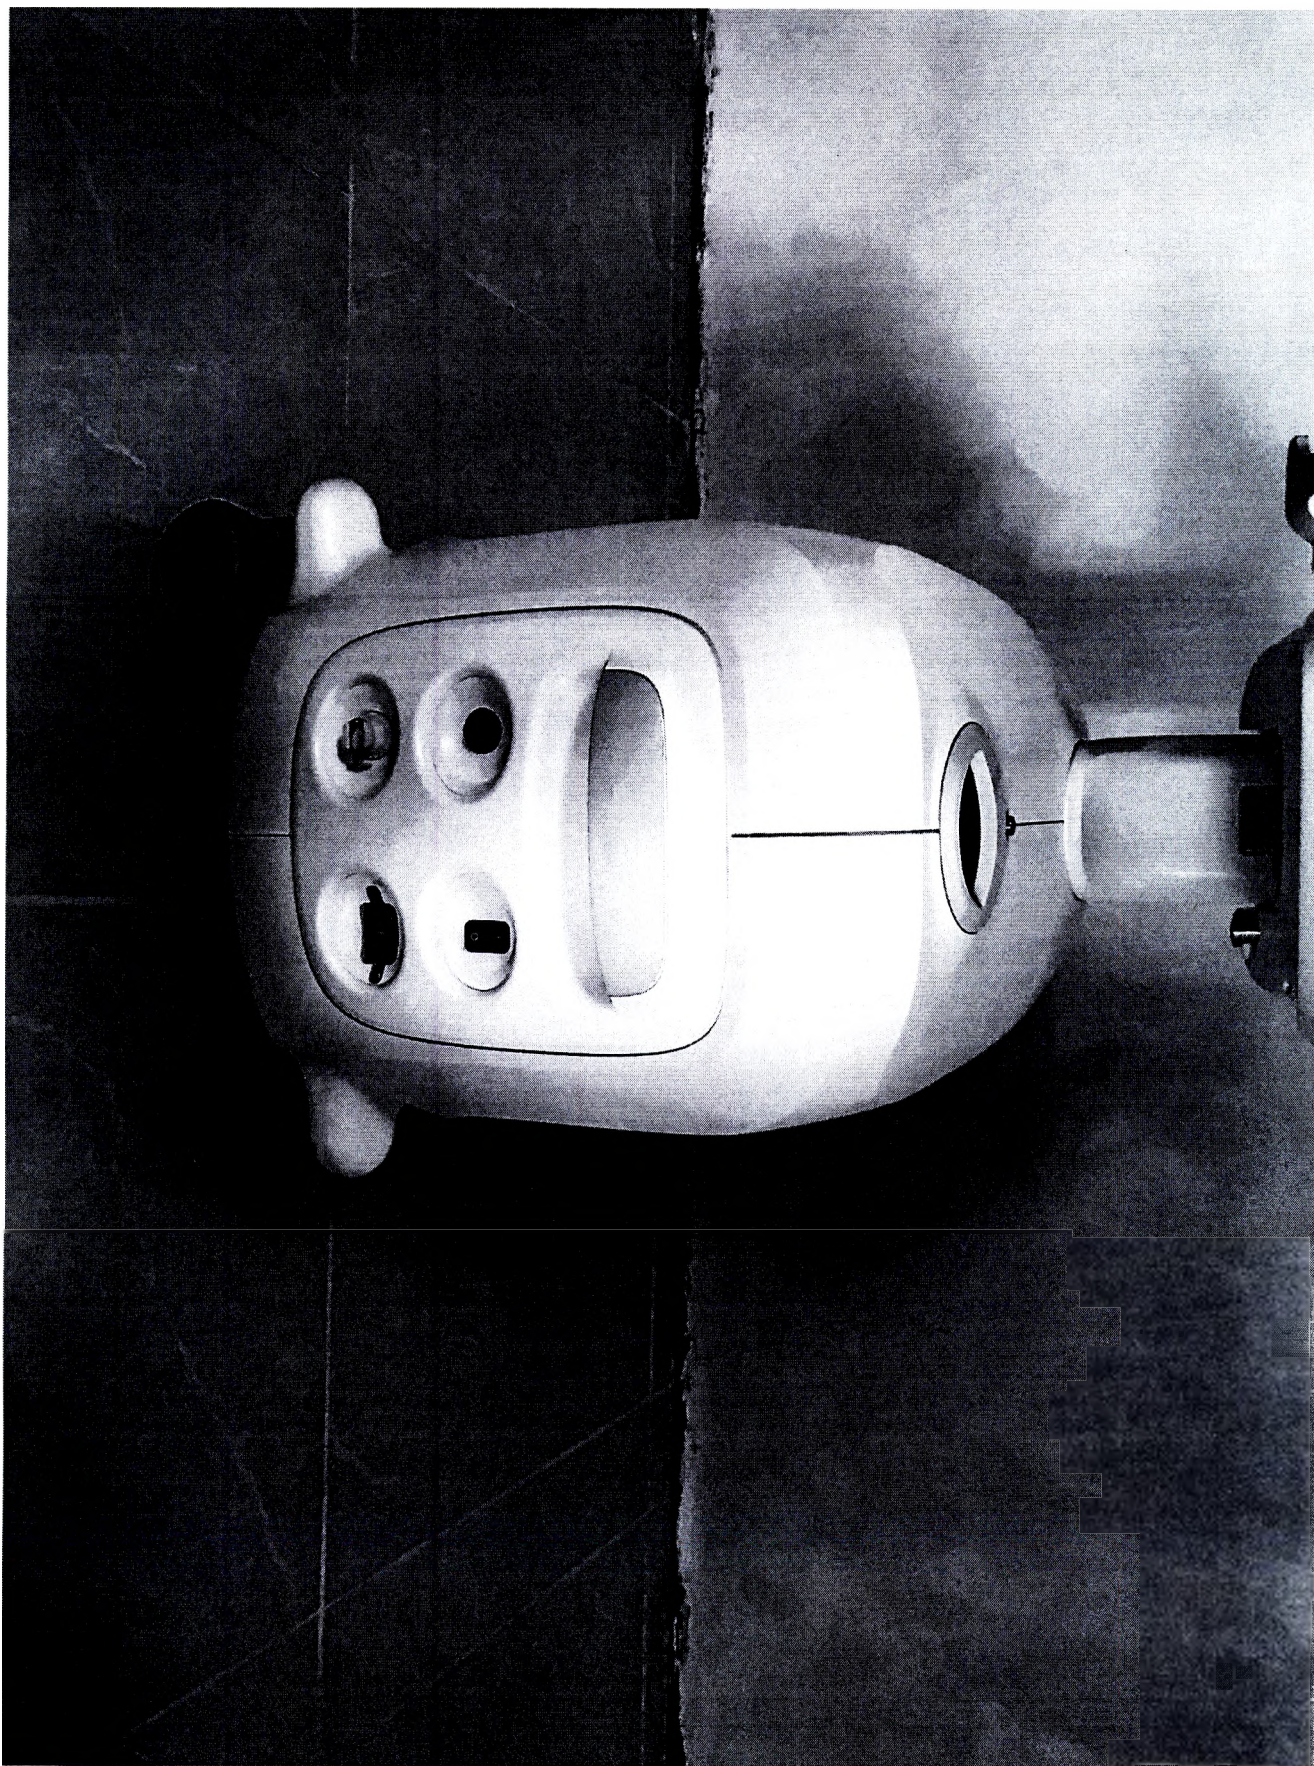

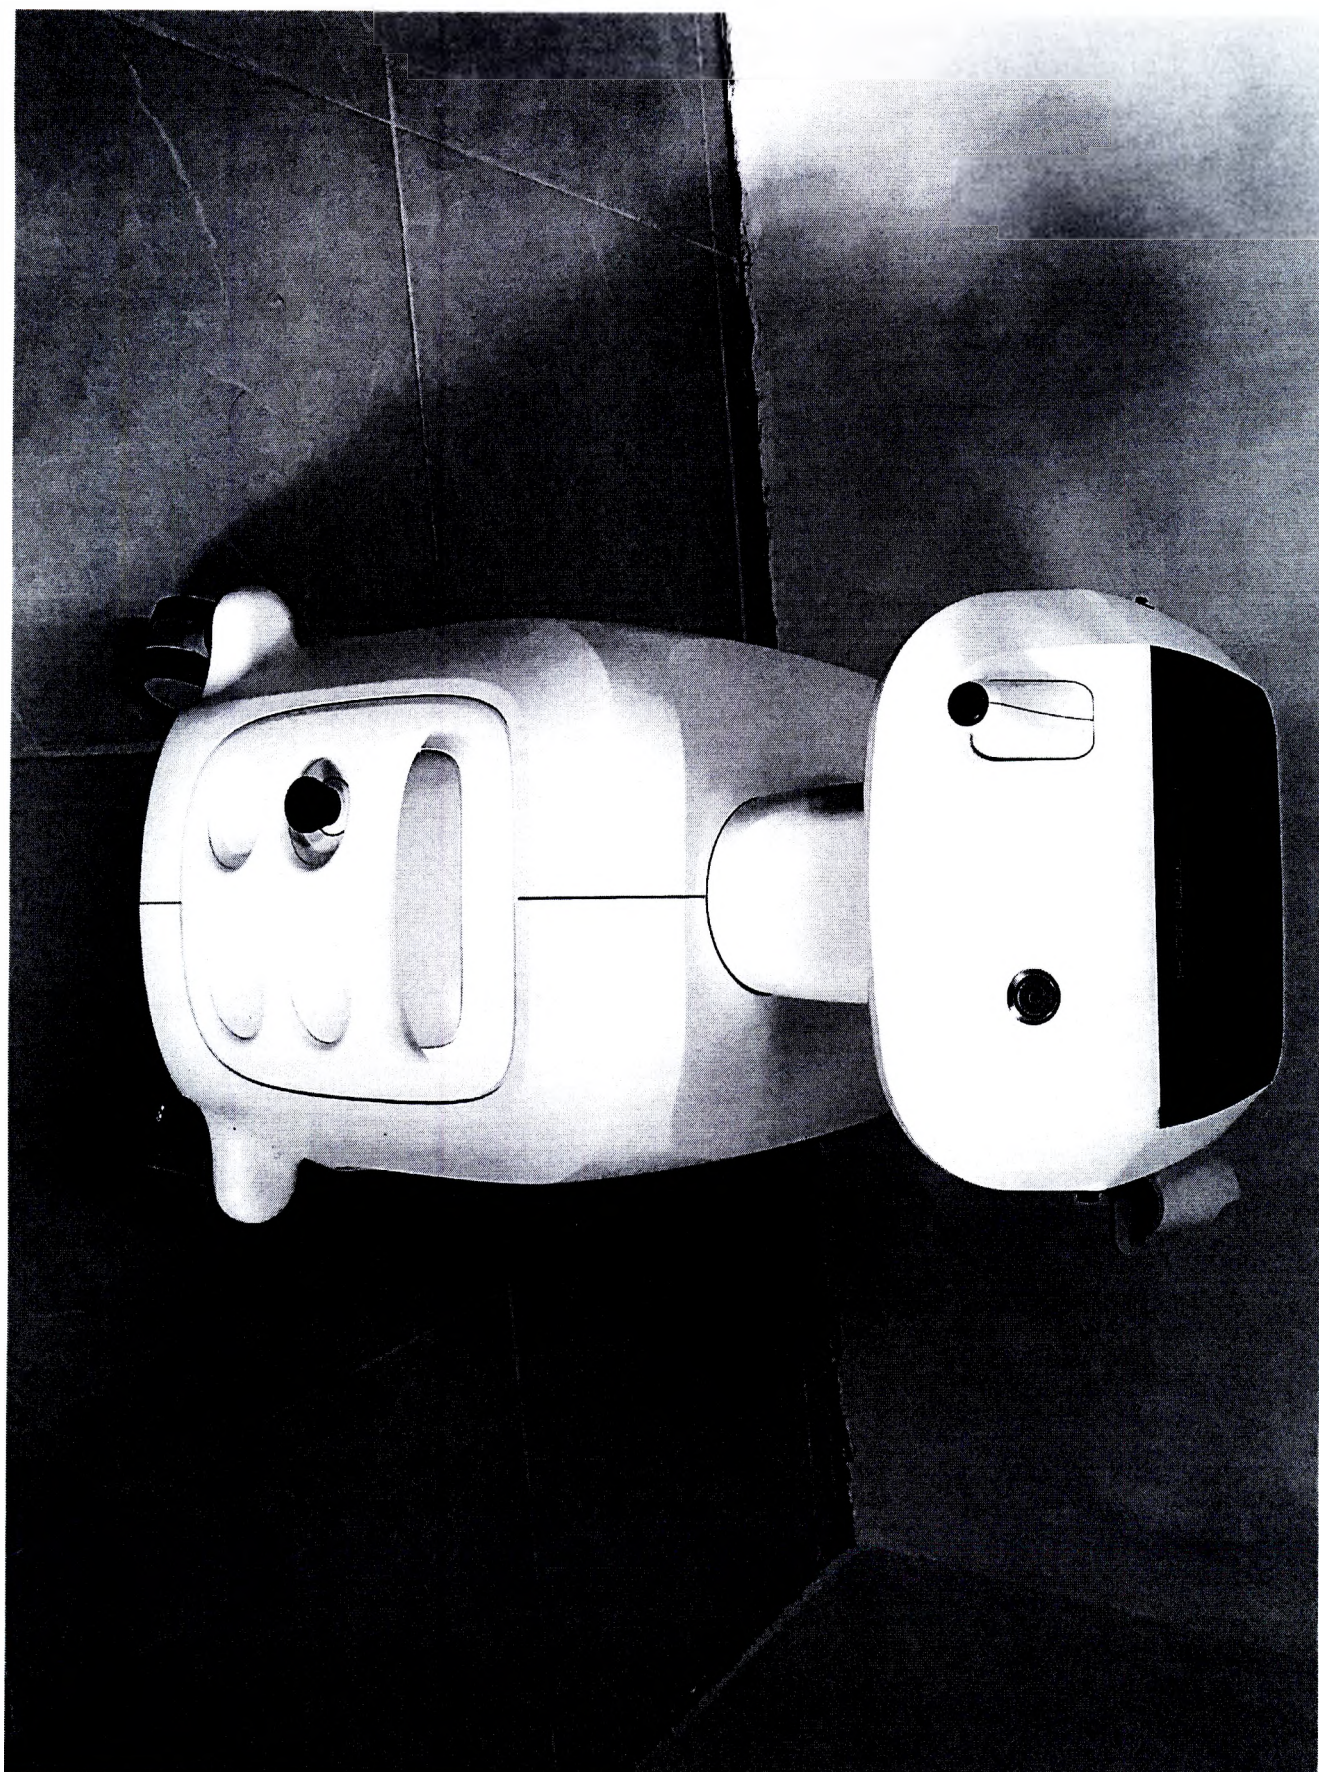



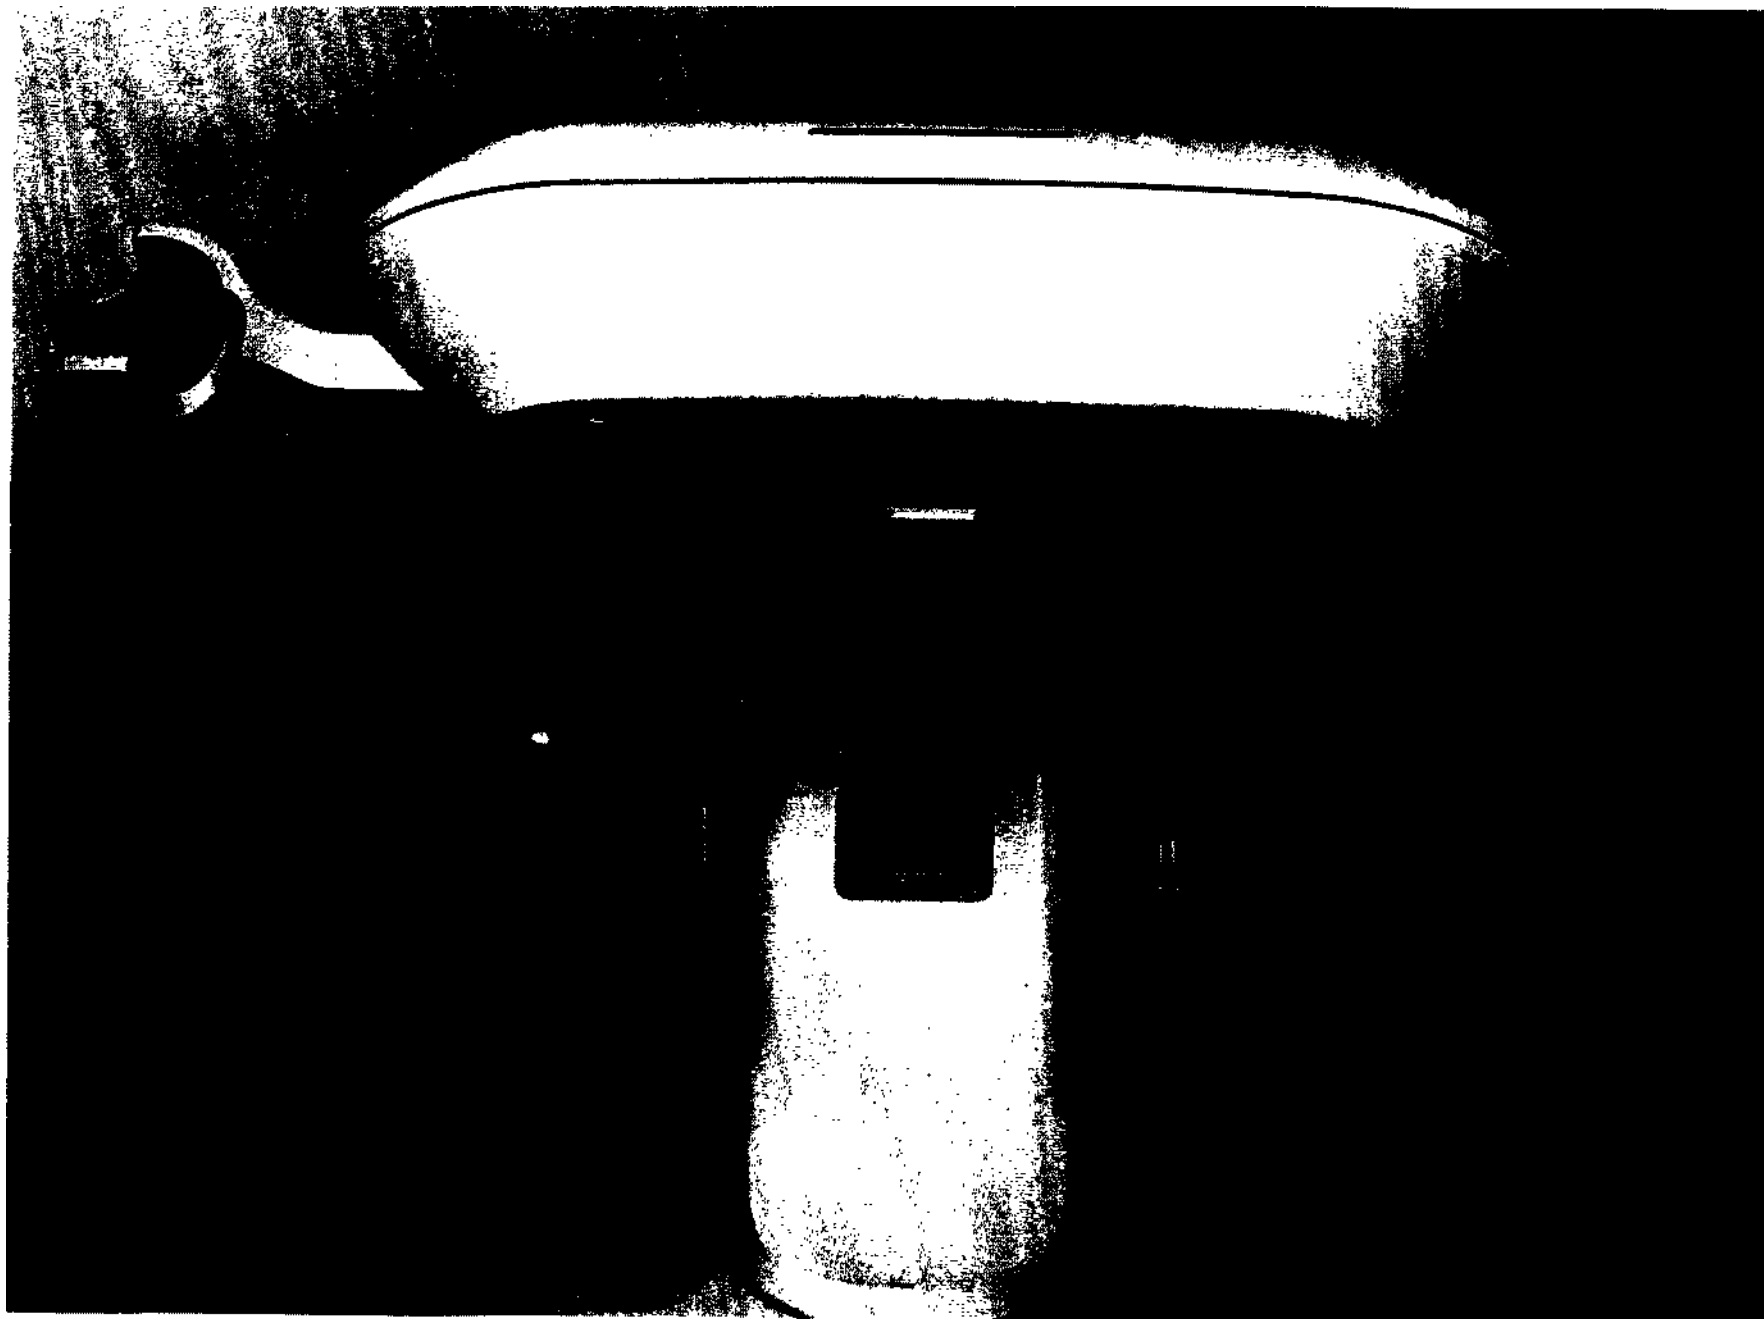



LIGHT
INSTRUMENTS



Light Instruments Ltd.
Tavor Building
Yokneam Industrial Zone
Yokneam Elite, 20692
Israel
Tel: +972 (0)73.244.2600

EC REP

European (EU/EC) Authorized Rep.
CEpartners4U B.V.
Esdoorlaan 13, 3951 DB Maarn
The Netherlands
Tel: +31 (0)343.442.524
www.CEpartners4U.eu

MODEL: LITETOUCH™



LI-FG0012A



POWER:

**100-240V ~ MAX 13A
50-60 Hz.**

THIS DEVICE COMPLIES WITH:

- a) 21 CFR 1040.10/11;
 - b) PART 18 OF THE FCC RULES For CLASS IV Laser Product
- OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:**
- 1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.
 - 2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.


CAUTION!


**U.S. FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE AND USE
BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED PHYSICIAN.**




LI-FG0012A


- Ножной переключатель

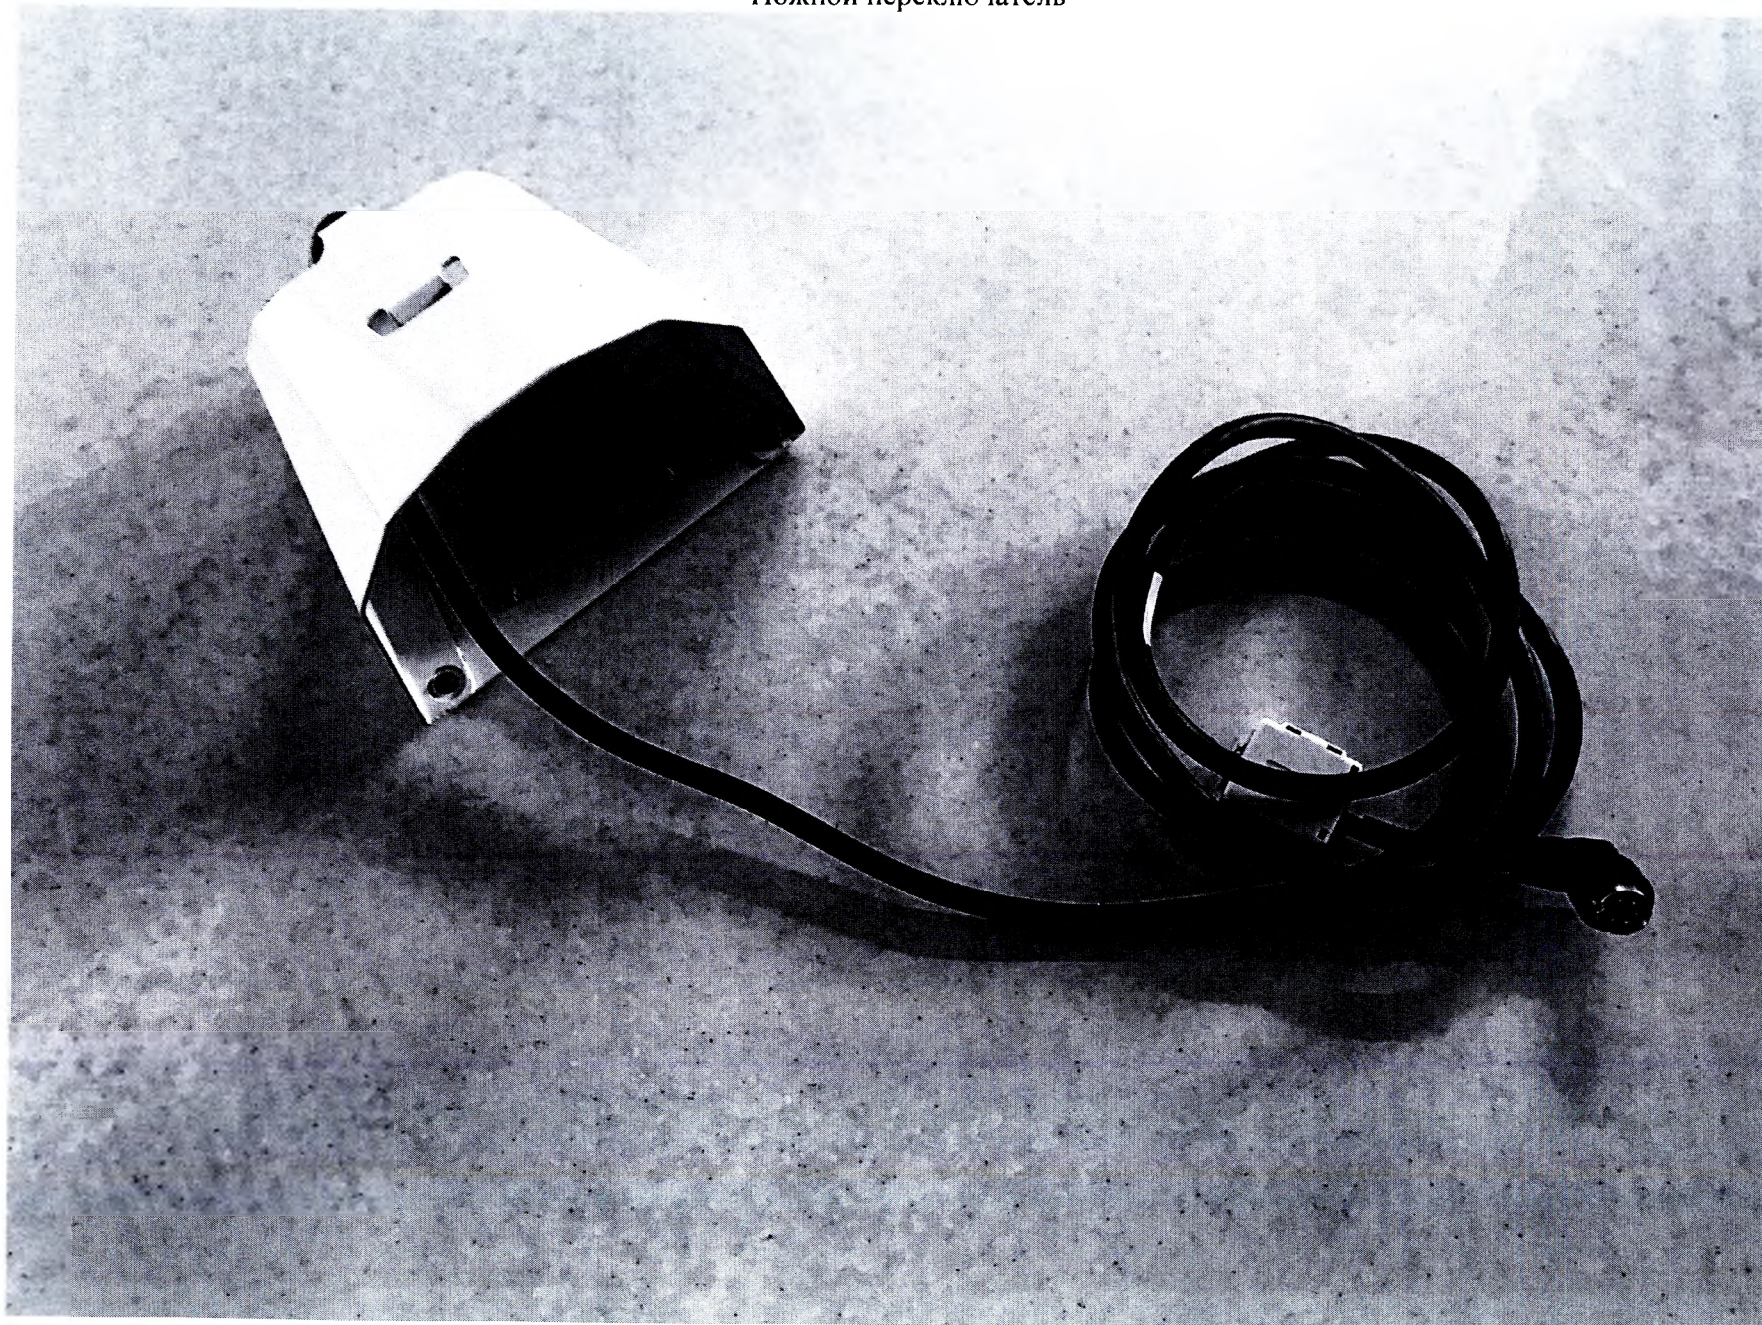

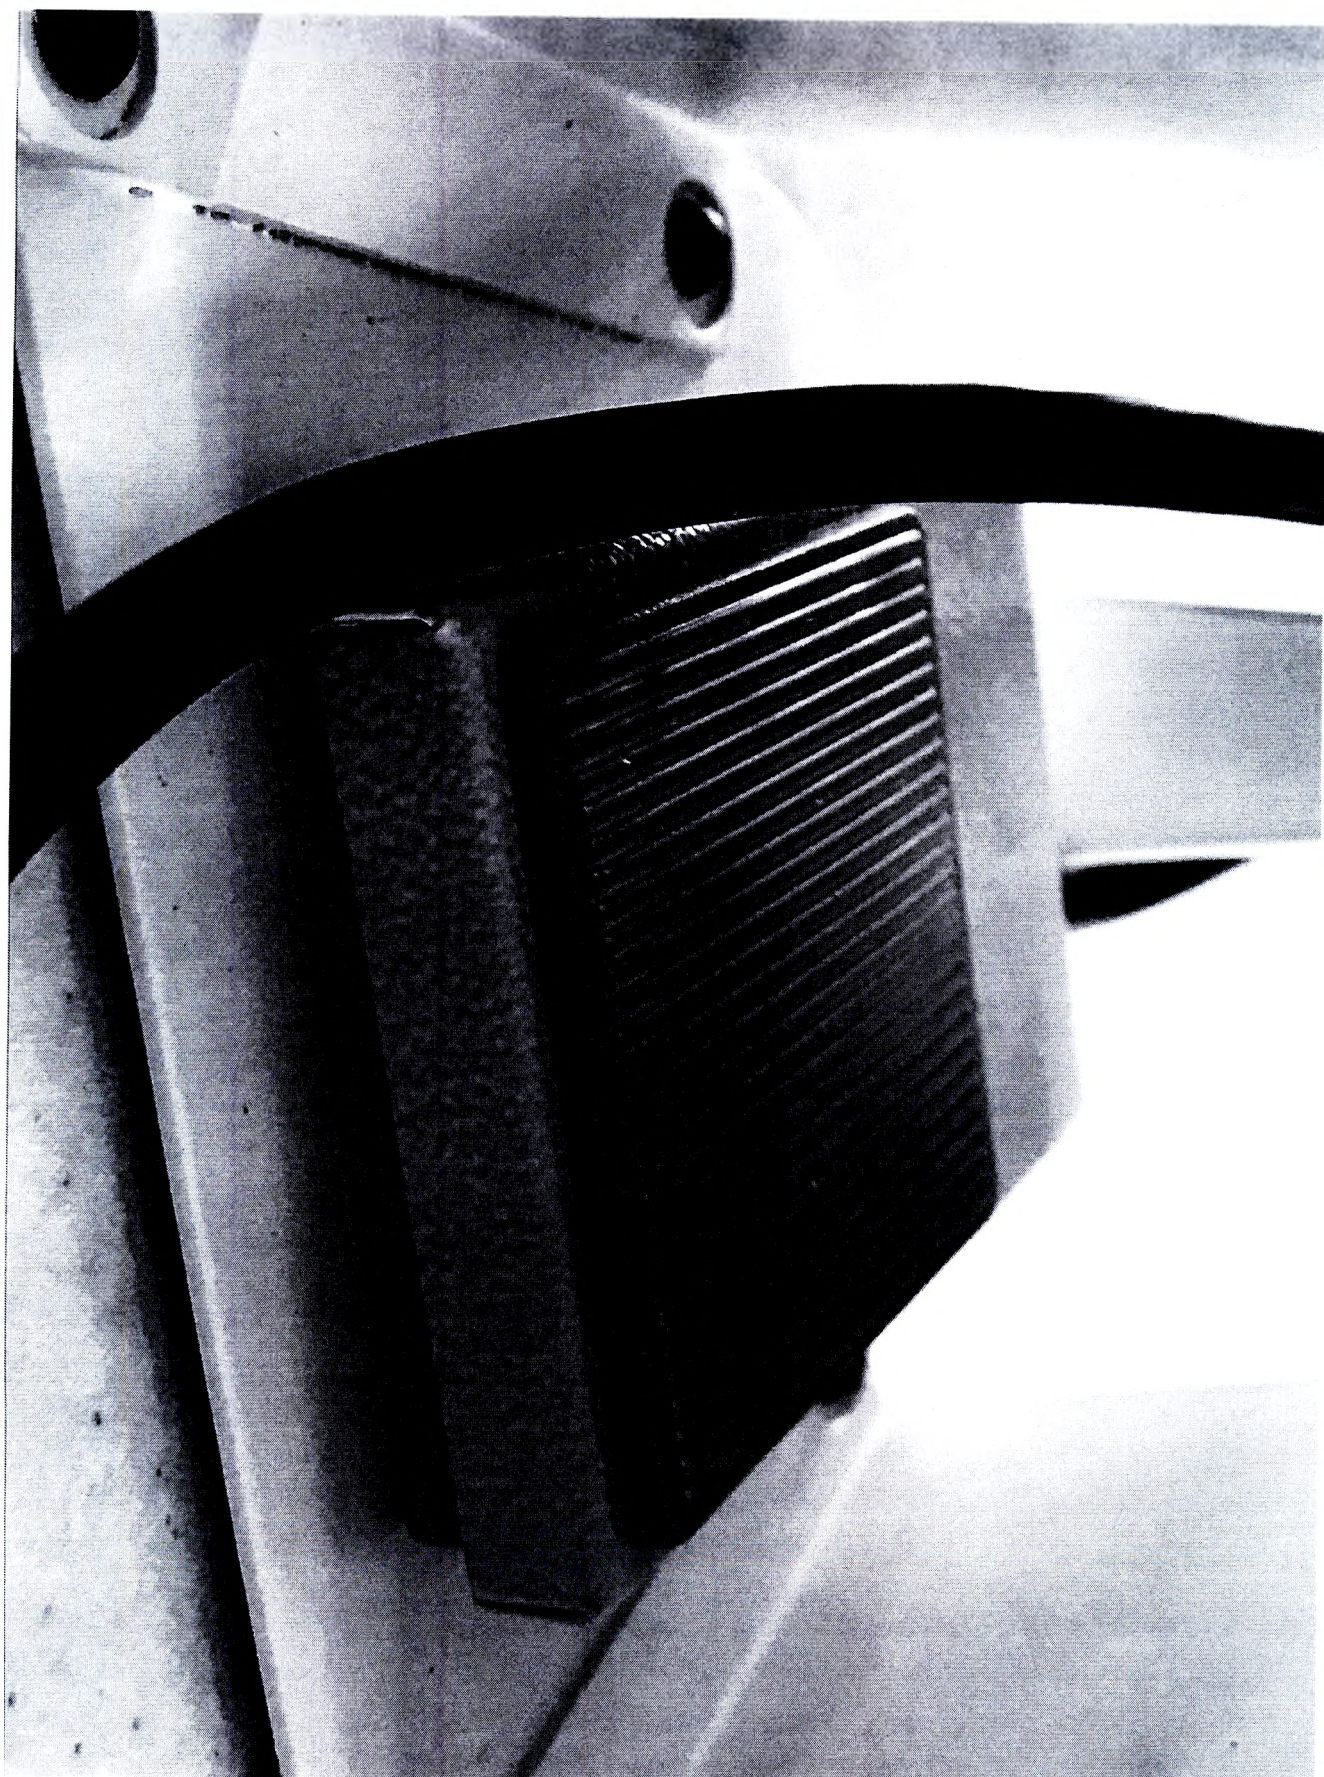

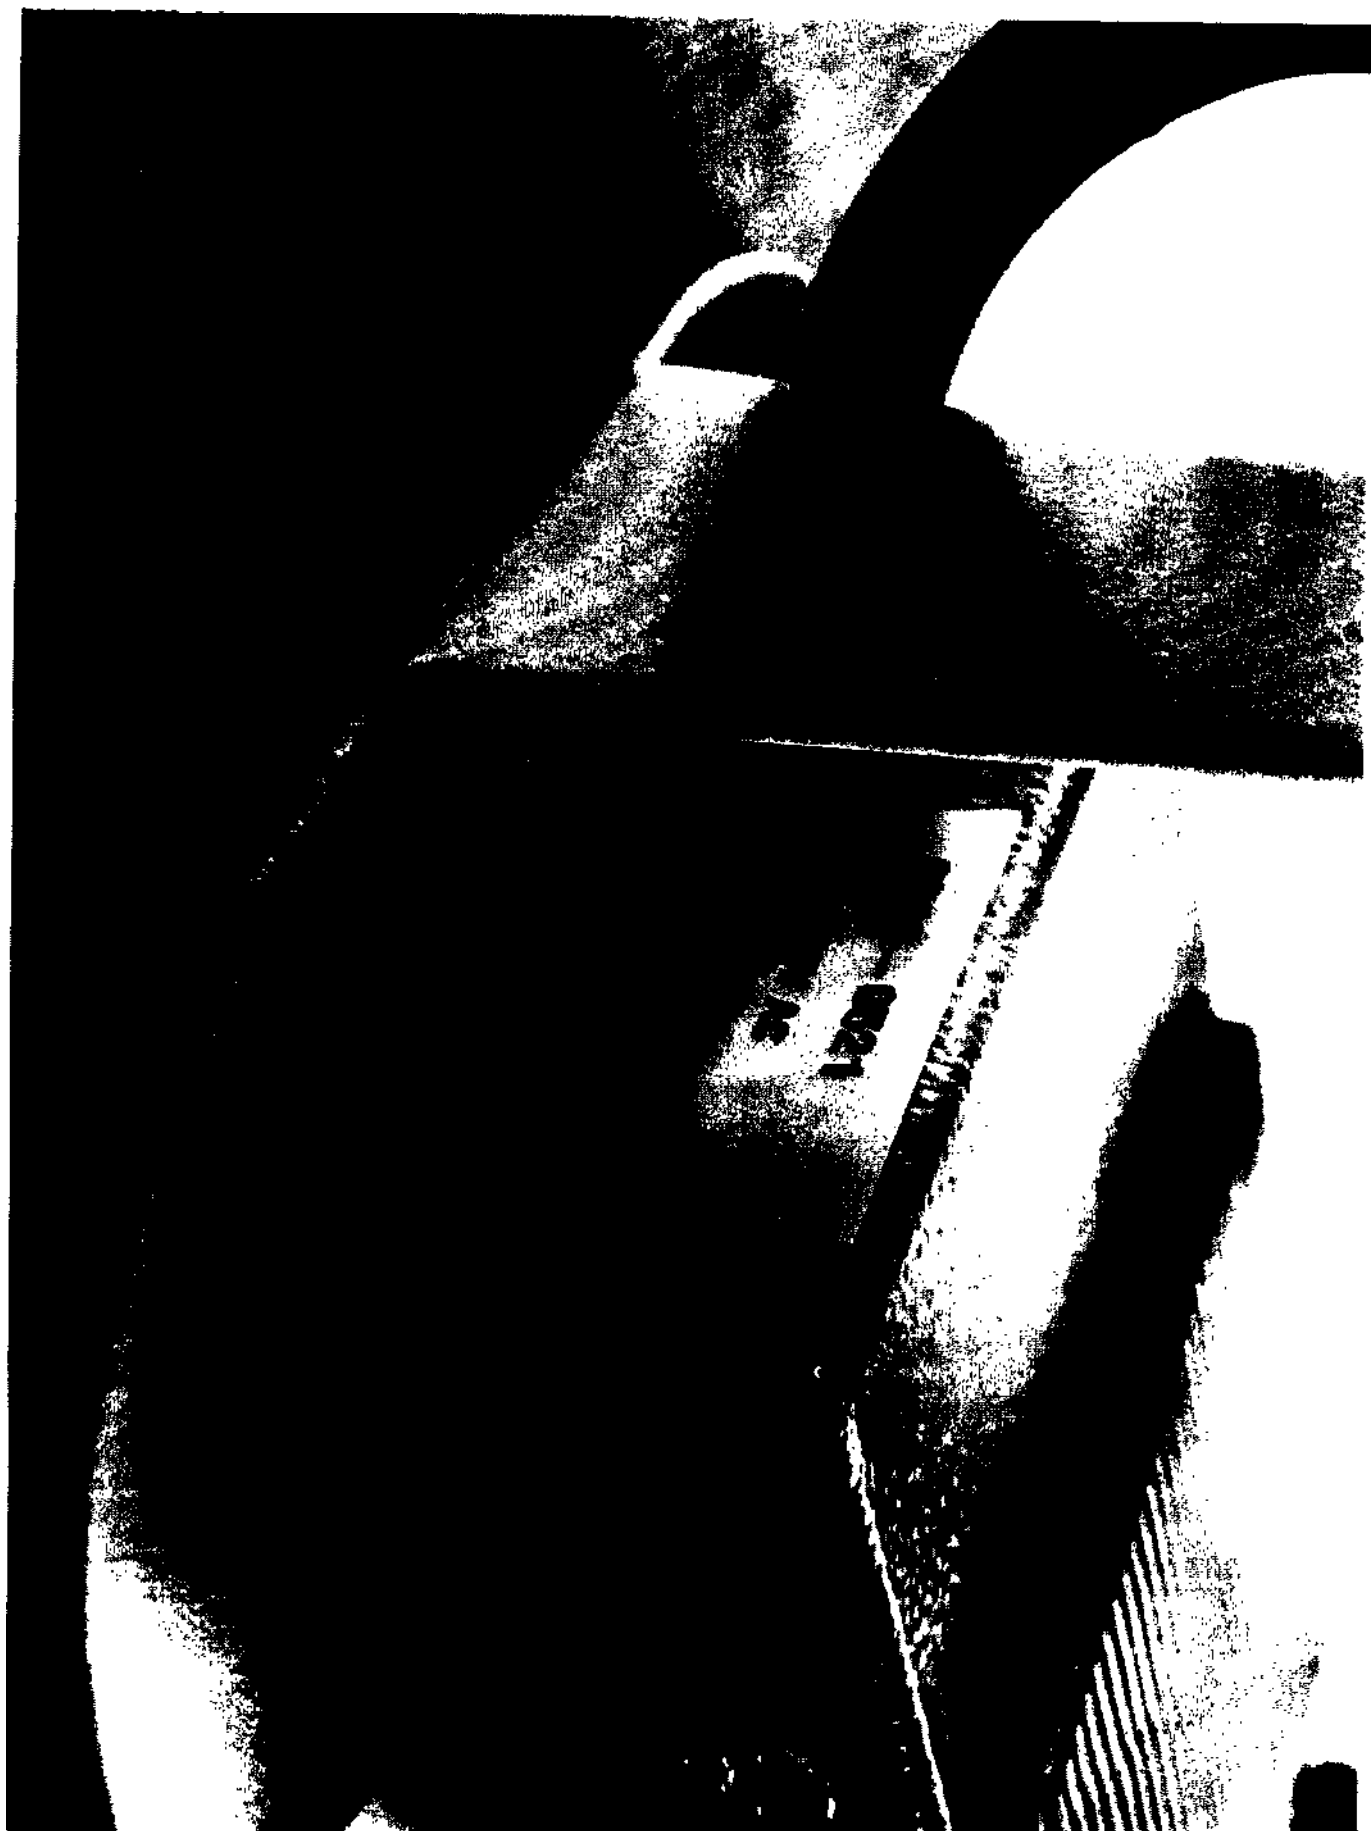


- Кейс для лазерного аппликатора

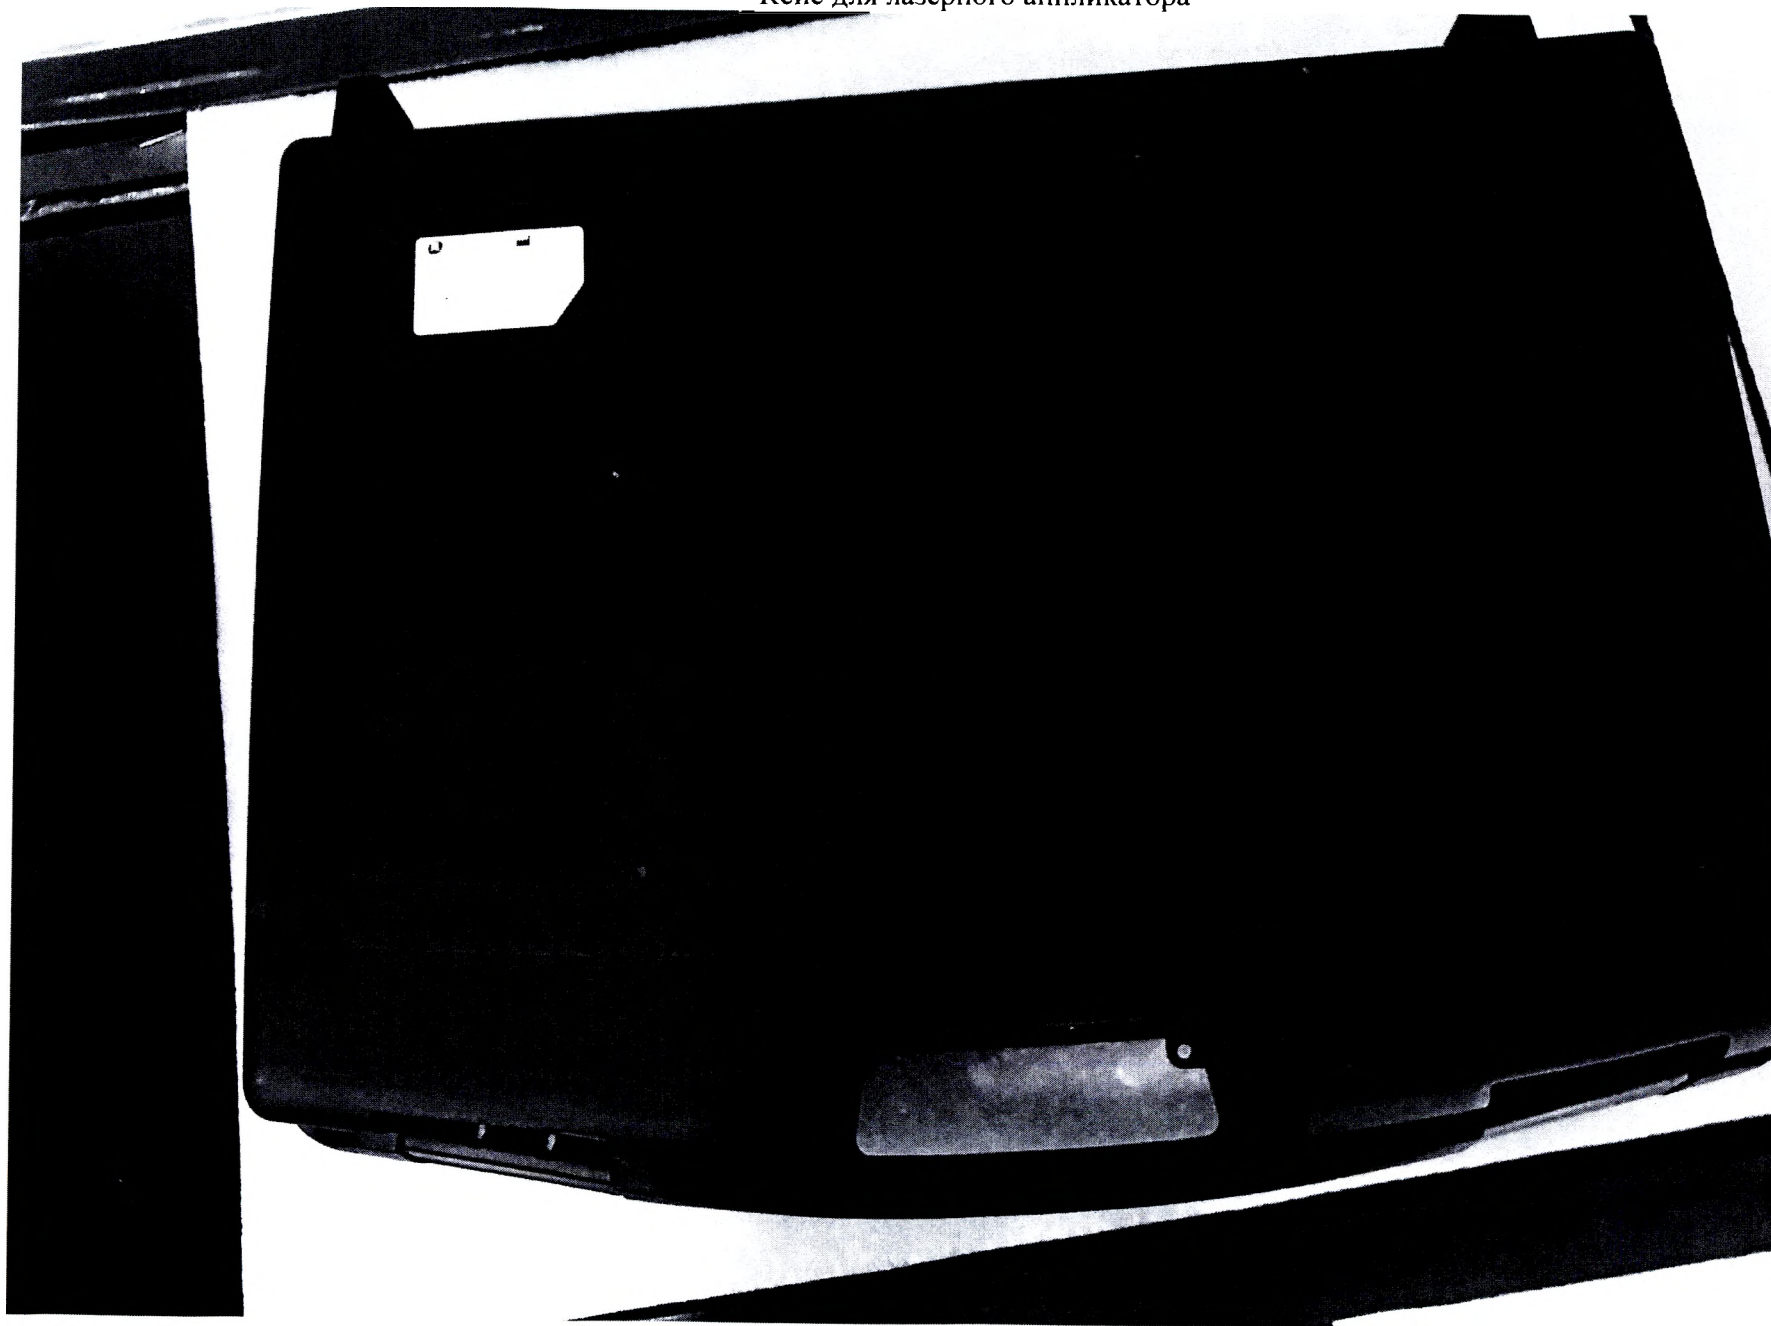




- Инструмент для разборки наконечника

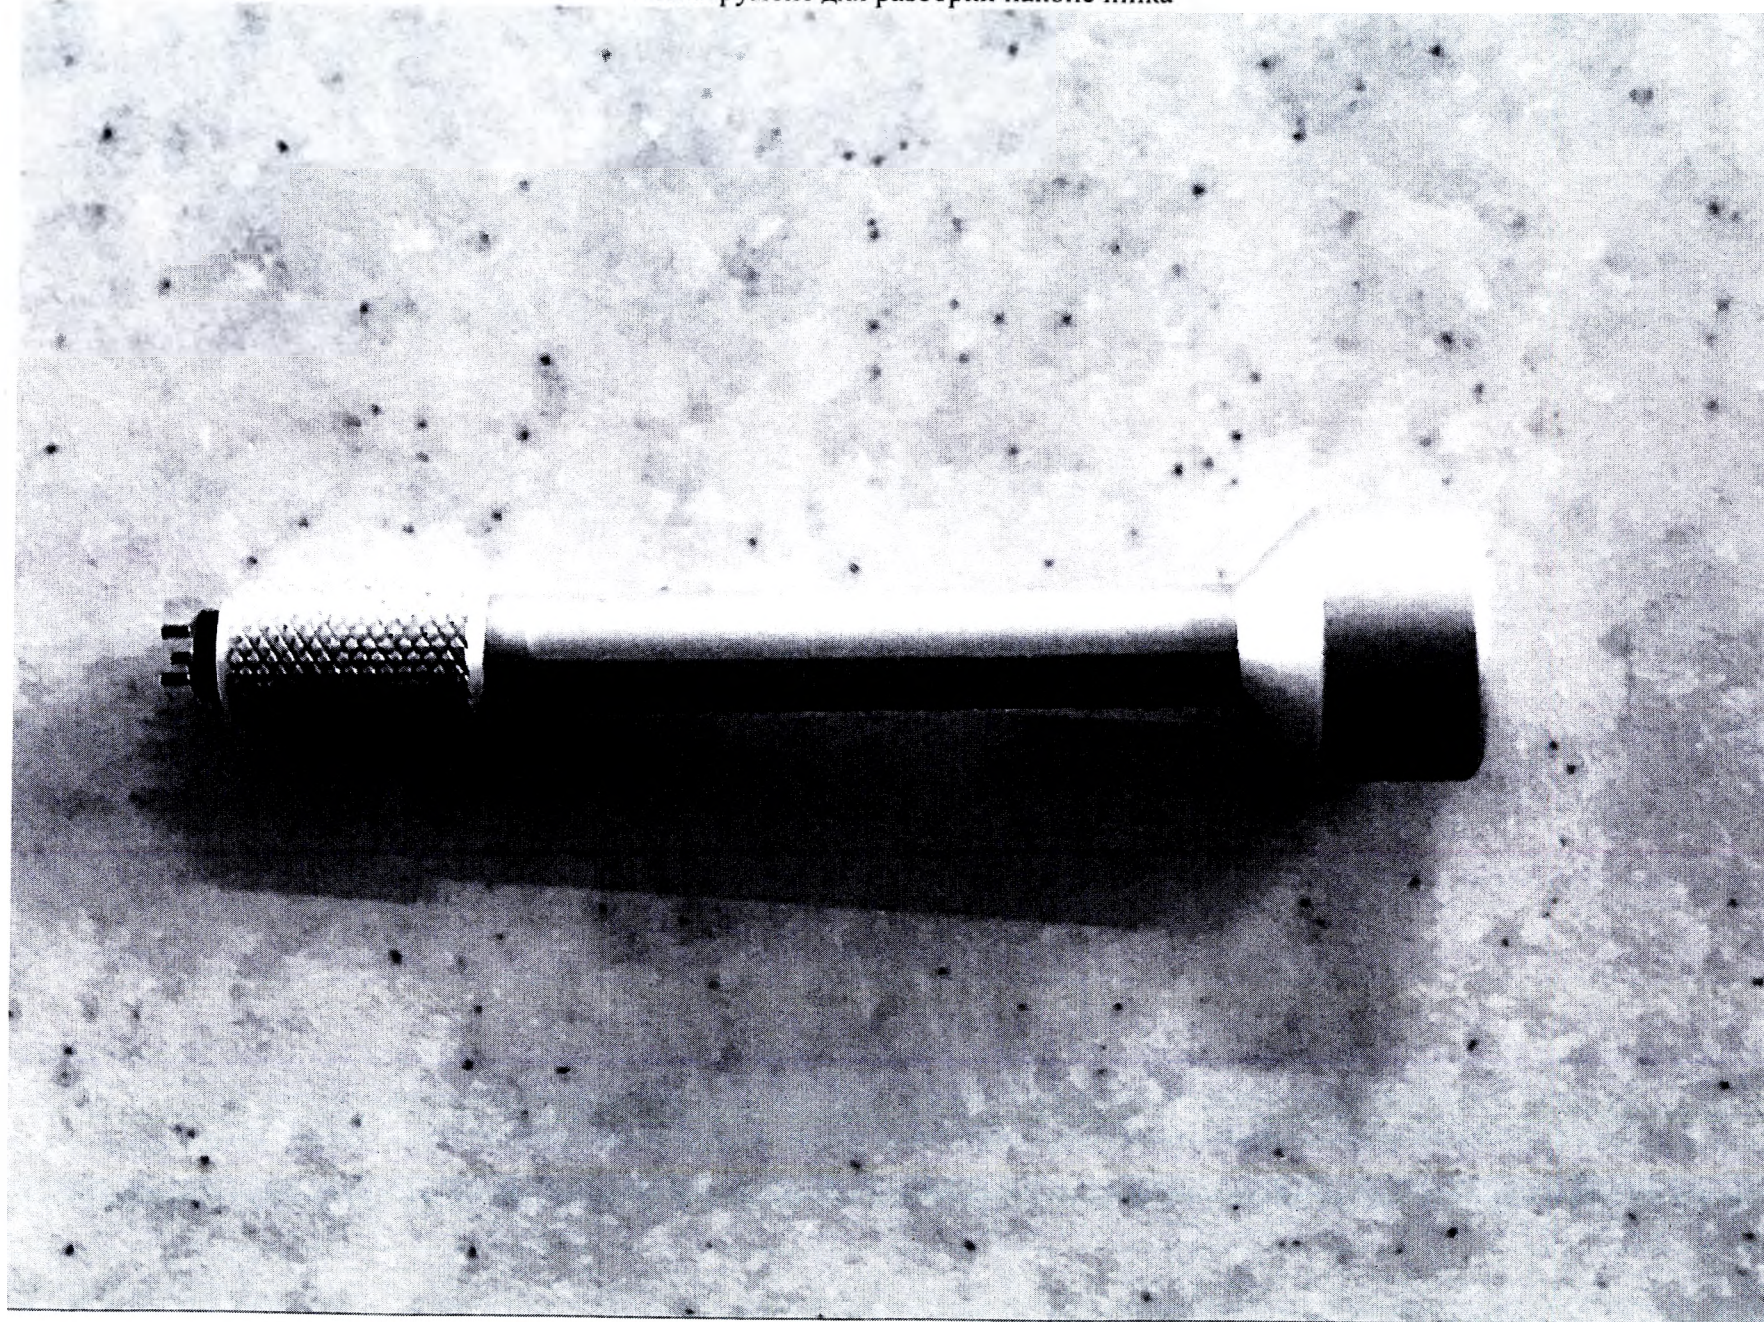





- Кабель питания

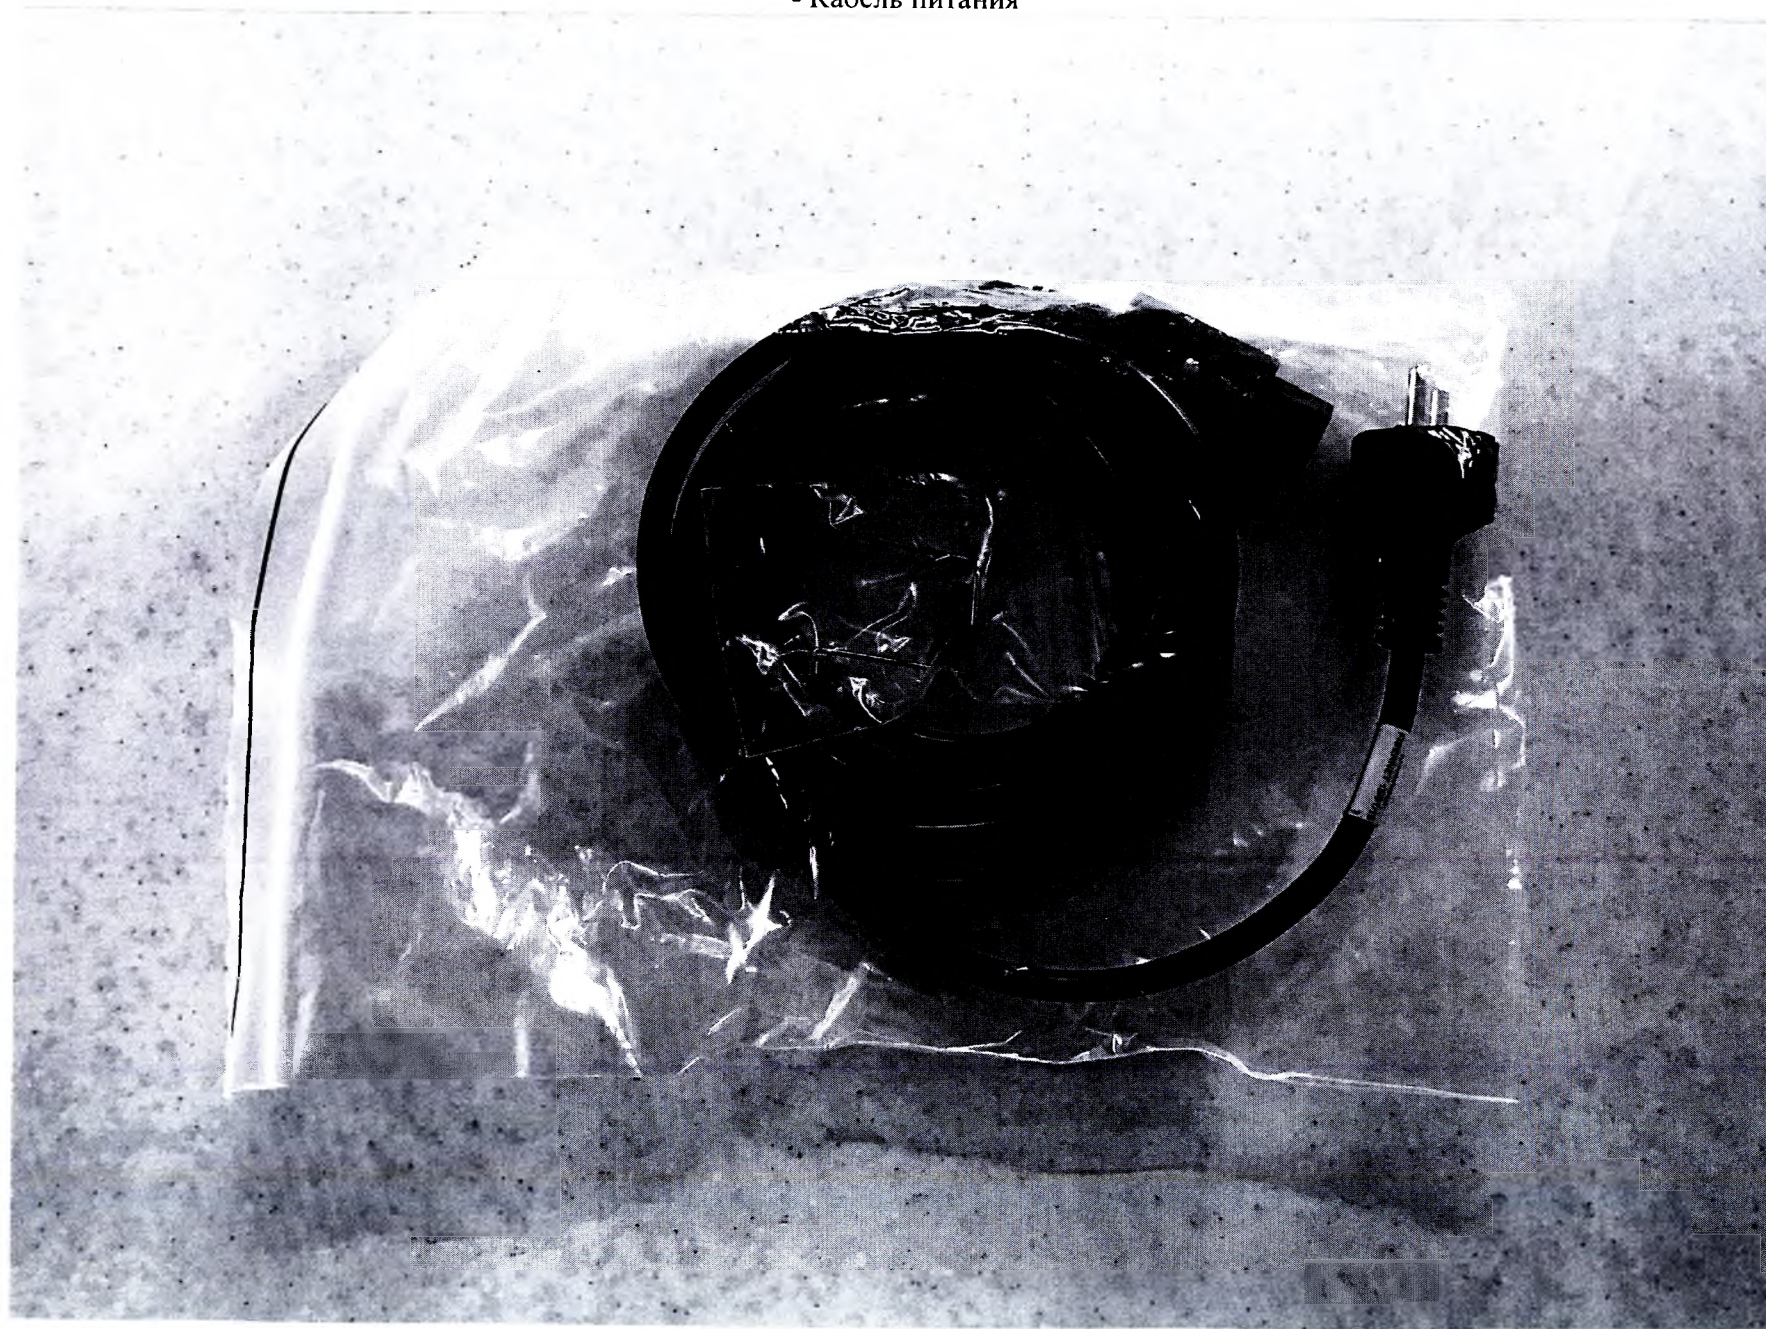




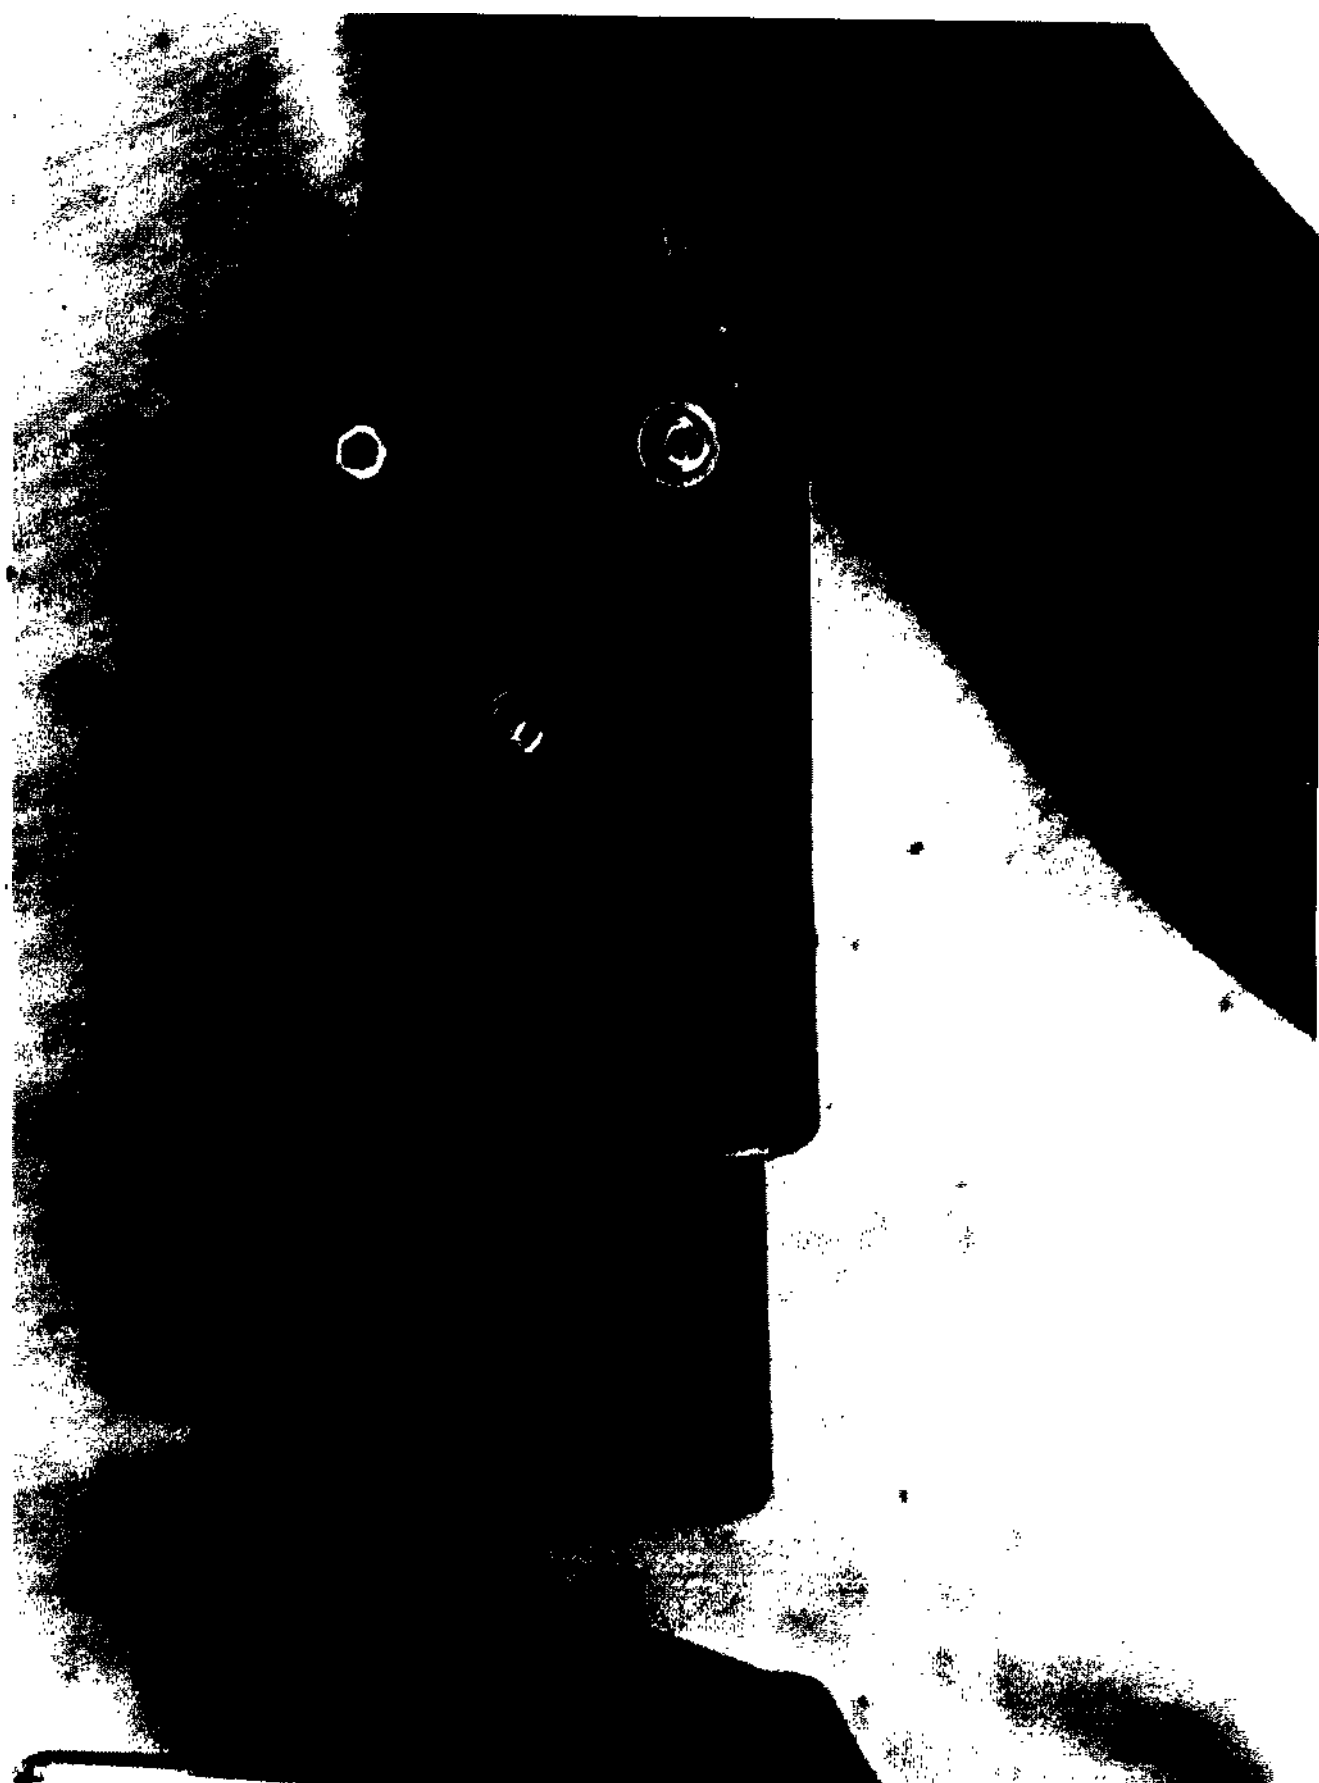

- Комплект насадок

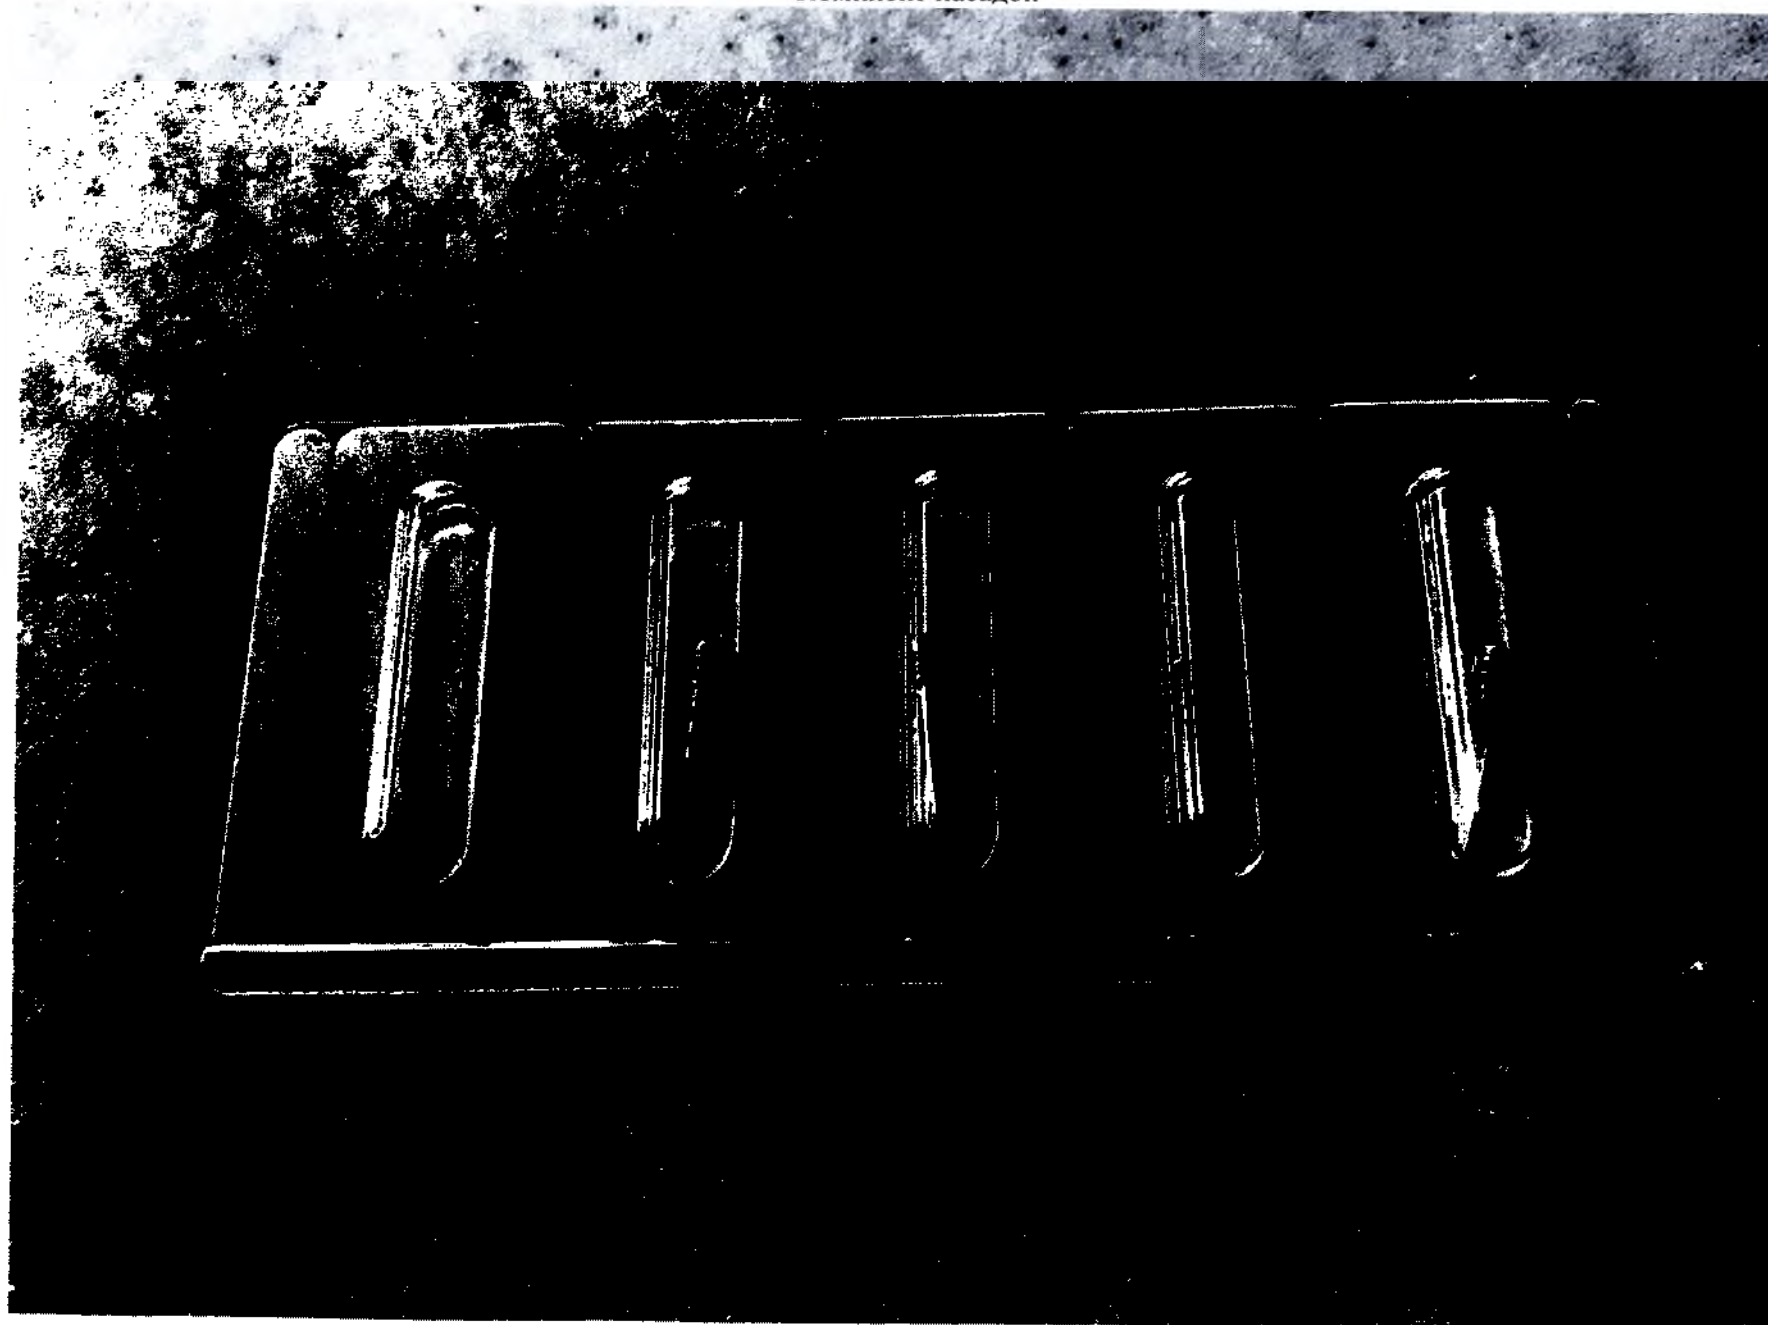

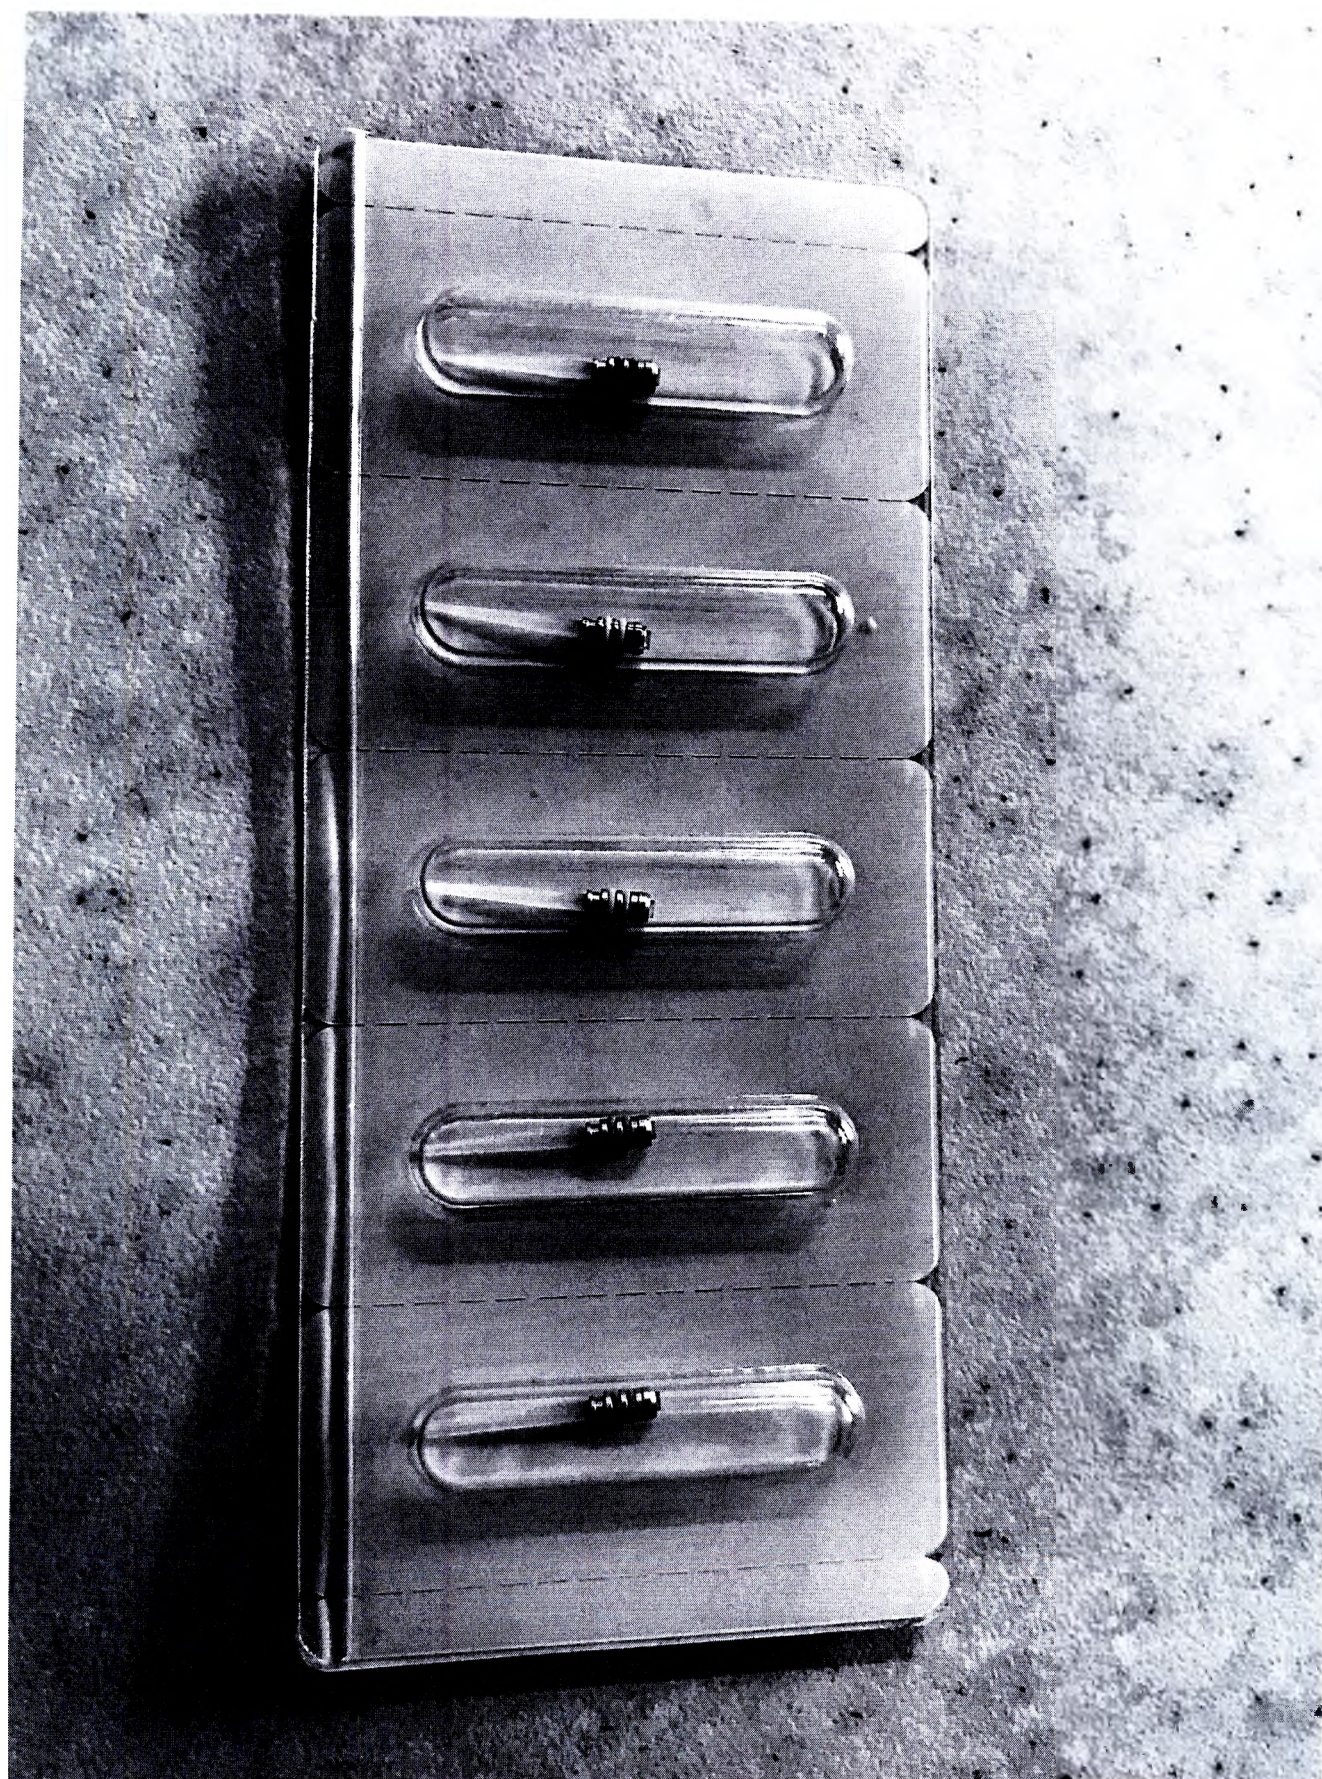

TIP for
LITE
Er:YAG laser
Non Sterile
CE 0483

TIP for
LITE
Er:YAG laser
Non Sterile
CE 0483

TIP for
LITE
Er:YAG laser
Non Sterile
CE 0483

TIP for
LITE
Er:YAG laser
Non Sterile
CE 0483

TIP for
LITE
Er:YAG laser
Non Sterile
CE 0483

BAT: 00016
D-0.8mm L-14mm
AS70742


BAT: 00017
D-1.0mm L-14mm
AS70732


BAT: 00014
D-1.3mm L-14mm
AS70662

BAT: 00010
D-1.3mm L-17mm
AS70652


BAT: 00013
D-1.3mm L-19mm
AS70712

- Угловой наконечник

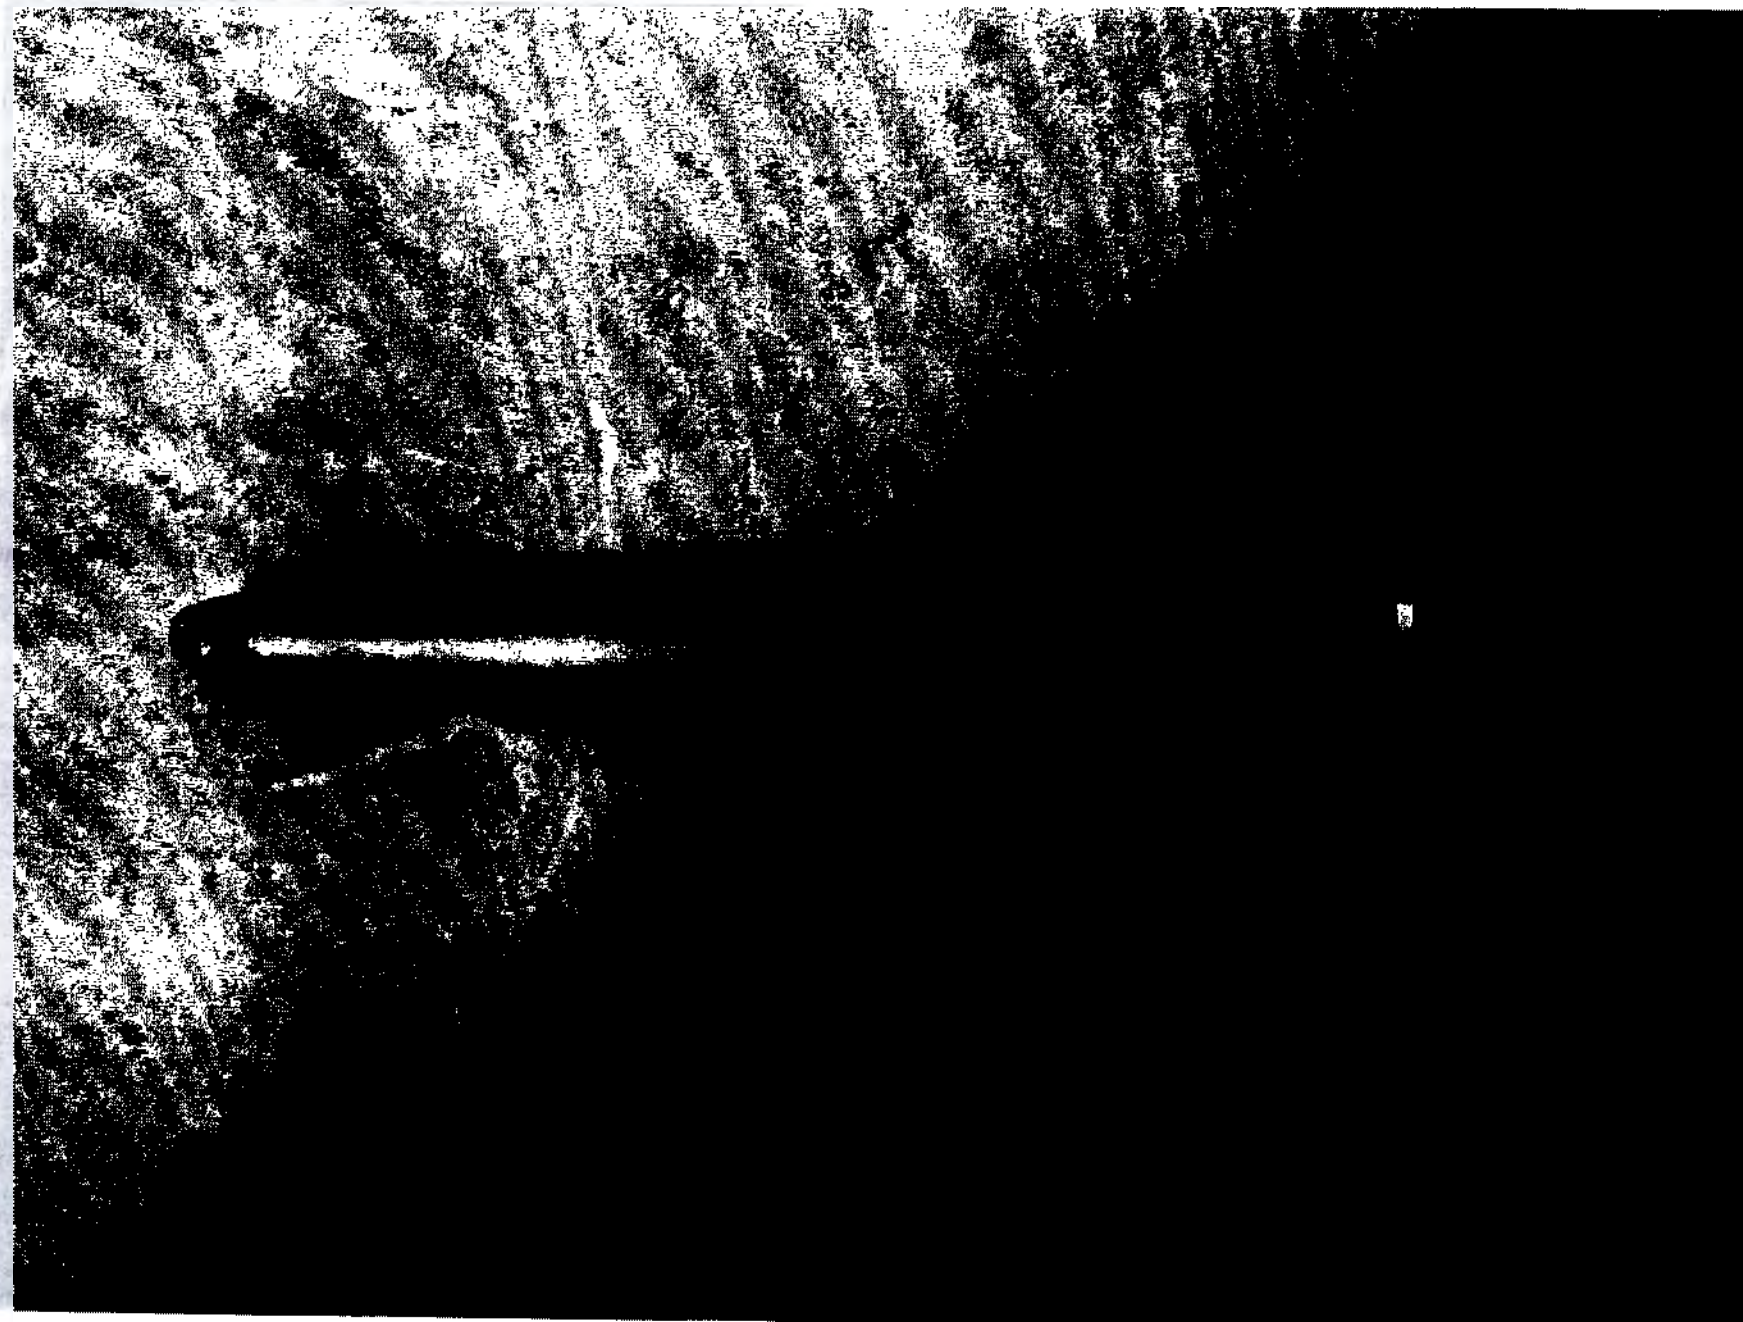

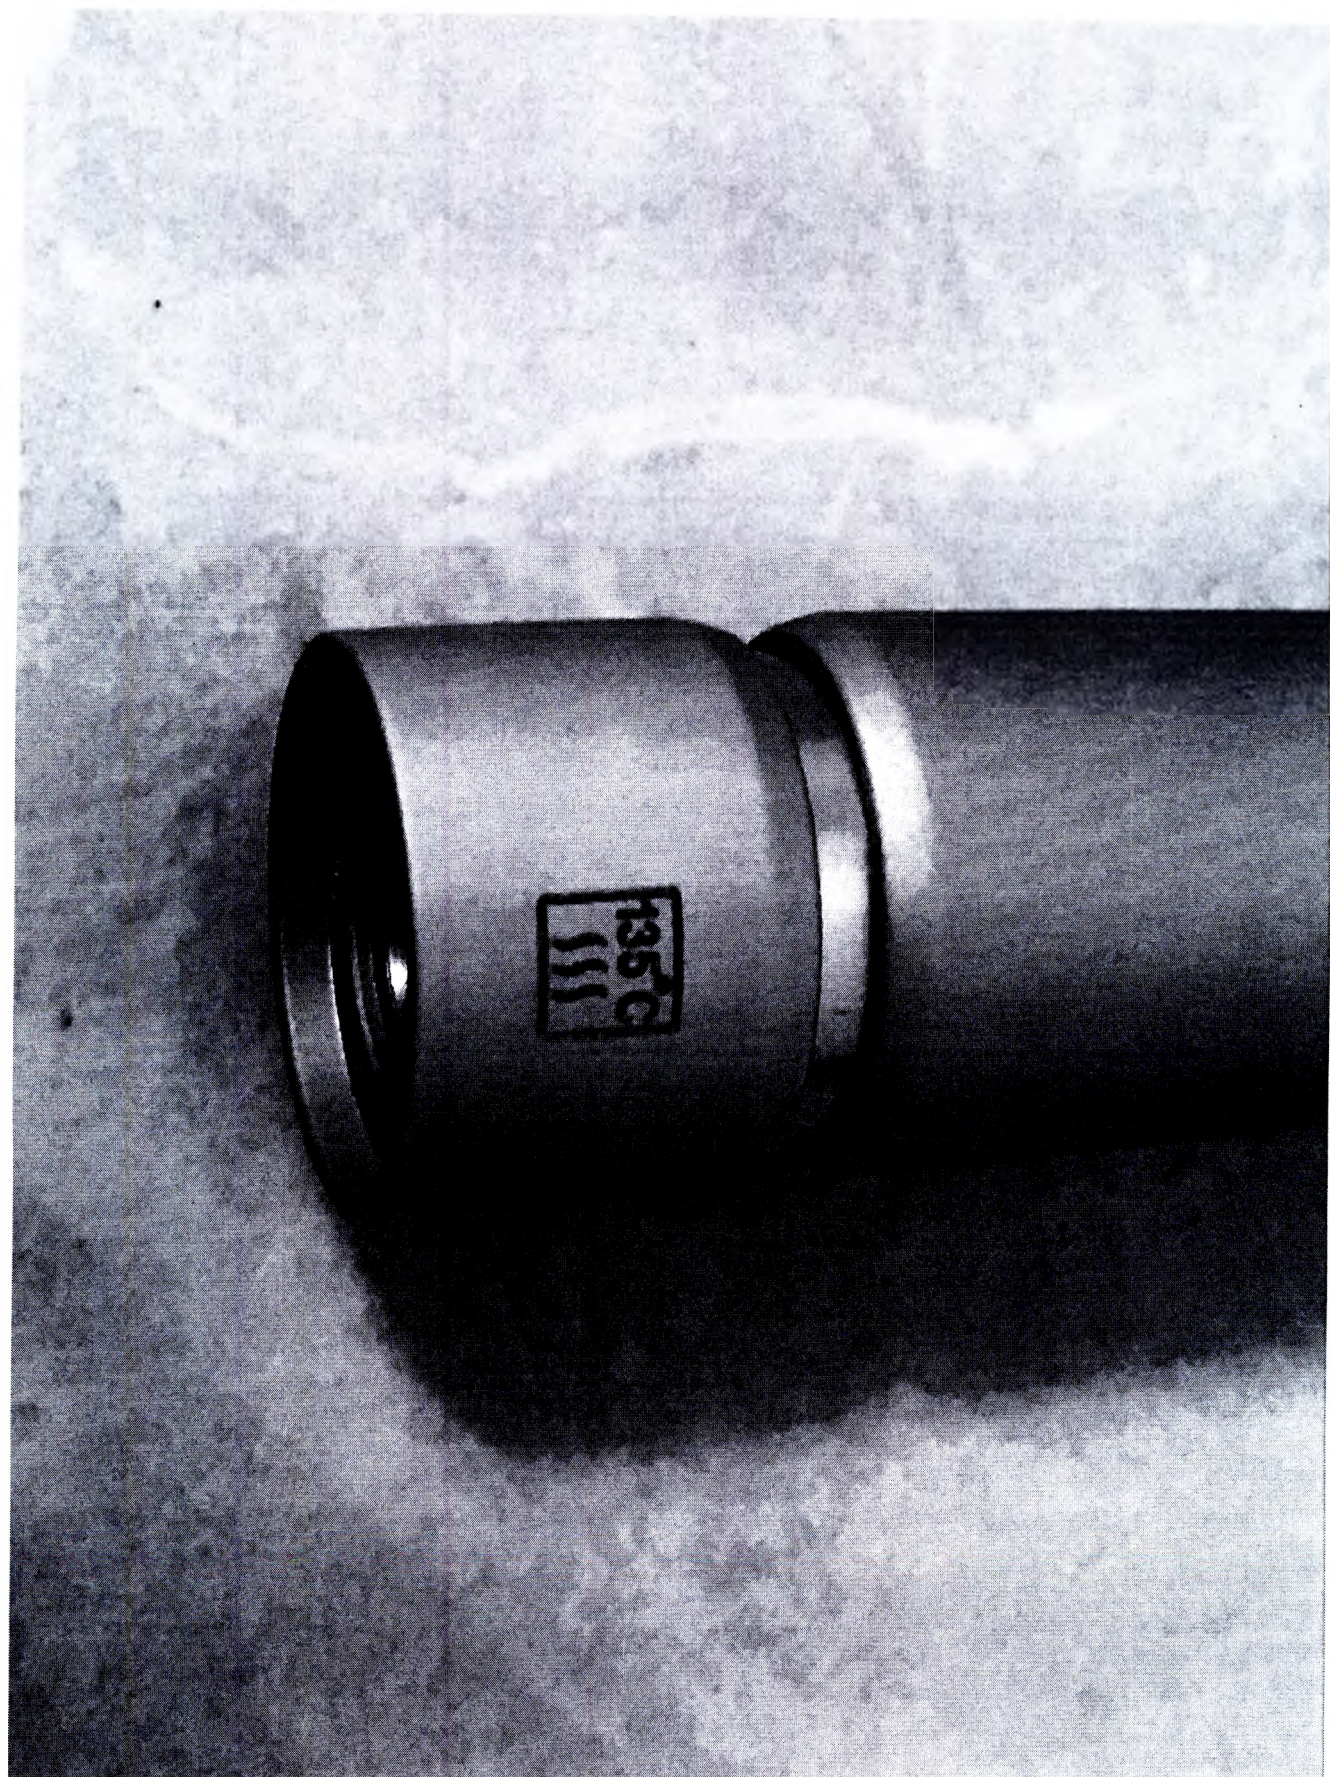



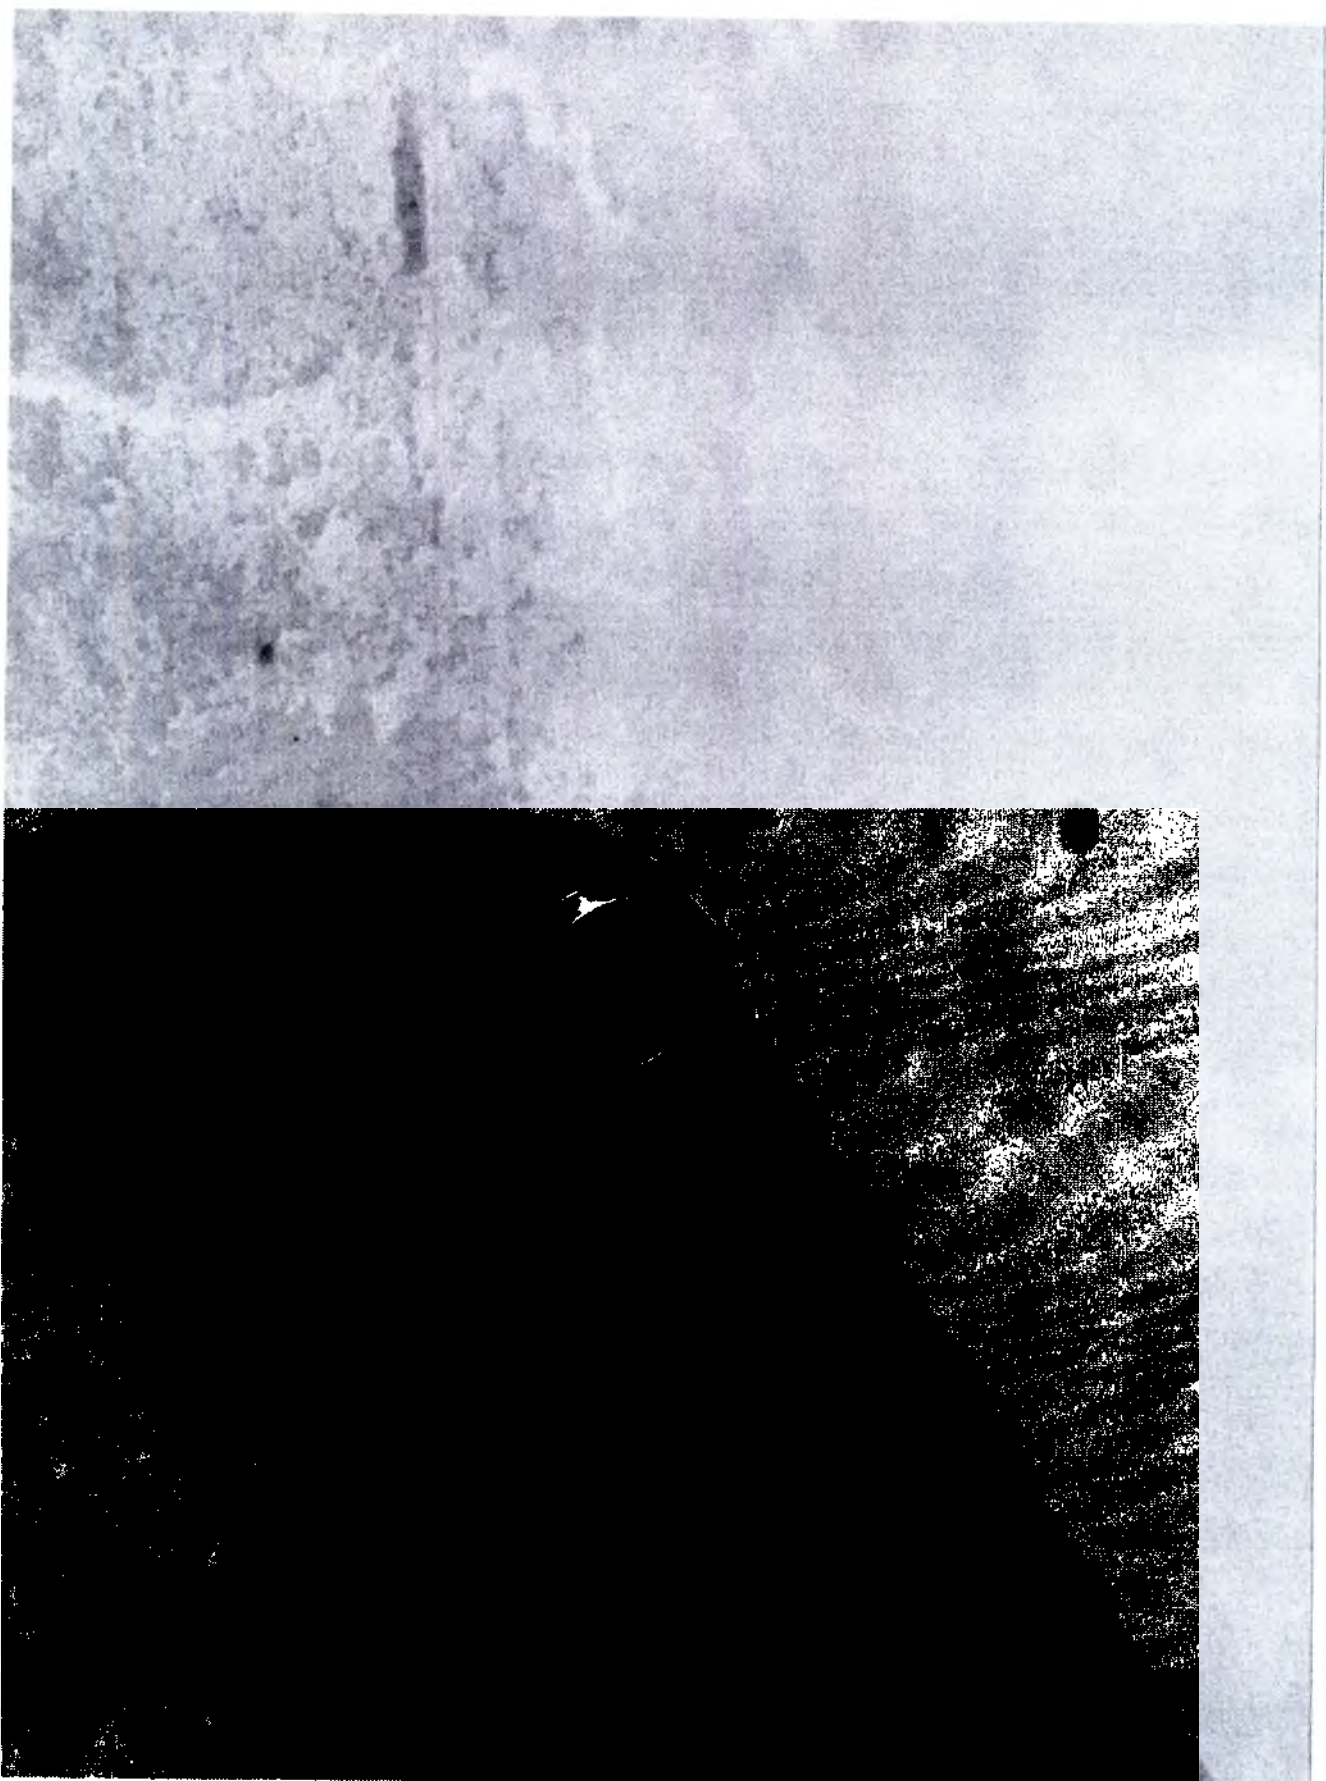


- Очки защитные








- Перемычка дистанционной блокировки

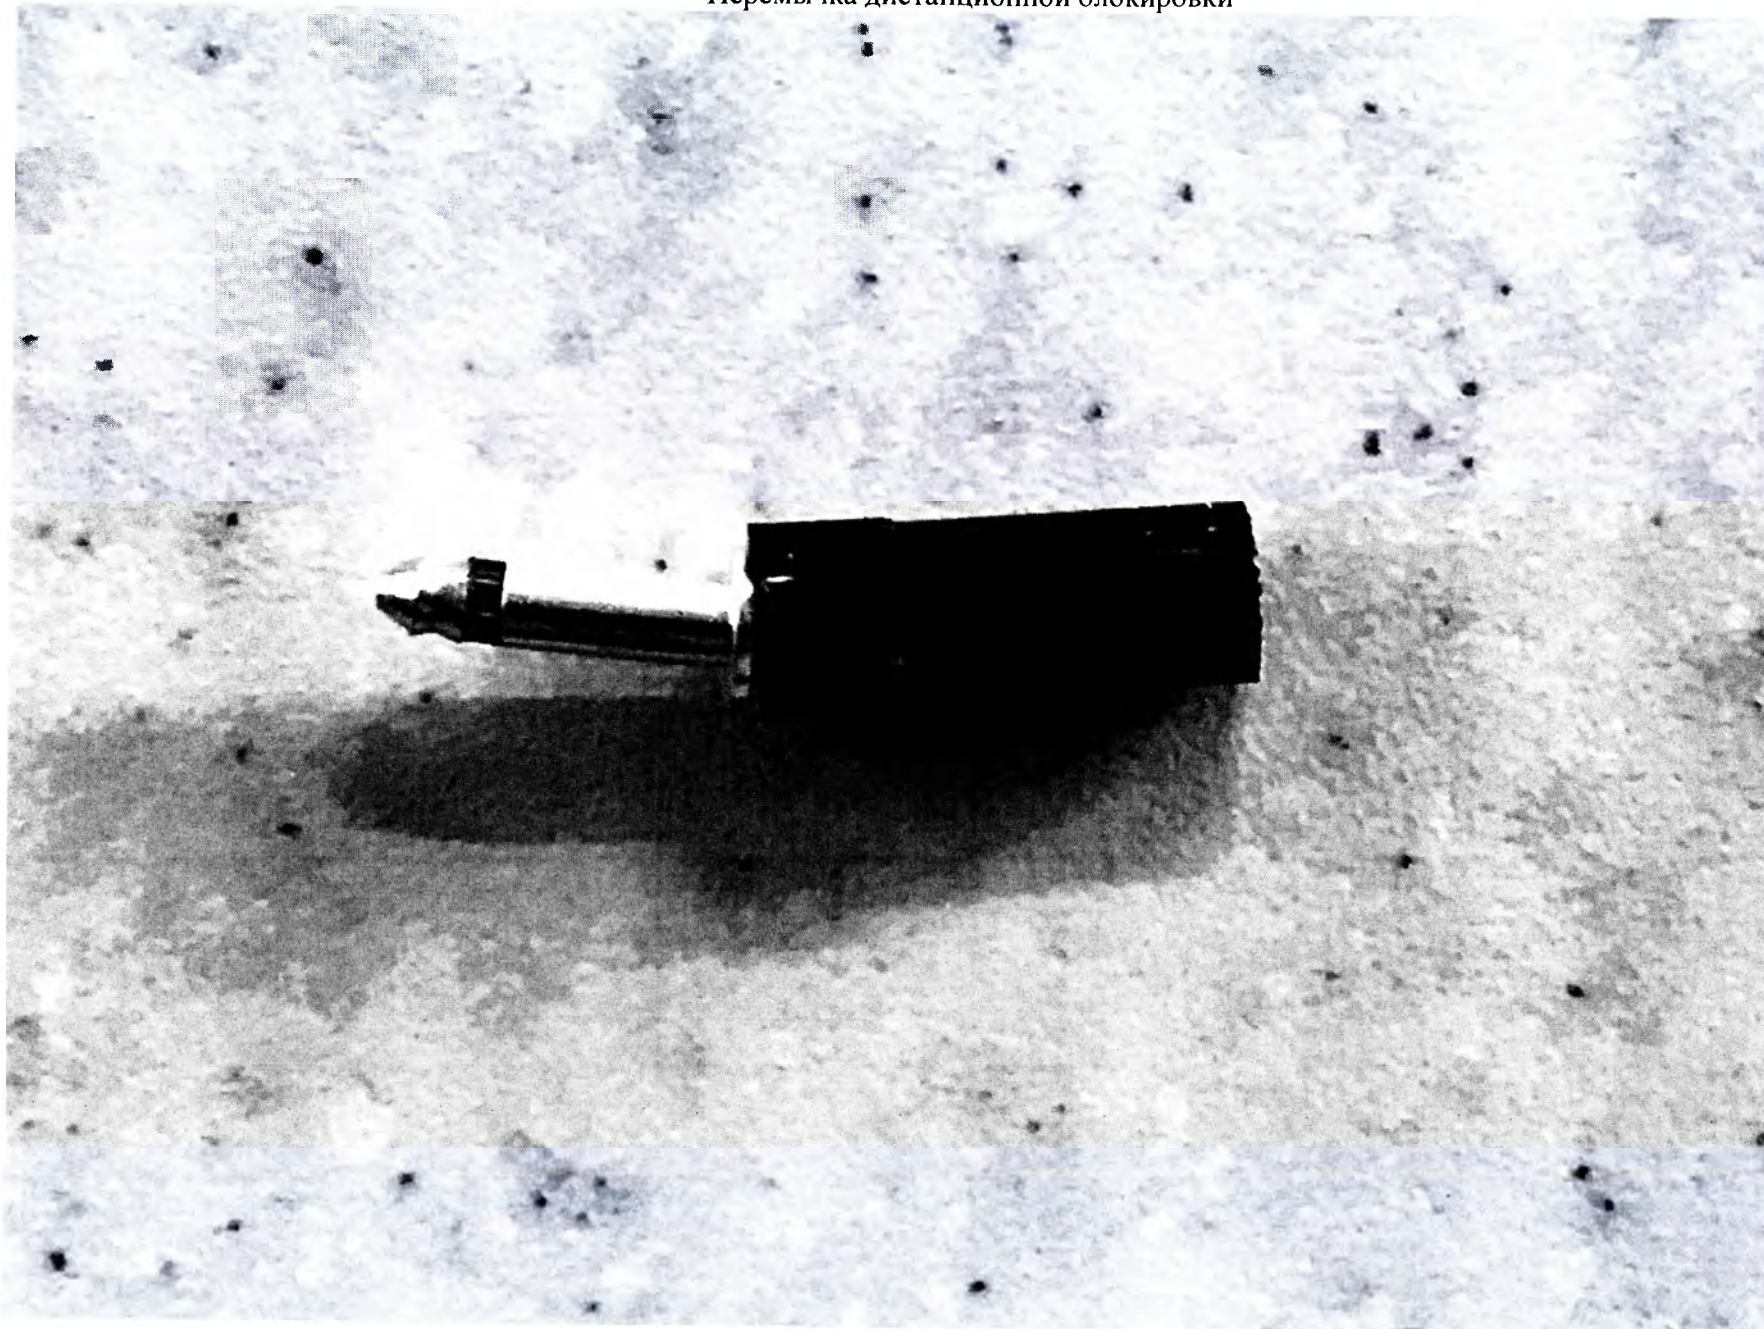



TOUCH

Er:YAG Dental Laser System

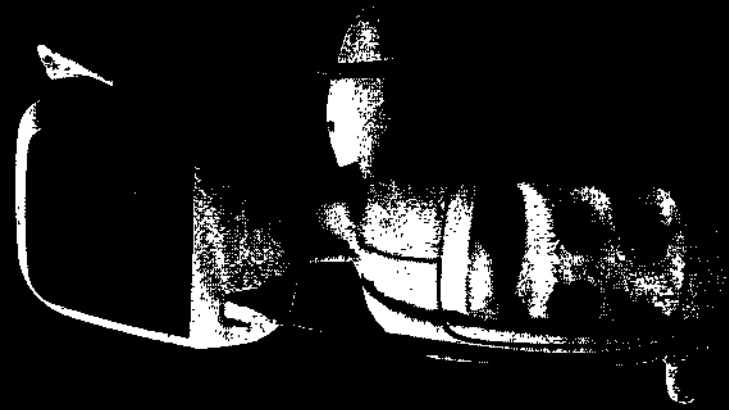

- Трубка воздушная





II. Принадлежности:

- Держатель насадок





- Зеркала выходные








DANGER

**VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION**

**Avoid eye or skin exposure
To direct or scattered radiation.**

**LASER SURGERY IN PROGRESS
SAFETY EYEWEAR REQUIRED**

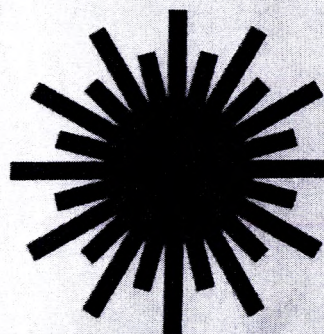


Erbium Laser 2940 nm 15 Watts max 1.2 Joule max / pulse

Diode Laser 980 nm 15 Watts max


CLASS IV LASER

- Кольца уплотнительные

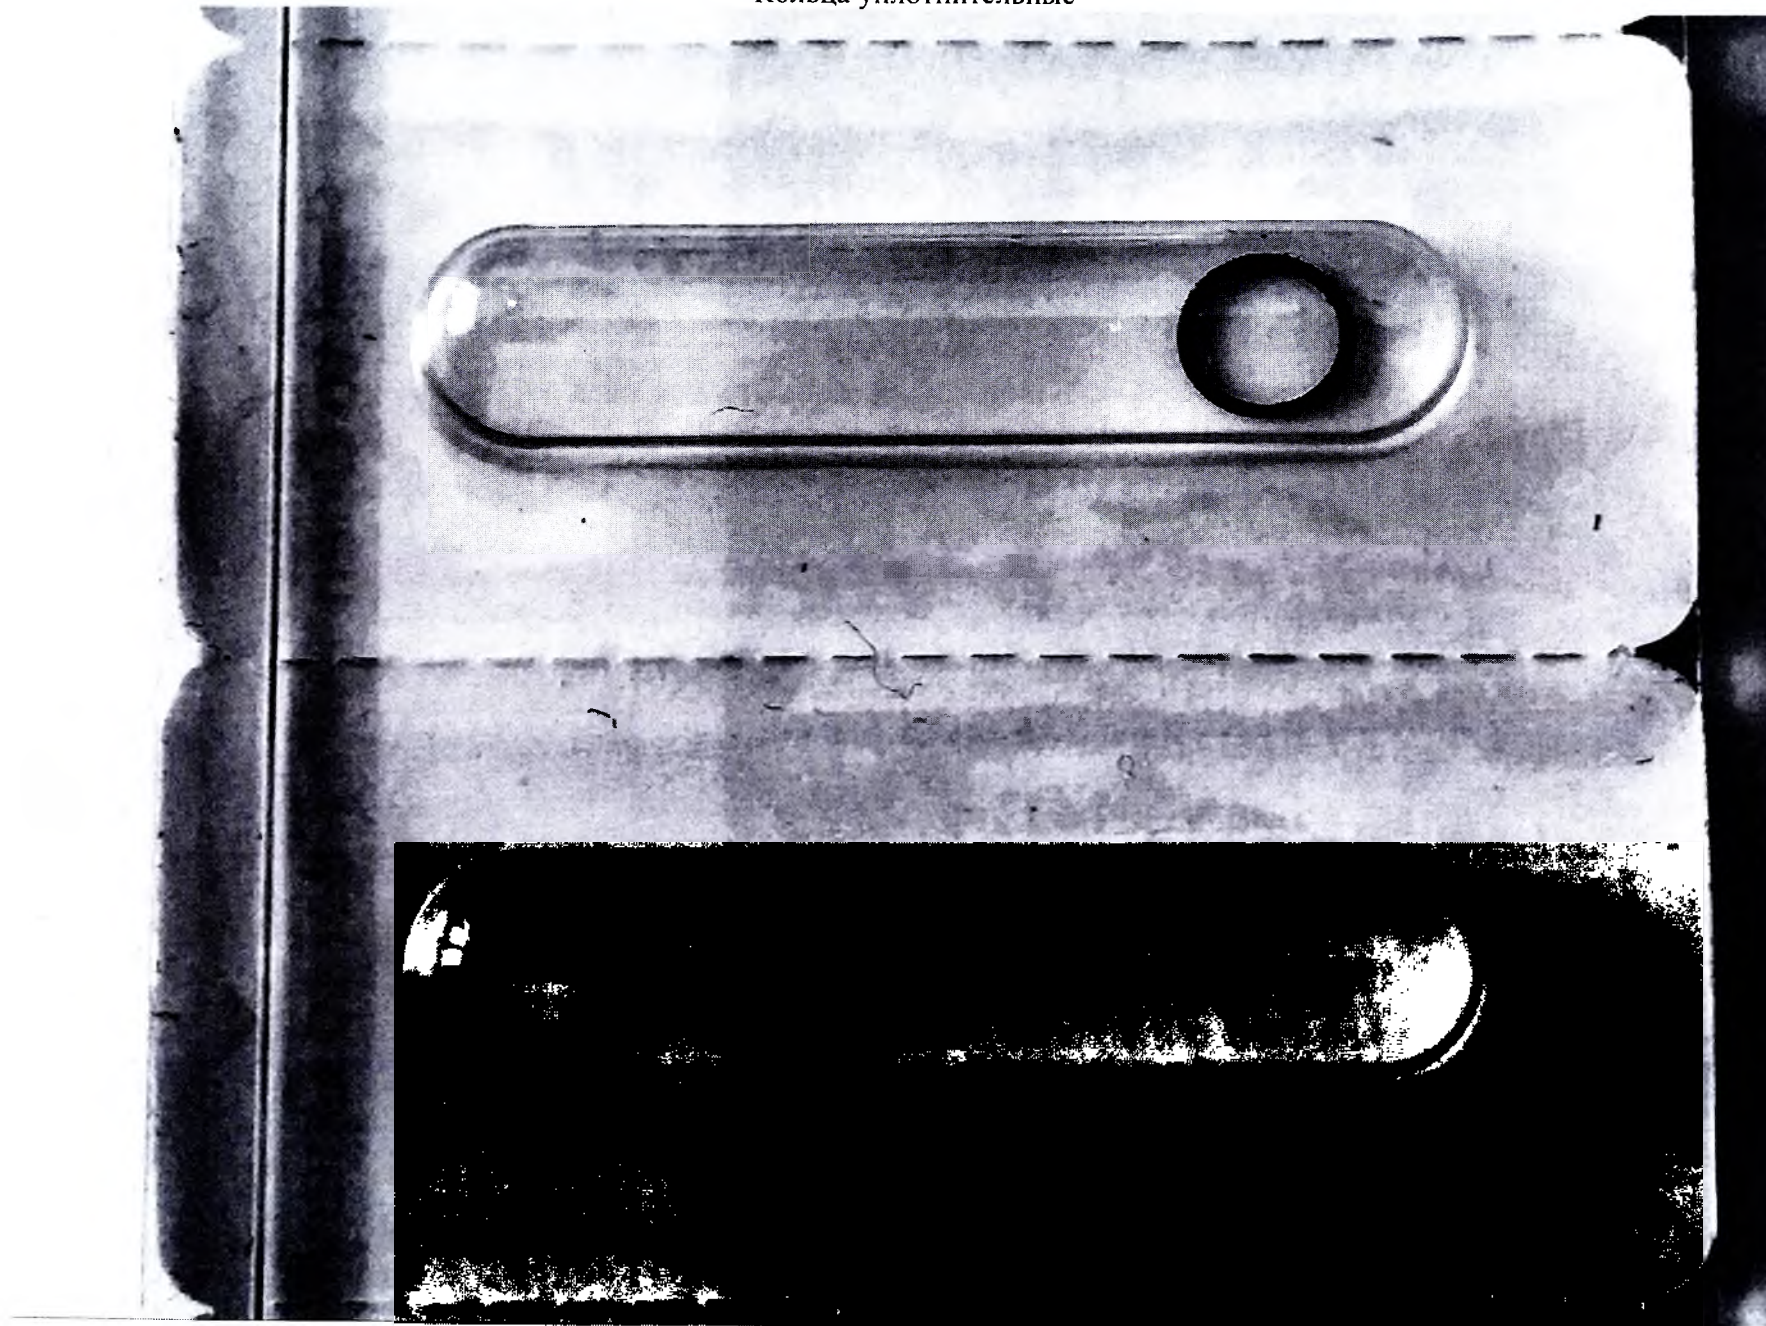


- Палочки для очистки зеркал выходных



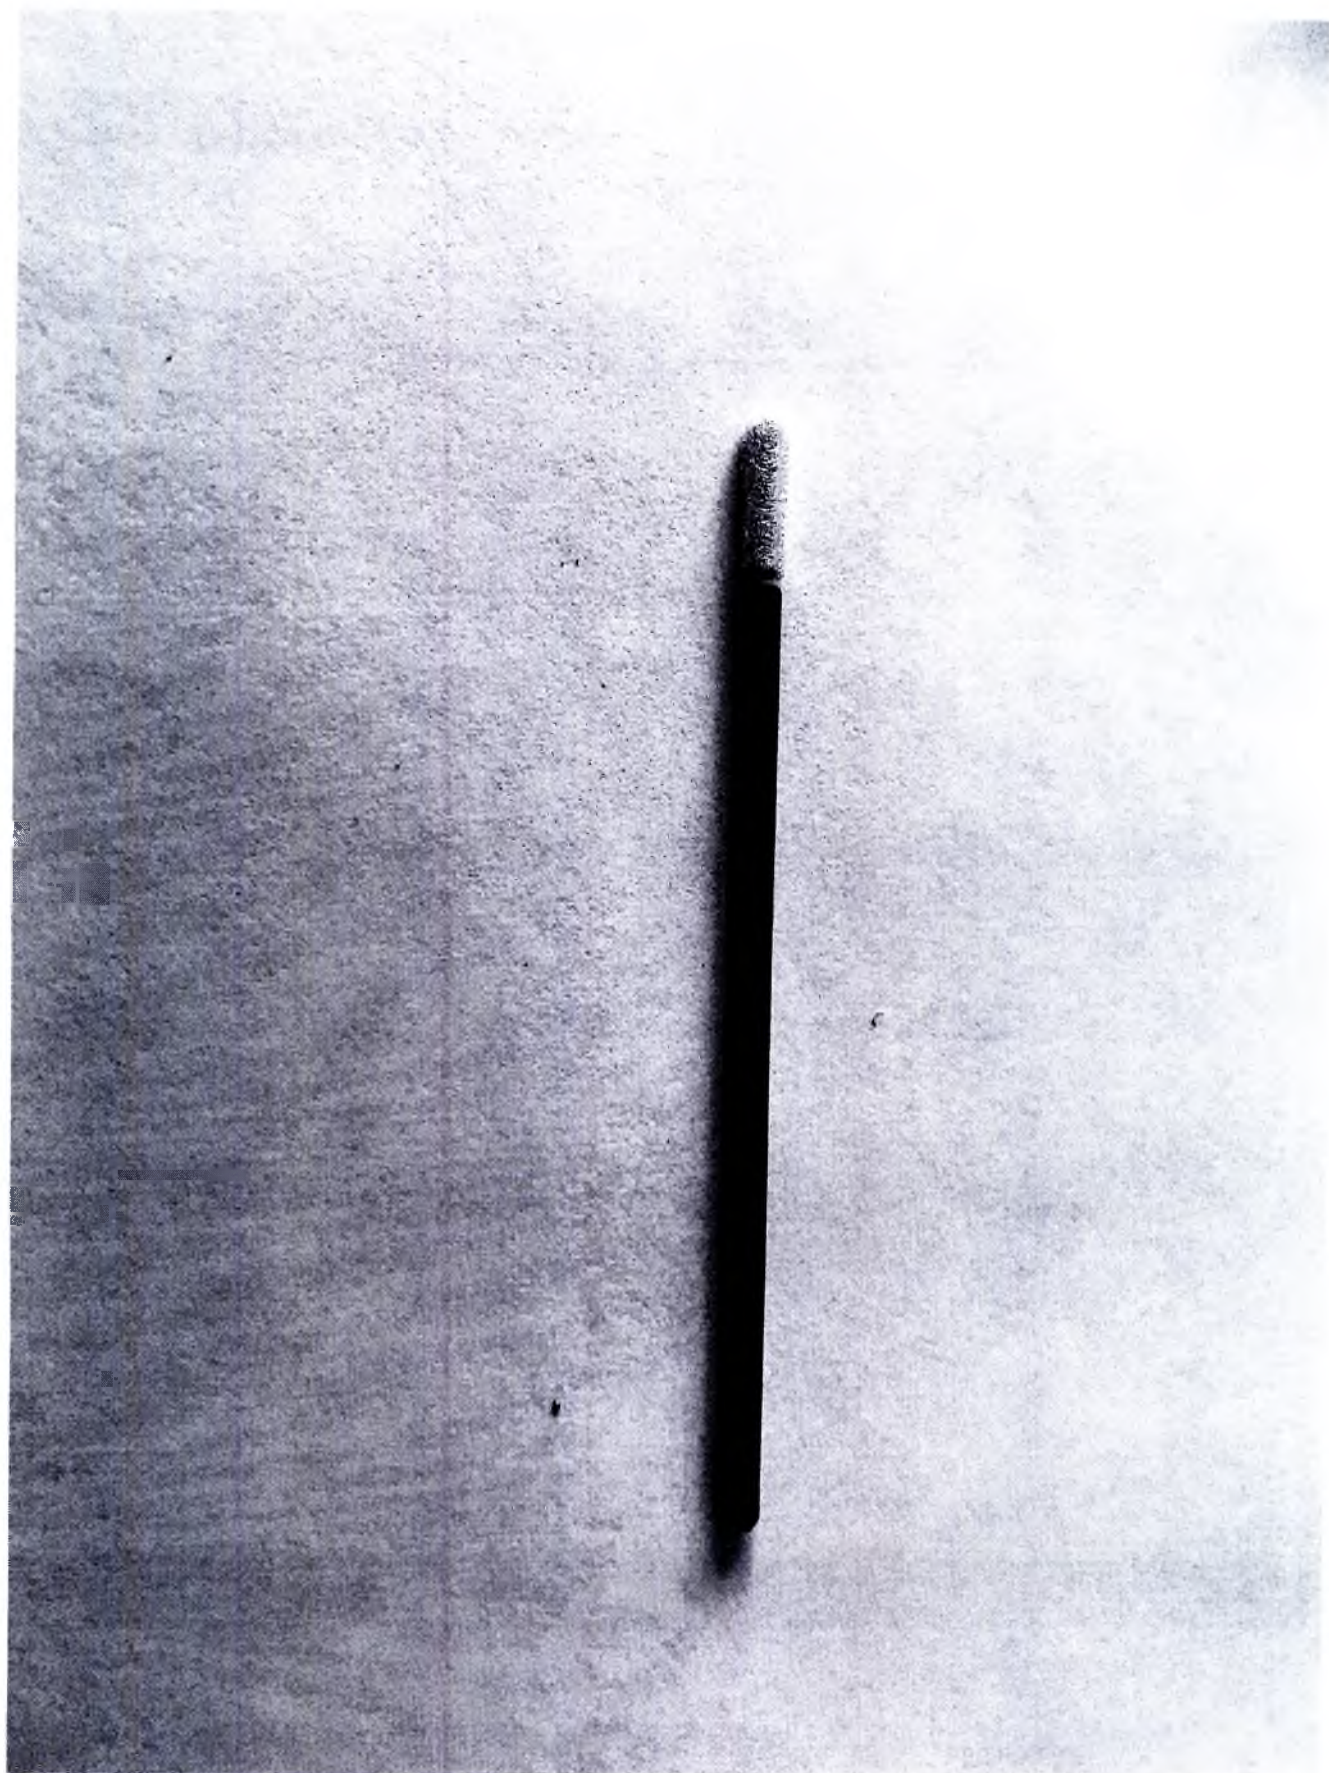


- Смазка силиконовая для колец уплотнительных

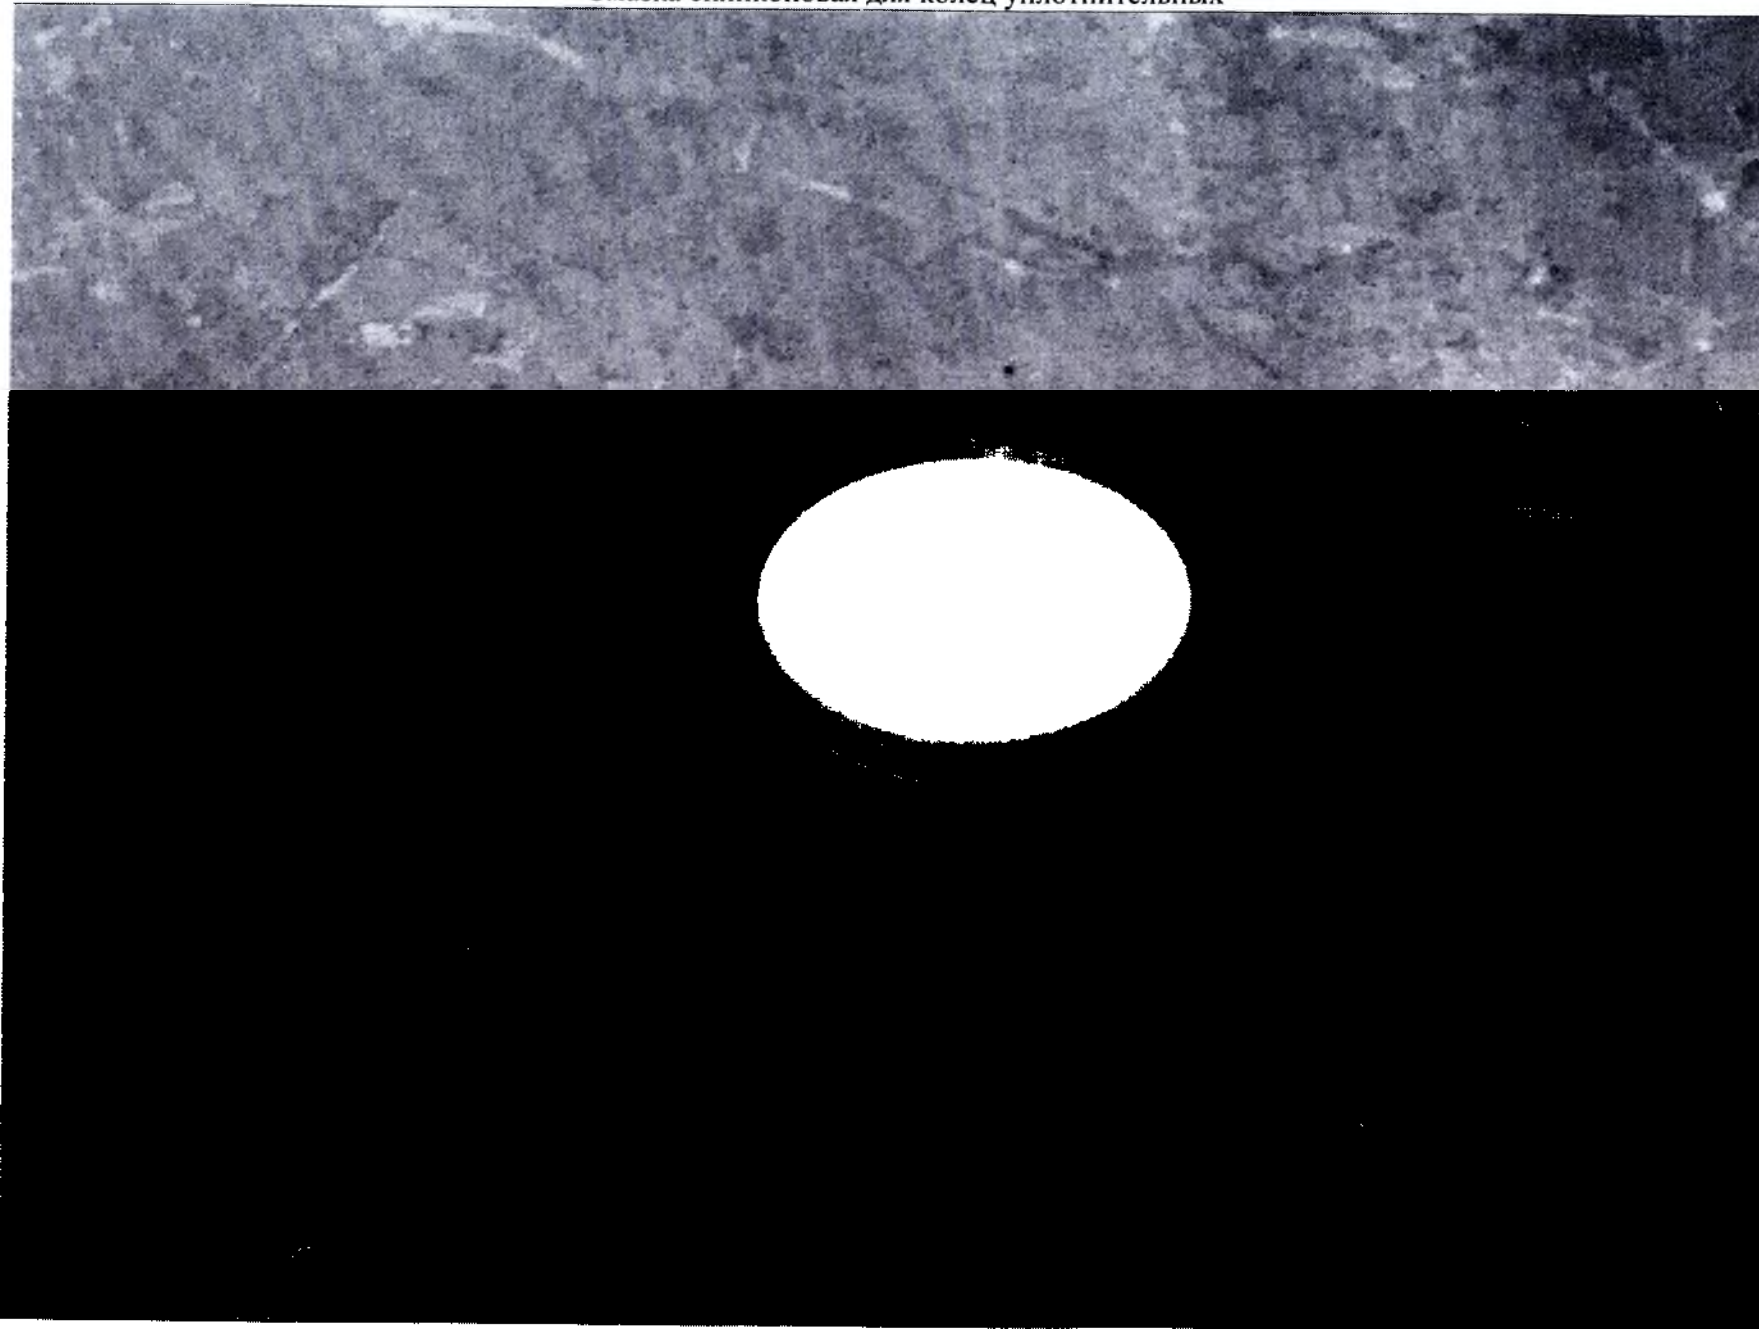




- Фиксатор кабеля питания

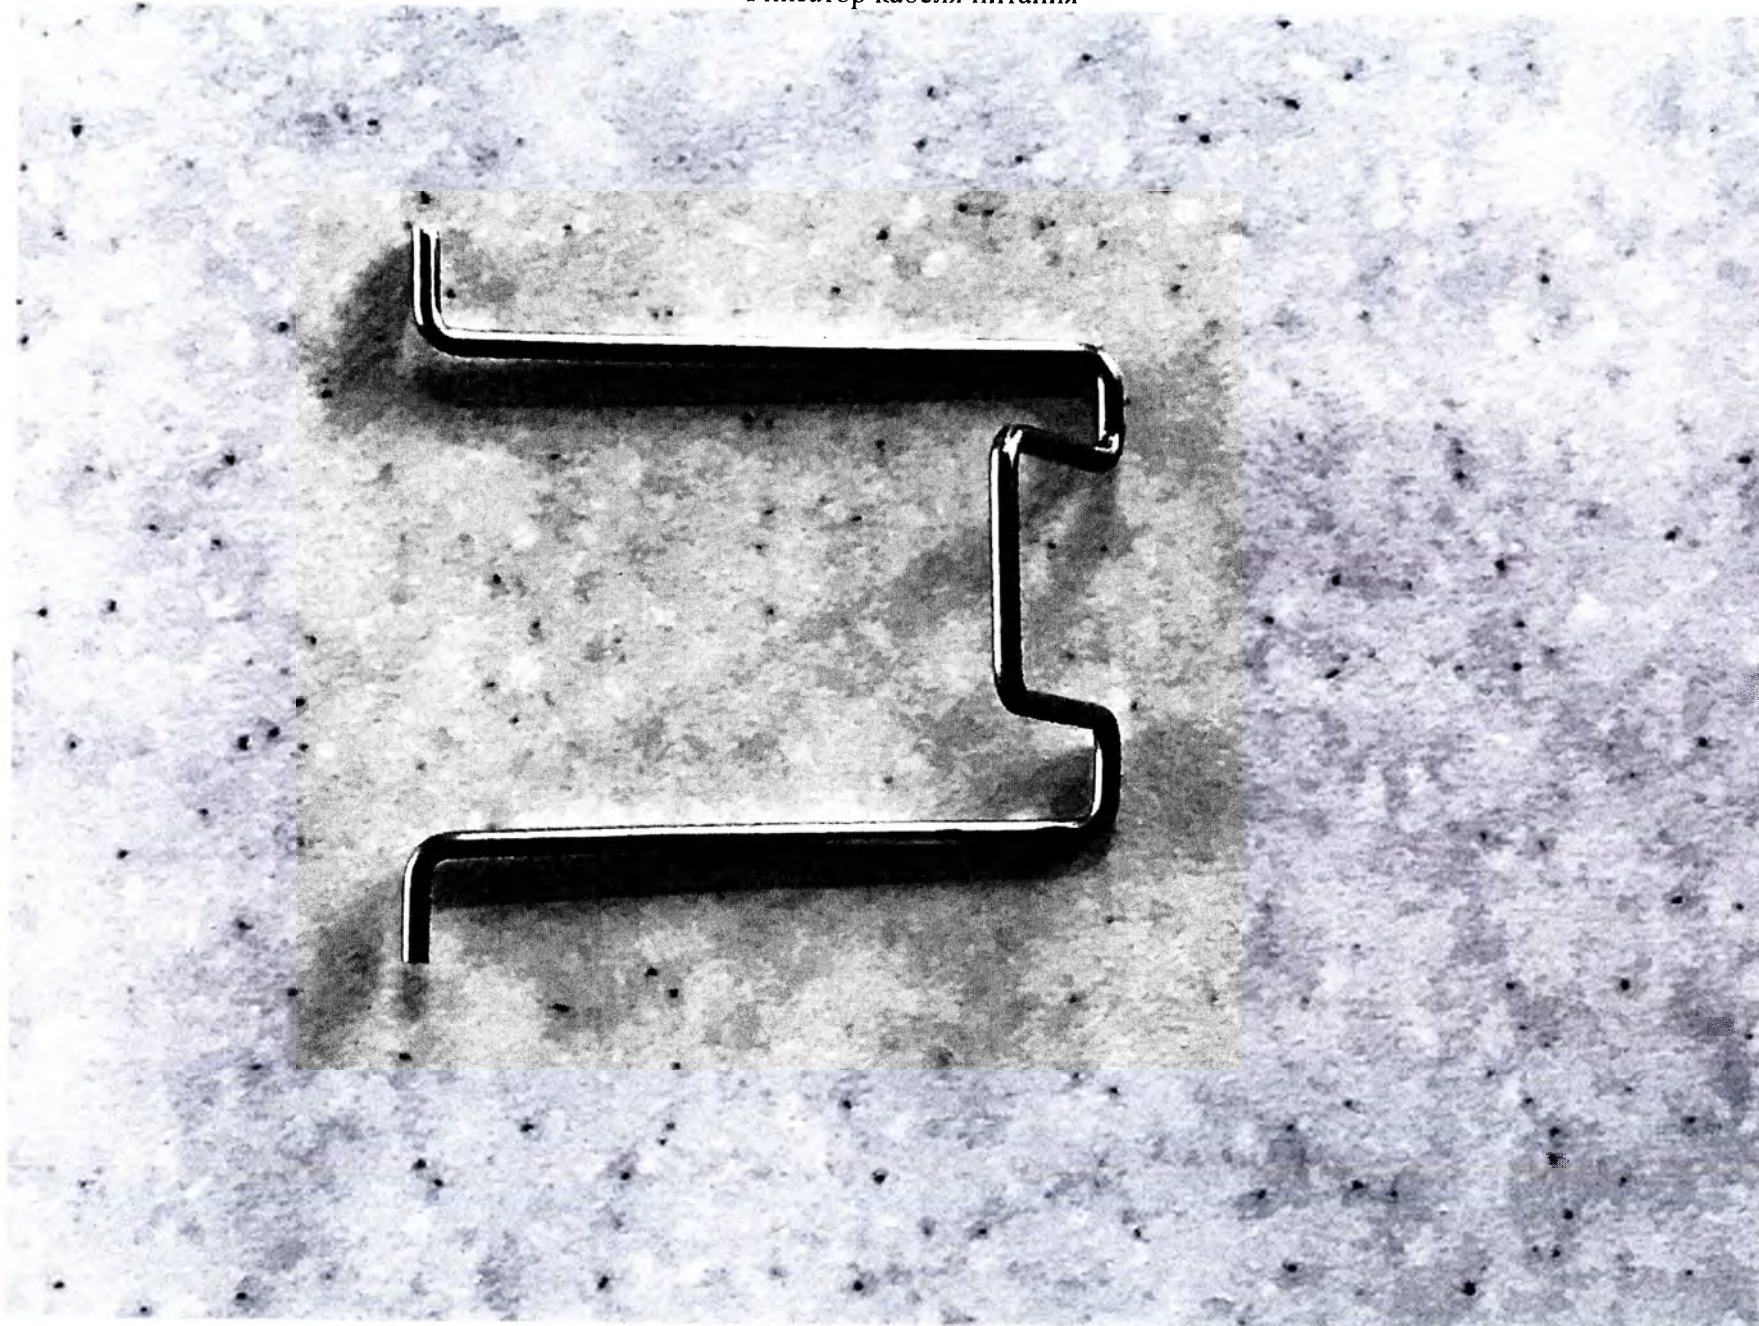

- Емкость для наполнения водой от панели управления

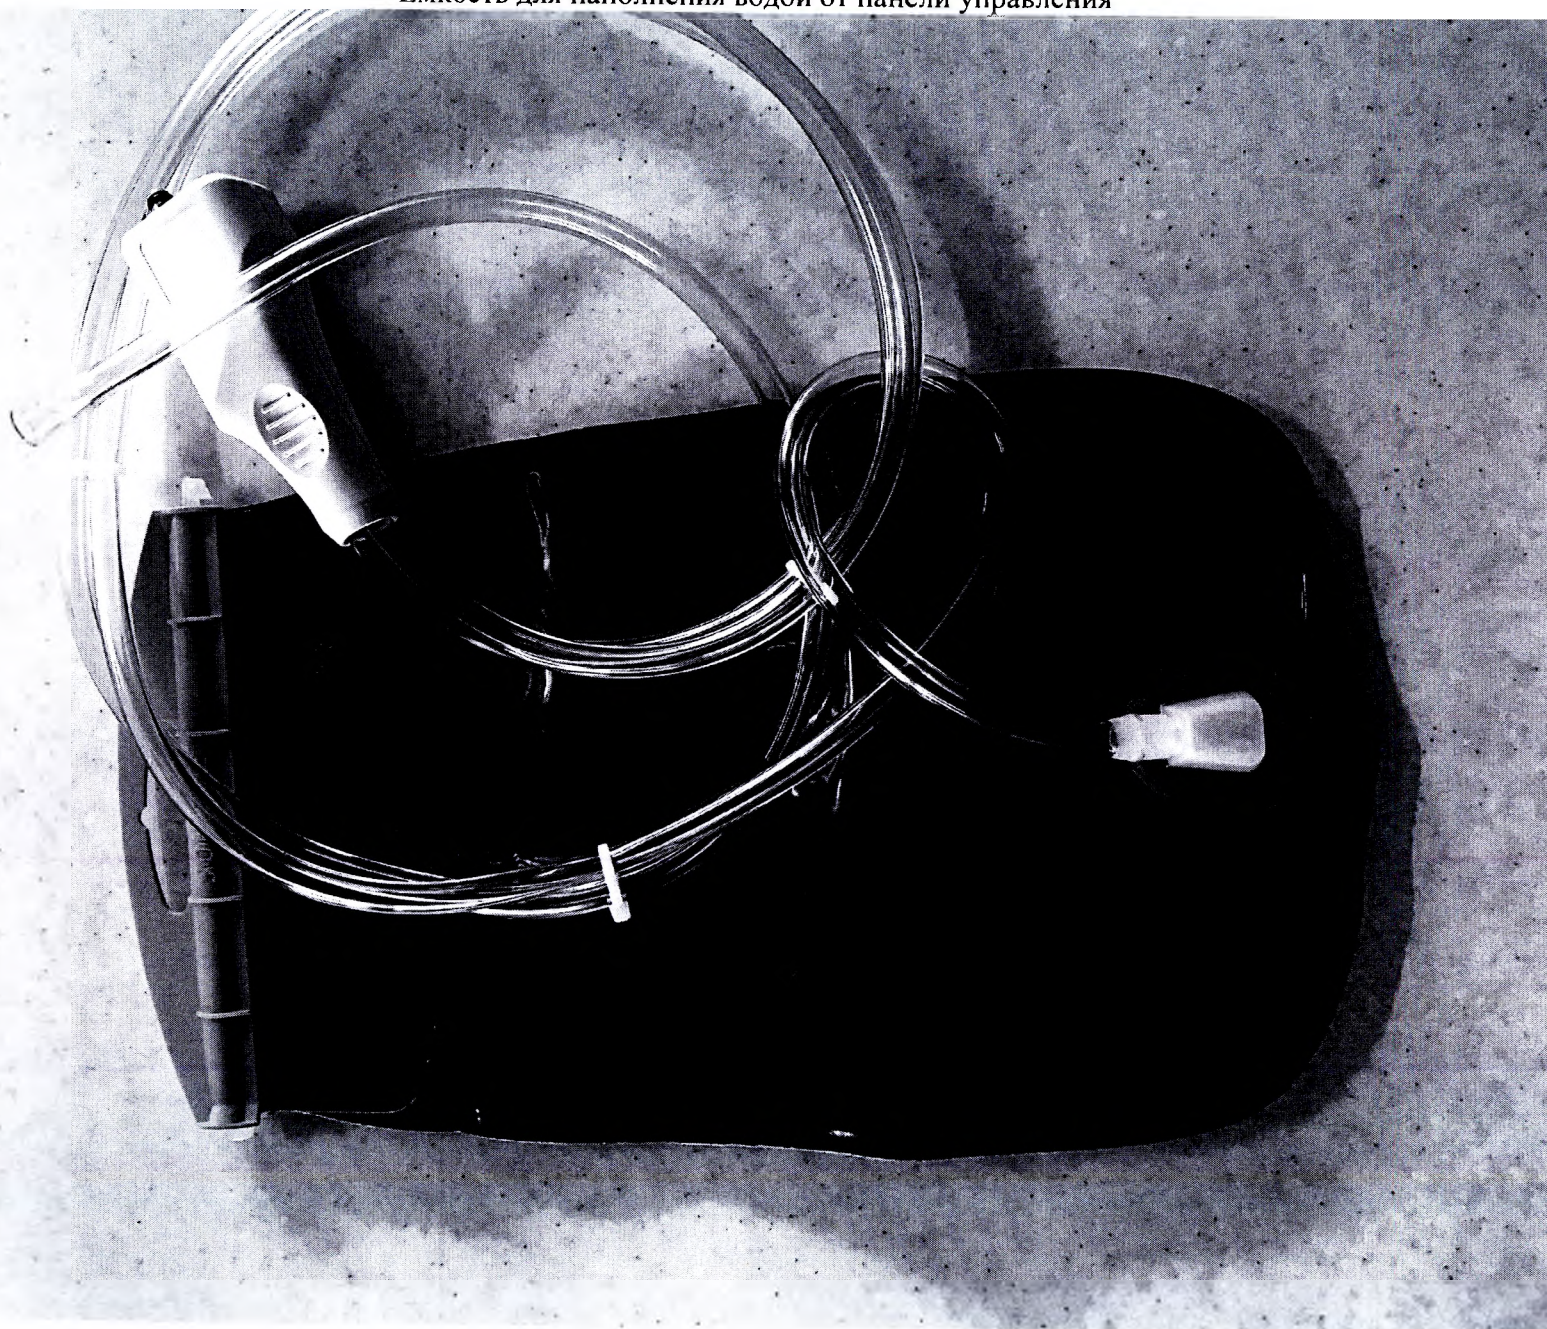



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 50 лист (ов)

2 А.В. Завалюк

