

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Аткус»

Ганичева В.А.


2018 г.




Фотографии изделия медицинского назначения

Медицинский лазерный аппарат Латус-С по ТУ УШРК.941133.001ТУ

Медицинский лазерный аппарат Латус-С

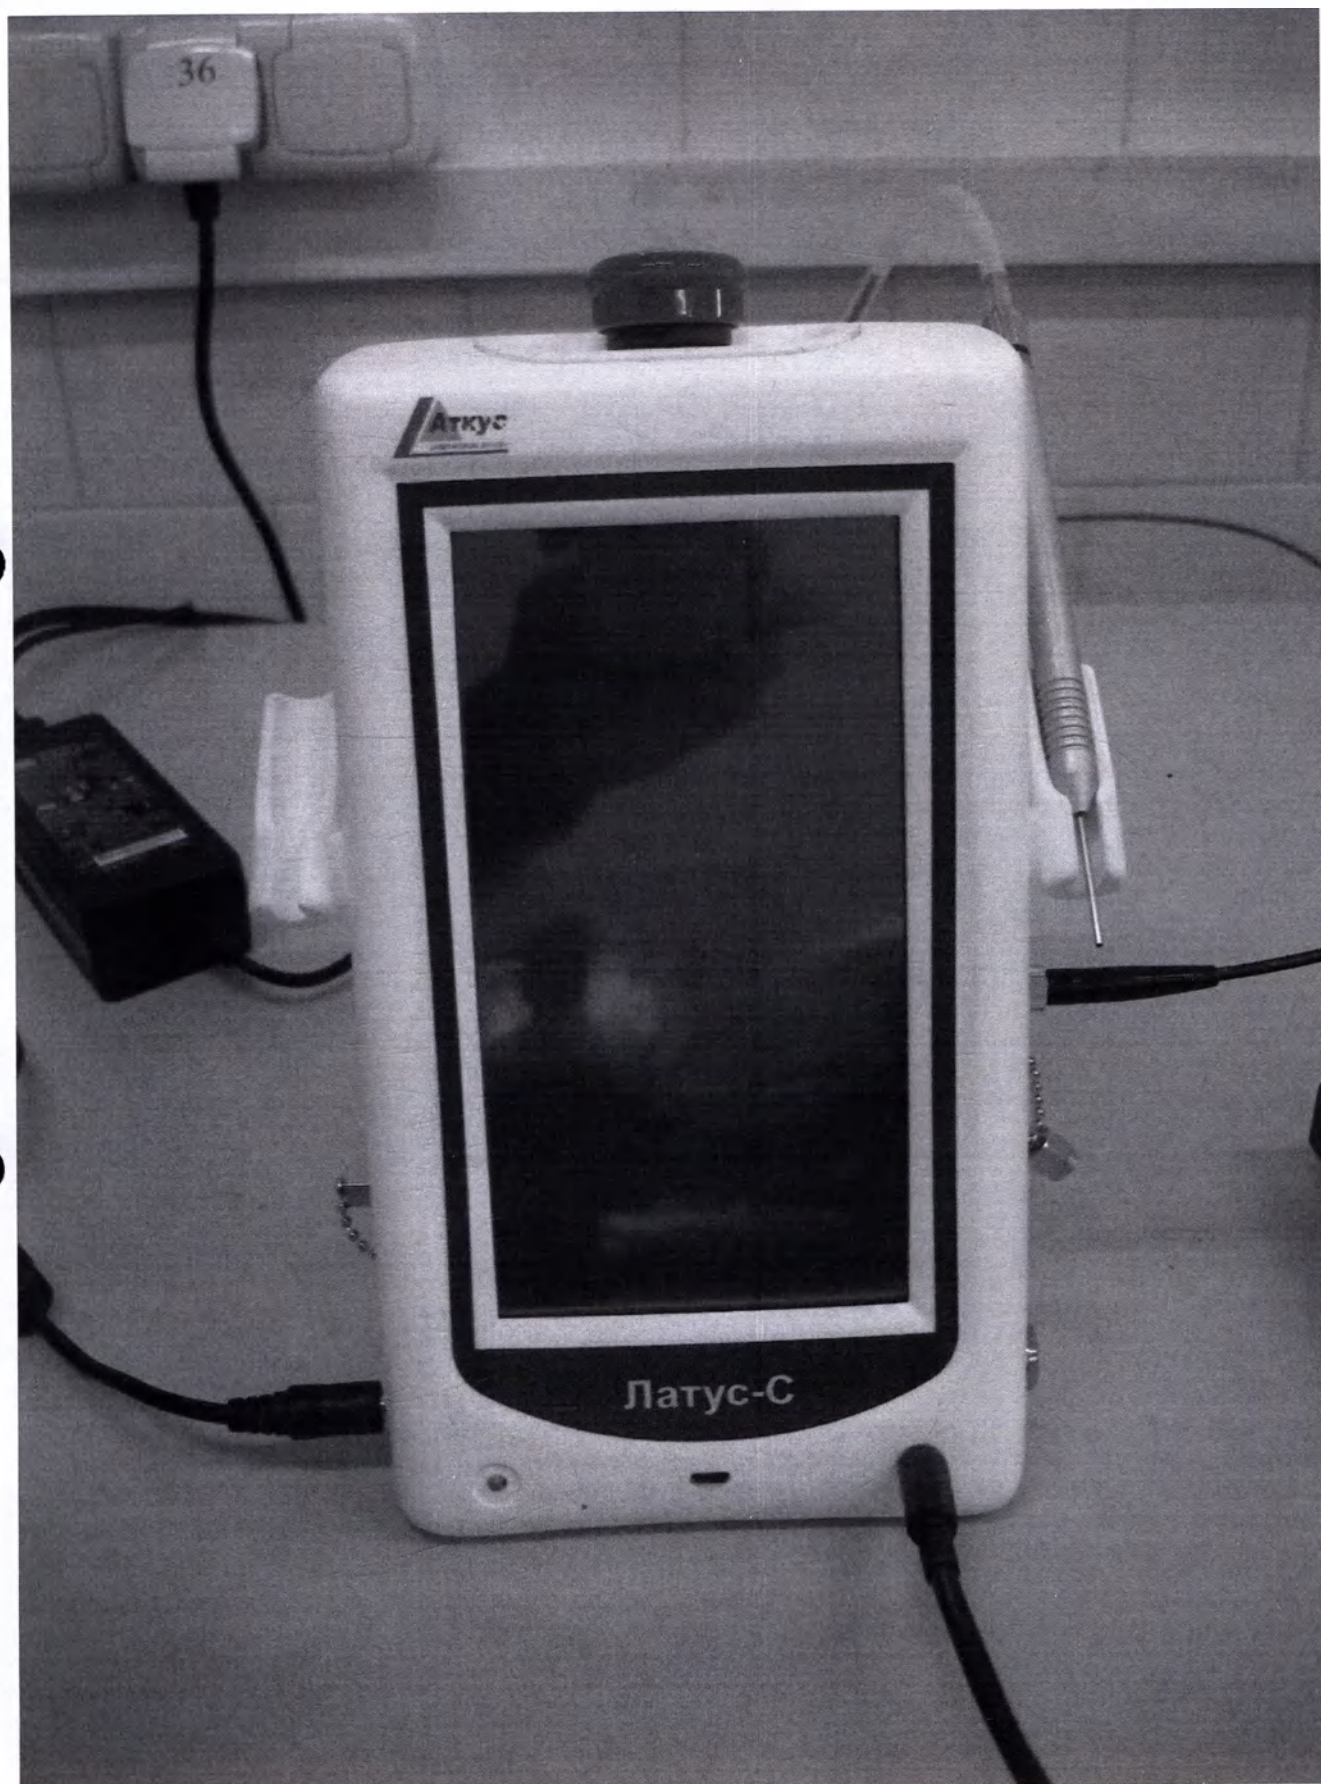

Вид справа

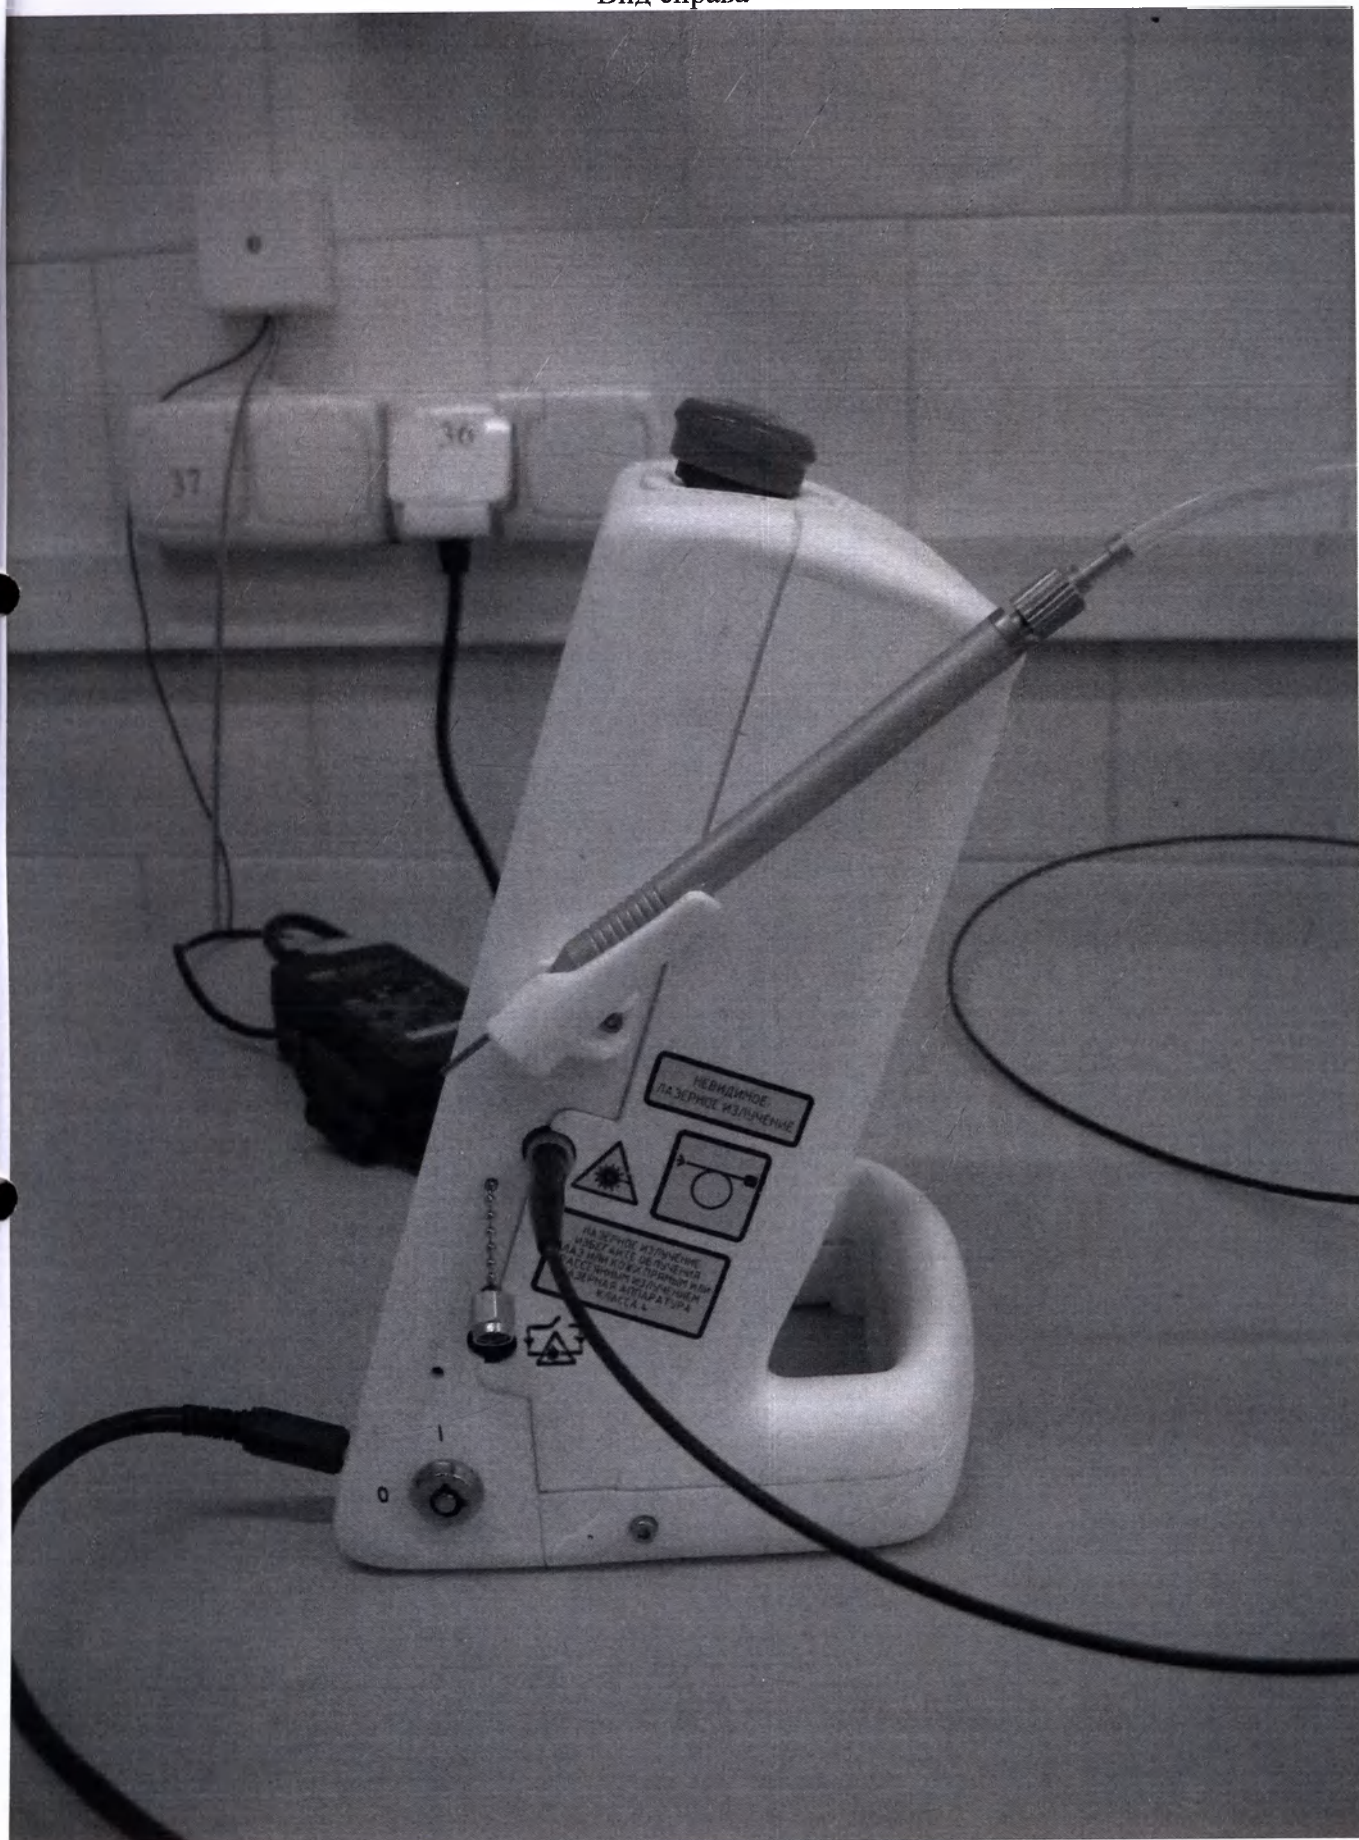

Вид слева



**Аппарат лазерный медицинский
ЛАТУС-С**

УШРК.941133.001ТУ Зав. №0002/2018

Максимальная оптическая мощность:

на длине волны от 800 до 990 нм - 8 Вт

на длине волны от 400 до 680 нм - 400 мВт

Класс лазерной опасности IV Питание — 24 В

Потребляемая мощность: не более 60 Вт

Изготовлено ООО "Аткус"


Тел. +7 812 294 25 32

e-mail: sales@atcus.ru

www.atcus.ru




Маркировка

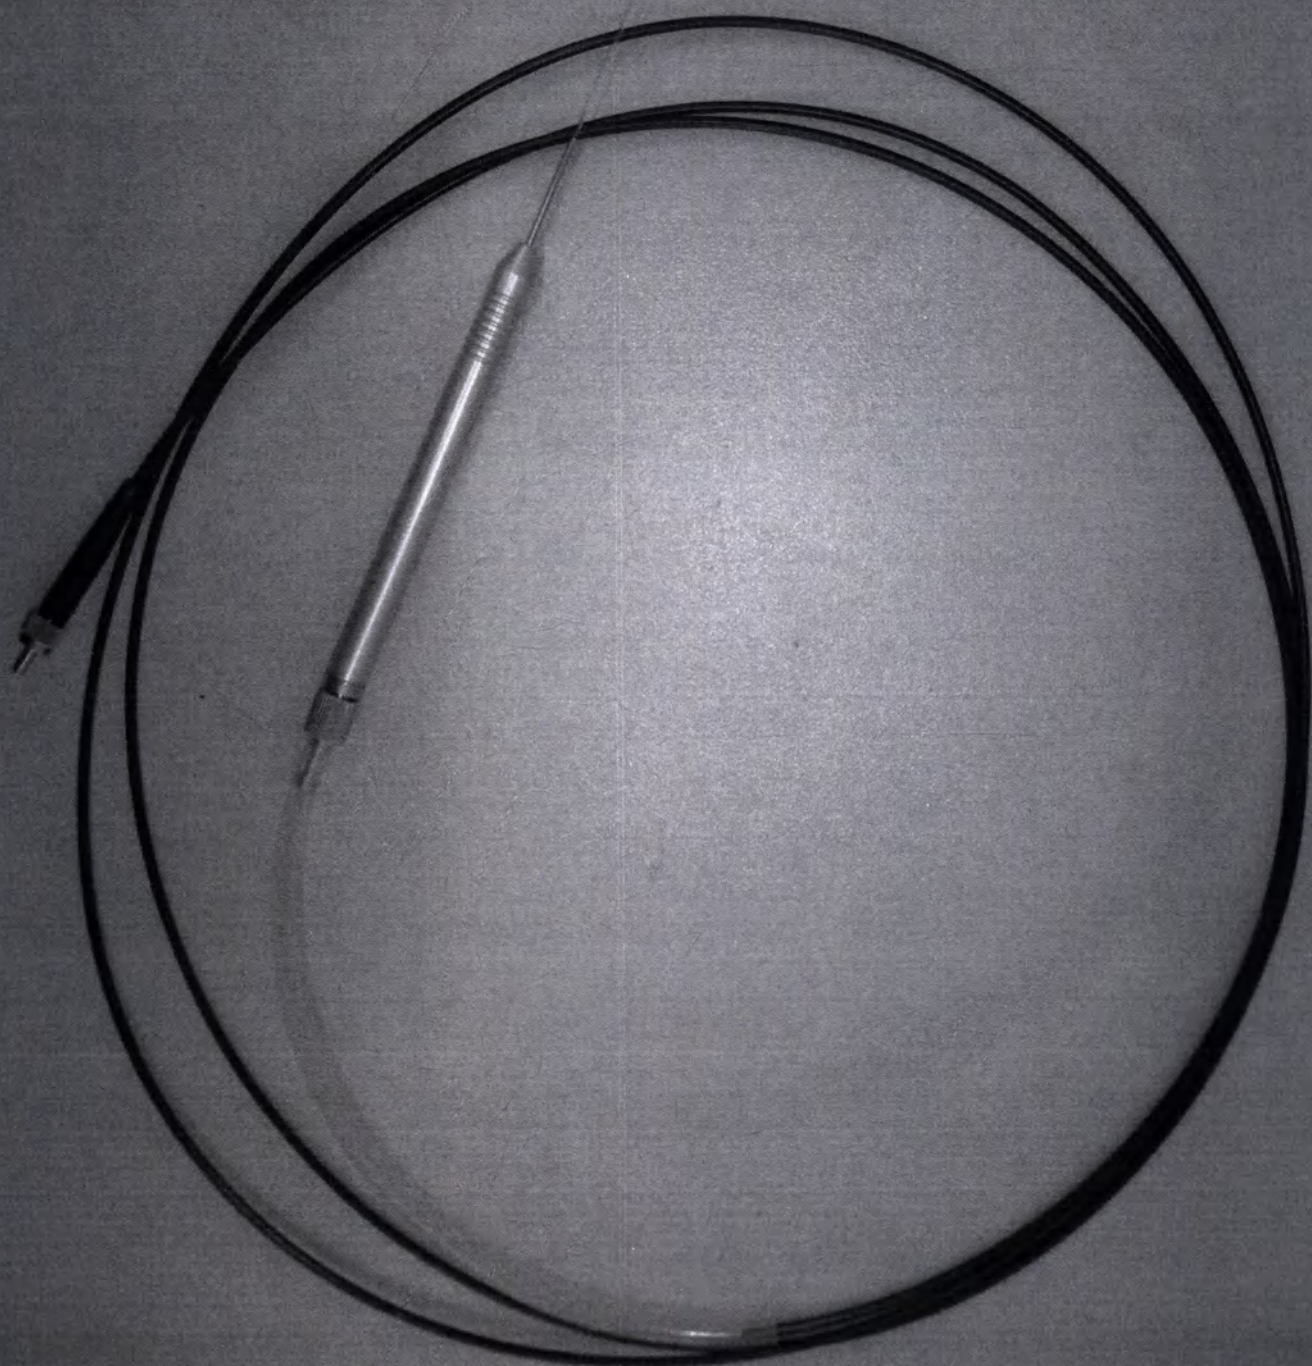







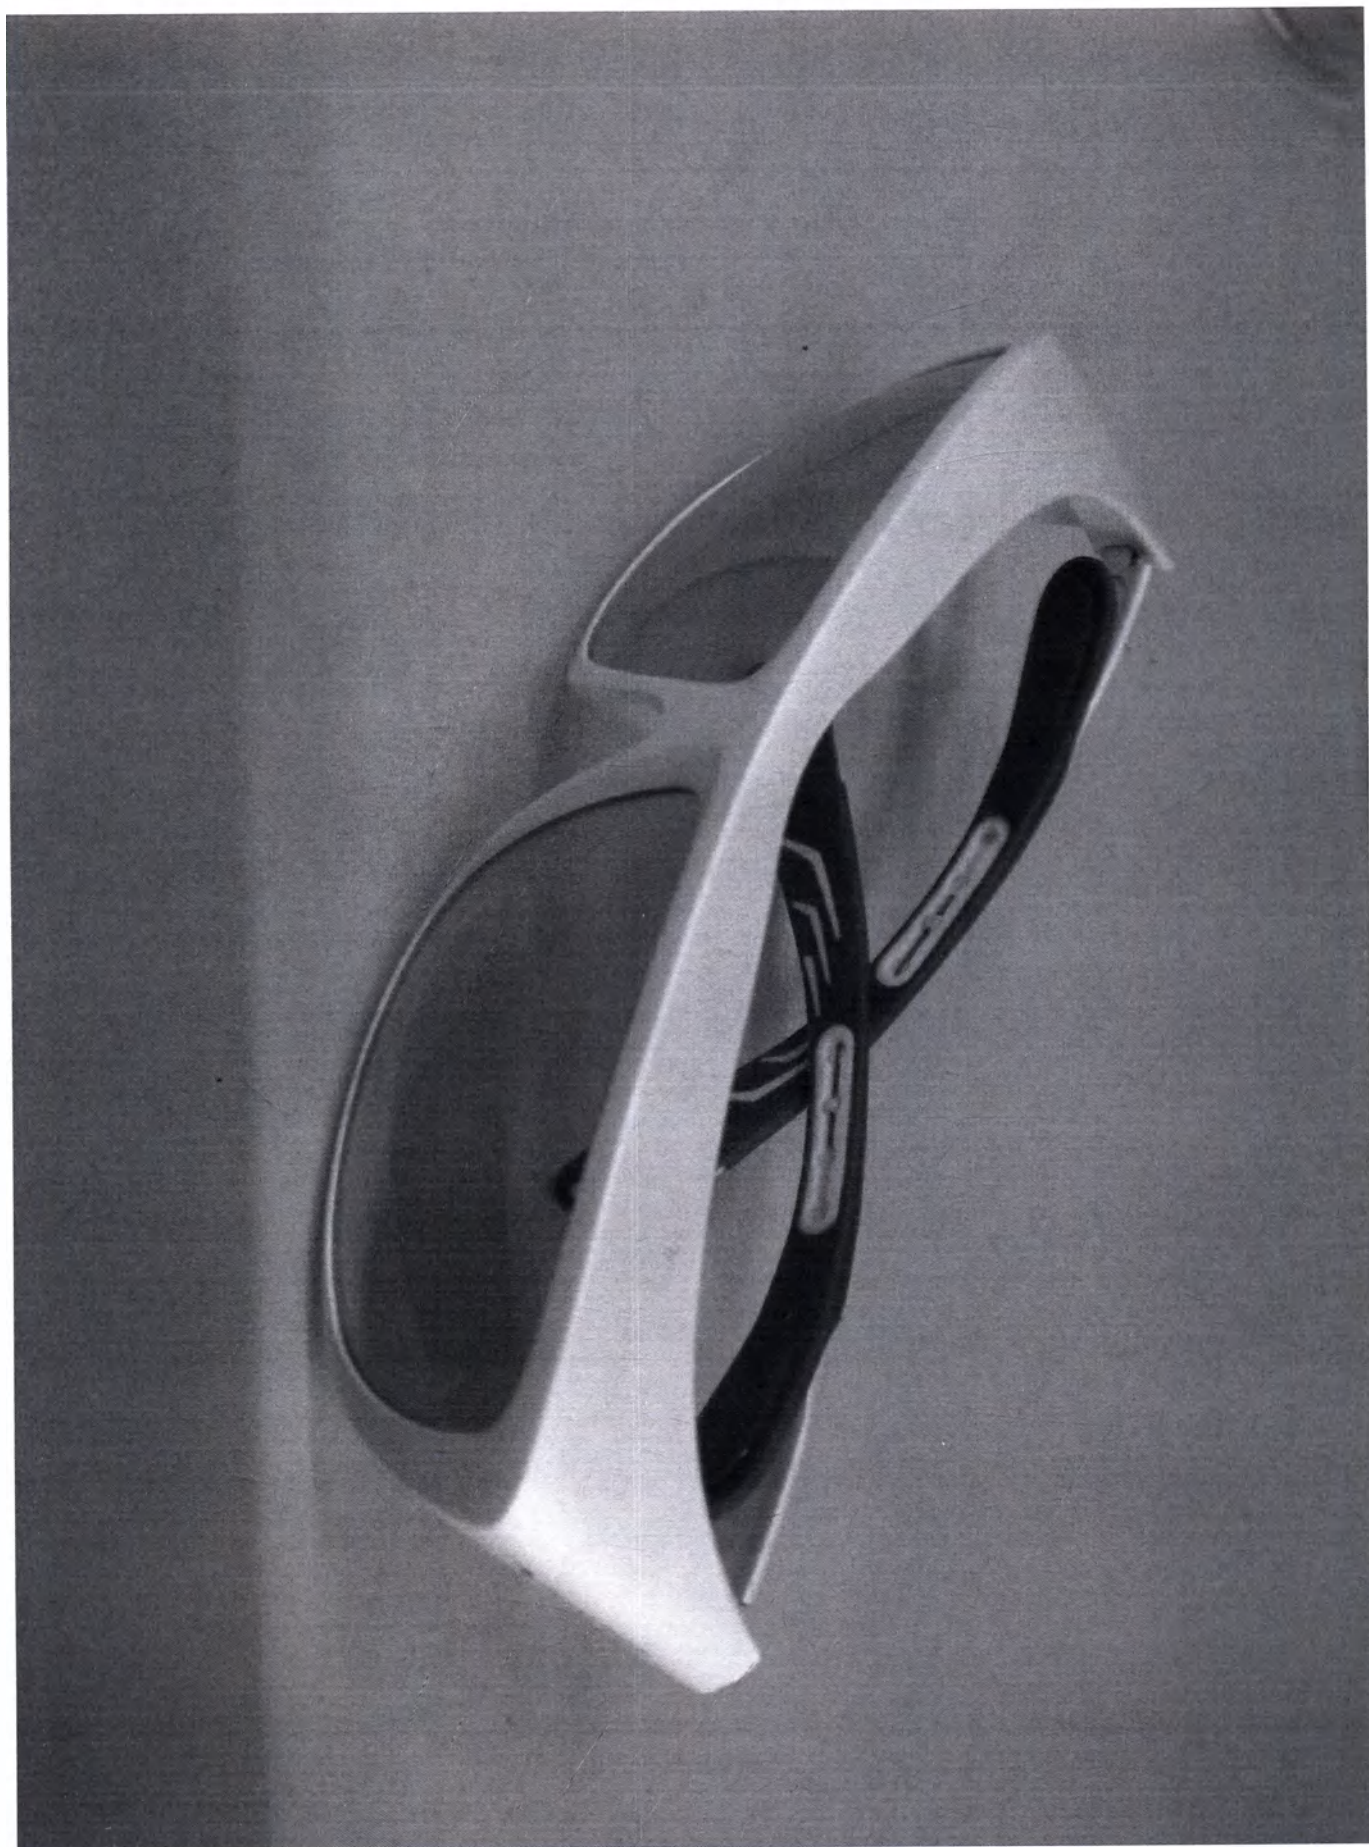


Педаль управления УШРК.941139.015

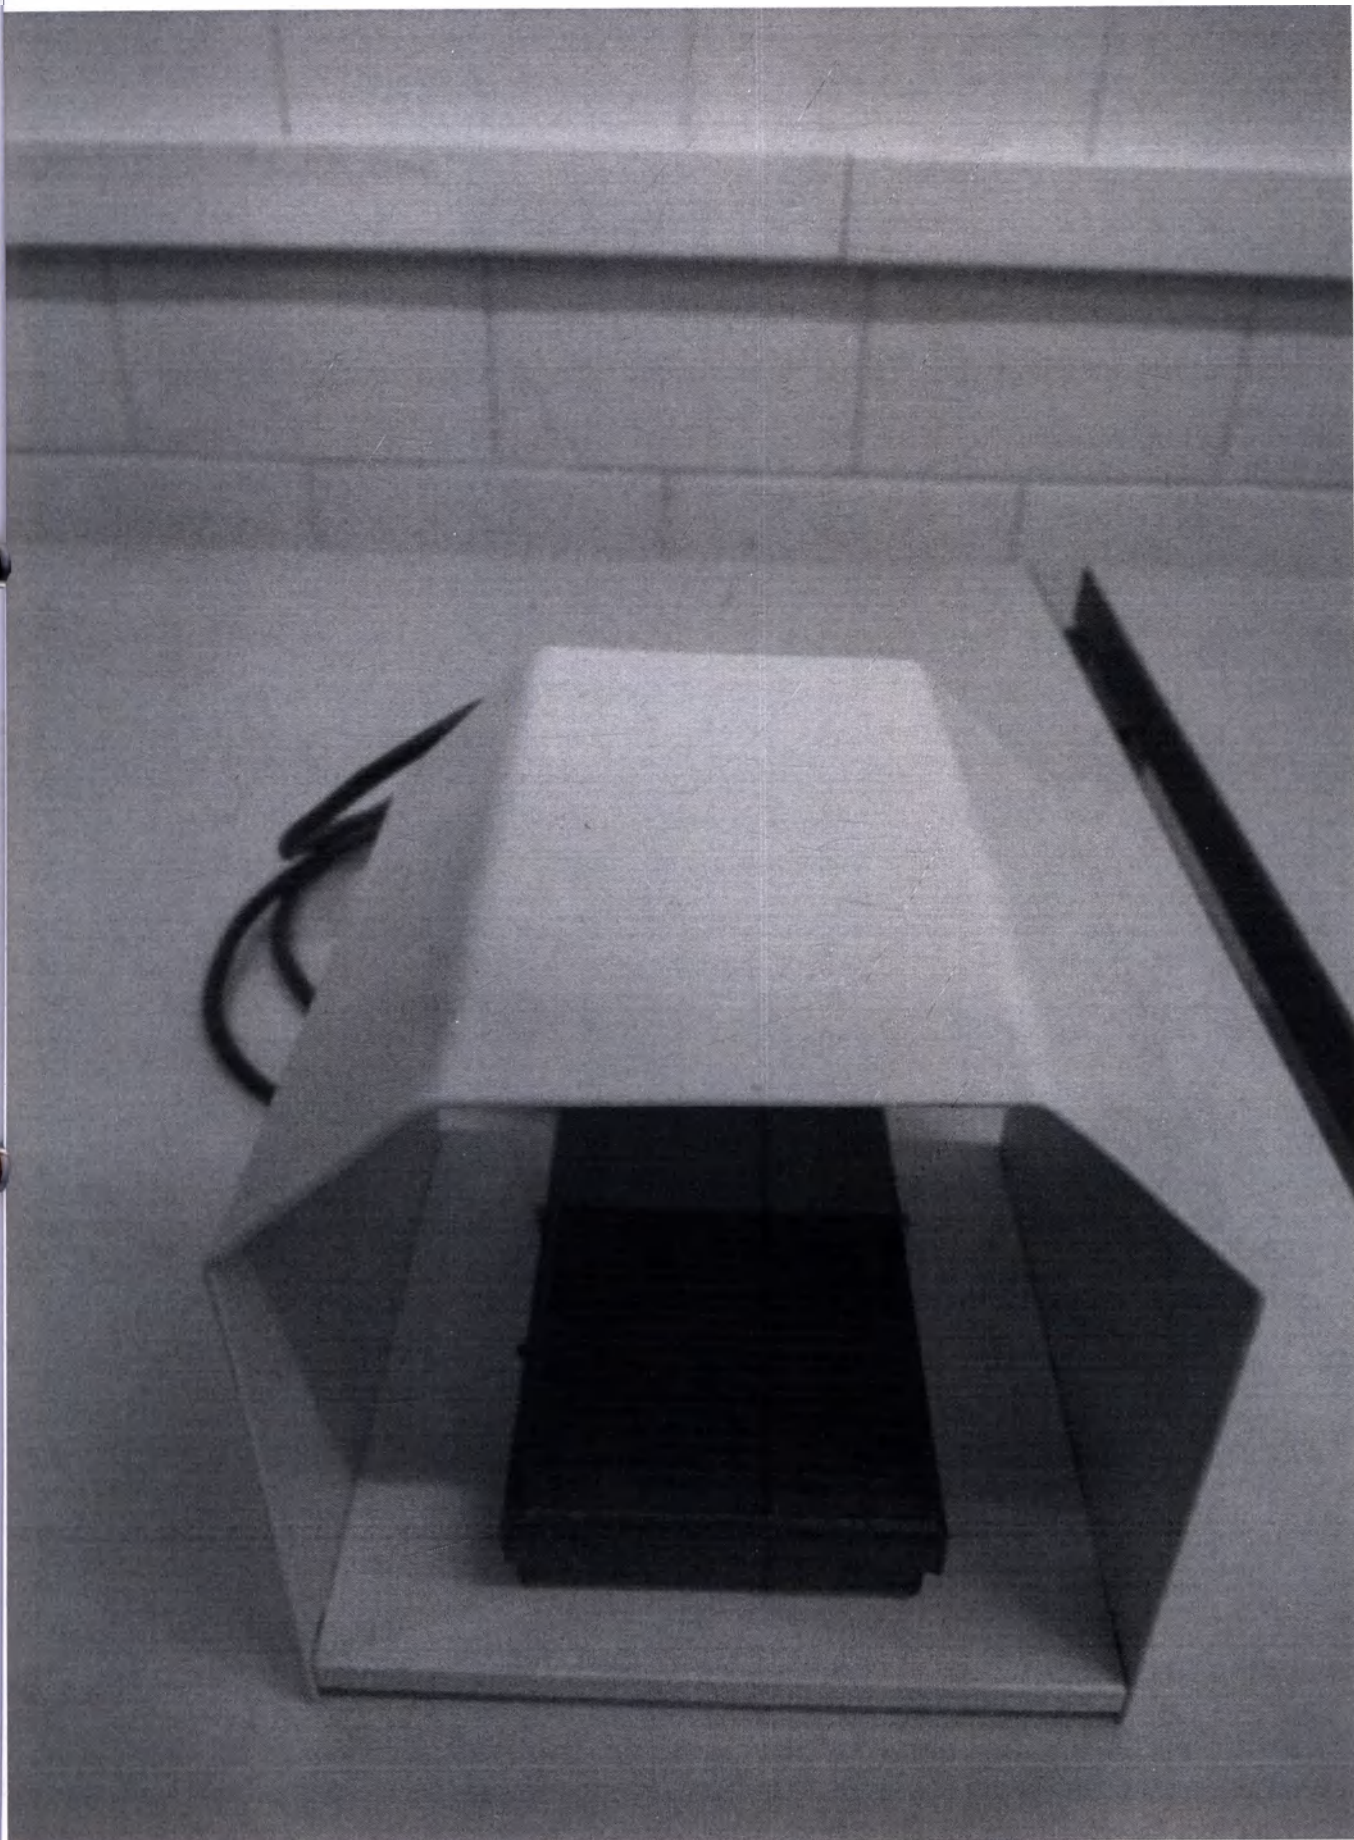

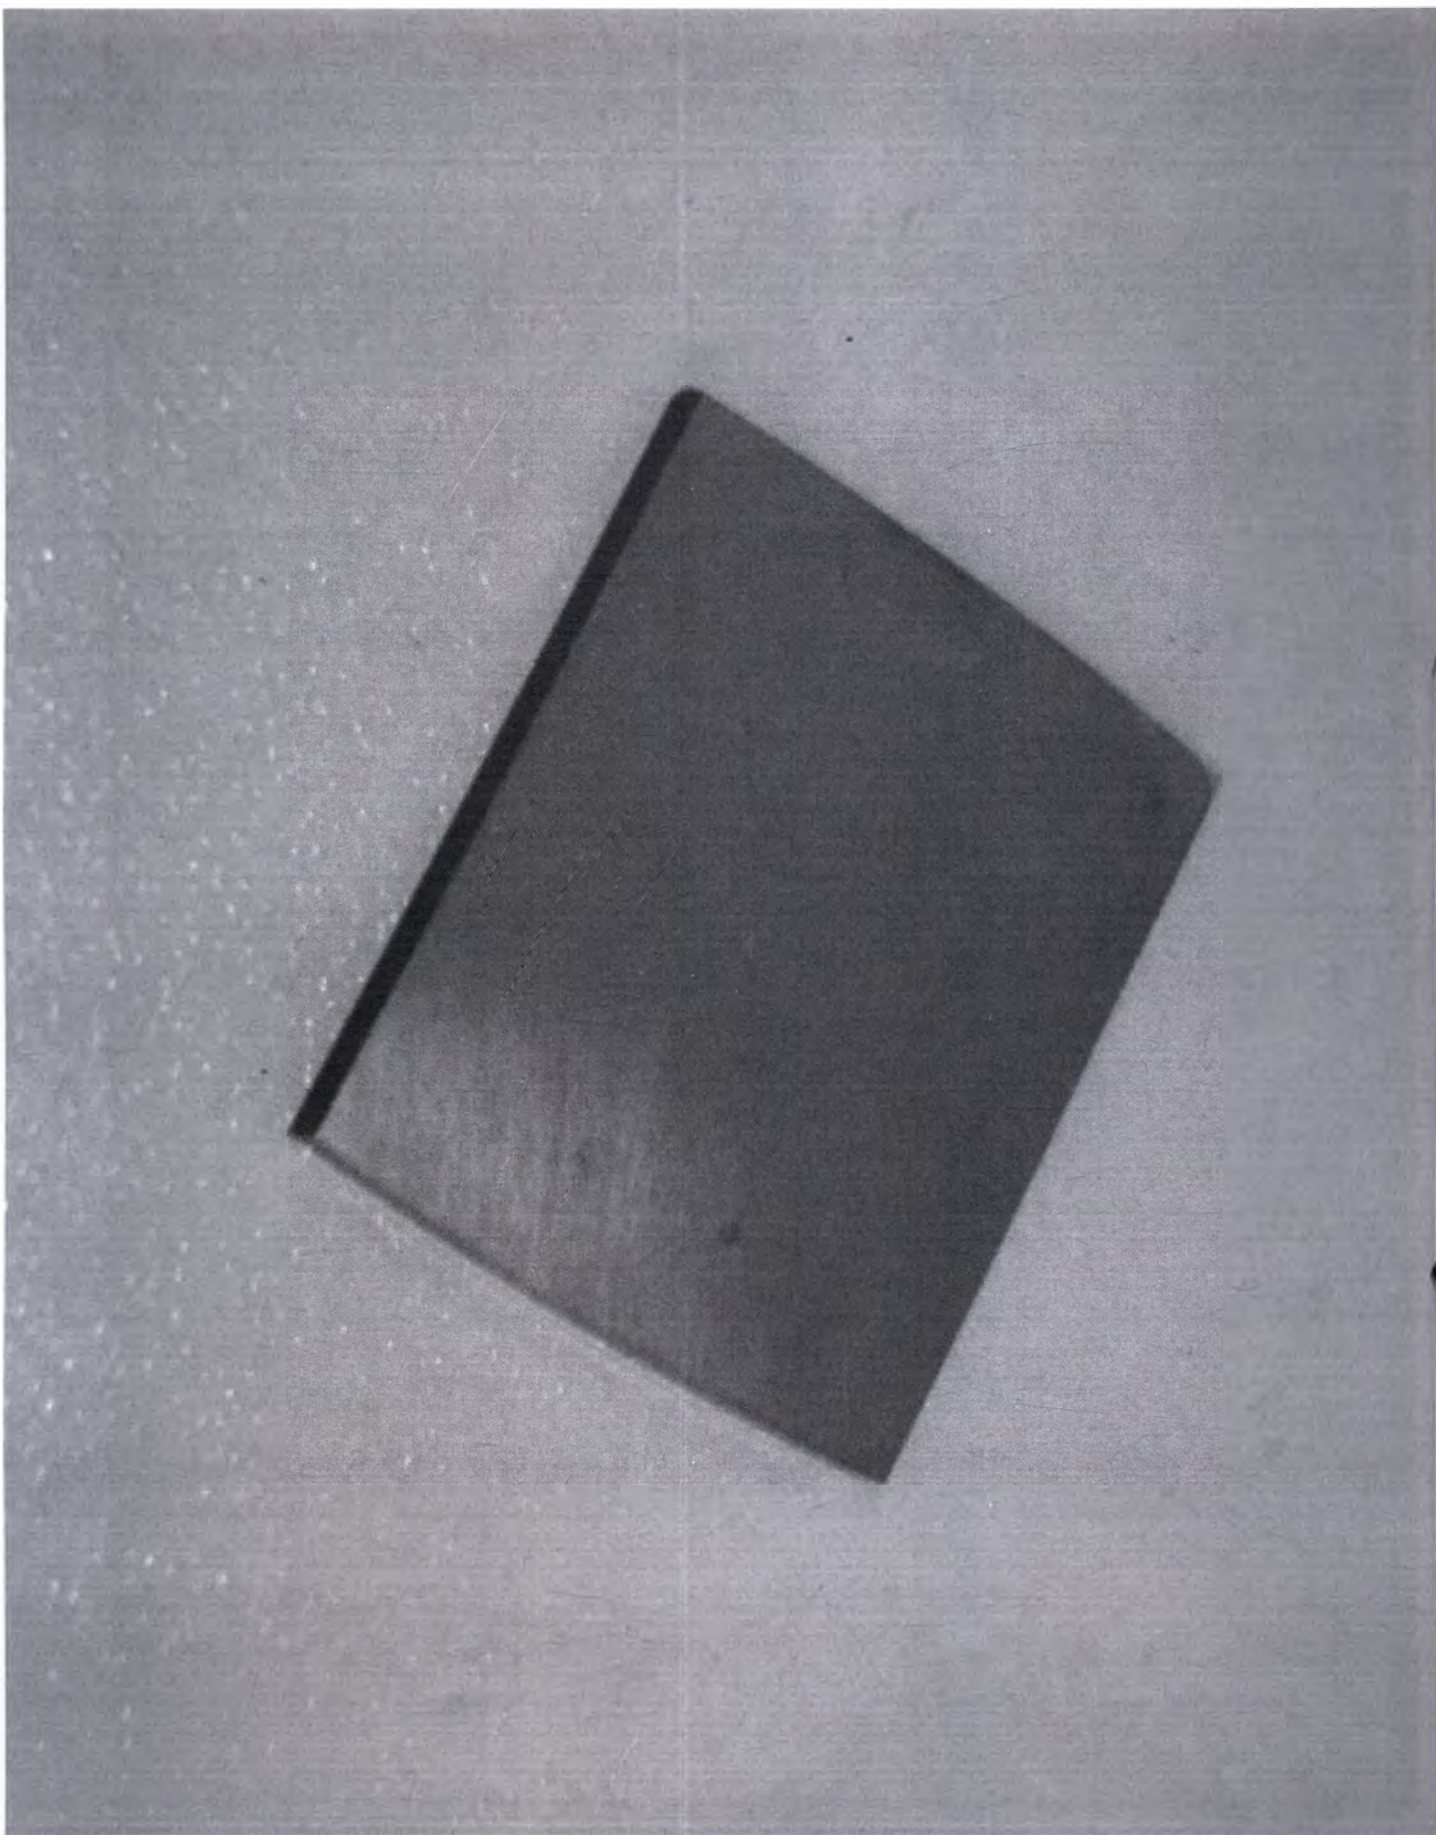



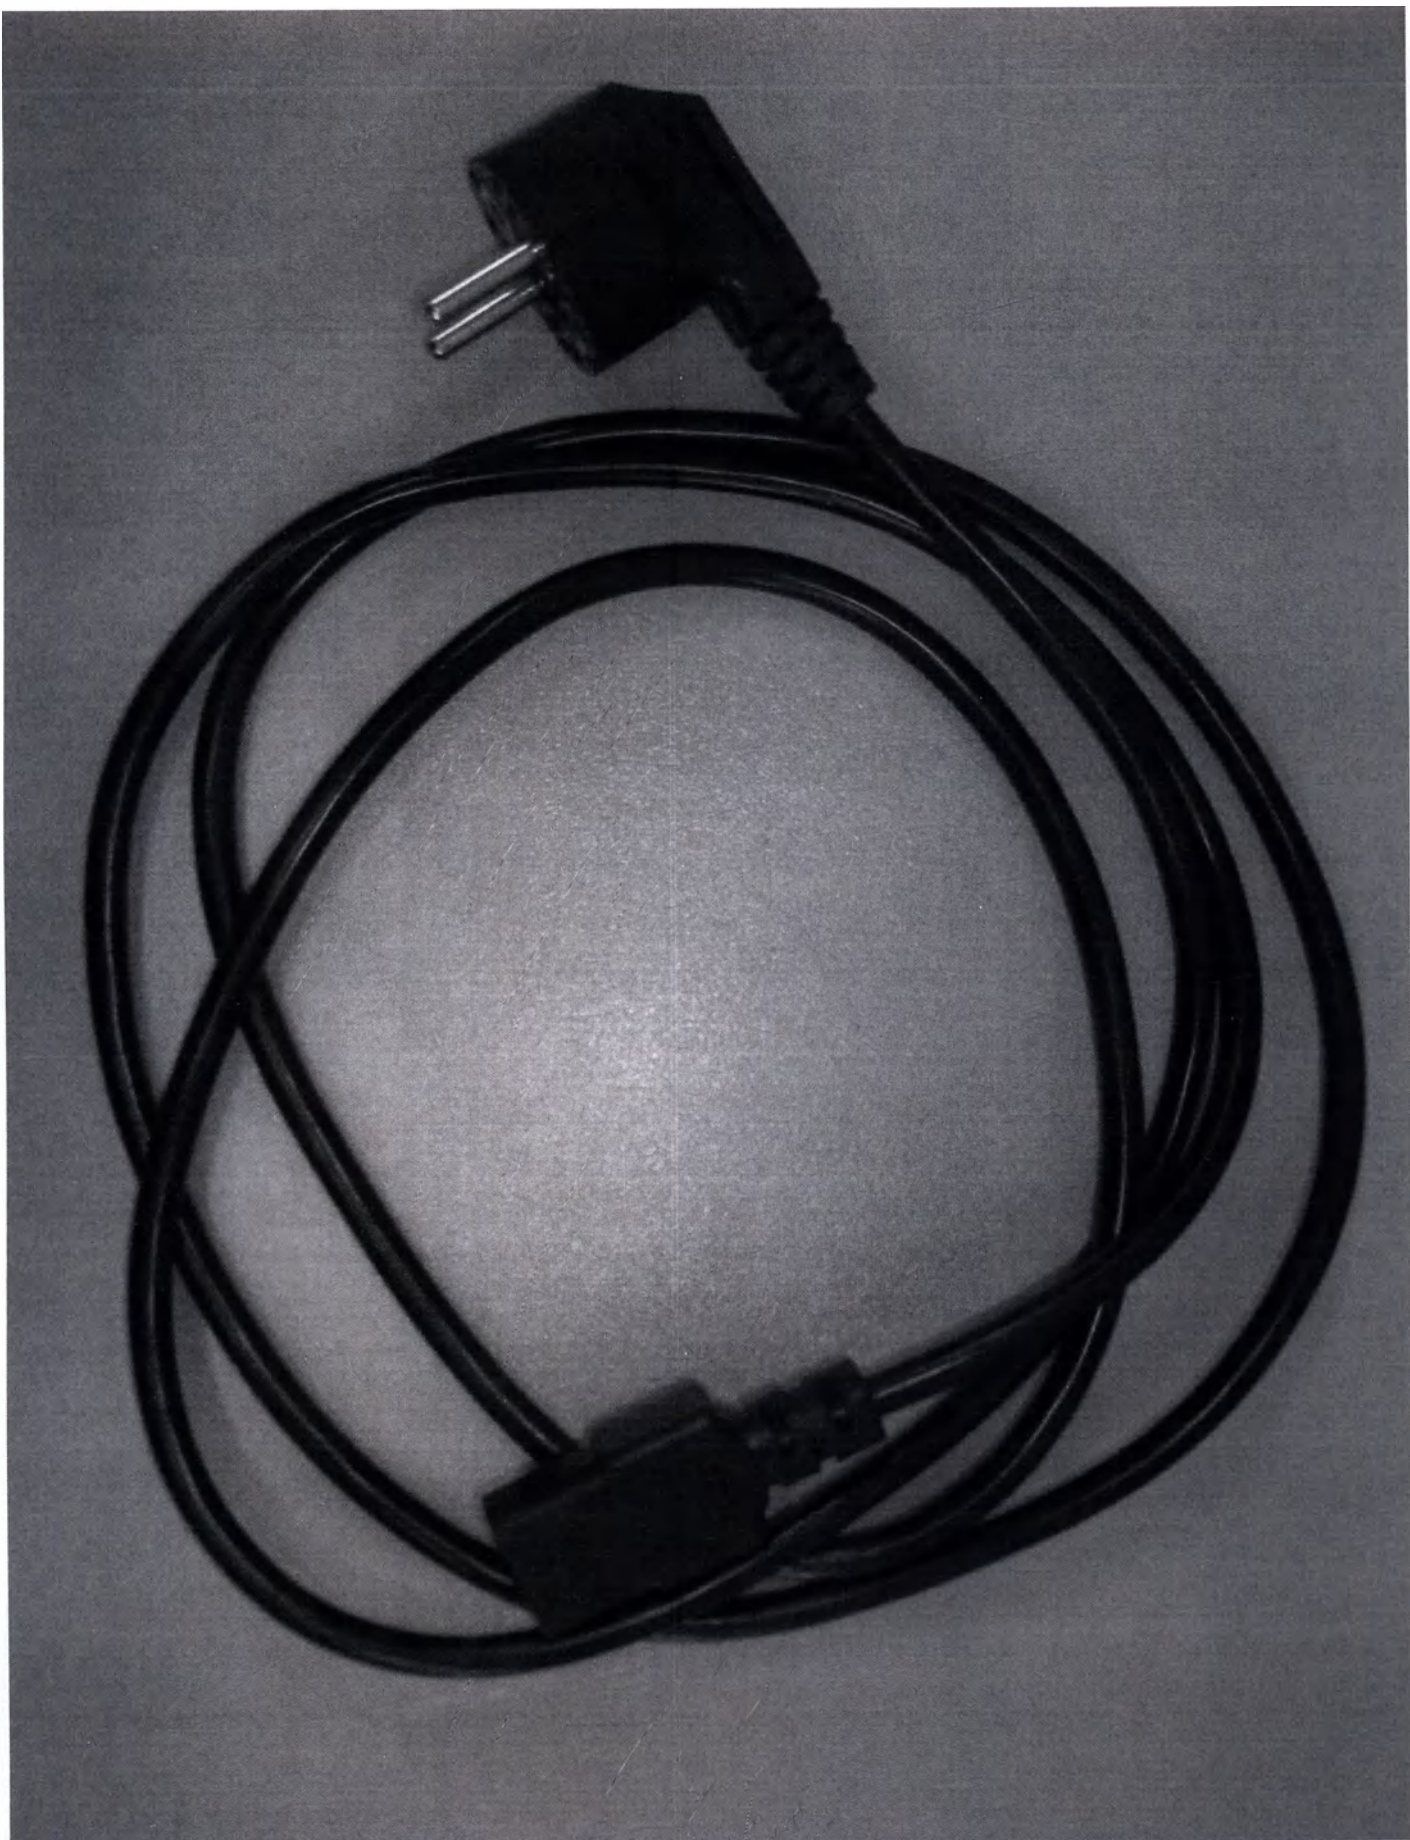

Внешний блок питания GSM60A24-P1J



Order No.:
GSM60A24-P1J

AC/DC SWITCHING ADAPTOR

MODEL NO.: GSM60A24

INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.4-0.7A

OUTPUT: 24V $\equiv$ 2.5A, 60W MAX.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)



CAUTION



DO NOT OPEN RISK
OF ELECTRIC SHOCK

Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf
aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von
autorisiertem Servicepersonal geöffnet werden



ATTENTION:

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

S/N:



EB43239052

MADE IN CHINA

MW02



Ключи блокировки JIN-TAY



Всего прошито и пронумеровано 16
(Исходный лист)

Директор
ООО «Аткус» В.А. Ганичева

