




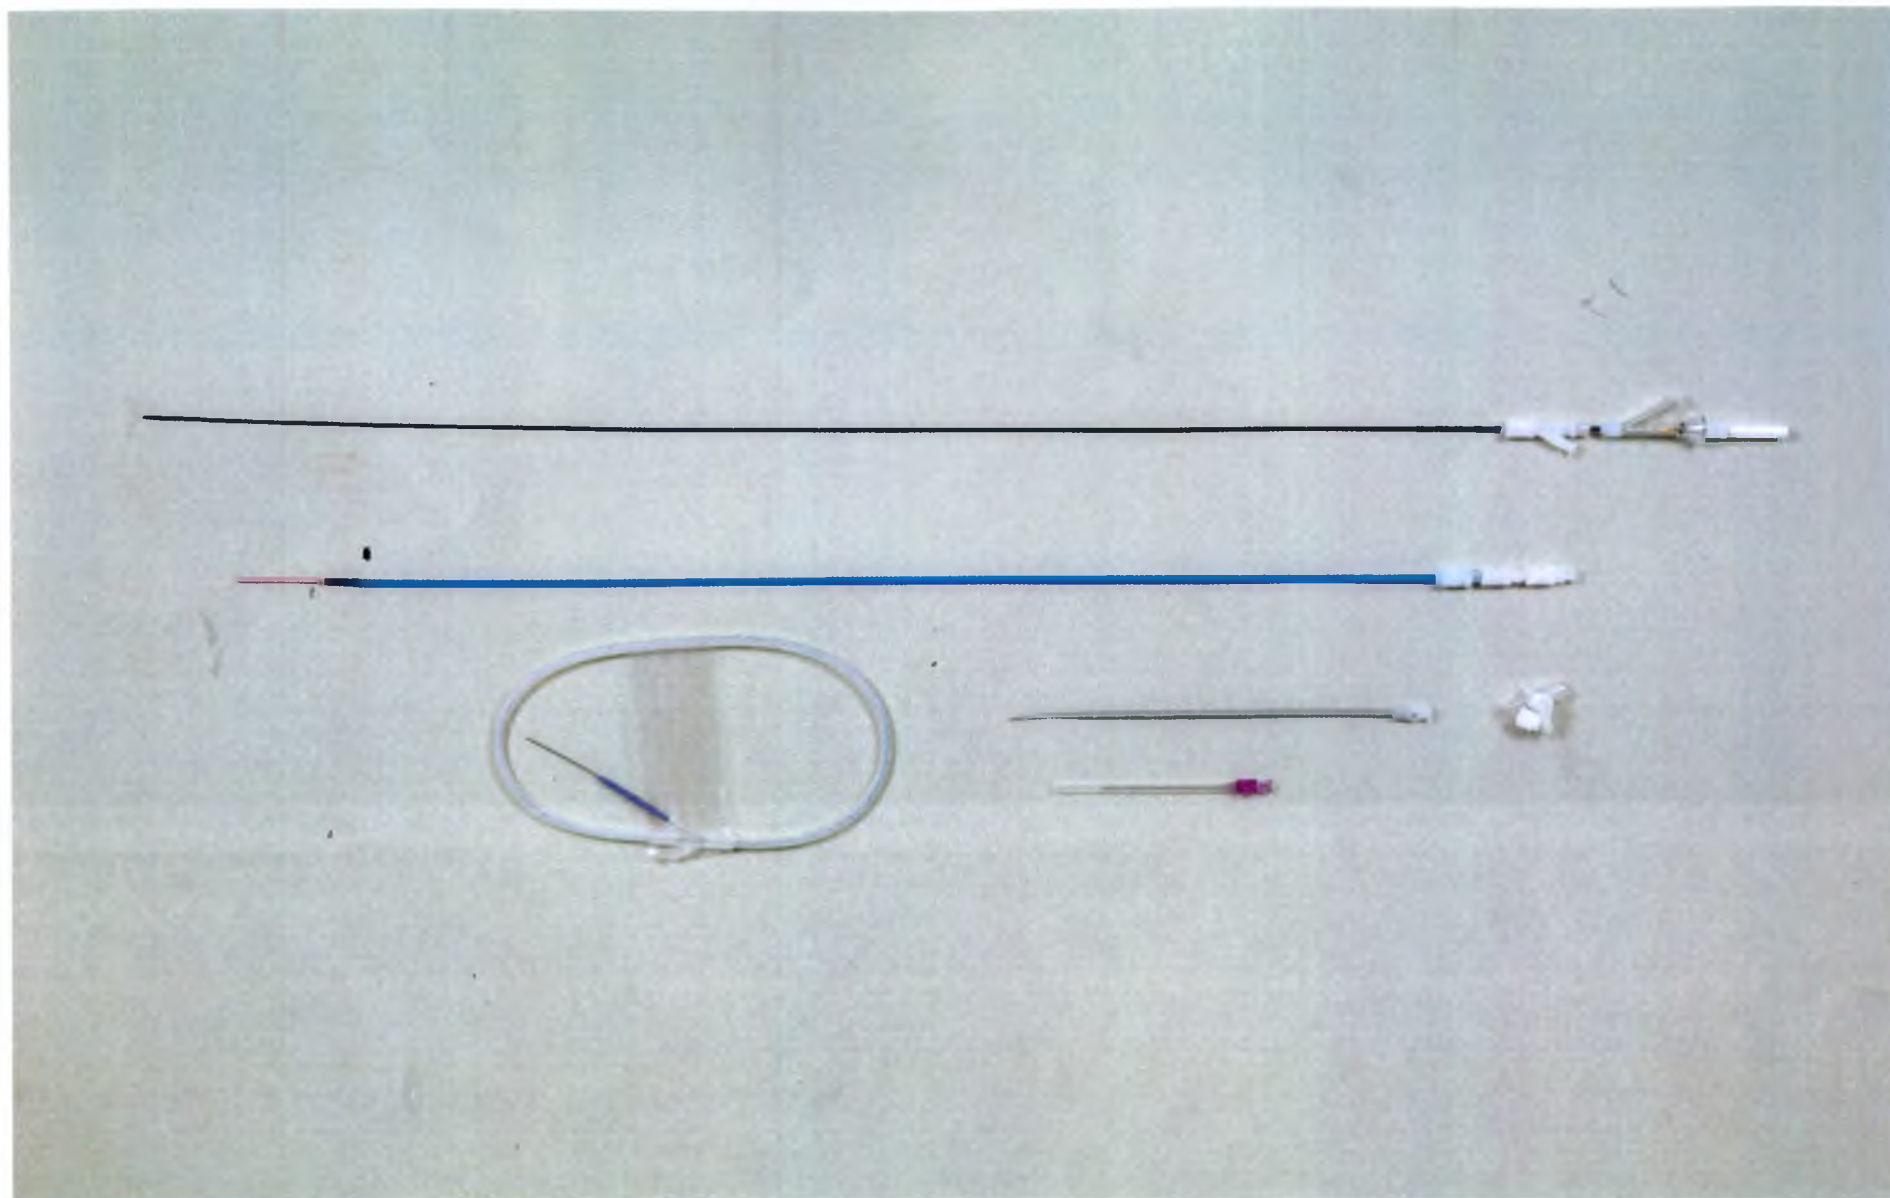


Ретриверы с петлей GTRS-200-RB.

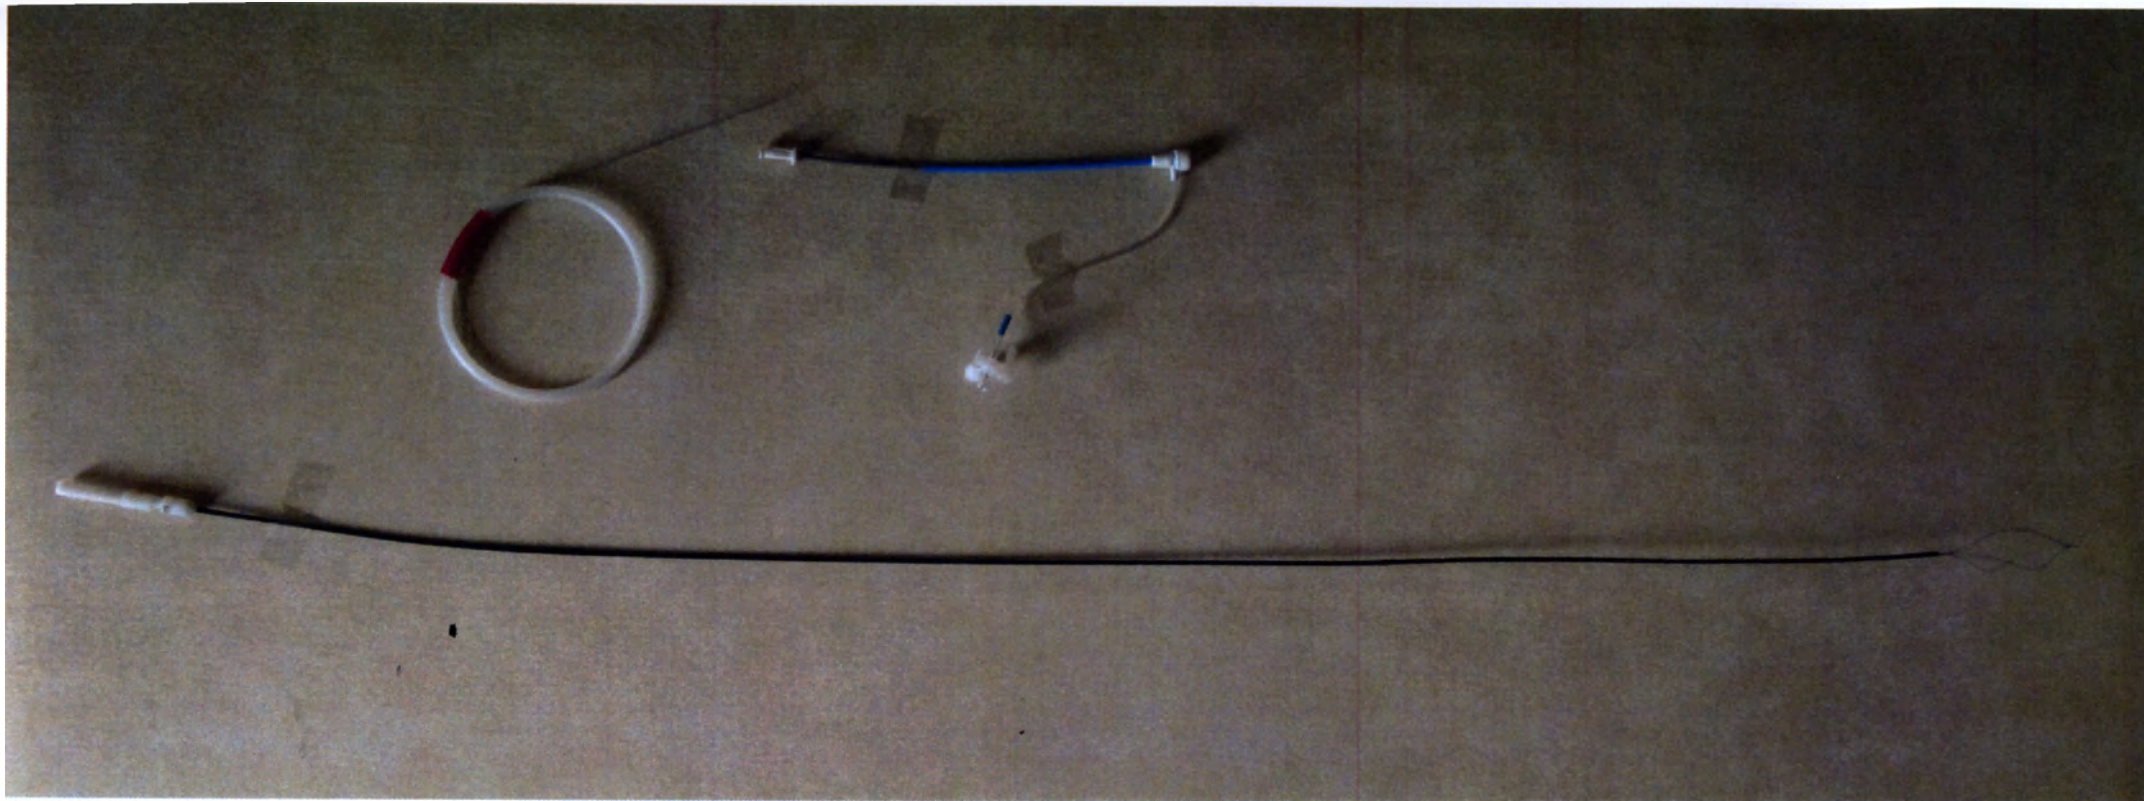


Ретриверы с корзинкой: DRS-100

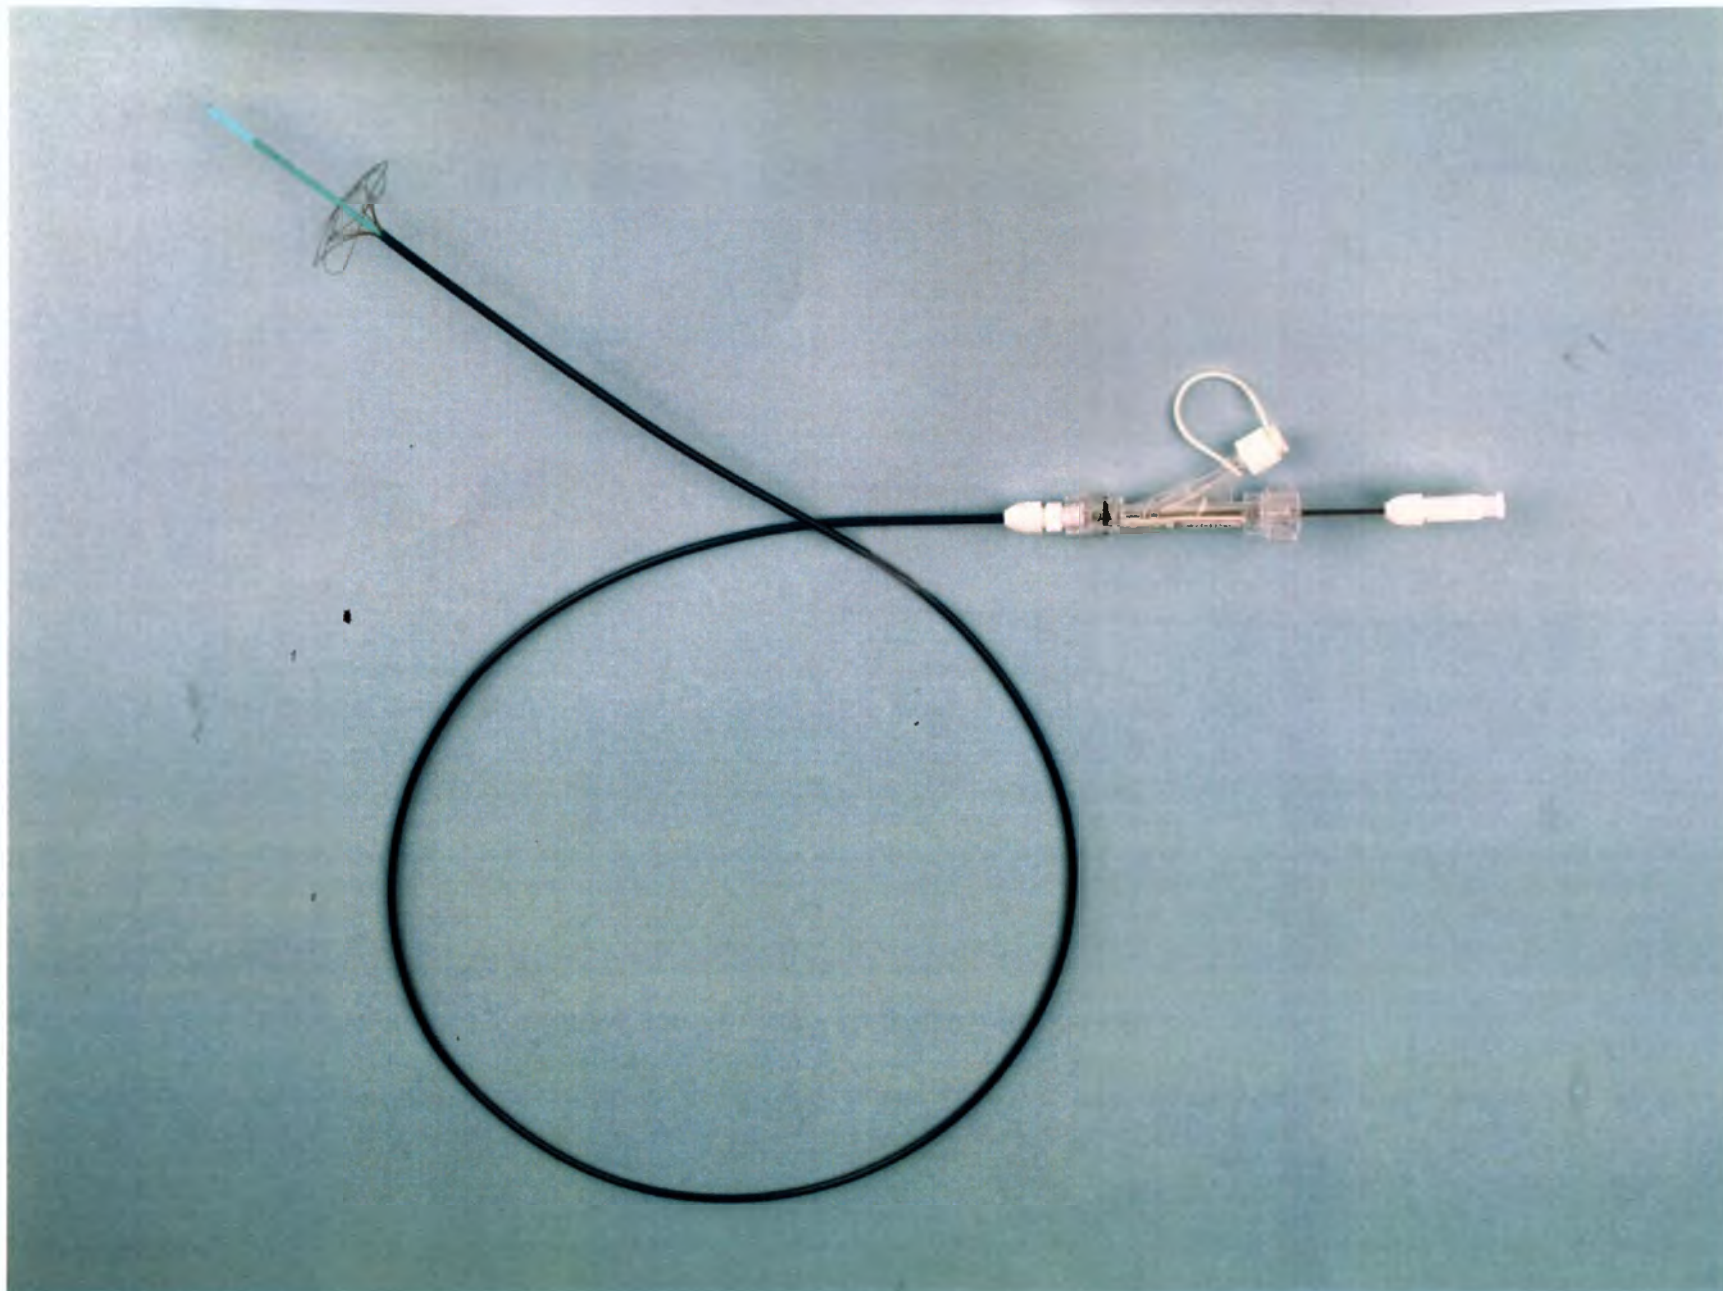


Ретриверы с корзинкой: INDY-8.0-35-100-40, INDY-8.0-35-55-40.

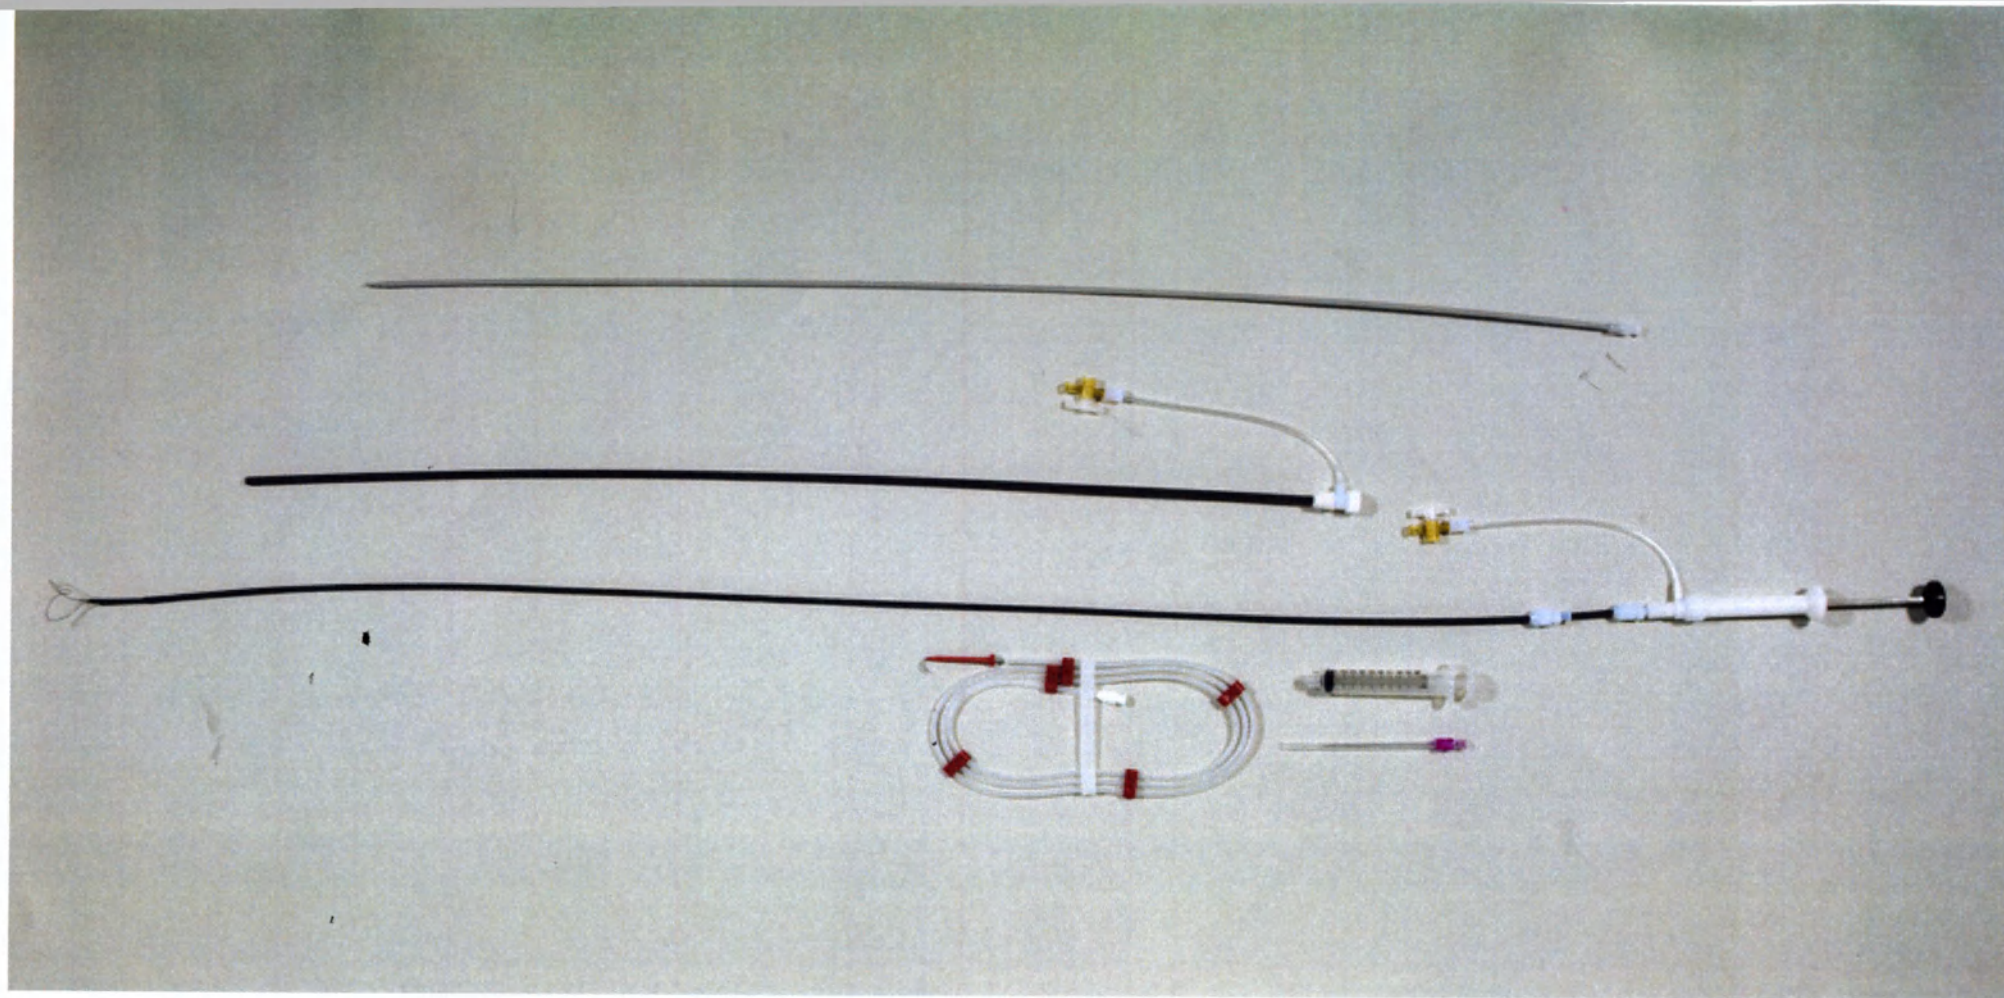

Ретриверы с петлей: LR-NES001, LR-NES002, LR-NES541, LR-SSN001, LR-SSN002

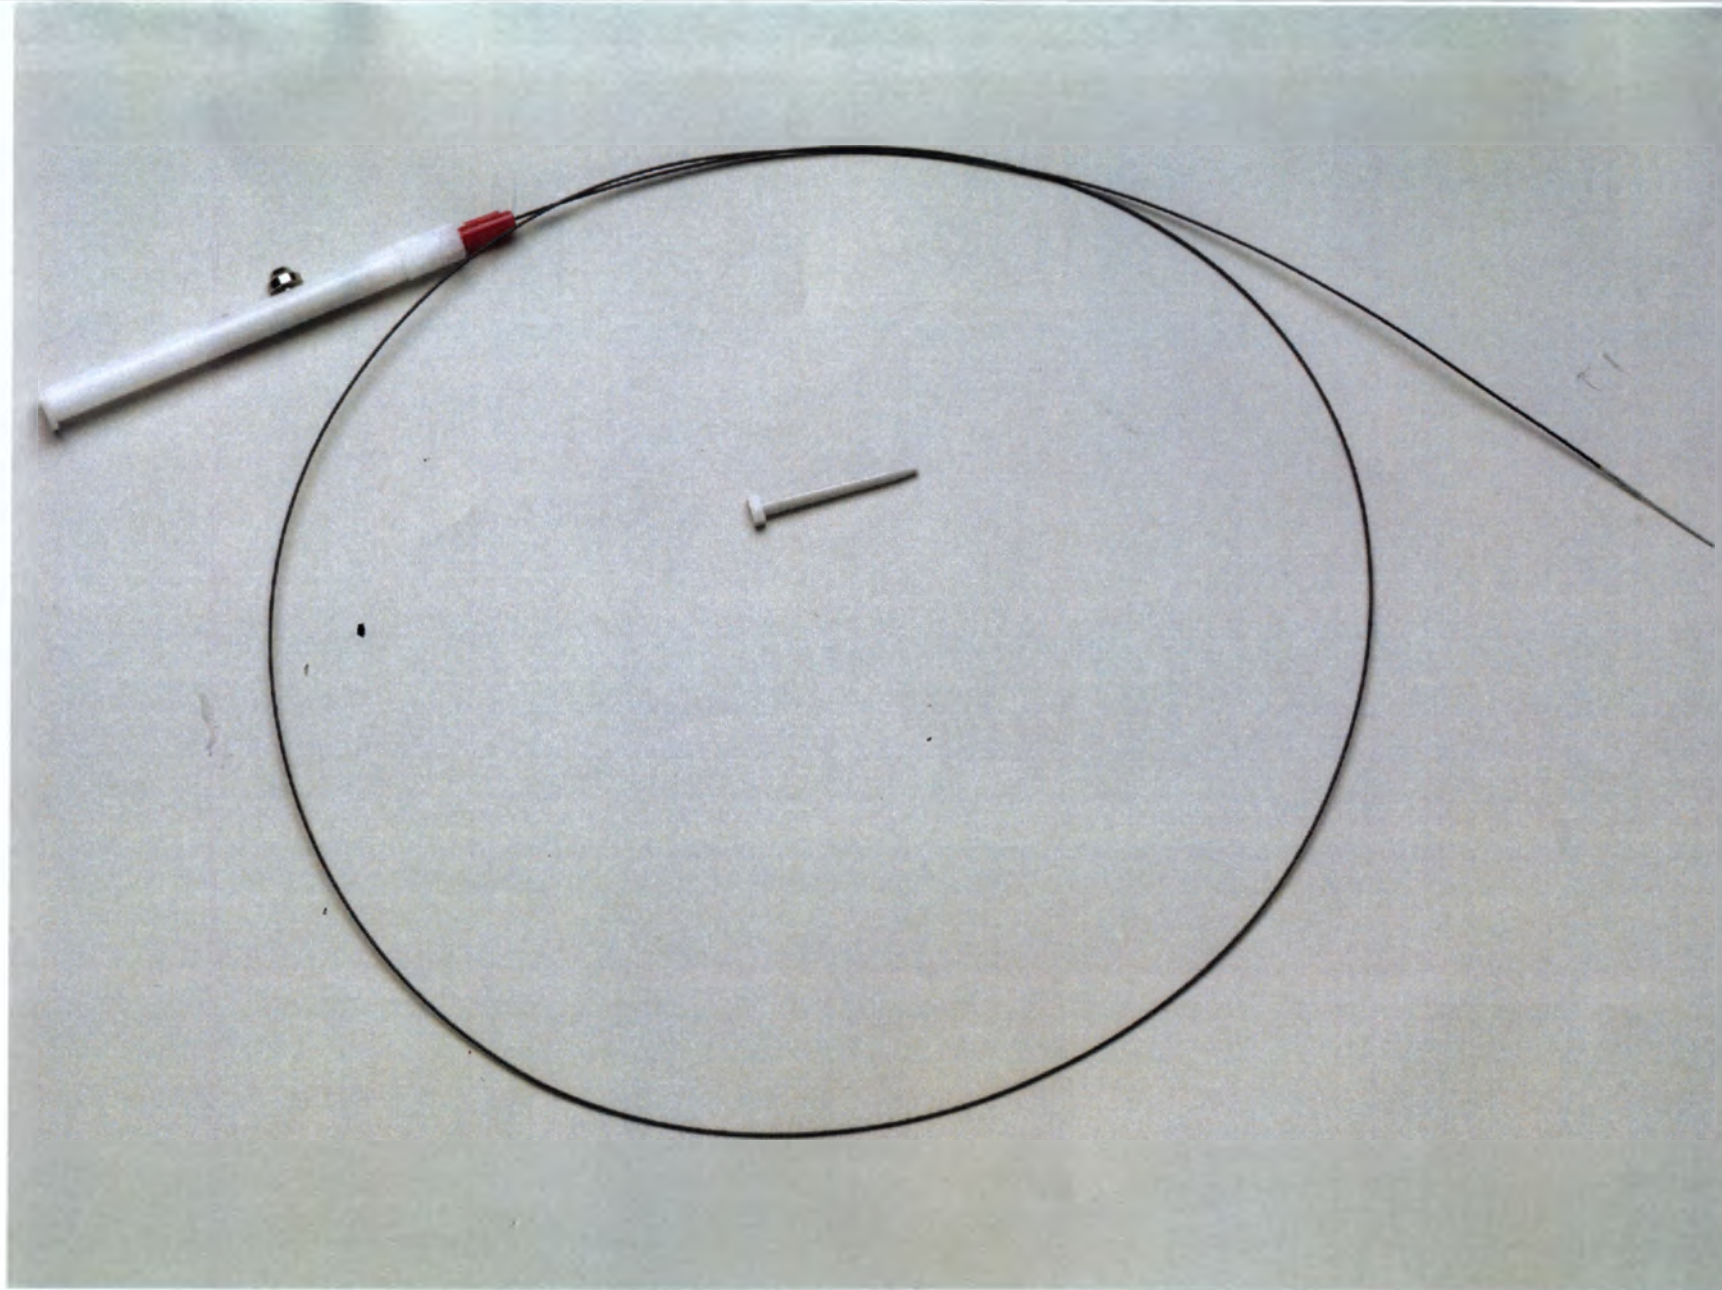

Ретриверы с щипцами: VRF-3.0-120, VRF-3.0-135.

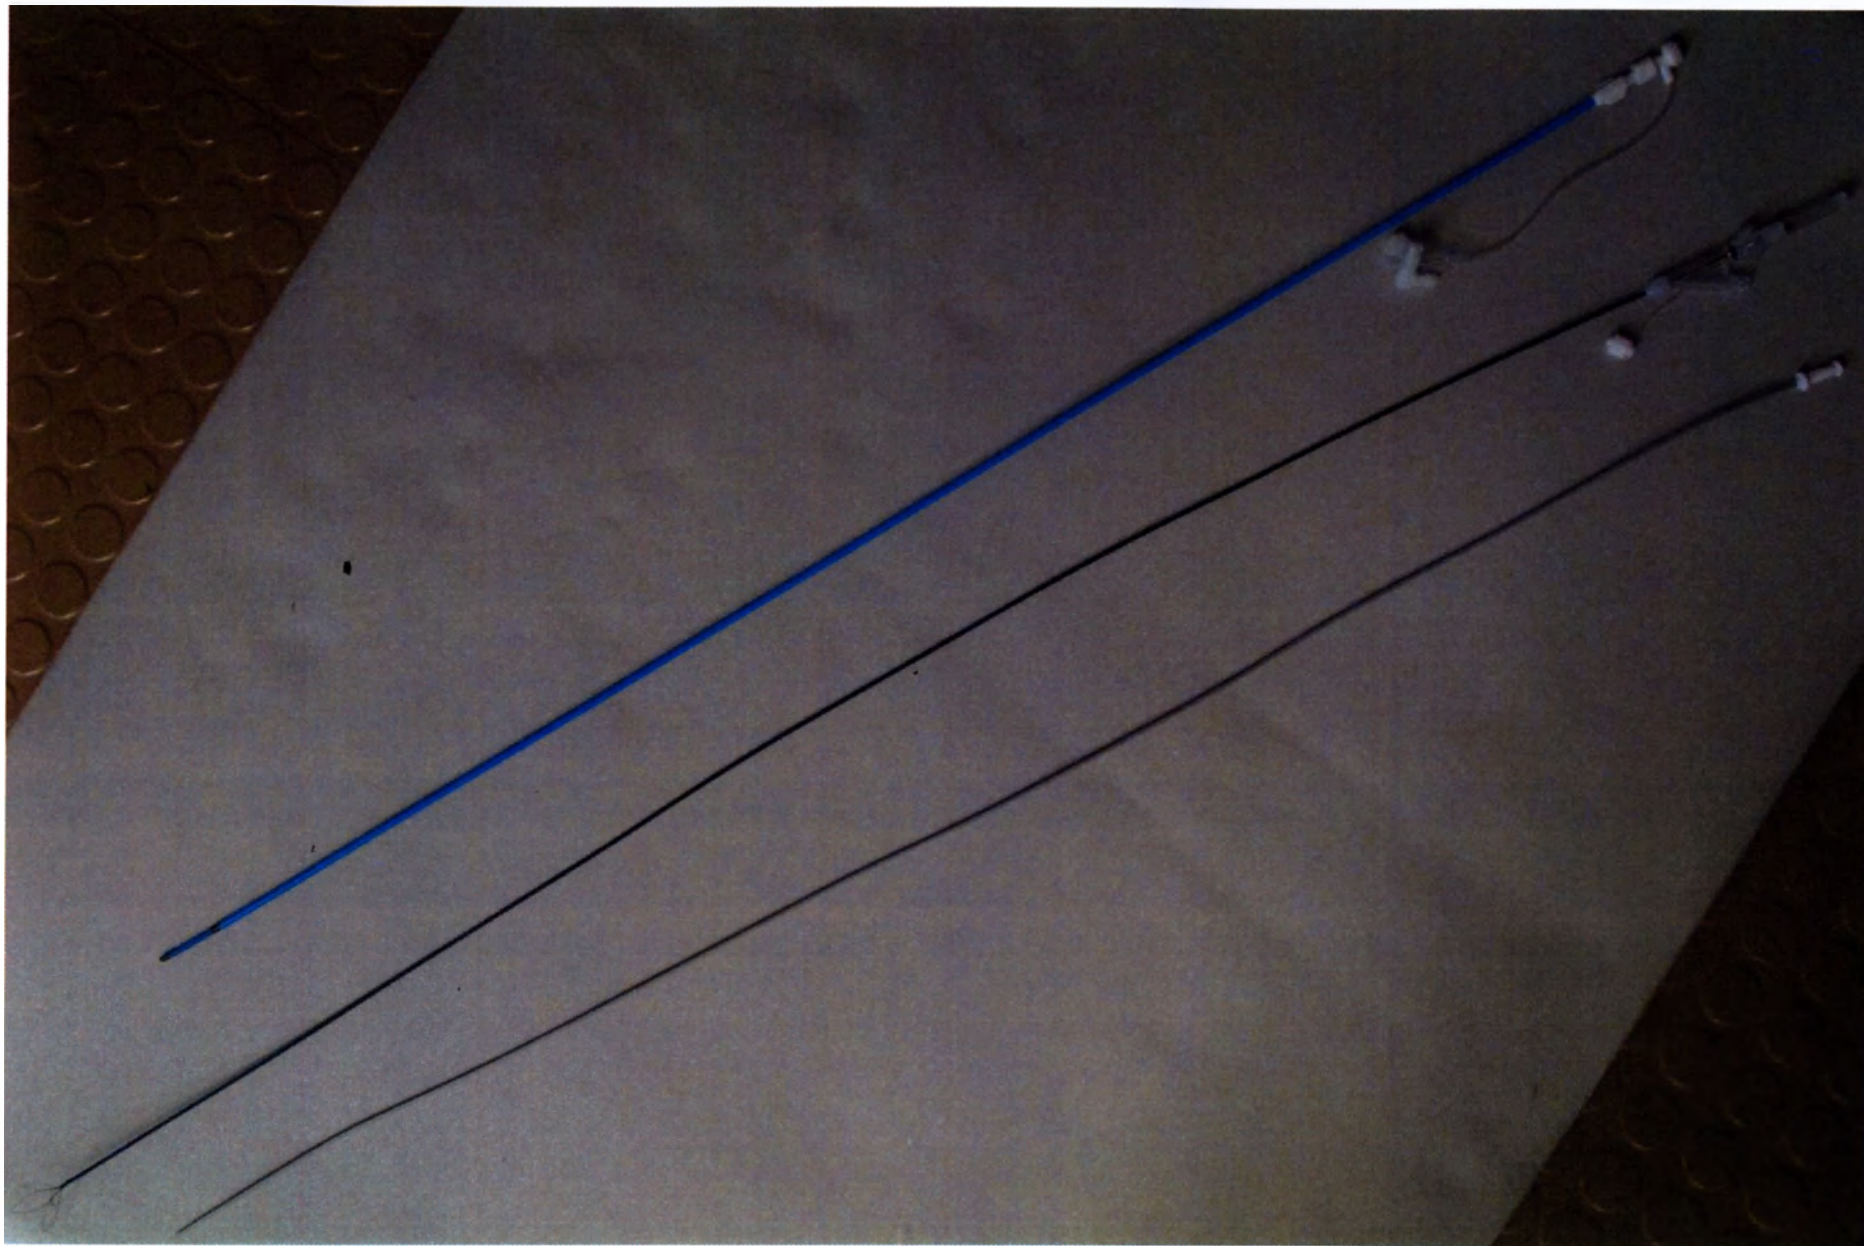

Ретриверы с корзинкой VRS-6.0-90.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов

Генеральный директор

С/Б

С.Н.Курип



Ретриверы эндоваскулярные в наборах.

Ретриверы с петлей

Варианты исполнения: AWLR-5.0-50-10; AWLR-6.3-100-10; AWLR-6.3-100-25



Макет маркировки:

AWLR-XX-XX-XX

Ретривер эндоваскулярный с петлей

Набор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____;

петля диаметр-_____.

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Ретриверы эндоваскулярные в наборах.

Ретриверы с петлей

Варианты исполнения: GTRS-200-RB

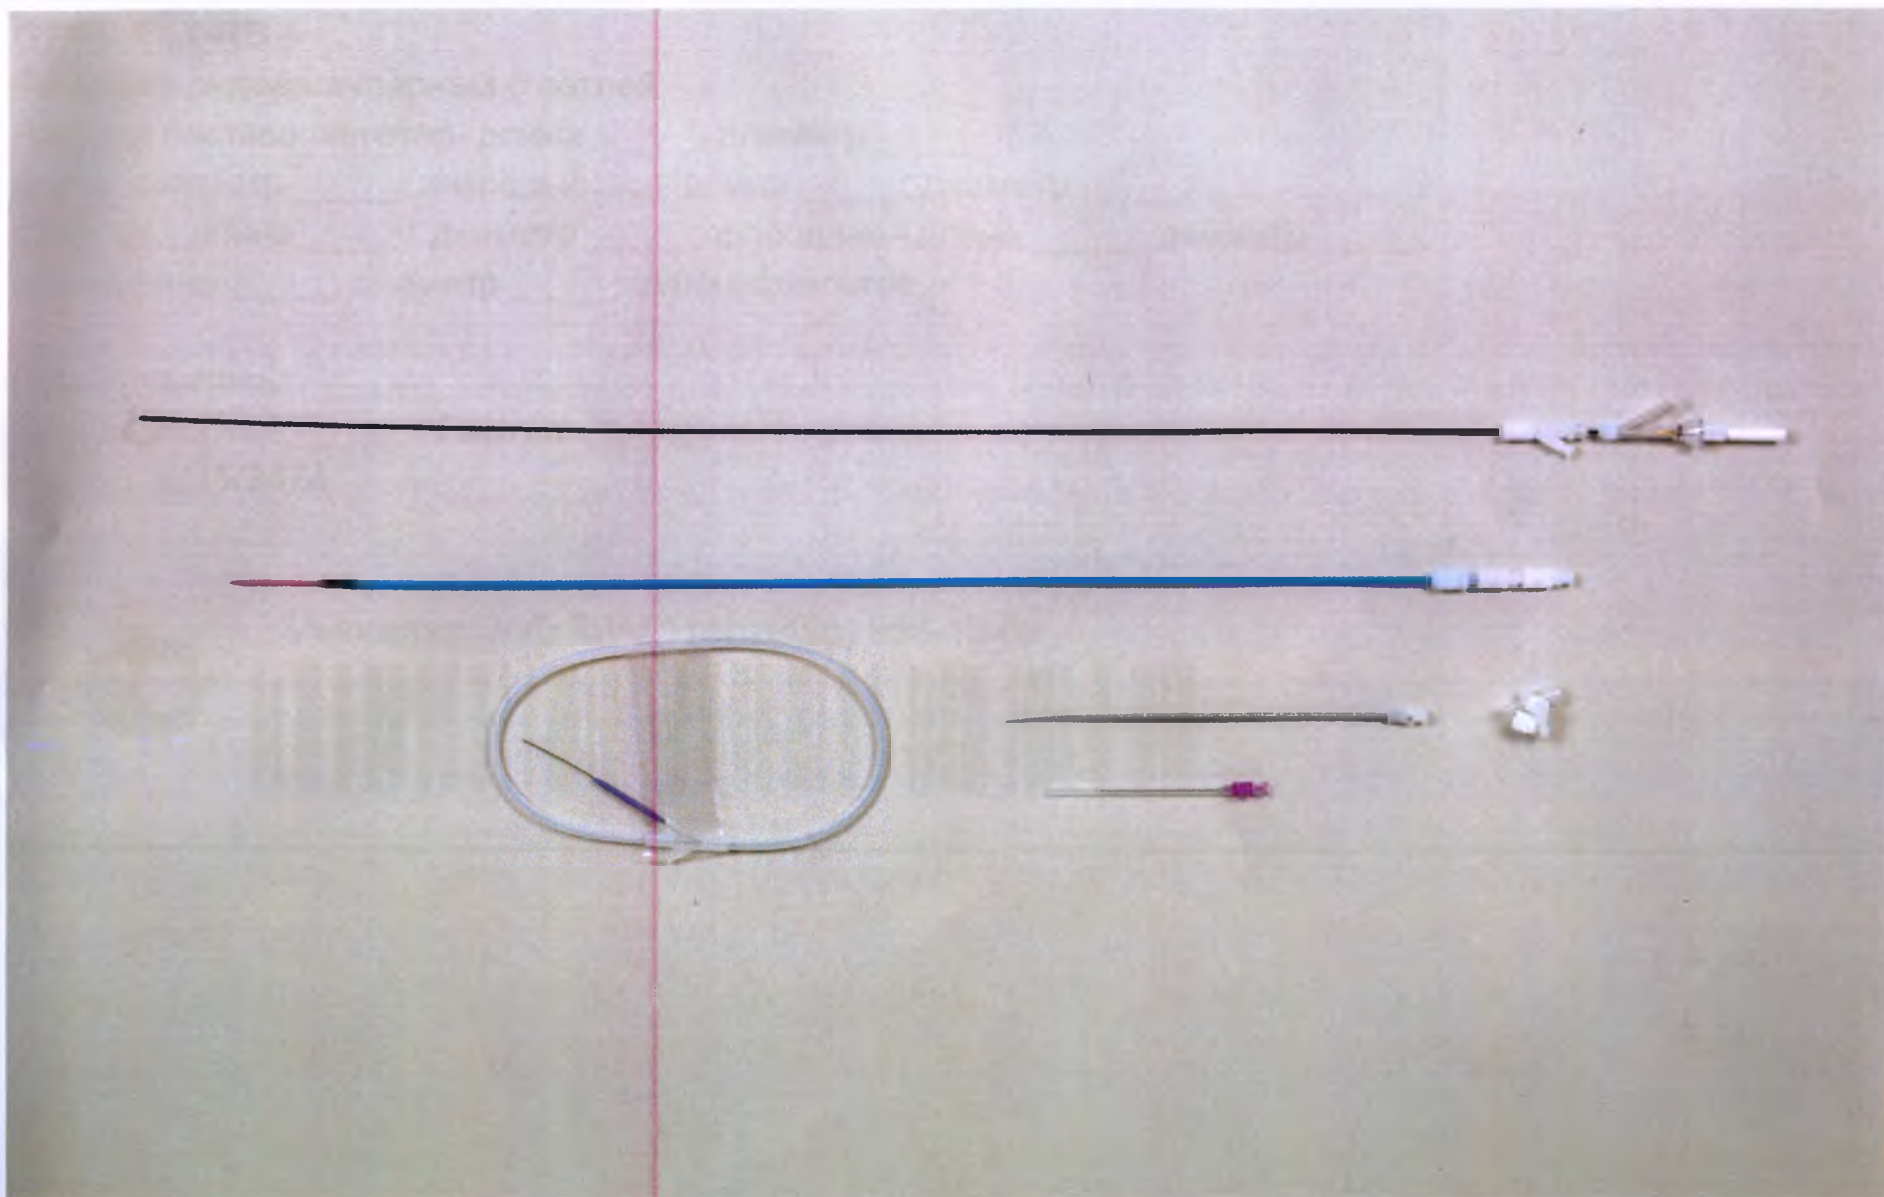

Лакет маркировки:

ЗТРС-XXX-RB

Ретривер эндоваскулярный с петлей

Набор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____;

петля -диаметр-_____; интродьюсер - длина _____, диаметр _____;

дилатор - длина _____, диаметр _____;проводник - длина _____, диаметр _____;

игла- длина _____, диаметр _____;краник-фиксатор.

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: 2015/2474



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



гиверы эндоваскулярные в наборах.
гиверы с корзиной:
рианты исполнения: DRS-100

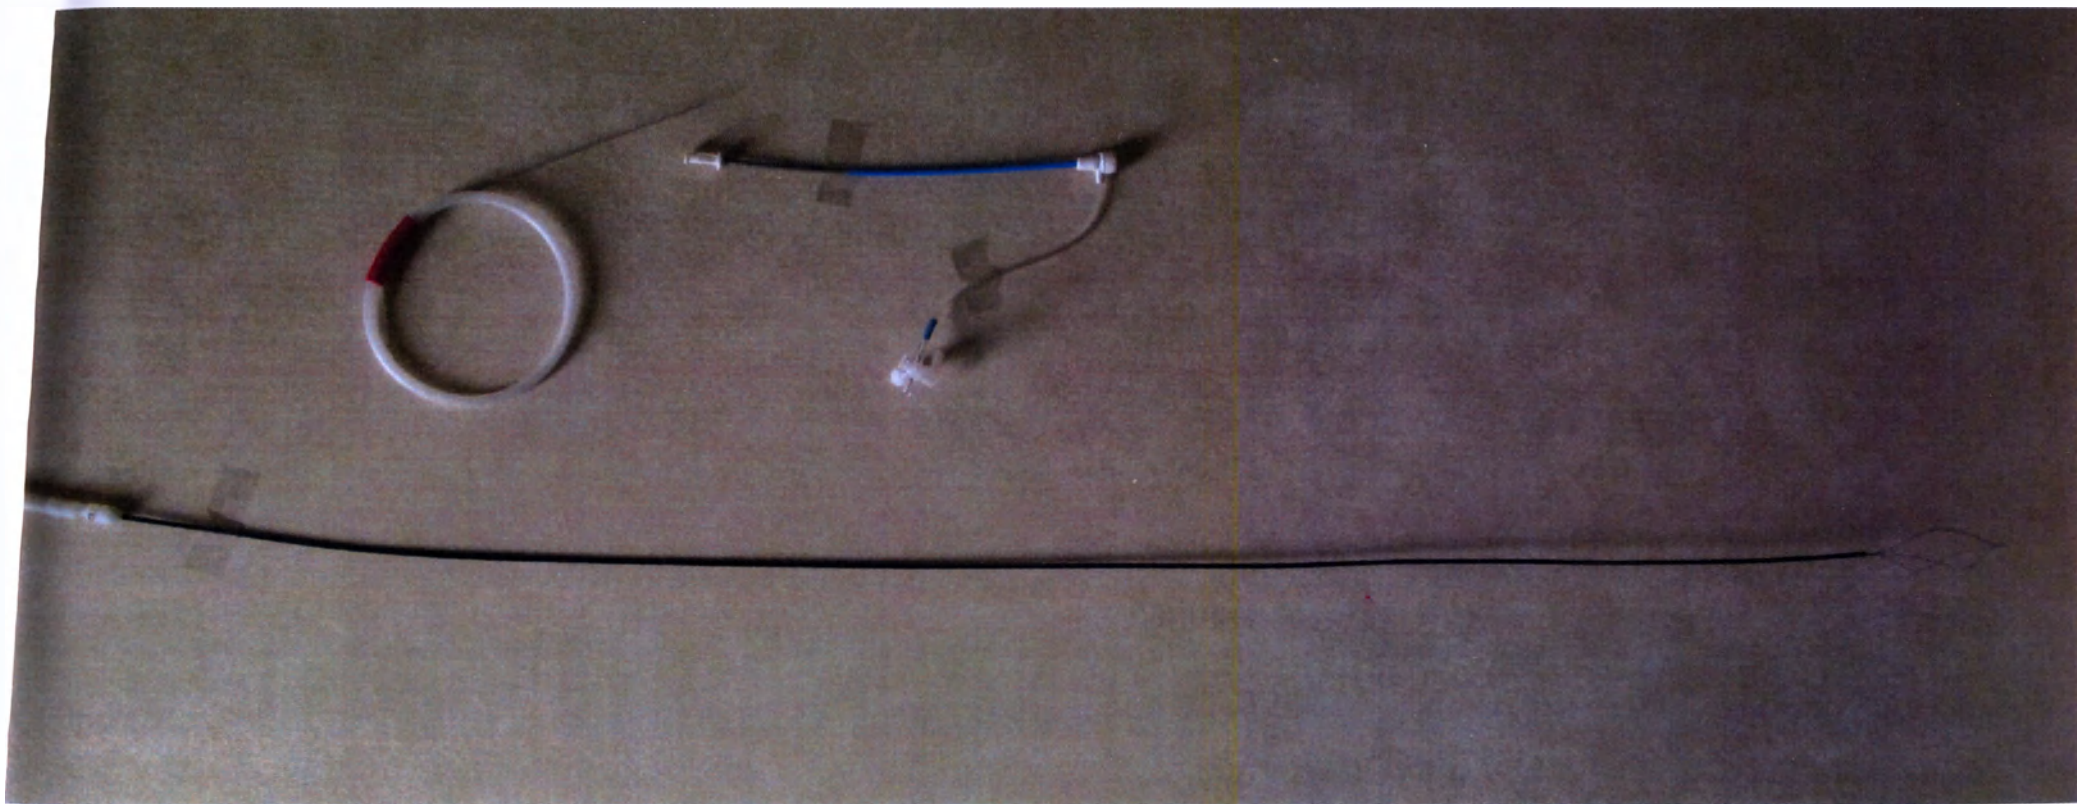

кет маркировки:

RS-XXX

этривер эндоваскулярный с корзинкой:

абор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____;

тержень с корзинкой-____; интродьюсер - длина _____, диаметр _____; дилатор - длина _____, диаметр _____; проводник - длина _____, диаметр _____; цанговый зажим.

Производитель: _____


Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474

Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



етриверы эндоваскулярные в наборах.
етриверы с корзинкой:
Варианты исполнения: VRS-6.0-90.

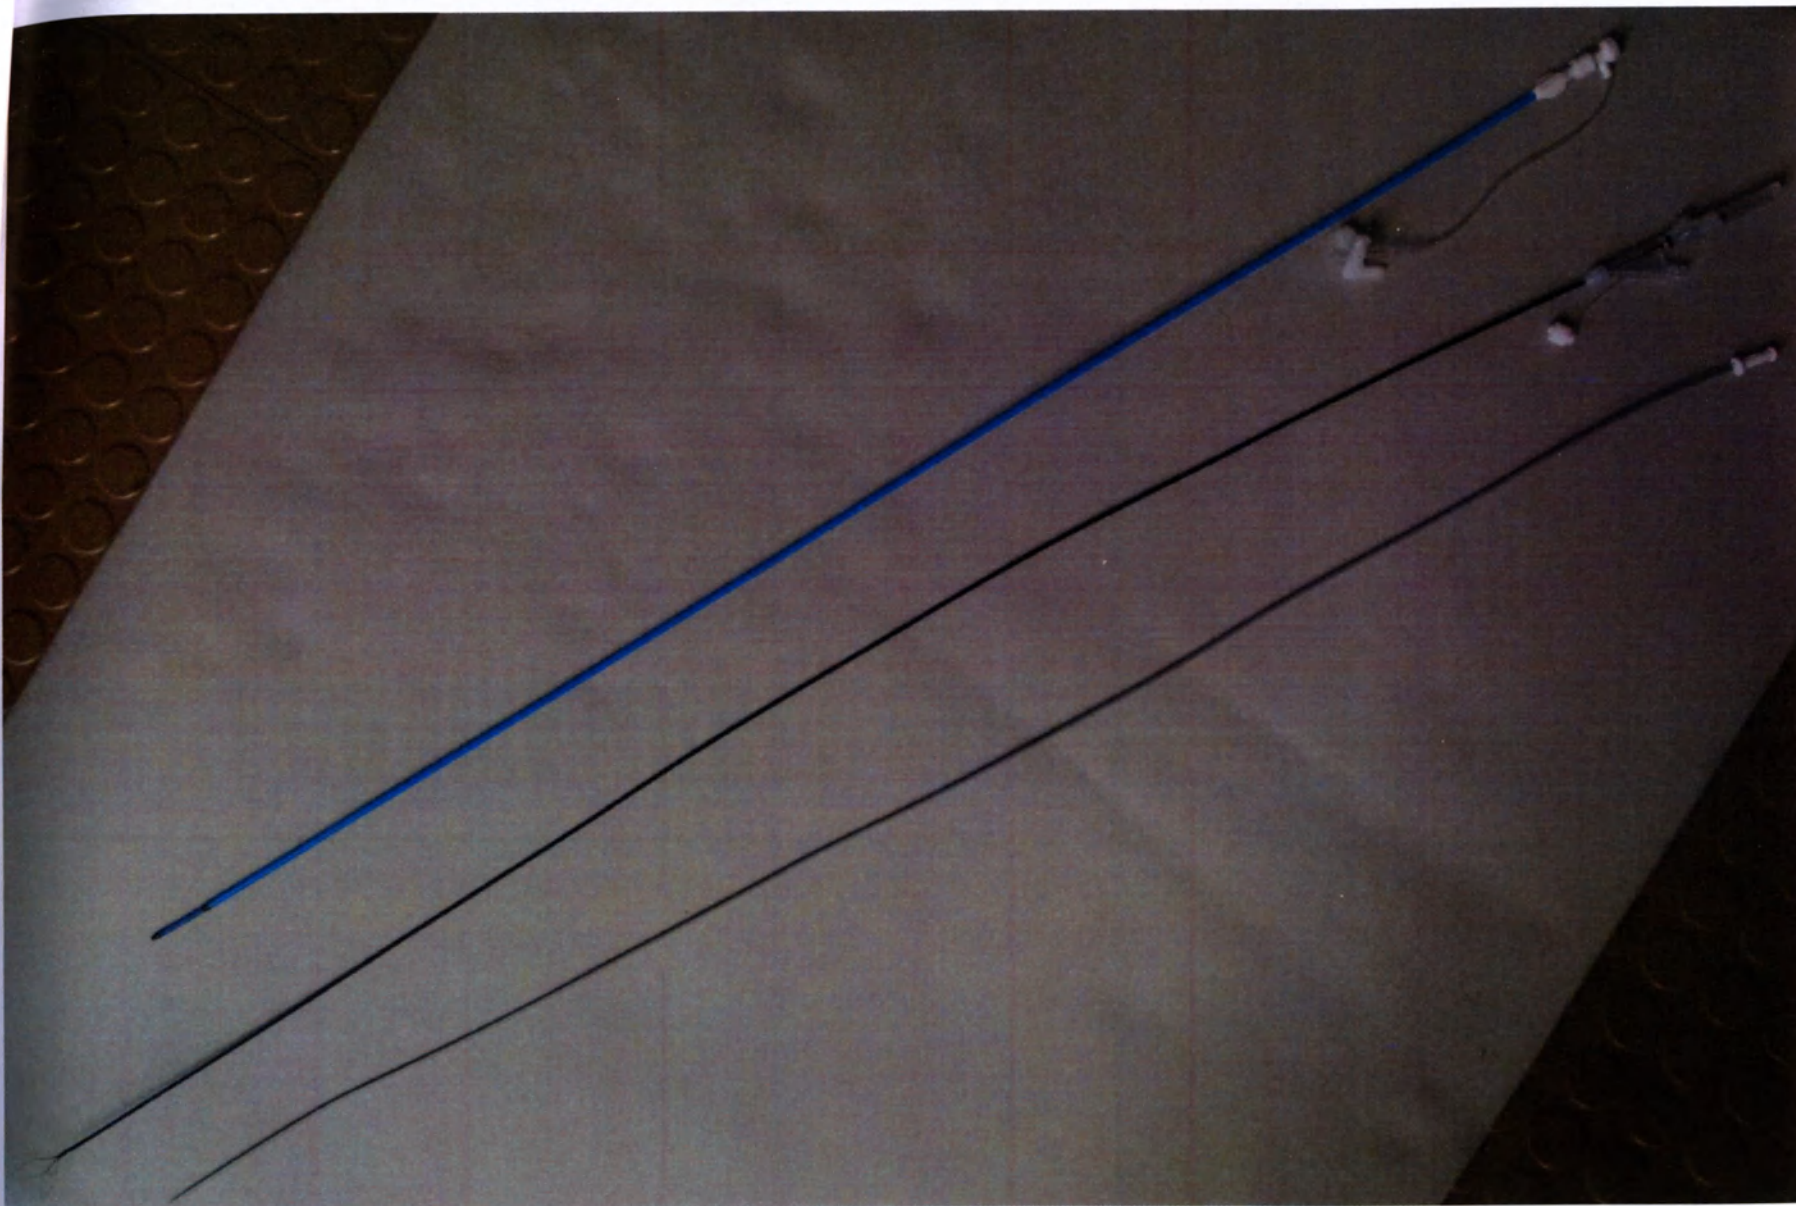

Макет маркировки:

VRS-XX-XX

Ретривер эндоваскулярный с корзинкой:

Набор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____; Стержень с корзинкой- _____; интродьюсер внутренний - длина _____, диаметр _____; интродьюсер наружный - длина _____, диаметр _____; дилатор - длина _____, диаметр _____; цанговый зажим; Y-адаптер.

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Ретриверы эндоваскулярные в наборах.

Ретриверы с щипцами:

Варианты исполнения: VRF-3.0-120, VRF-3.0-135.

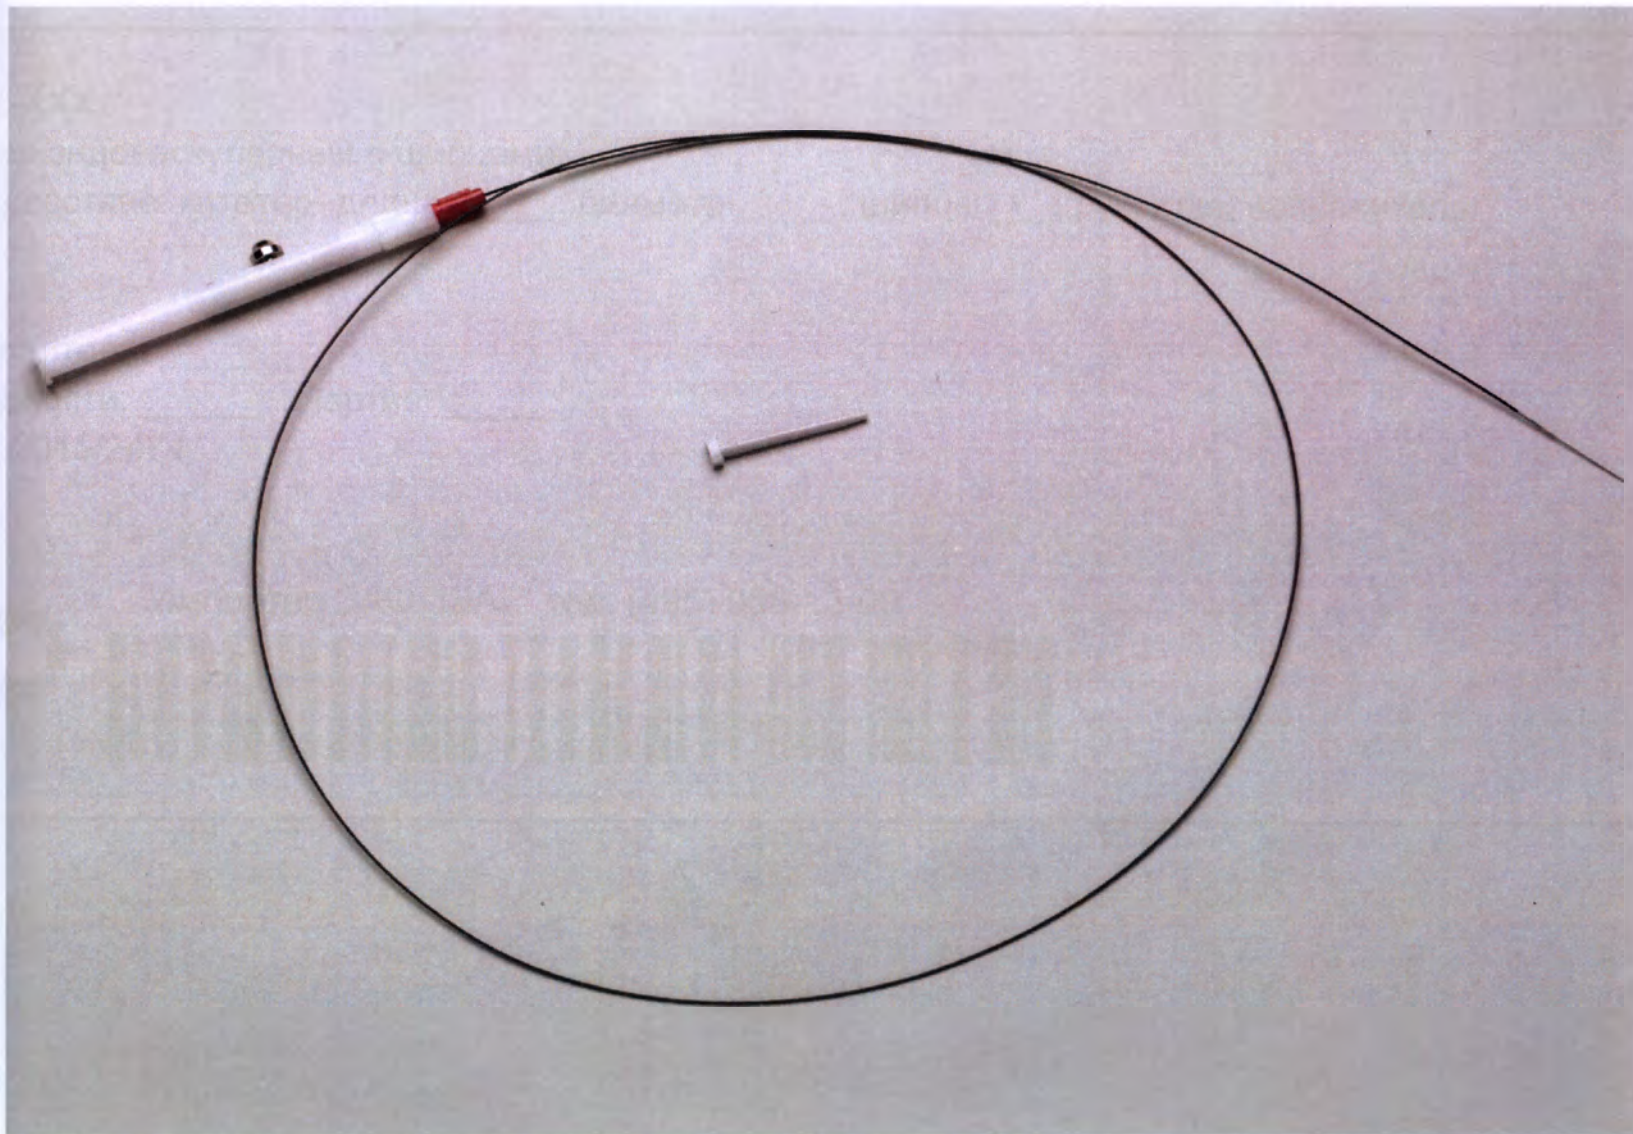

Макет маркировки:

VRF-XX-XXX

Ретривер эндоваскулярный с щипцами:

Набор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____; щипцы ____; рукоятка; направитель.

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



ретриверы эндоваскулярные в наборах.

ретриверы с корзиной:

Варианты исполнения: INDY-8.0-35-100-40, INDY-8.0-35-55-40.

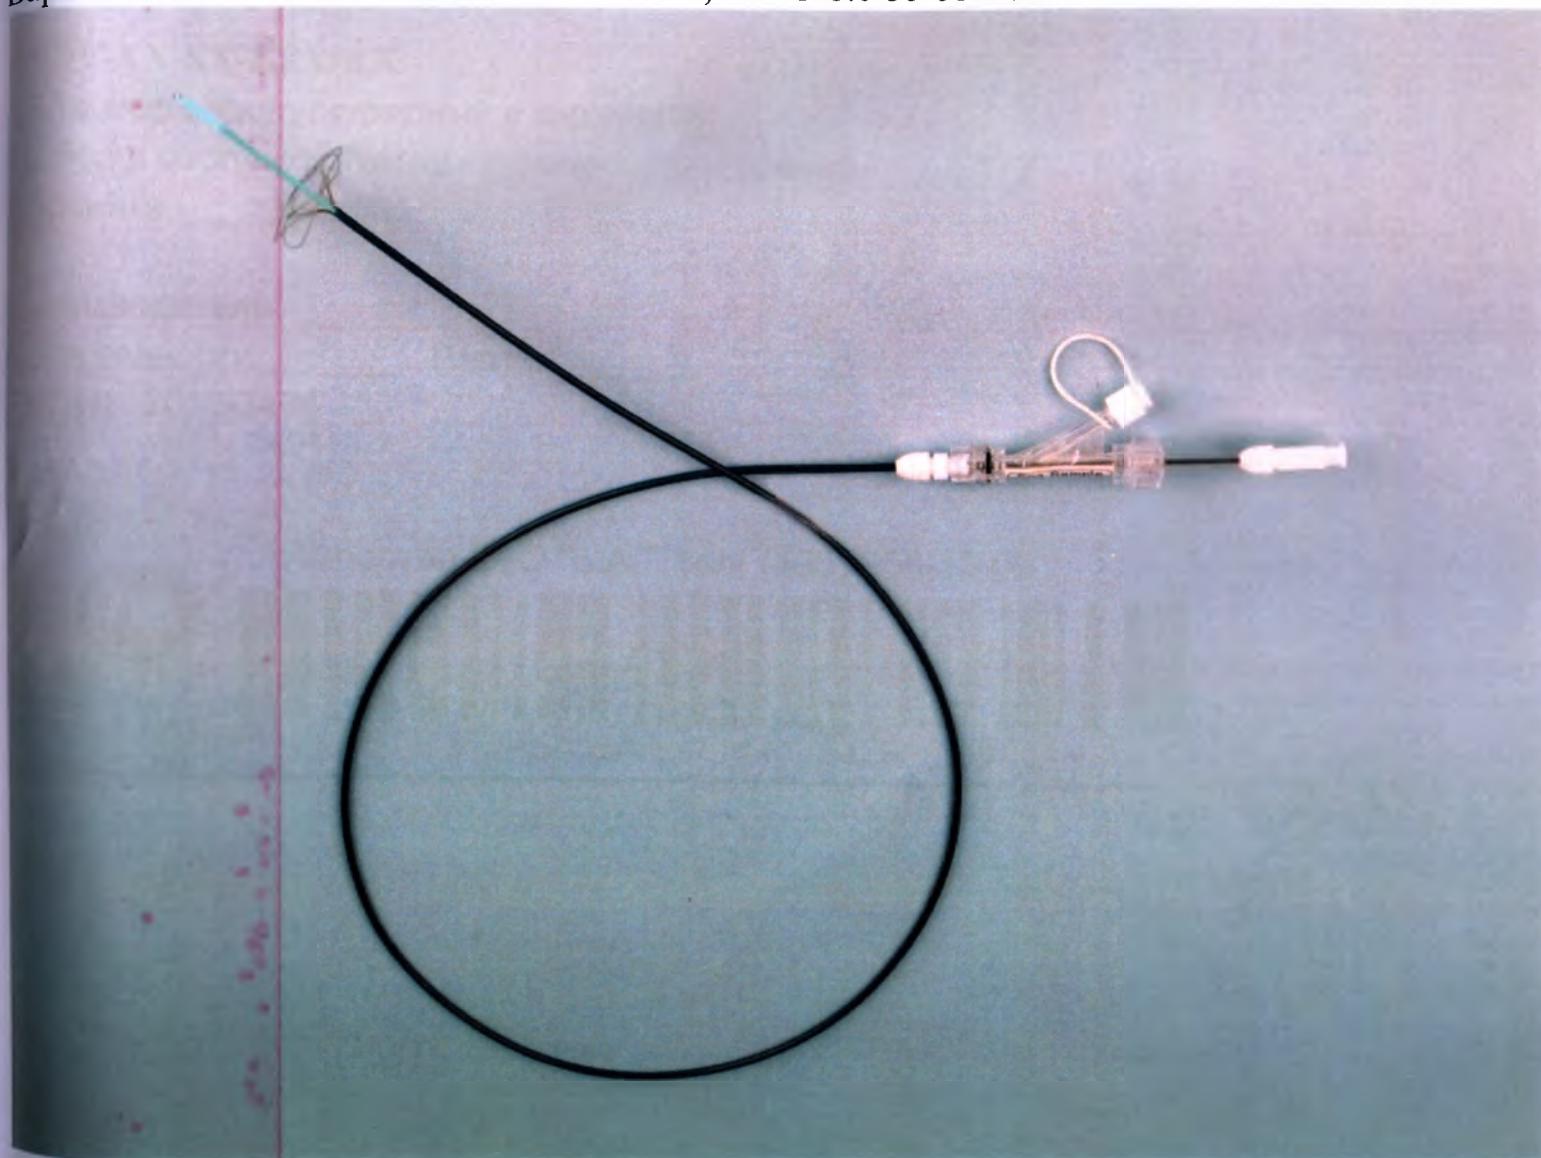

Макет маркировки:

INDY-XX-XX-XXX-XX

Ретривер эндоваскулярный с корзинкой:

Набор в составе: катетер - длина _____, диаметр _____;

Корзинка - ____; адаптер Tuohy-Borst.

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Ретриверы эндоваскулярные в наборах.

Ретриверы с петлей

Варианты исполнения: LR-SSN001, LR-SSN002

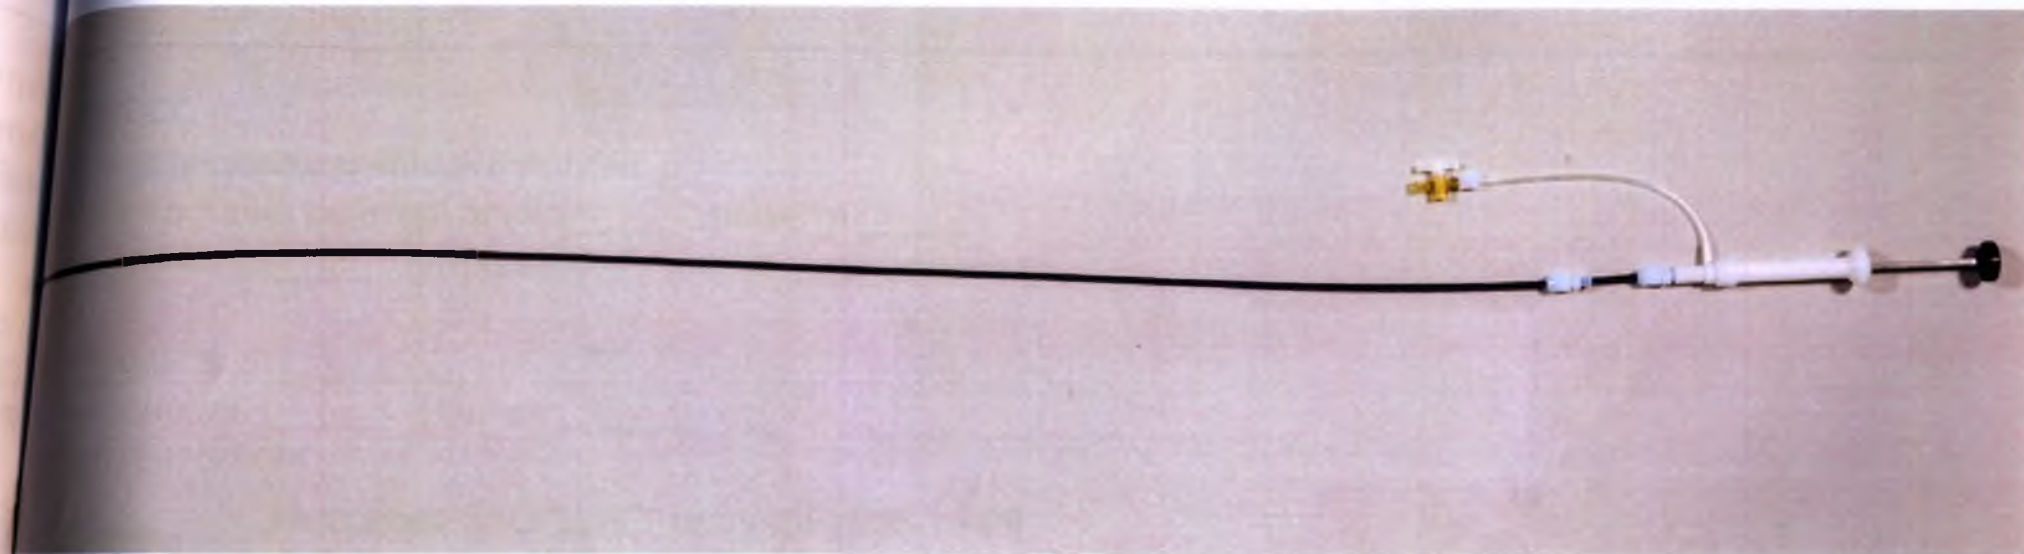

т маркировки:

SNXX

мивер эндоваскулярный с петлей

р в составе: катетер- длина _____, диаметр _____;

я -диаметр-_____; интродьюсер - длина _____, диаметр

изводитель: _____

х годности: _____ Партия: _____

уд.: 2015/2474


Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



триверы эндоваскулярные в наборах.

триверы с петлей

варианты исполнения: LR-NES001, LR-NES002, LR-NES541

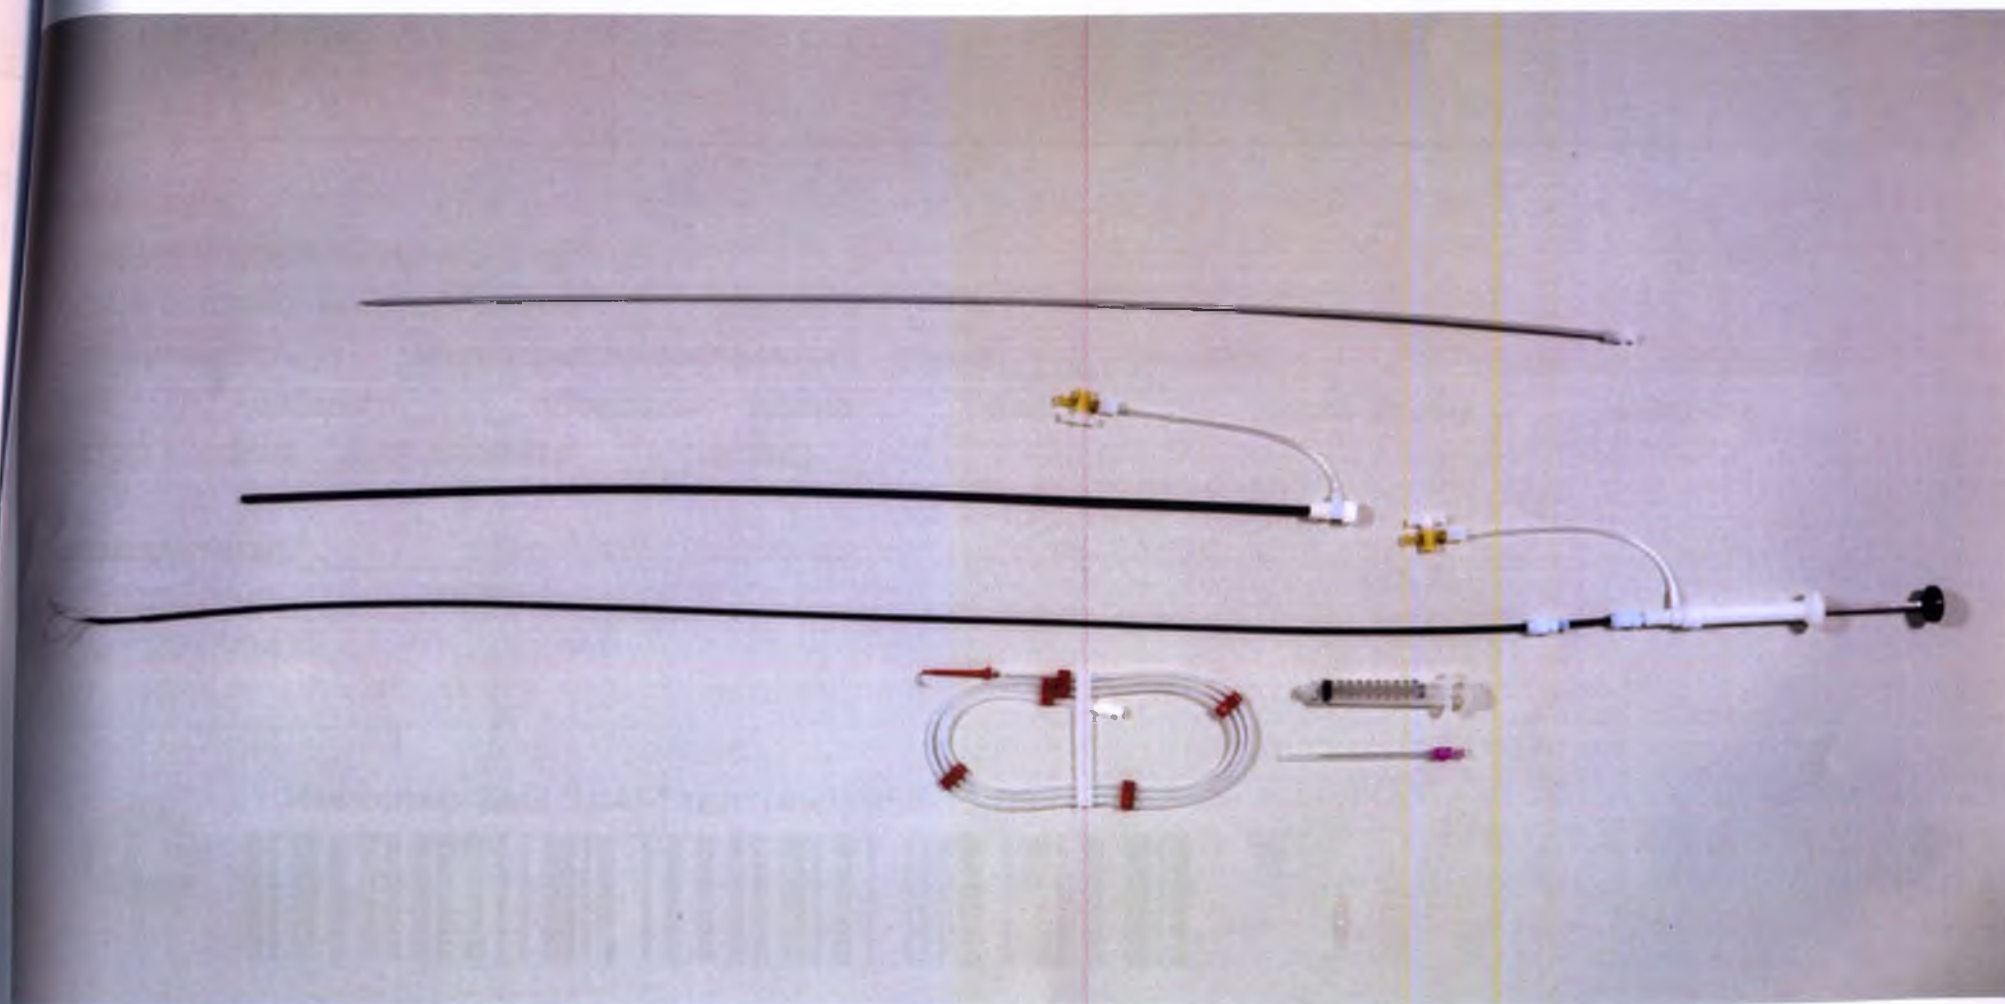

кет маркировки:

R- NESXXX

атривер эндоваскулярный с петлей

набор в составе: катетер- длина _____, диаметр _____;
петля -диаметр-_____; интродьюсер внутренний - длина _____, диаметр _____; интродьюсер наружный -
длина _____, диаметр _____; проводник - длина _____, диаметр _____; игла- длина _____, диаметр _____;
дилатор - длина _____, диаметр _____;шприц-____

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: 2015/2474



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 16 листов
Генеральный директор

