


УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ХАРИКО ДЕНТА МЕД»
Бадгали Нараян Датт




Фотографические изображения
медицинского изделия
«Наборы CRS Set для внутриротовой регистрации центрального
соотношения челюстей»,
производства Candulor AG (Кандулор АГ), Швейцария
Редакция 2

Содержание


1. Набор CRS Set 10 для внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей (вид общий).....	3
2. Регистрационный штифт, короткий.....	4
3. Регистрационный штифт, длинный.....	5
4. Регистрационная пластинка.....	6
5. Опорная пластинка для штифта, малая.....	7
6. Опорная пластинка для штифта, большая.....	8
7. Винт и шайба для регистрационной пластинки.....	9
8. Плексигласовая пластинка.....	10
9. Candulor маркер.....	11
10. Упаковка набора CRS Set 10 внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей с маркировкой.....	12
11. Набор CRS Set 15 для внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей (вид общий).....	13
12. Регистрационная пластинка 1.....	14
13. Регистрационная пластинка 2.....	15
14. Регистрационная пластинка 3.....	16
15. Регистрационная пластинка 4.....	17
16. Опорная пластинка для штифта.....	18
17. Регистрационный штифт с втулкой, короткий.....	19
18. Регистрационный штифт с втулкой, длинный.....	20
19. Плексигласовая круглая пластина.....	21
20. Candulor маркер.....	22
21. Упаковка набора CRS Set 10 внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей с маркировкой.....	23

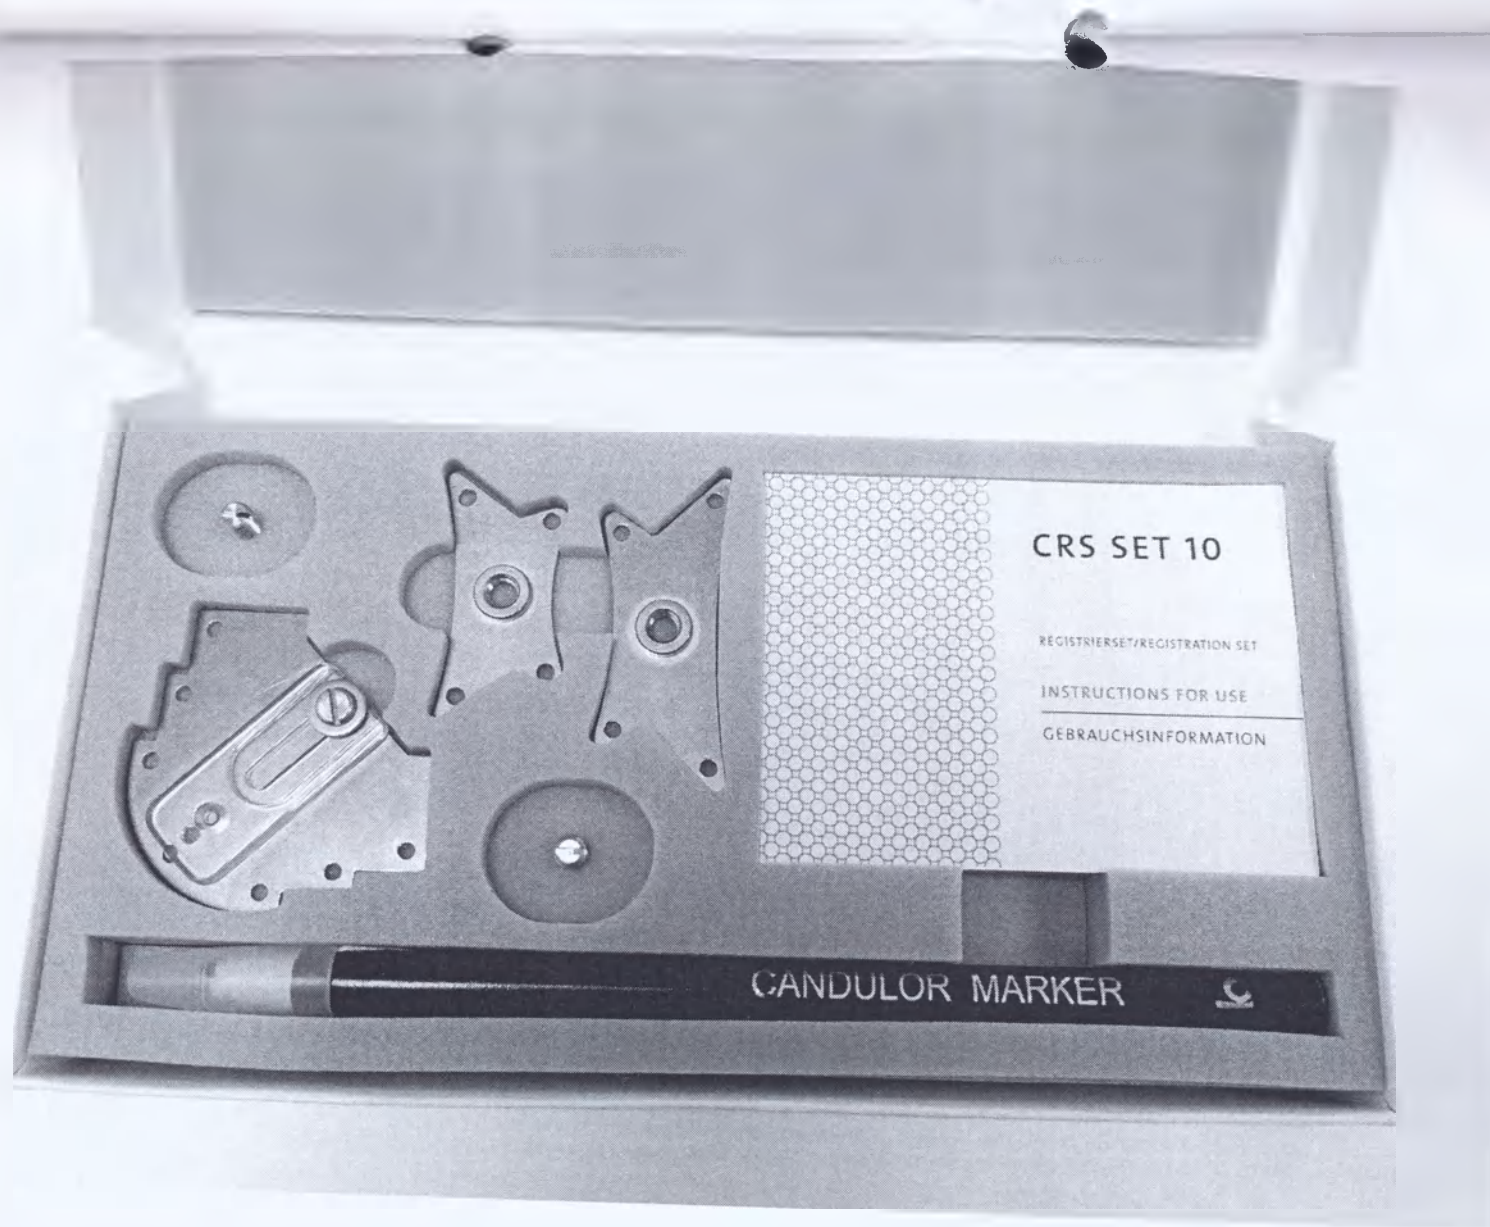


Набор CRS 10 для внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей (вид общий)

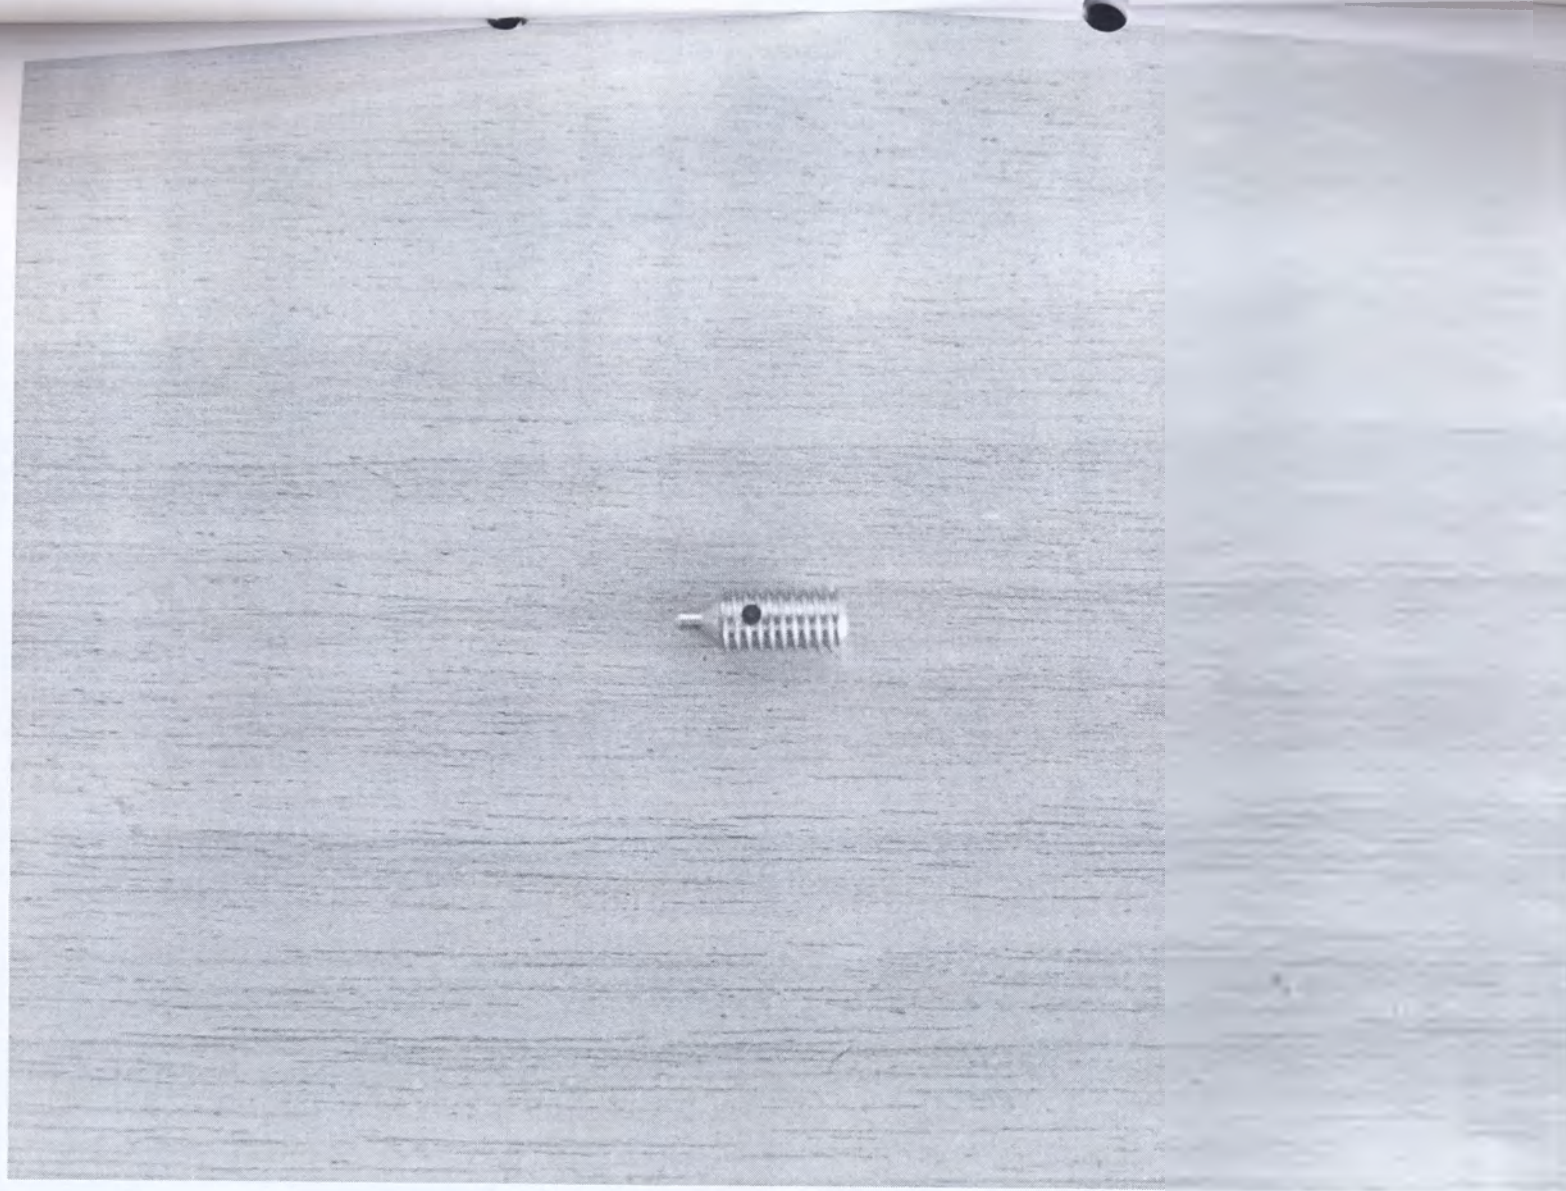


Регистрационный штифт, короткий

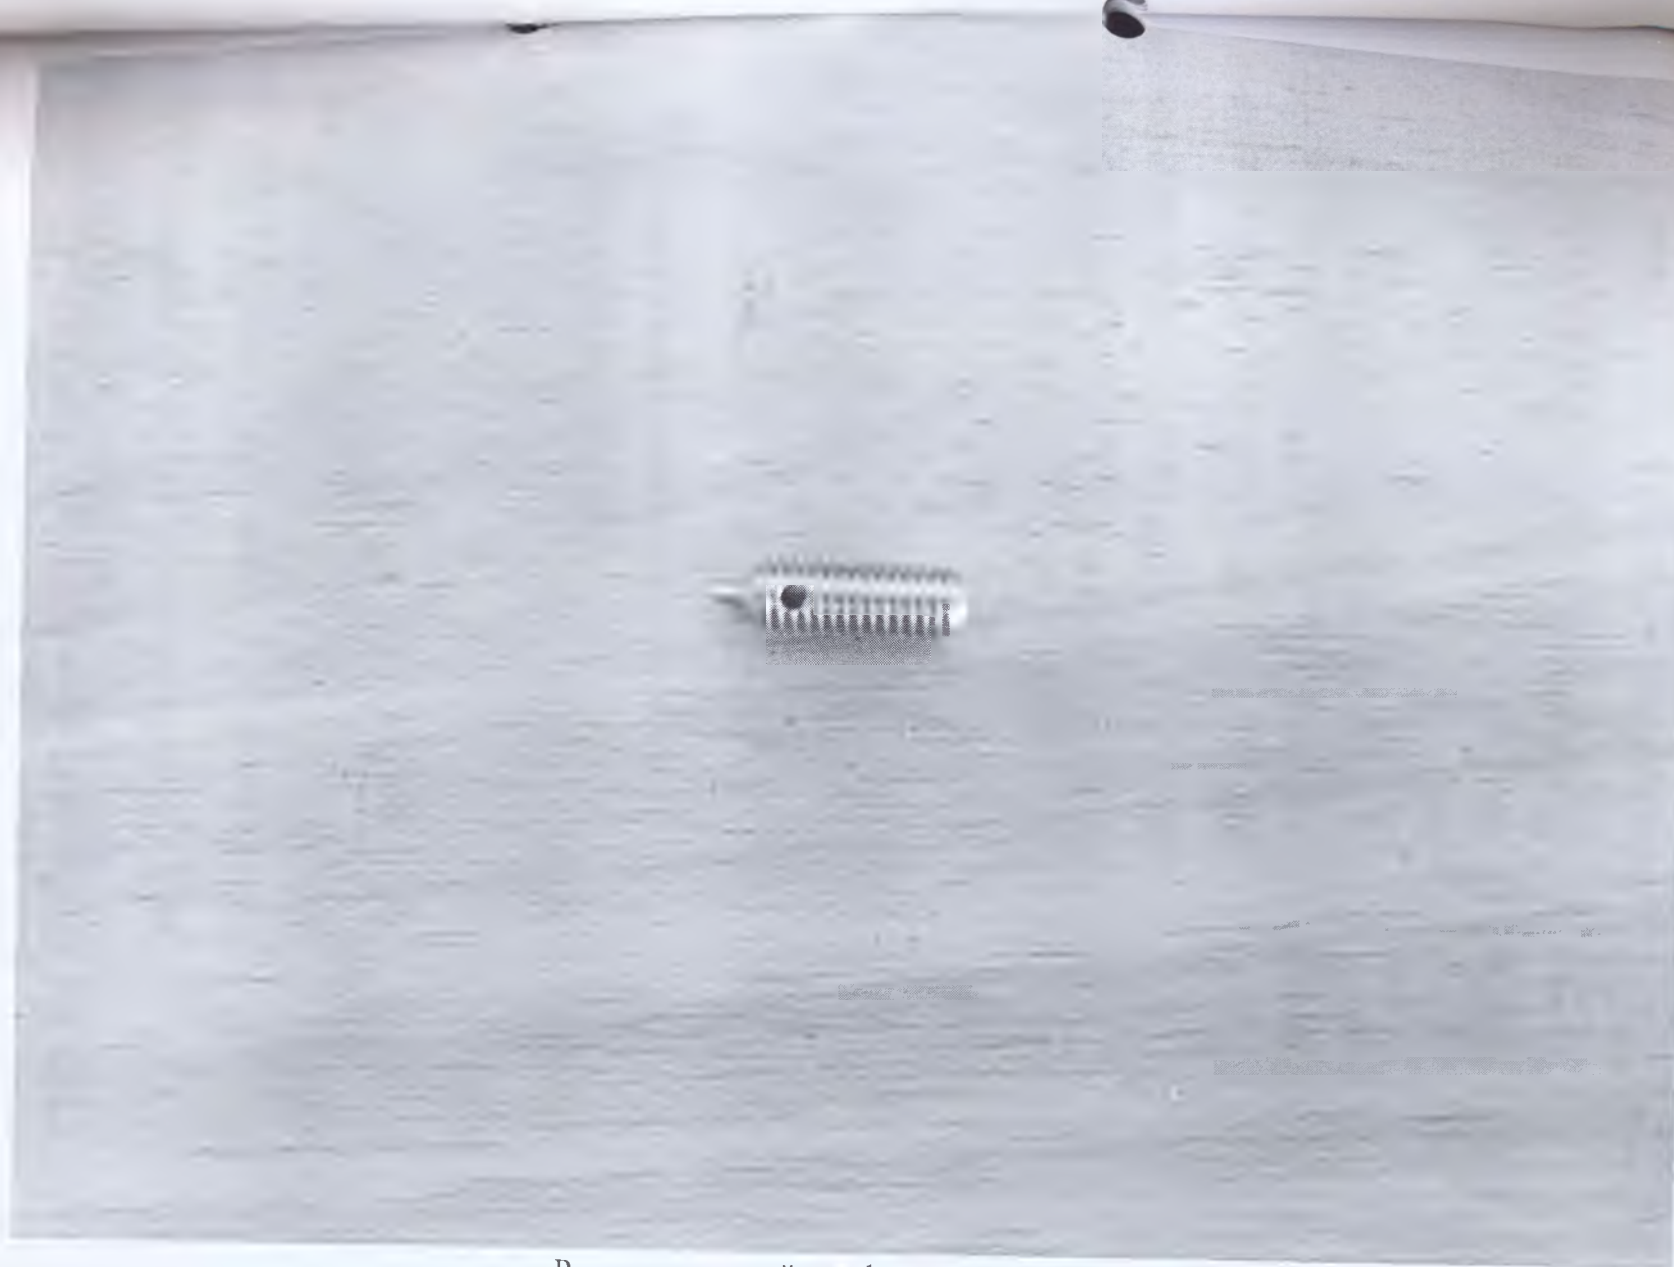


Регистрационный штифт, длинный

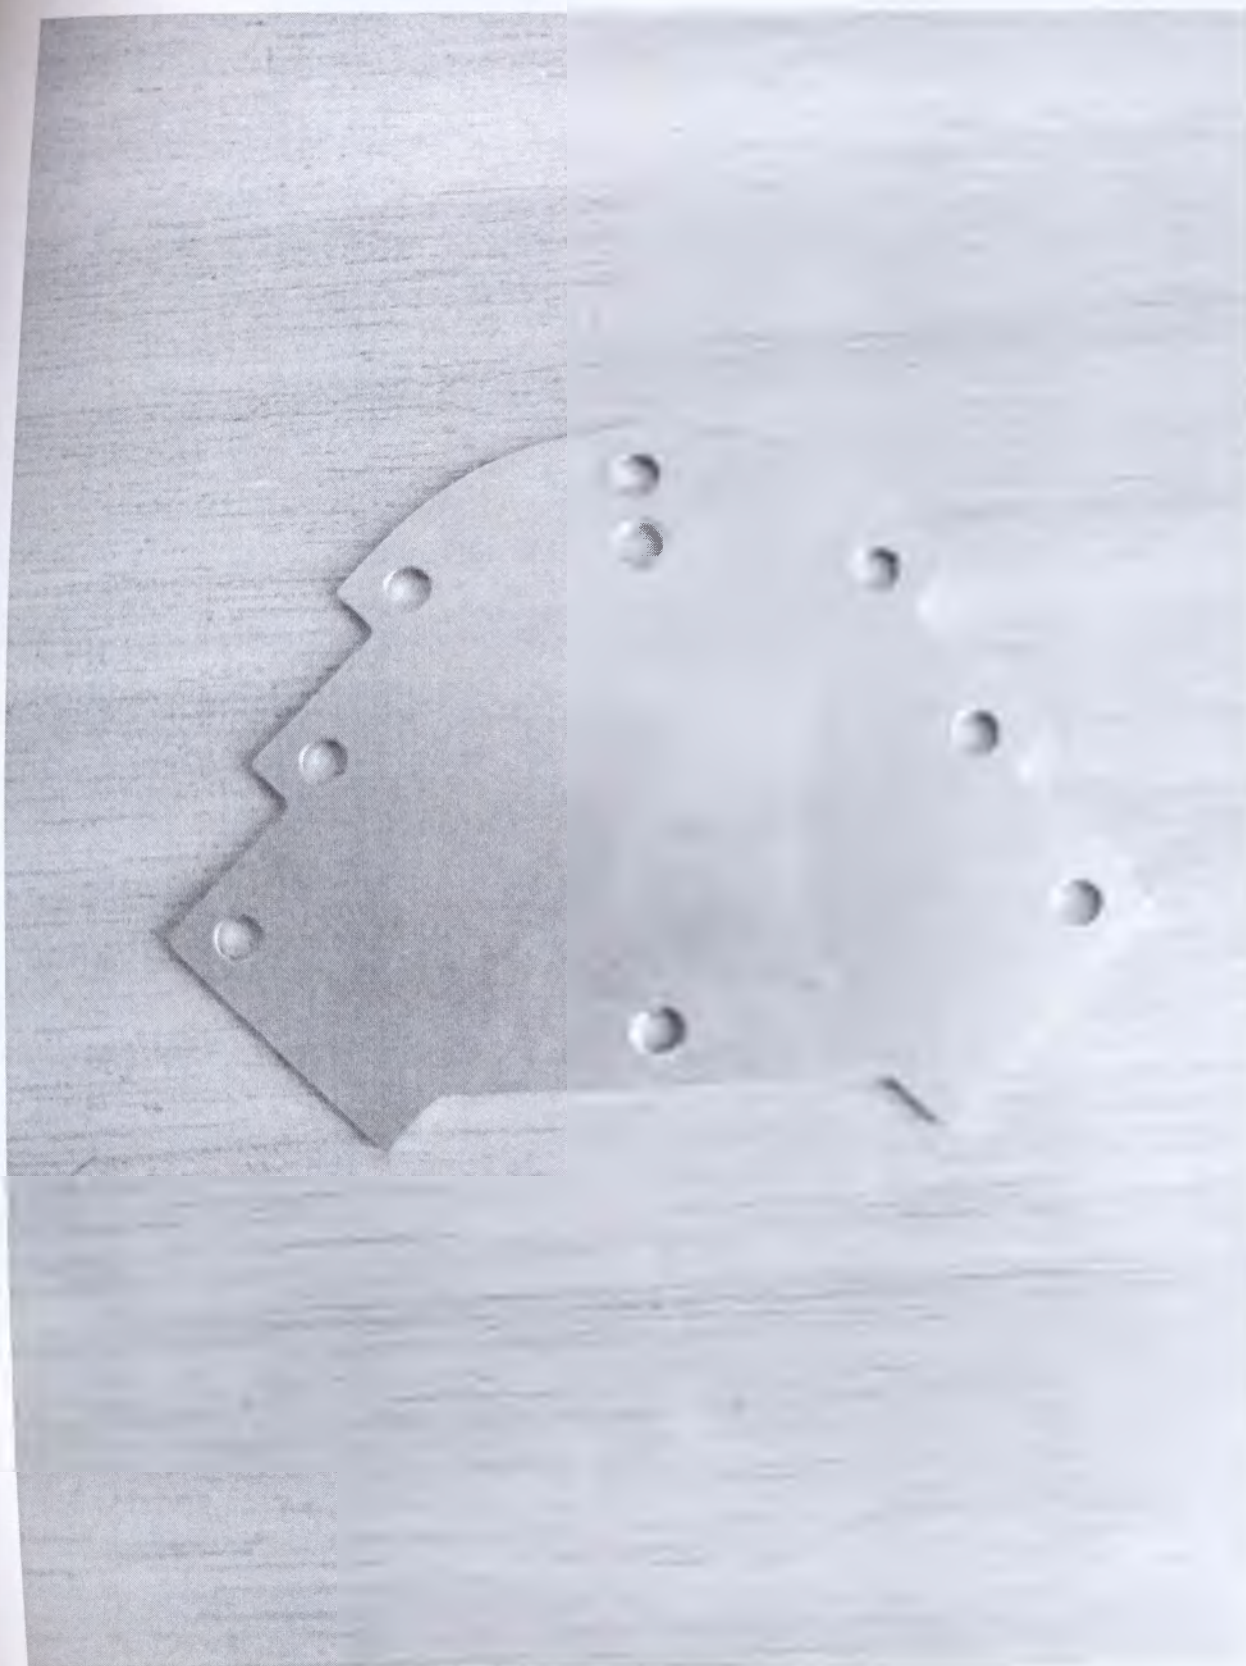


Регистрационная пластинка

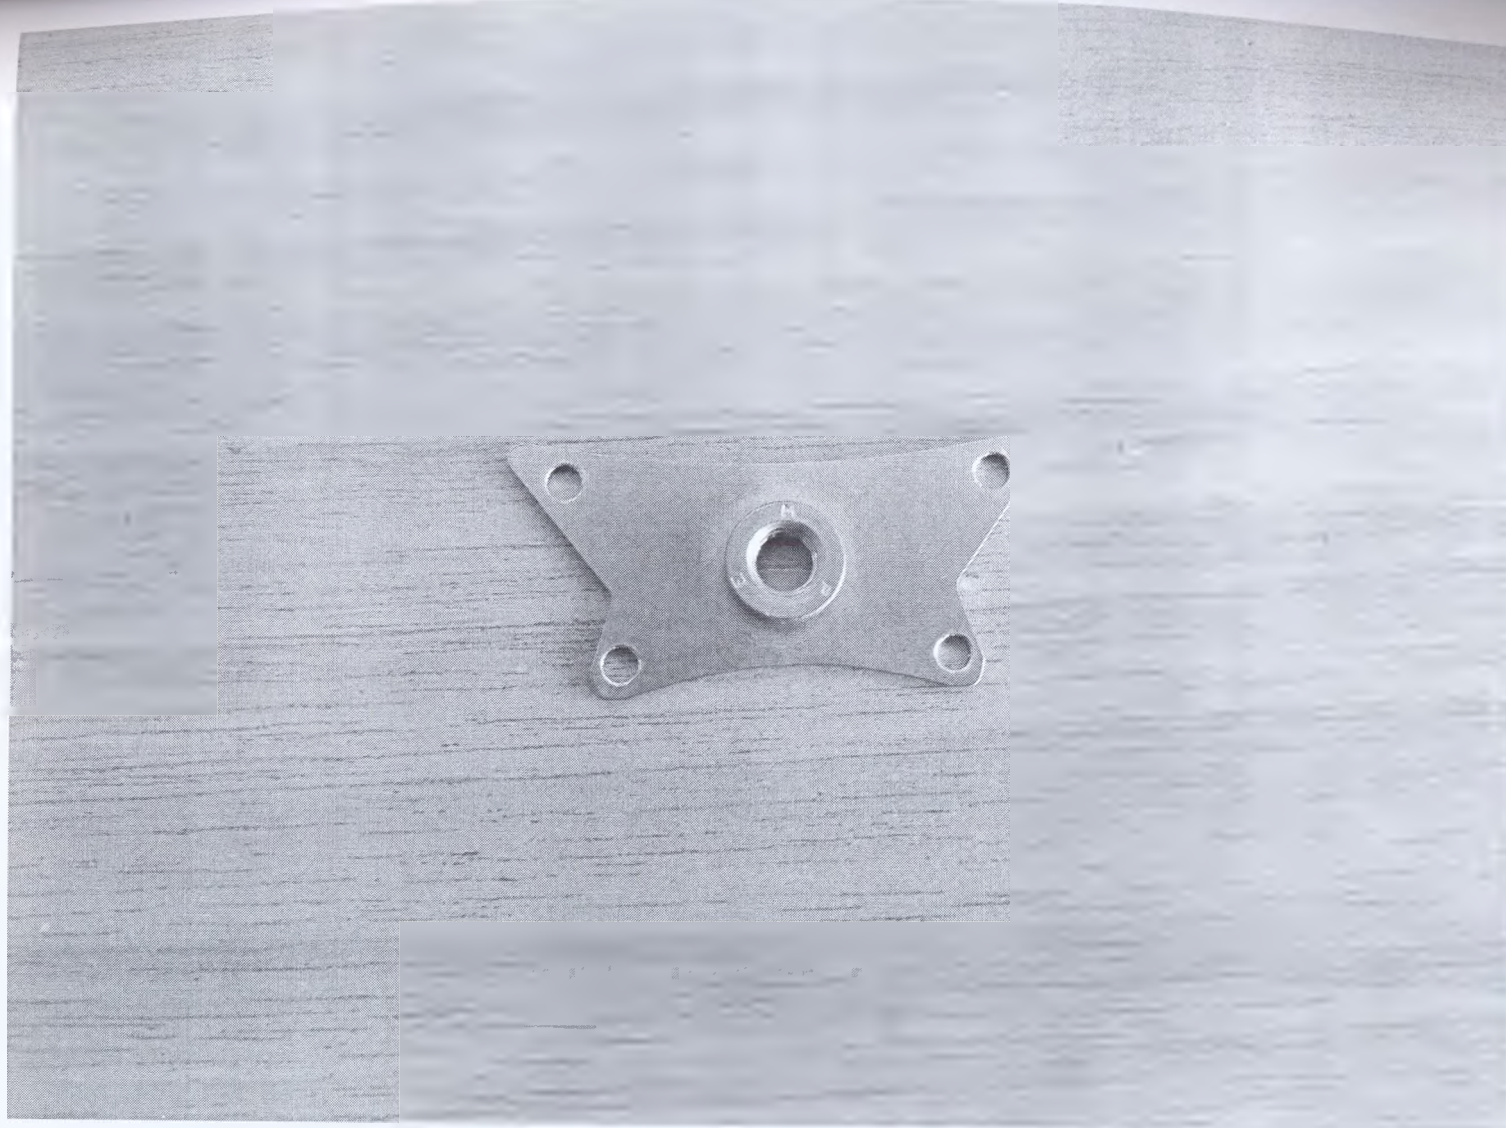

Опорная пластинка для штифта, малая

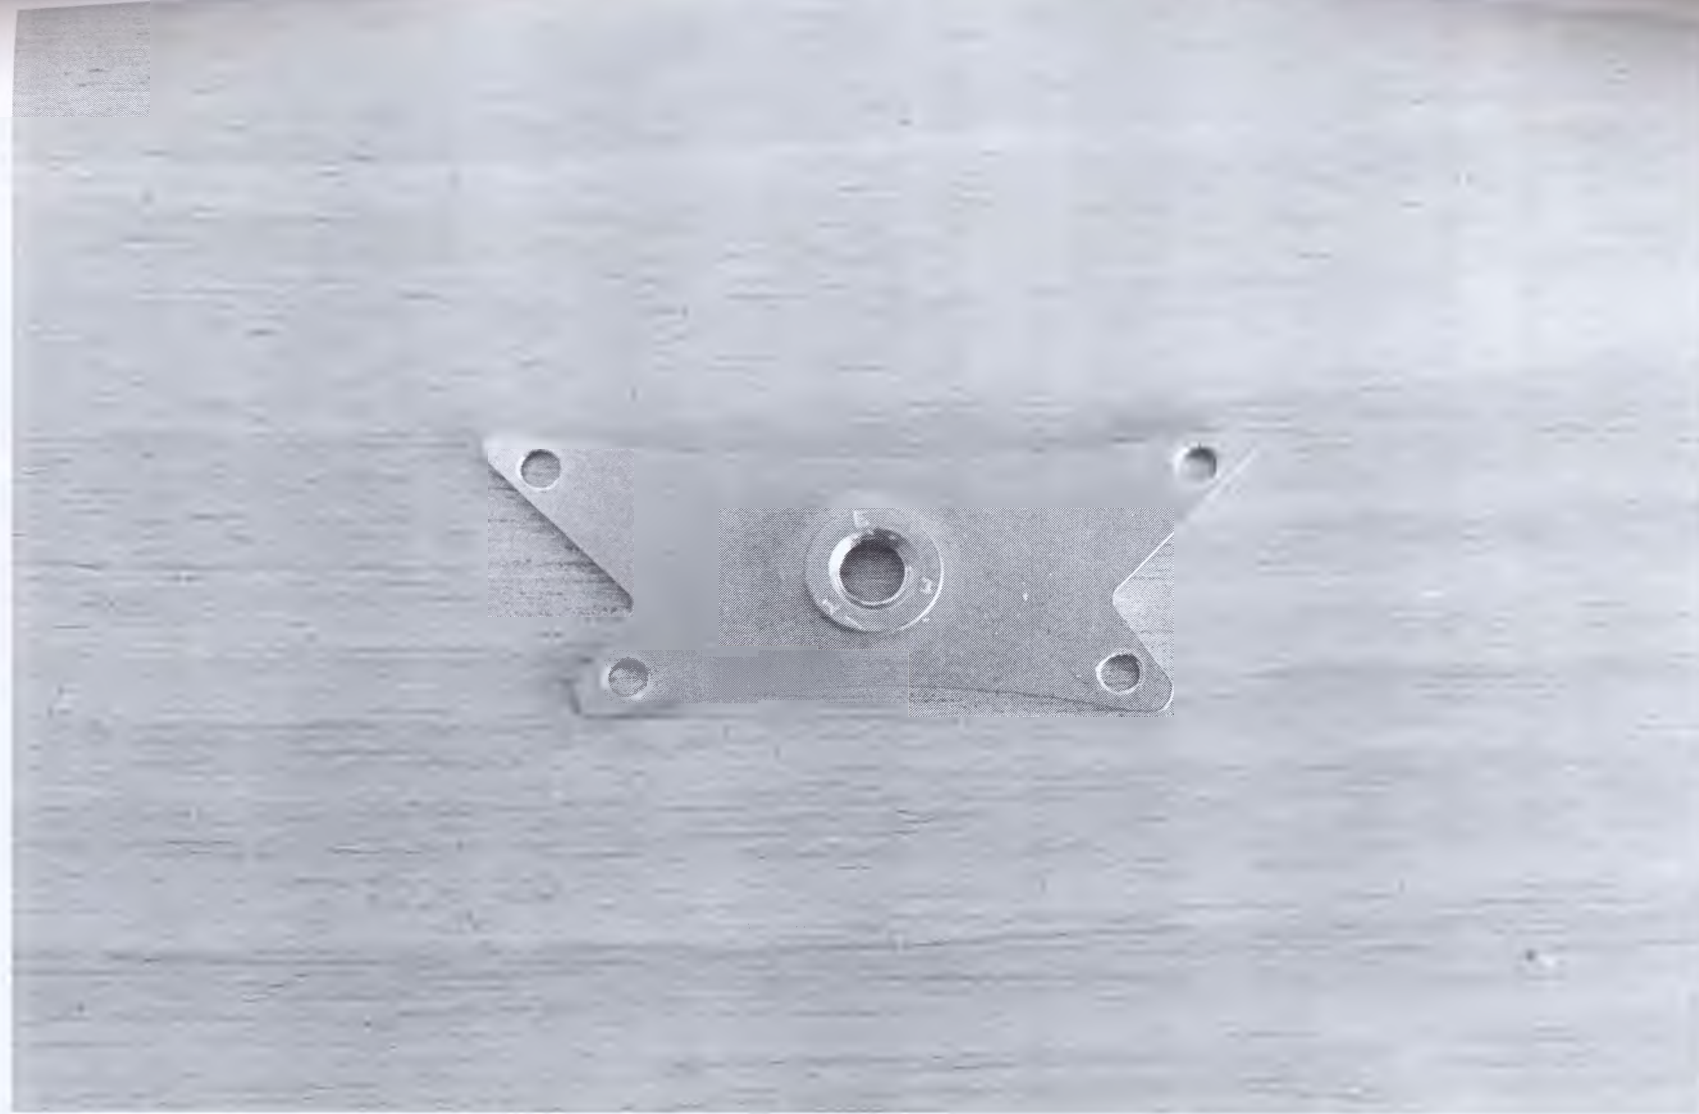

Опорная пластинка для штифта, большая

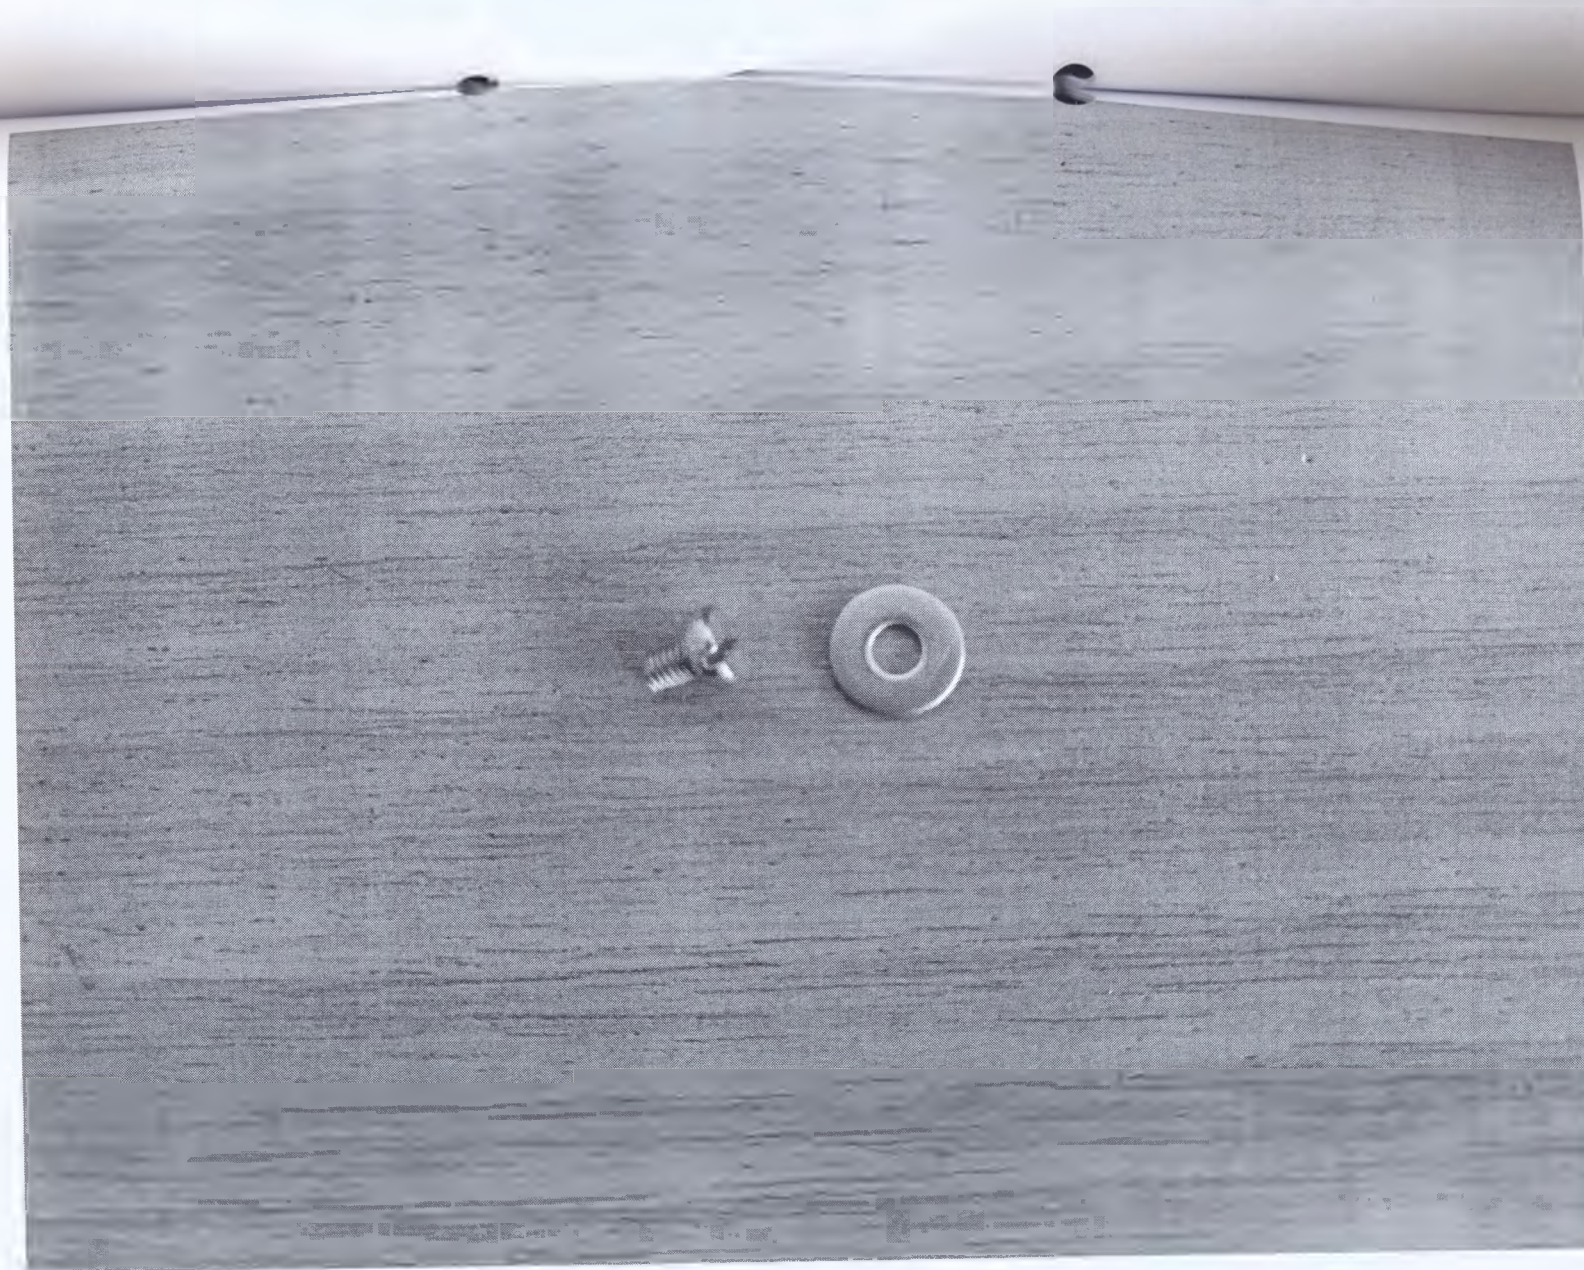

Винт и шайба для регистрационной пластинки



Плексигласовая пластинка



Candulor маркер




Упаковка набора CRS Set 10 интравитальной регистрации центрального соотношения челюстей с маркировкой




Набор CRS 15 для внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей




Регистрационная пластинка 1

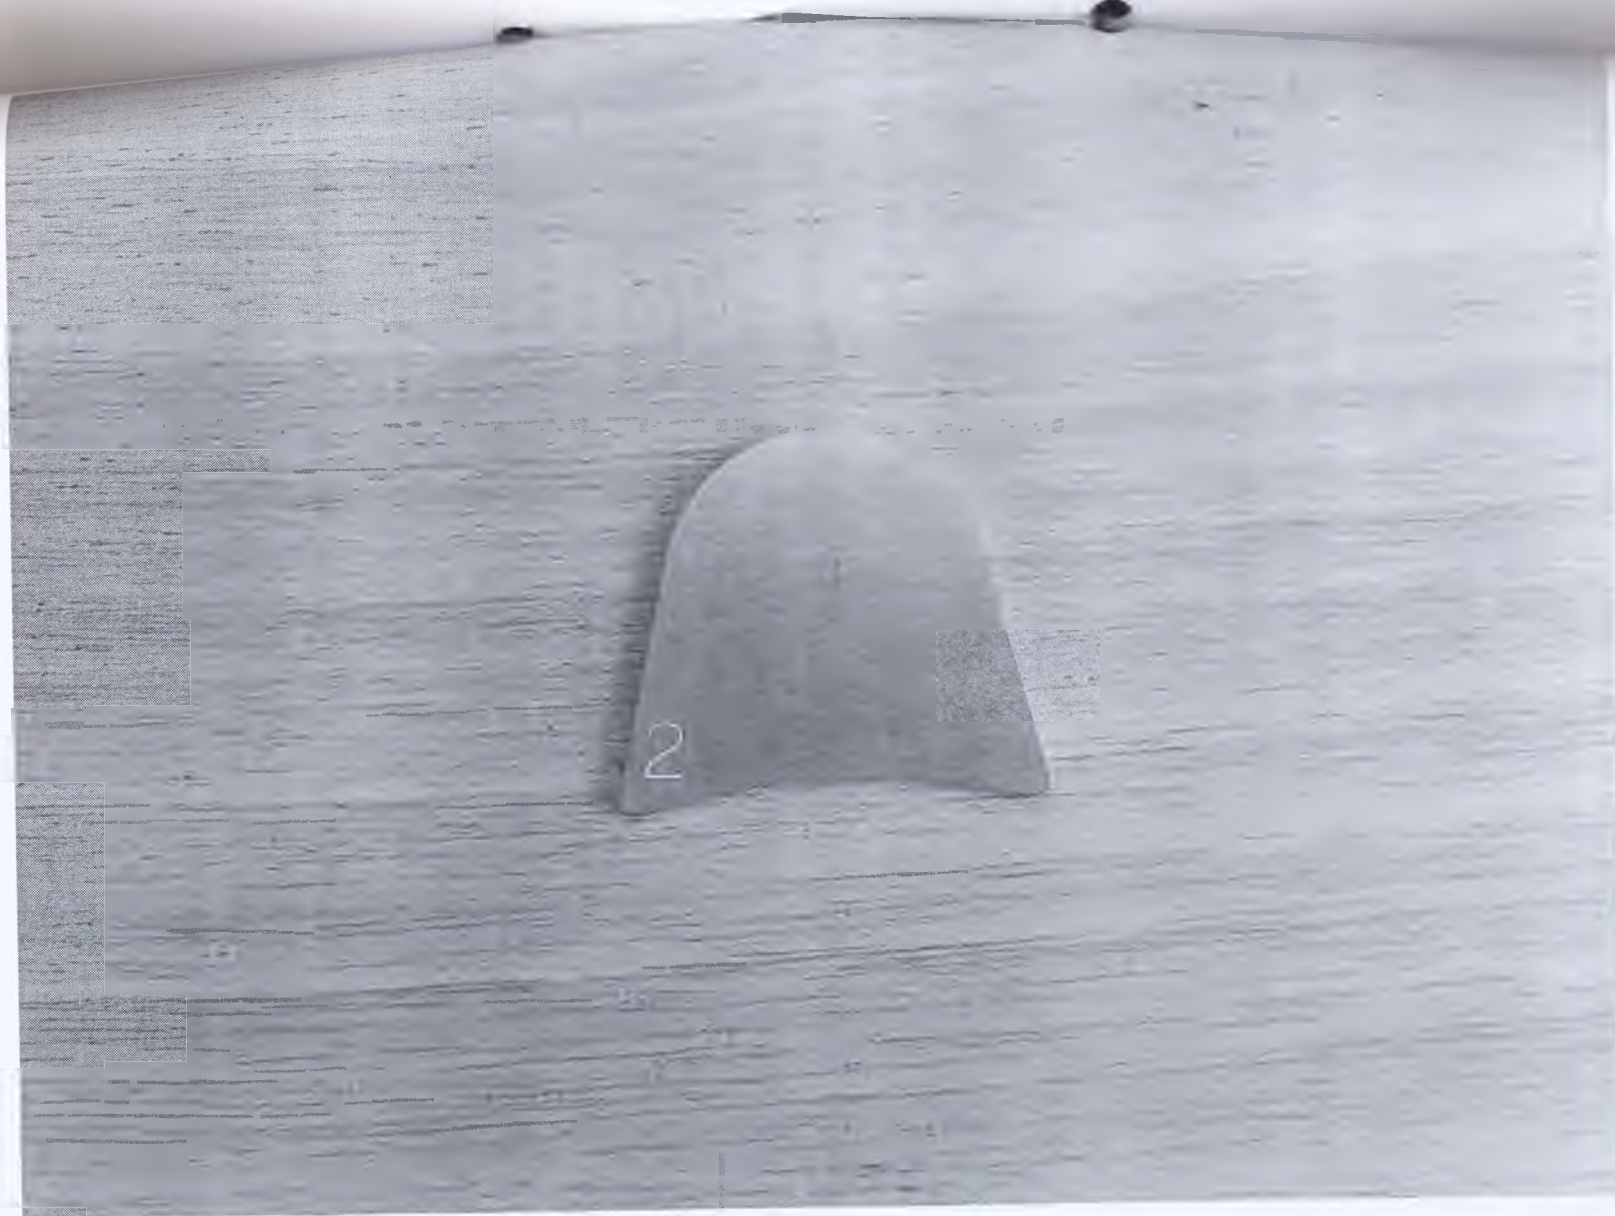


Регистрационная пластинка 2

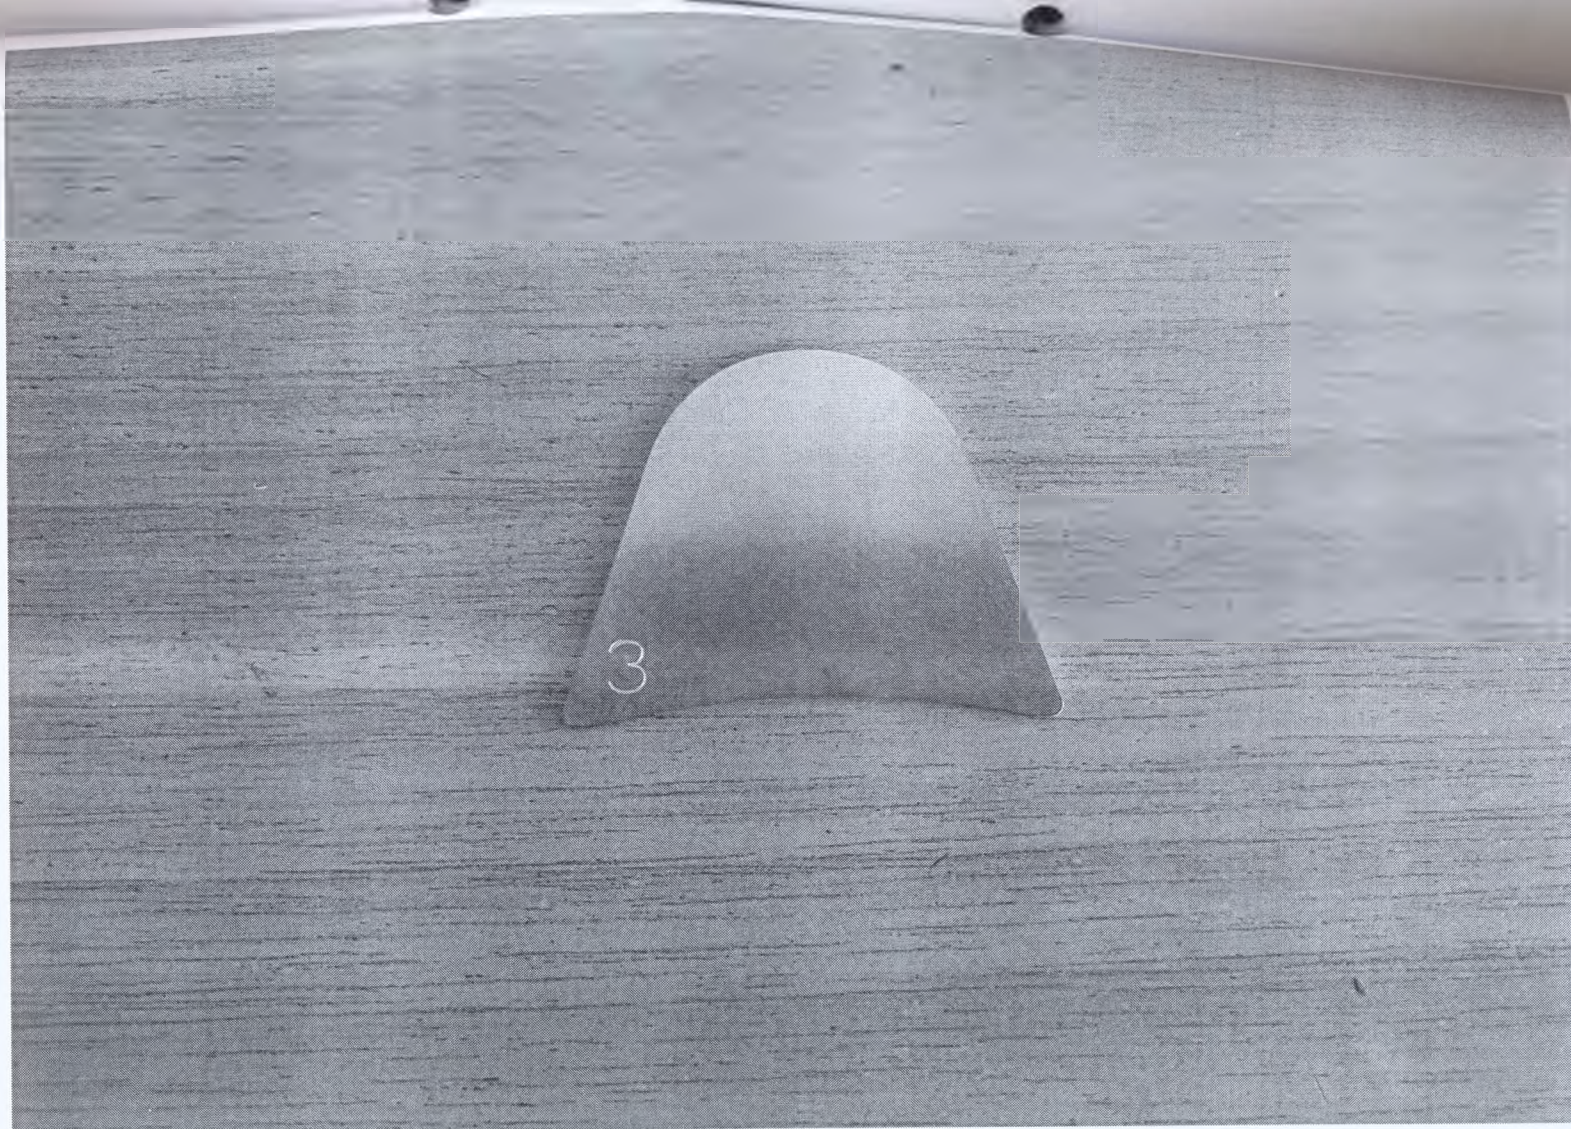


Регистрационная пластинка 3

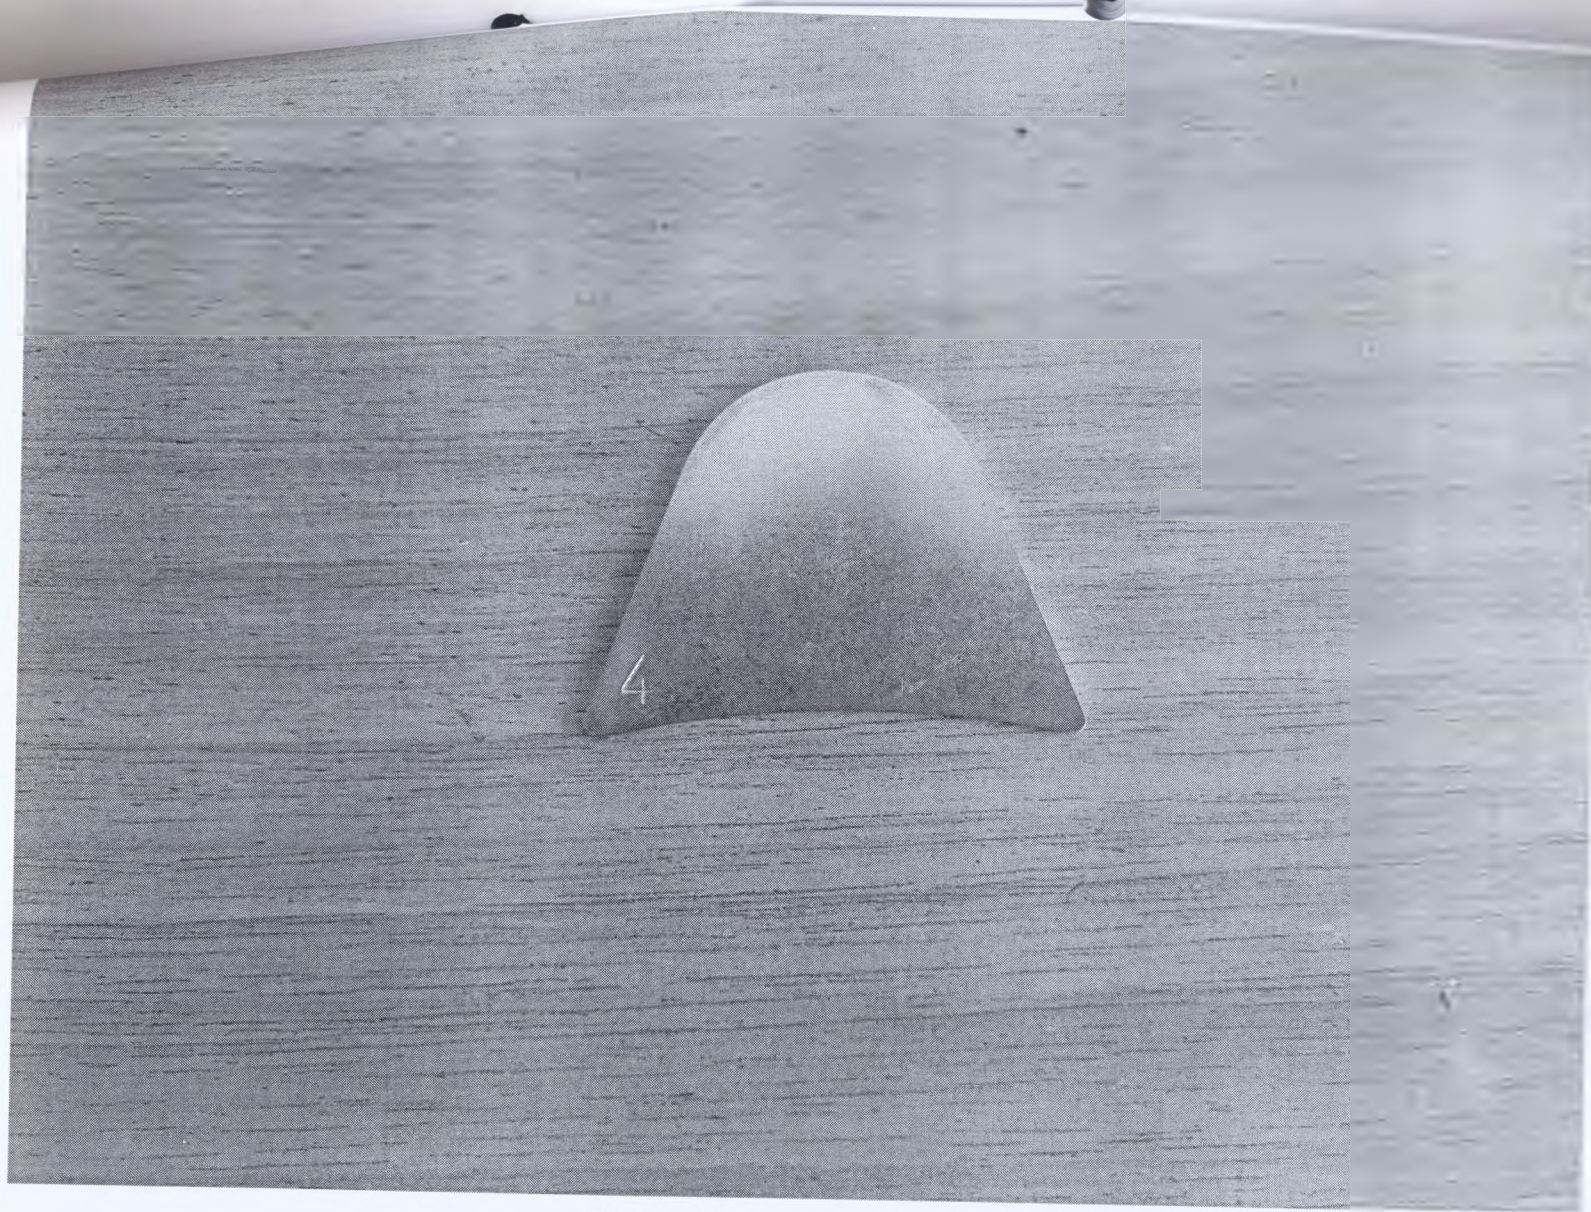


Регистрационная пластинка 4

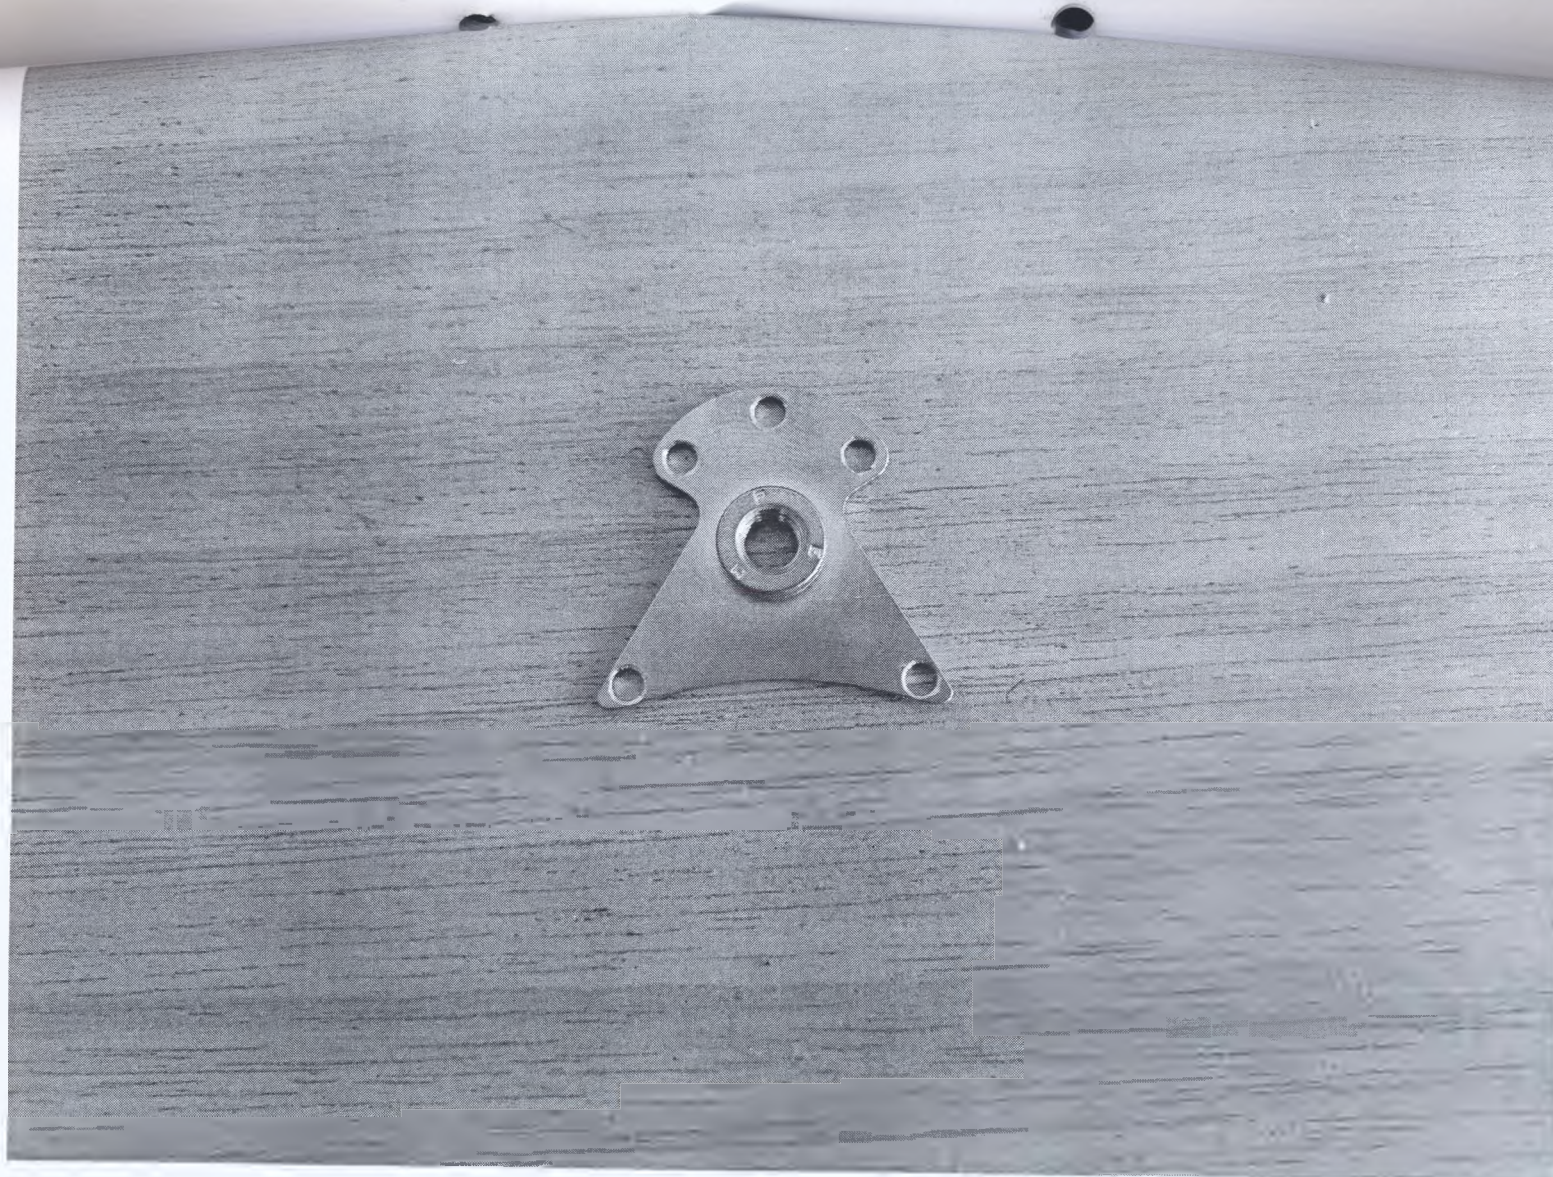


Опорная пластинка для штифта

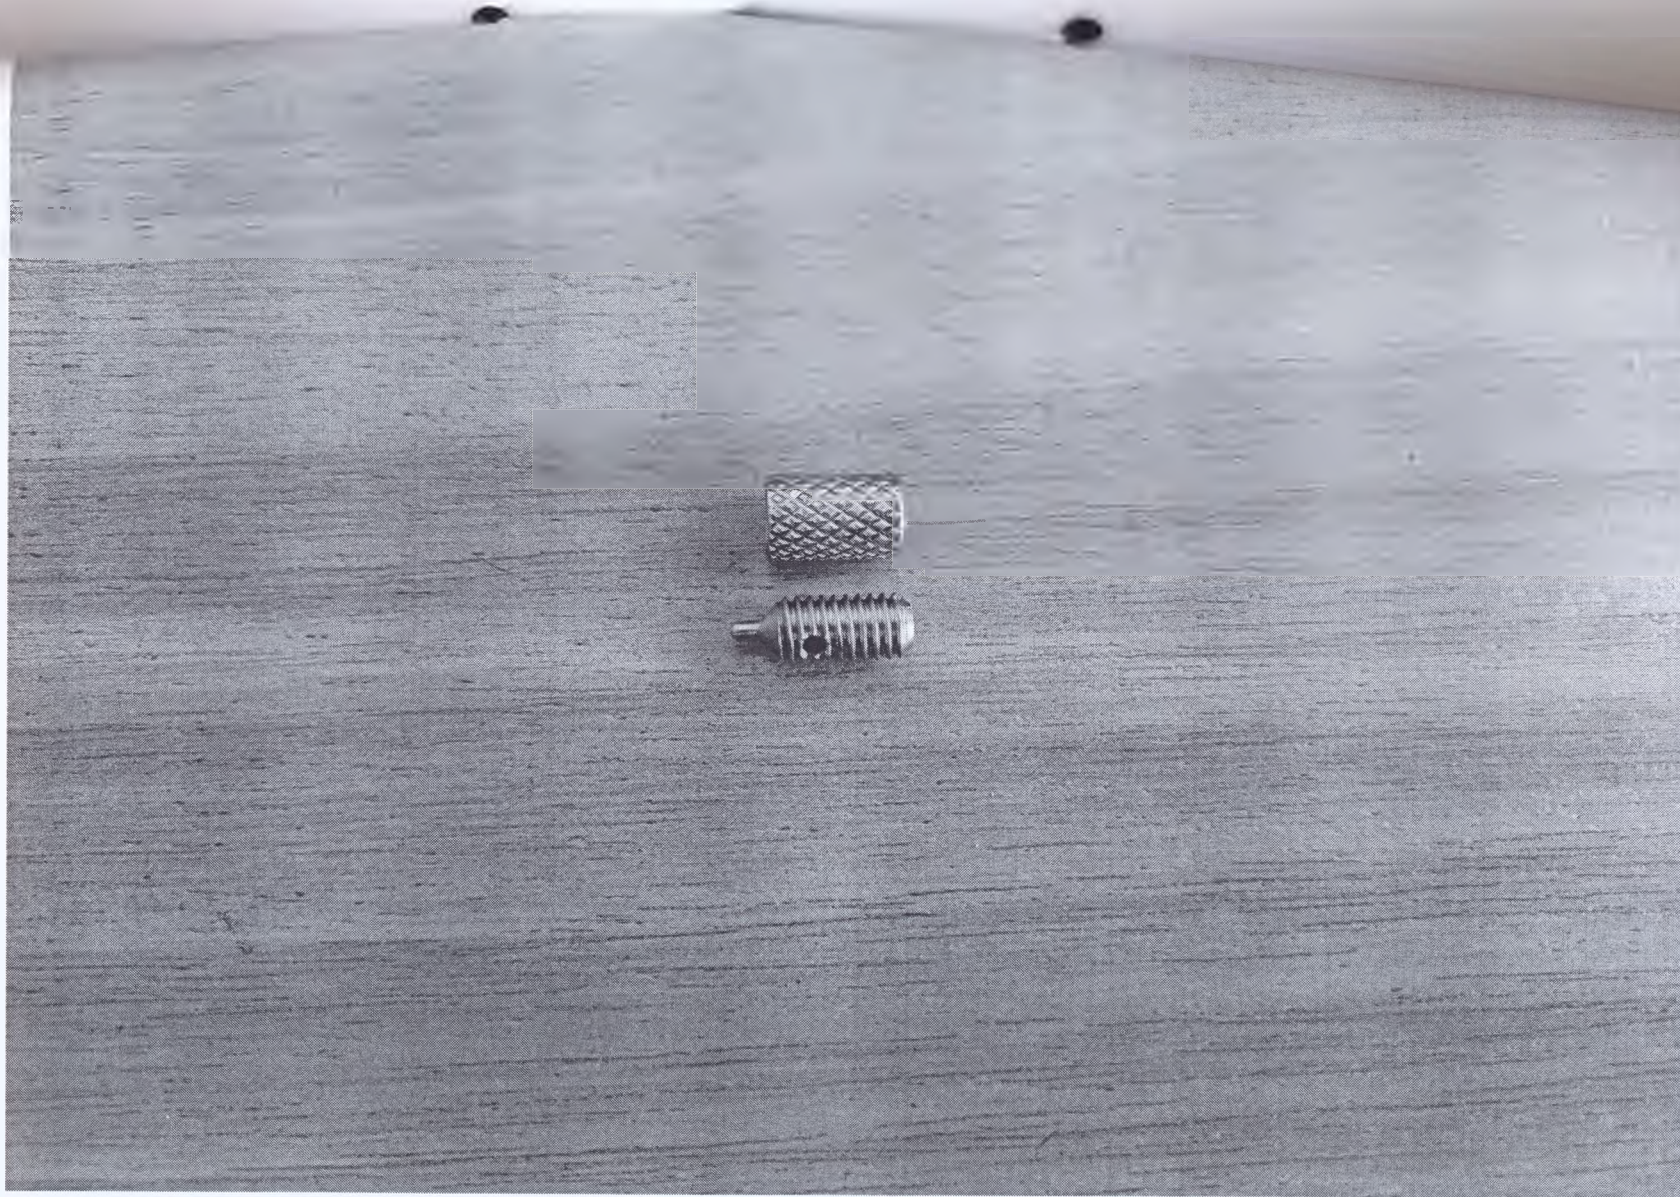


Регистрационный штифт с втулкой, короткий

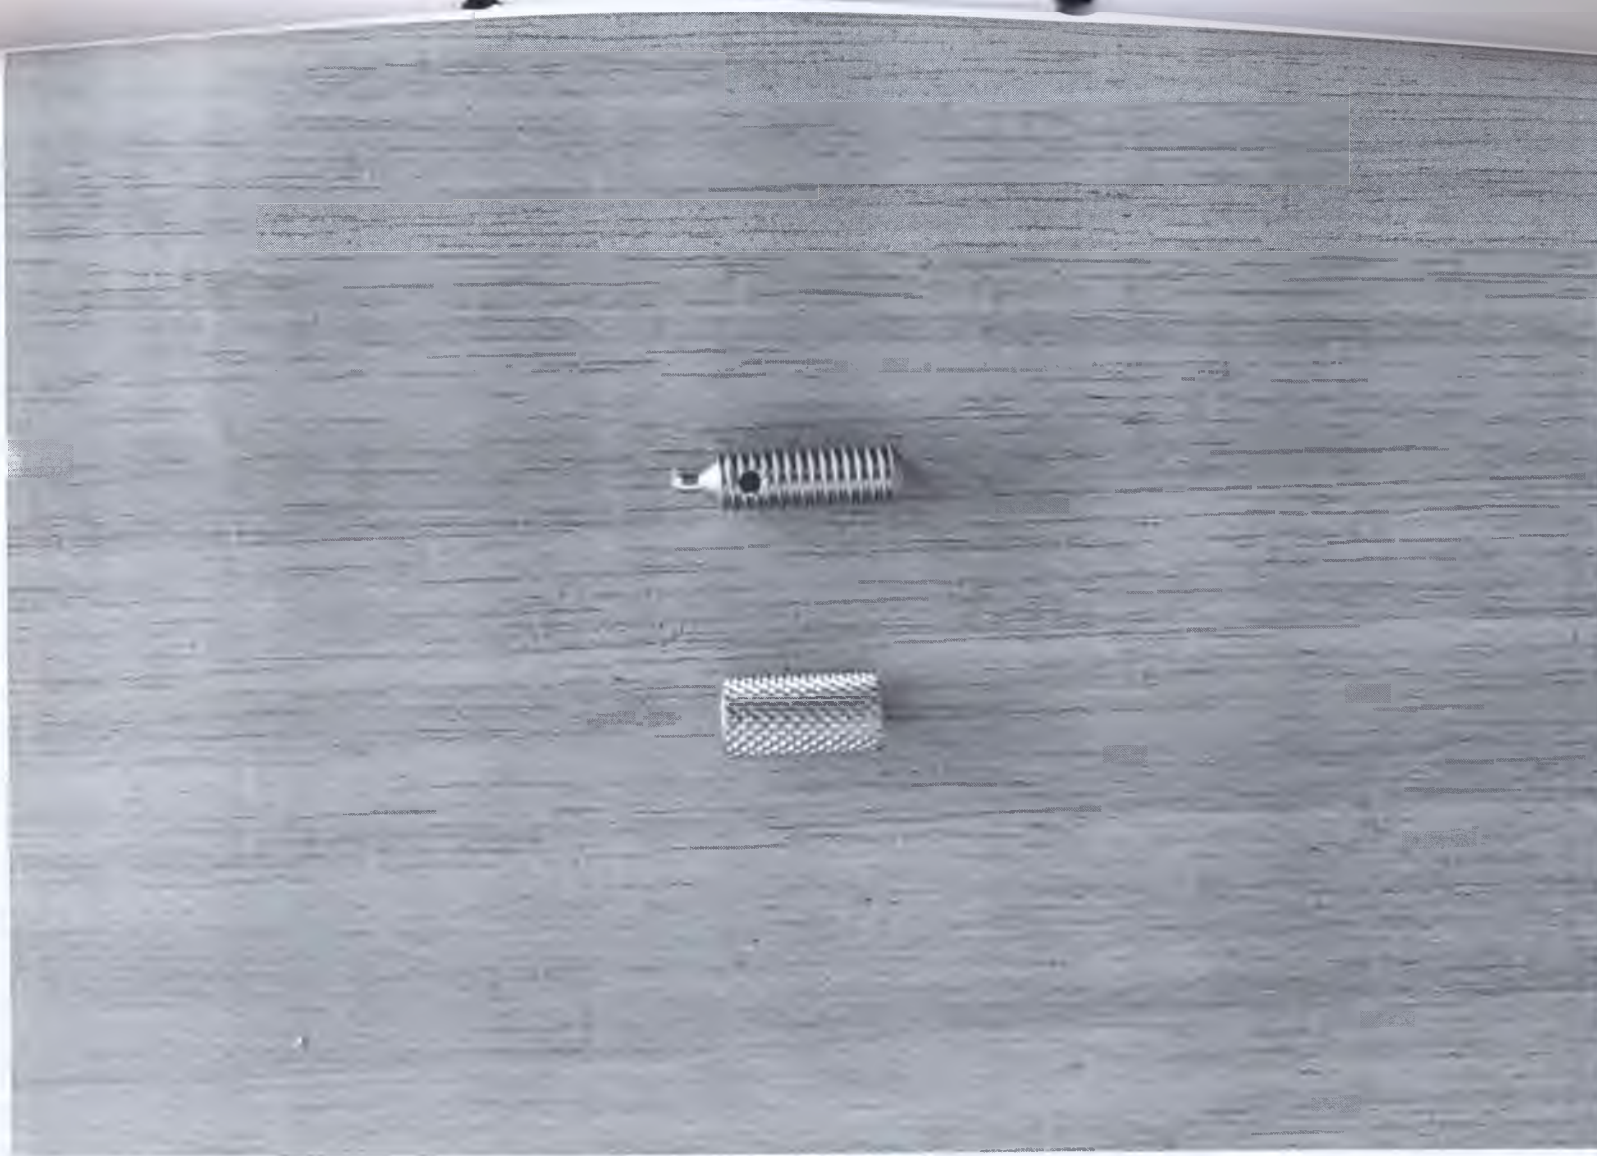

Регистрационный штифт с втулкой, длинный

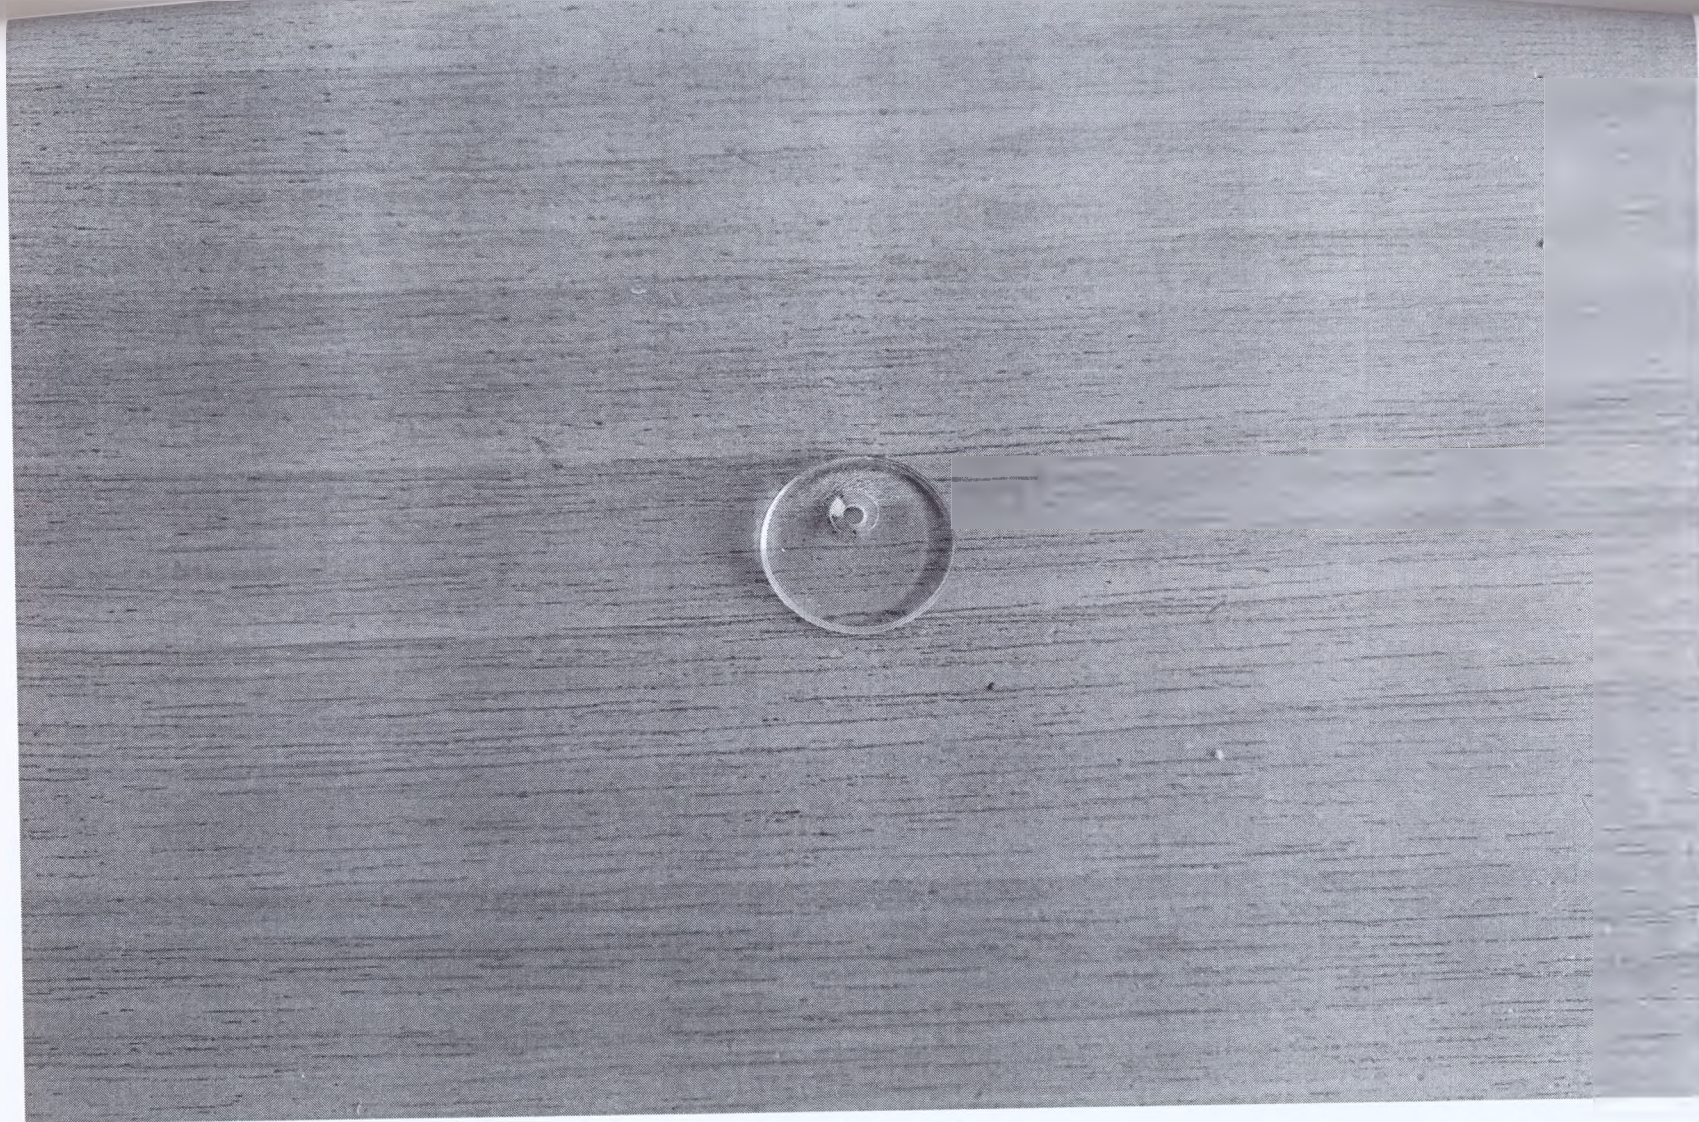

Плексигласовая круглая пластина

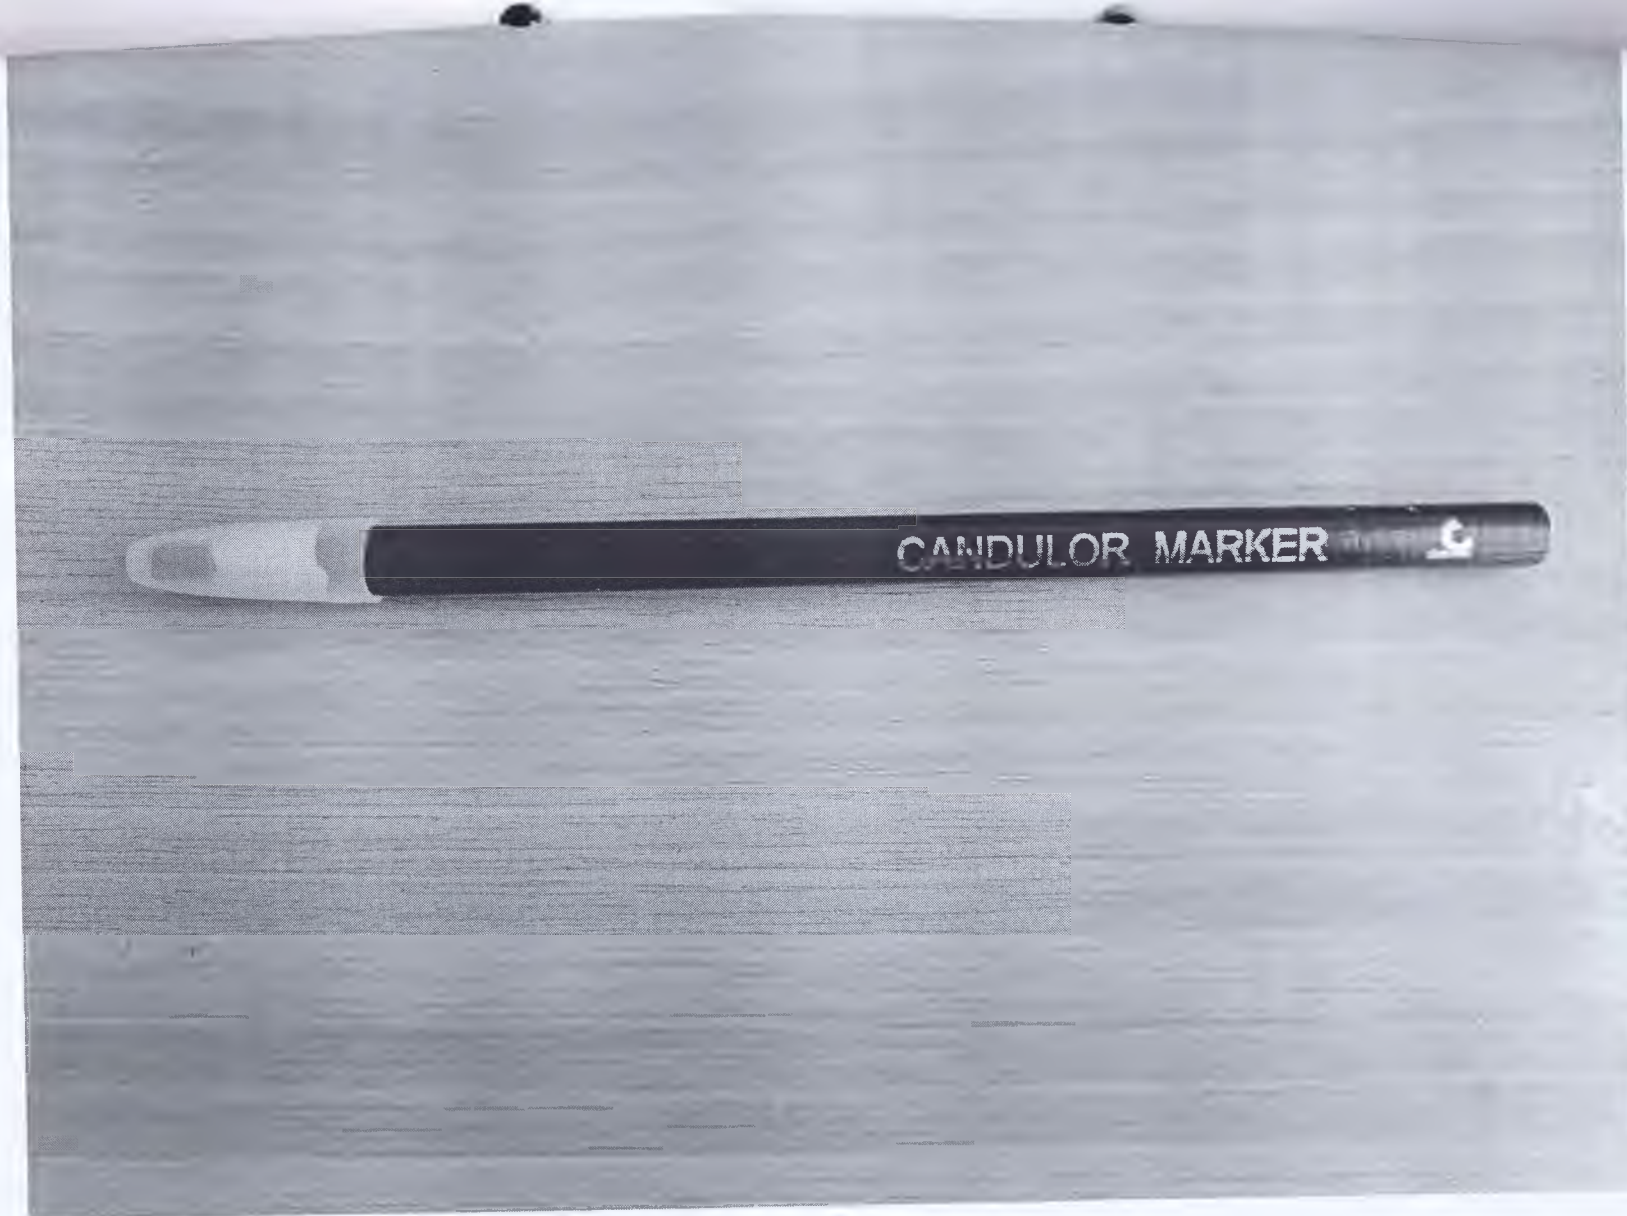

Candulor маркер

Набор CRS Set 15 для внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей

662521

Производитель

Candulor AG

Булвар Лилиенталя 8,

8152 Глаттпарк (Опфikon) Швейцария

Тел. +41 (0) 44 805 90 00

Факс: +41 (0) 44 805 90 90

Уполномоченный представитель: ООО «ХАРИКО ДЕНТА МЕД», Россия, 115230,

г. Москва, Кашинское шоссе, д. 5, корп. 1

Регистрационное удостоверение № P 201X/XXXX от XX XXXX 201X года

Место производства

ШЕПФ Фертигунгстехник ГмбХ

Хауптштрассе, 65 6719 Блудеш, Австрия

CRS Set 15

662521

CANDULOR AG

Boulevard Lilienthal 8

CH-8152 Glattpark (Opfikon)

T +41 (0) 44 805 90 00

F +41 (0) 44 805 90 90

CE



Упаковка набора CRS Set 15 внутриротовой регистрации центрального соотношения челюстей с маркировкой

1
Прошито и пронумеровано

• лист

Ген.директор

