

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Концентратор кислорода «Armed» в вариантах исполнения с принадлежностями»

производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. («Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко..
Лтд.»)

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(Г.Г. Добыш)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИМПОРТ» (ООО «МЕДИМПОРТ»)
(наименование организации-заявителя)



Содержание:

1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-1

1.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-1, в составе:

- 1.1.1. Концентратор кислорода
- 1.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м
- 1.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м
- 1.1.4. Диффузор

1.2. Принадлежности:

- 1.2.1. Фильтр тонкой очистки
- 1.2.2. Пульт ДУ

2. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-1

2.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-1, в составе:

- 2.1.1. Концентратор кислорода
- 2.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м
- 2.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м
- 2.1.4. Диффузор (2 шт.)

2.2. Принадлежности:

- 2.2.1. Фильтр тонкой очистки
- 2.2.2. Пульт ДУ

3. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения YU600

3.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения YU600, в составе:

- 3.1.1. Концентратор кислорода
- 3.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м
- 3.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м
- 3.1.4. Диффузор (2 шт.)

3.2. Принадлежности:

- 3.2.1. Фильтр губчатый
- 3.2.2. Пульт ДУ

4. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3W

4.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3W, в составе:

- 4.1.1. Концентратор кислорода
- 4.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м
- 4.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м
- 4.1.4. Диффузор (2 шт.)
- 4.1.5. Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

4.2. Принадлежности:

- 4.2.1. Фильтр тонкой очистки

5. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5W

5.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5W, в составе:

- 5.1.1. Концентратор кислорода
- 5.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м
- 5.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м
- 5.1.4. Диффузор (2 шт.)
- 5.1.5. Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

5.2. Принадлежности:

5.2.1. Фильтр тонкой очистки

6. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-5AW

6.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-5AW, в составе:

6.1.1. Концентратор кислорода

6.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

6.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

6.1.4. Увлажнитель

6.1.5. Диффузор (2 шт.)

6.1.6. Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

6.2. Принадлежности:

6.2.1. Фильтр тонкой очистки

6.2.2. Пульт ДУ

7. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-3A

7.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-3A, в составе:

7.1.1. Концентратор кислорода

7.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

7.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

7.1.4. Увлажнитель

7.1.5. Диффузор (2 шт.)

7.2. Принадлежности:

7.2.1. Фильтр тонкой очистки

7.2.2. Пульт ДУ

8. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3A

8.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3A, в составе:

8.1.1. Концентратор кислорода

8.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

8.1.3. Диффузор (2 шт.)

8.1.4. Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

8.2. Принадлежности:

8.2.1. Фильтр тонкой очистки

8.2.2. Пульт ДУ

9. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3B

9.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3B, в составе:

9.1.1. Концентратор кислорода

9.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

9.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

9.1.4. Диффузор (2 шт.)

9.2. Принадлежности:

9.2.1. Фильтр тонкой очистки

9.2.2. Пульт ДУ

10. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3BW

10.1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3BW, в составе:

10.1.1. Концентратор кислорода

10.1.2. Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

10.1.3. Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

10.1.4. Диффузор (2 шт.)

10.1.5. Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

10.2. Принадлежности:

10.2.1. Фильтр тонкой очистки

10.2.2. Пульт ДУ

1. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-1

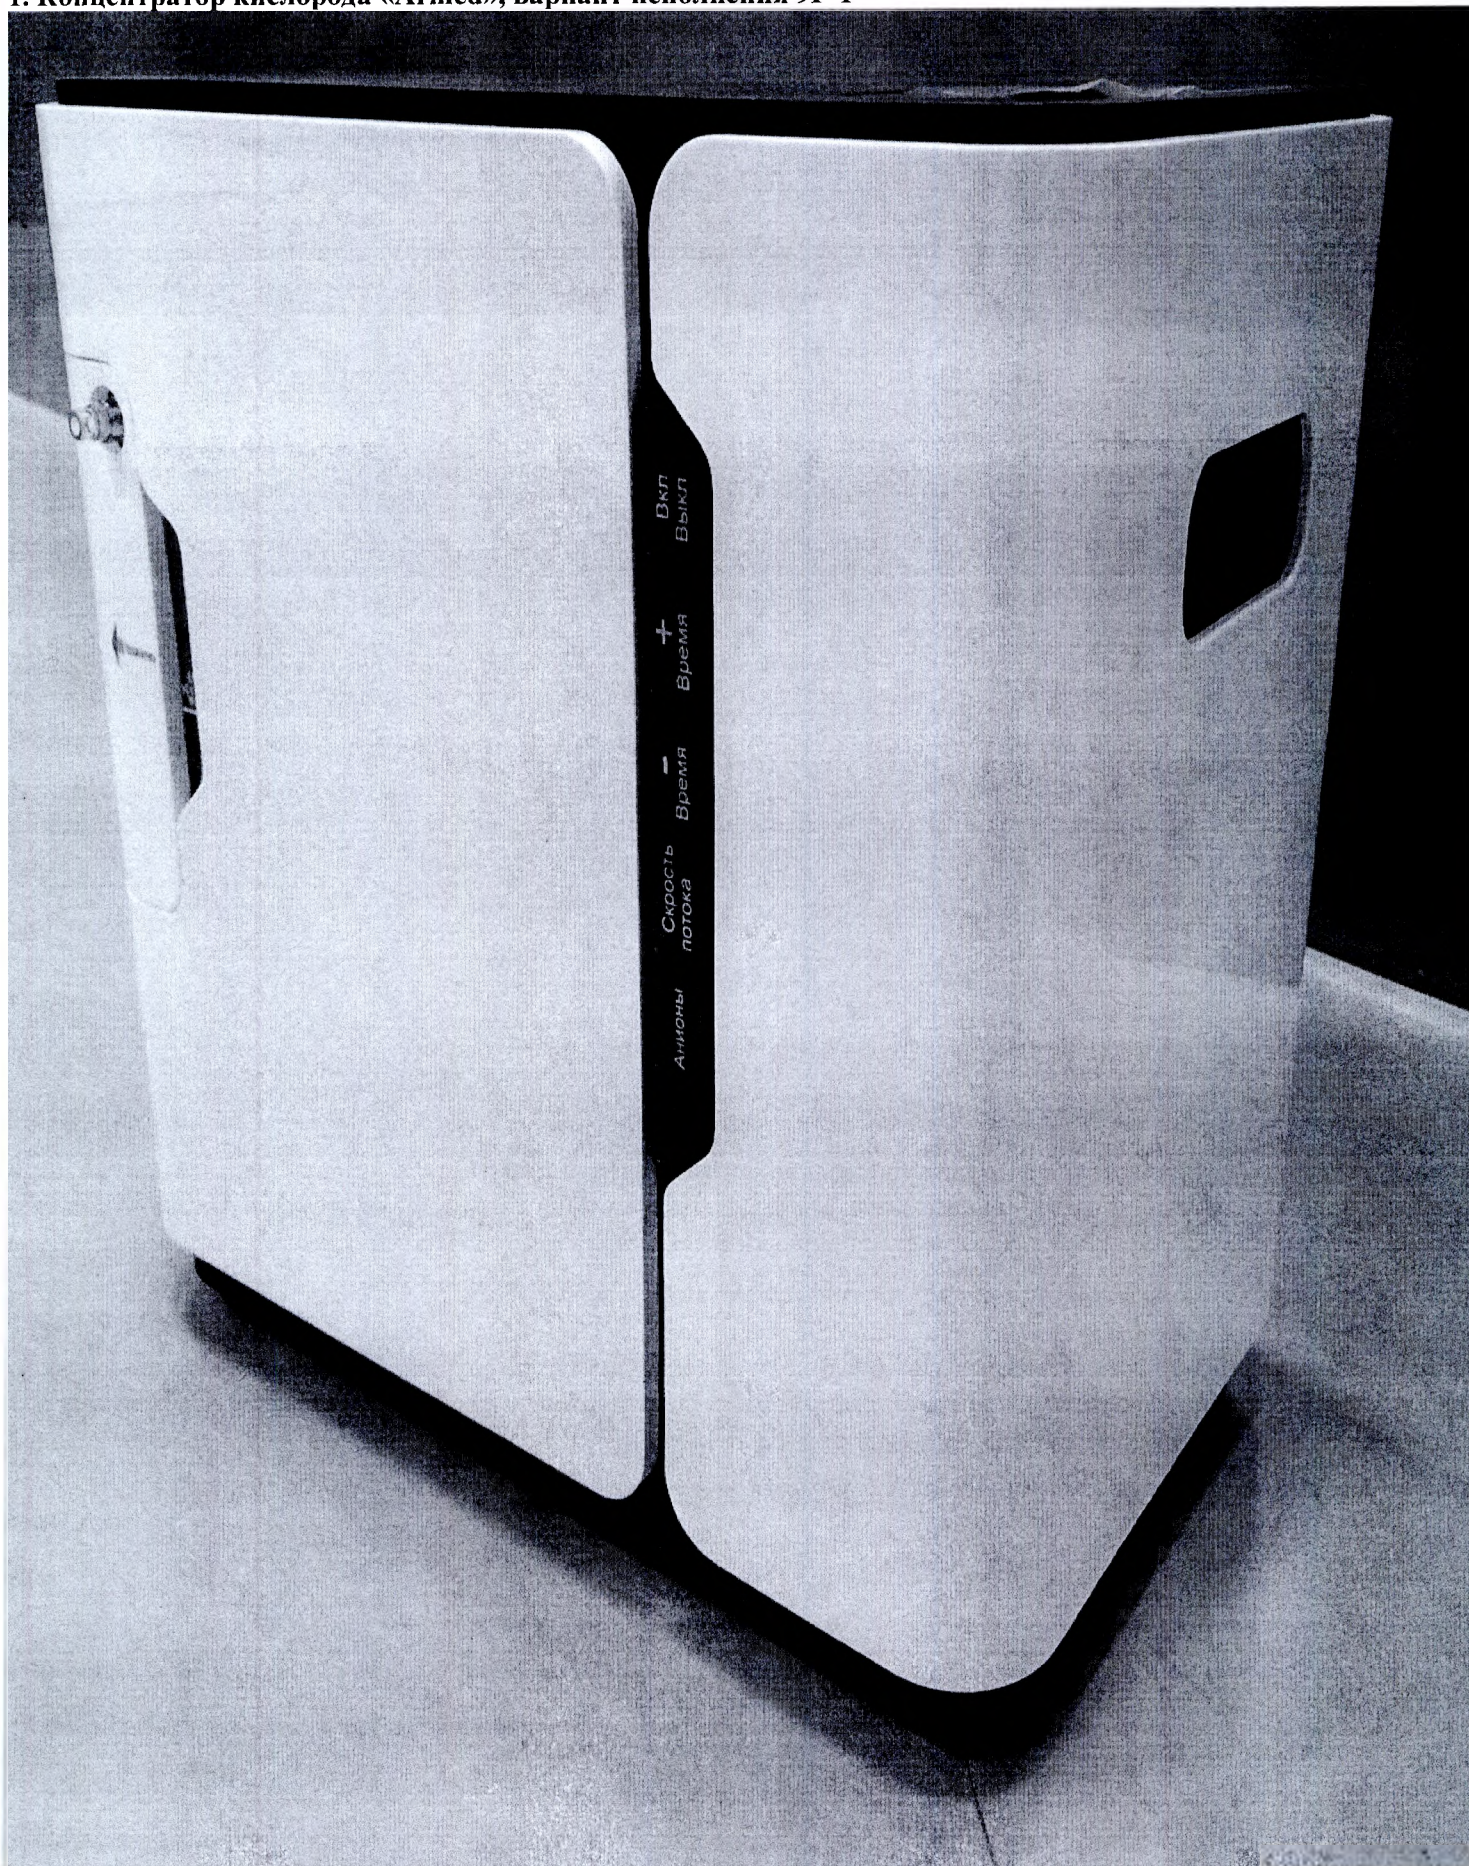


Рис. 1.1.1 – Концентратор кислорода

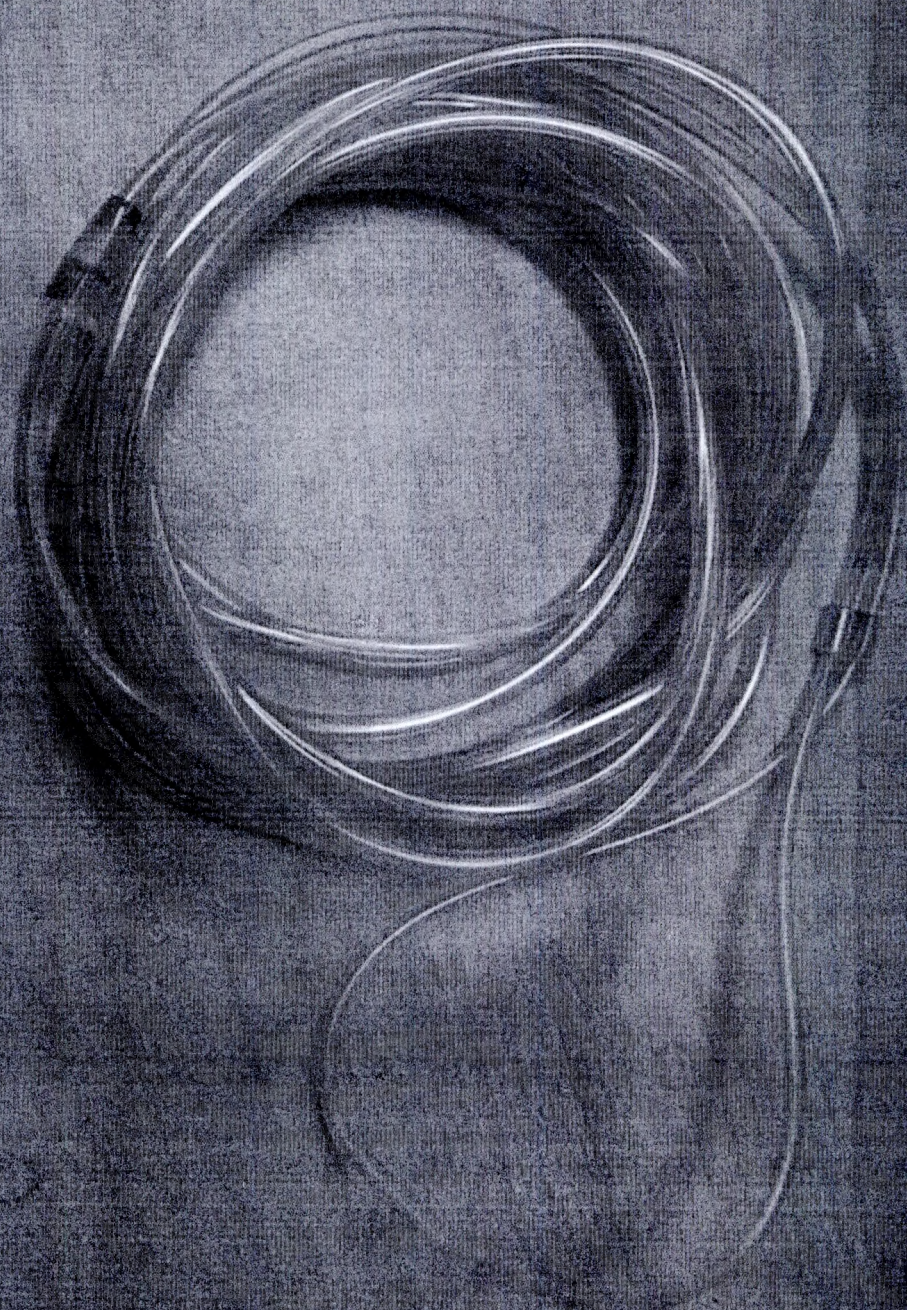


Рис. 1.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

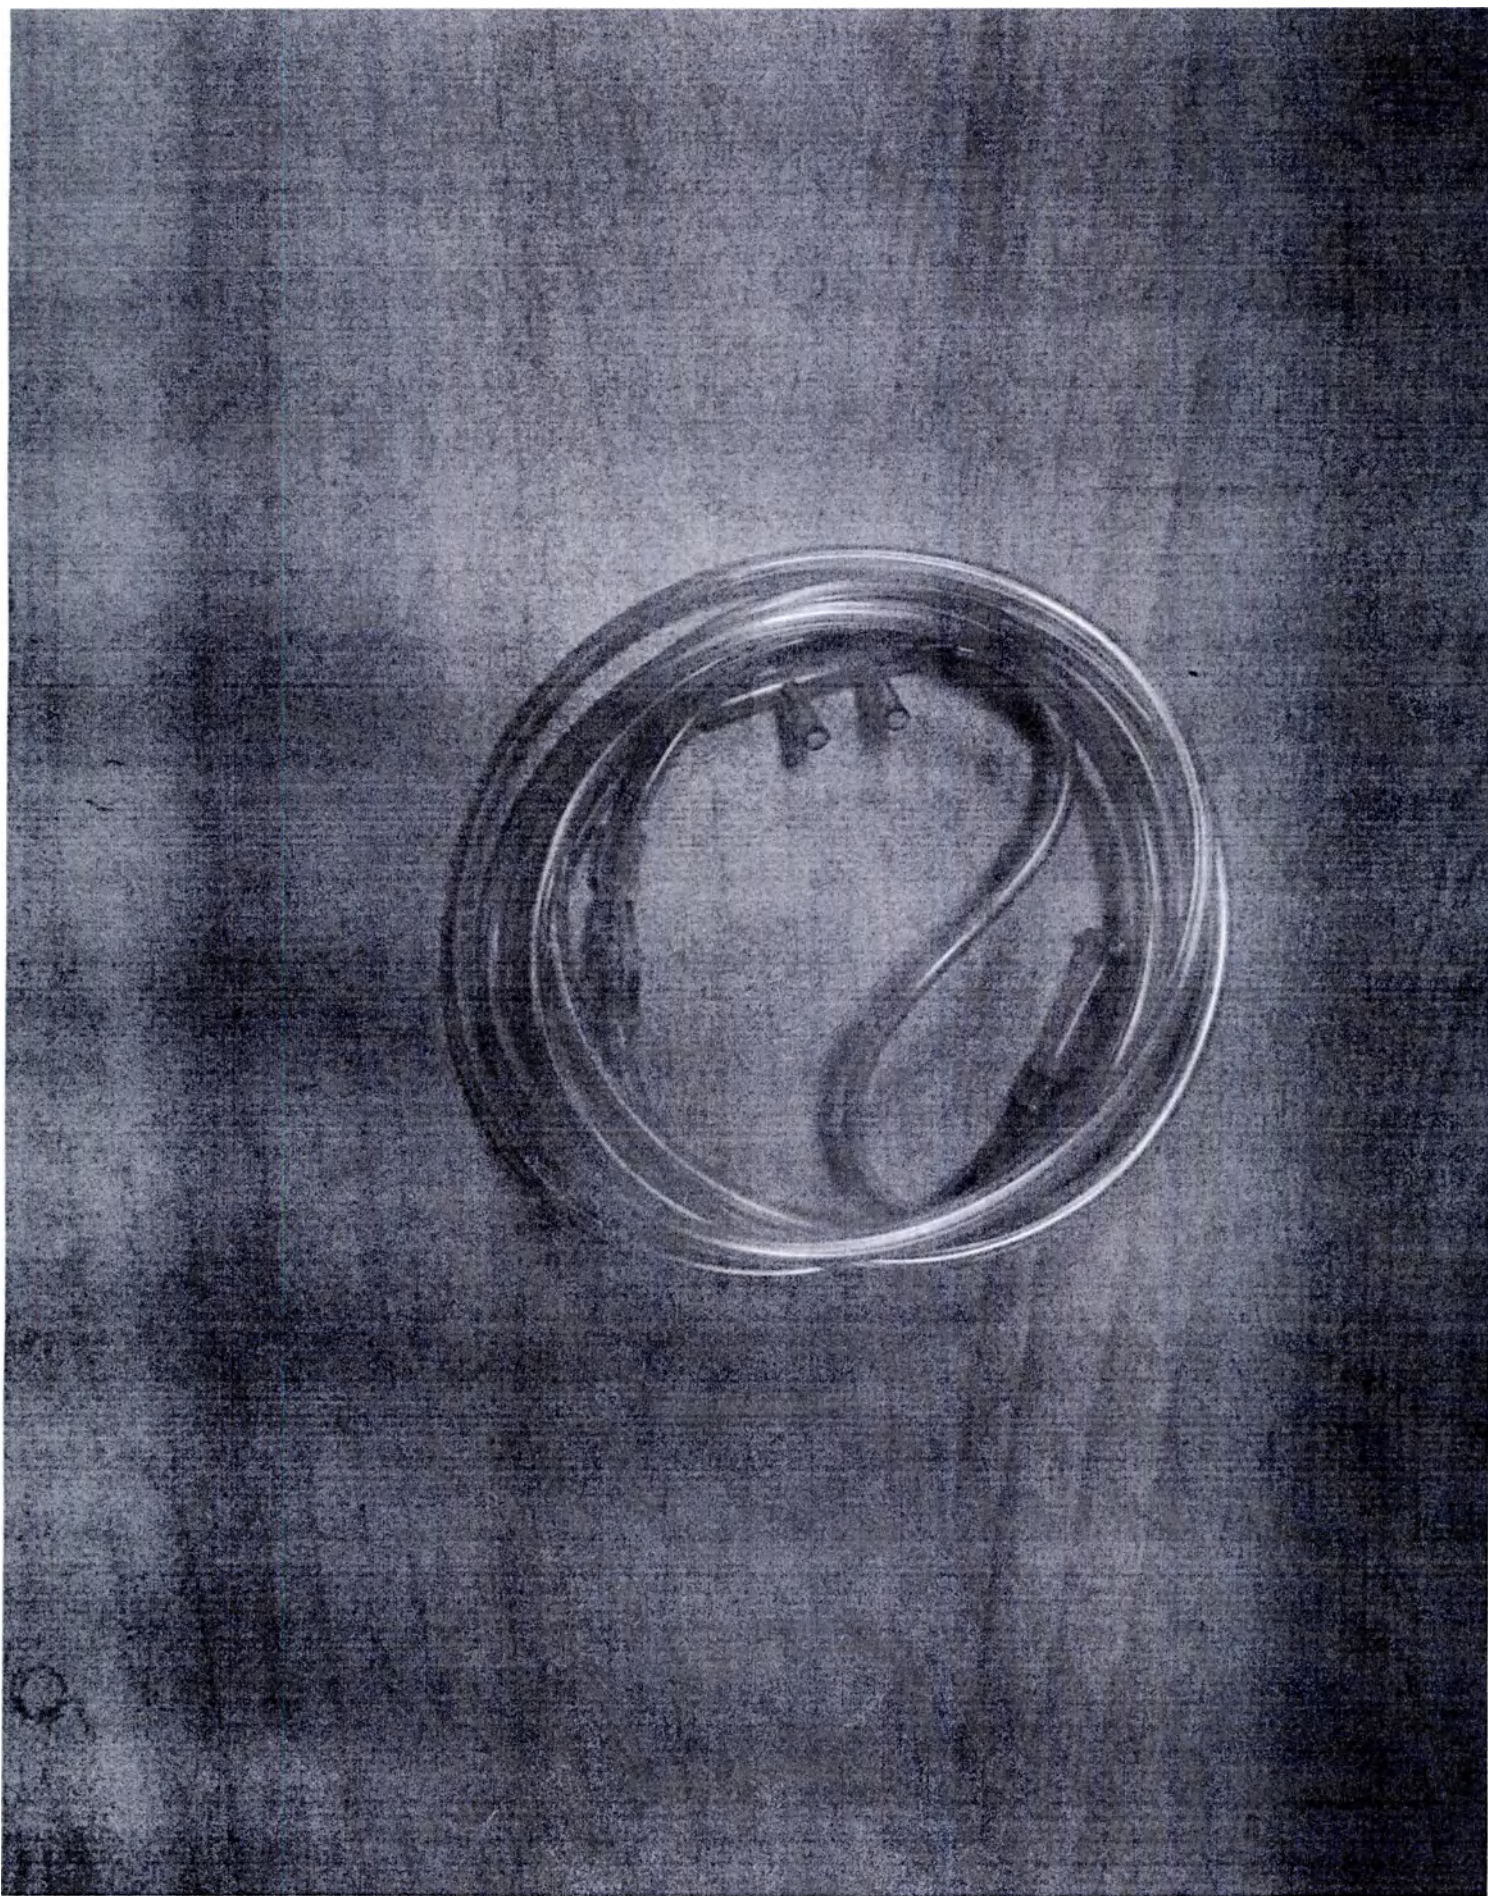


Рис. 1.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м



Рис. 1.1.4 – Диффузор

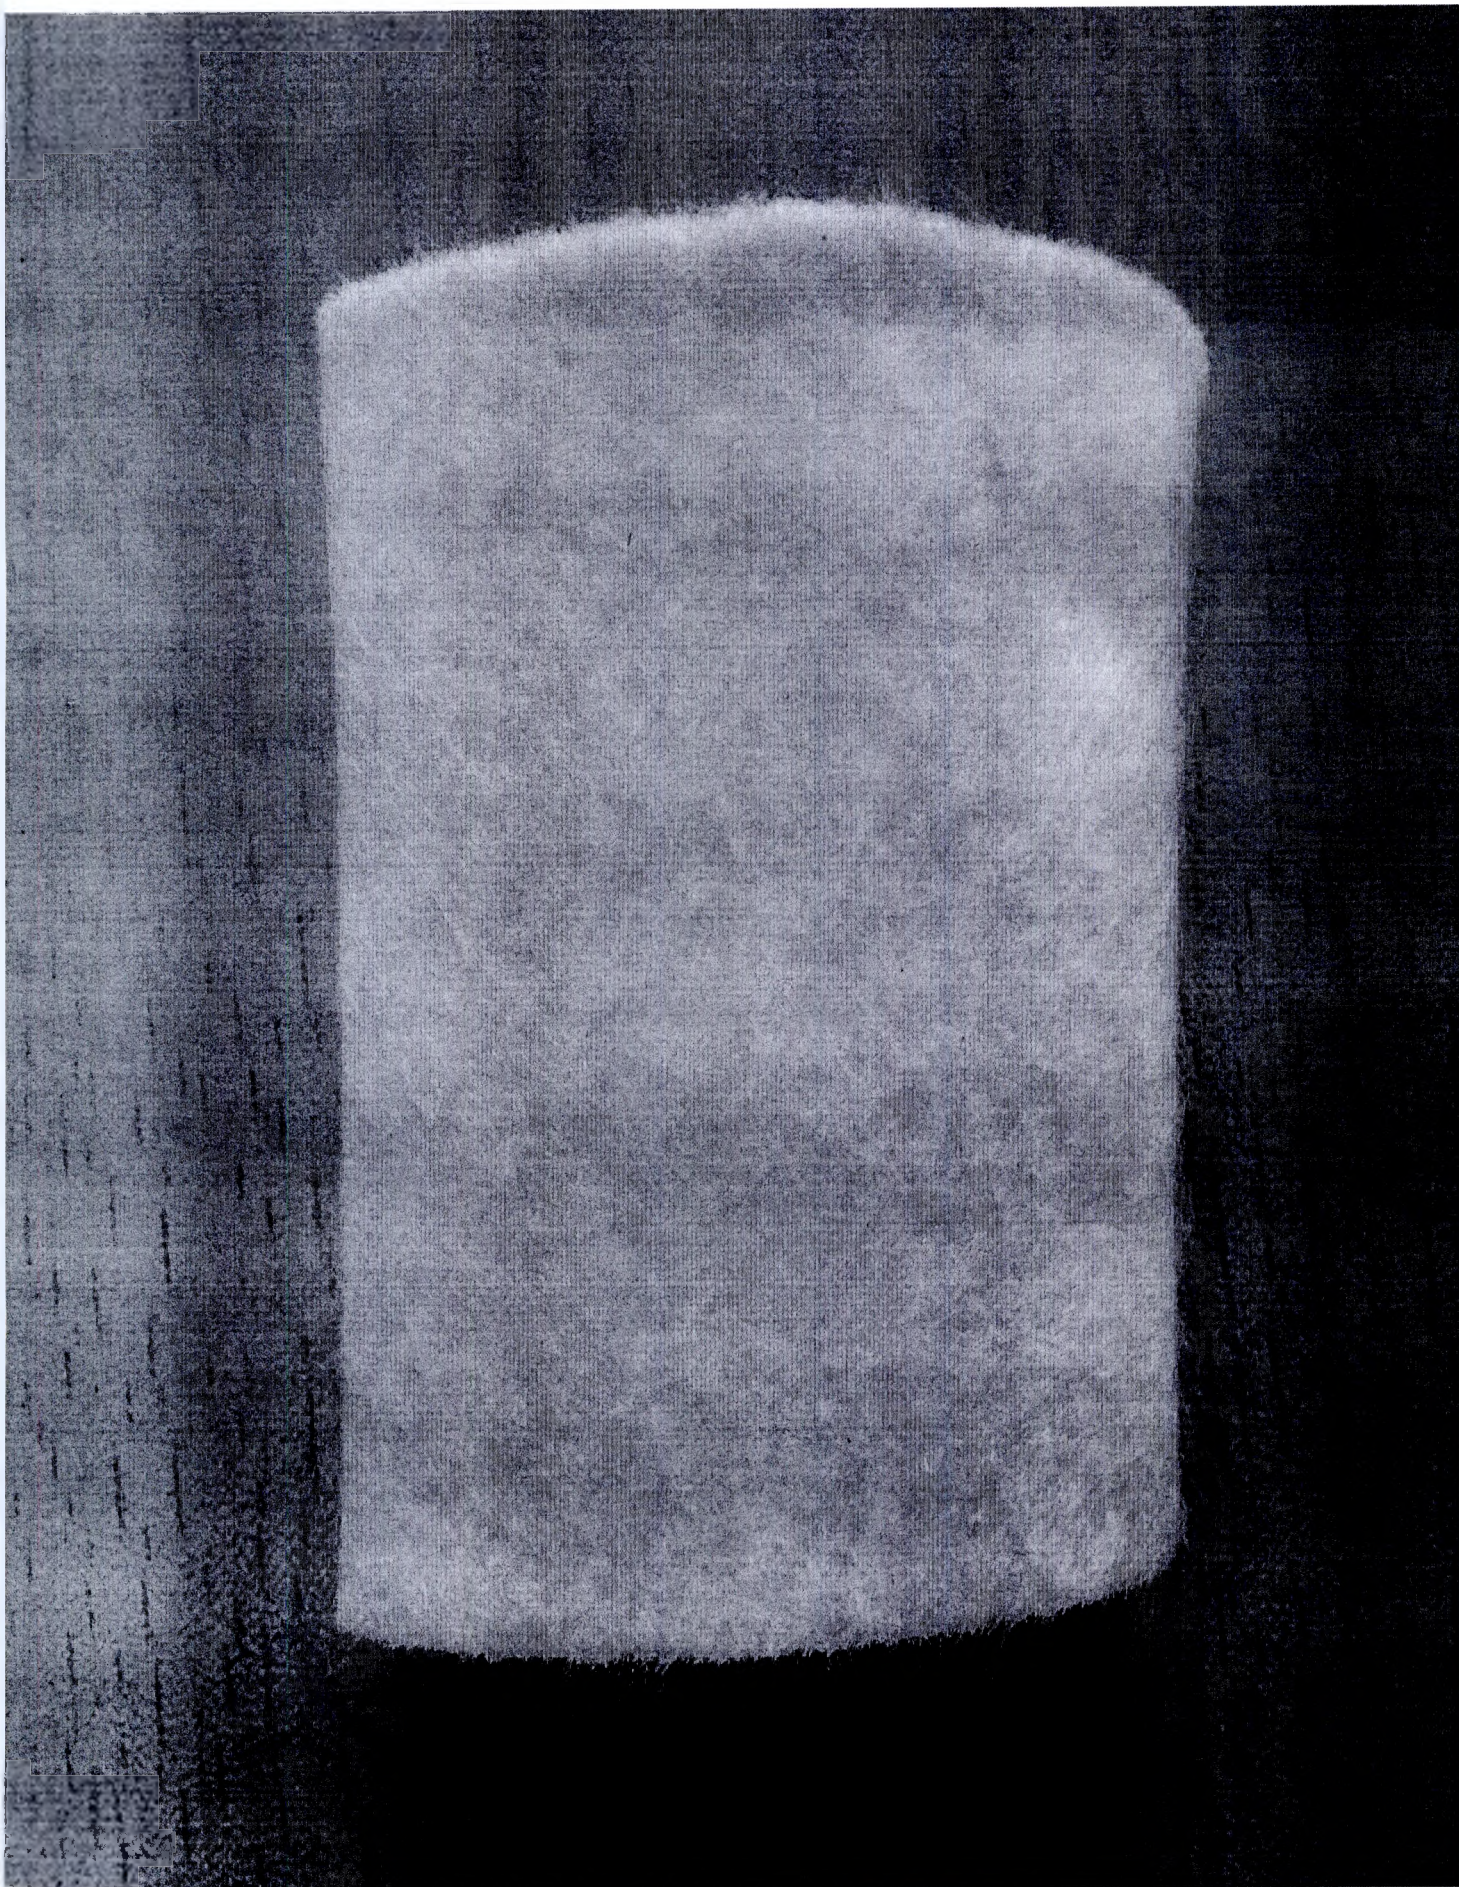


Рис. 1.2.1 – Фильтр тонкой очистки

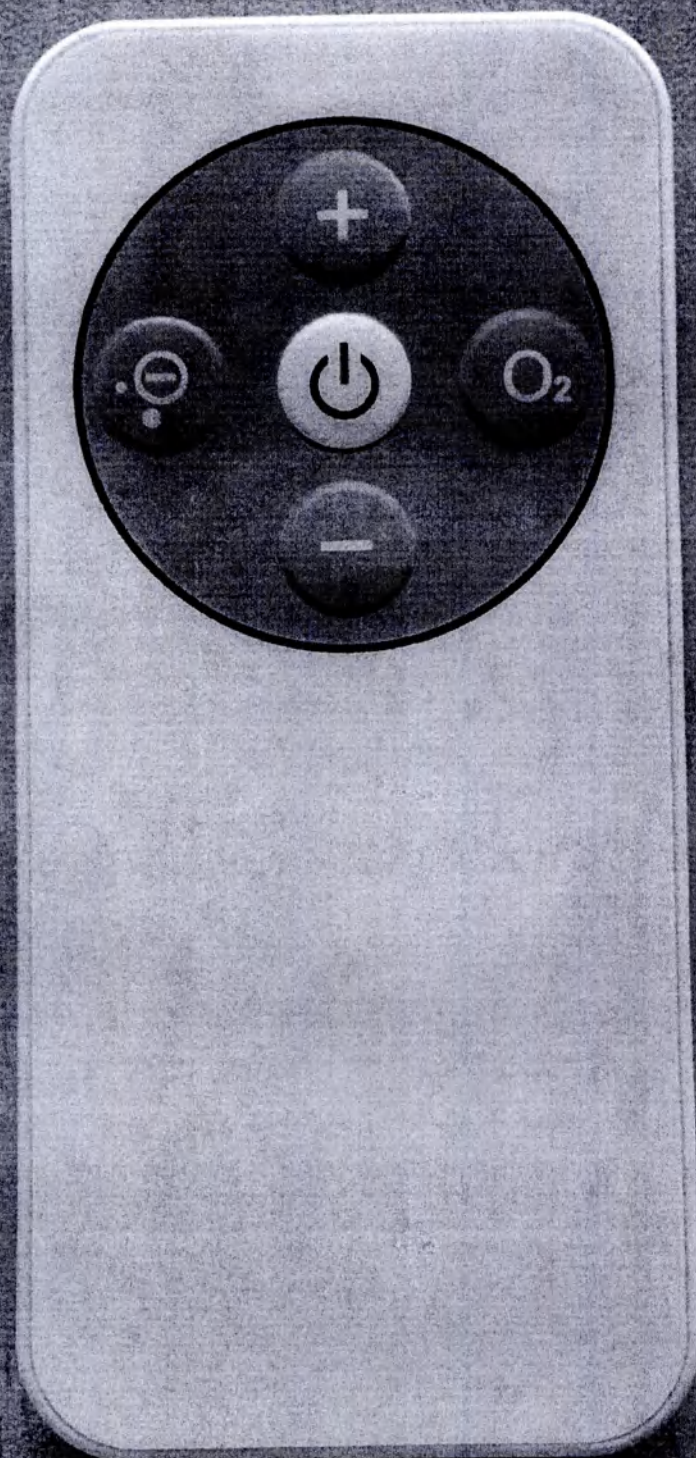


Рис. 1.2.2 – Пульт ДУ

2. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-1

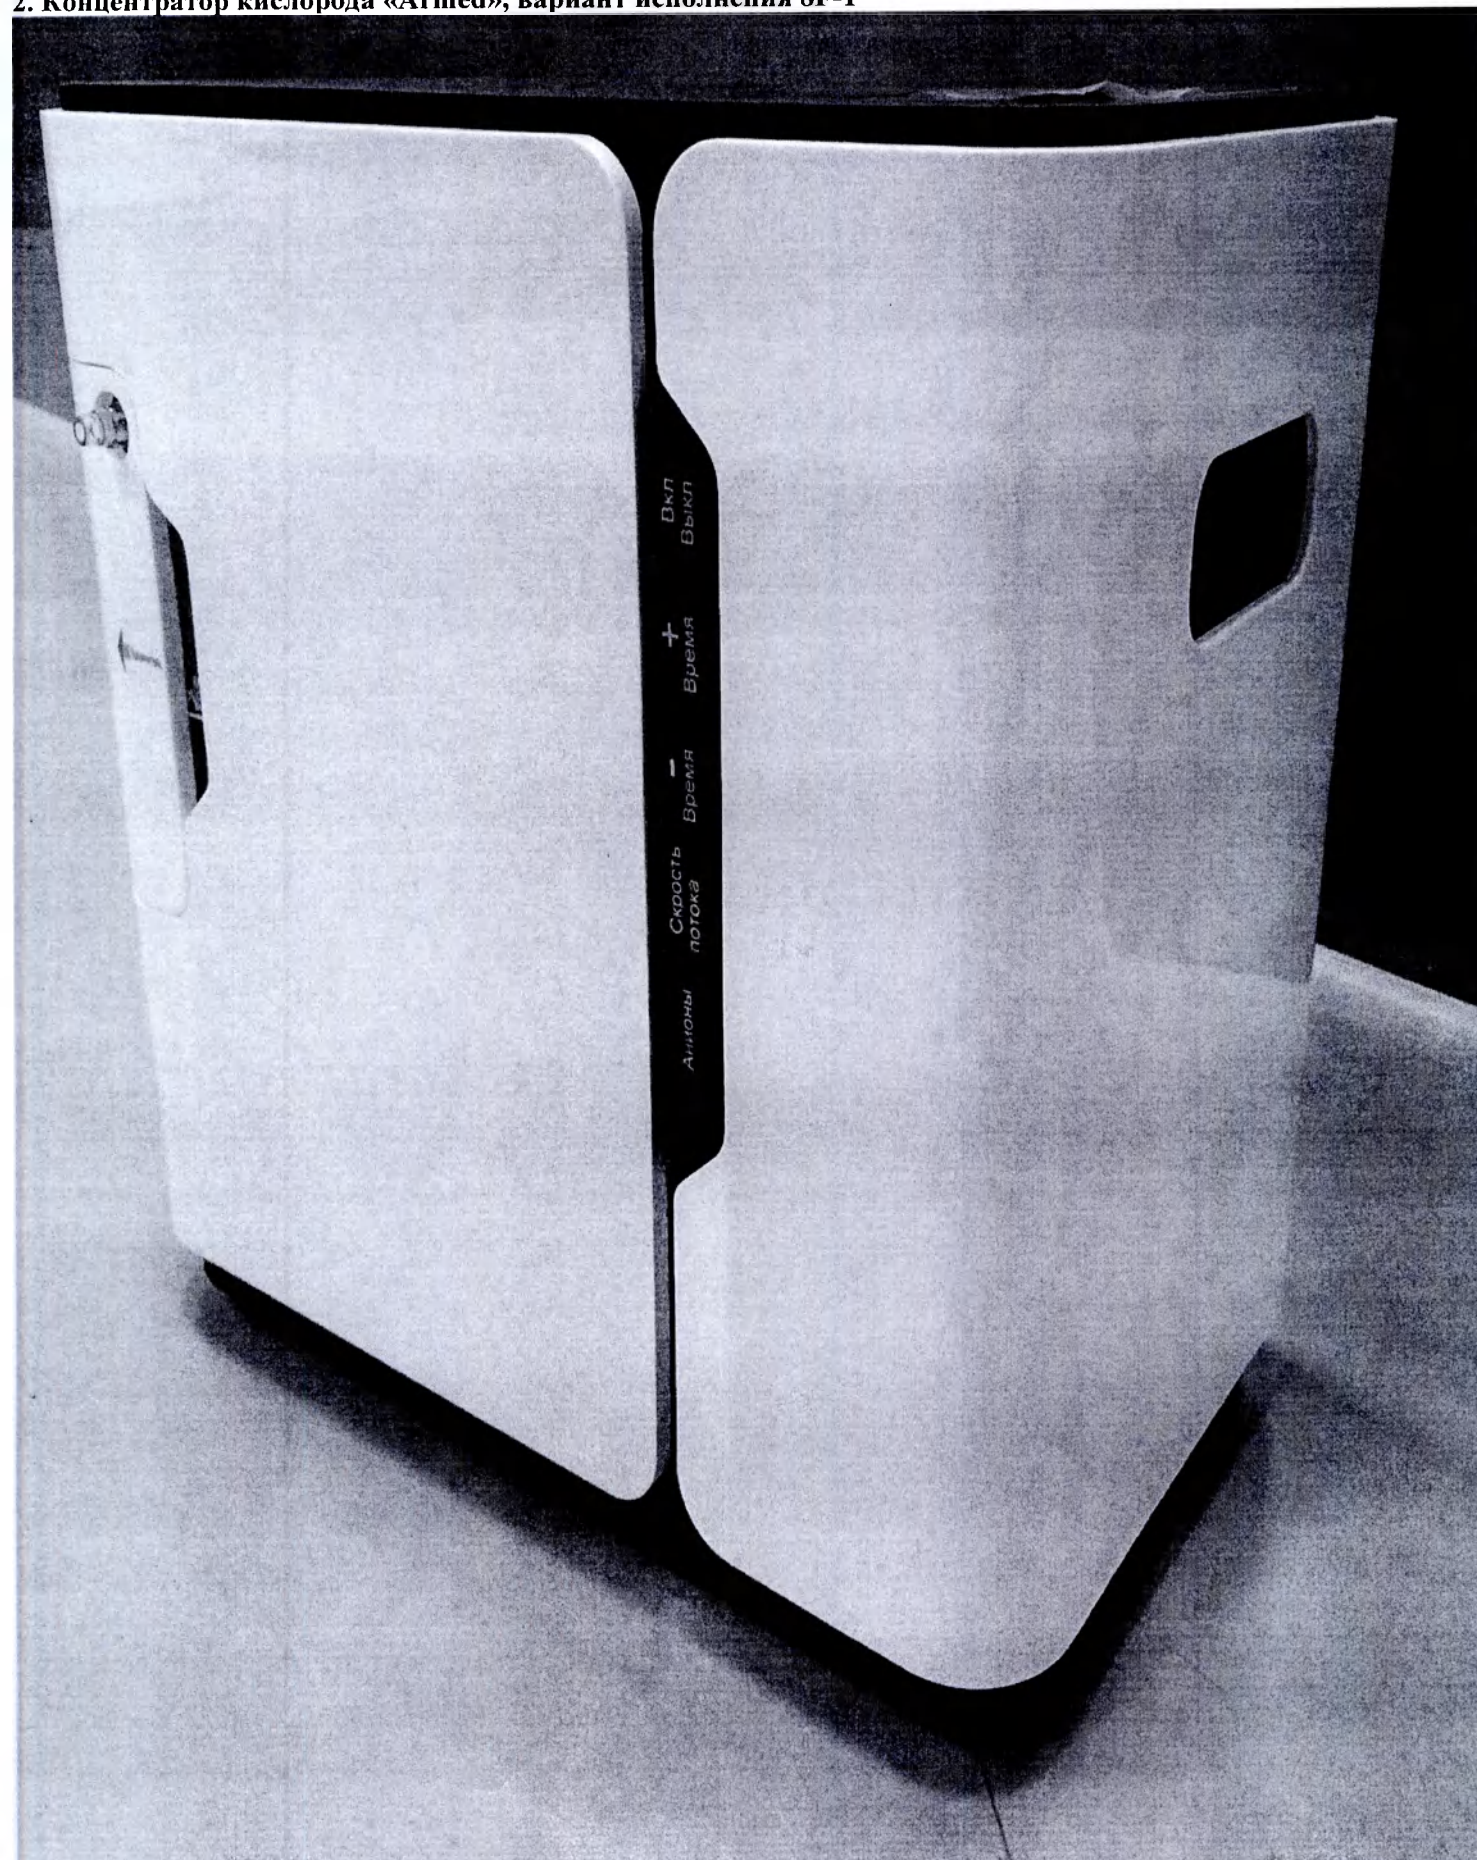


Рис. 2.1.1 – Концентратор кислорода

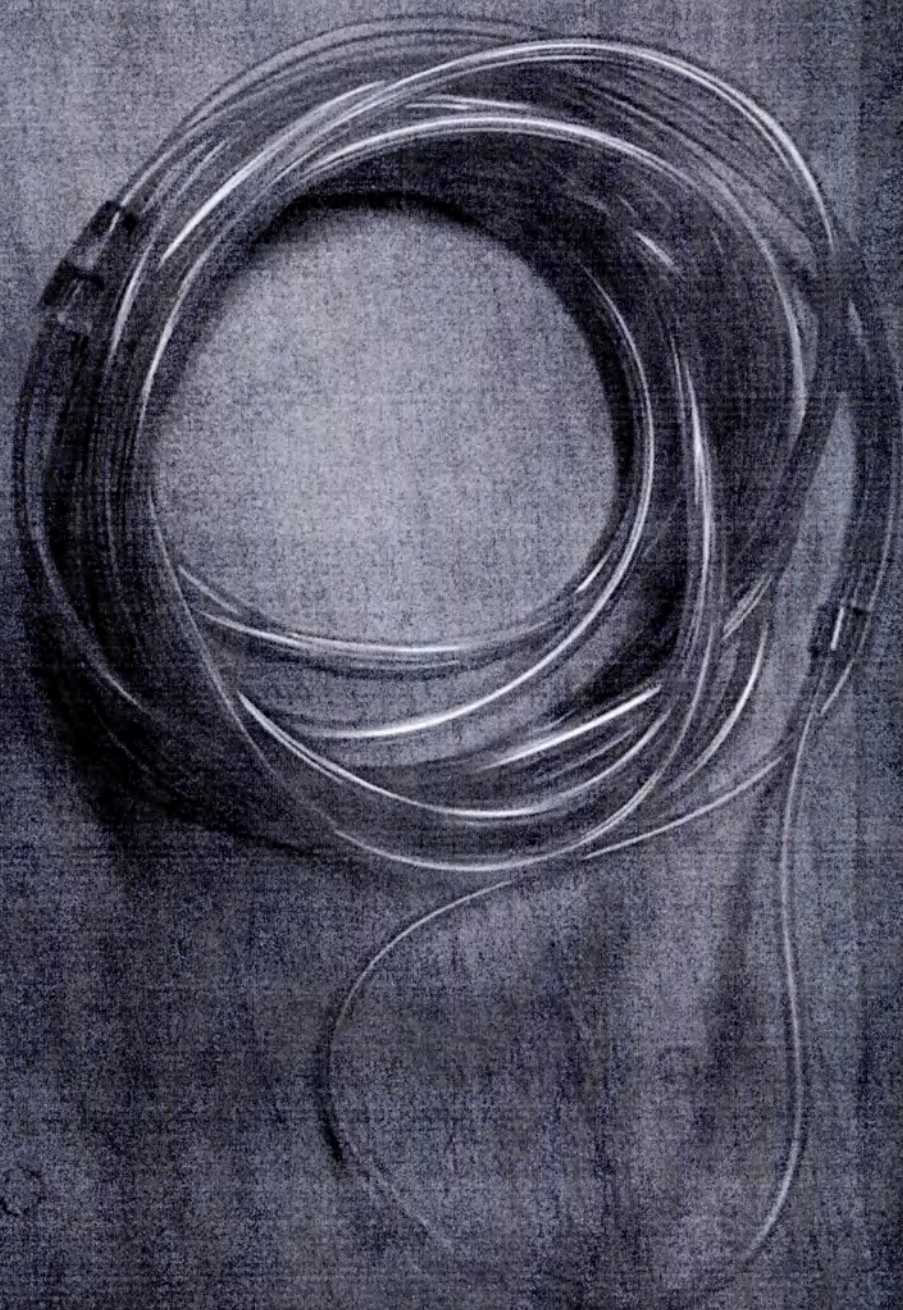


Рис. 2.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м



Рис. 2.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

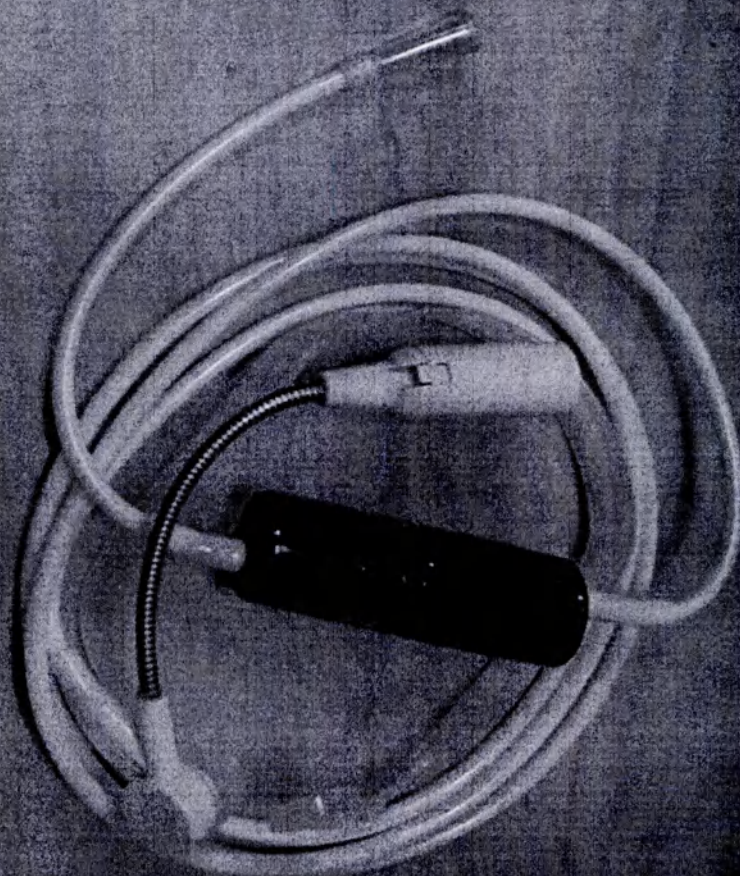


Рис. 2.1.4 – Диффузор (2 шт.)

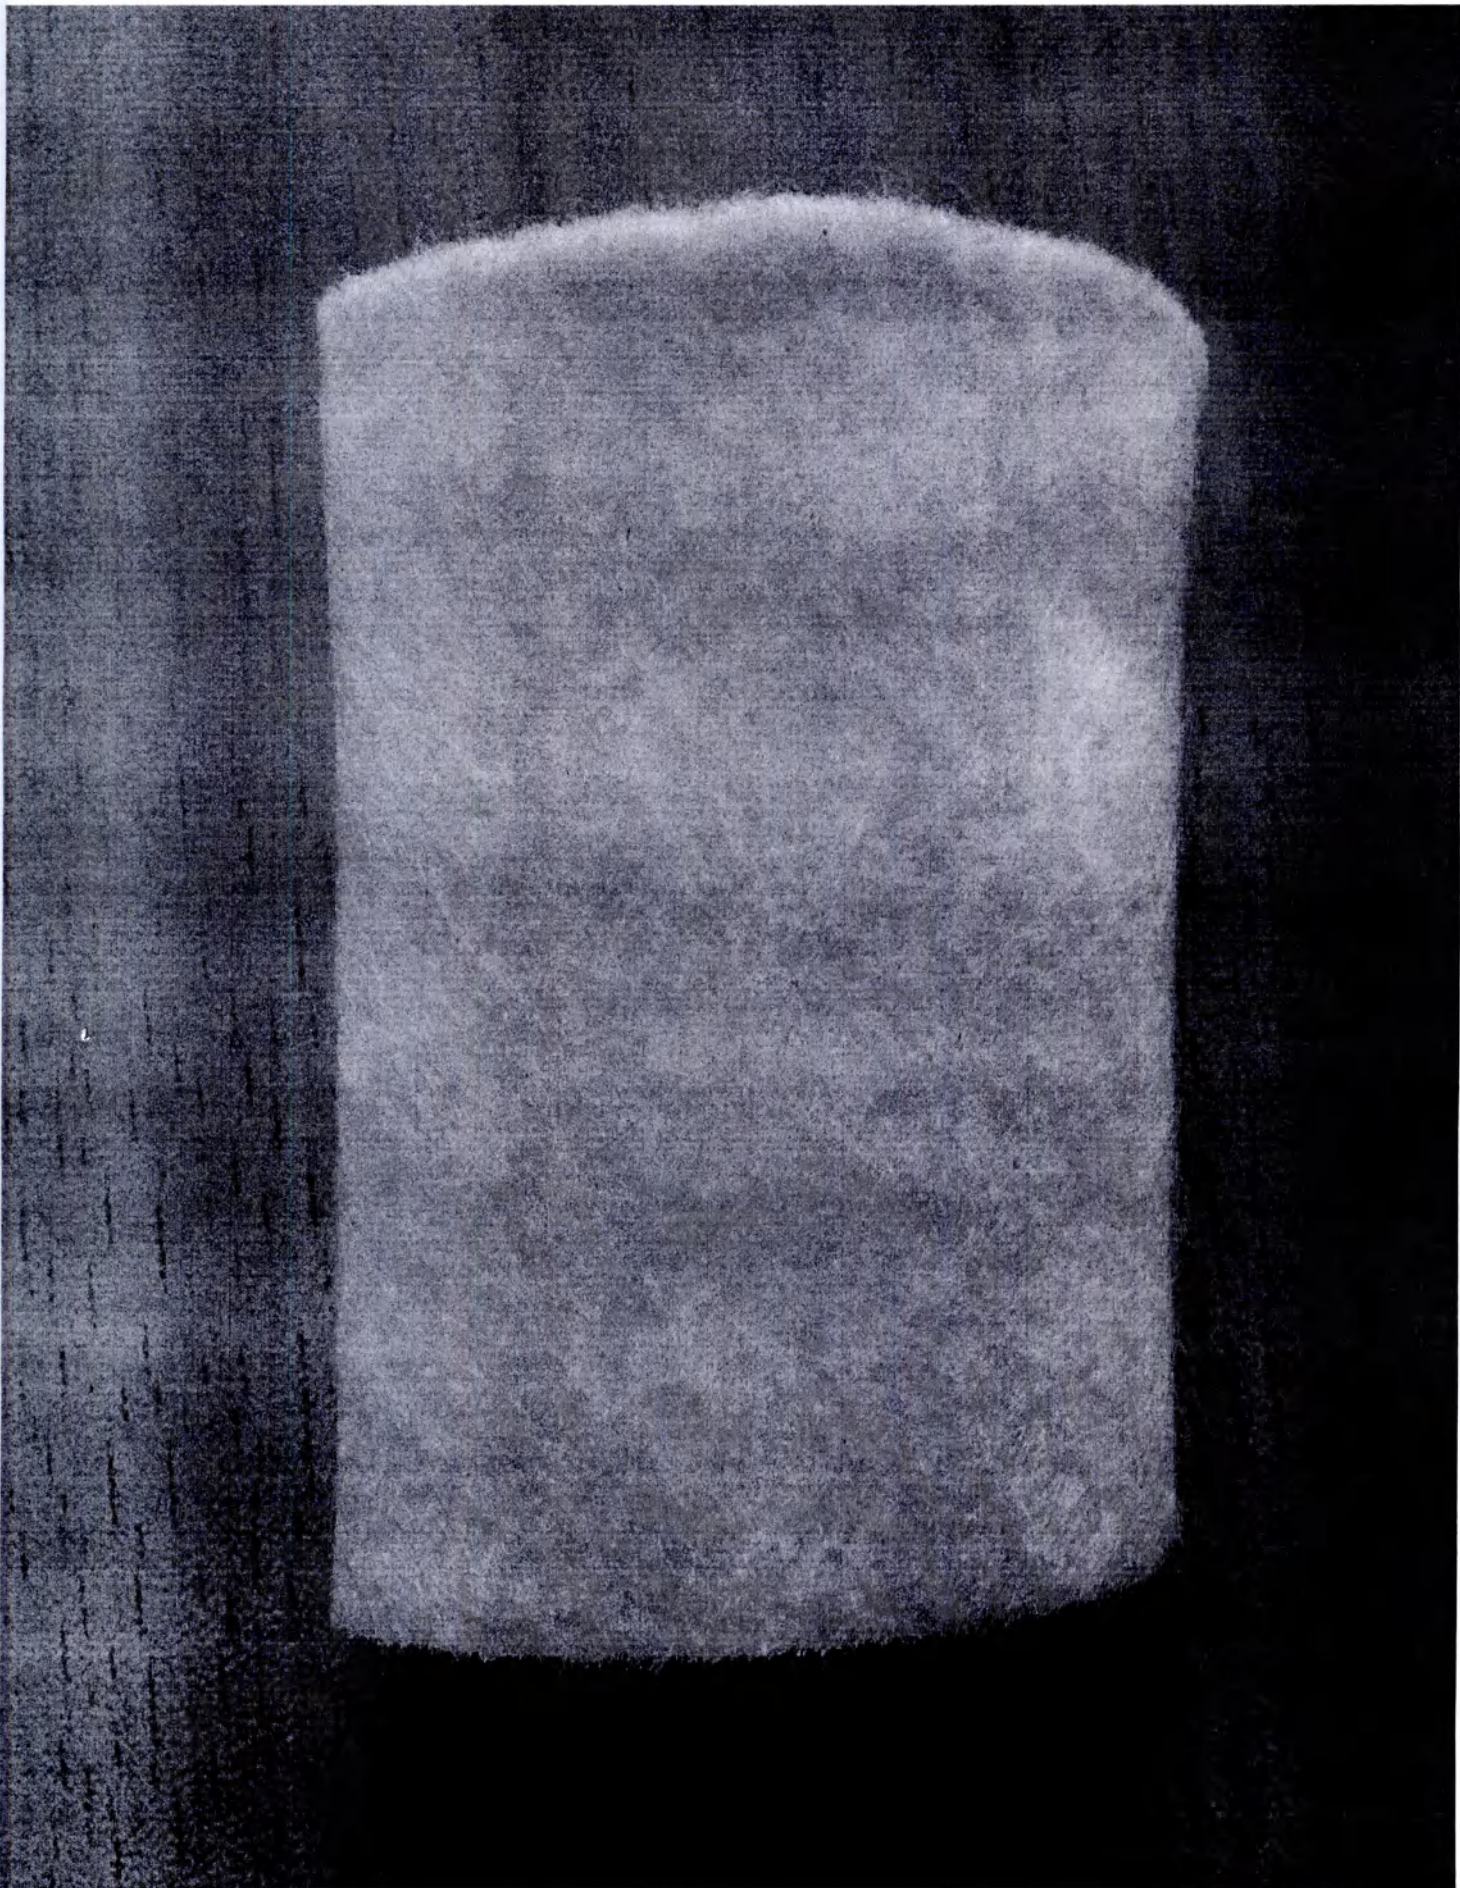


Рис. 2.2.1 – Фильтр тонкой очистки

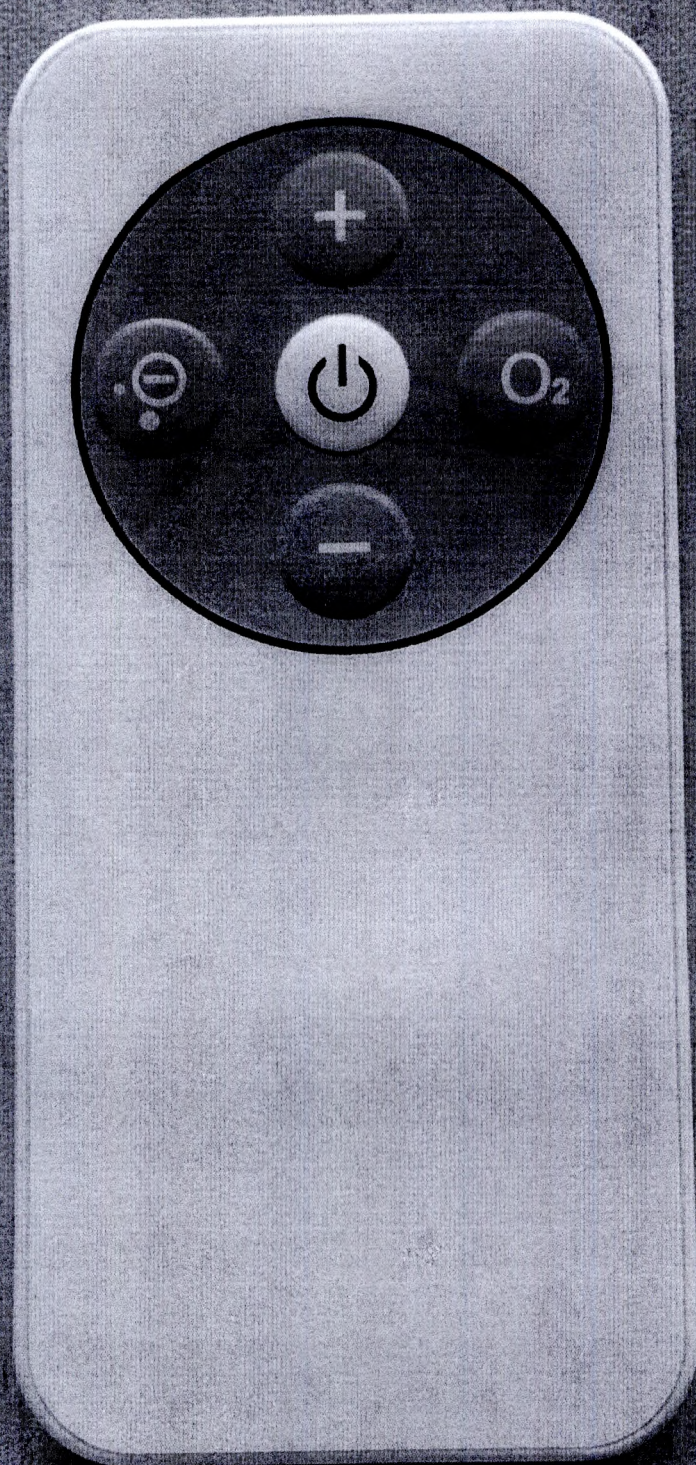


Рис. 2.2.2 – Пульт ДУ

3. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения YU600

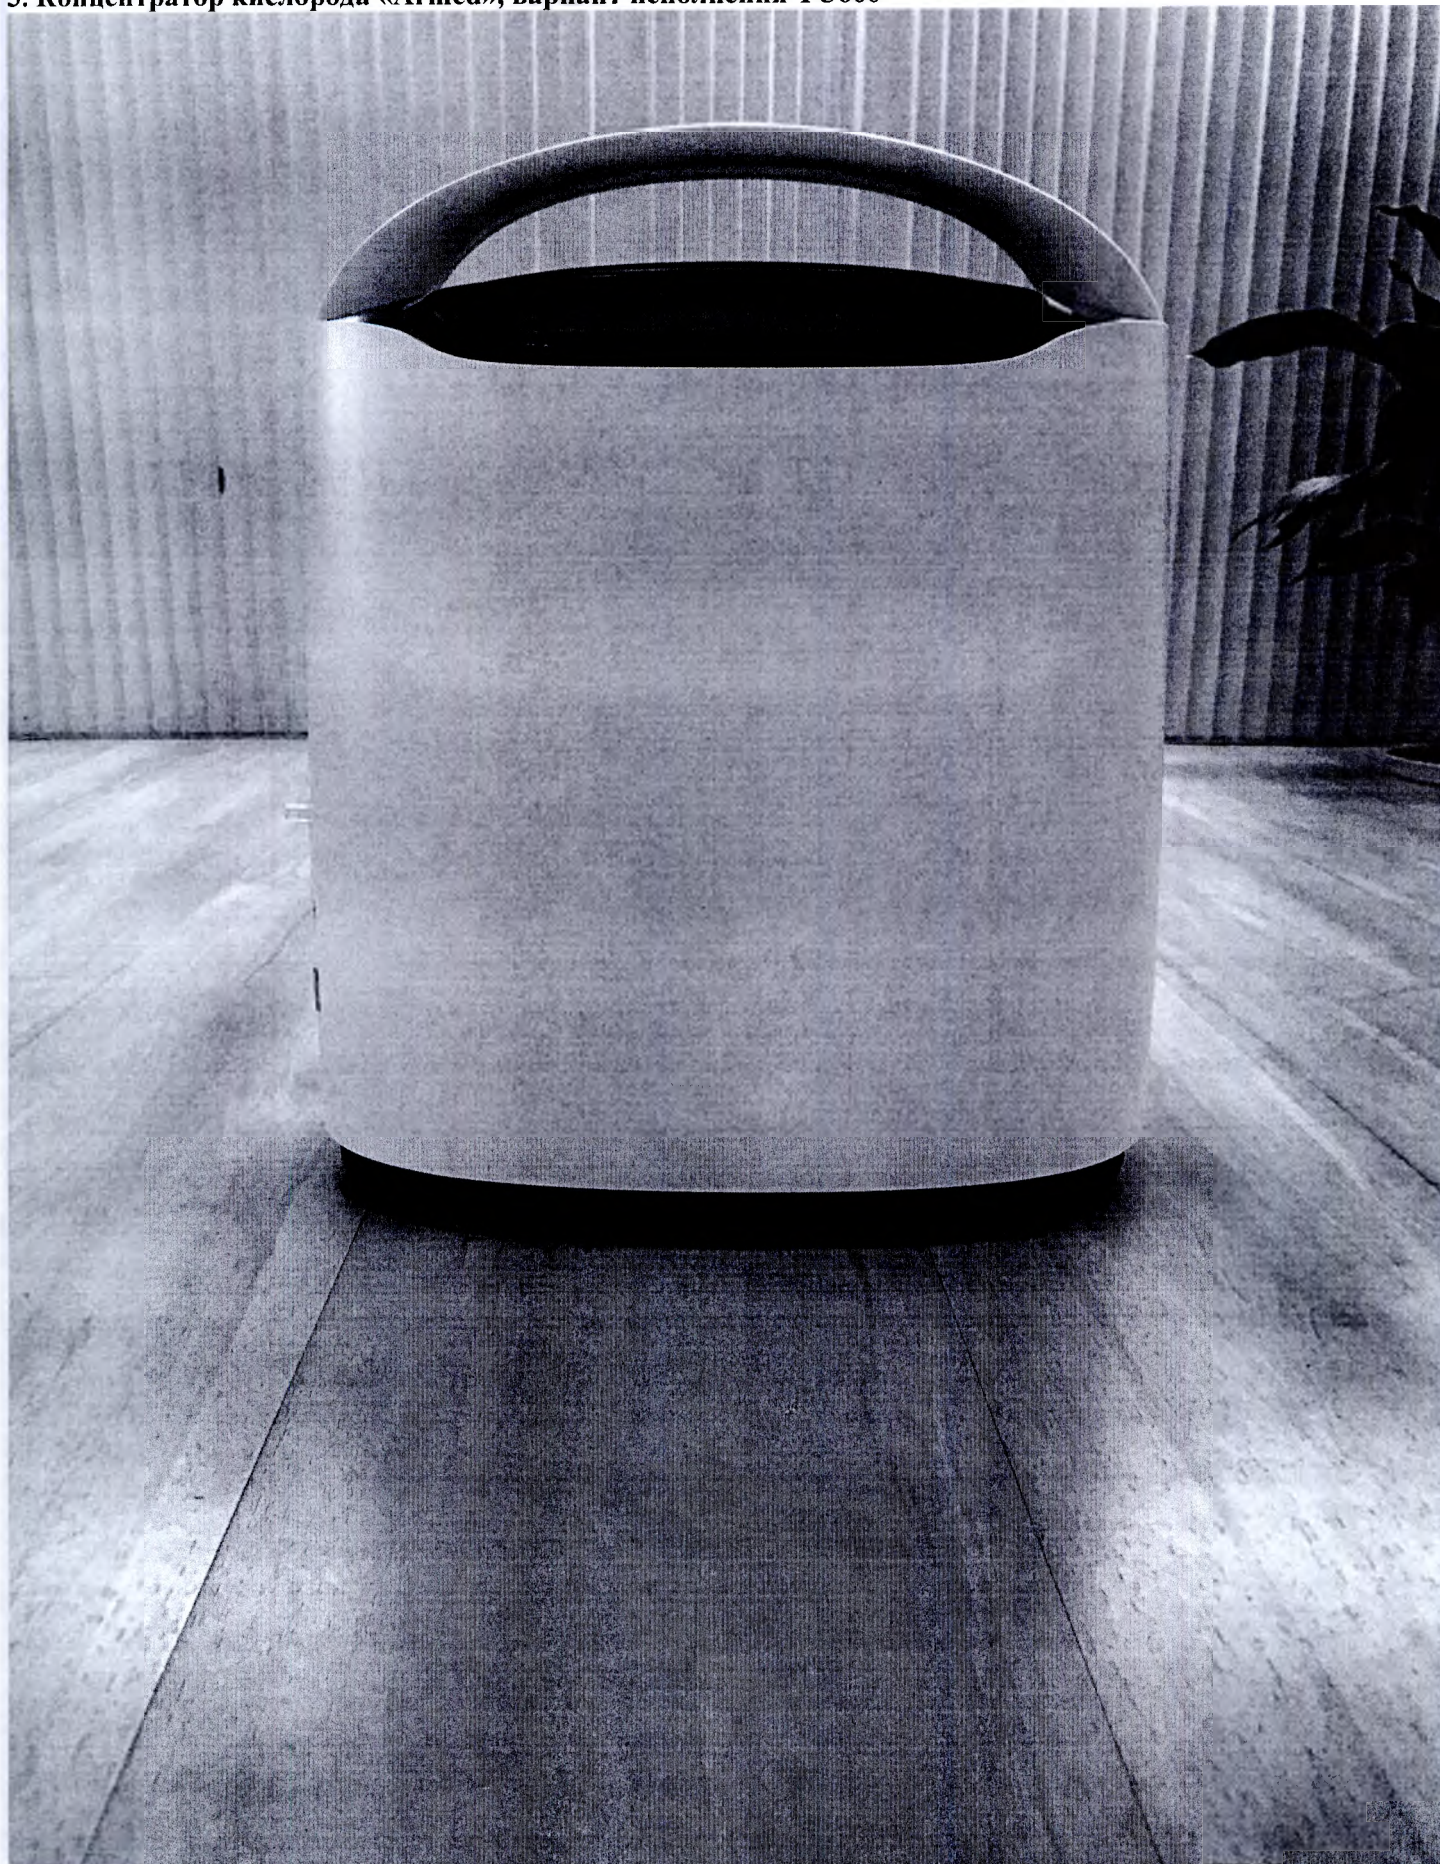


Рис. 3.1.1 – Концентратор кислорода

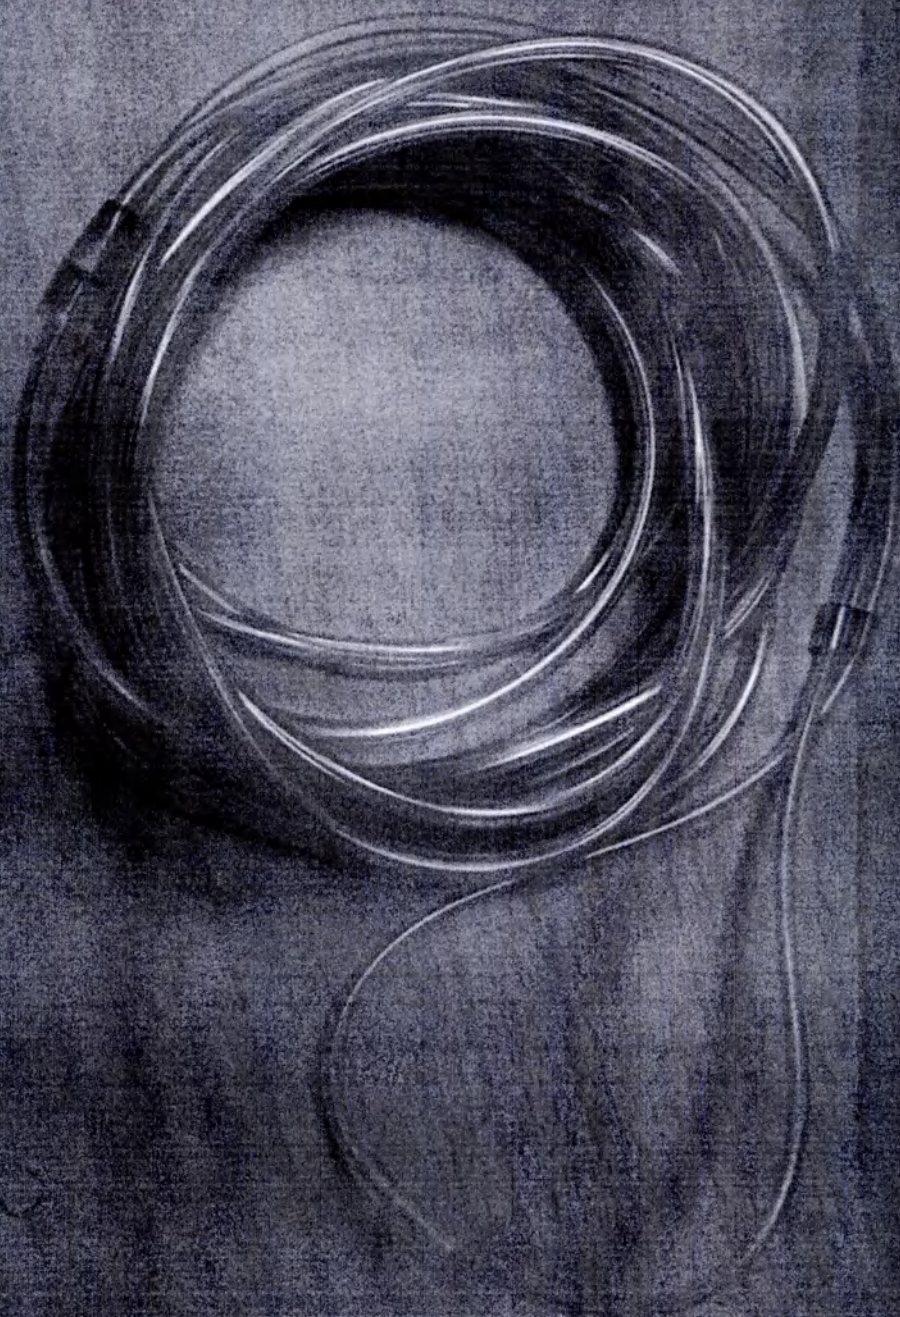


Рис. 3.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м



Рис. 3.1.3 -- Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

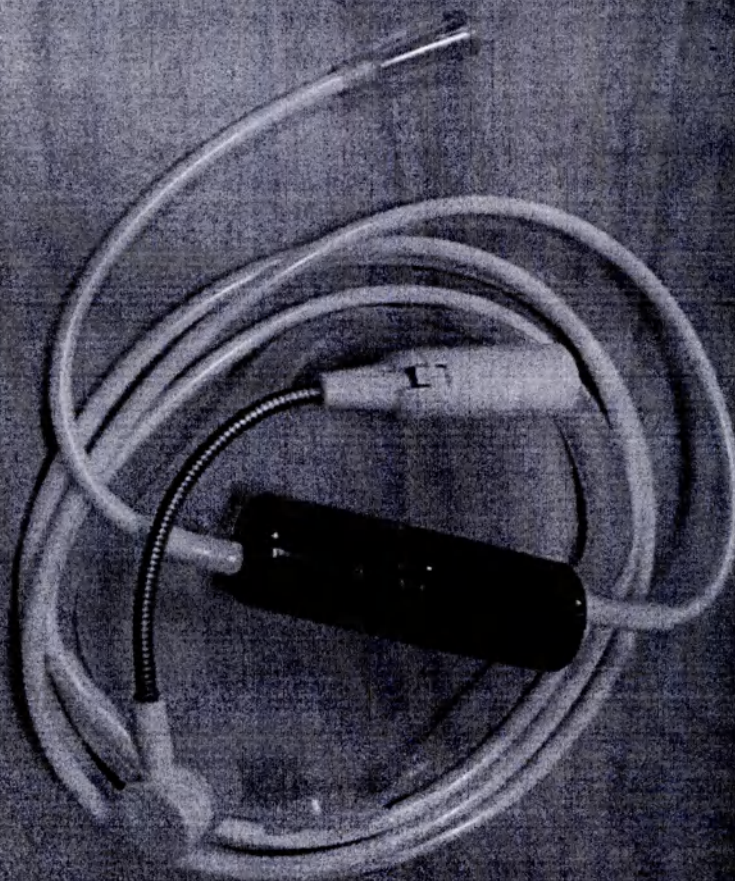


Рис. 3.1.4 – Диффузор (2 шт.)

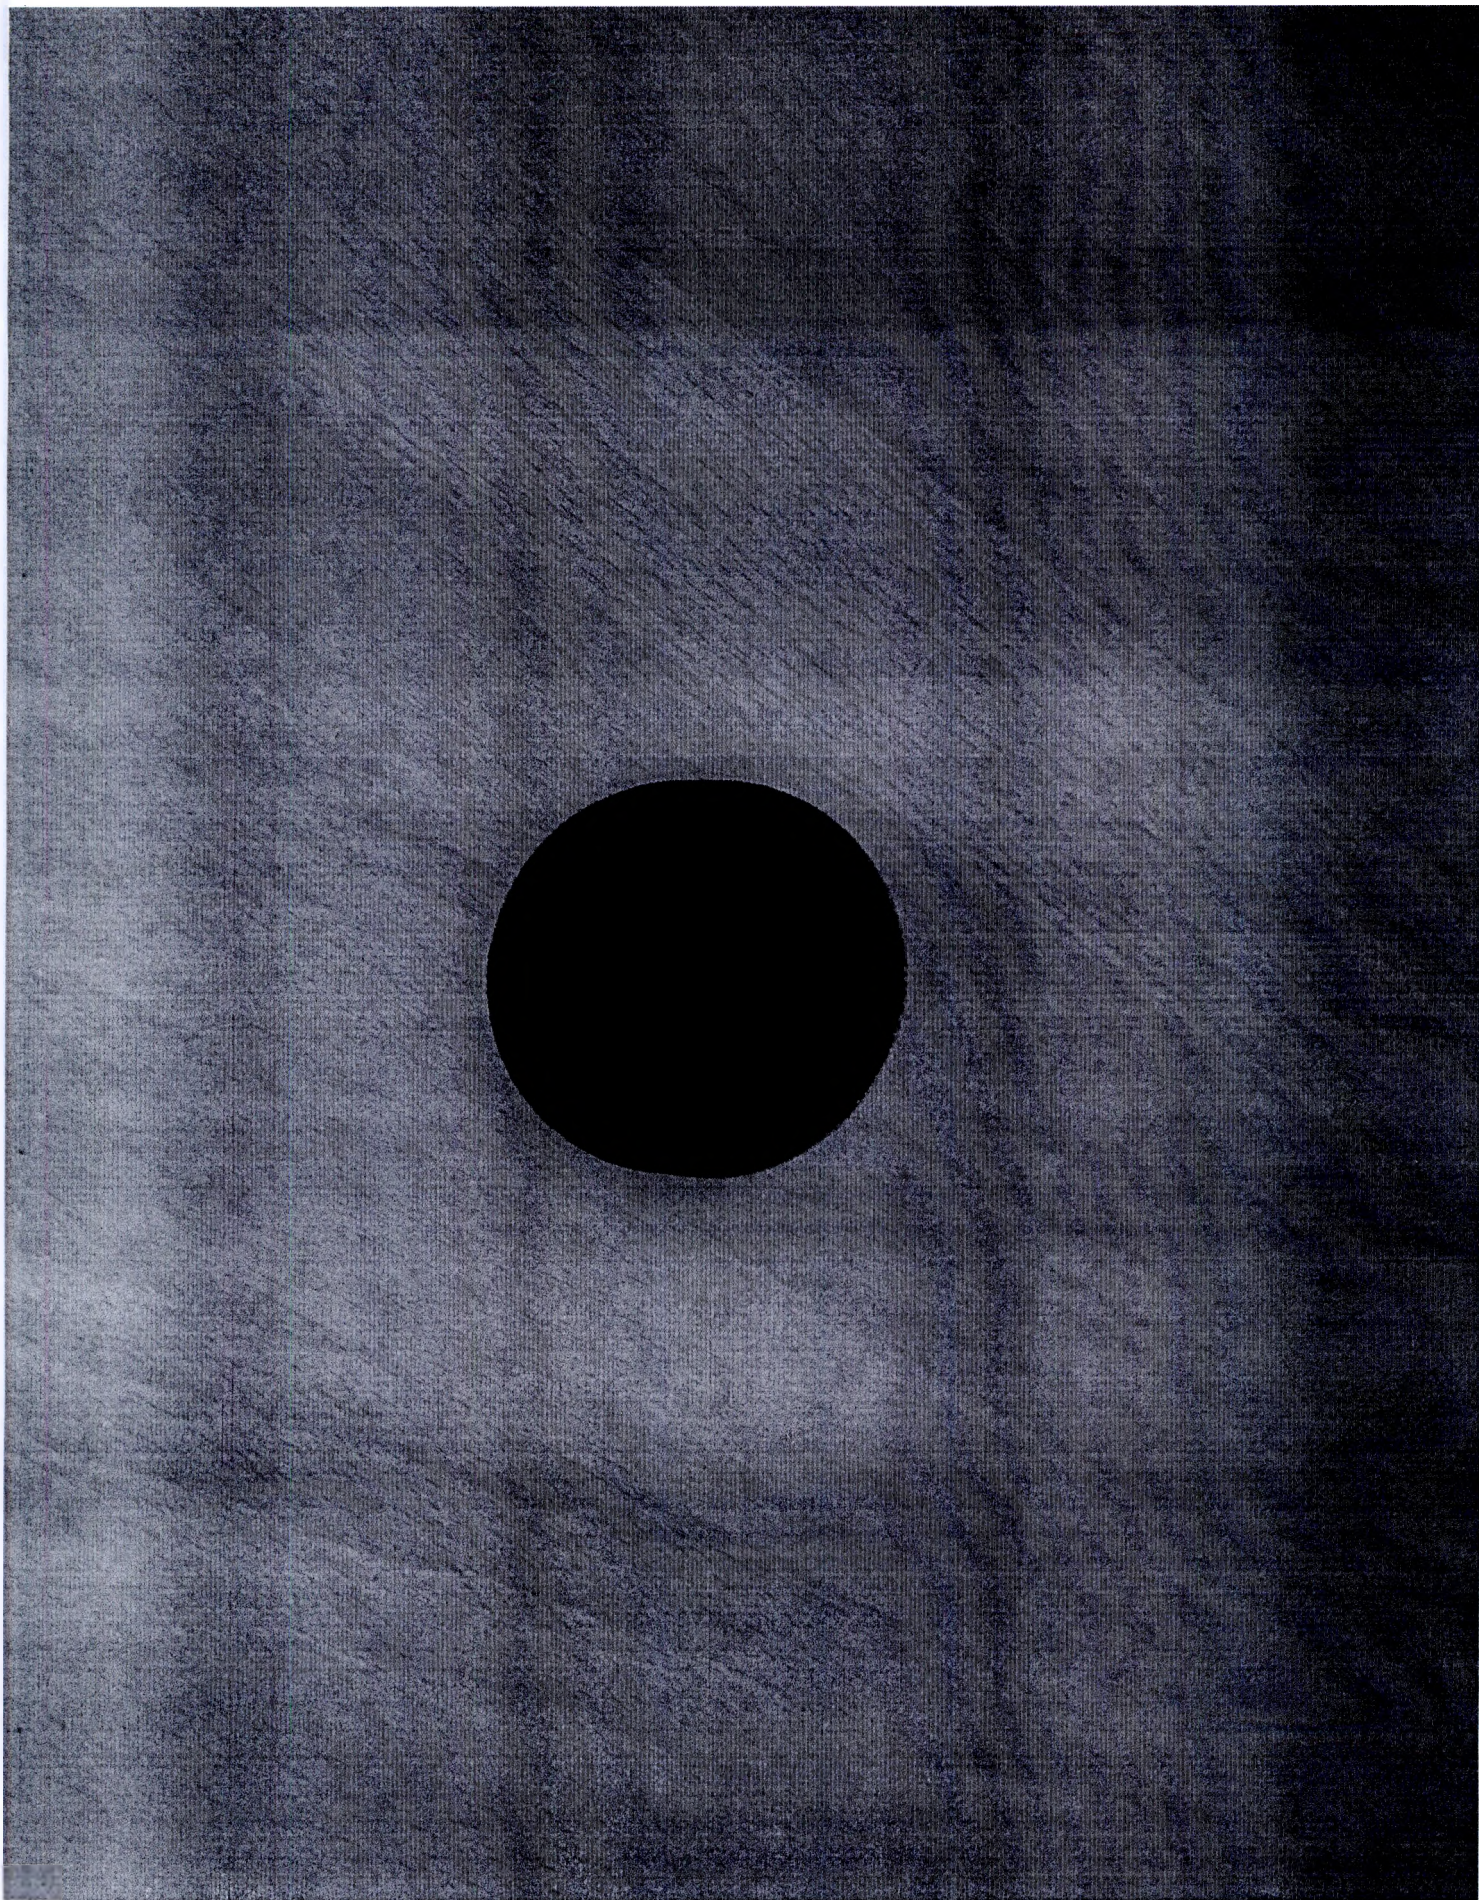


Рис. 3.2.1 – Фильтр губчатый

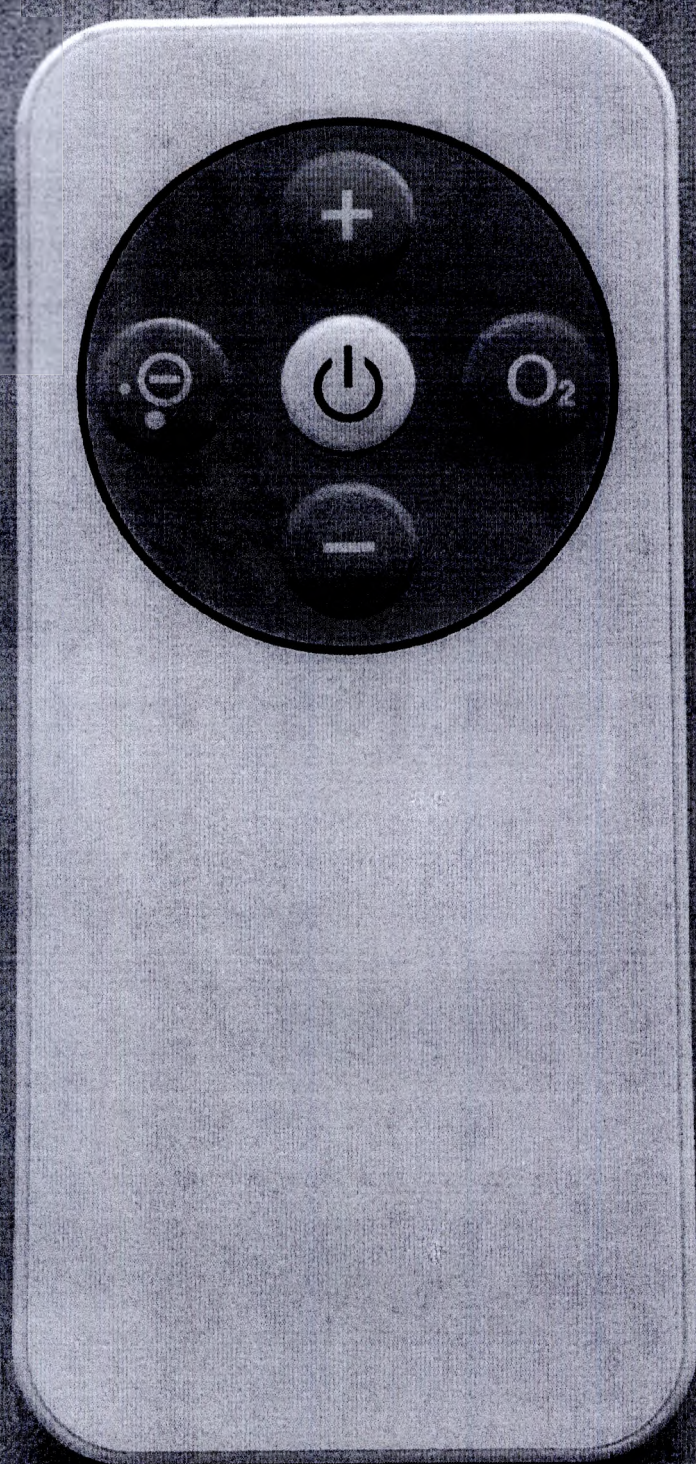


Рис. 3.2.2 – Пульт ДУ

4. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3W

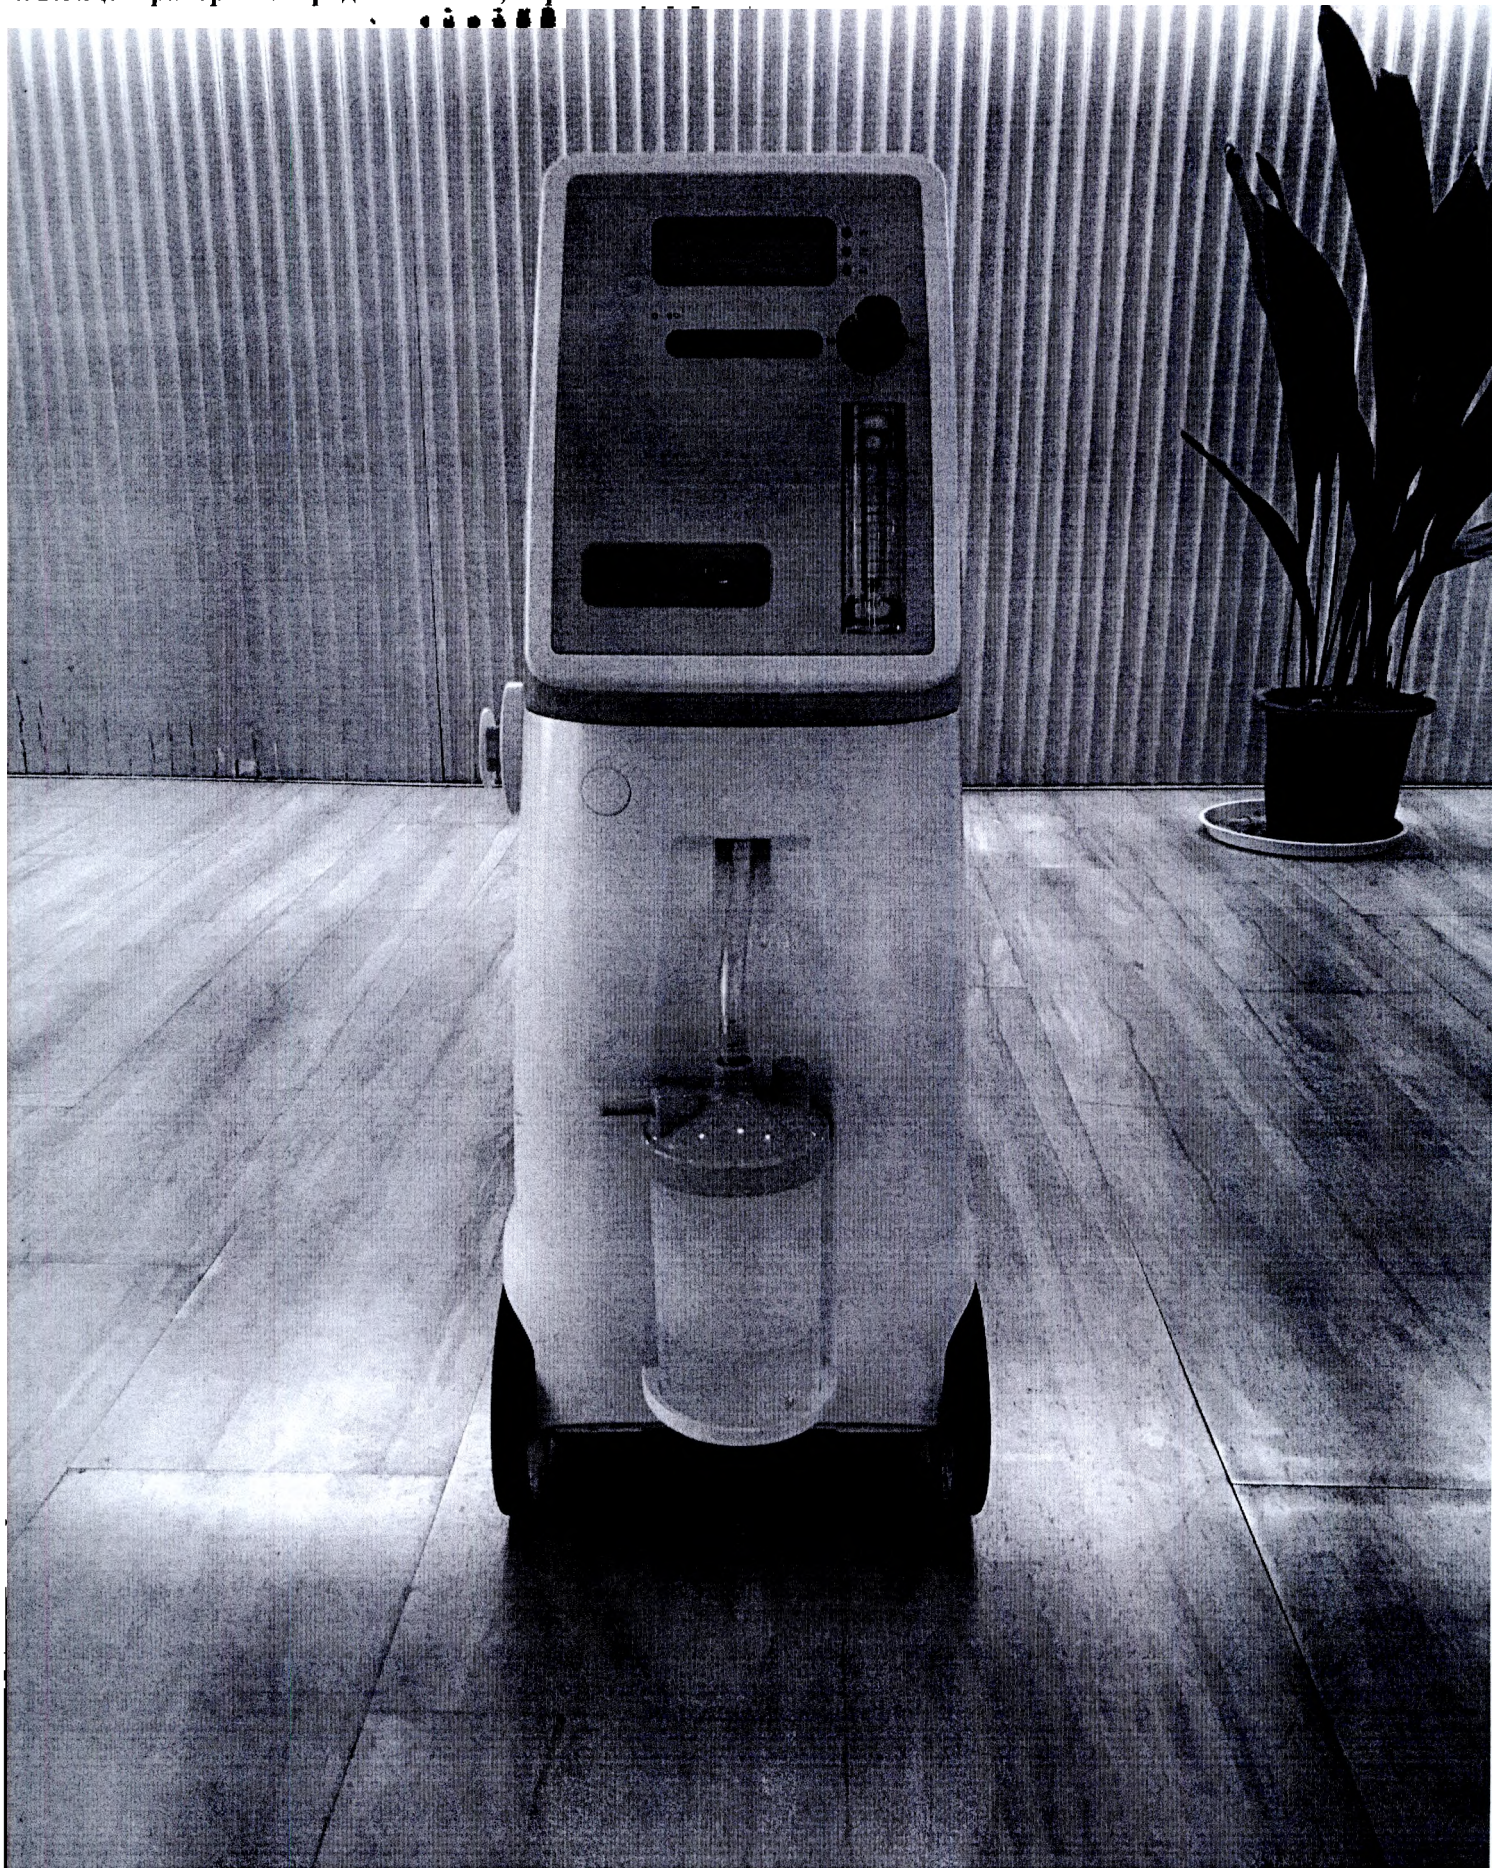


Рис. 4.1.1 – Концентратор кислорода

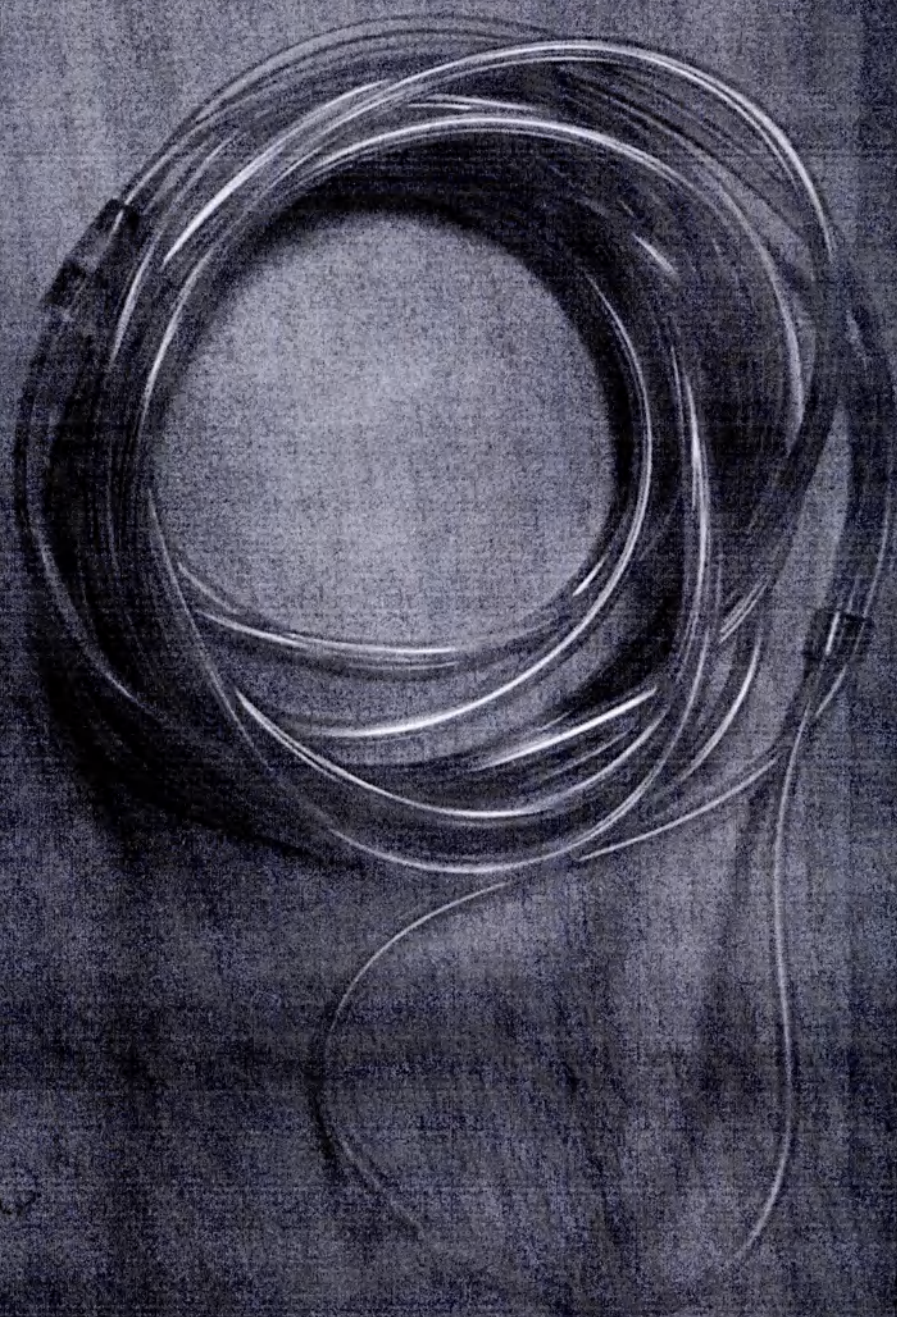


Рис. 4.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

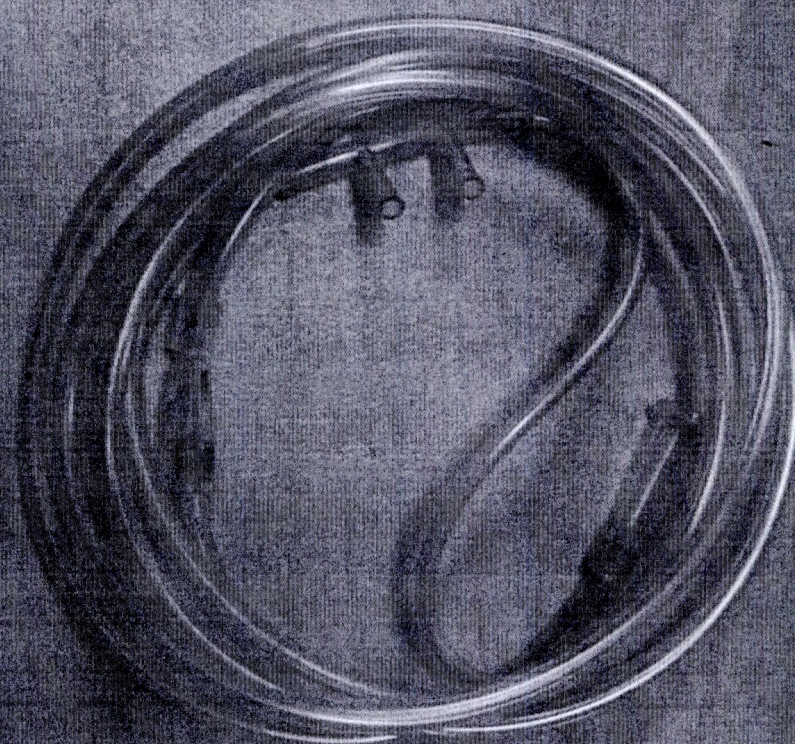


Рис. 4.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м



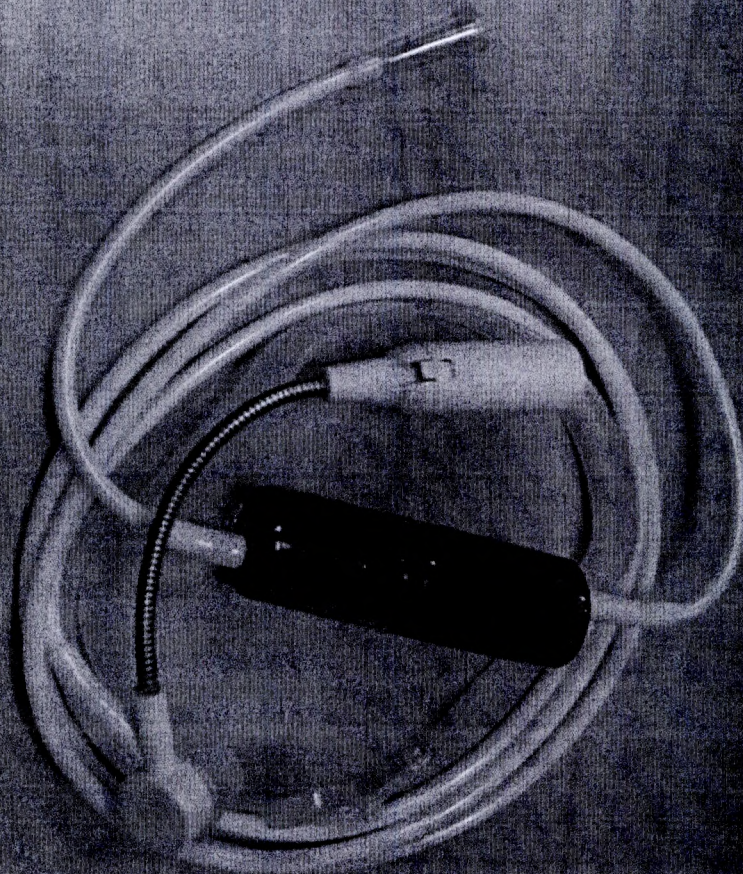


Рис. 4.1.4 – Диффузор (2 шт.)

Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м

Мундштук

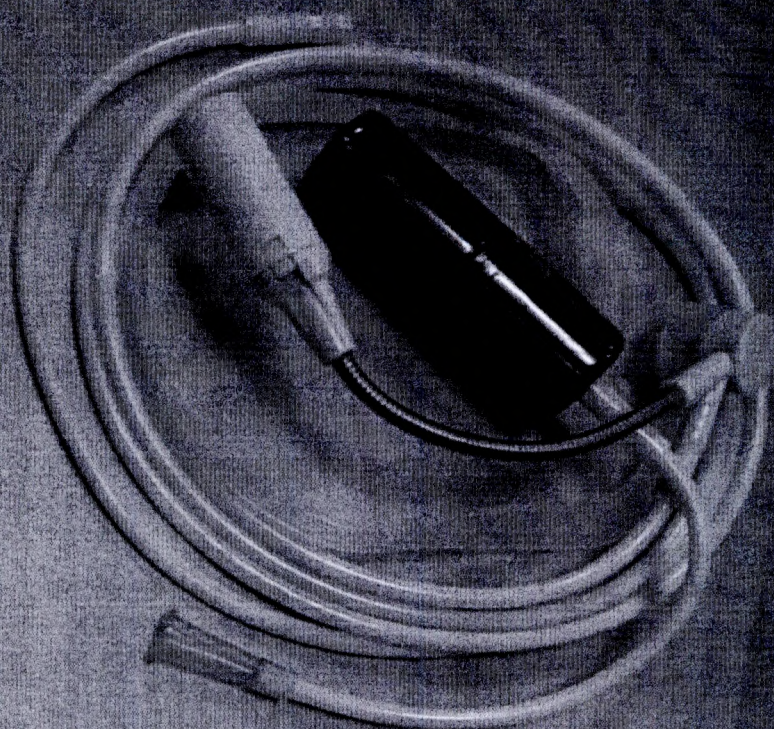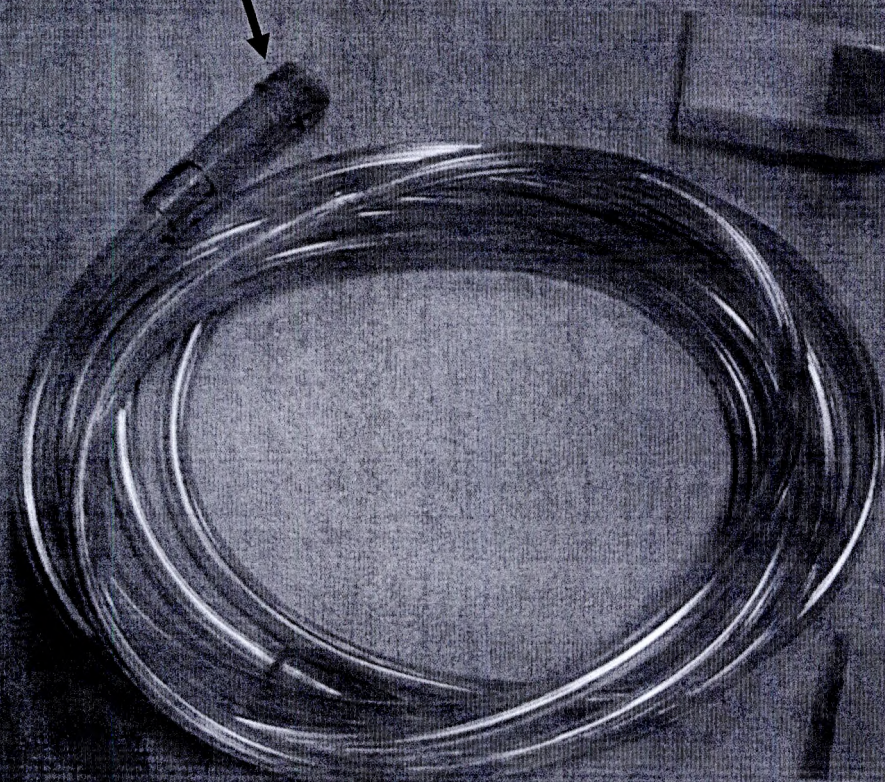

Резервуар распылителя

Рис. 4.1.5 – Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

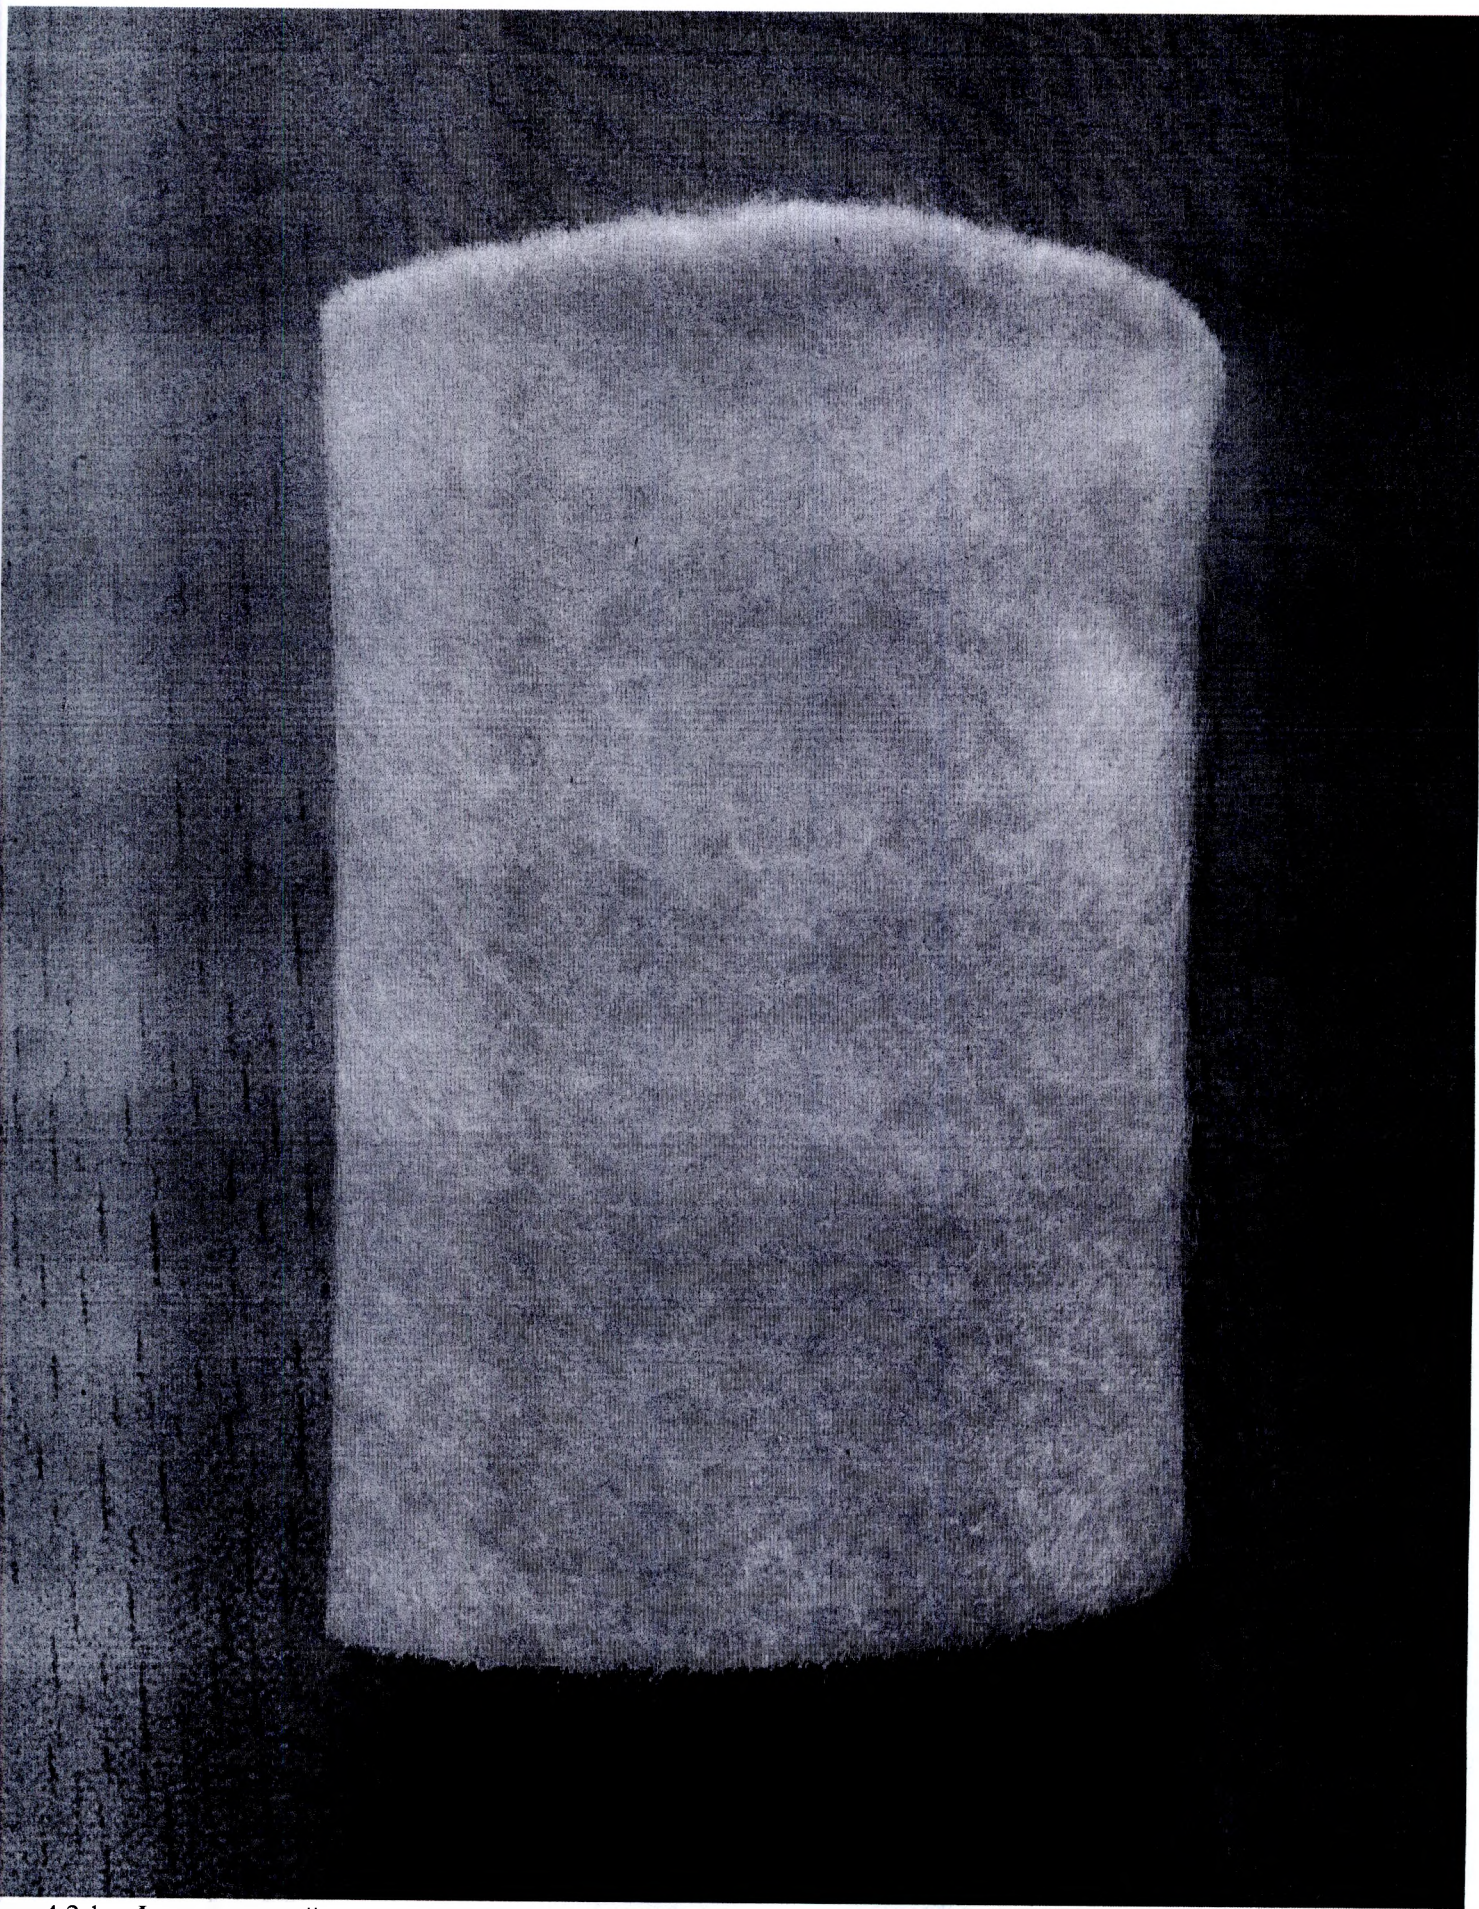


Рис. 4.2.1 – Фильтр тонкой очистки

5. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5W

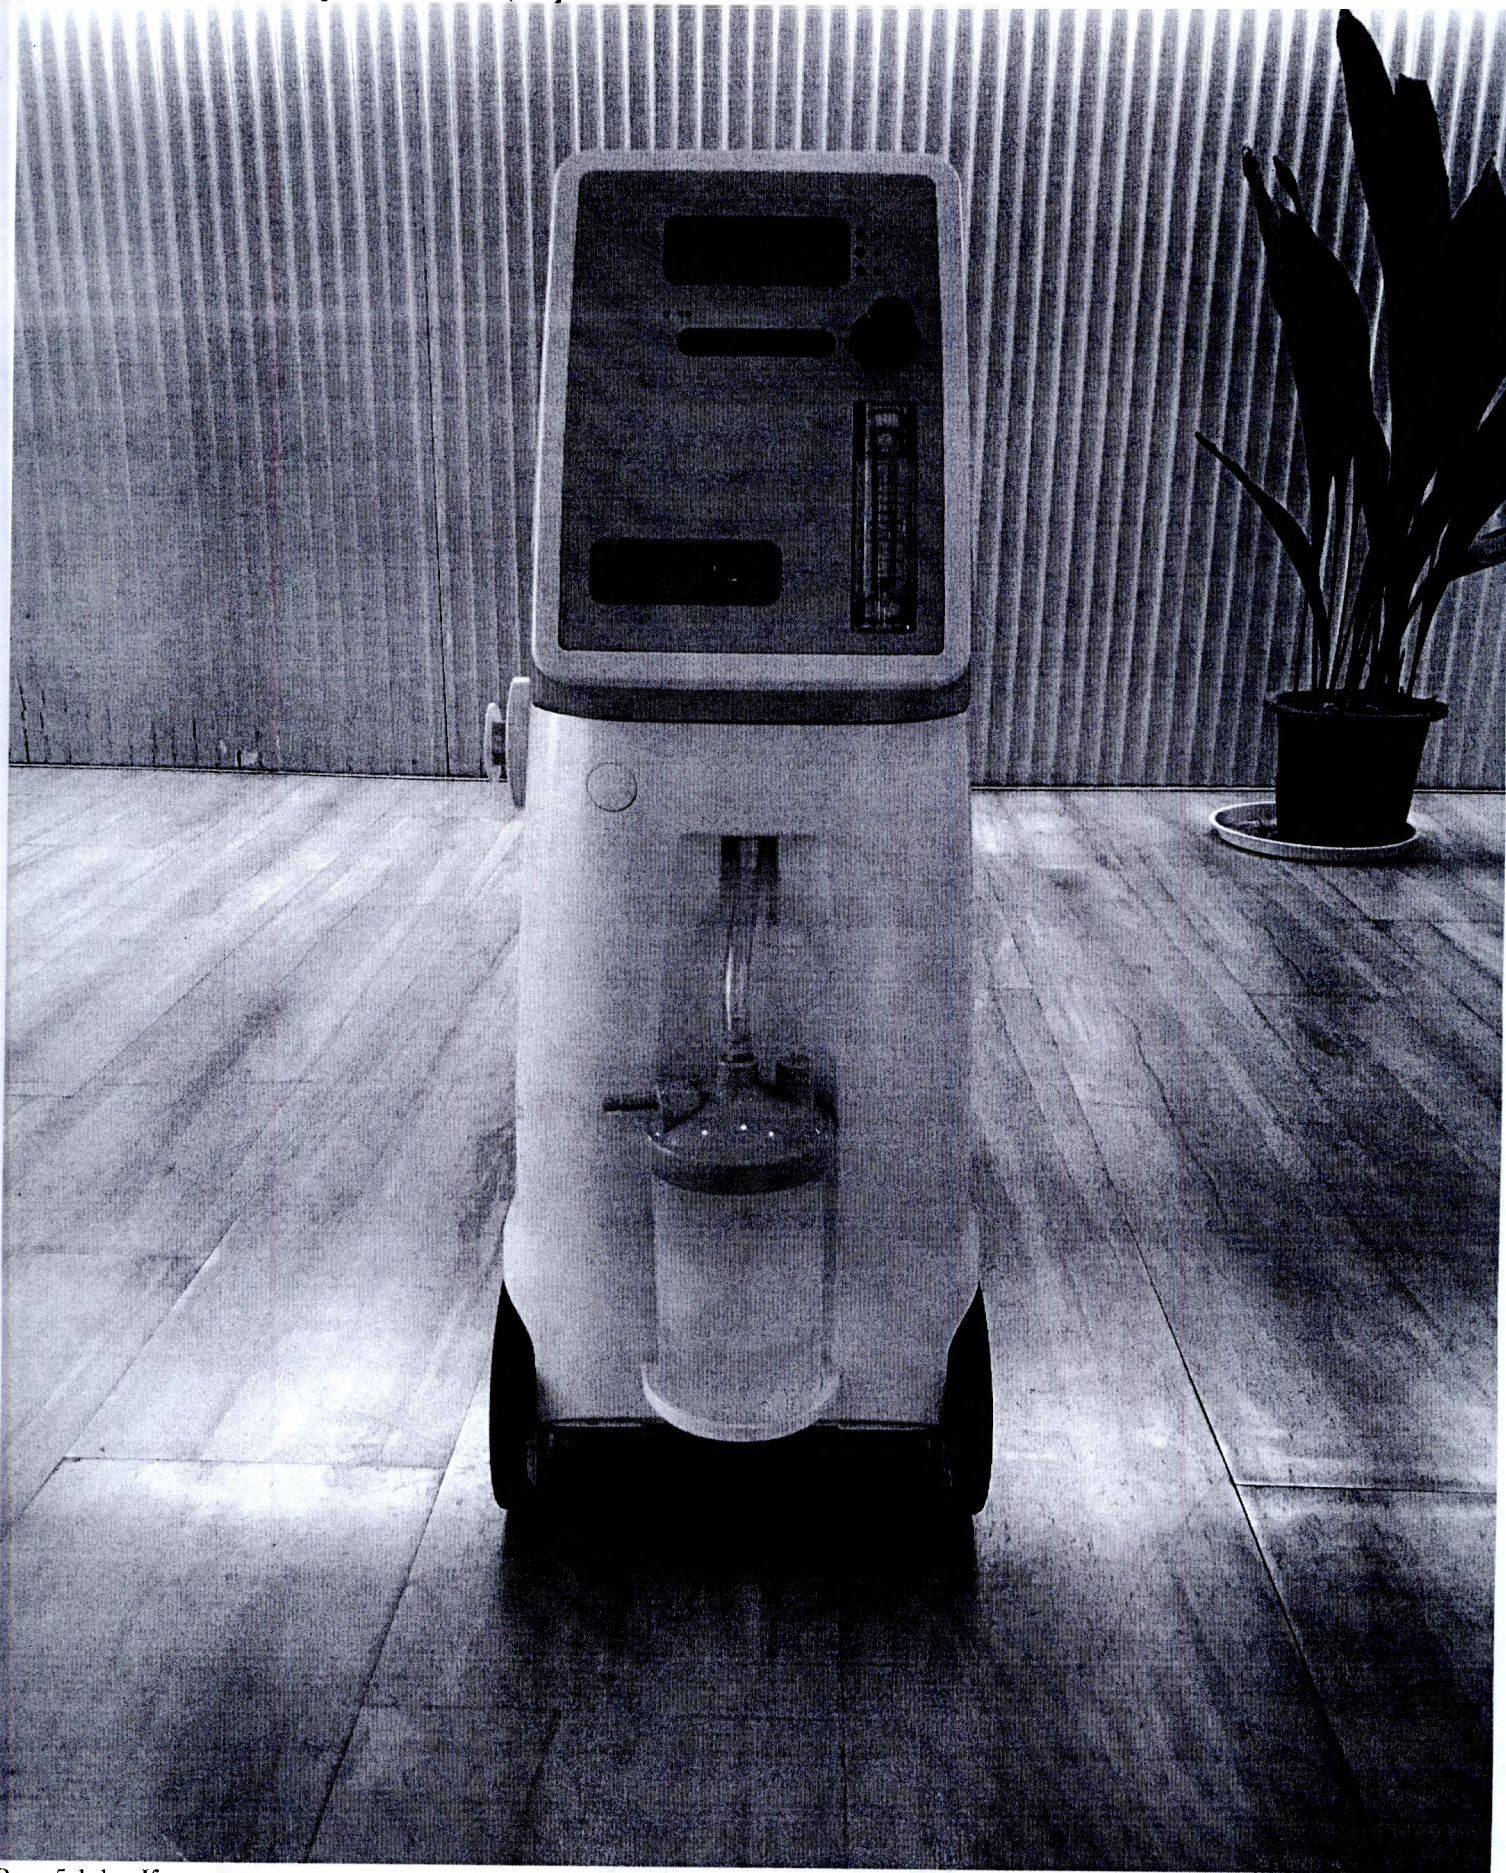


Рис. 5.1.1 – Концентратор кислорода

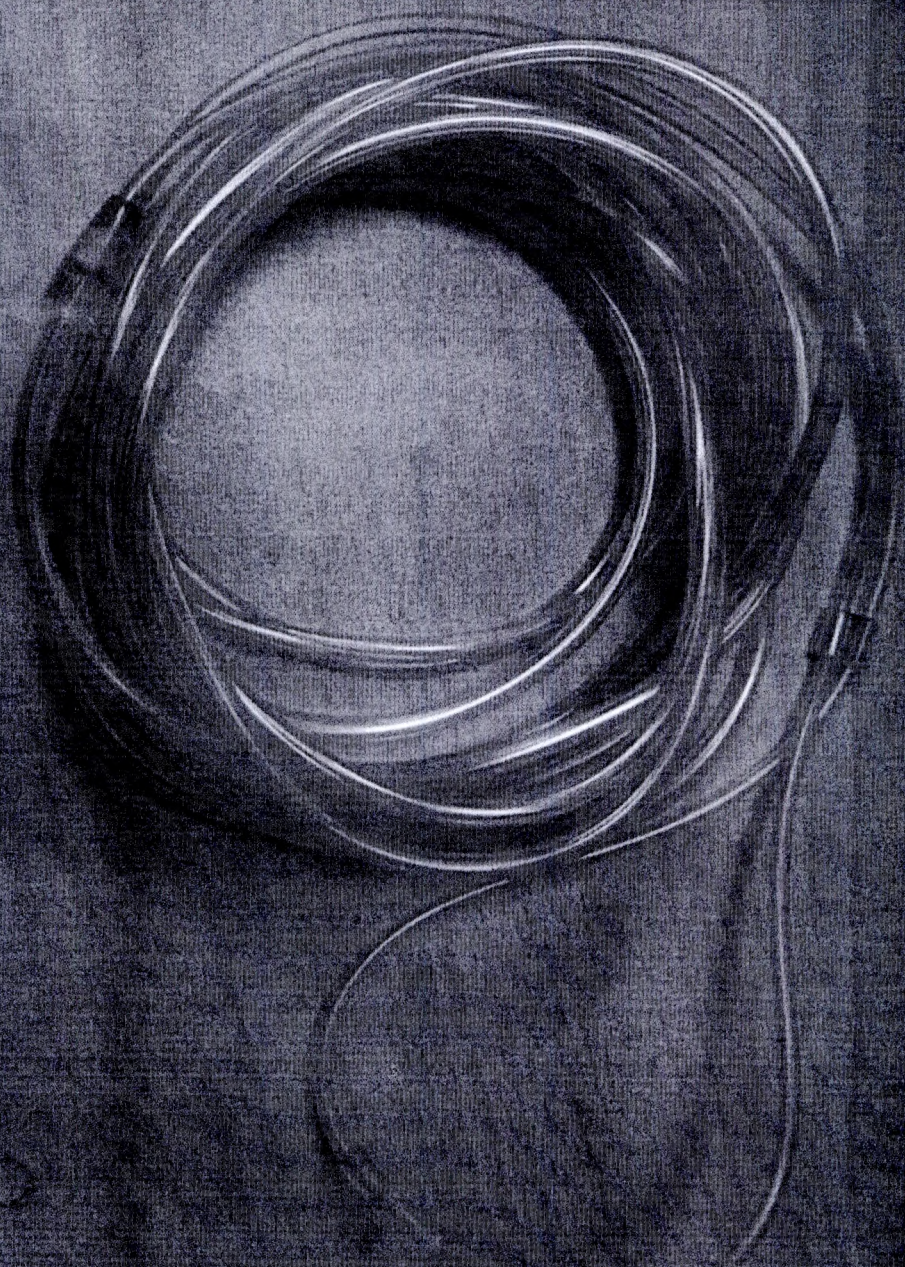


Рис. 5.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м



Рис. 5.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м



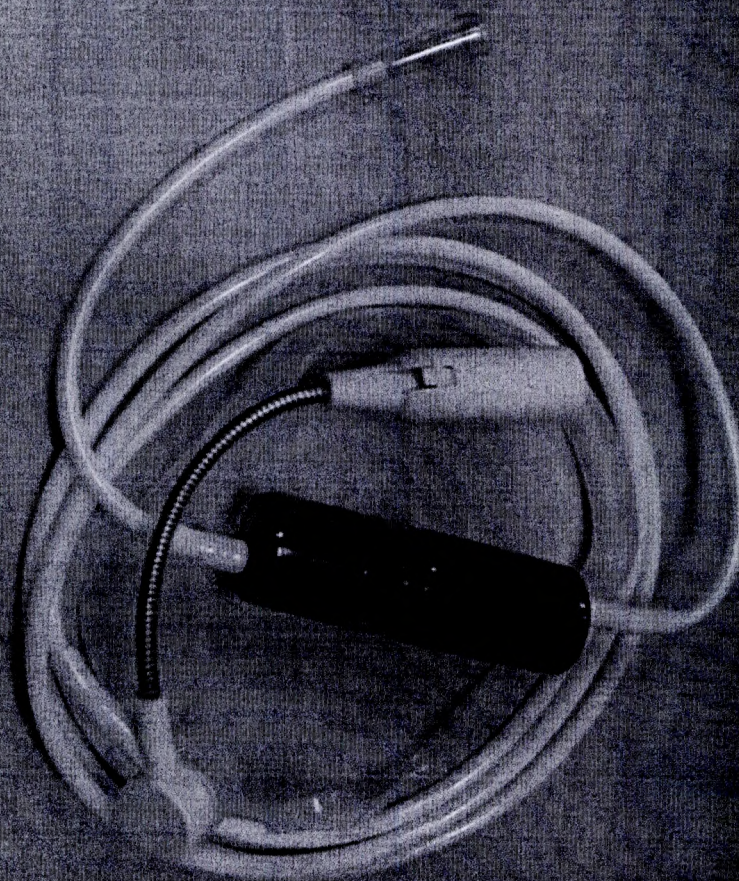


Рис. 5.1.4 – Диффузор (2 шт.)

Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м

Мундштук

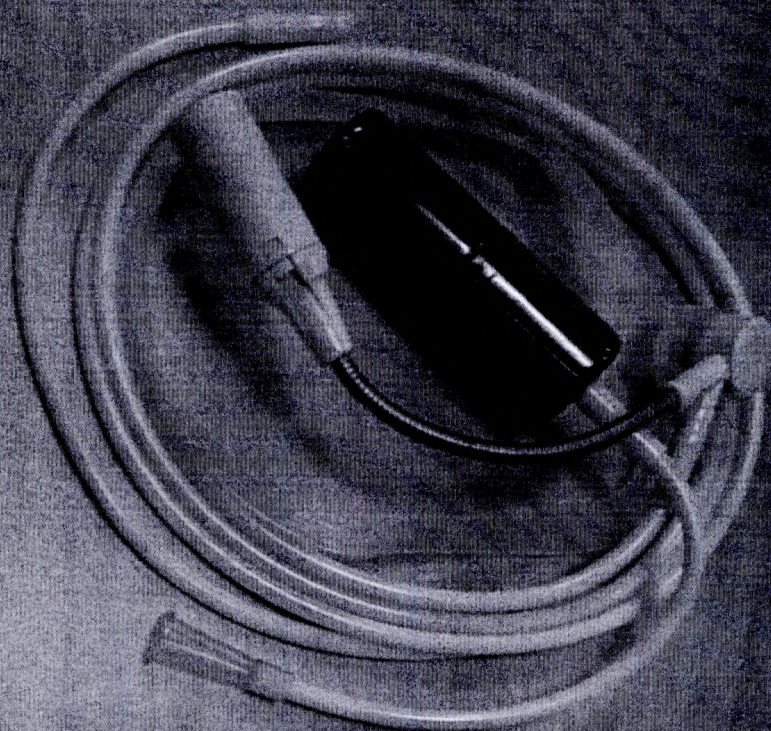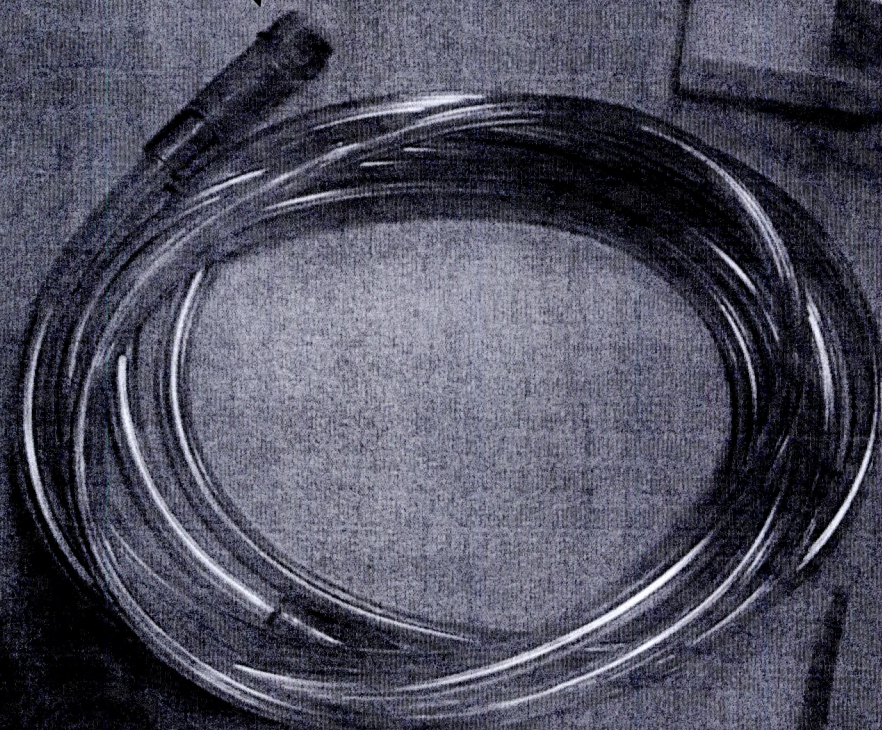

Резервуар распылителя

Рис. 5.1.5 – Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

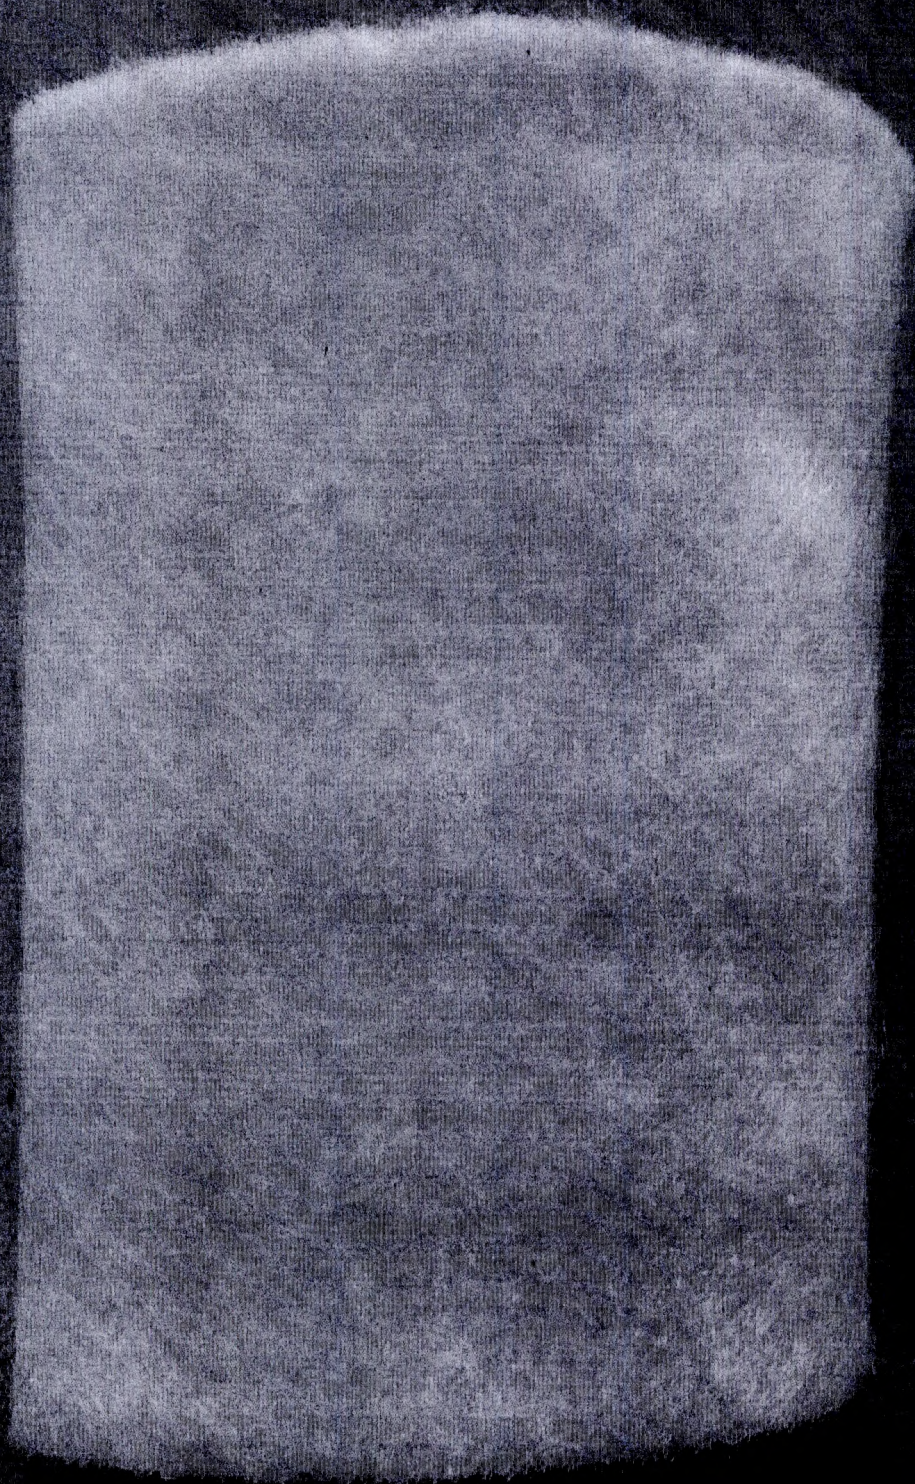


Рис. 5.2.1 – Фильтр тонкой очистки

6. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-5AW

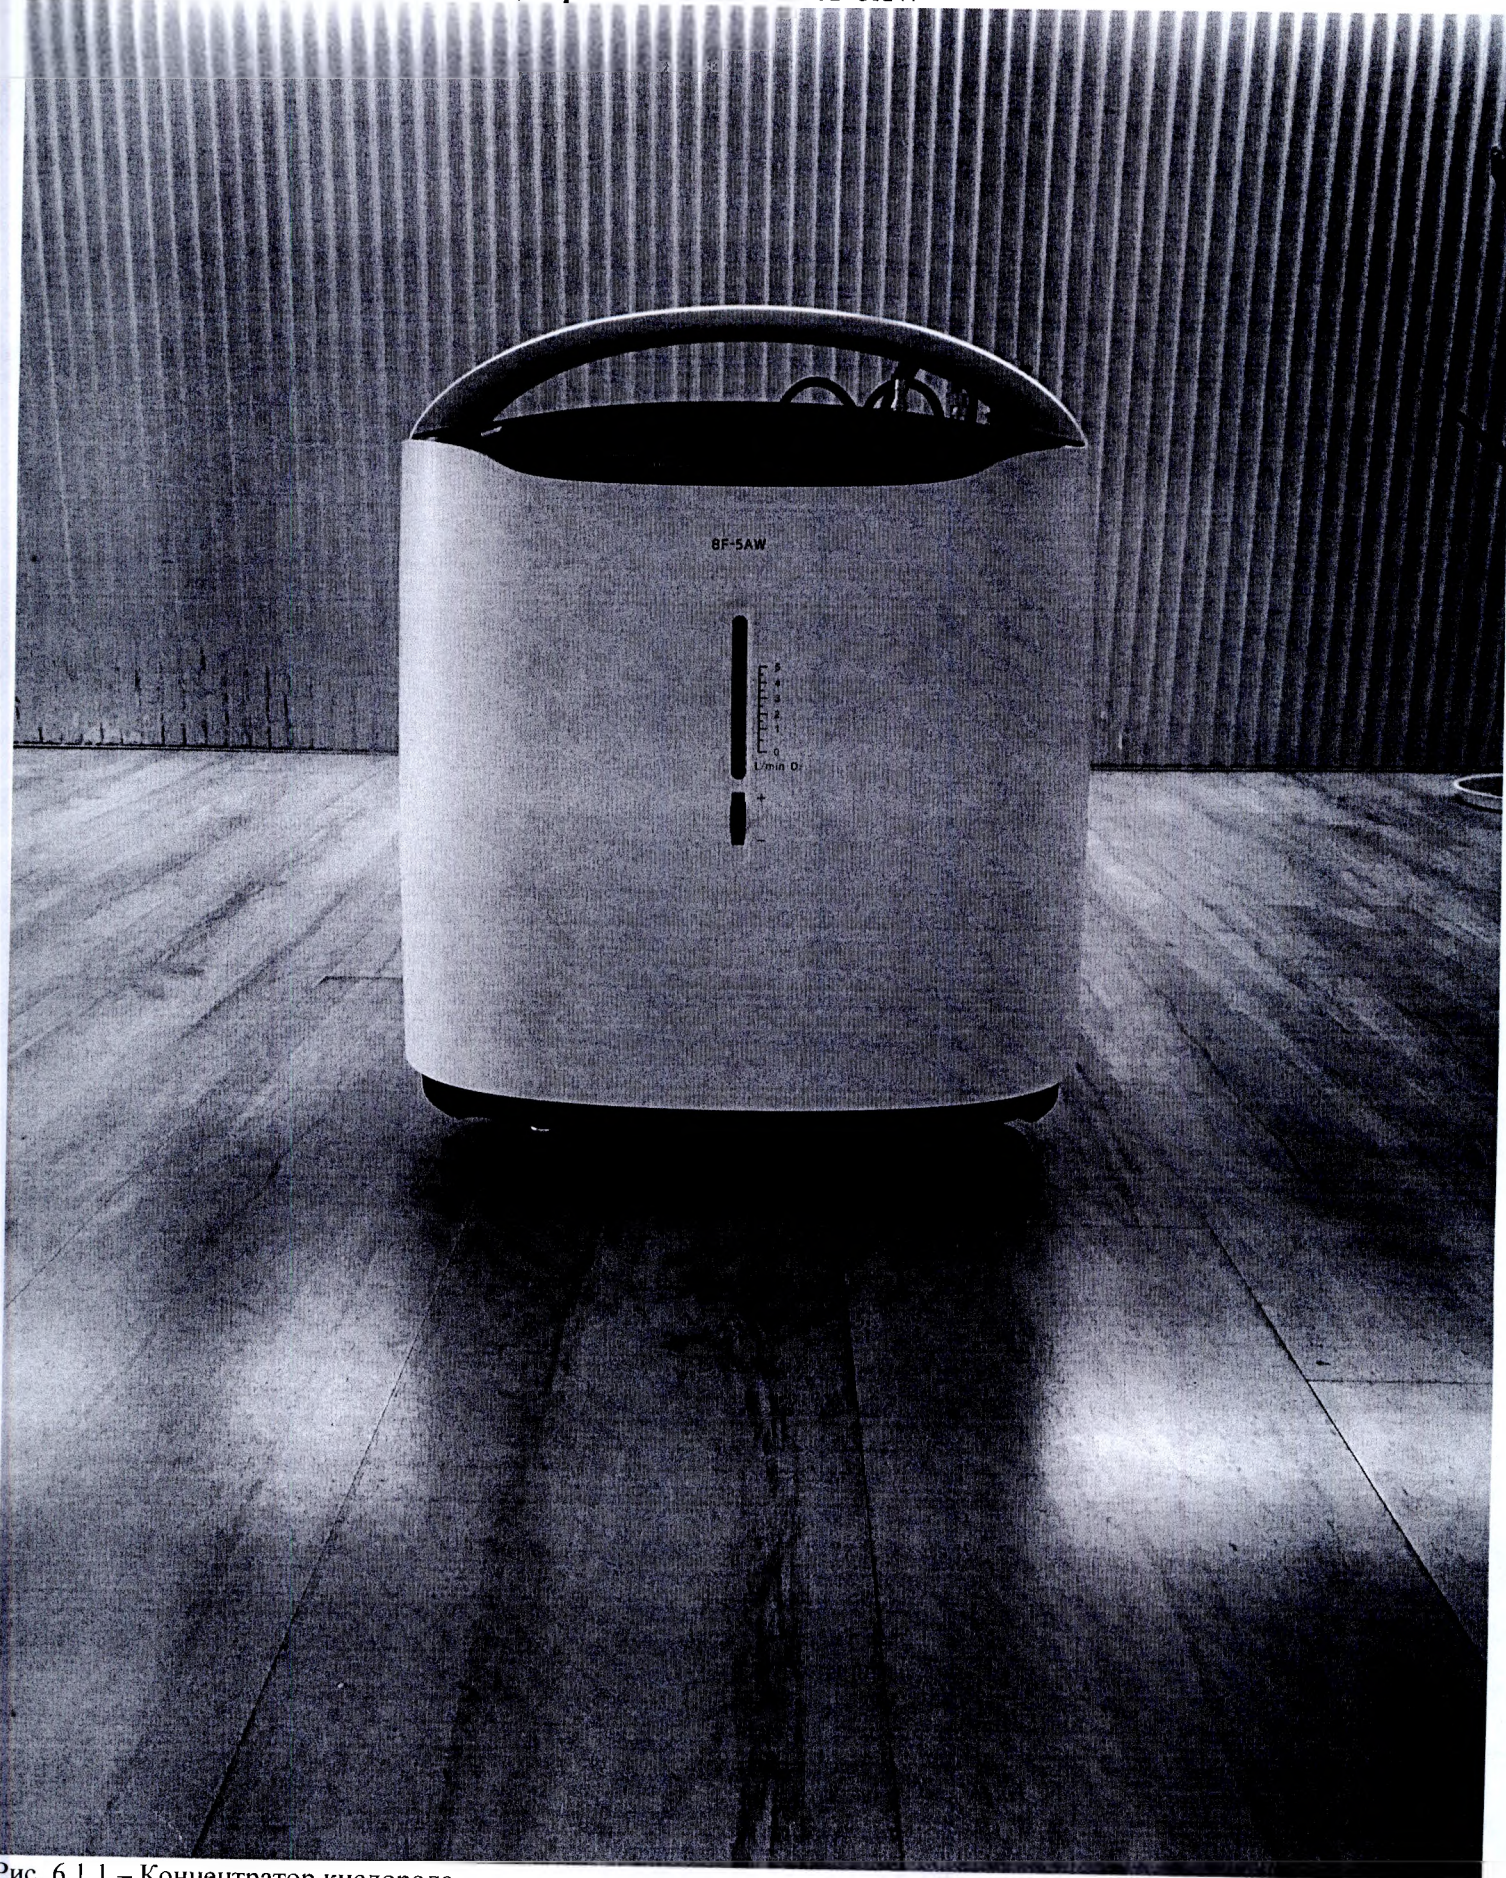


Рис. 6.1.1 – Концентратор кислорода

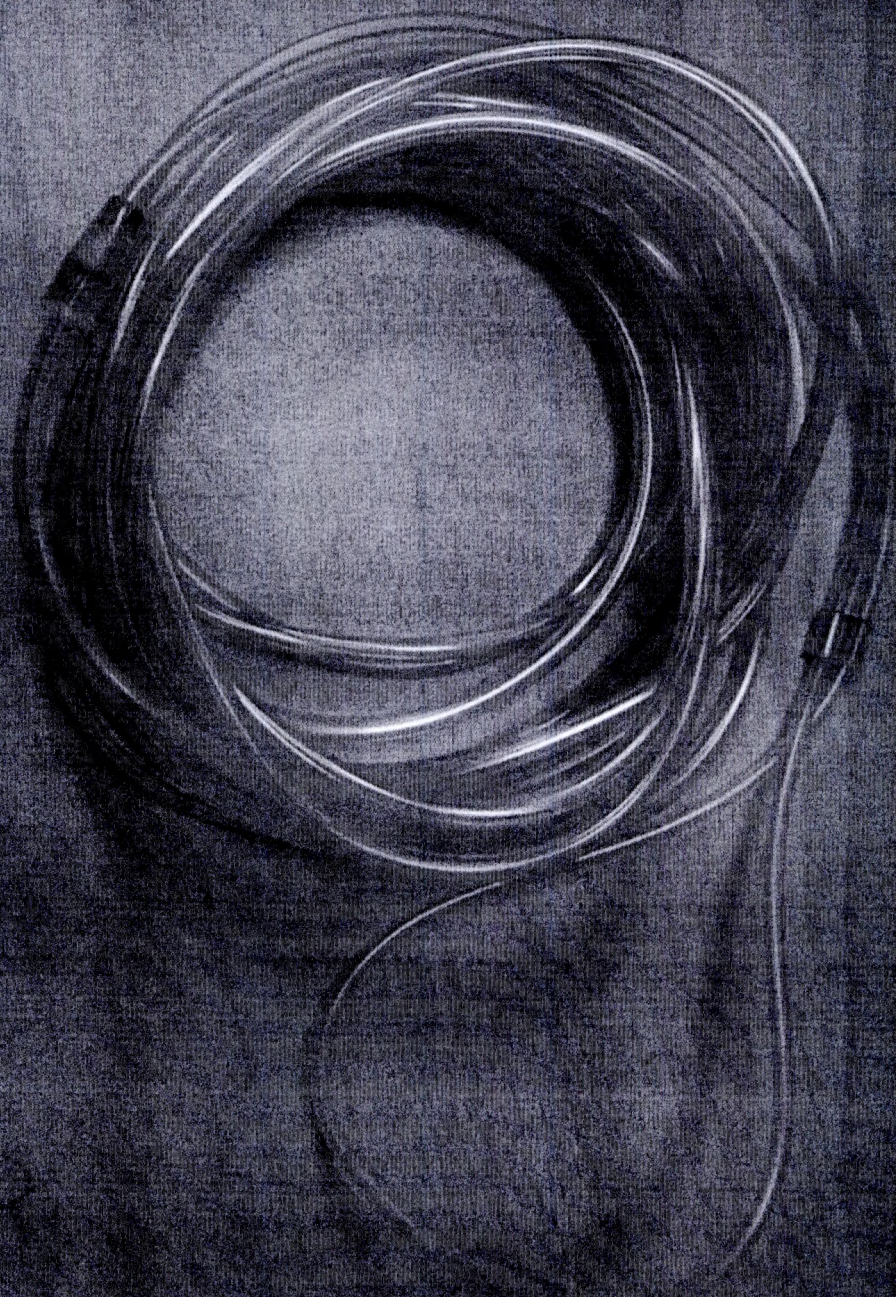


Рис. 6.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

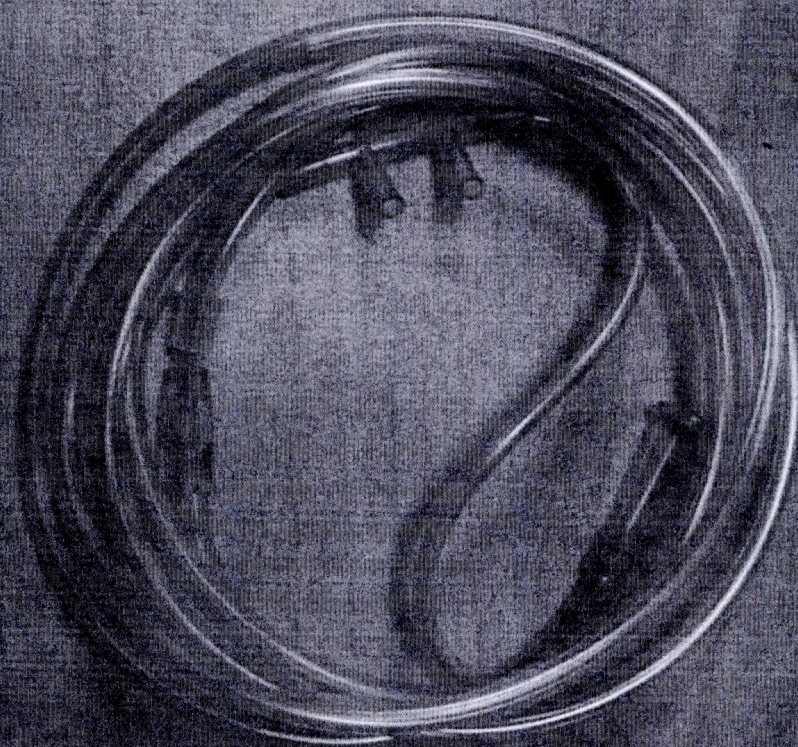


Рис. 6.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

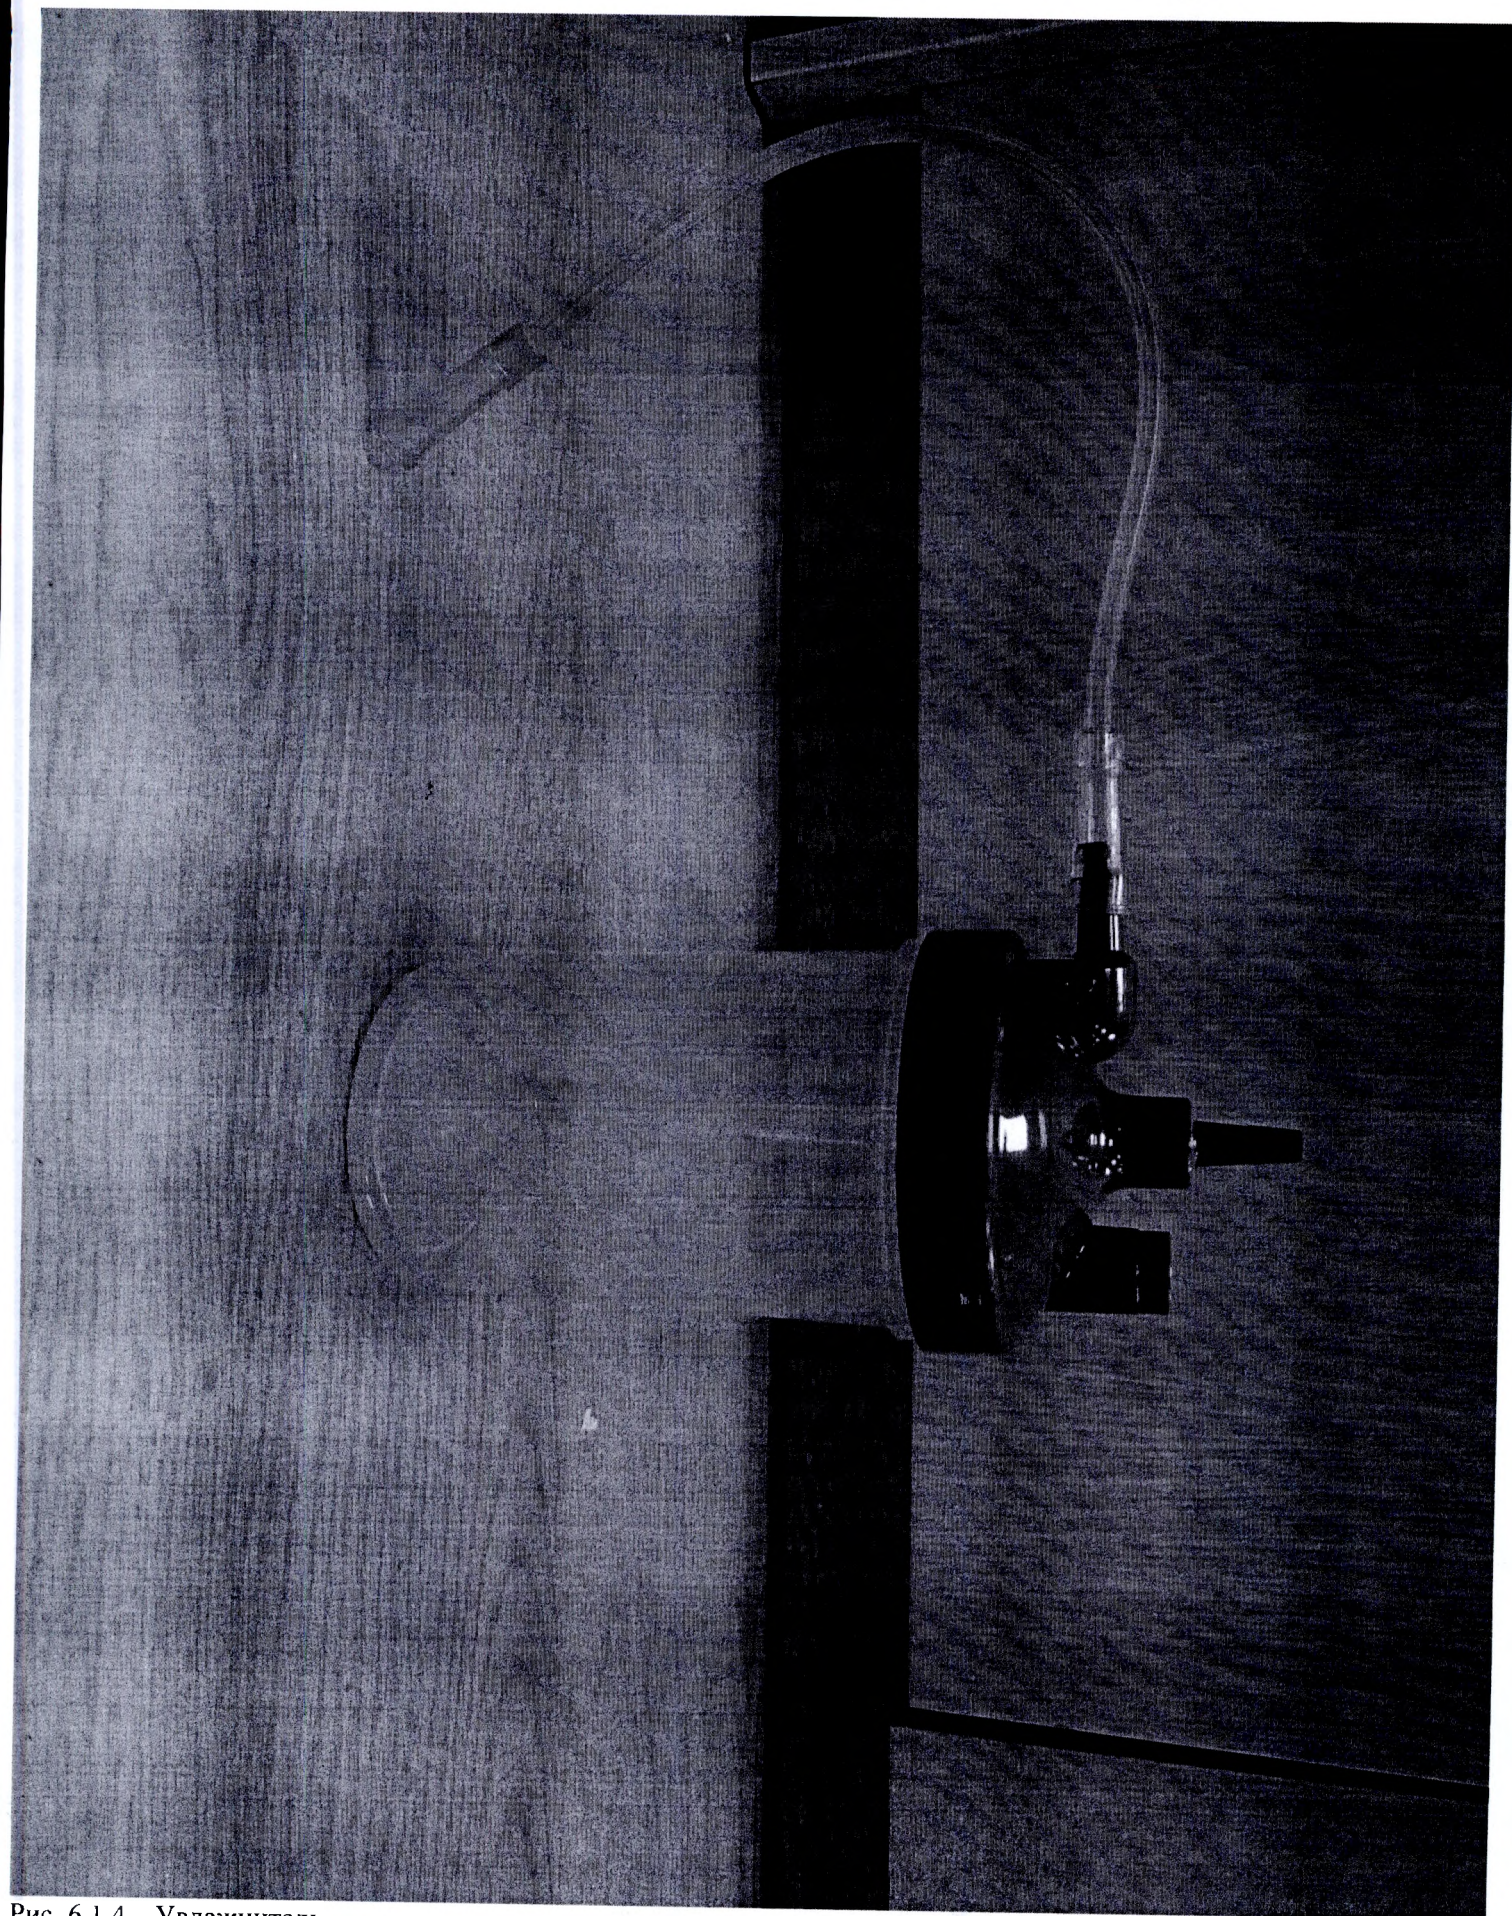


Рис. 6.1.4 – Увлажнитель


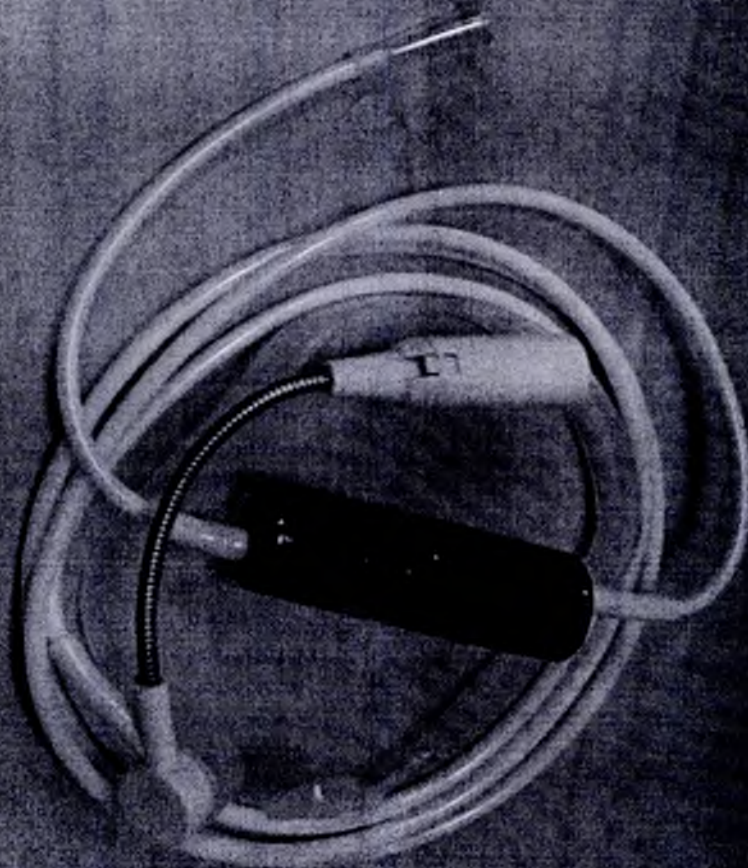


Рис. 6.1.5 – Диффузор (2 шт.)

Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м

Мундштук

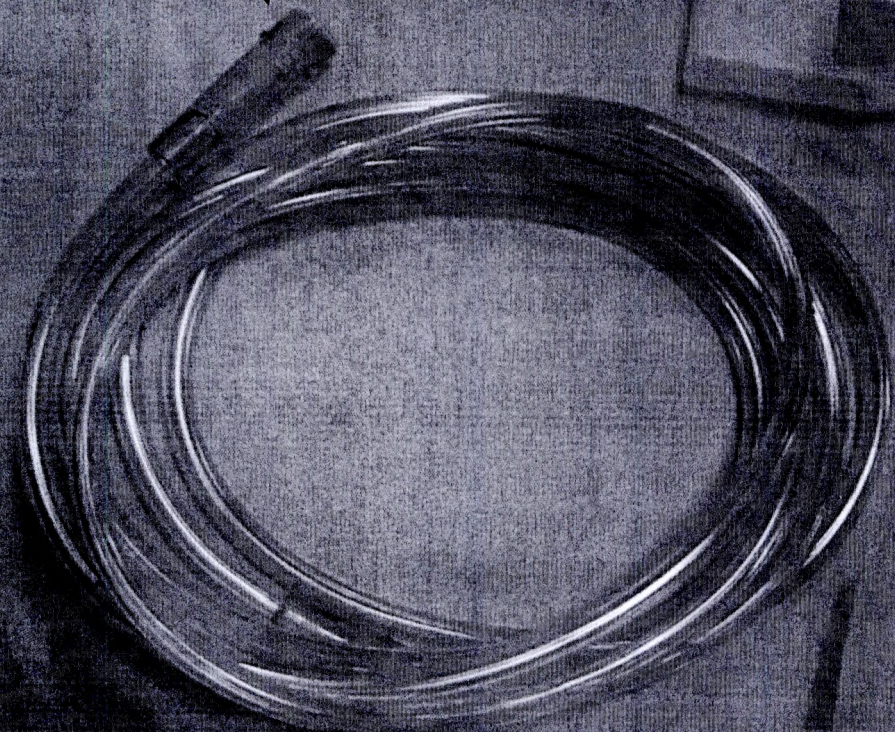

Резервуар распылителя

Рис. 6.1.6 – Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

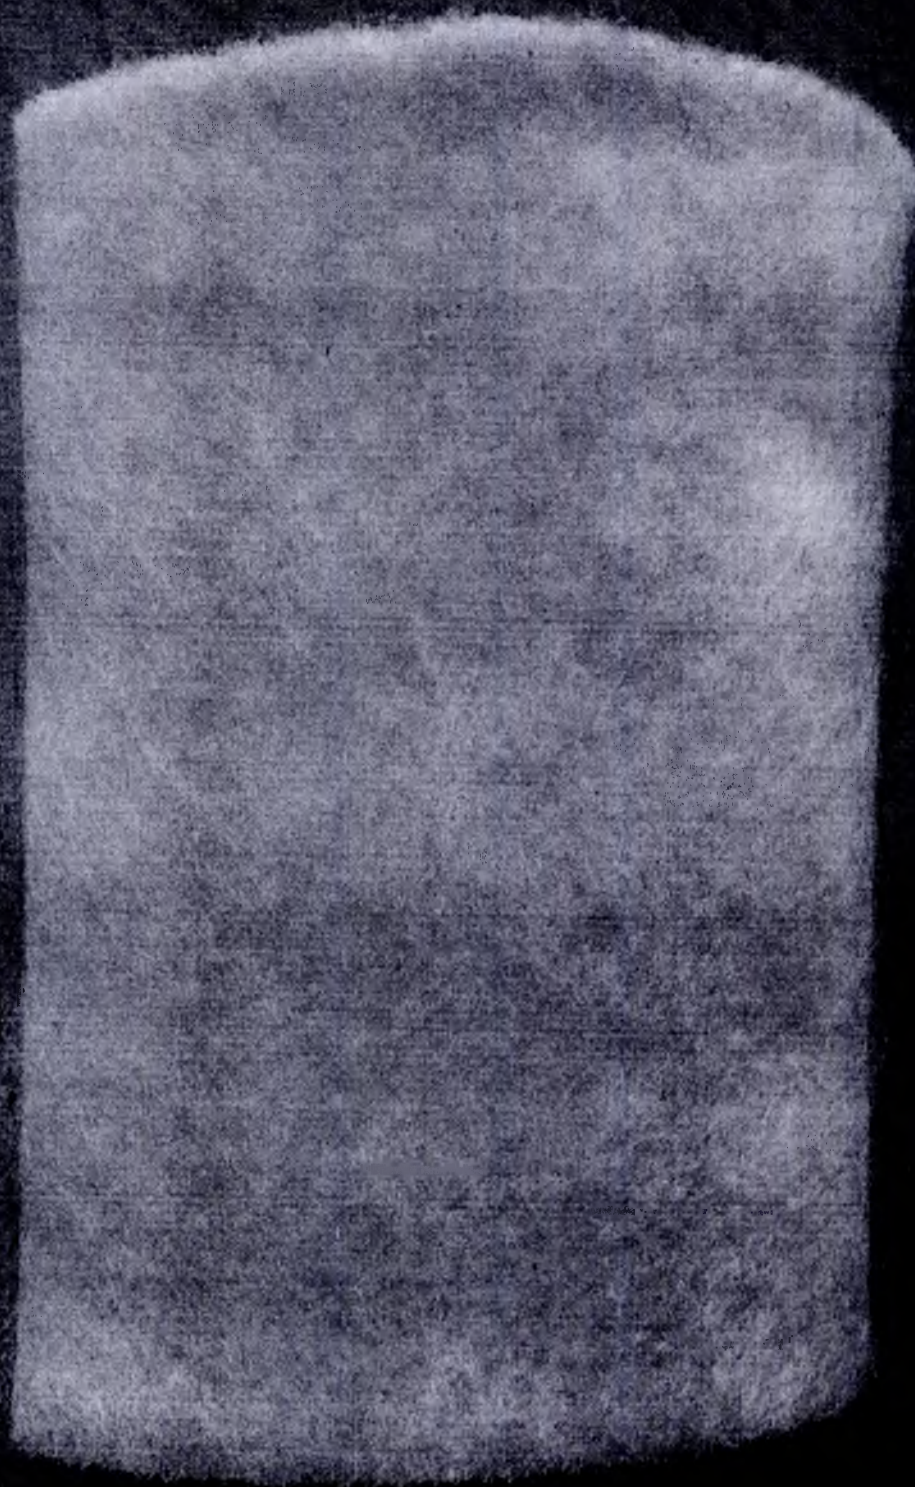


Рис. 6.2.1 – Фильтр тонкой очистки

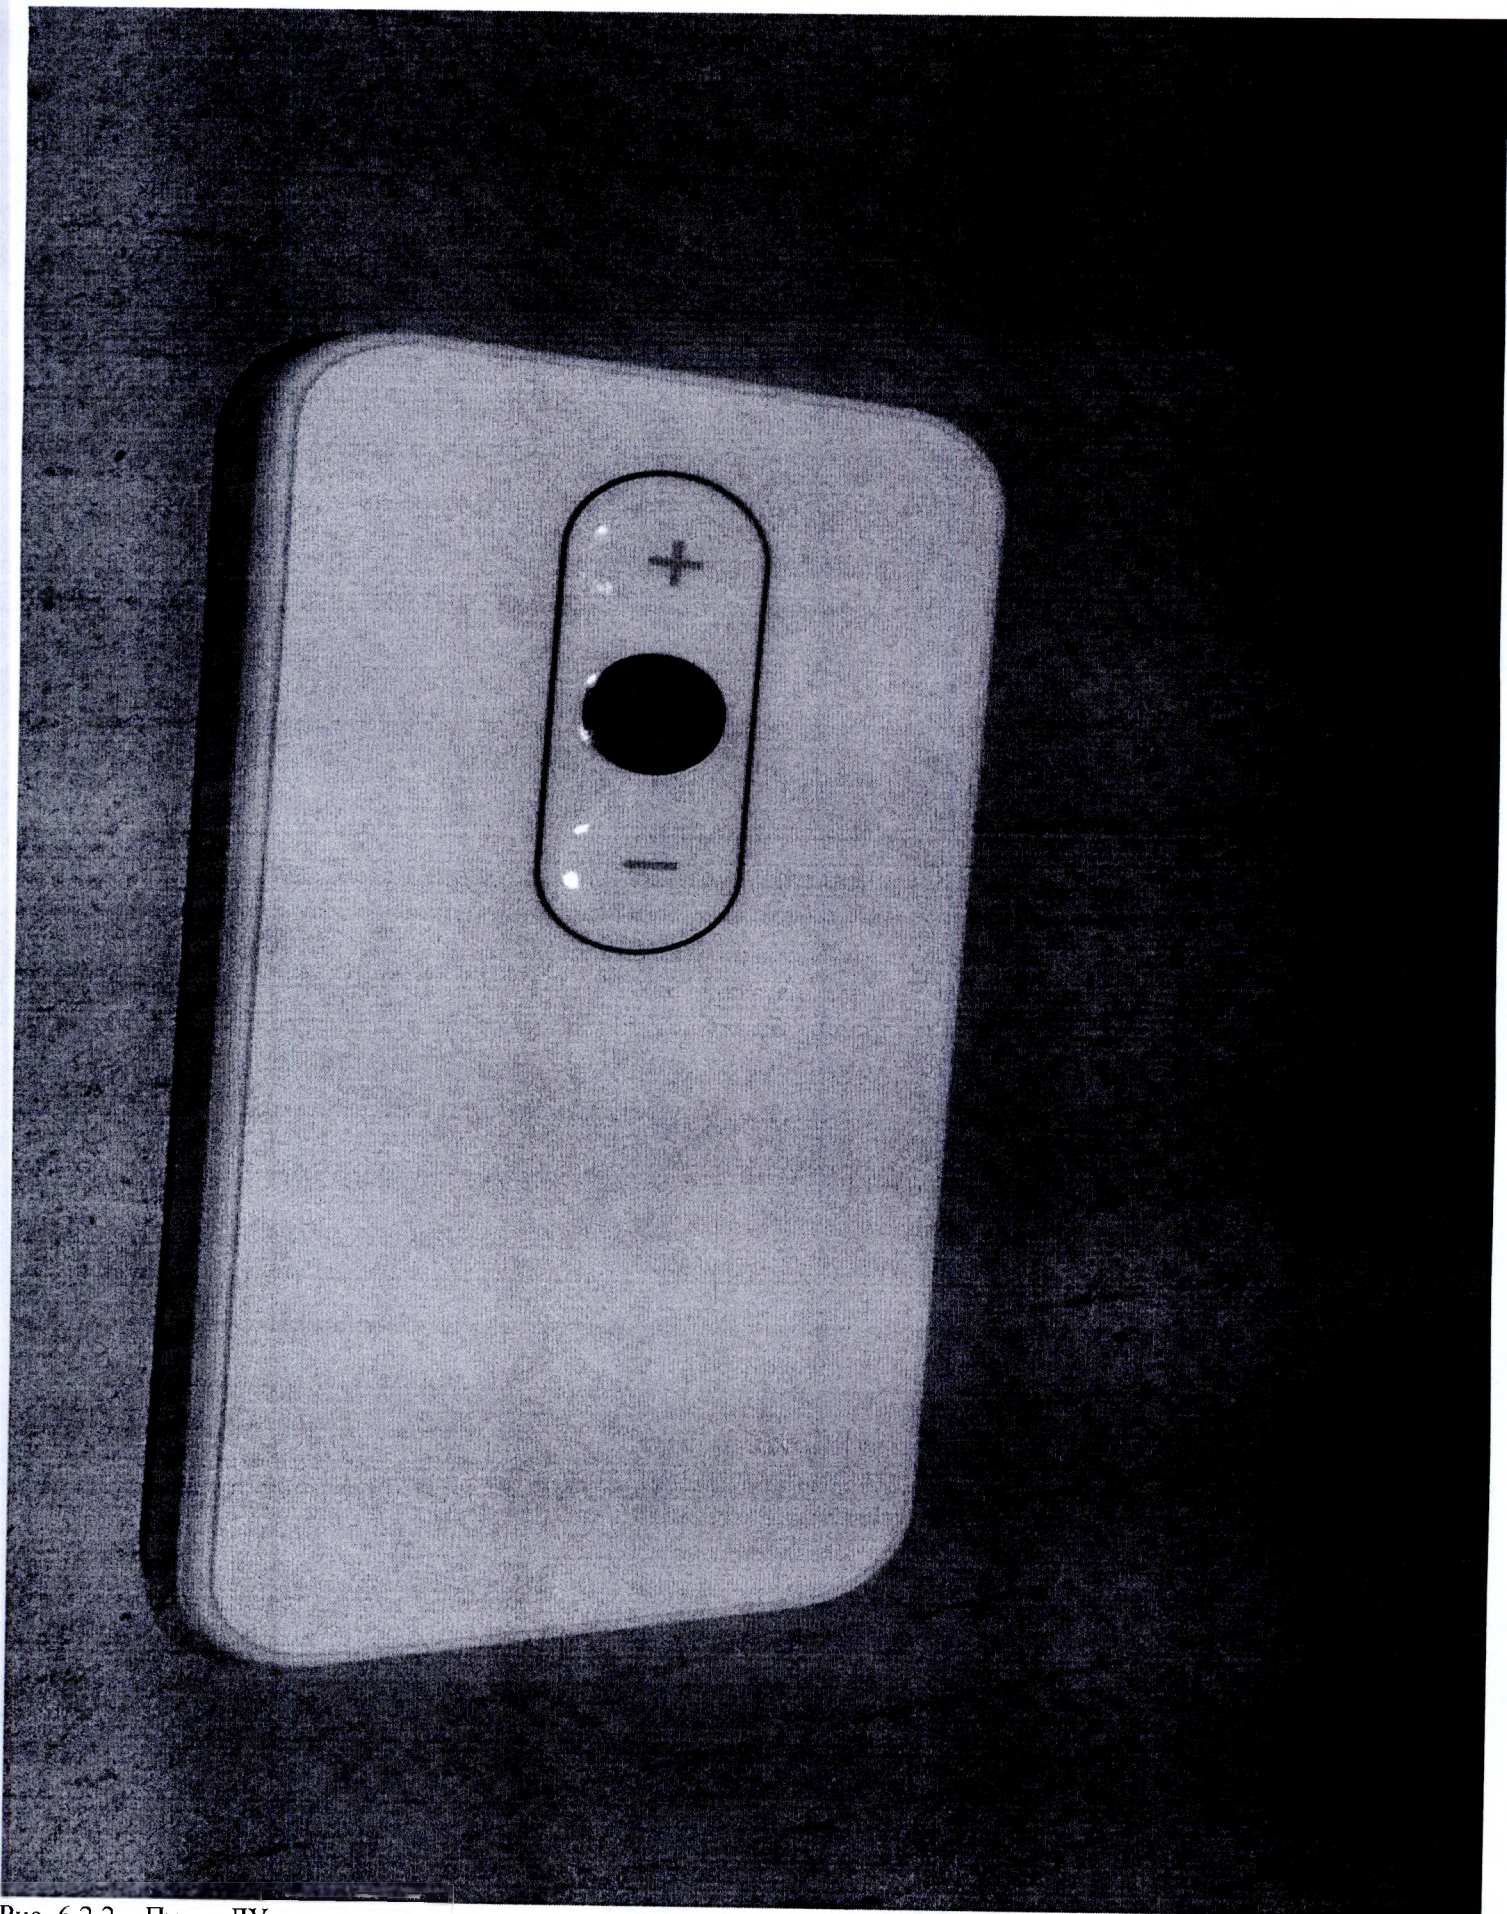


Рис. 6.2.2 – Пульт ДУ

7. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-3A

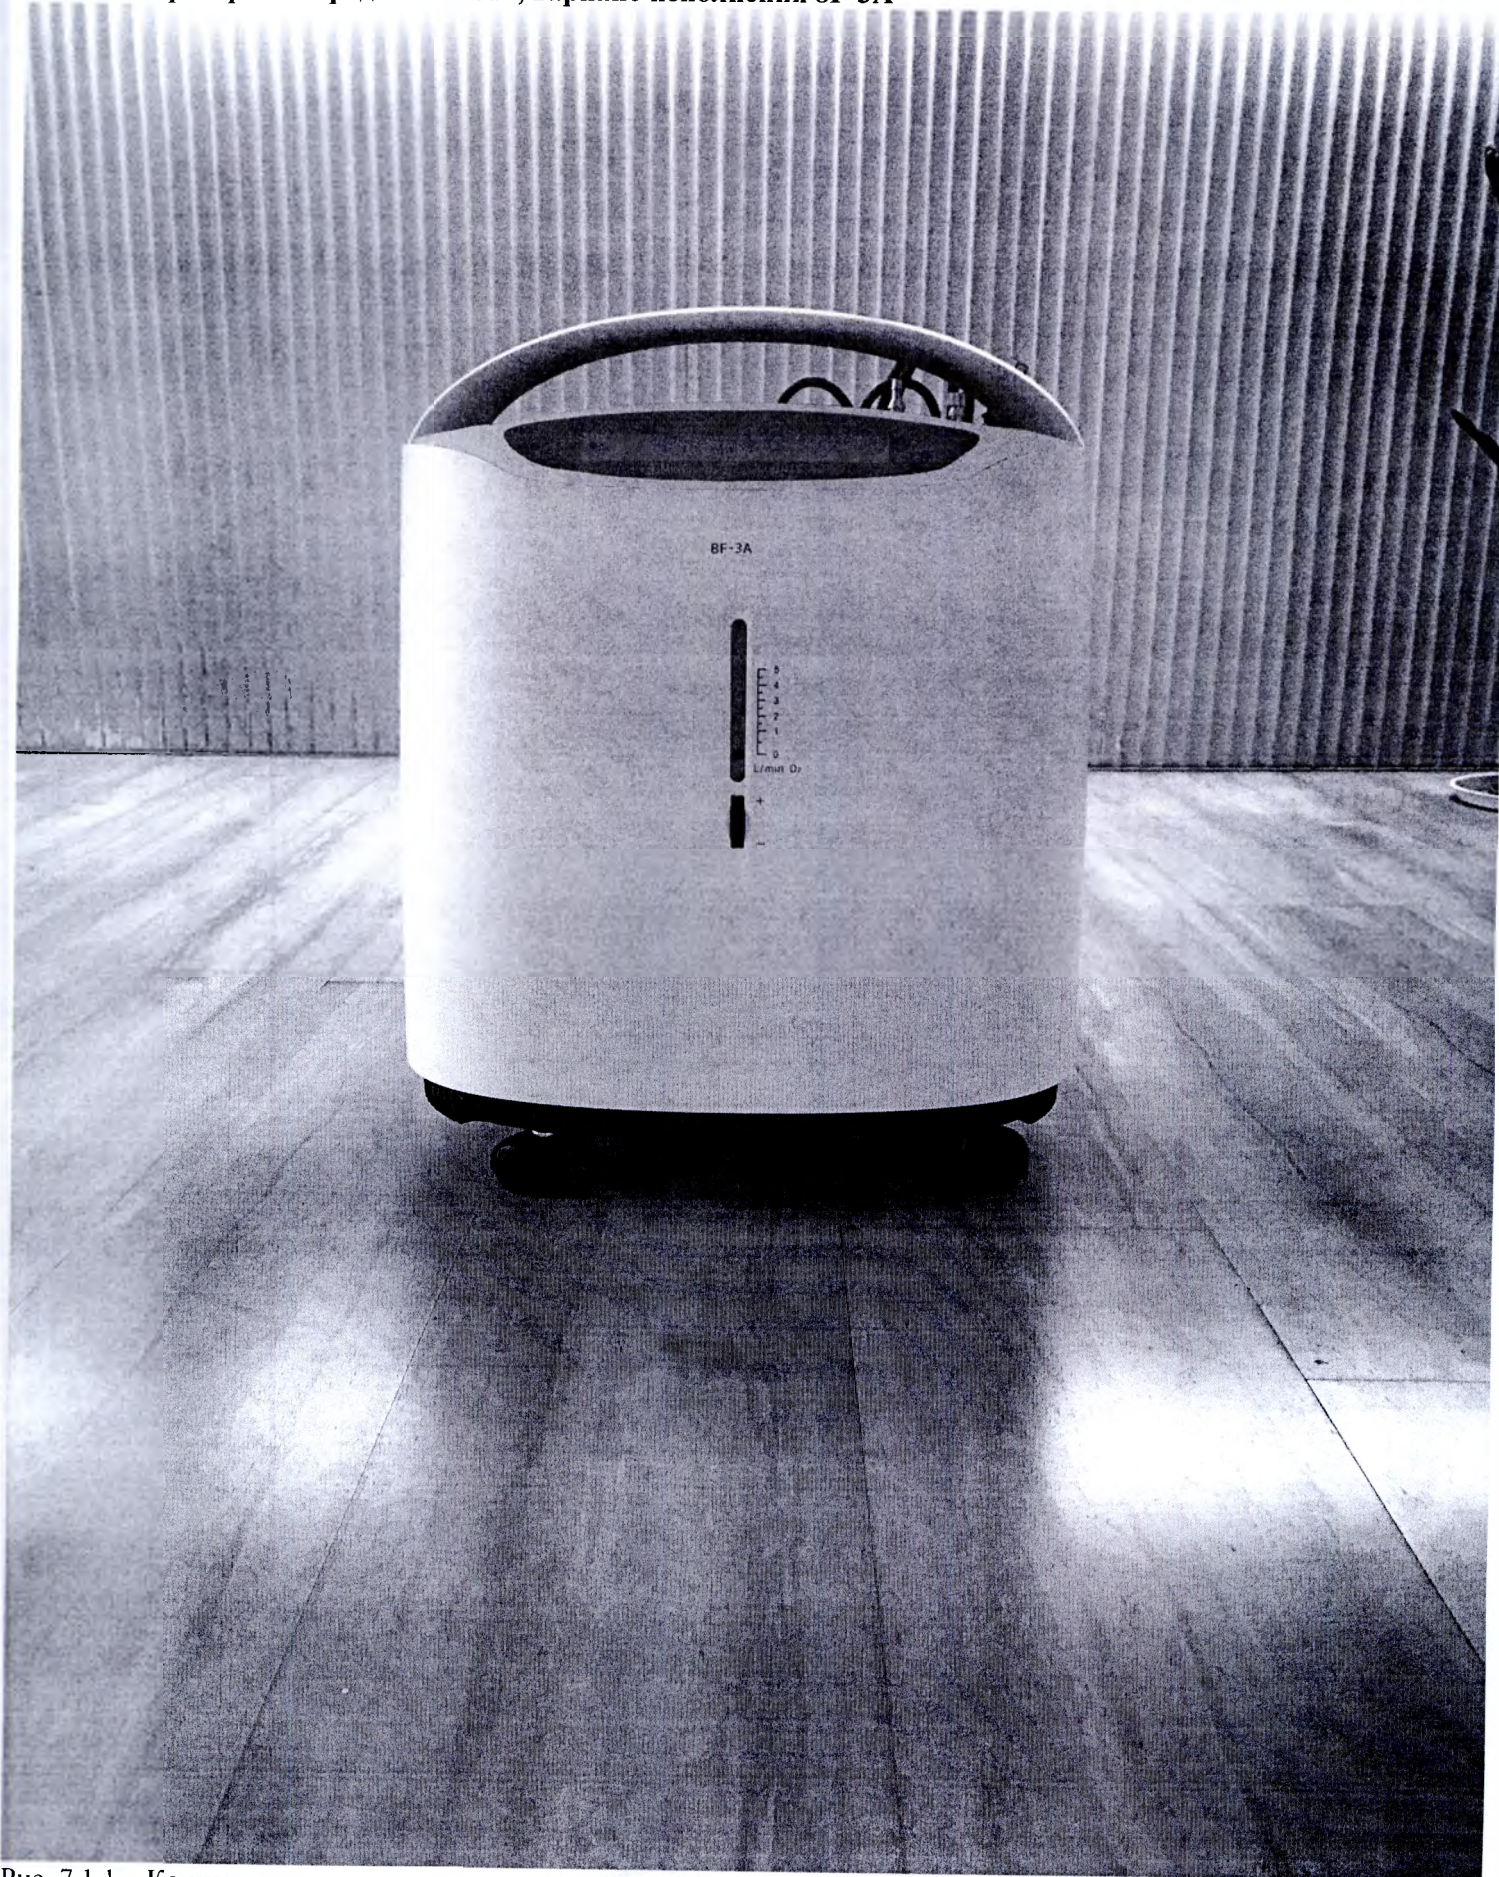


Рис. 7.1.1 – Концентратор кислорода

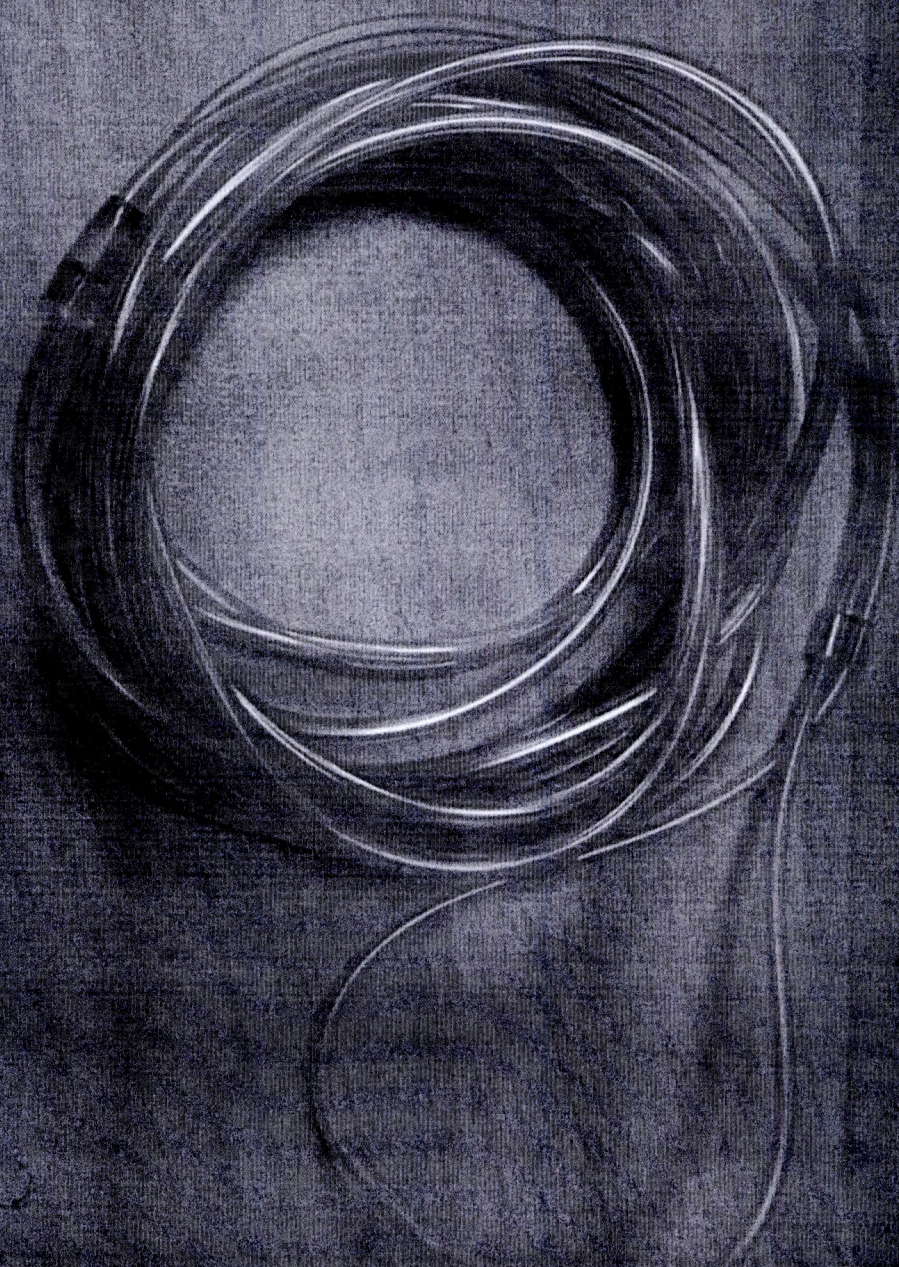


Рис. 7.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

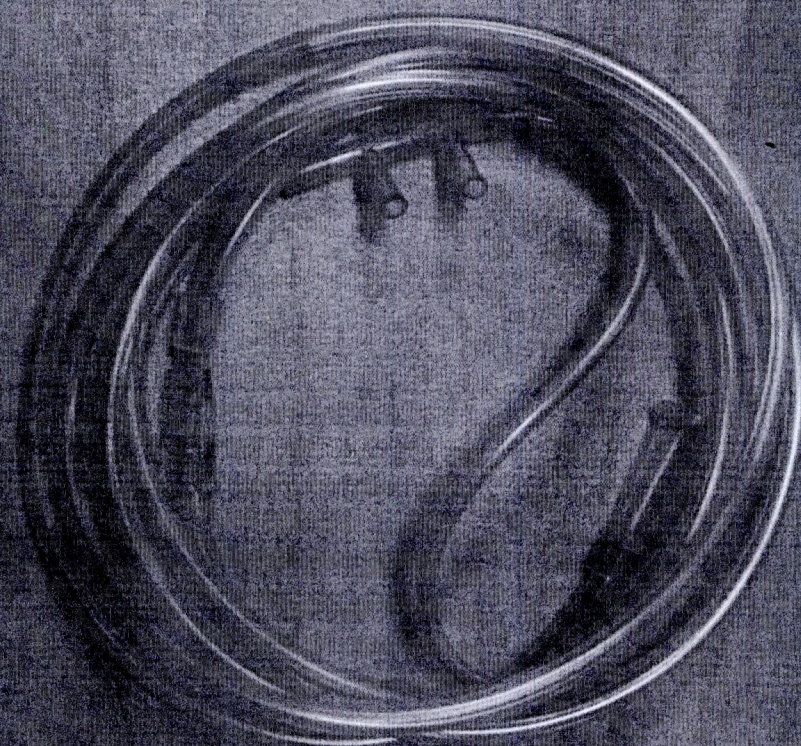


Рис. 7.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м



Рис. 7.1.4 – Увлажнитель

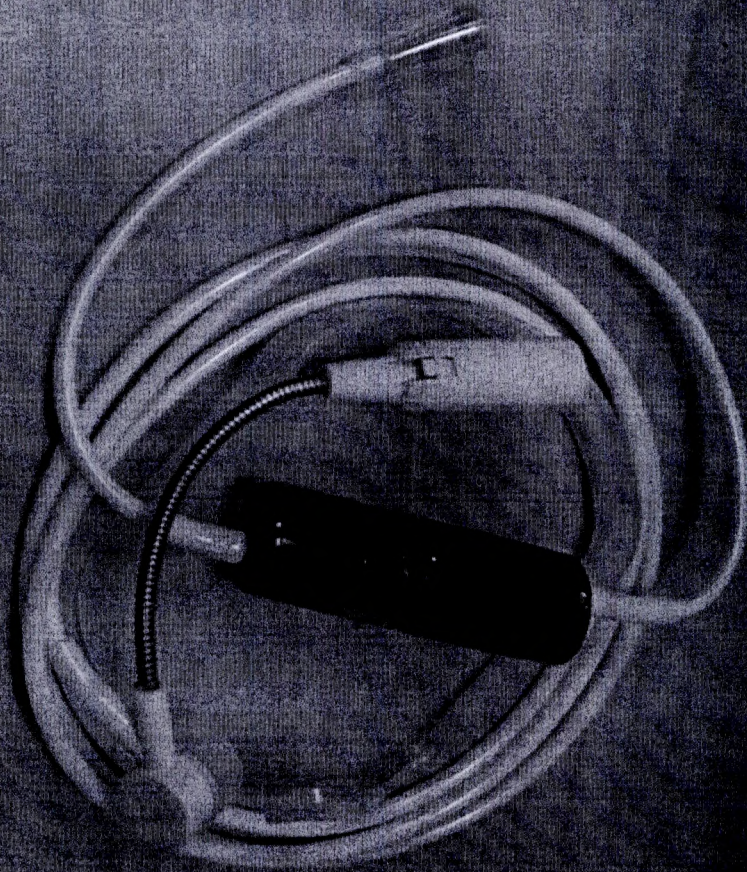


Рис. 7.1.5 – Диффузор (2 шт.)

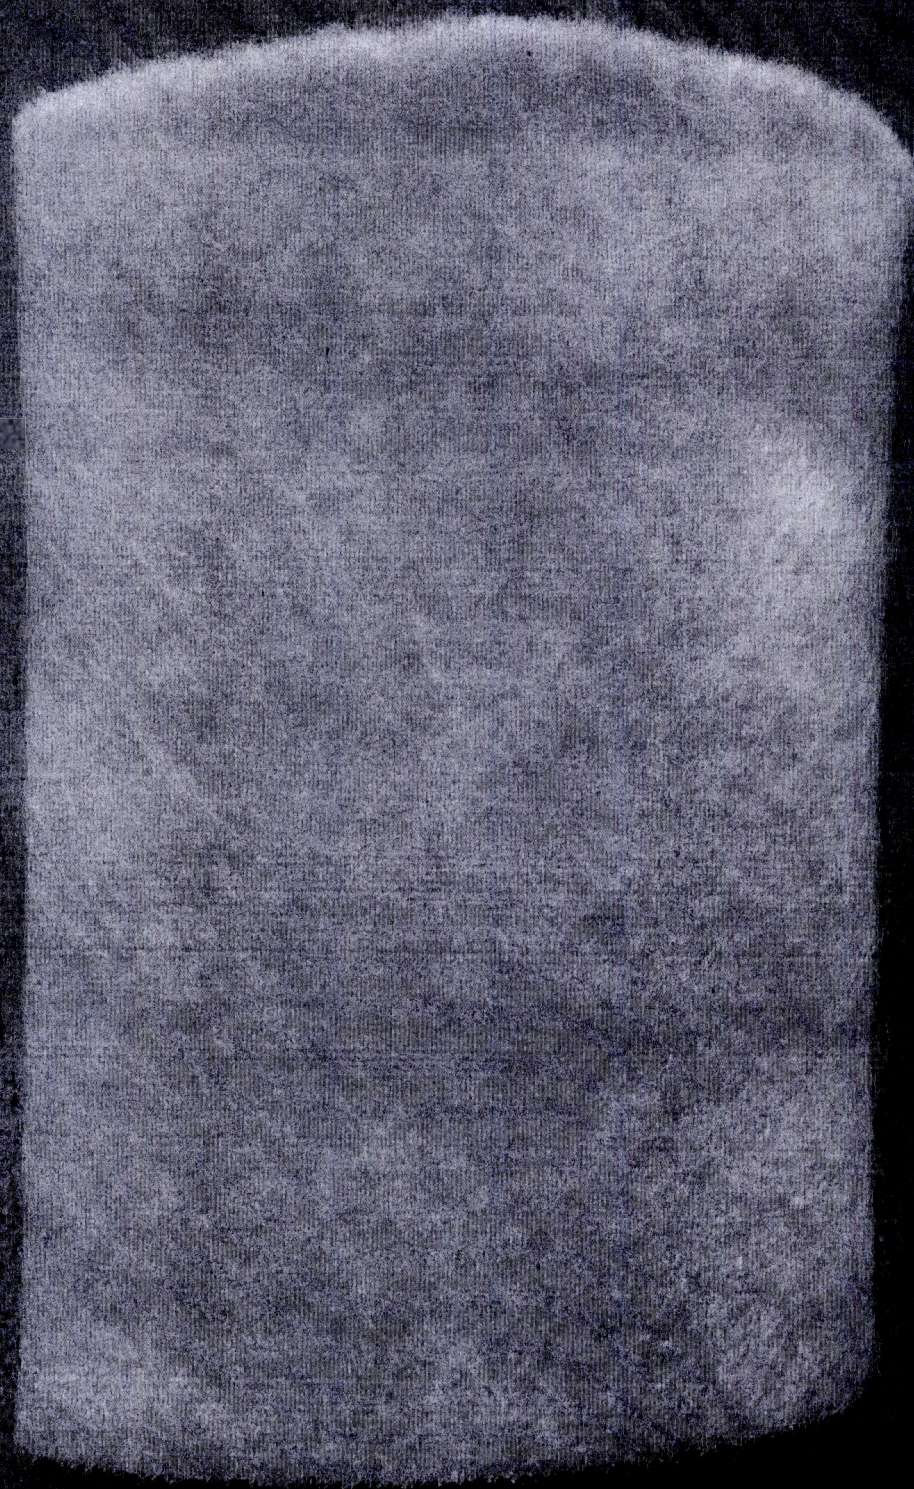


Рис. 7.2.1 – Фильтр тонкой очистки

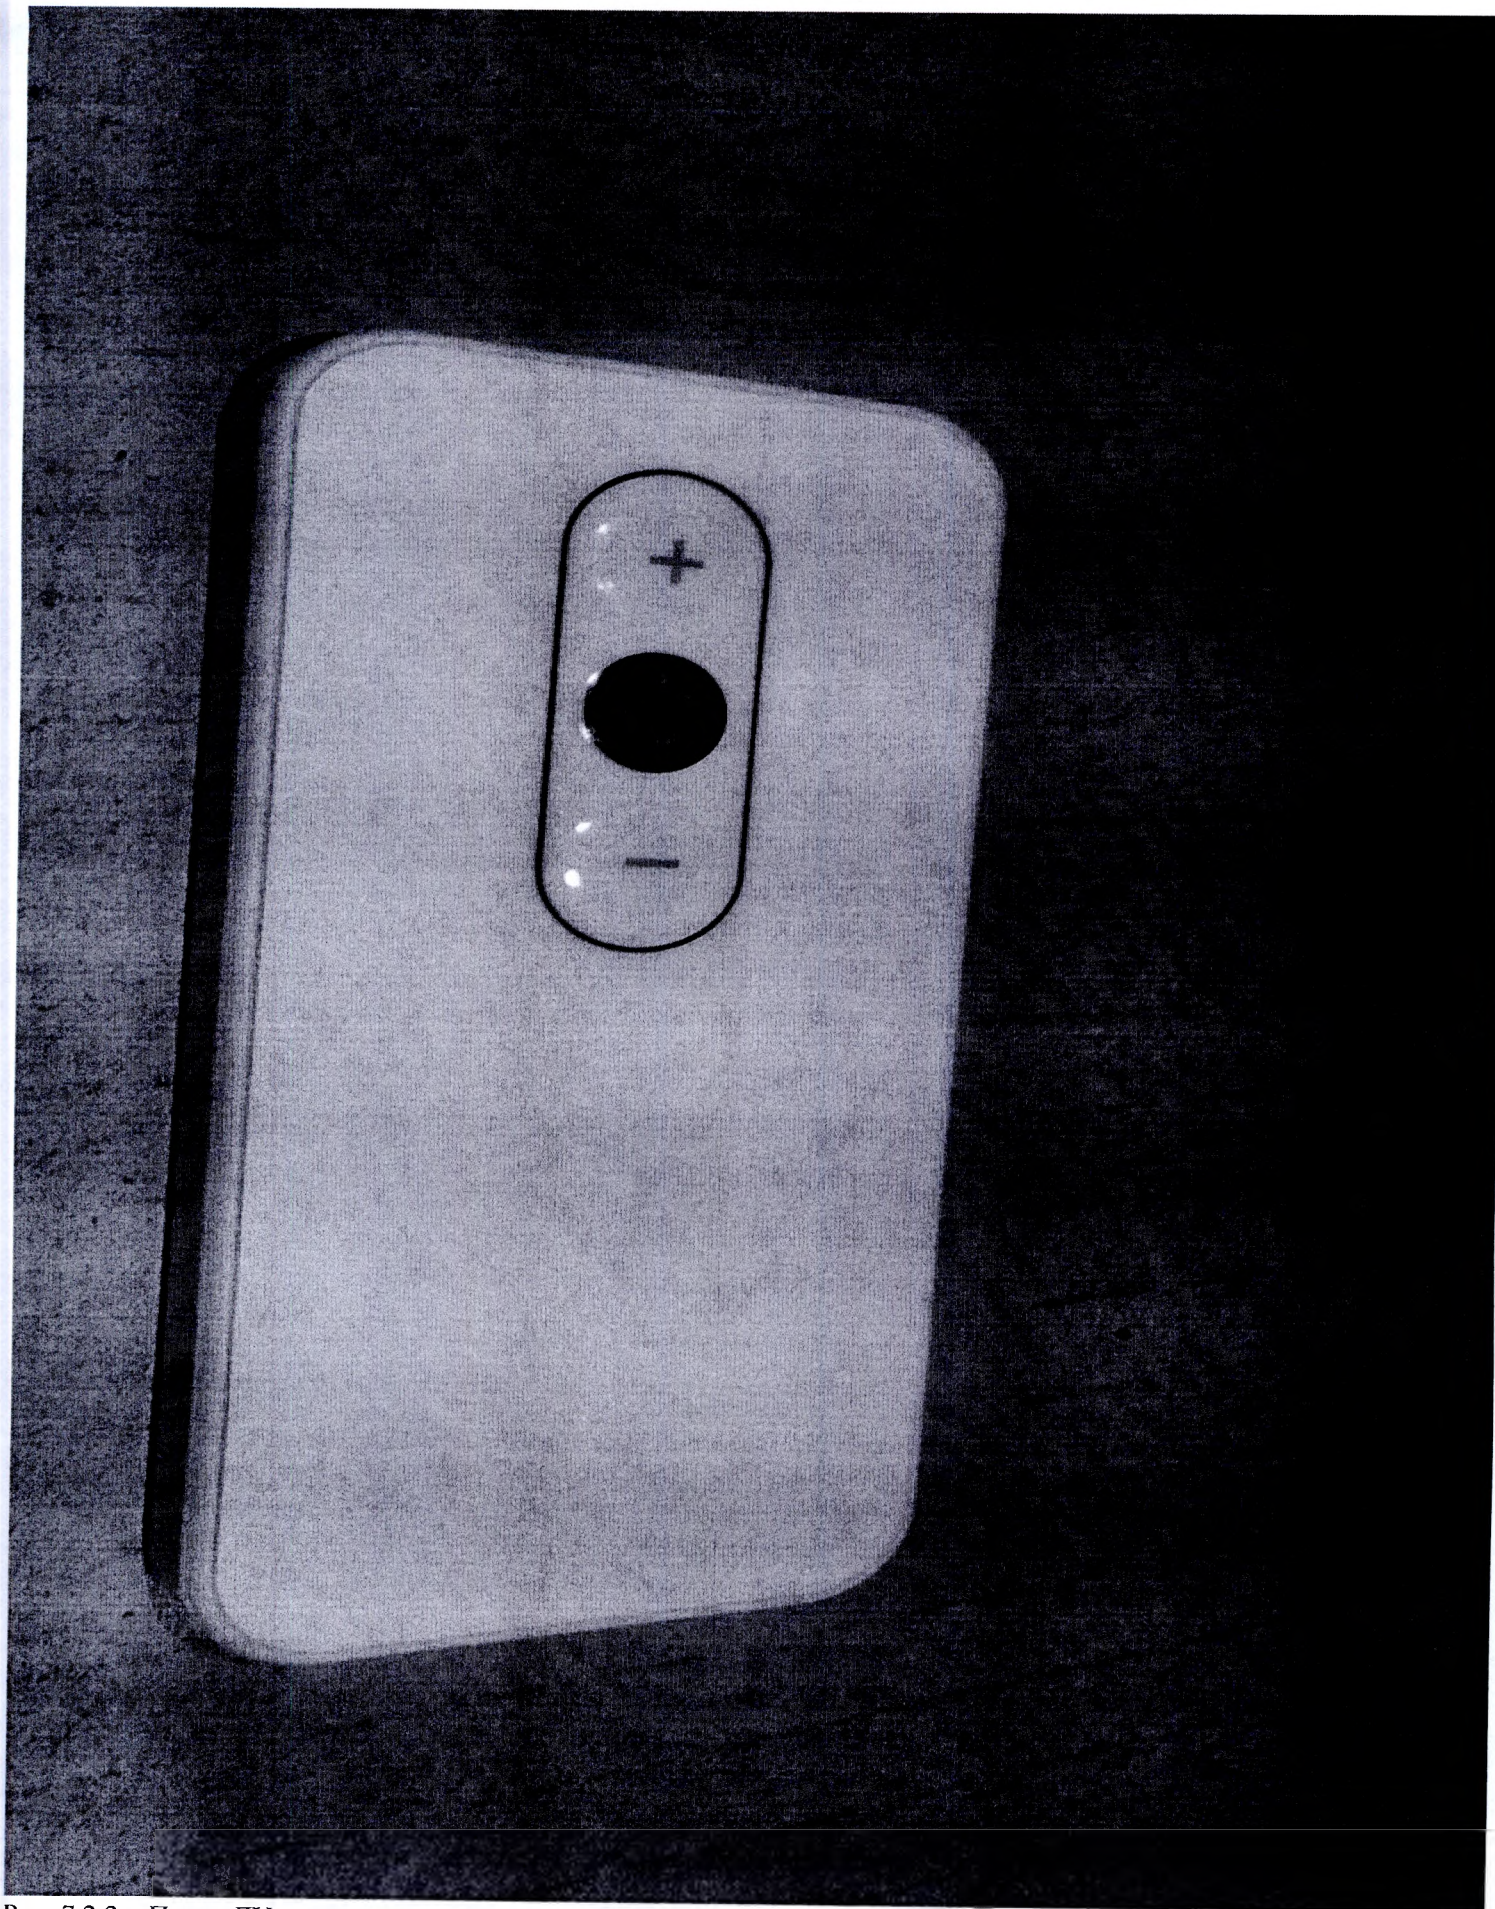


Рис. 7.2.2 – Пульт ДУ

8. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3A

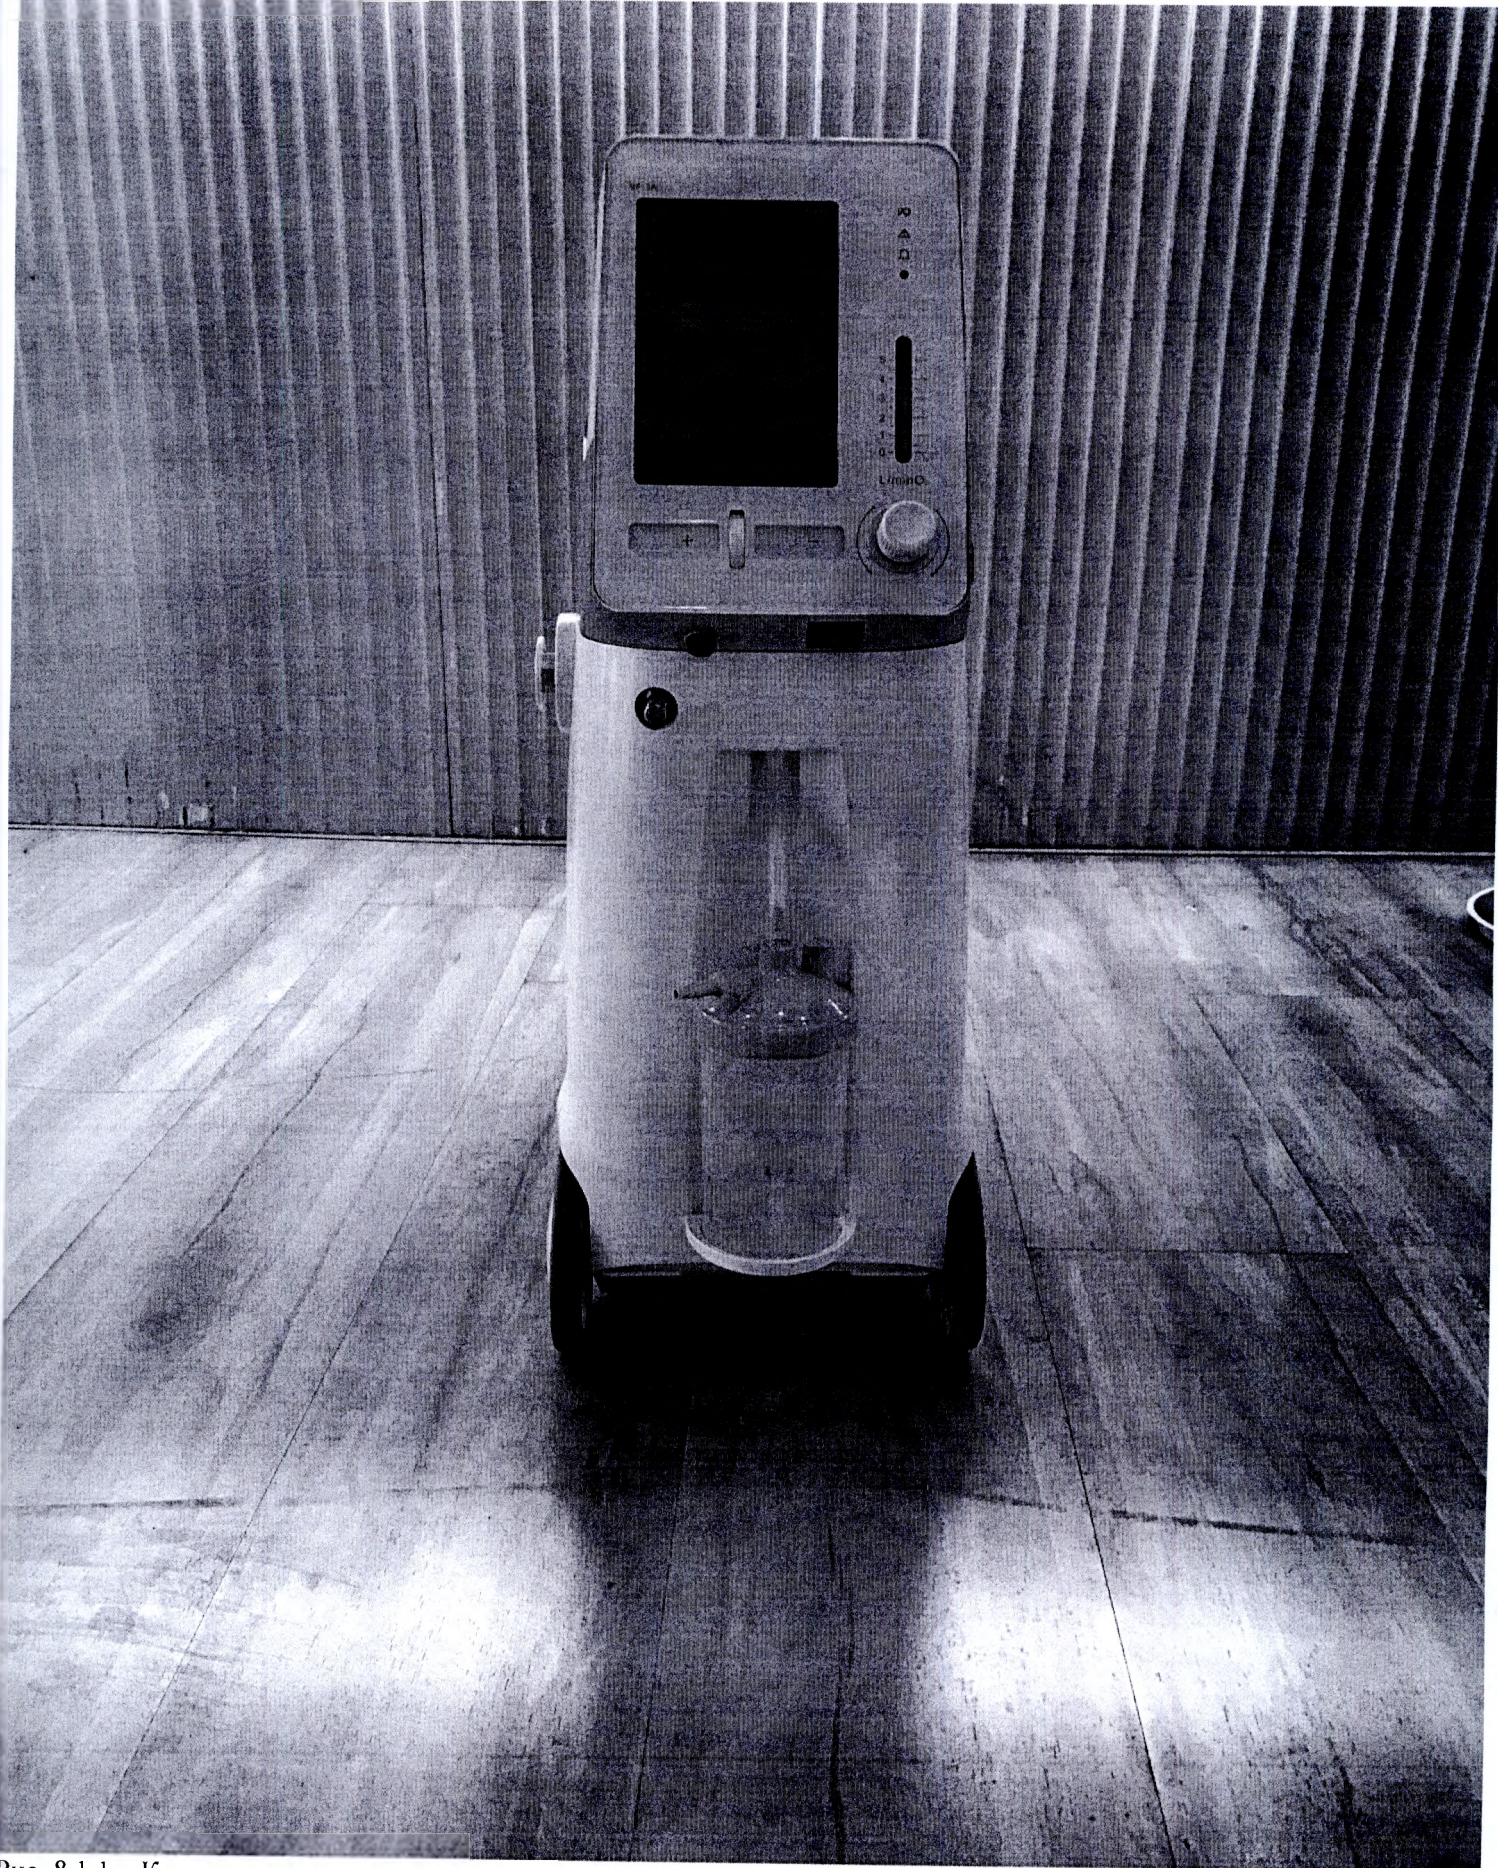


Рис. 8.1.1 – Концентратор кислорода

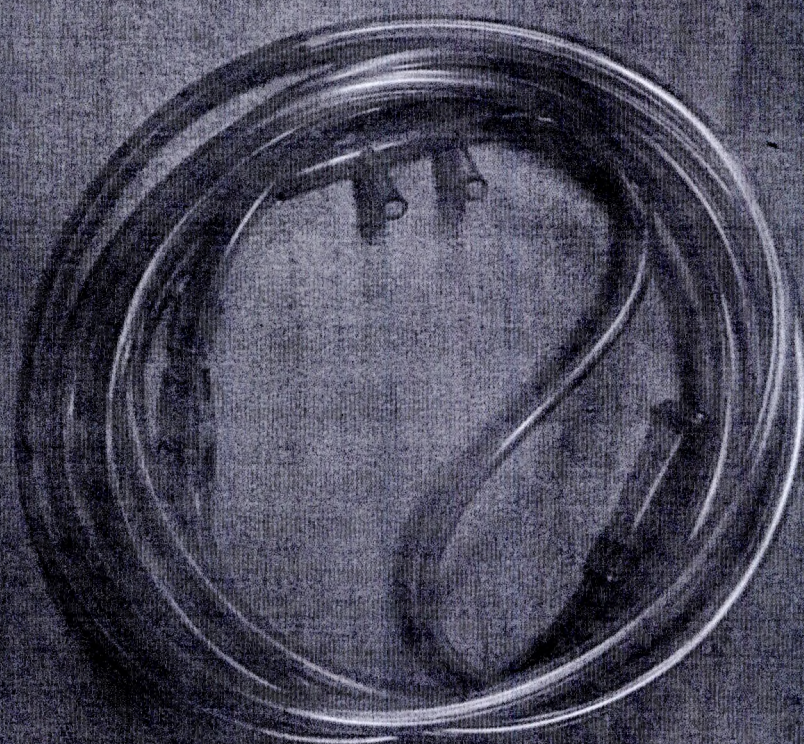


Рис. 8.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м




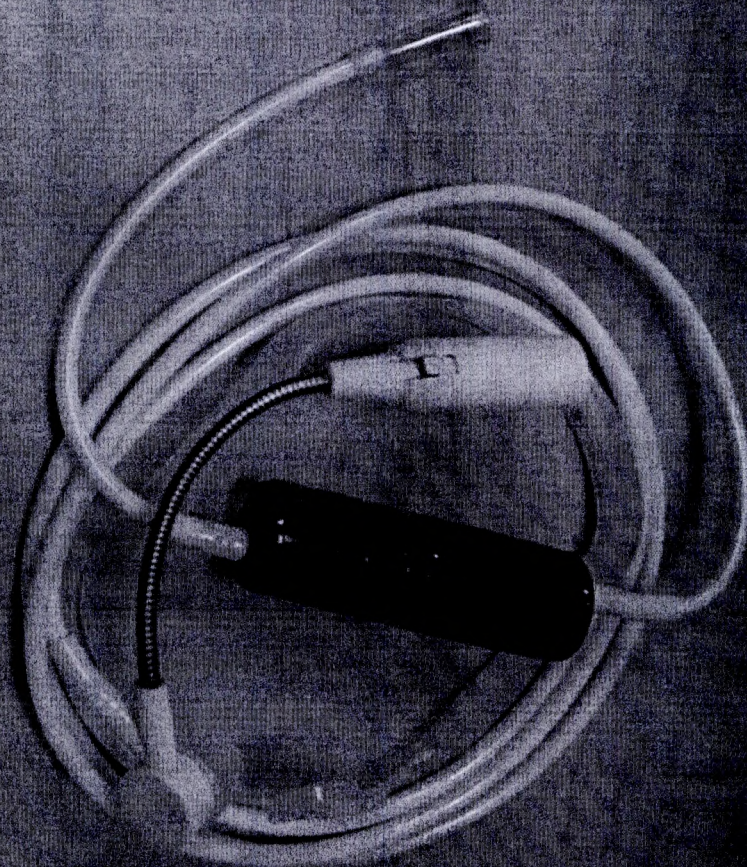


Рис. 8.1.3 -- Диффузор (2 шт.)

Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м

Мундштук

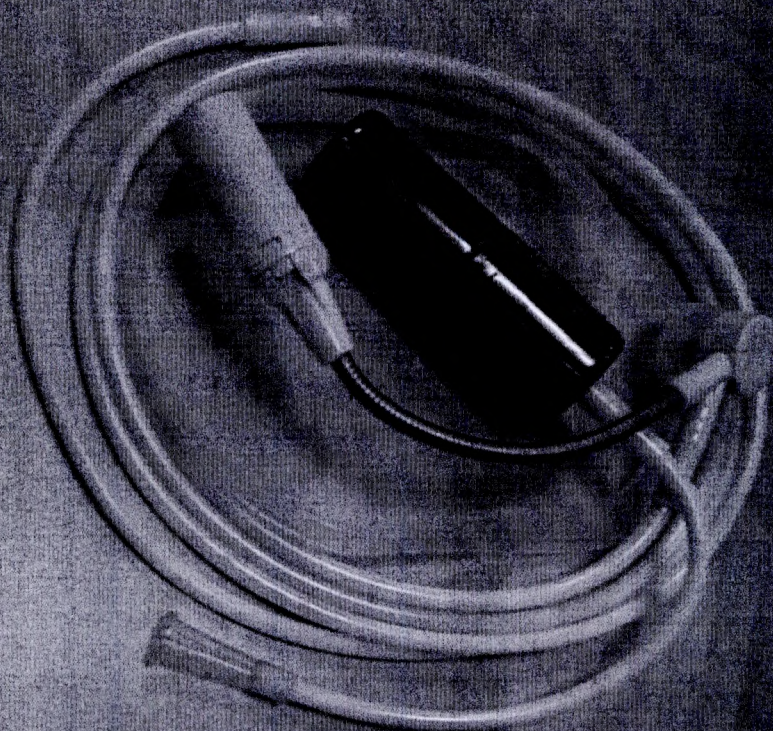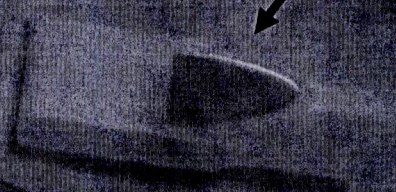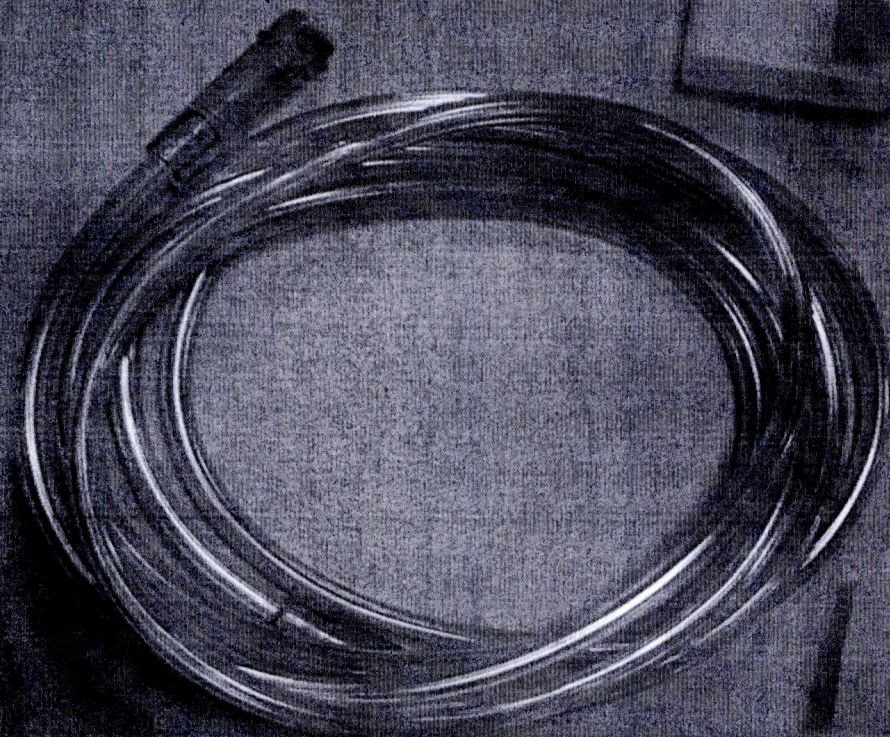

Резервуар распылителя

Рис. 8.1.4 – Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

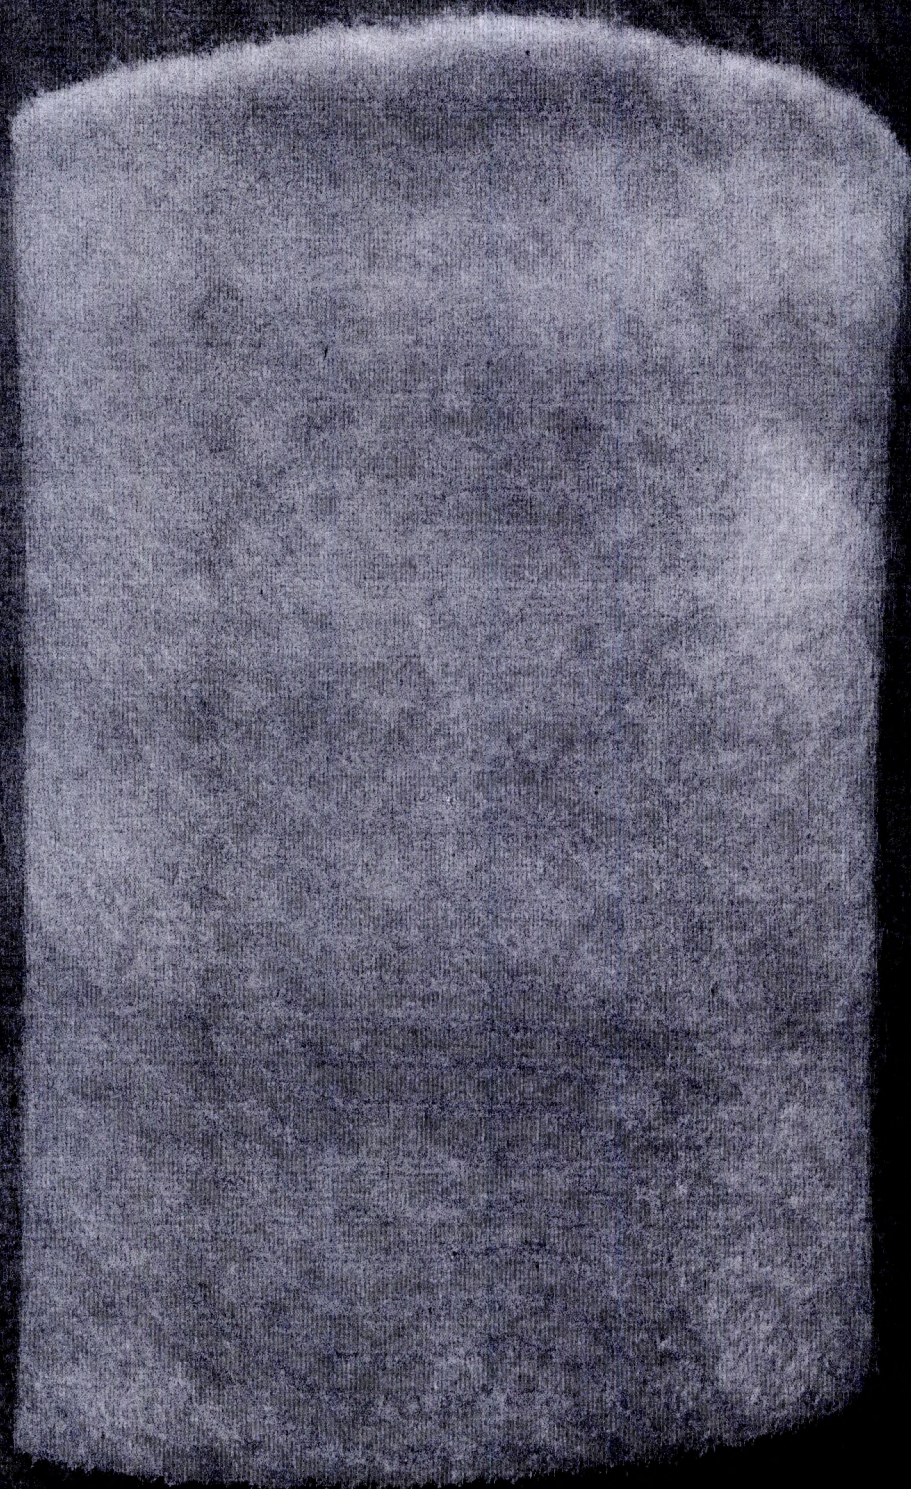


Рис. 8.2.1 – Фильтр тонкой очистки

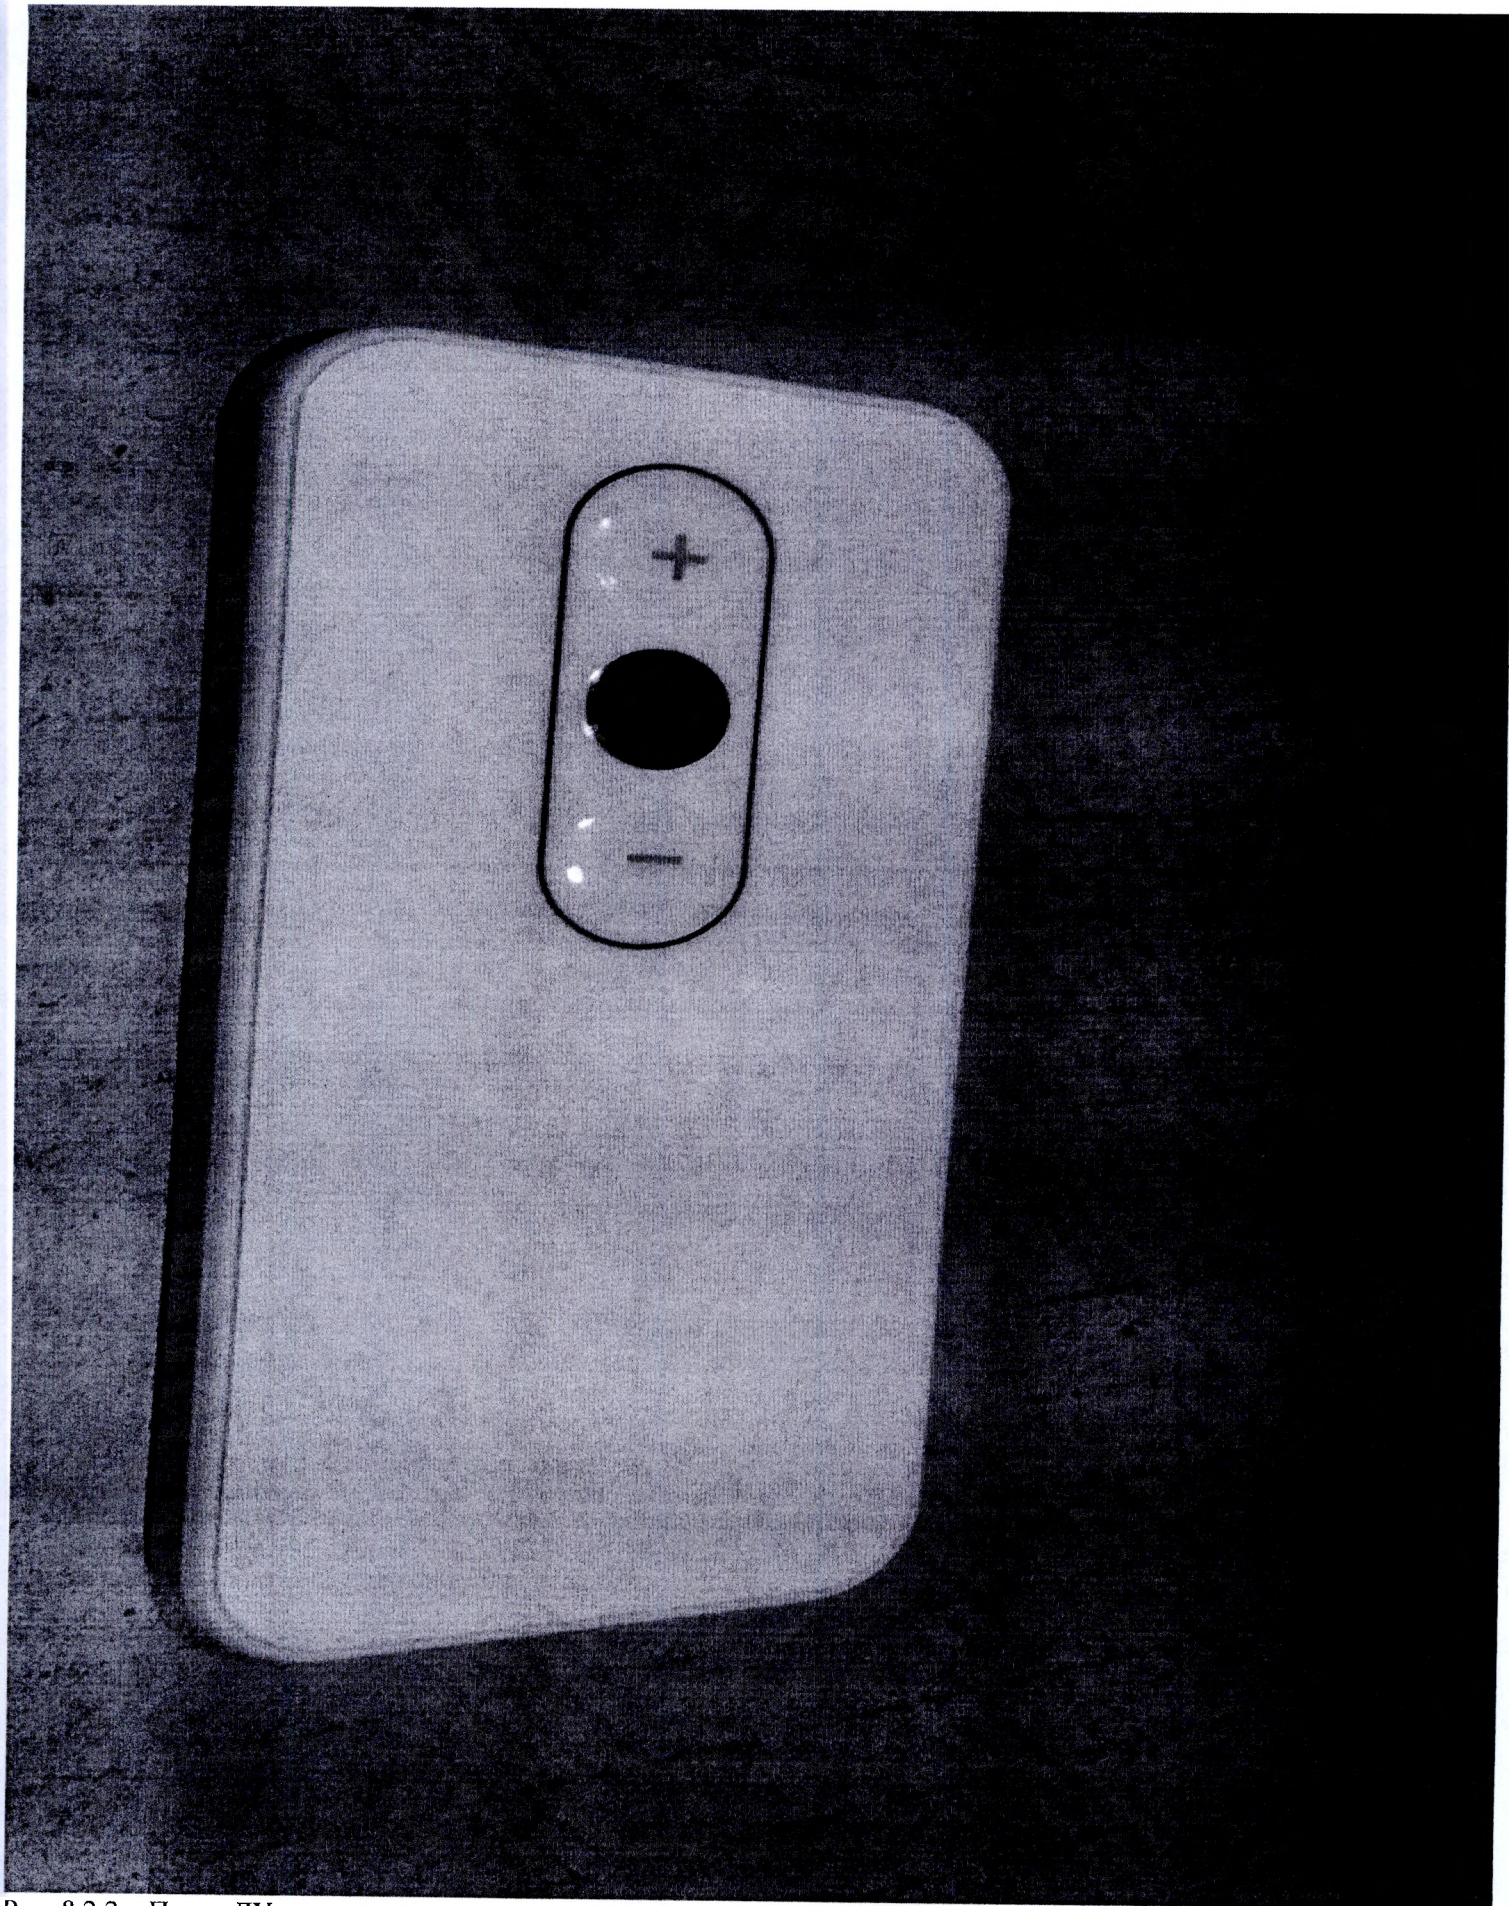


Рис. 8.2.2 – Пульт ДУ

9. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3B

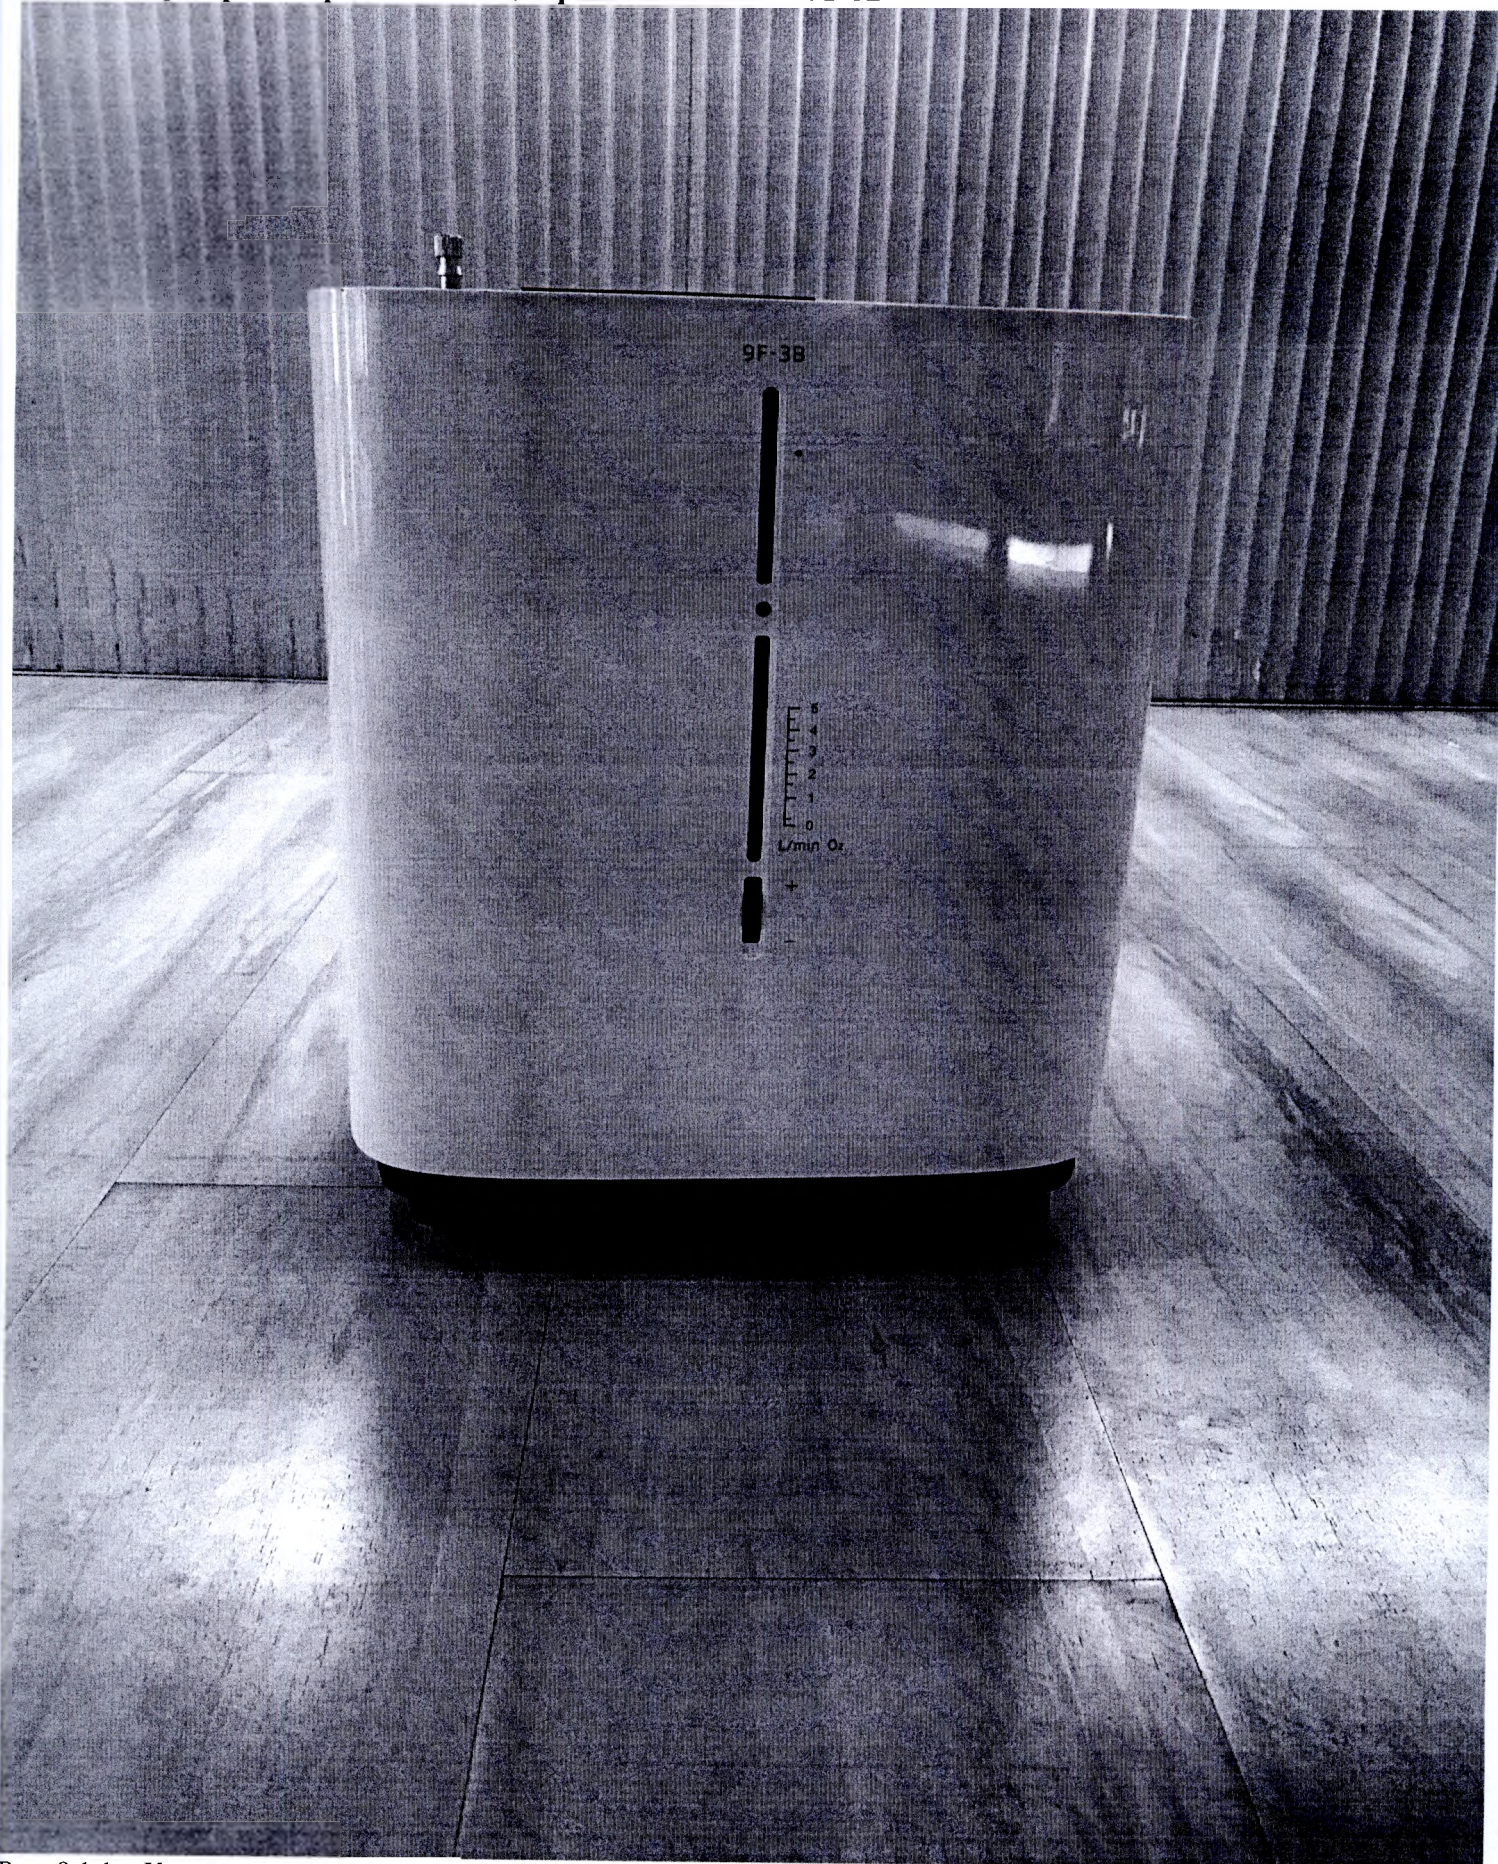


Рис. 9.1.1 – Концентратор кислорода

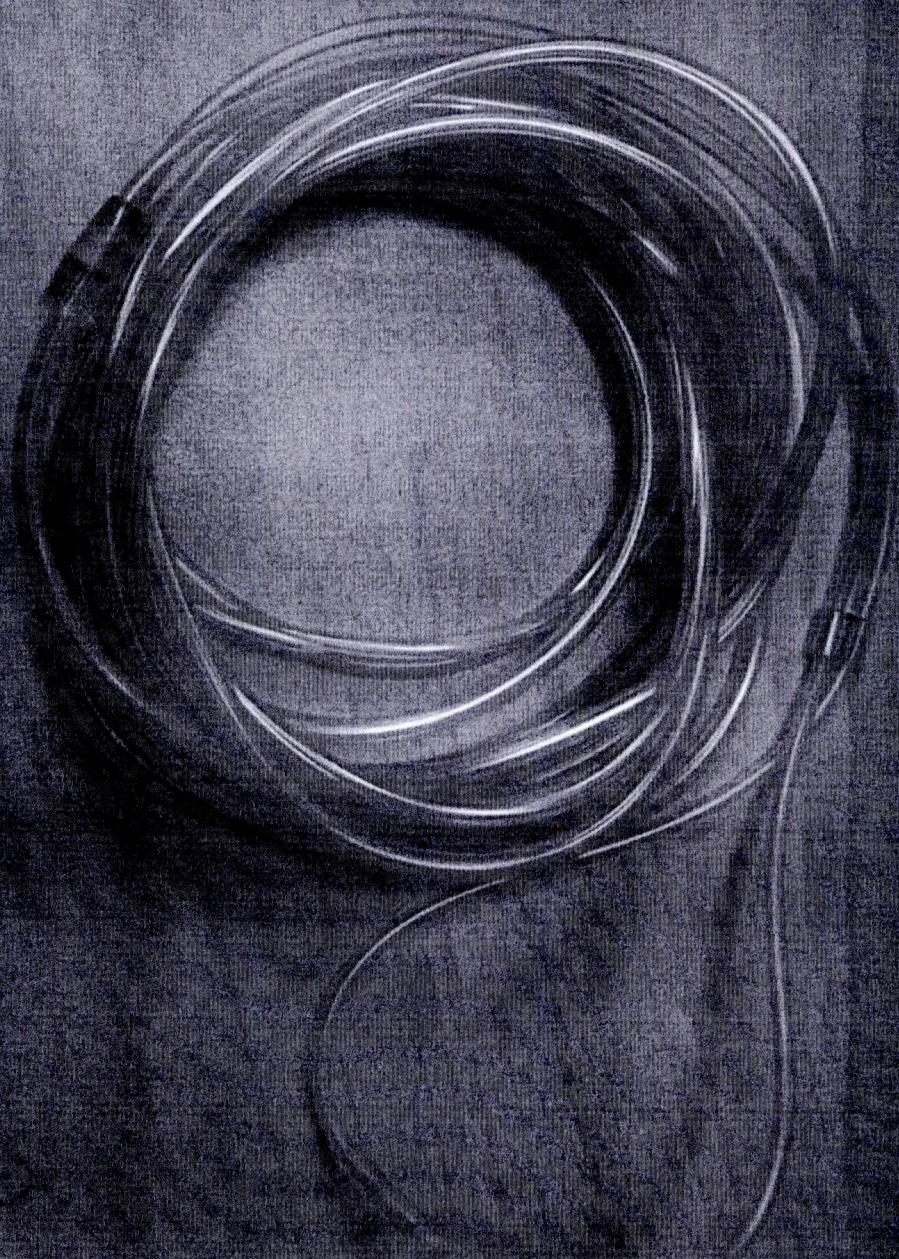


Рис. 9.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

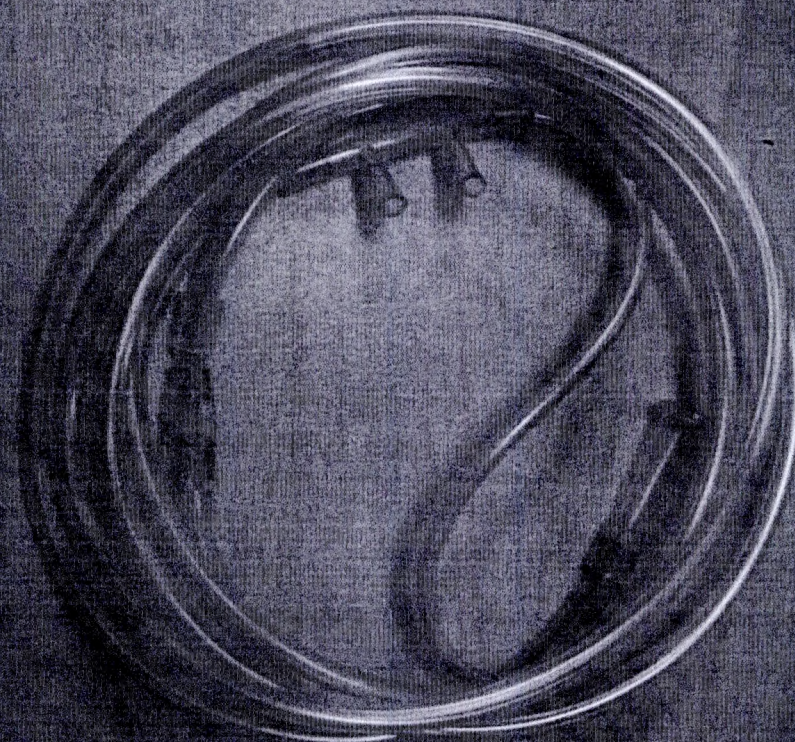


Рис. 9.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м

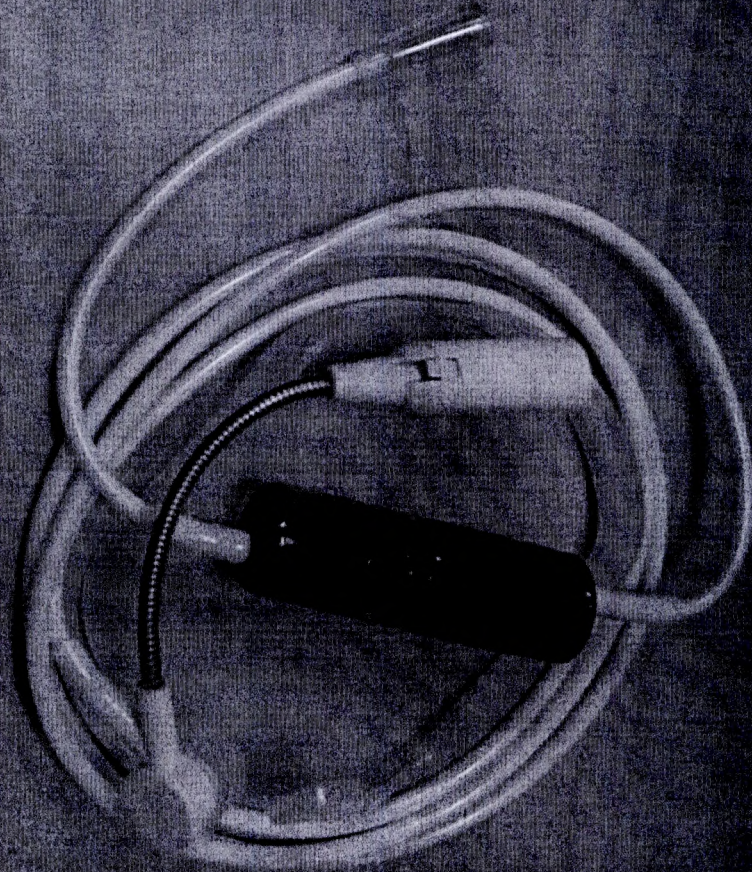
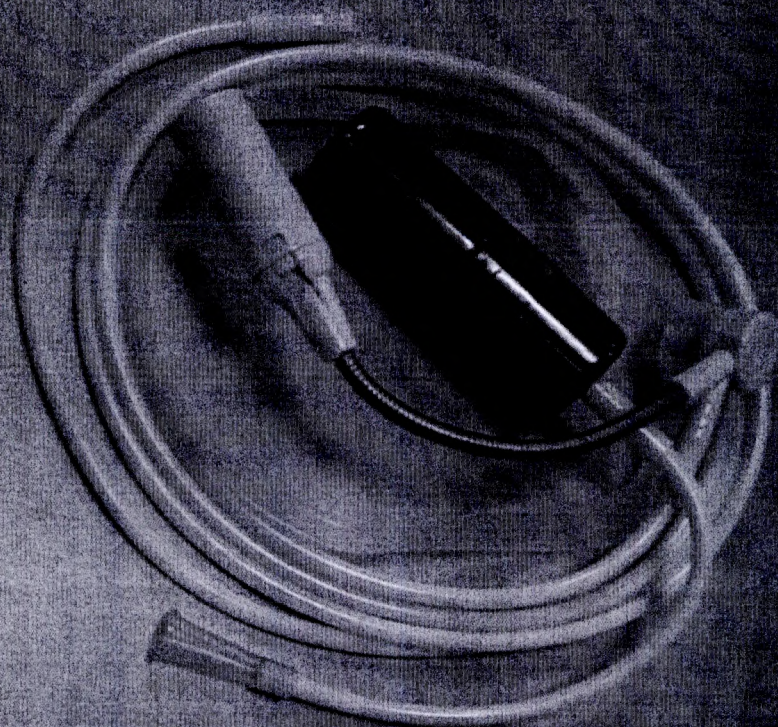


Рис. 9.1.4 – Диффузор (2 шт.)



Рис. 9.2.1 – Фильтр тонкой очистки

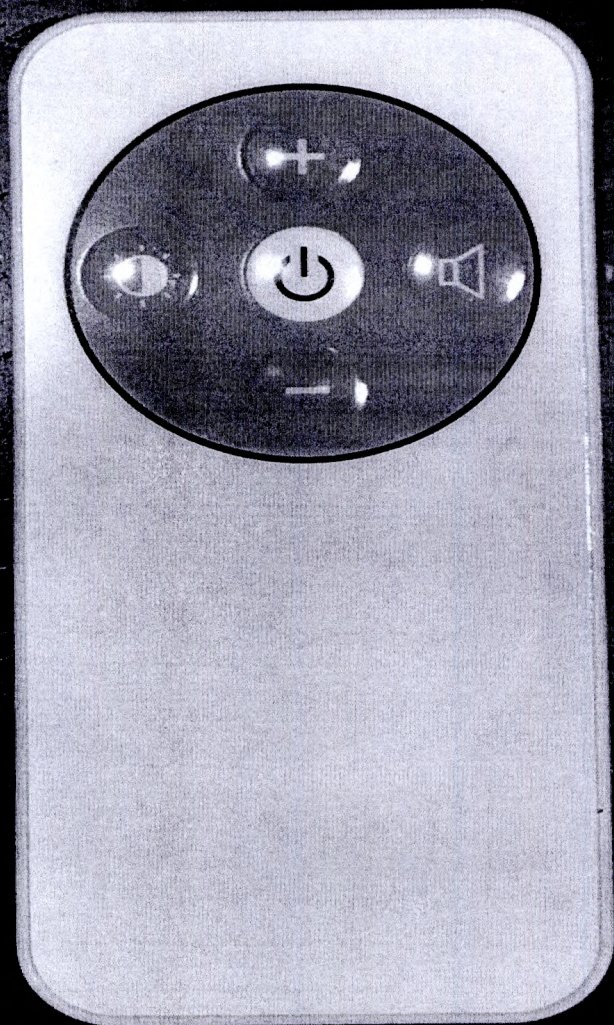


Рис. 9.2.2 – Пульт ДУ

10. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-3BW

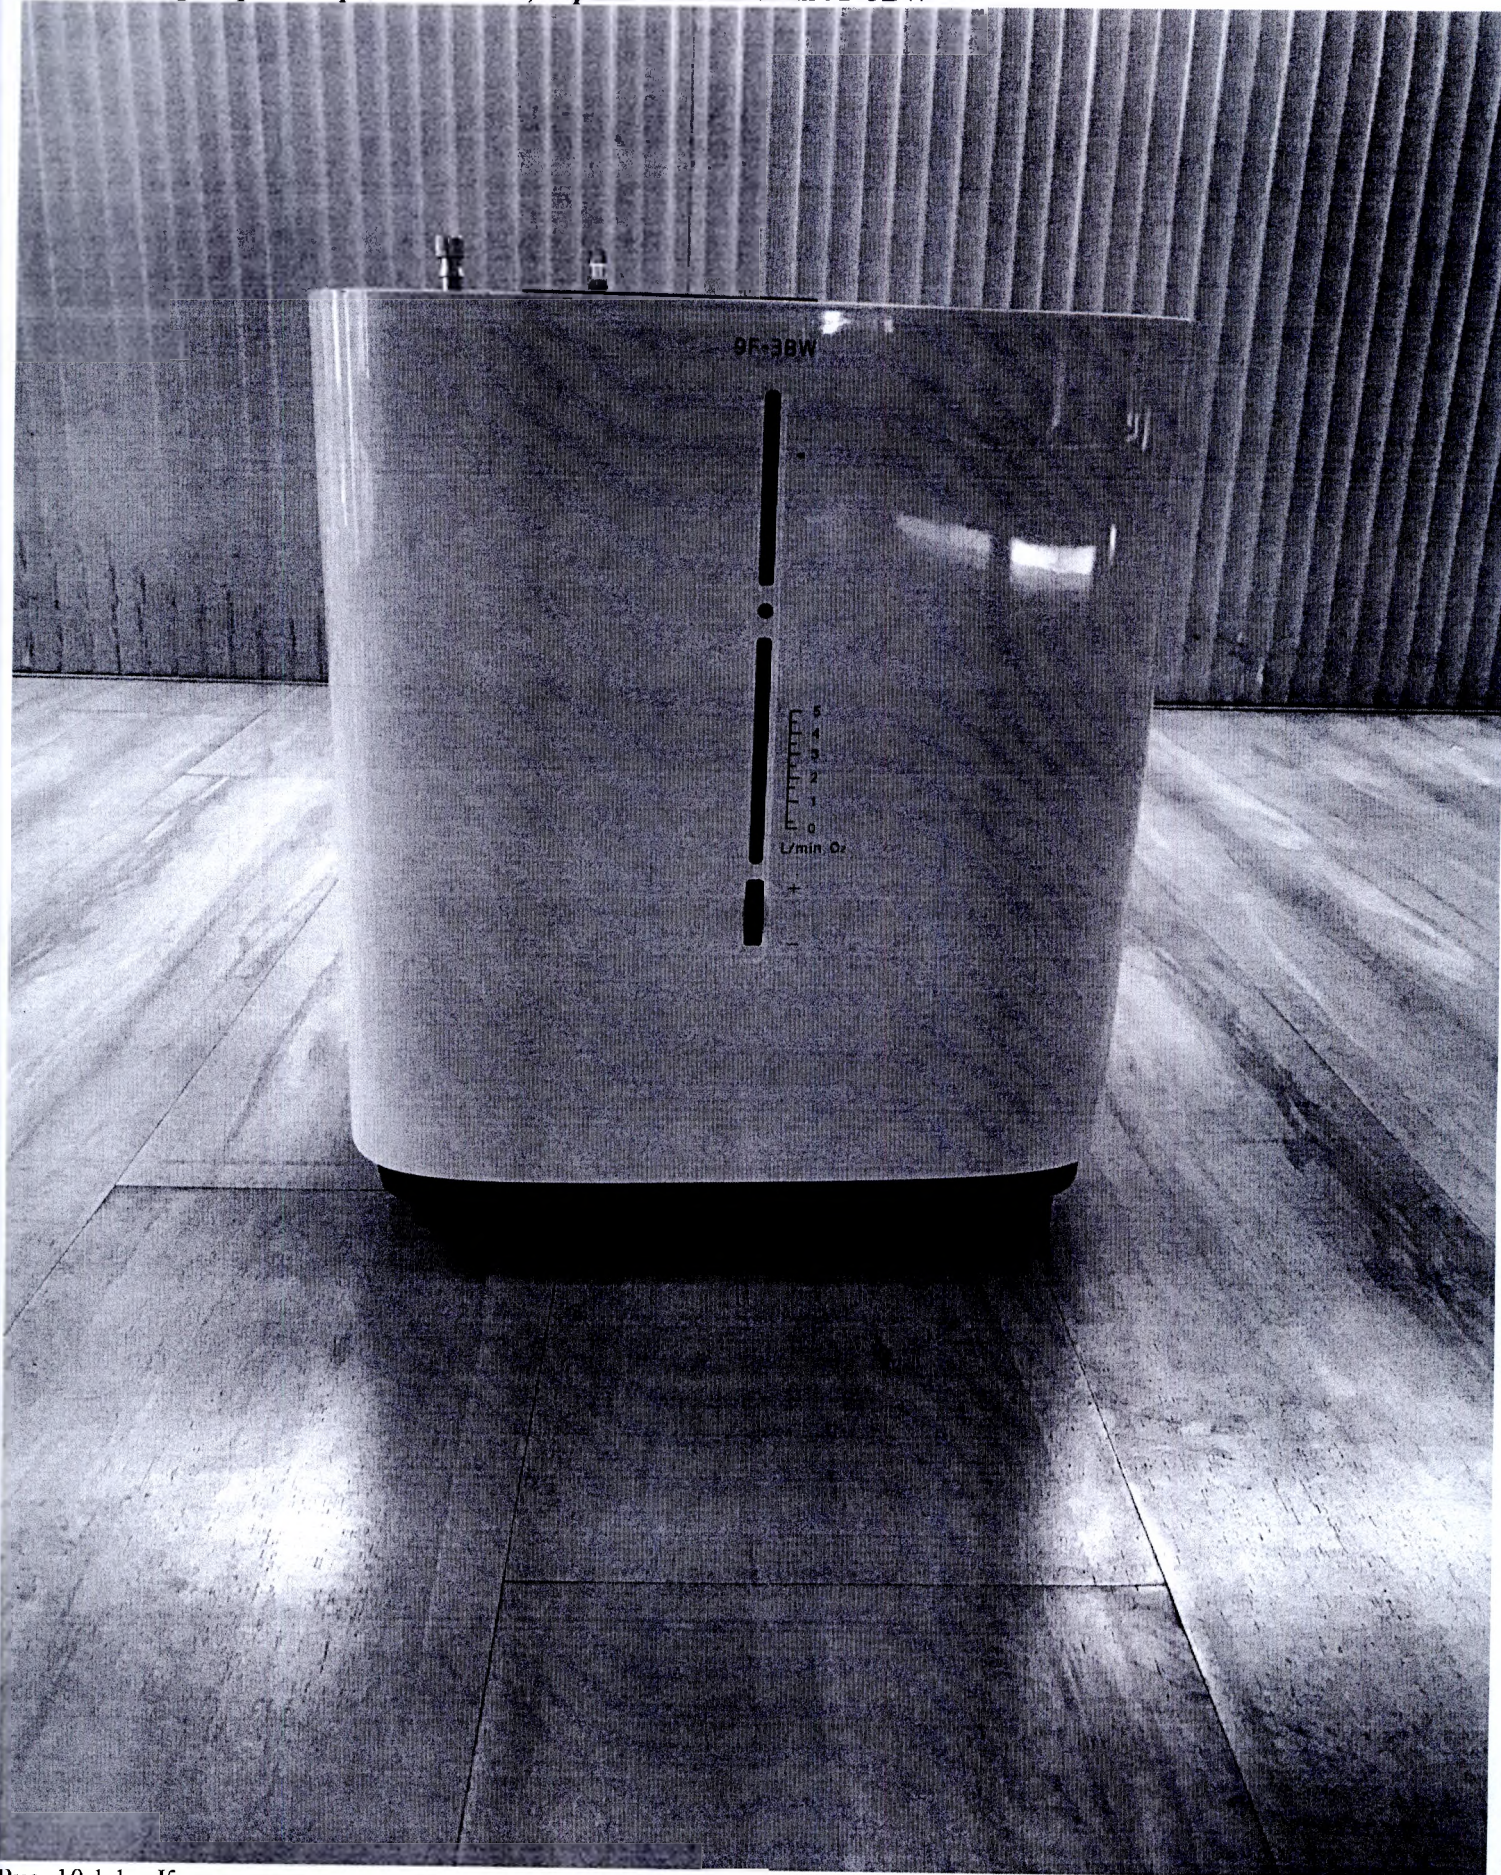


Рис. 10.1.1 – Концентратор кислорода

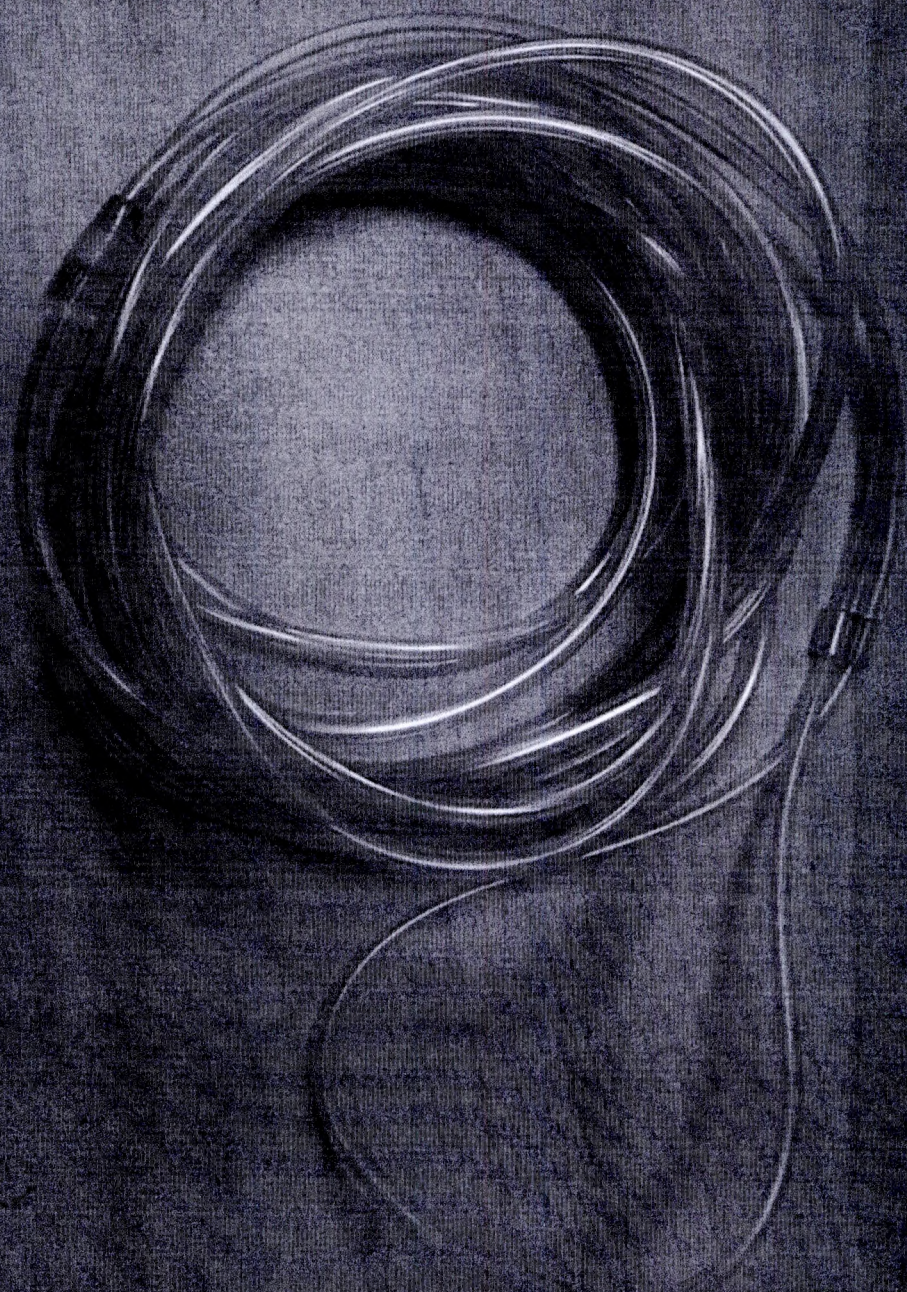


Рис. 10.1.2 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 5 м

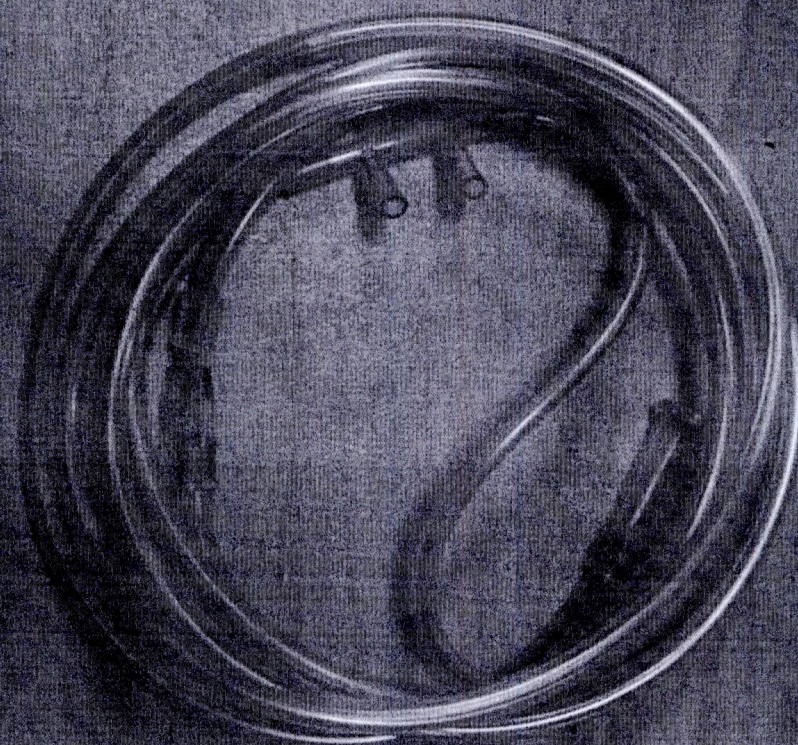


Рис. 10.1.3 – Канюля назальная Ø5 мм, длина 2 м


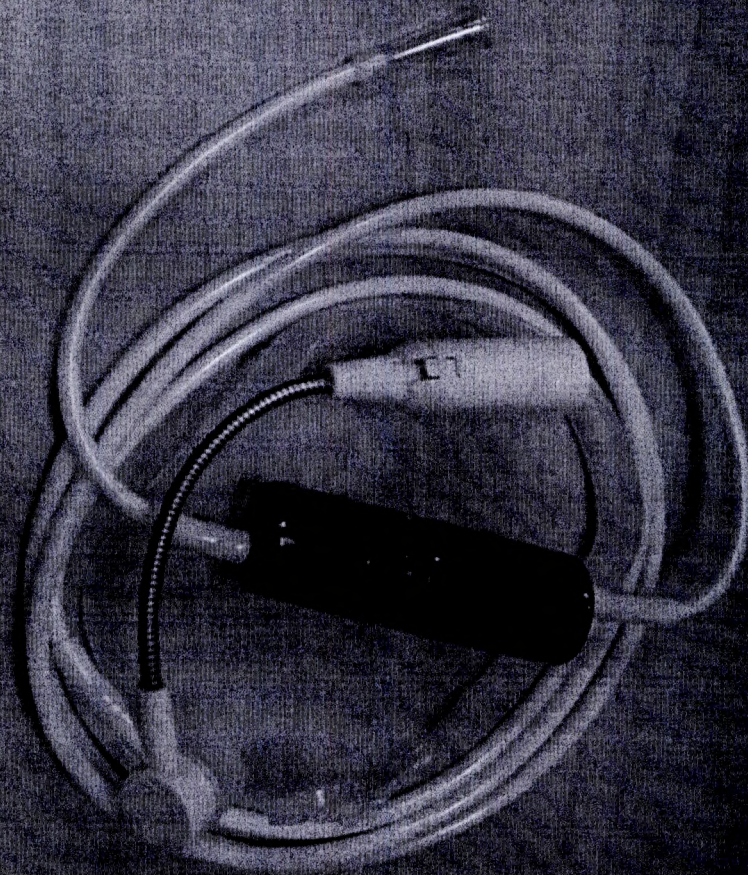


Рис. 10.1.4 – Диффузор (2 шт.)

Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м

Мундштук

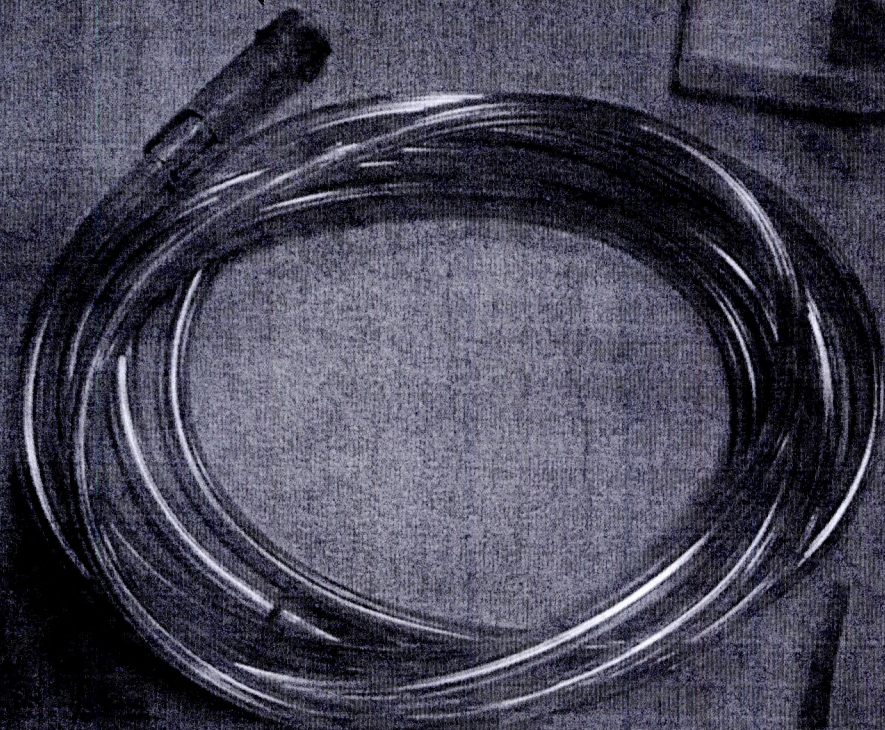

Резервуар распылителя

Рис. 10.1.5 – Комплект для ингаляций (Шланг соединительный Ø5 мм, длина 2 м – 1 шт., Резервуар распылителя – 1 шт., Мундштук – 1 шт.)

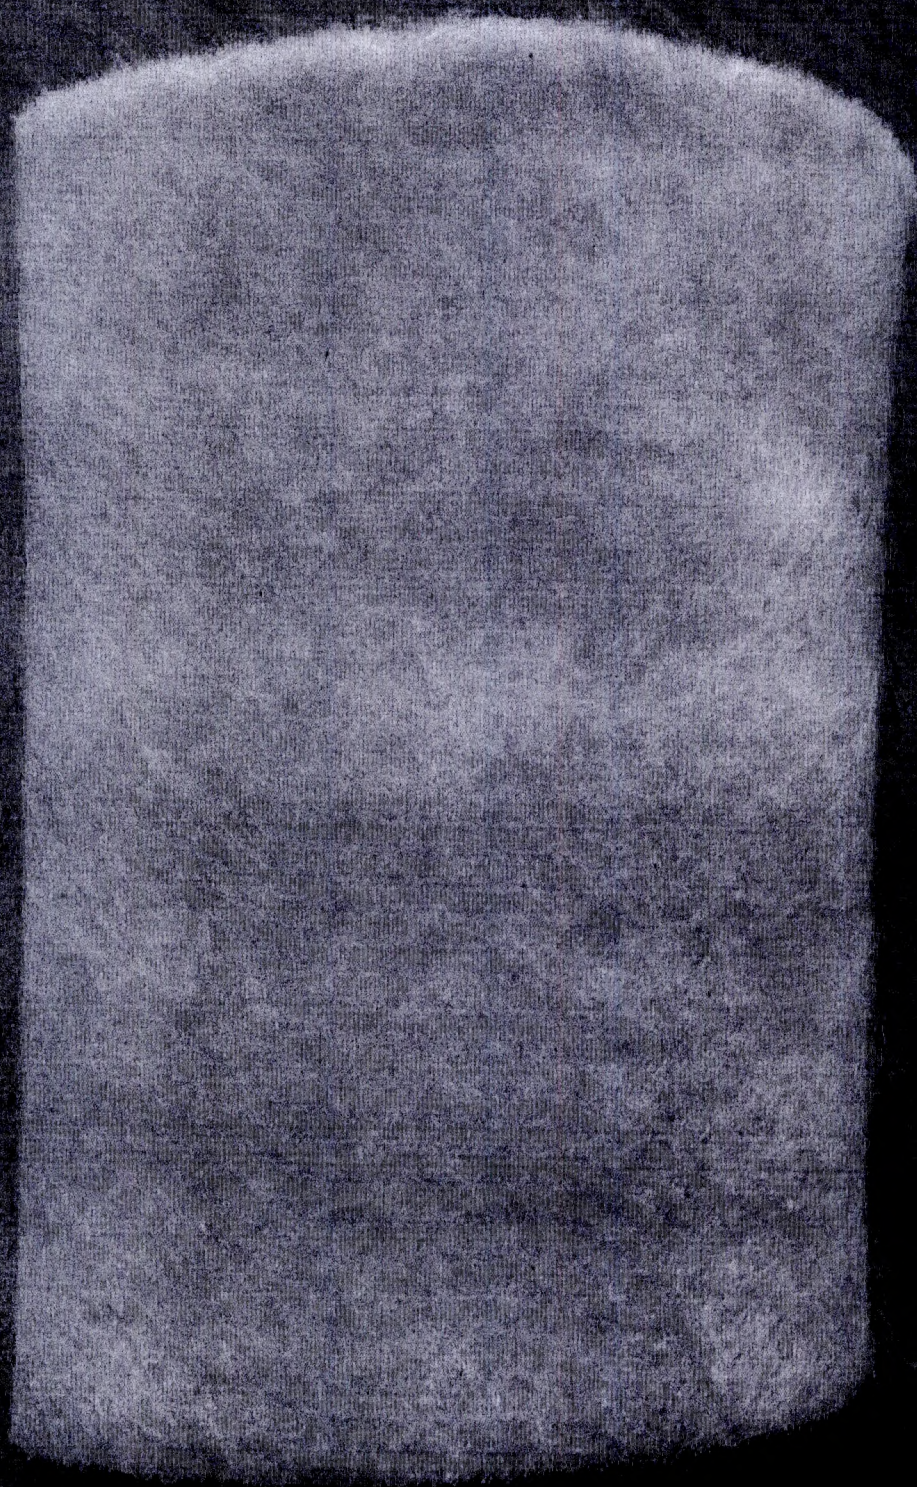


Рис. 10.2.1 – Фильтр тонкой очистки

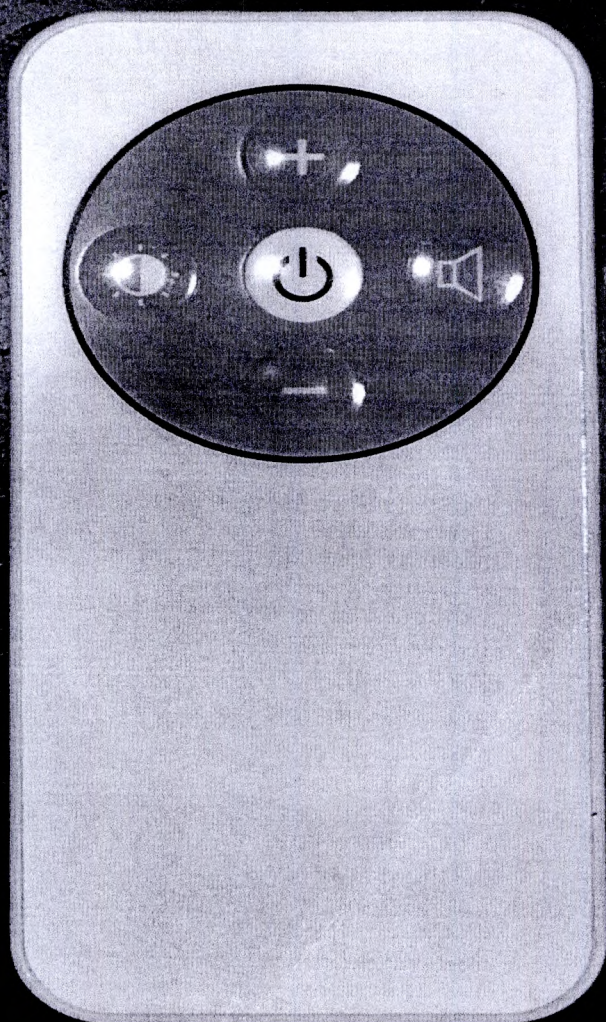


Рис. 10.2.2 – Пульт ДУ

Прошито 68
(шестедят восемь) листов

Генеральный директор
ООО «МЕДИМПОРТ»

Г.Г. Добыш

М.П.

«МЕДИМПОРТ»

