

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Устройство для исследования вибрационной чувствительности «Вибросенсотест» по ТУ 26.60.12-005-63704475-
2018 с принадлежностями:**


г. Москва, 2018

Оглавление

I. Устройство для исследования чувствительности «Вибросенсотест» по ТУ 26.60.12–005–63704475–2018 в составе:	3
1. Вибропреобразователь ВП-01	3
2. Вибропреобразователь ВП-02	4
3. Персональный компьютер	5
4. Кнопка ответа	6
5. Блок питания (модель 1)	7
6. Блок питания (модель 2)	8
7. ПО «Вибросенсотест», (на CD-диске или флеш-карте)	9
8. Руководство по эксплуатации	10
II. Принадлежности:	11
1. Блок управления БУ–01	11
2. Блок управления БУ–02	12
3. Блок коммутационный БК	13
4. Штатив	14
5. Опора для ступни	15
6. Кабель интерфейсный.	16


I. Устройство для исследования чувствительности «Вибросенсотест» по ТУ 26.60.12-005-63704475-2018 в составе:

1. Вибропреобразователь ВП-01

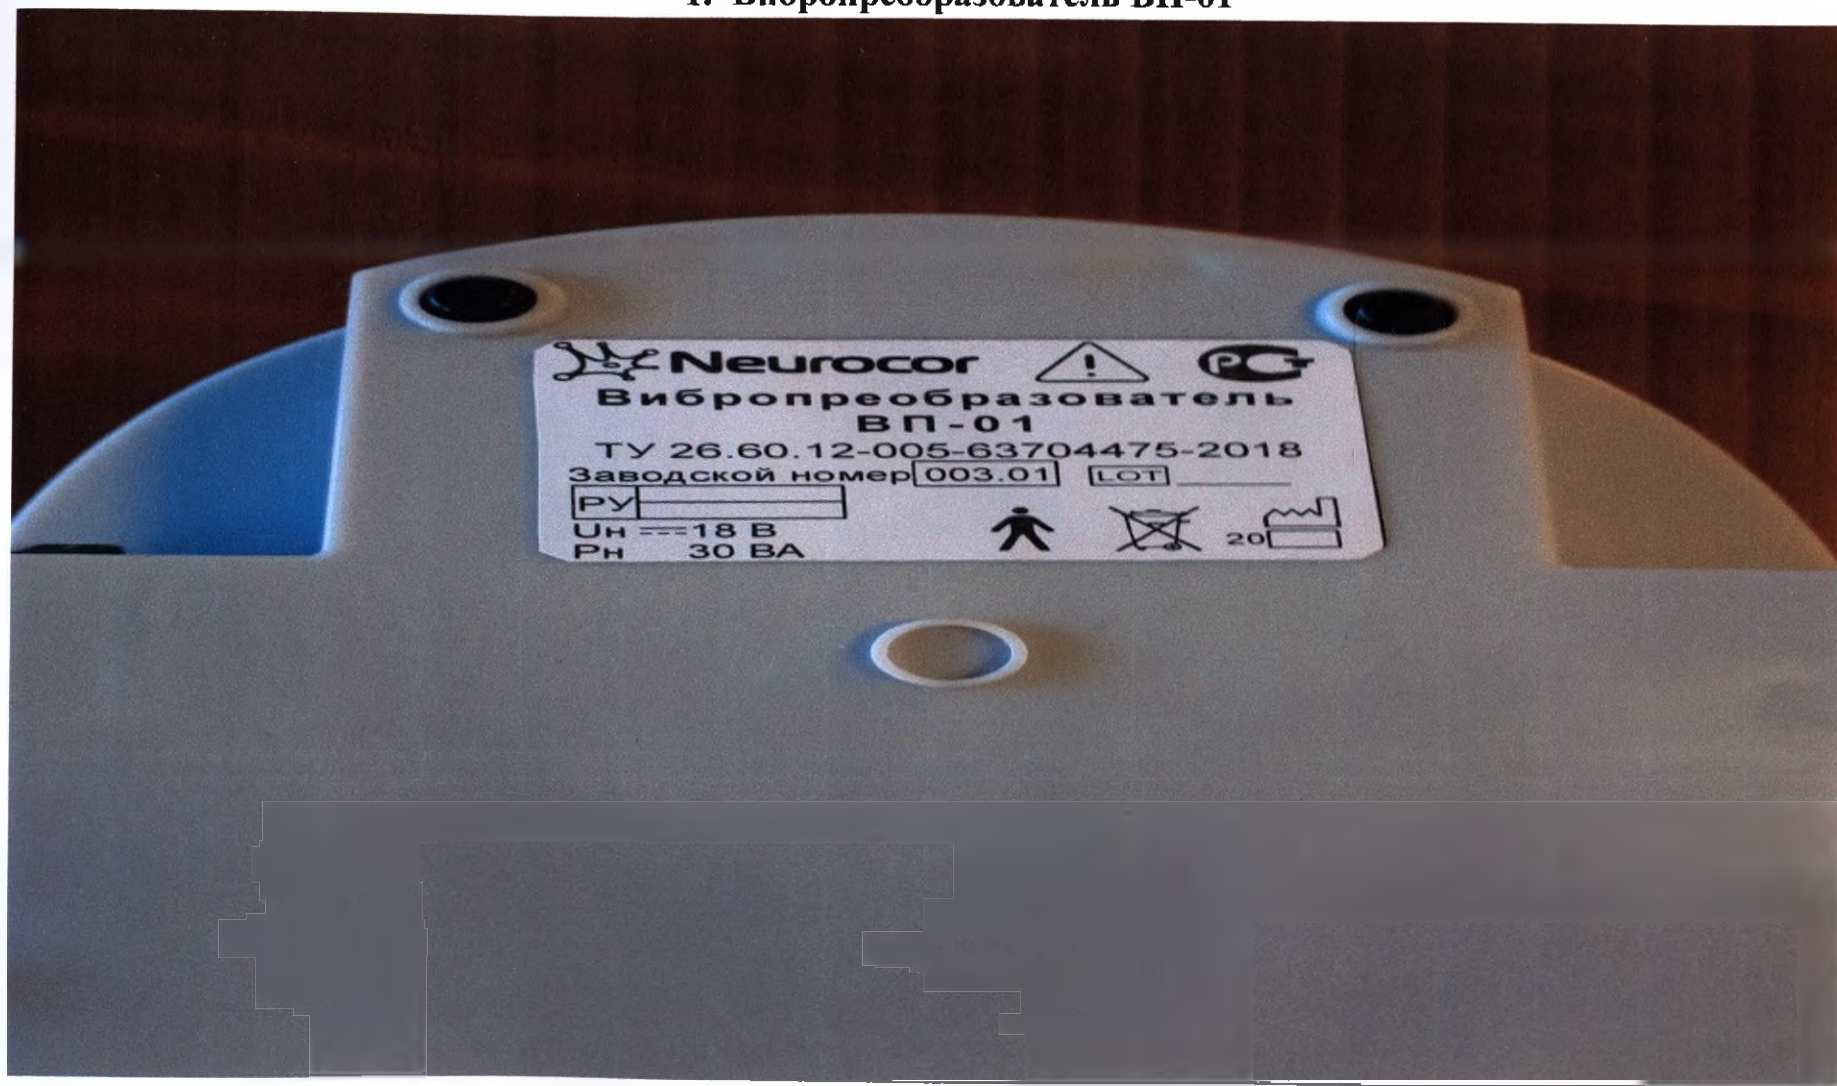

2. Вибропреобразователь ВП-02



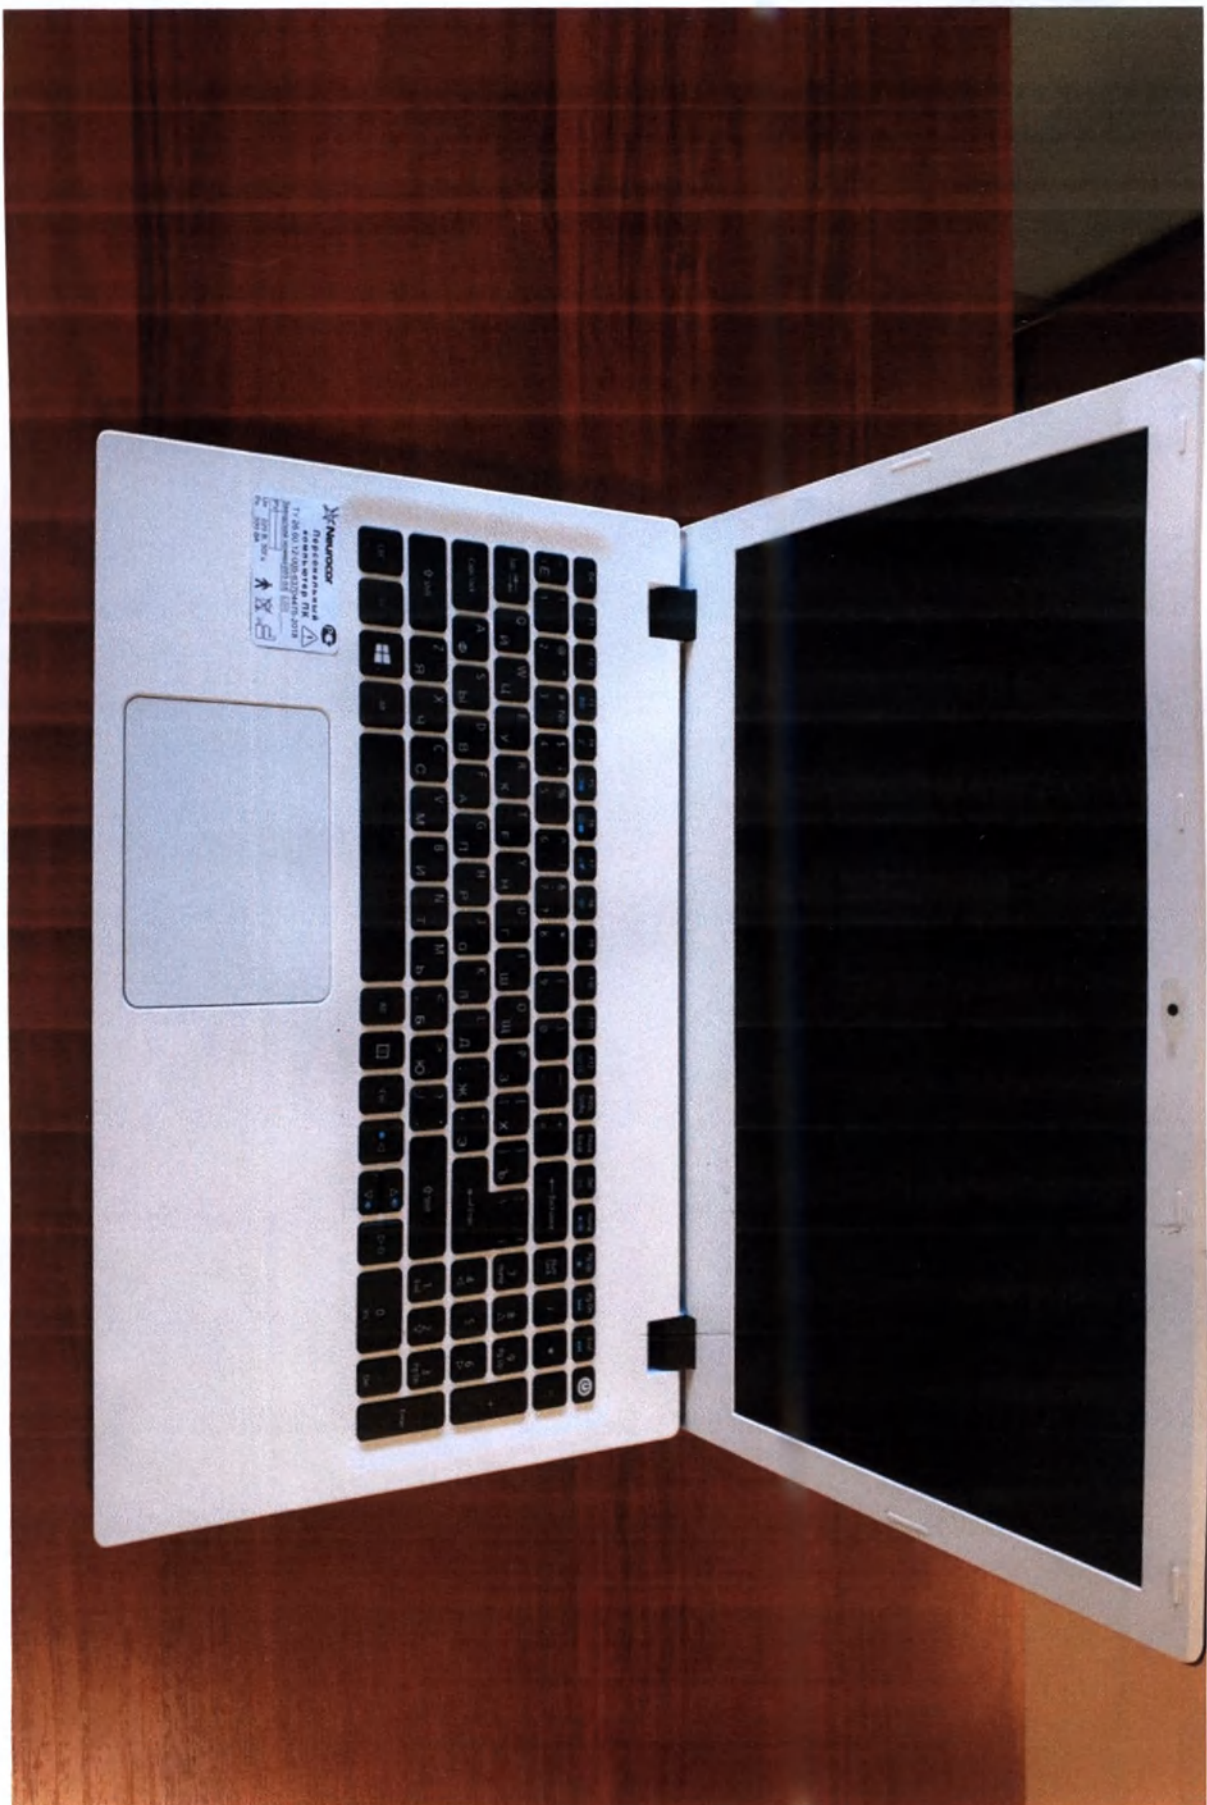

4. Кнопка ответа.




5. Блок питания (модель 1)



6. Блок питания (модель 2)



7. ПО «Вибросенсотест», (на CD-диске или флеш-карте)

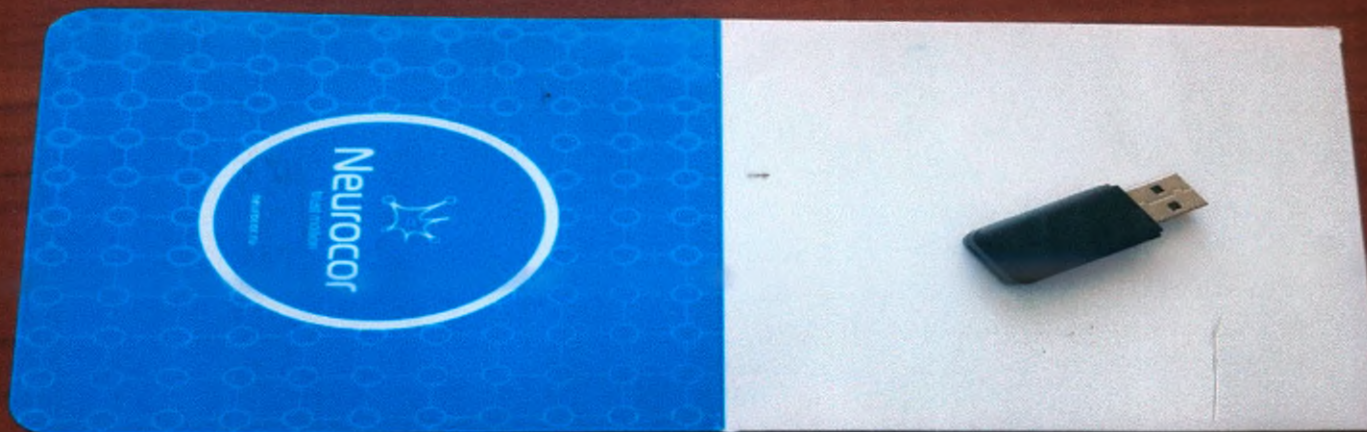

 **Neurocor** 

ПО «Вибросенсотест»

ТУ 26.60.12-005-63704475-2018

8. Руководство по эксплуатации

Проектная документация на строительство «Видросенсорность»		ООО «Небоскор» Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Небоскор»	
ТУ 38.6013-002-63.04422-2018 «Видросенсорность» Устройство для несвязывания выдыхающей		ИЗДАТЕЛЬСТВО на МН	
Версия: 1		Номер документа: РЗ 38.6013-002-63.04422-2018	
Дата выпуска: «02» апреля 2018 г.		Страница: 1 из 28	

руководство по эксплуатации
устройство для несвязывания выдыхающей «Видросенсорность»
по ТУ 38.6013-002-63.04422-2018

РЗ 38.6013-002-63.04422-2018

1. Блок управления БУ-01







3. Блок коммутационный БК



4. Штатив

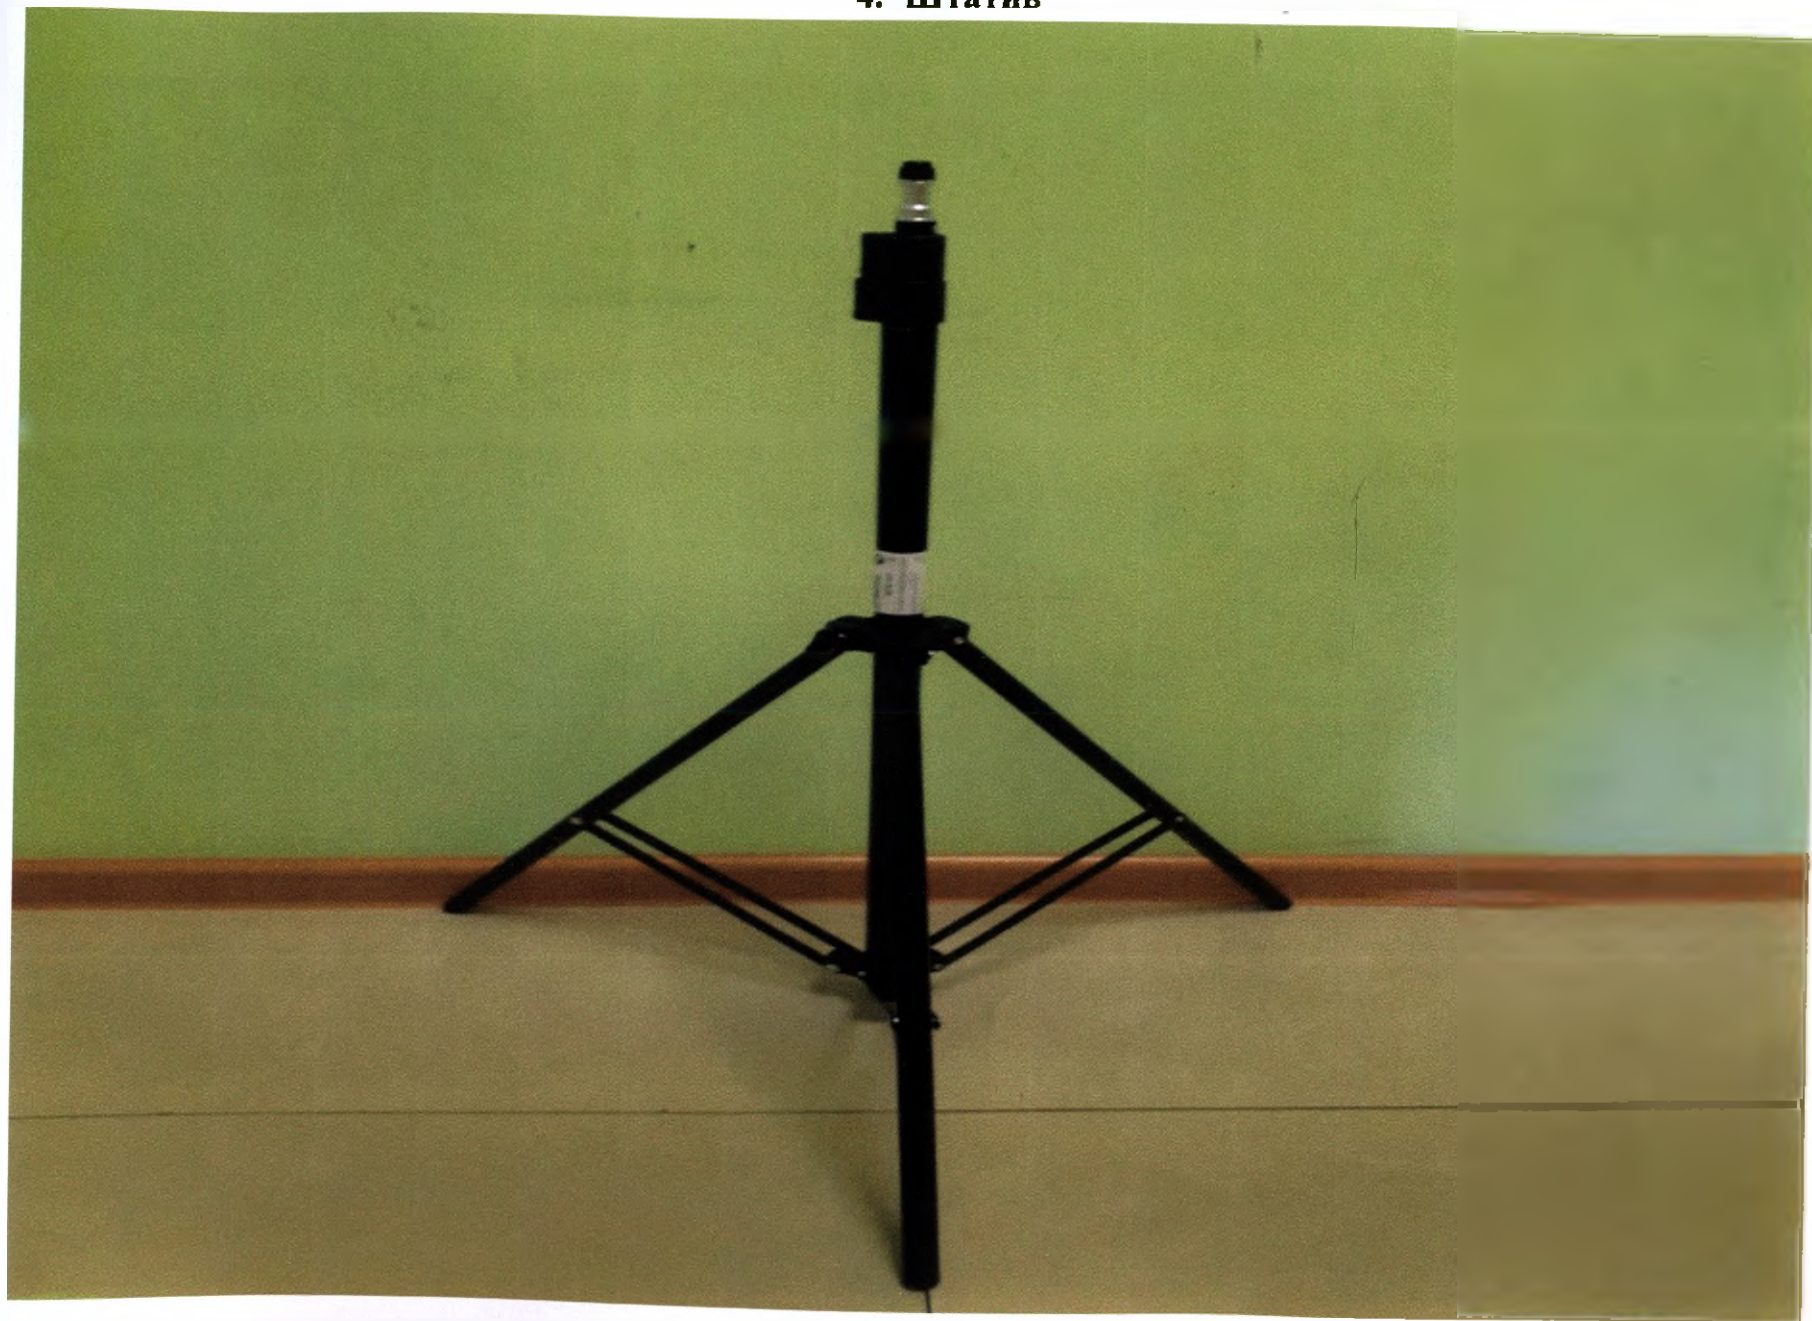

5. Опора для ступни

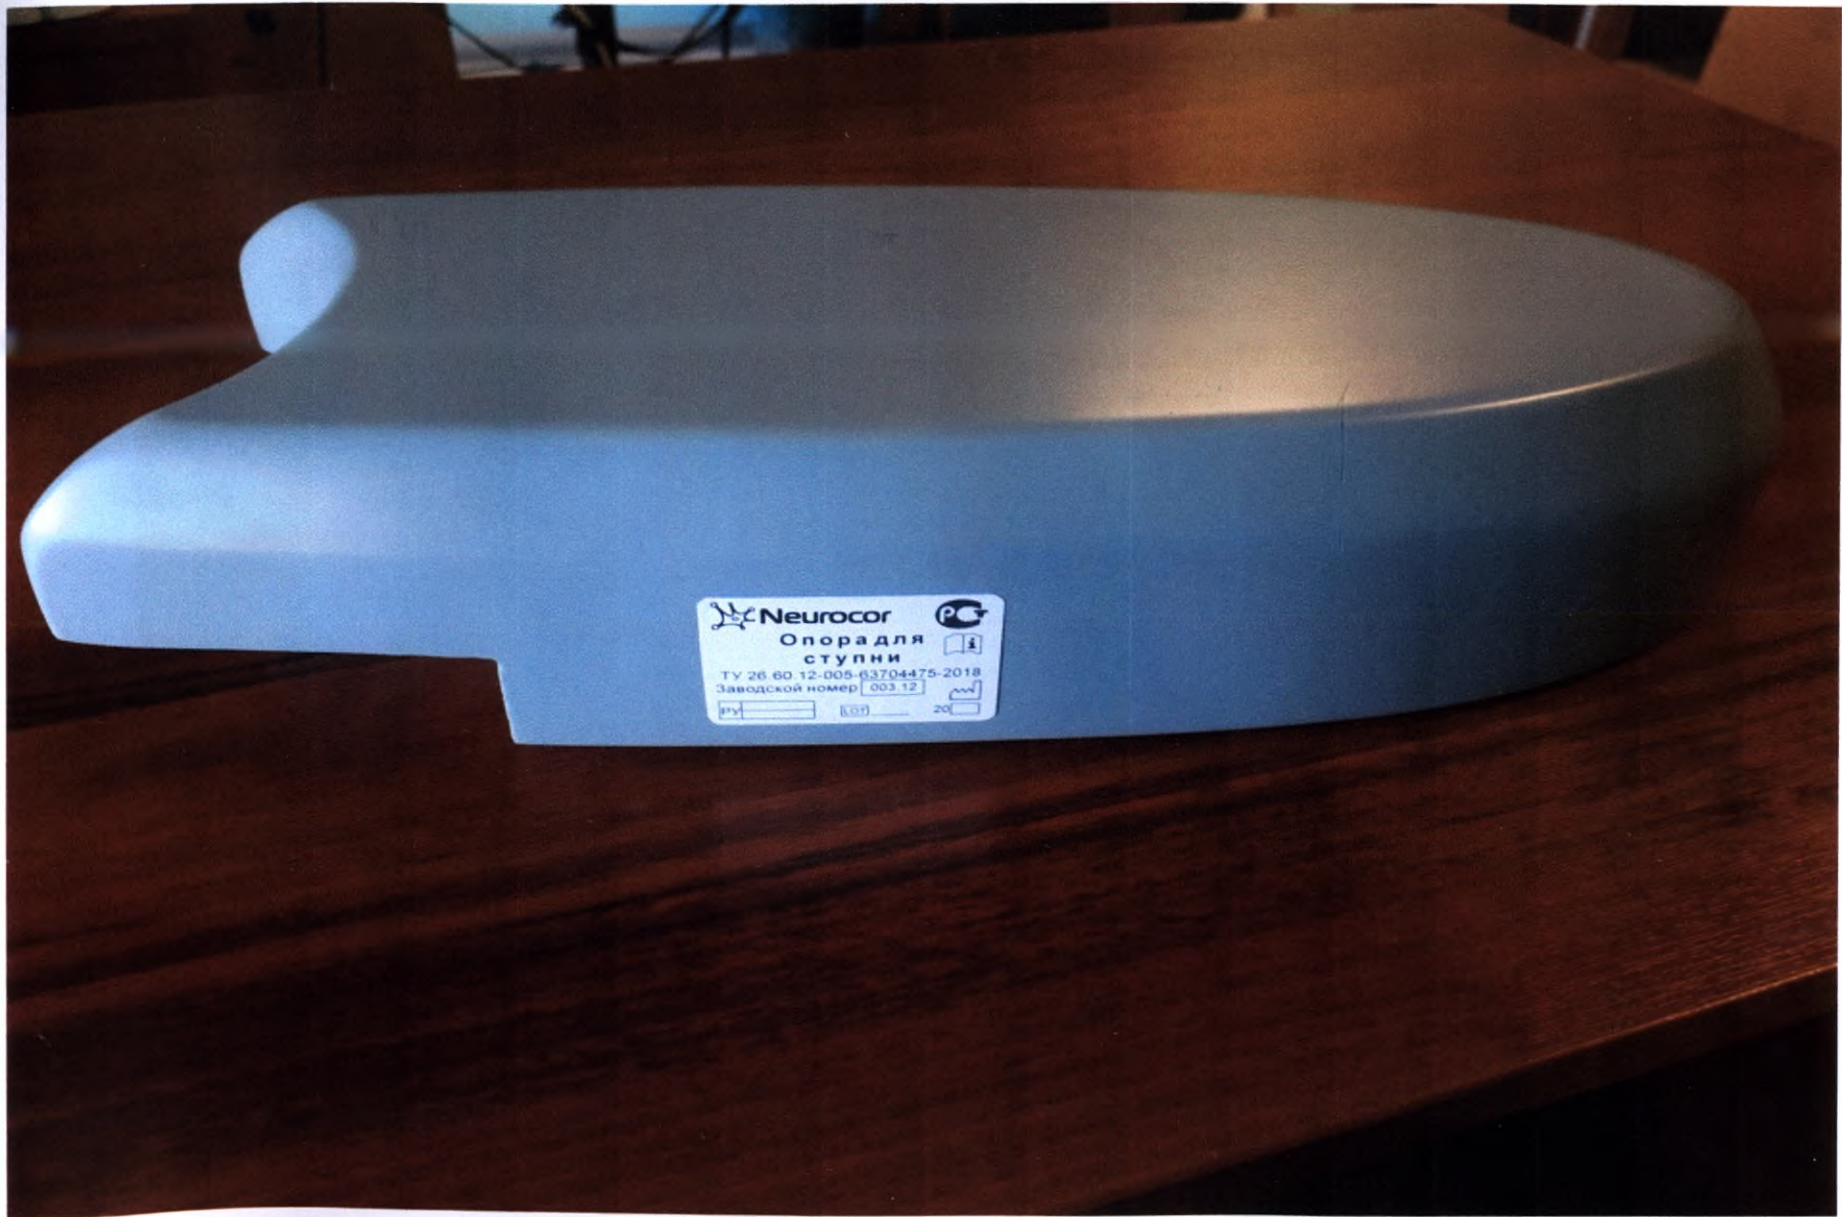

6. Кабель интерфейсный.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 16 листов

Генеральный директор
ООО "Неврокор"




Ишутин Д.В.