




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-
Irrigated с принадлежностями, варианты
исполнения»**

Общий вид: «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated с принадлежностями, варианты исполнения».

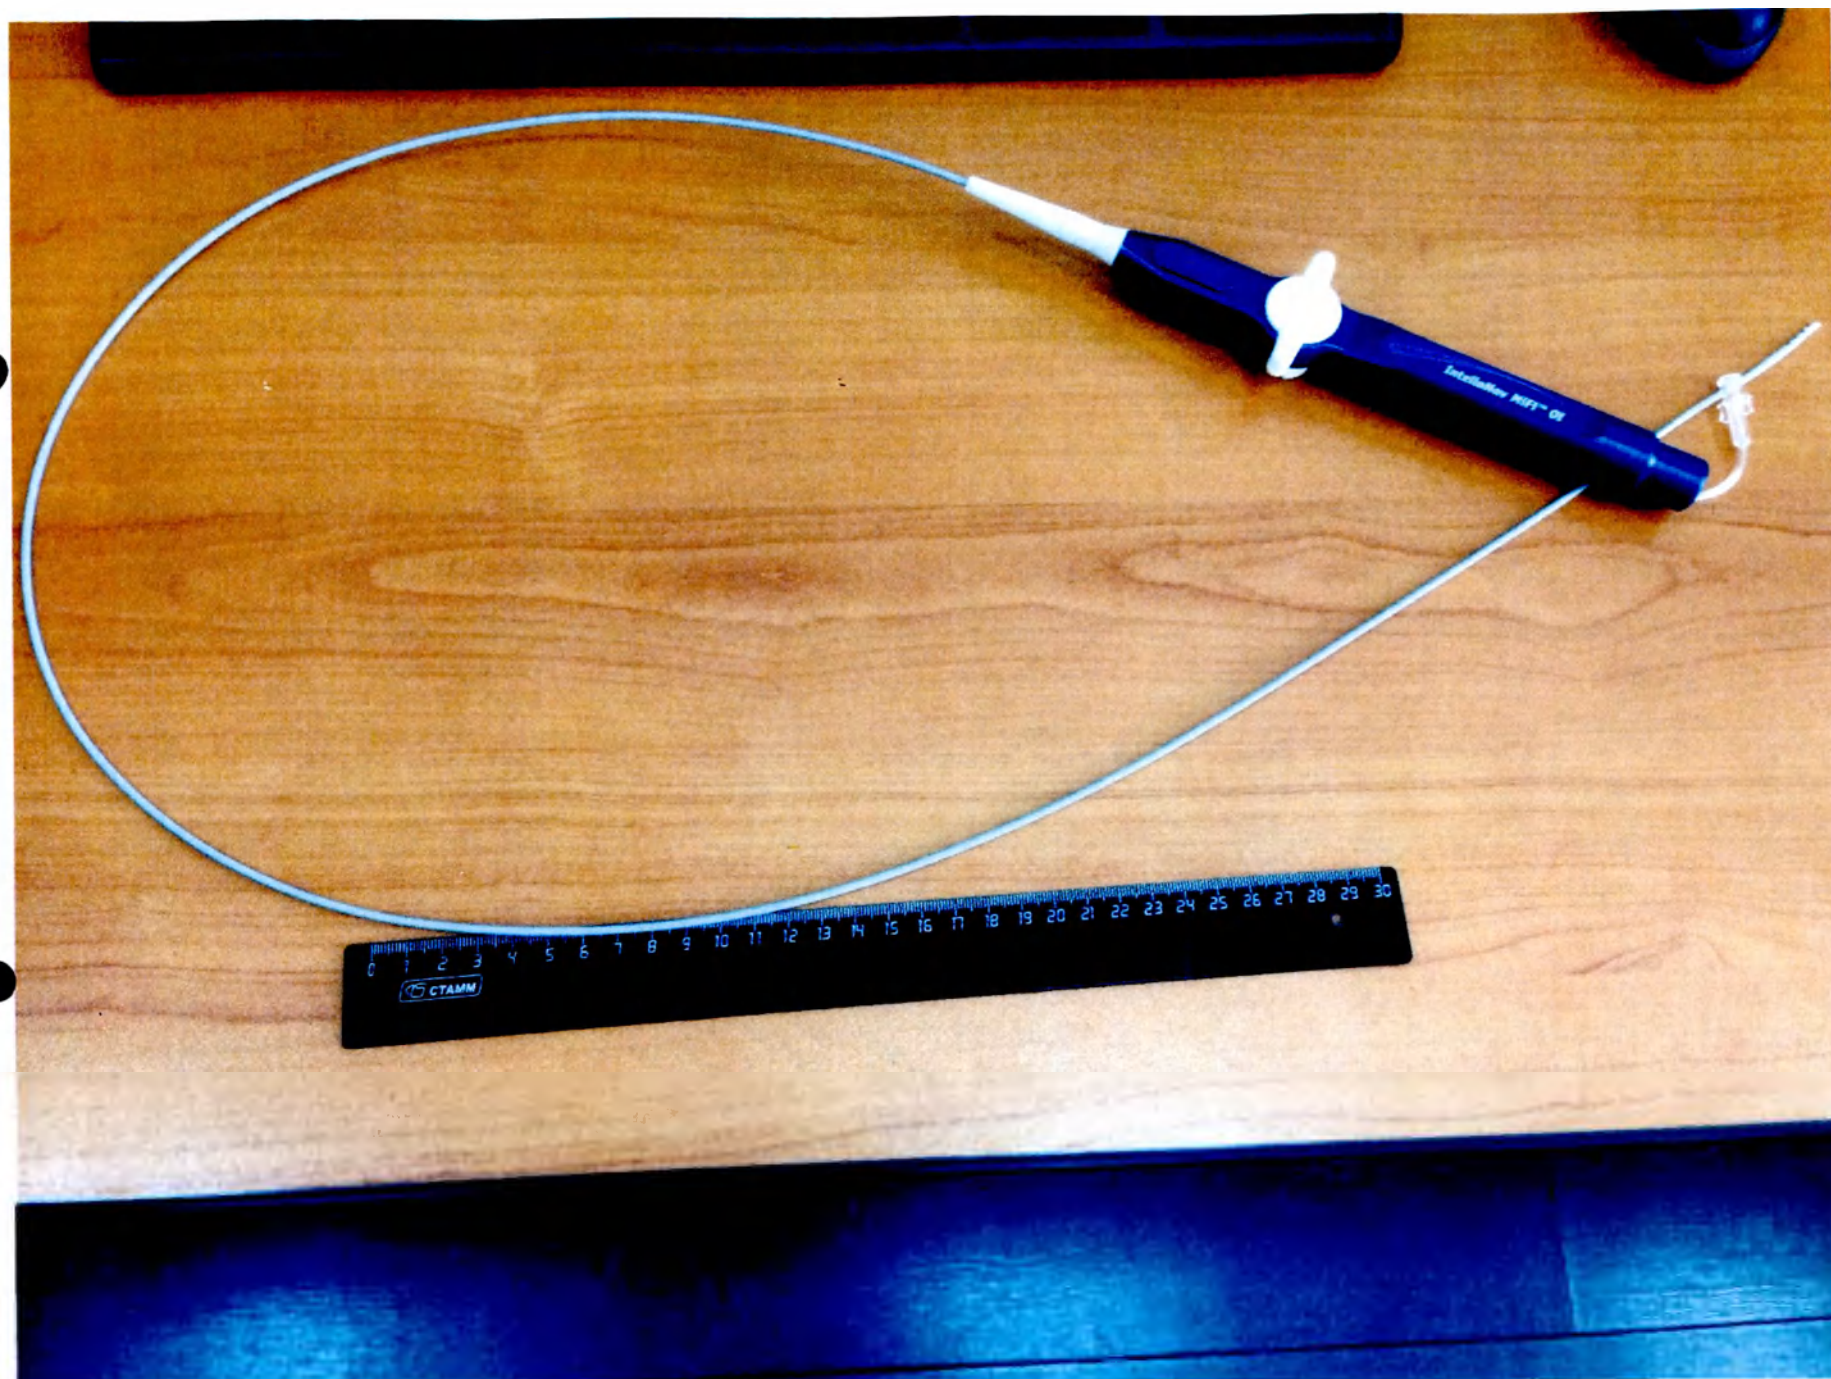


Дистальный стержень.



Дистальный кончик (электрод кончика, кольцевые электроды, мини-электроды, порты для орошения) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated с принадлежностями, варианты исполнения».



Компенсатор натяжения

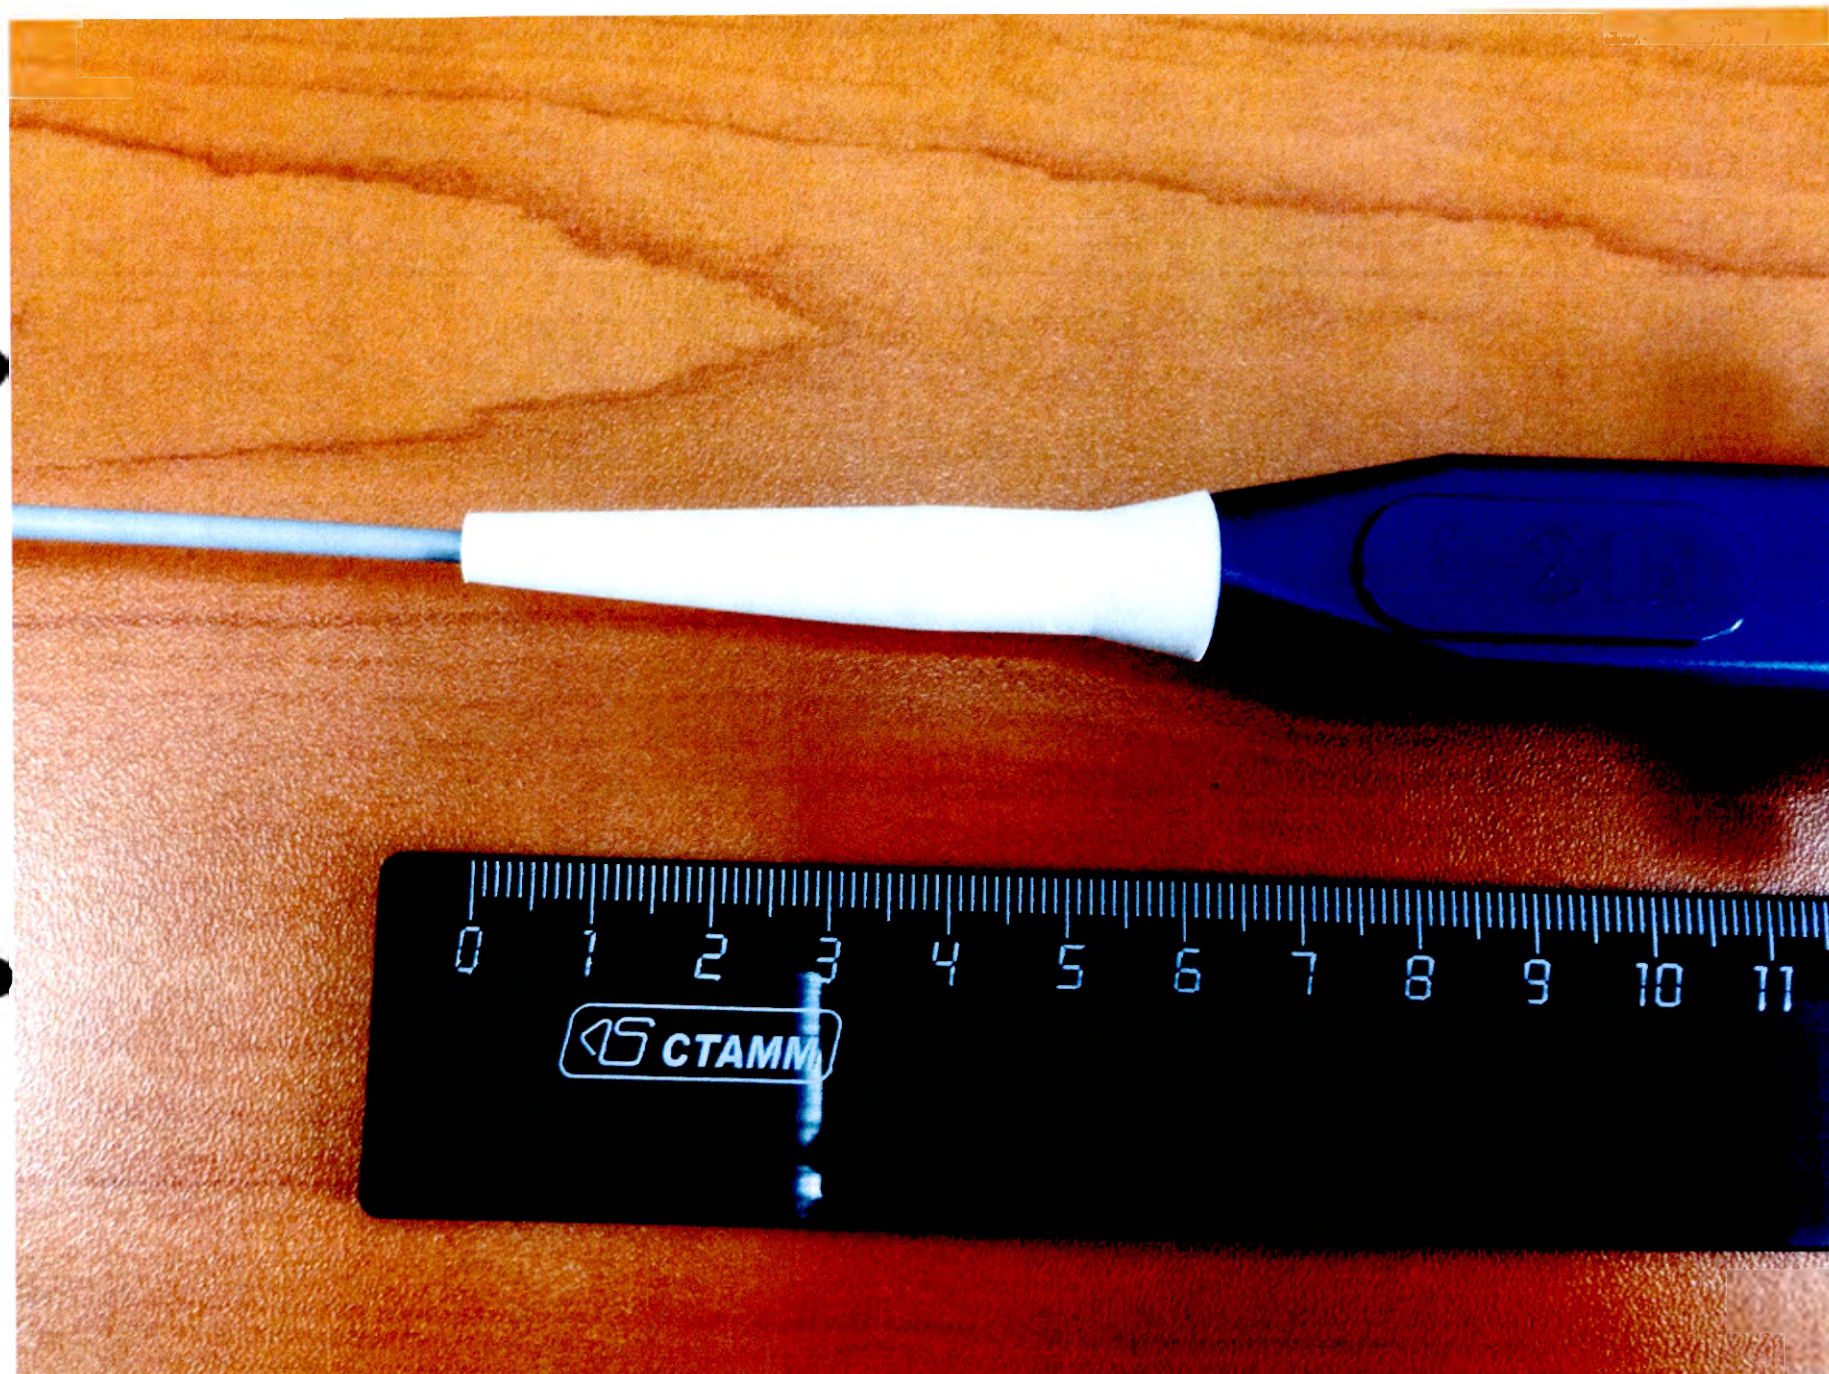


Рукоятка (ручка управления, ручка регуляции натяжения).




Кабельный разъем, удлинительная трубка охлаждения.



Насадка Люэра.

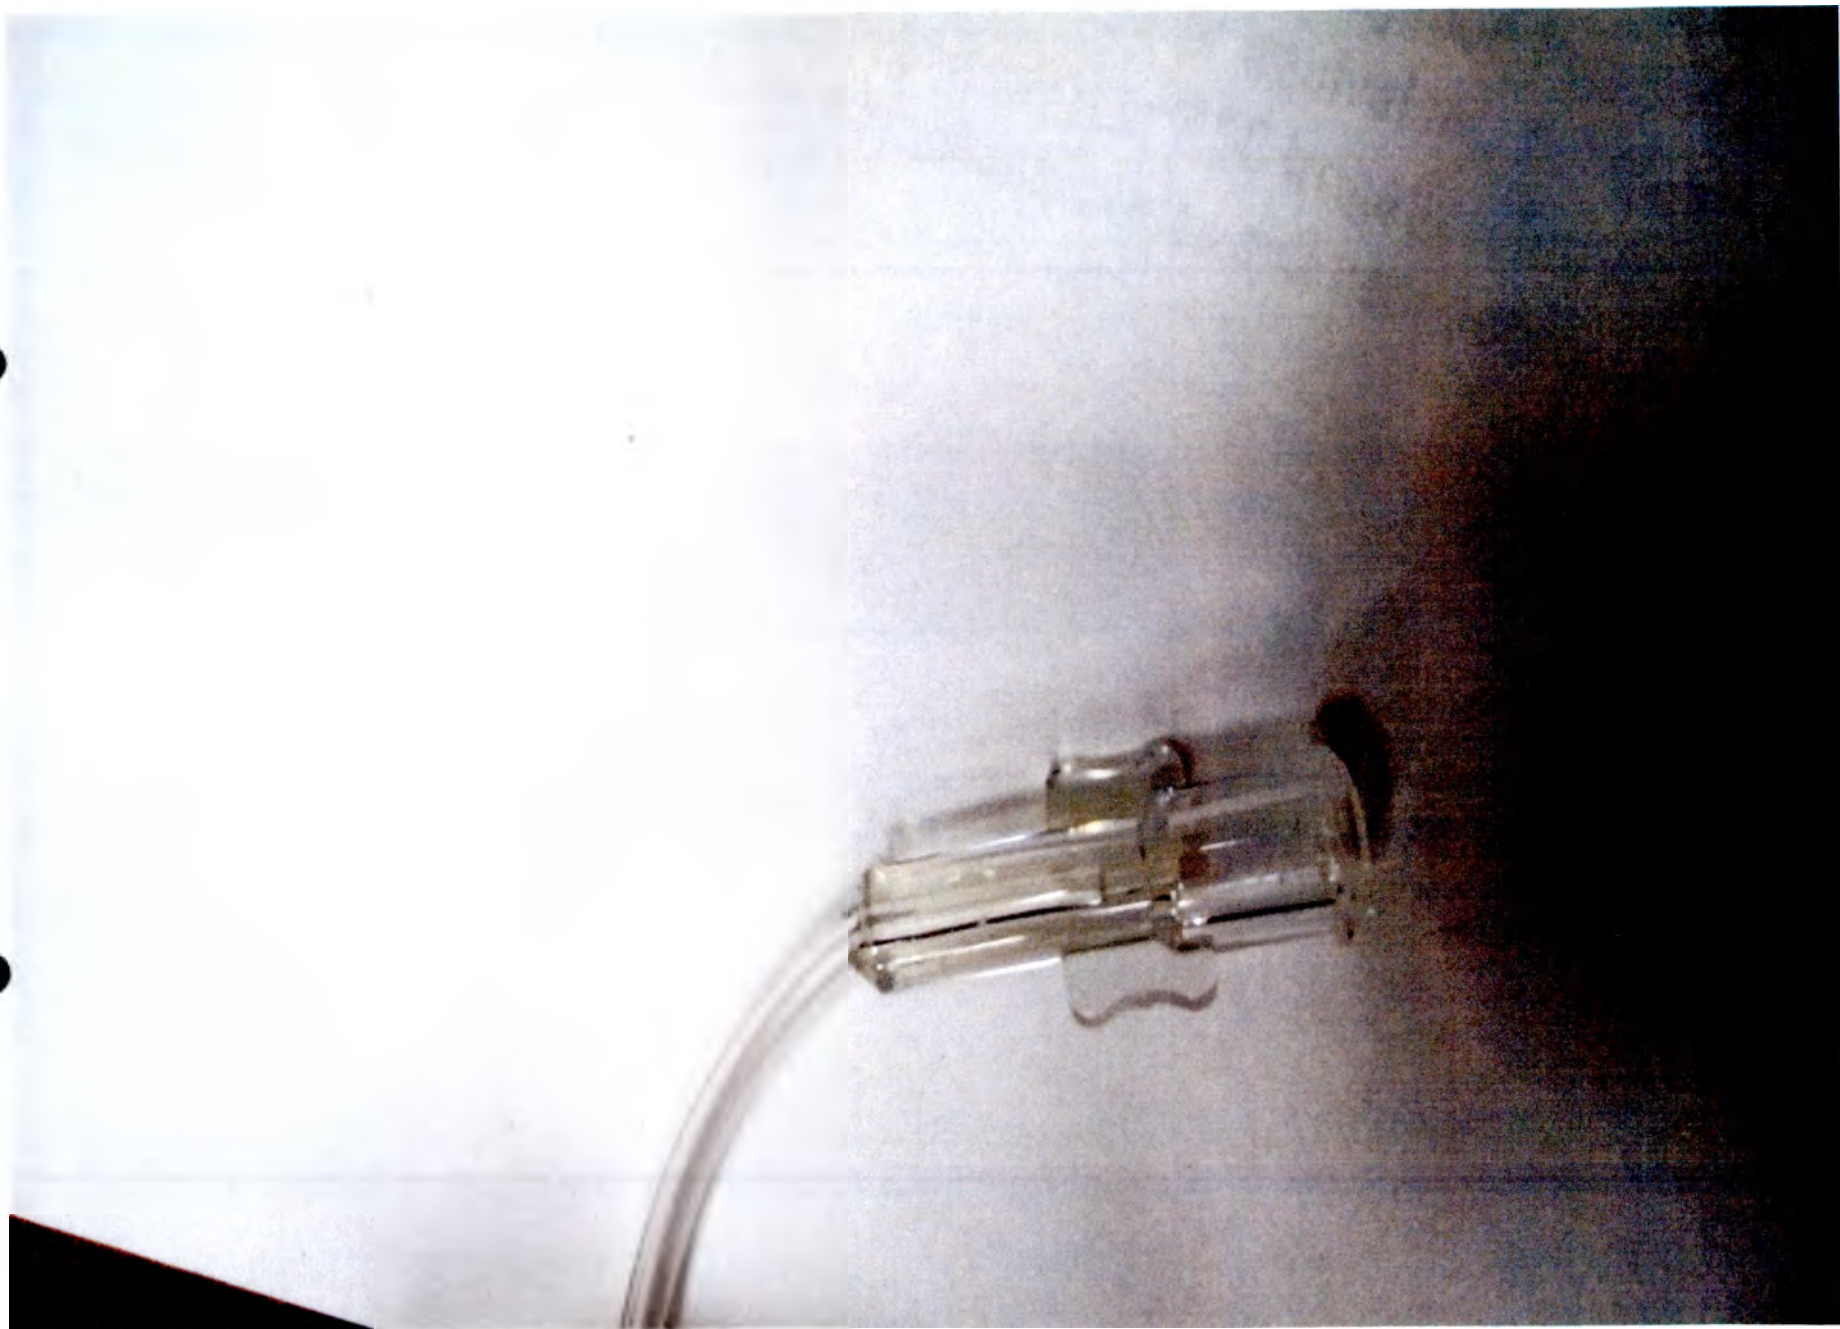

Защитная трубка.

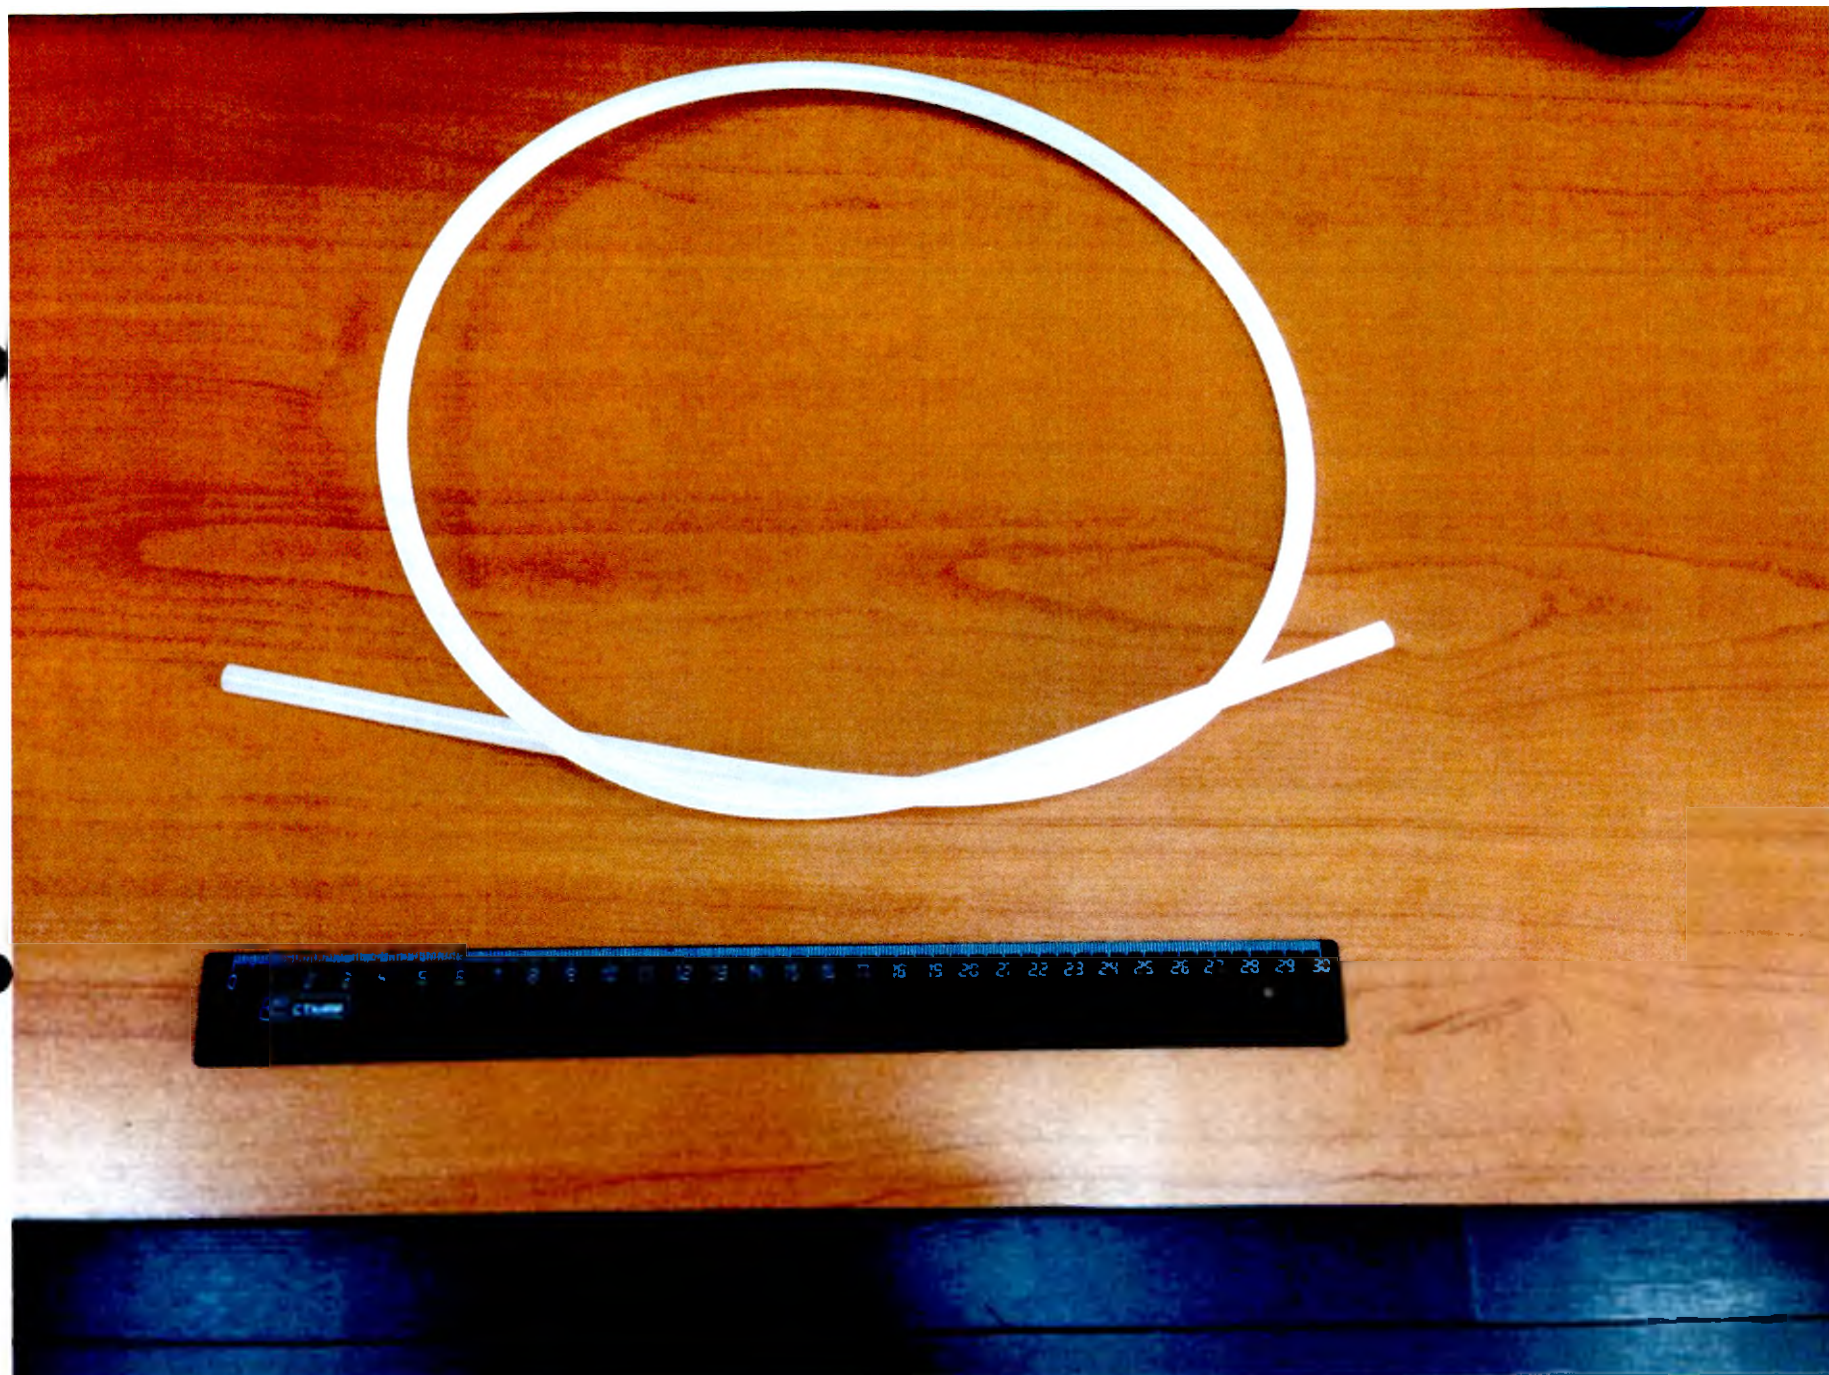

Термоформованная подложка.




Термоформованная подложка со вложенным катетером.



Запечатываемый пакет (лицевая сторона) со вложенными термоформованной подложкой и катетером.



Запечатываемый пакет (обратная сторона).

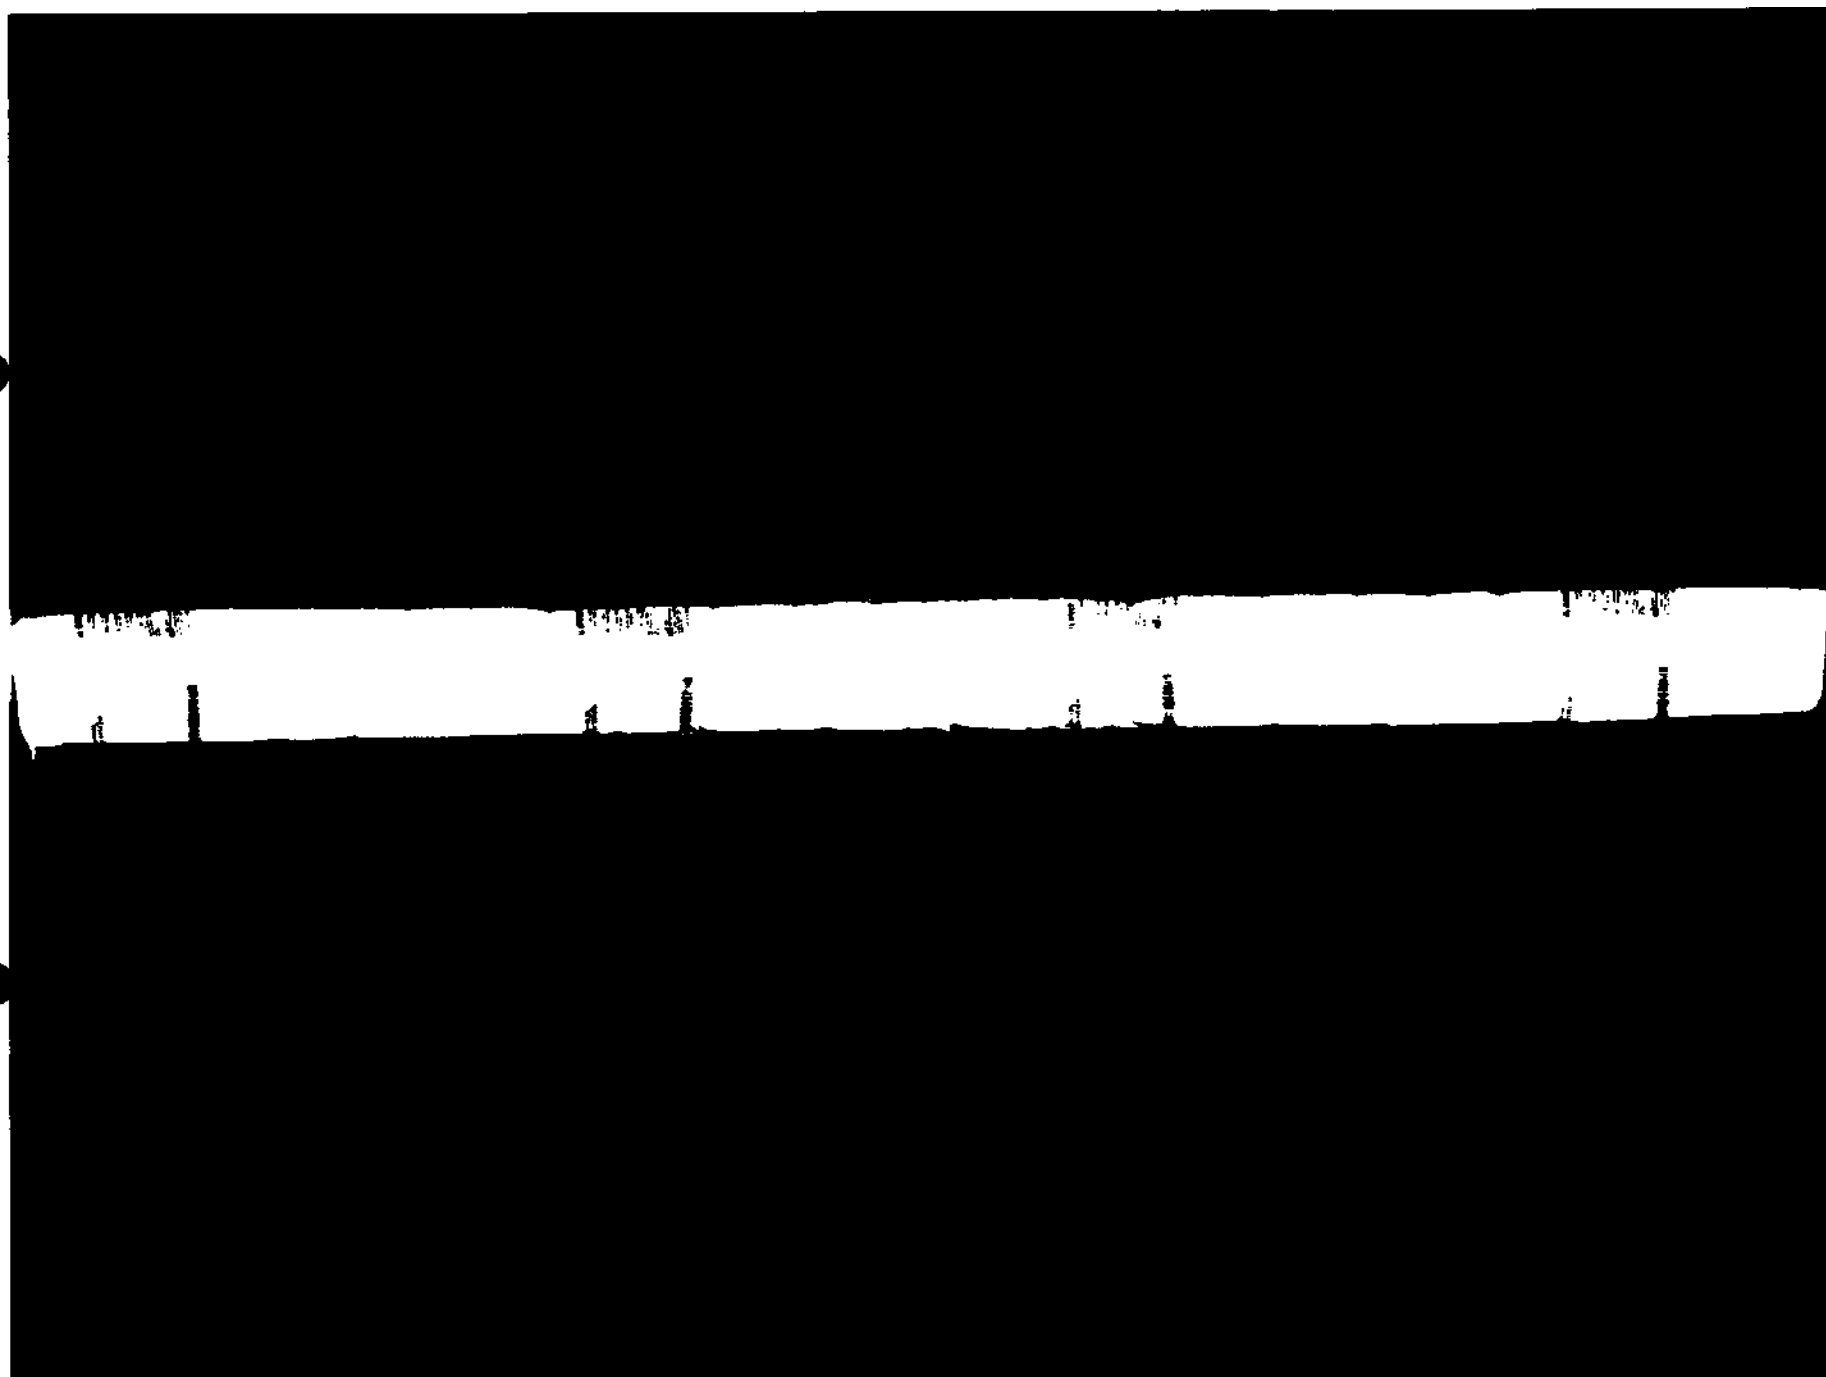

Картонная коробка (лицевая сторона).




Картонная коробка (обратная сторона).



Картонная коробка (верхняя сторона). МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: большая».




Картонная коробка (верхняя сторона). МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: ассиметричная».

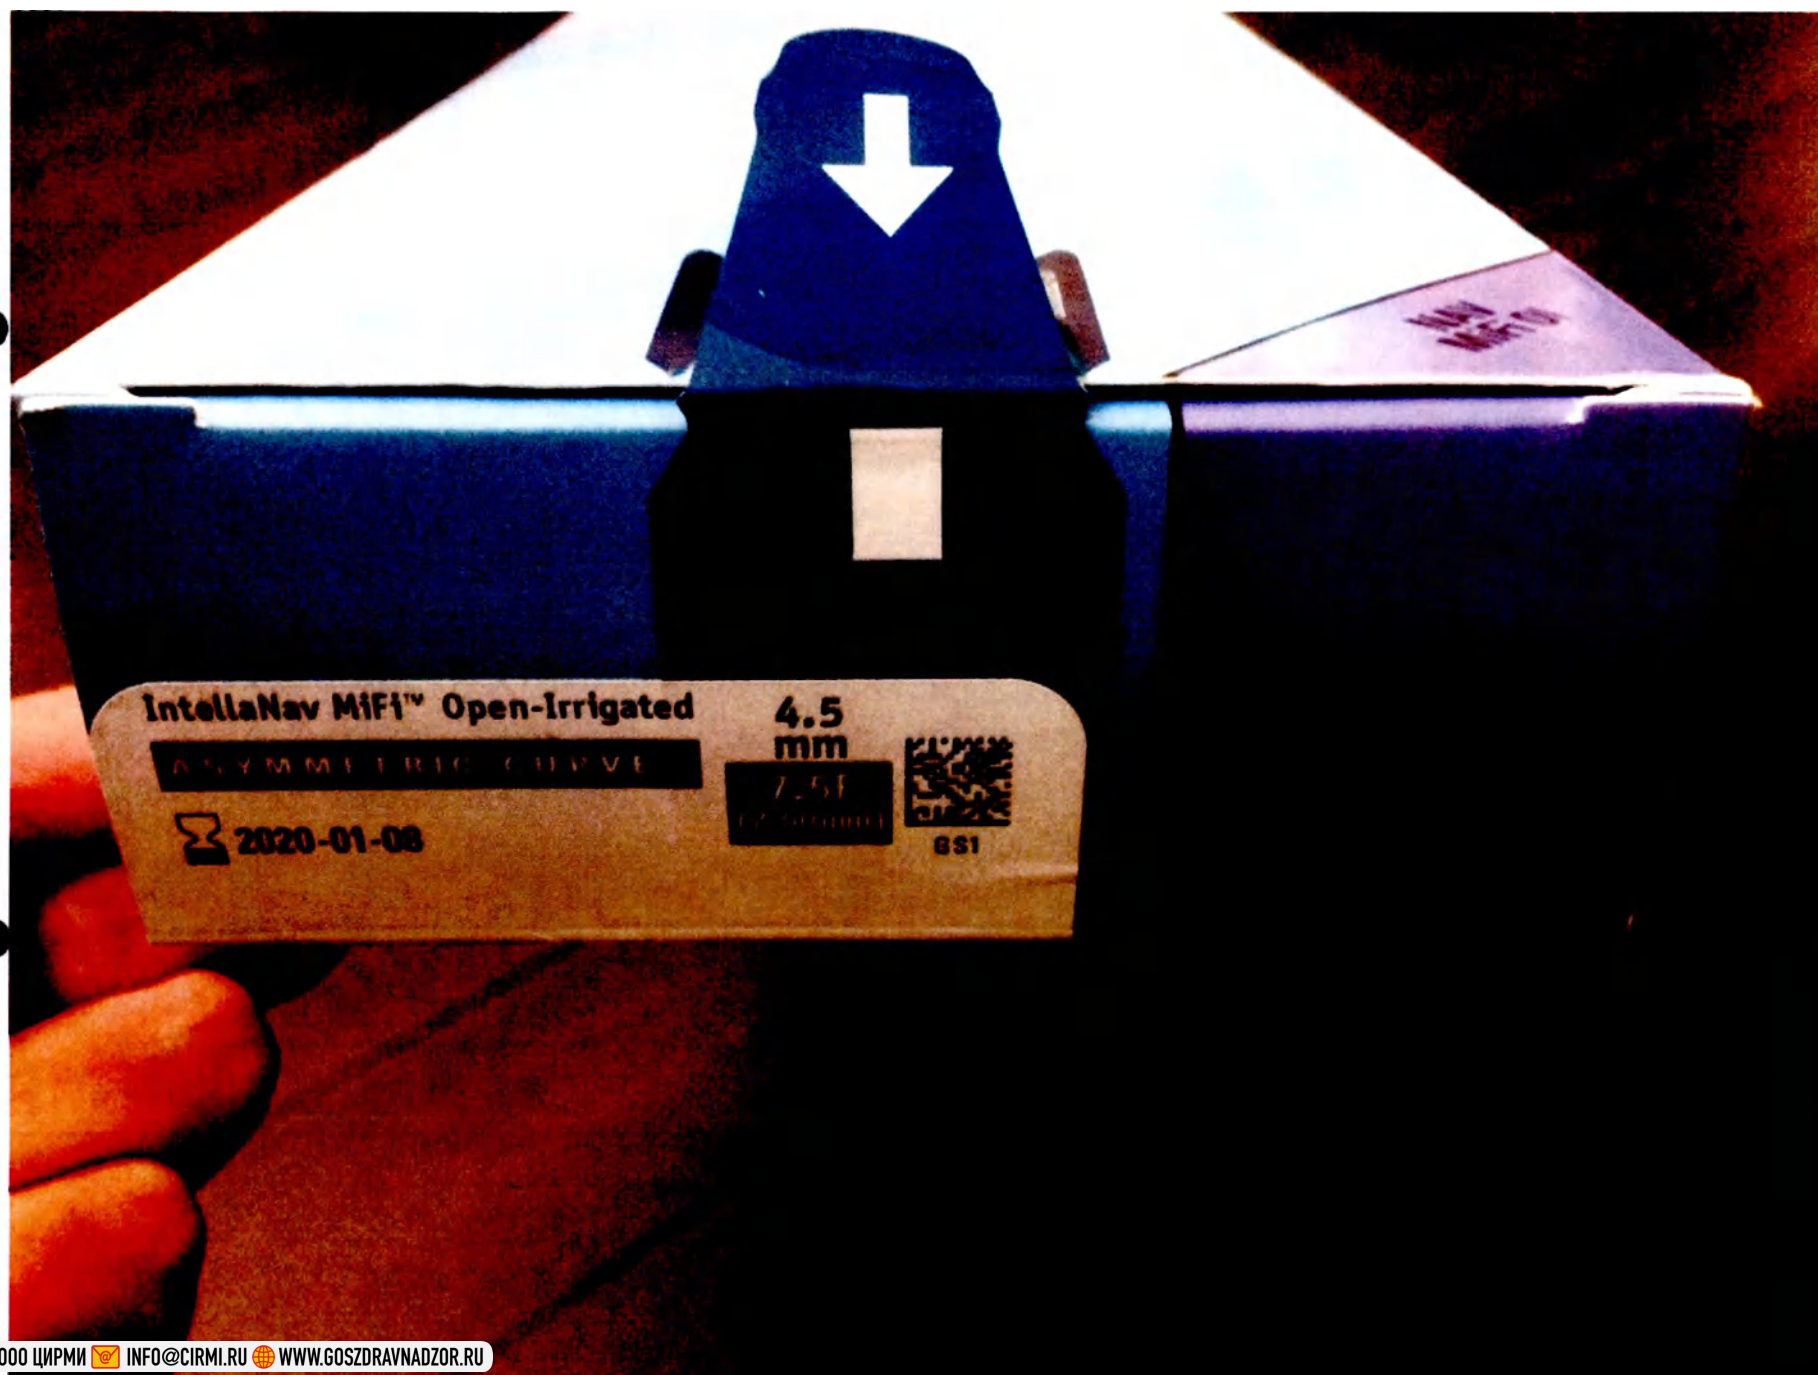


Картонная коробка (верхняя сторона). МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: стандартная».



Картонная коробка (левая сторона).

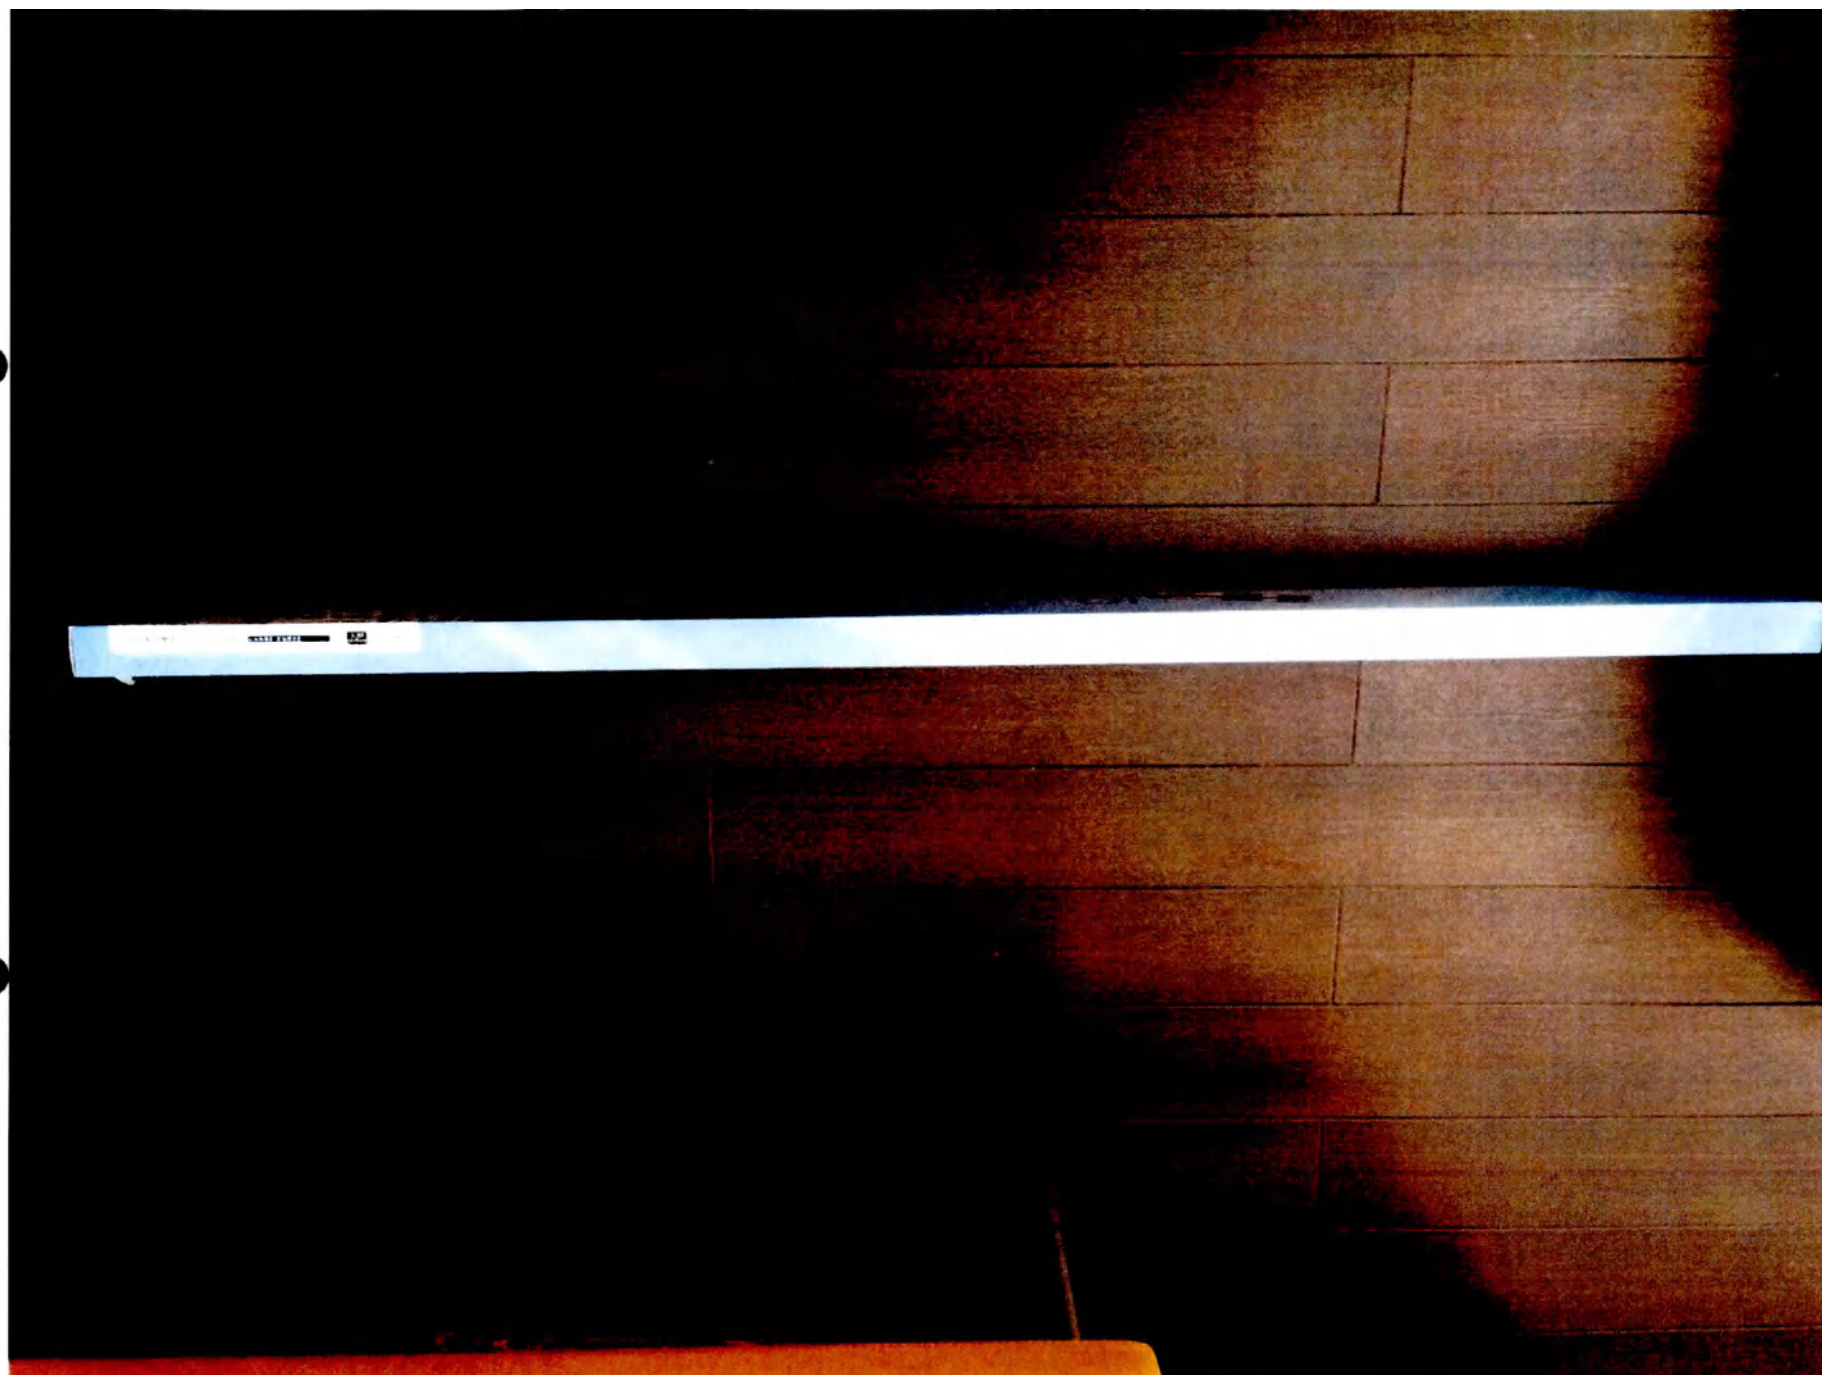


Картонная коробка (правая сторона).

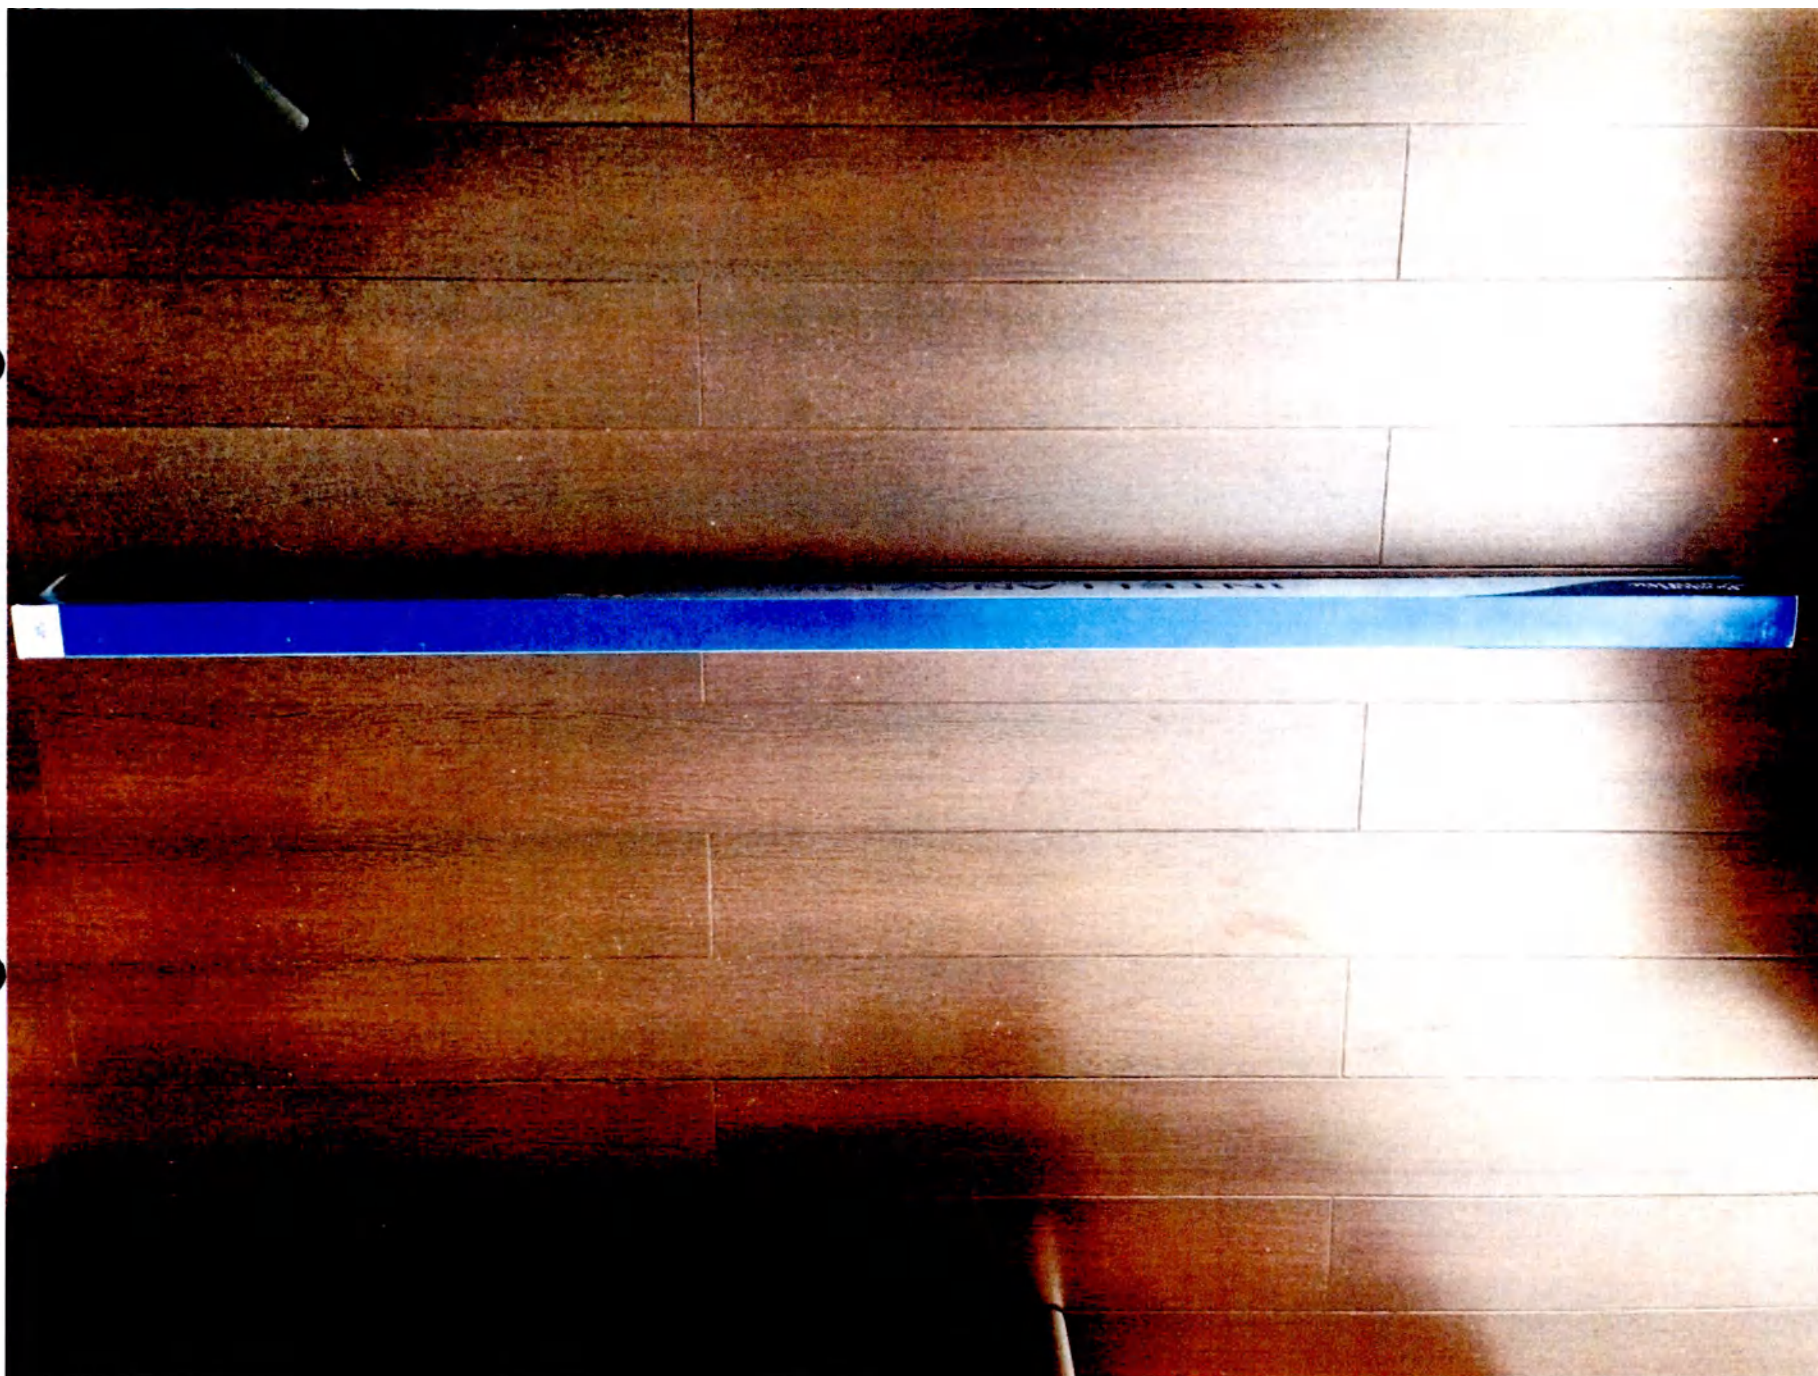

[illegible]

Этикетка на запечатываемом пакете (лицевая сторона) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: большая».

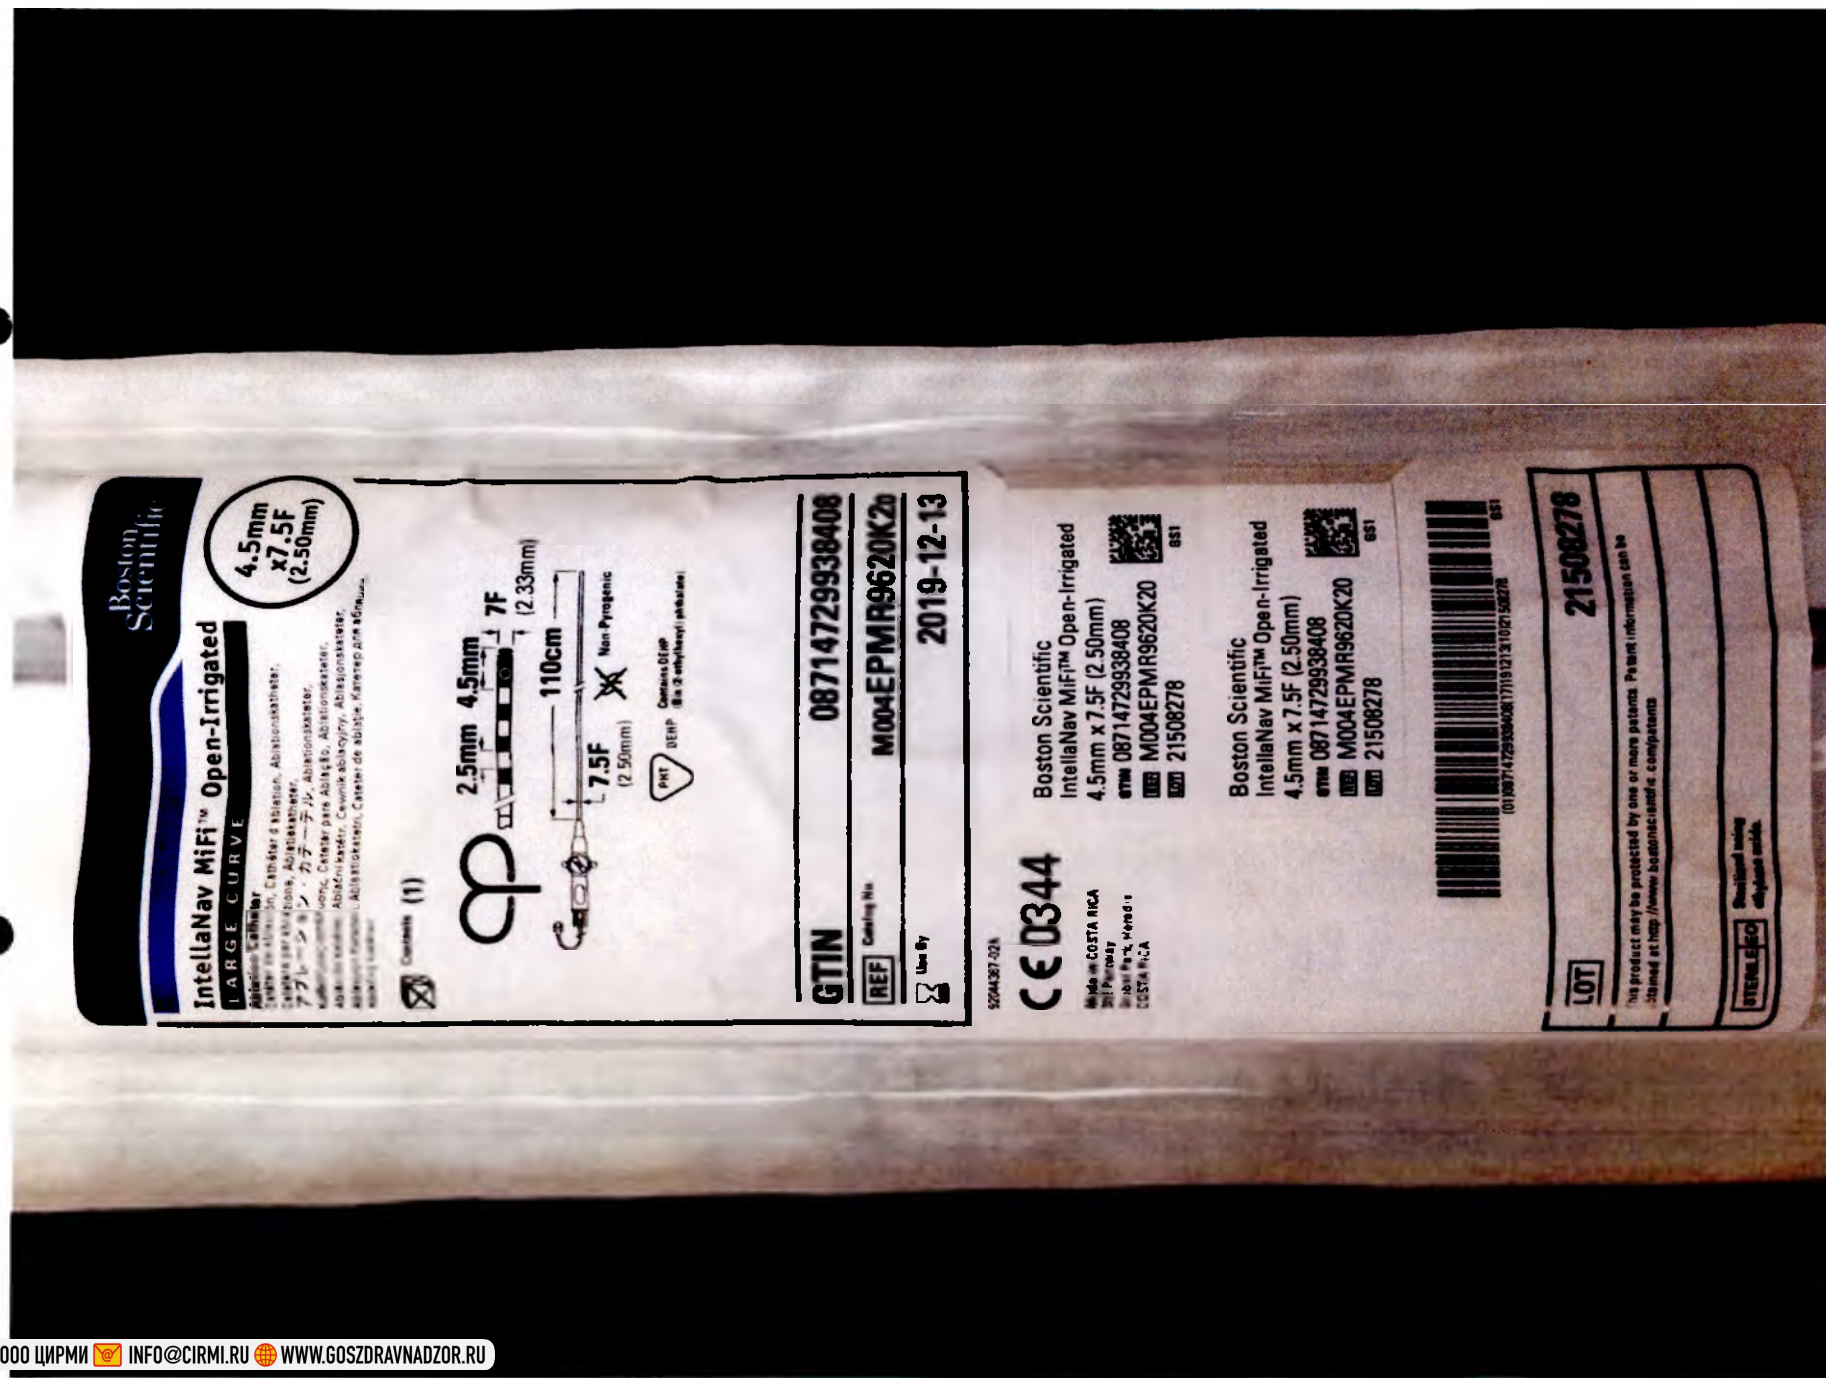

Этикетка на запечатываемом пакете (лицевая сторона) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: ассиметричная».

IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated
ASYM CURVE

Abductor Catheter
Catheter ablation, Ablation catheter.
Catheter para ablacion, Ablacion catheter.
アブレーション・カテテル, Ablation catheter.
abductor catheter, Catheter para Ablacion, Ablation catheter.
abductor catheter, Catheter para Ablacion, Ablation catheter.
abductor catheter, Catheter para Ablacion, Ablation catheter.

4.5mm x 7.5F (2.50mm)

GTIN 08714729949633

REF Catalog No. M004EPMR9620N40

Lot No 2020-01-08

CE 0344

Made in COSTA RICA
301 Pkwy
Burlington, MA 01803
COSTA RICA

Boston Scientific
IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated
4.5mm x 7.5F (2.50mm)
08714729949633
M004EPMR9620N40
21578974

Boston Scientific
IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated
4.5mm x 7.5F (2.50mm)
08714729949633
M004EPMR9620N40
21578974

LOT 21578974

The product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patents>

Маркировка на запечатываемом пакете. Обратная сторона.

**Boston
Scientific**

Rx ONLY

 For single use only.
Do not reuse.

 Do Not
STERILIZE Reuse/Refill

 Consult instruction
for use.

 Do not use if package
is damaged.

EC **PREP** **EU Authorized
Representative**

Boston Scientific Limited
Ballycork Business Park
Galway
IRELAND

 **Legal
Manufacturer**
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01750
USA
CEA Customer Service: 800 338 688

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound into the book's spine, showing the inner structure of the binding. The overall tone is warm and slightly yellowed, consistent with the age of the document.



ООО ЦПМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

«Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated с принадлежностями, варианты исполнения». Маркировка на картонной коробке (лицевая сторона).



EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND



Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

Rx ONLY



Consult instructions
for use.




Do not use if package
is damaged.



Recyclable
Package



For single use only.
Do not reuse.



Do Not
Restertilize

Boston
Scientific



Этикетка на картонной коробке (левая сторона) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) х 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: стандартная».

IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated STANDARD CURVE

4.5 mm 7.5F (2.50mm)



2020-01-09

Этикетка на картонной коробке (левая сторона) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) x 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: ассиметричная».

IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated **ASYMMETRIC CURVE**

4.5
mm

7.5F
(2.50mm)




2020-01-08

Этикетка на картонной коробке (левая сторона) МИ «Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated, размер электрода кончика 7F (2.33 мм) х 4.5мм, диаметр катетера 7.5F (2.50 мм), кривизна: большая».

IntellaNav MiFi™ Open-Irrigated **LARGE CURVE**

4.5
mm

7.5F
(2.50mm)



2019 12 13

«Катетер абляционный IntellaNav MiFi Open-Irrigated с принадлежностями, варианты исполнения». Маркировка на картонной коробке (правая сторона).




NAV
MiFi OI

Кабель соединительный IntellaNav для Rhythmia.



[illegible]

Кабель соединительный IntellaNav для Rhythmia. Запечатываемый пакет (обратная сторона).

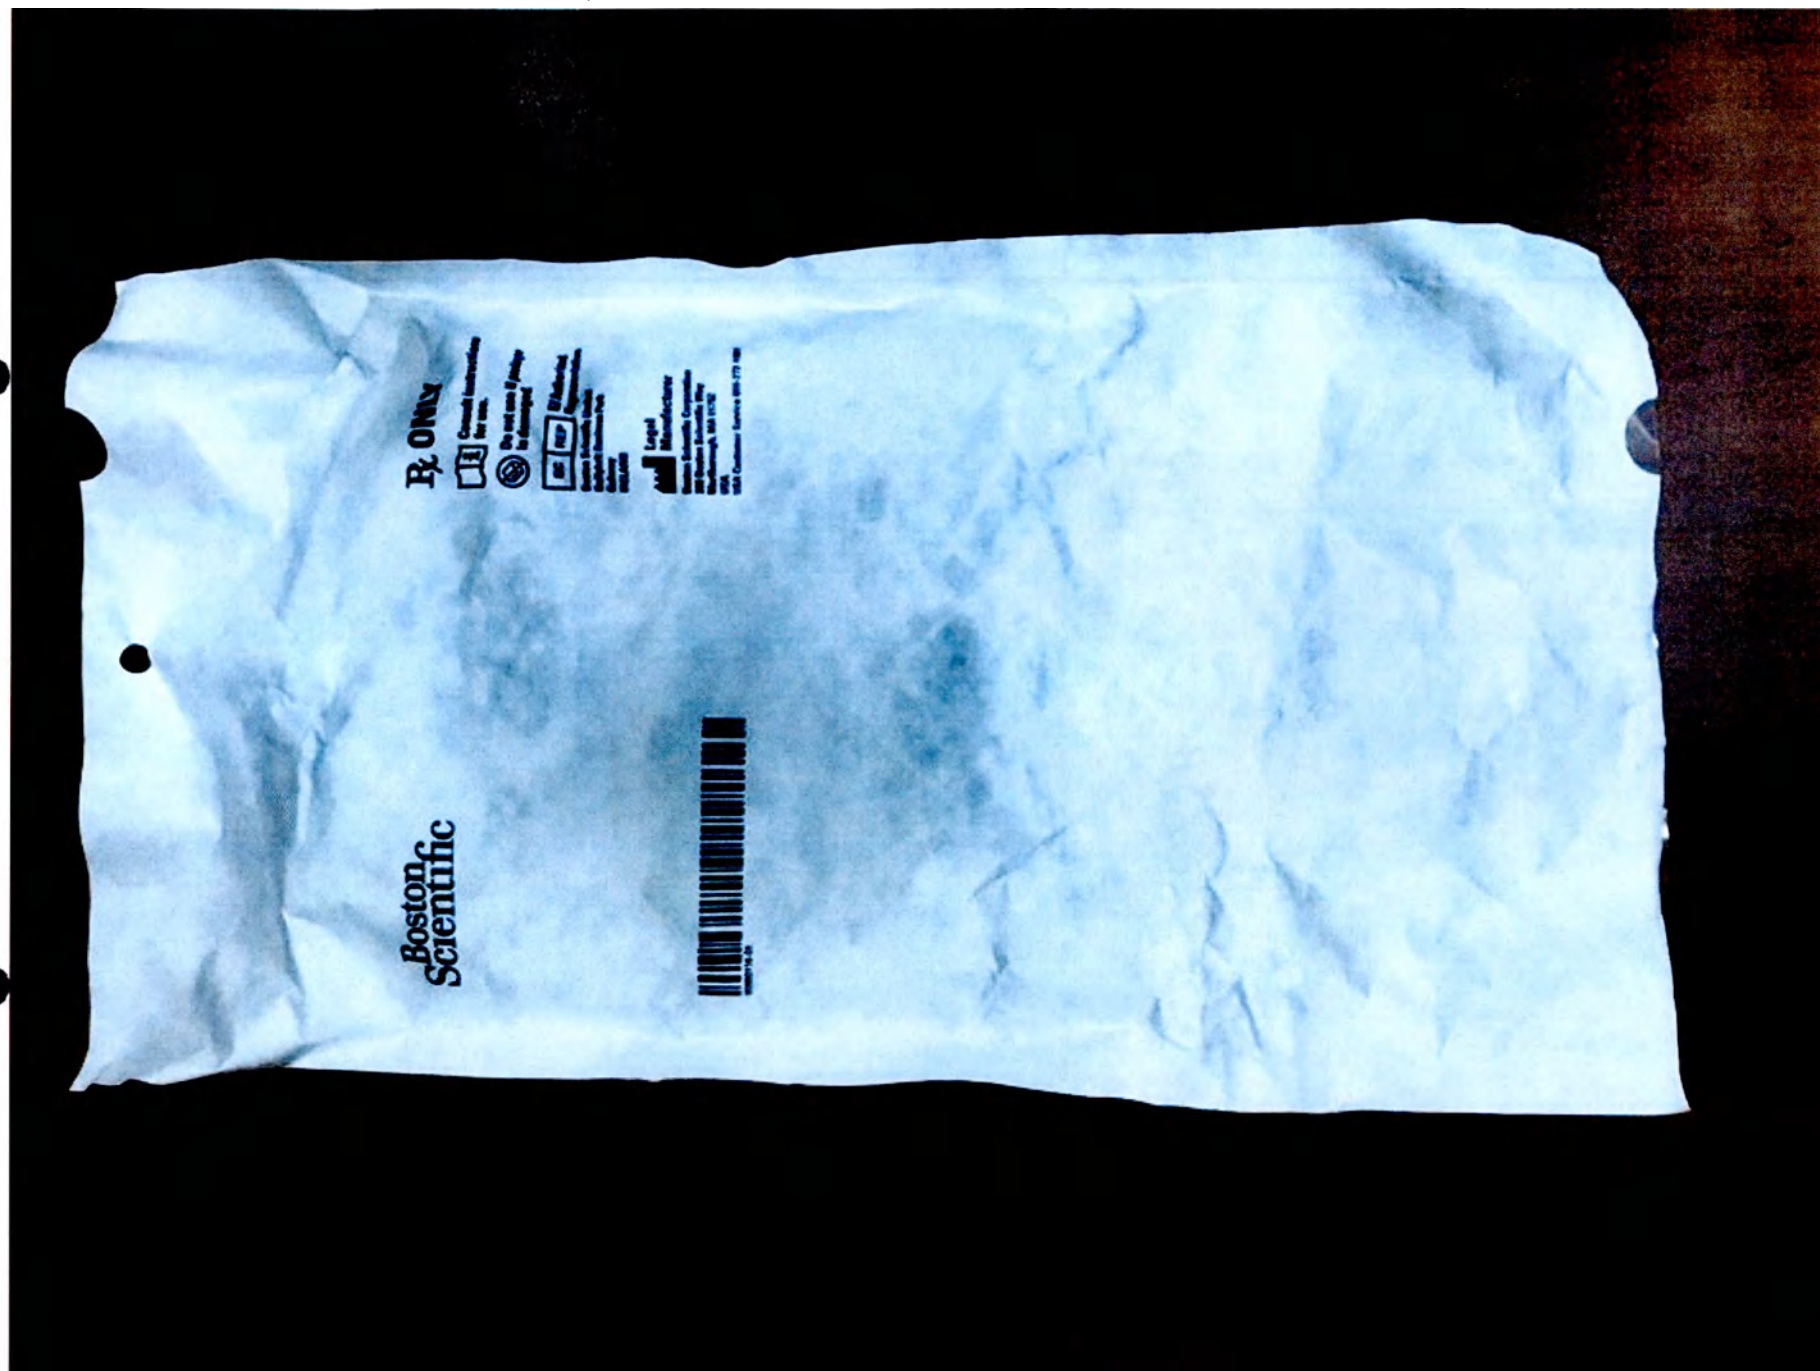

Boston
Scientific

**Cable Inserter™
Ablation Catheter**

200cm (6.6ft)

Boston Scientific
Cable Inserter™
Ablation Catheter
200cm (6.6ft)
Cat # 0871-6738-46783
MFG M00-4948-C010
STD 20903545

Boston Scientific
Cable Inserter™
Ablation Catheter
200cm (6.6ft)
Cat # 0871-6738-46783
MFG M00-4948-C010
STD 20903545

LOT 20903545

CE 0344

Model no. C03TA-MCA
Serial Part no. 0871-6738-46783
C03TA-MCA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at www.bioscience.com/patent.

ITEM#	QSC	Standard usage device code
-------	-----	-------------------------------

R ONLY


Consult instructions for use.

Do not use if pack appears damaged.


Eti Authorized Representative

Legal

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01751
USA Customer Service 800-377-8000

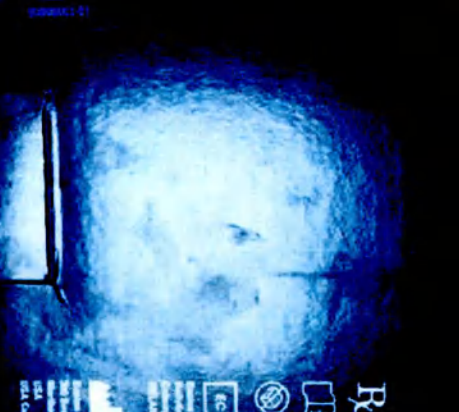

Кабель соединительный IntellaNav для Rhythmia. Картонная коробка (верхняя сторона).

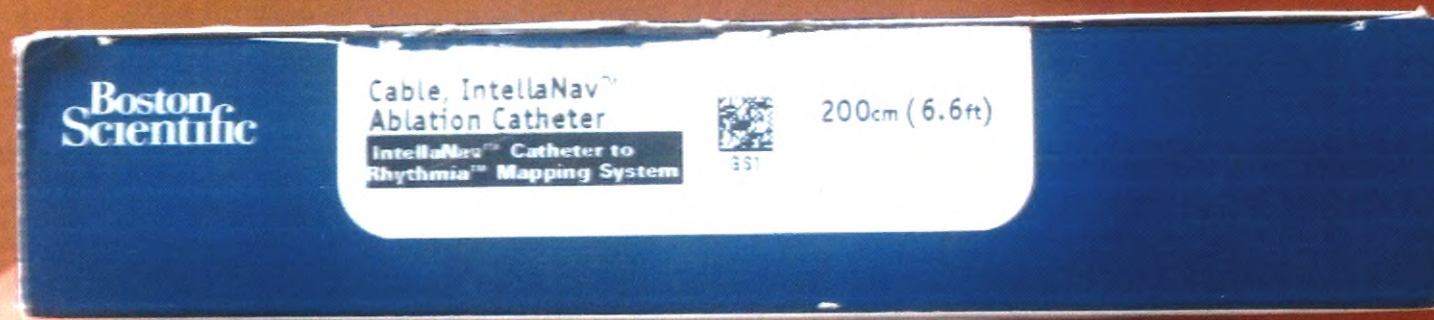

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
39 ЛИСТОВ