

Фотографические изображения
медицинского изделия

***ЭКГ- регистратор SEER 1000
в вариантах исполнения, с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по контролю качества и мониторингу
безопасности медицинского оборудования Россия и

СНГ



Суханова И.А.

ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

1. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 24 часовой записи.




ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

1. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 24 часовой записи.

SEER™ 1000

24 hour



SN

391 16 00001



GETEMED
Oderstr. 77
14513 Teltow
Germany

2016-04-07

Distributed by
GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA

CE 0197

LR03 1.5V / HR03 1.2V

Rx Only IP43



Contains FCC ID: QOQWT12
and IC: 5123A-BGTWT12A

Rev.B



(01)00840682108232

(11)160407

(21)3911600001

(241)2067634-058

ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

2. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 48 часовой записи.



ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

2. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 48 часовой записи.

SEER™ 1000

48 hour



SN

391 16 00001



GETEMED
Oderstr. 77
14513 Teltow
Germany

2016-04-07

Distributed by
GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA

CE 0197

LR03 1.5V / HR03 1.2V
Rx Only IP43



Contains FCC ID: QOQWT12
and IC: 5123A-BGTWT12A

Rev.B



(01)00840682108232
(11)160407
(21)3911600001
(241)2067634-059

ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

3. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 7 дневной записи.




ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

3. ЭКГ-регистратор SEER 1000 регистратор для 7 дневной записи.

SEER™ 1000

7 day



SN 391 16 00001



GETEMED
Oderstr. 77
14513 Teltow
Germany

2016-04-07

Distributed by
GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA

CE 0197

LR03 1.5V / HR03 1.2V
Rx Only IP43



Contains FCC ID: QOQWT12
and IC: 5123A-BGTWT12A

Rev.B




(01)00840682108232
(11)160407
(21)3911600001
(24)2067634-060




ЭКГ-регистратор SEER 1000 в вариантах исполнения, с принадлежностями:

4. Инструкция по эксплуатации.

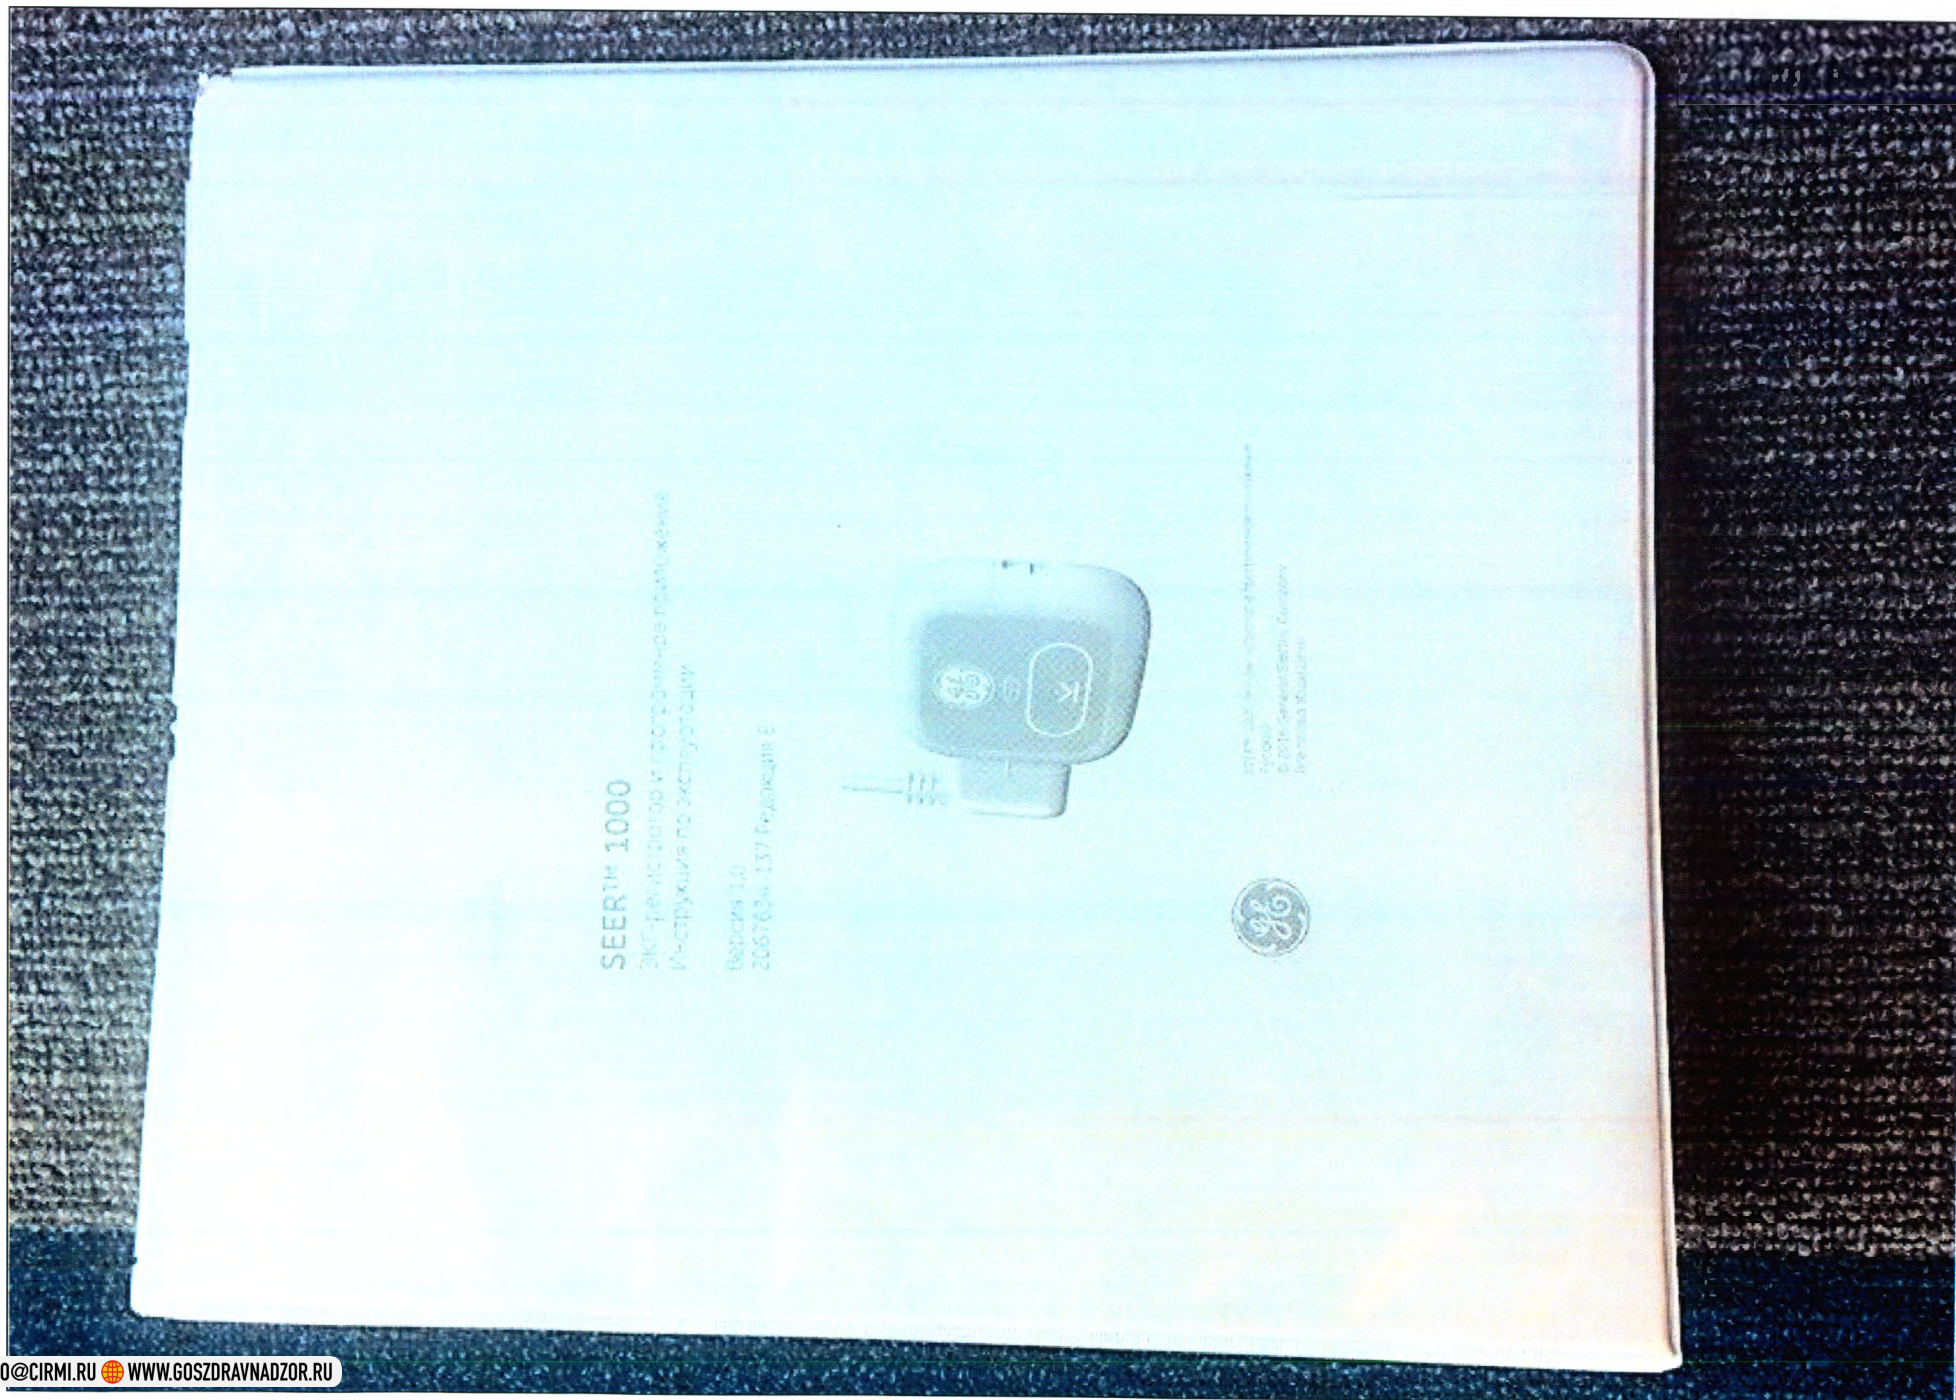


Принадлежности:

1. Кабель ЭКГ, 3 провода электродов, 3 канала, детский, стандарт IEC (не более 5 шт).

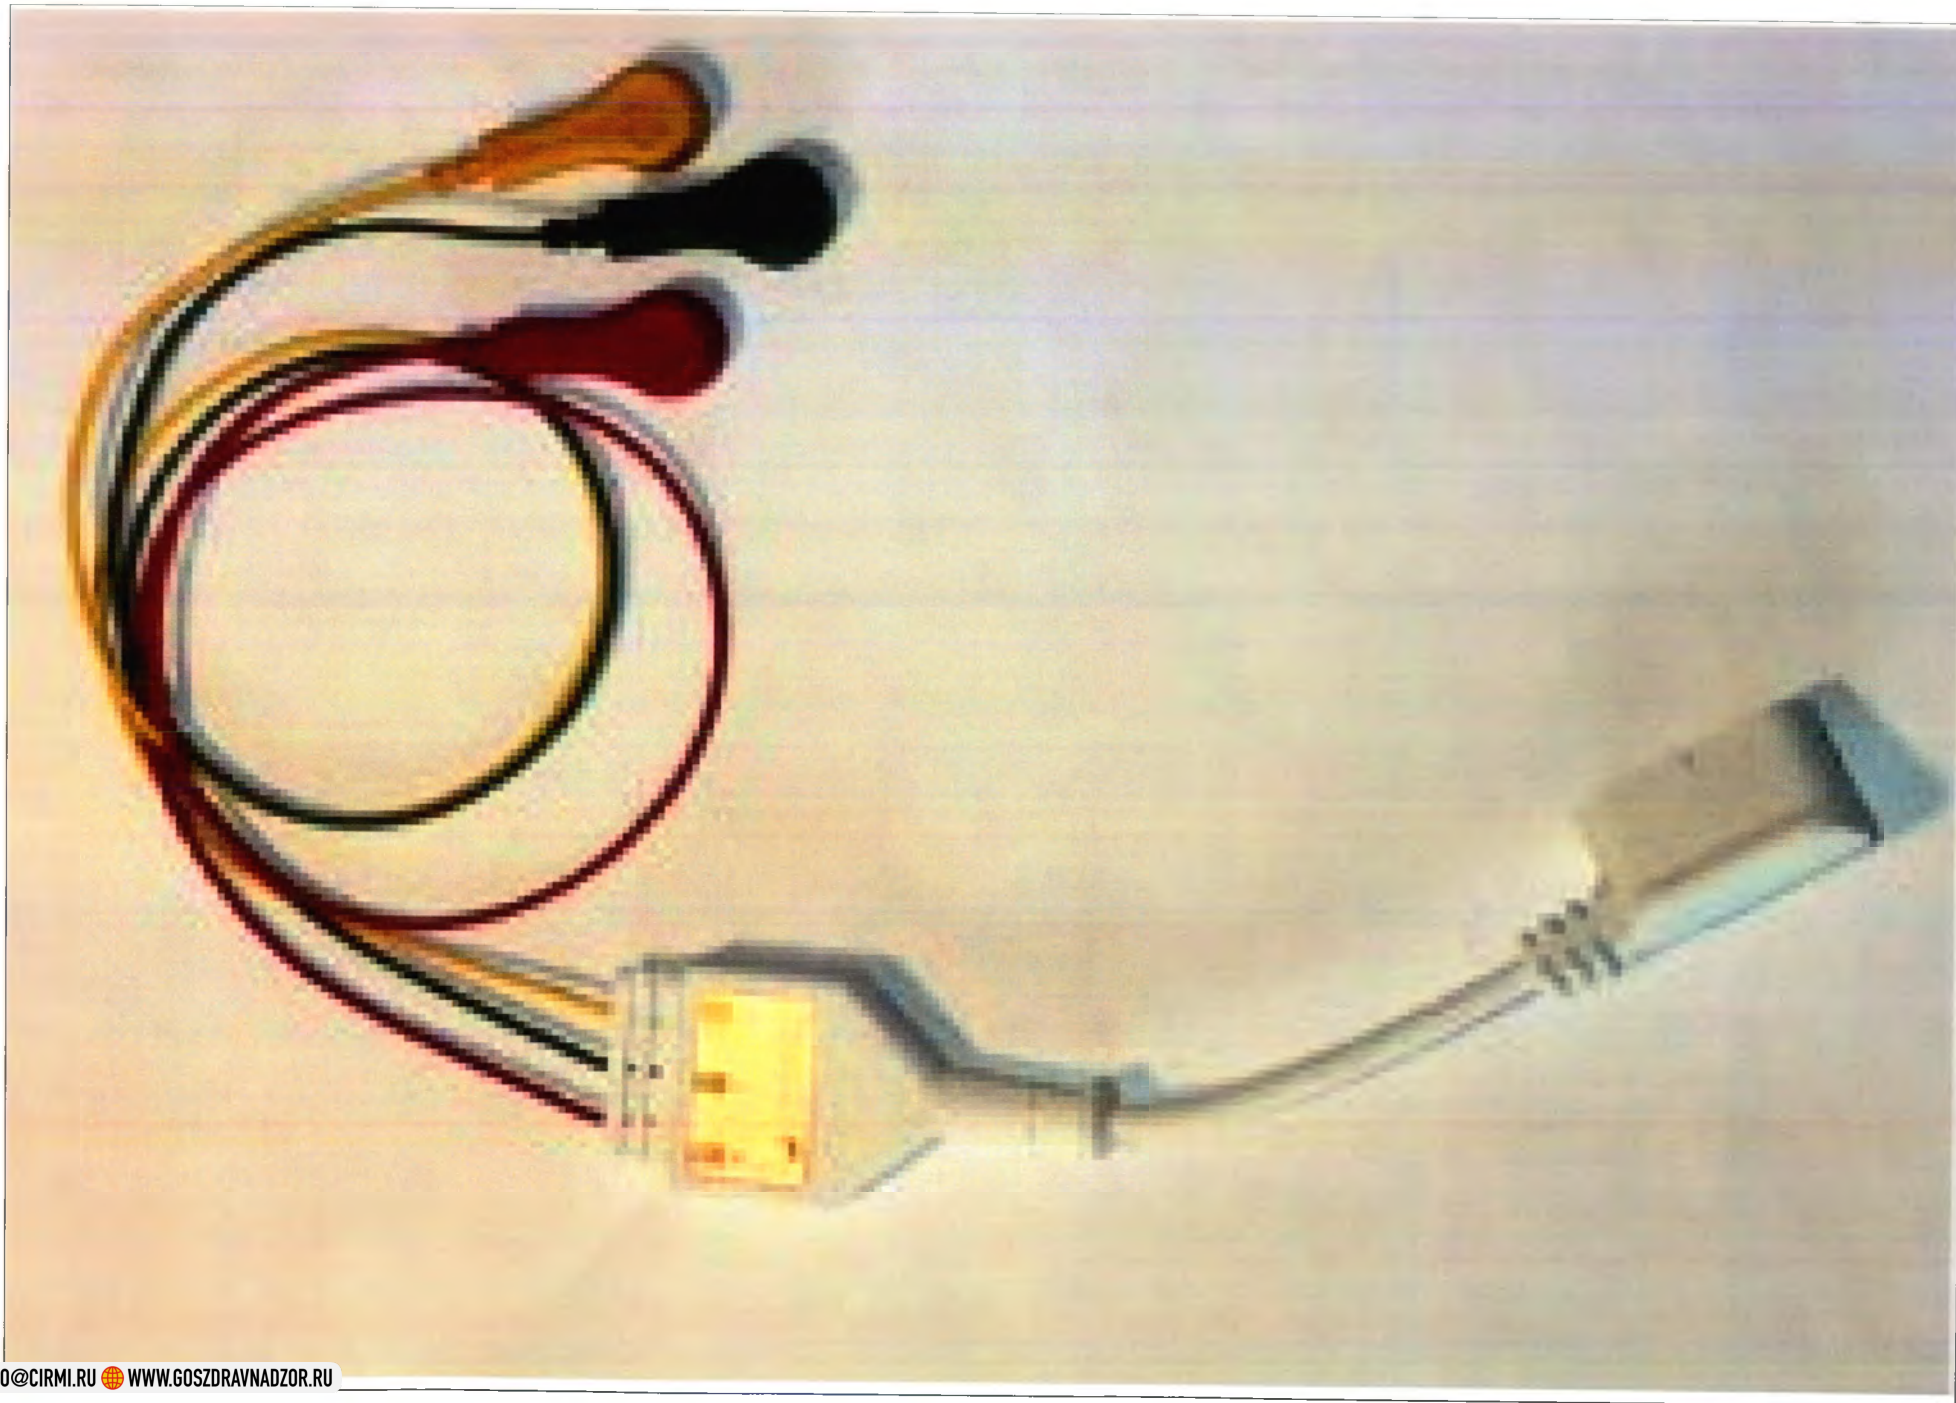


Принадлежности:

2. Кабель ЭКГ, 5 проводов электродов, 2 канала, детский, стандарт IEC (не более 5 шт).

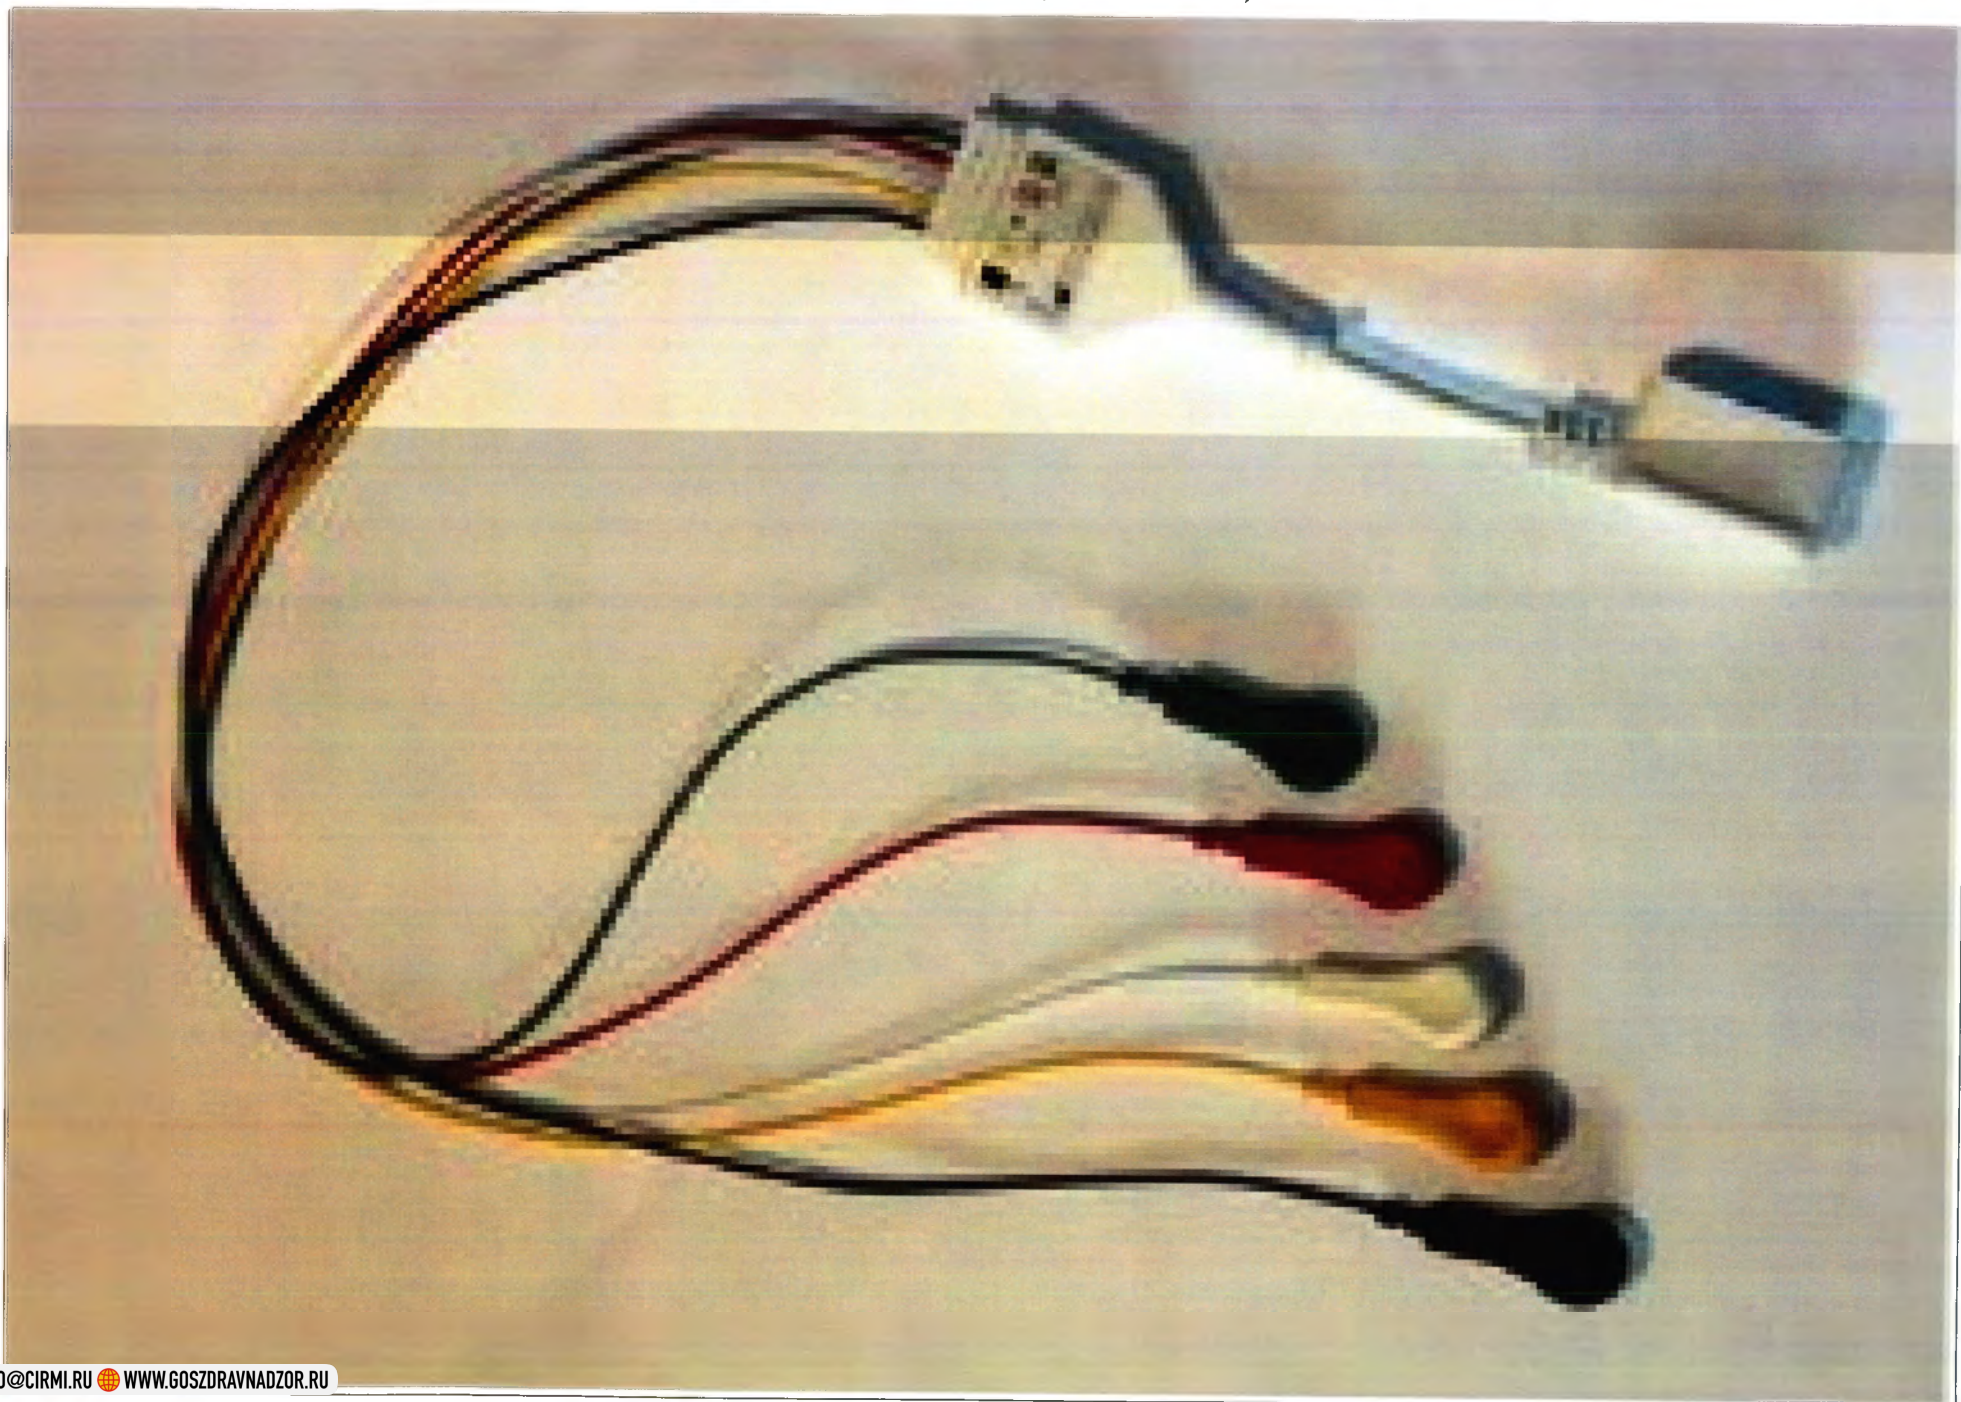


Принадлежности:

3. Кабель ЭКГ, 7 проводов электродов, 3 канала, детский, стандарт IEC (не более 5 шт).

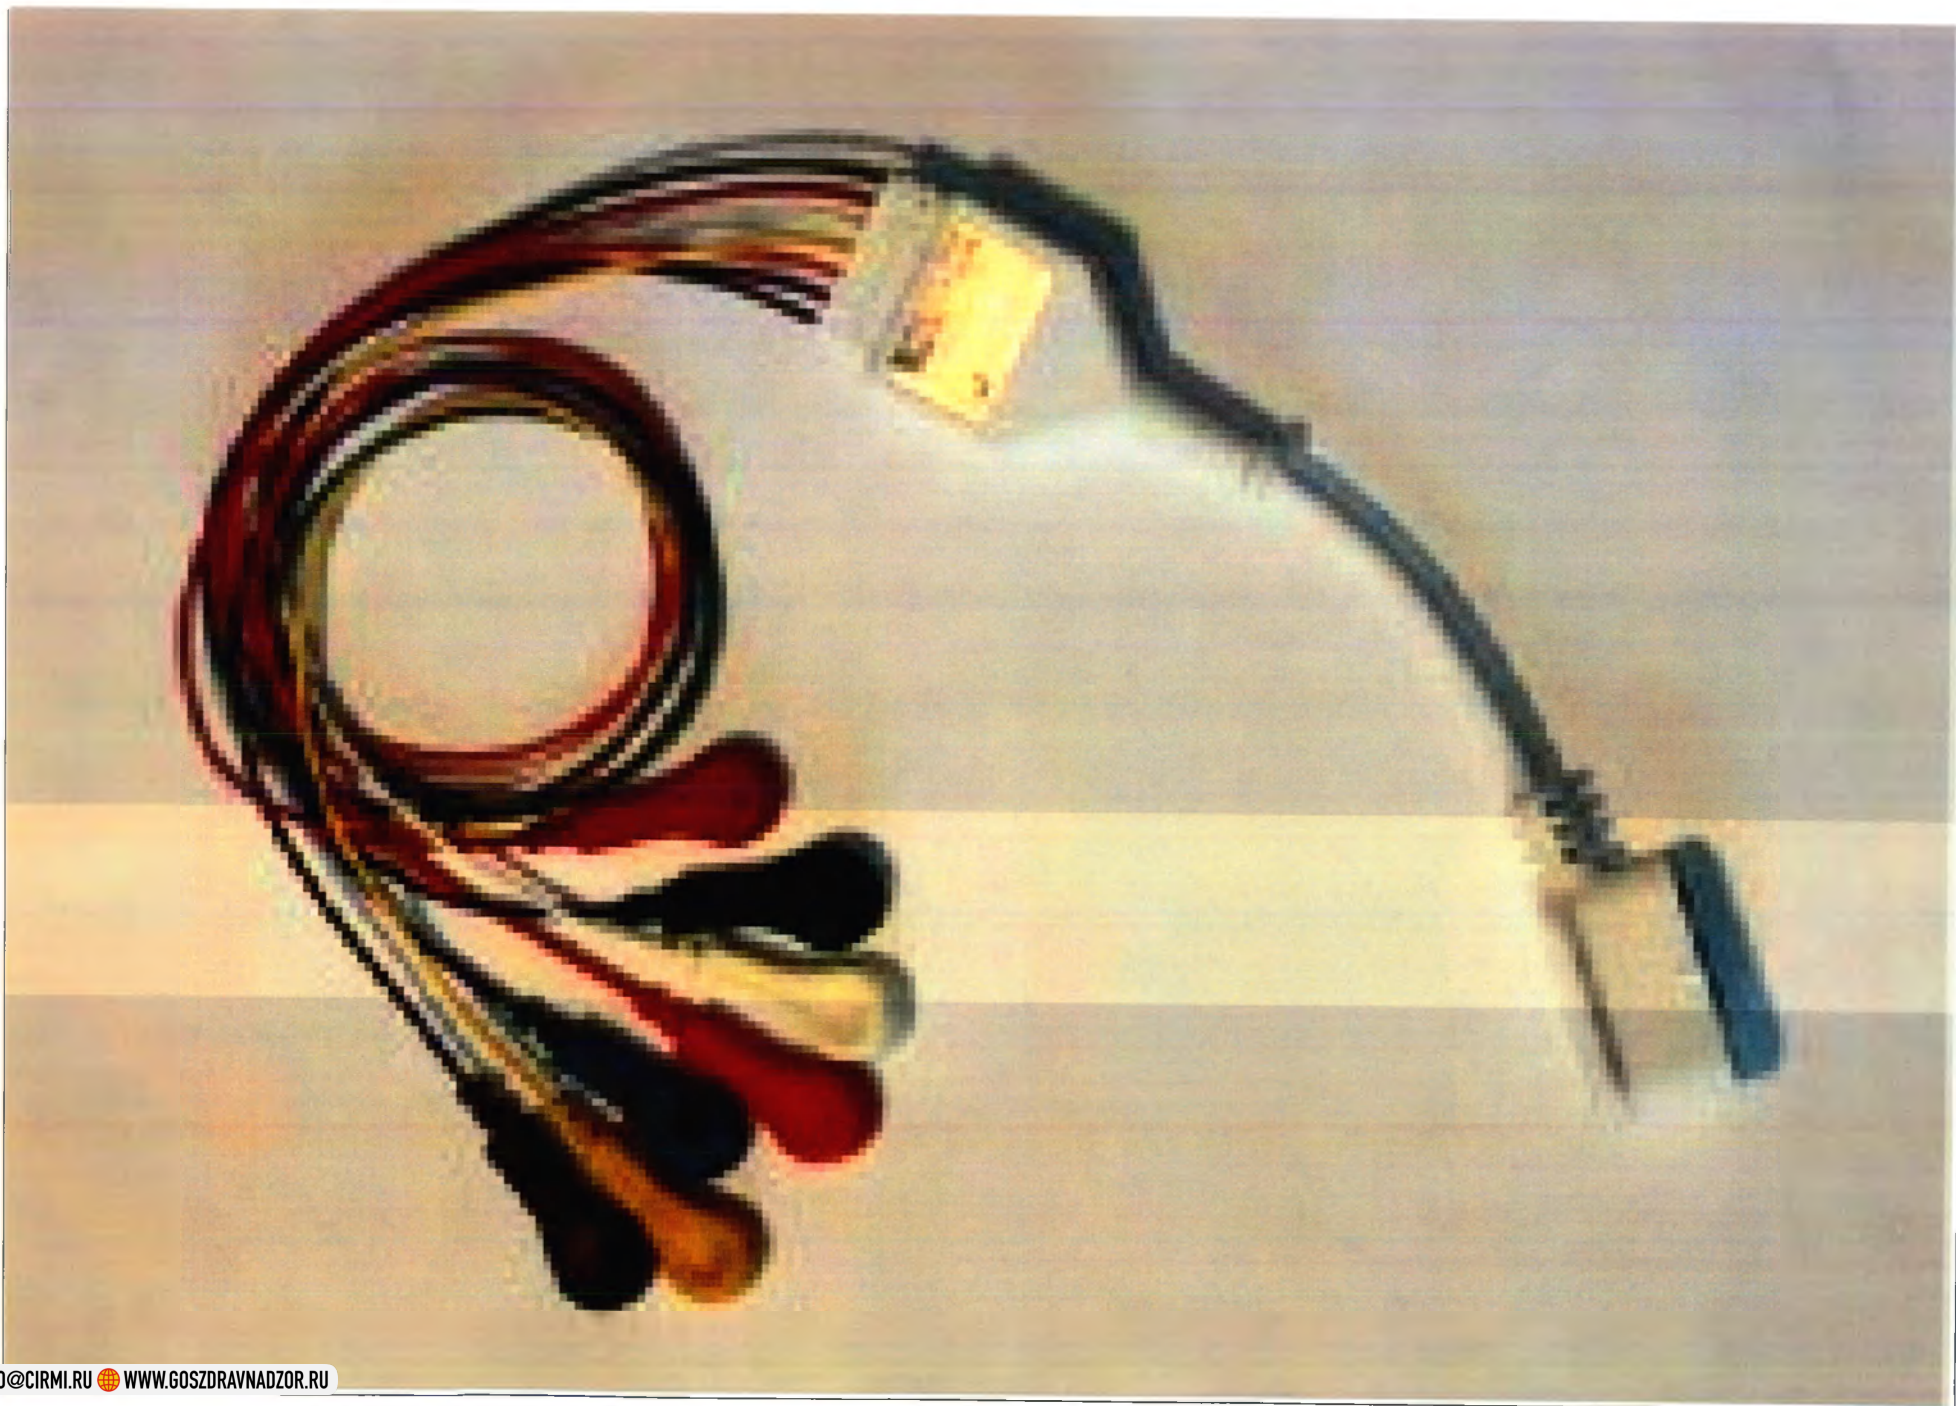


Принадлежности:

4. Кабель ЭКГ, 3 провода электродов, 3 канала, стандарт IEC(не более 5 шт).

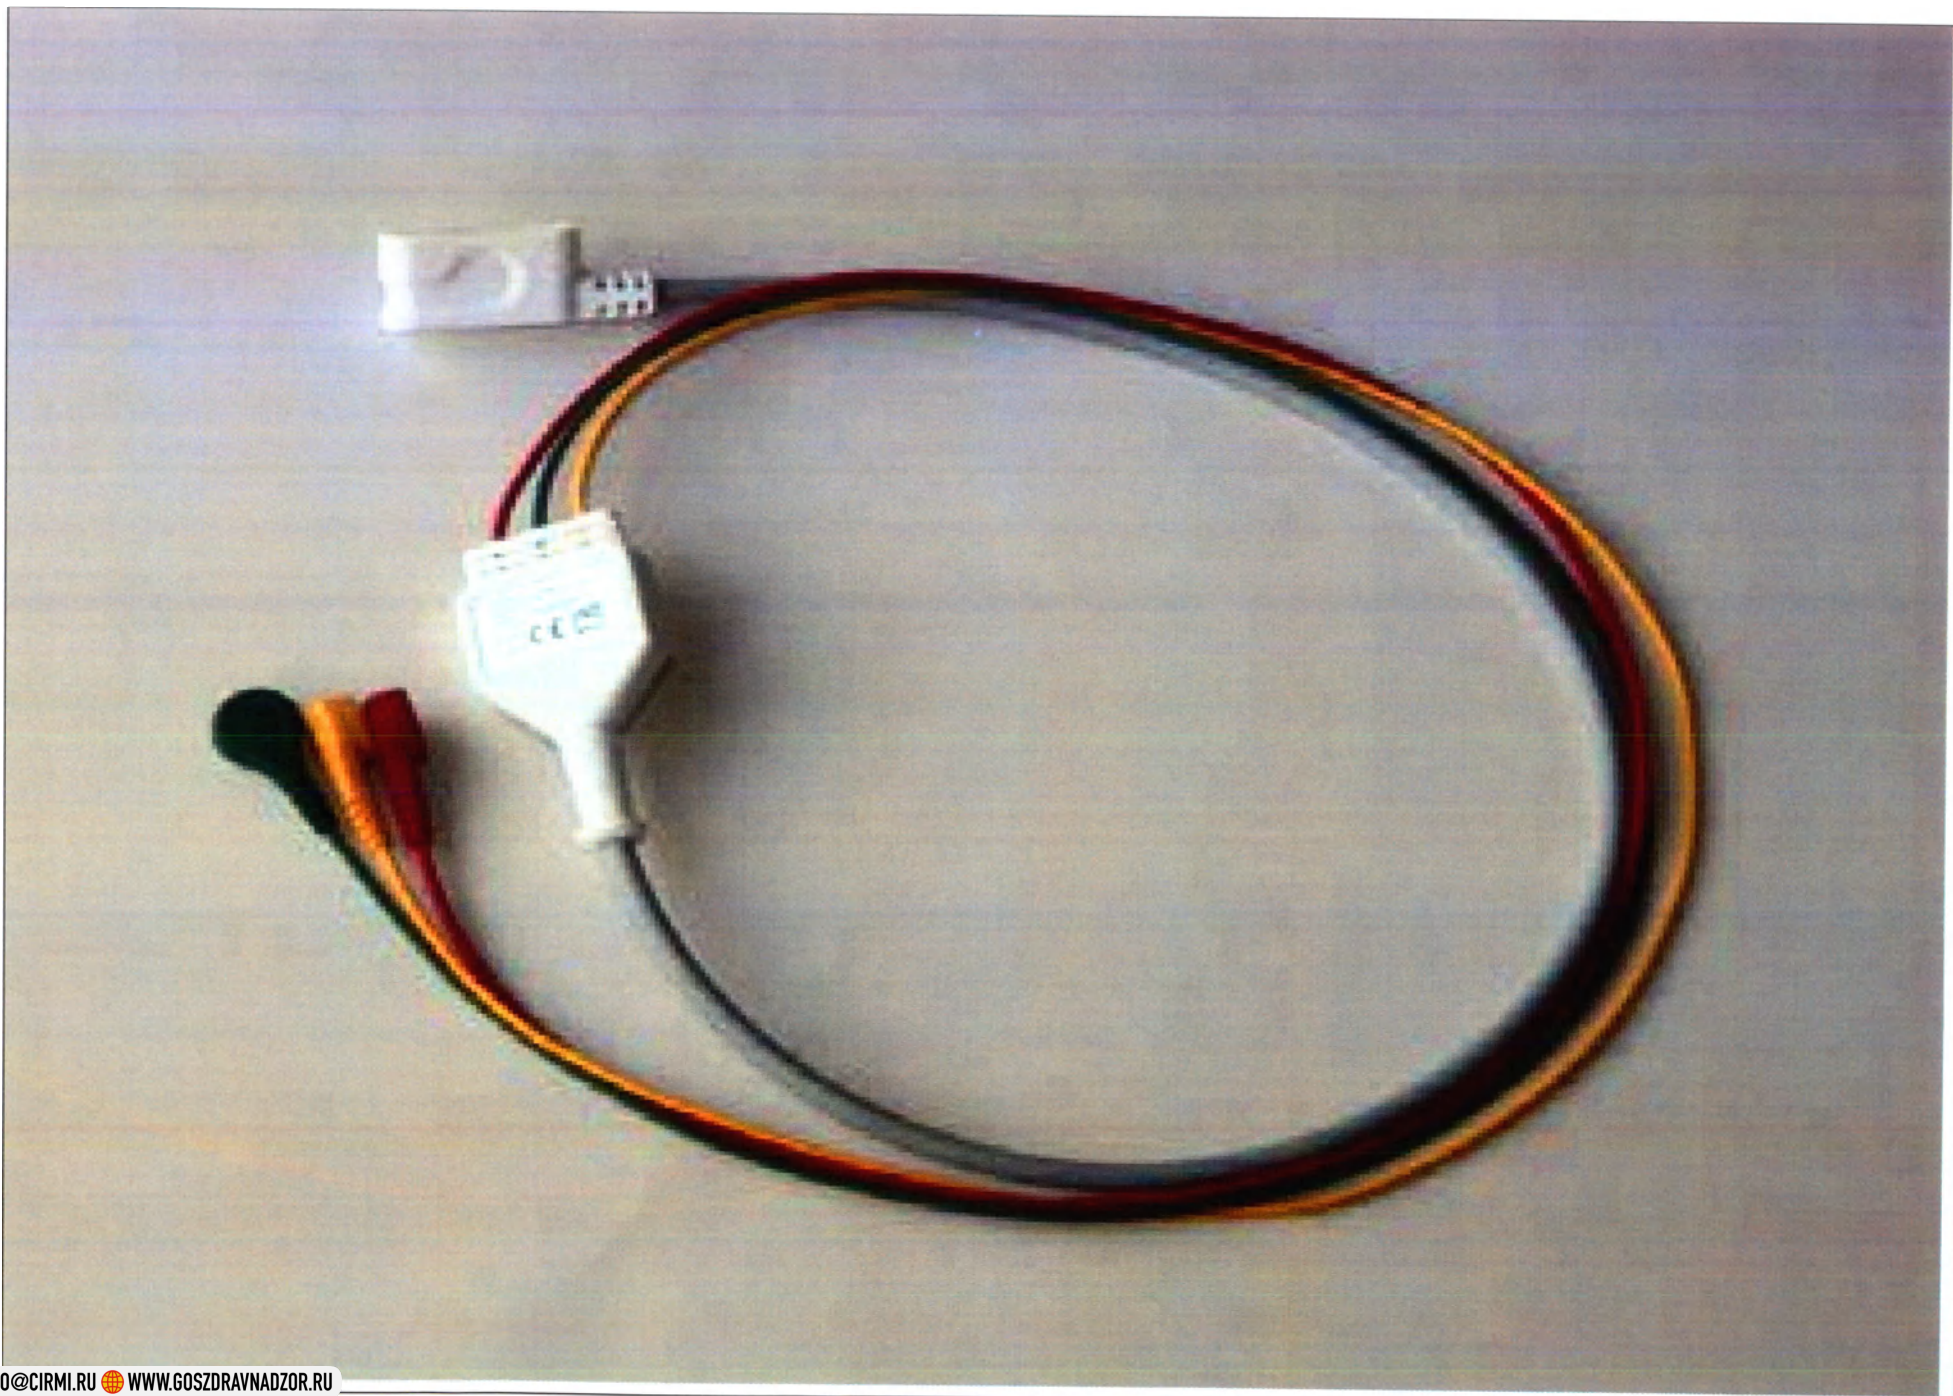


Принадлежности:

5. Кабель ЭКГ, 5 проводов электродов, 2 канала, стандарт IEC (не более 5 шт).

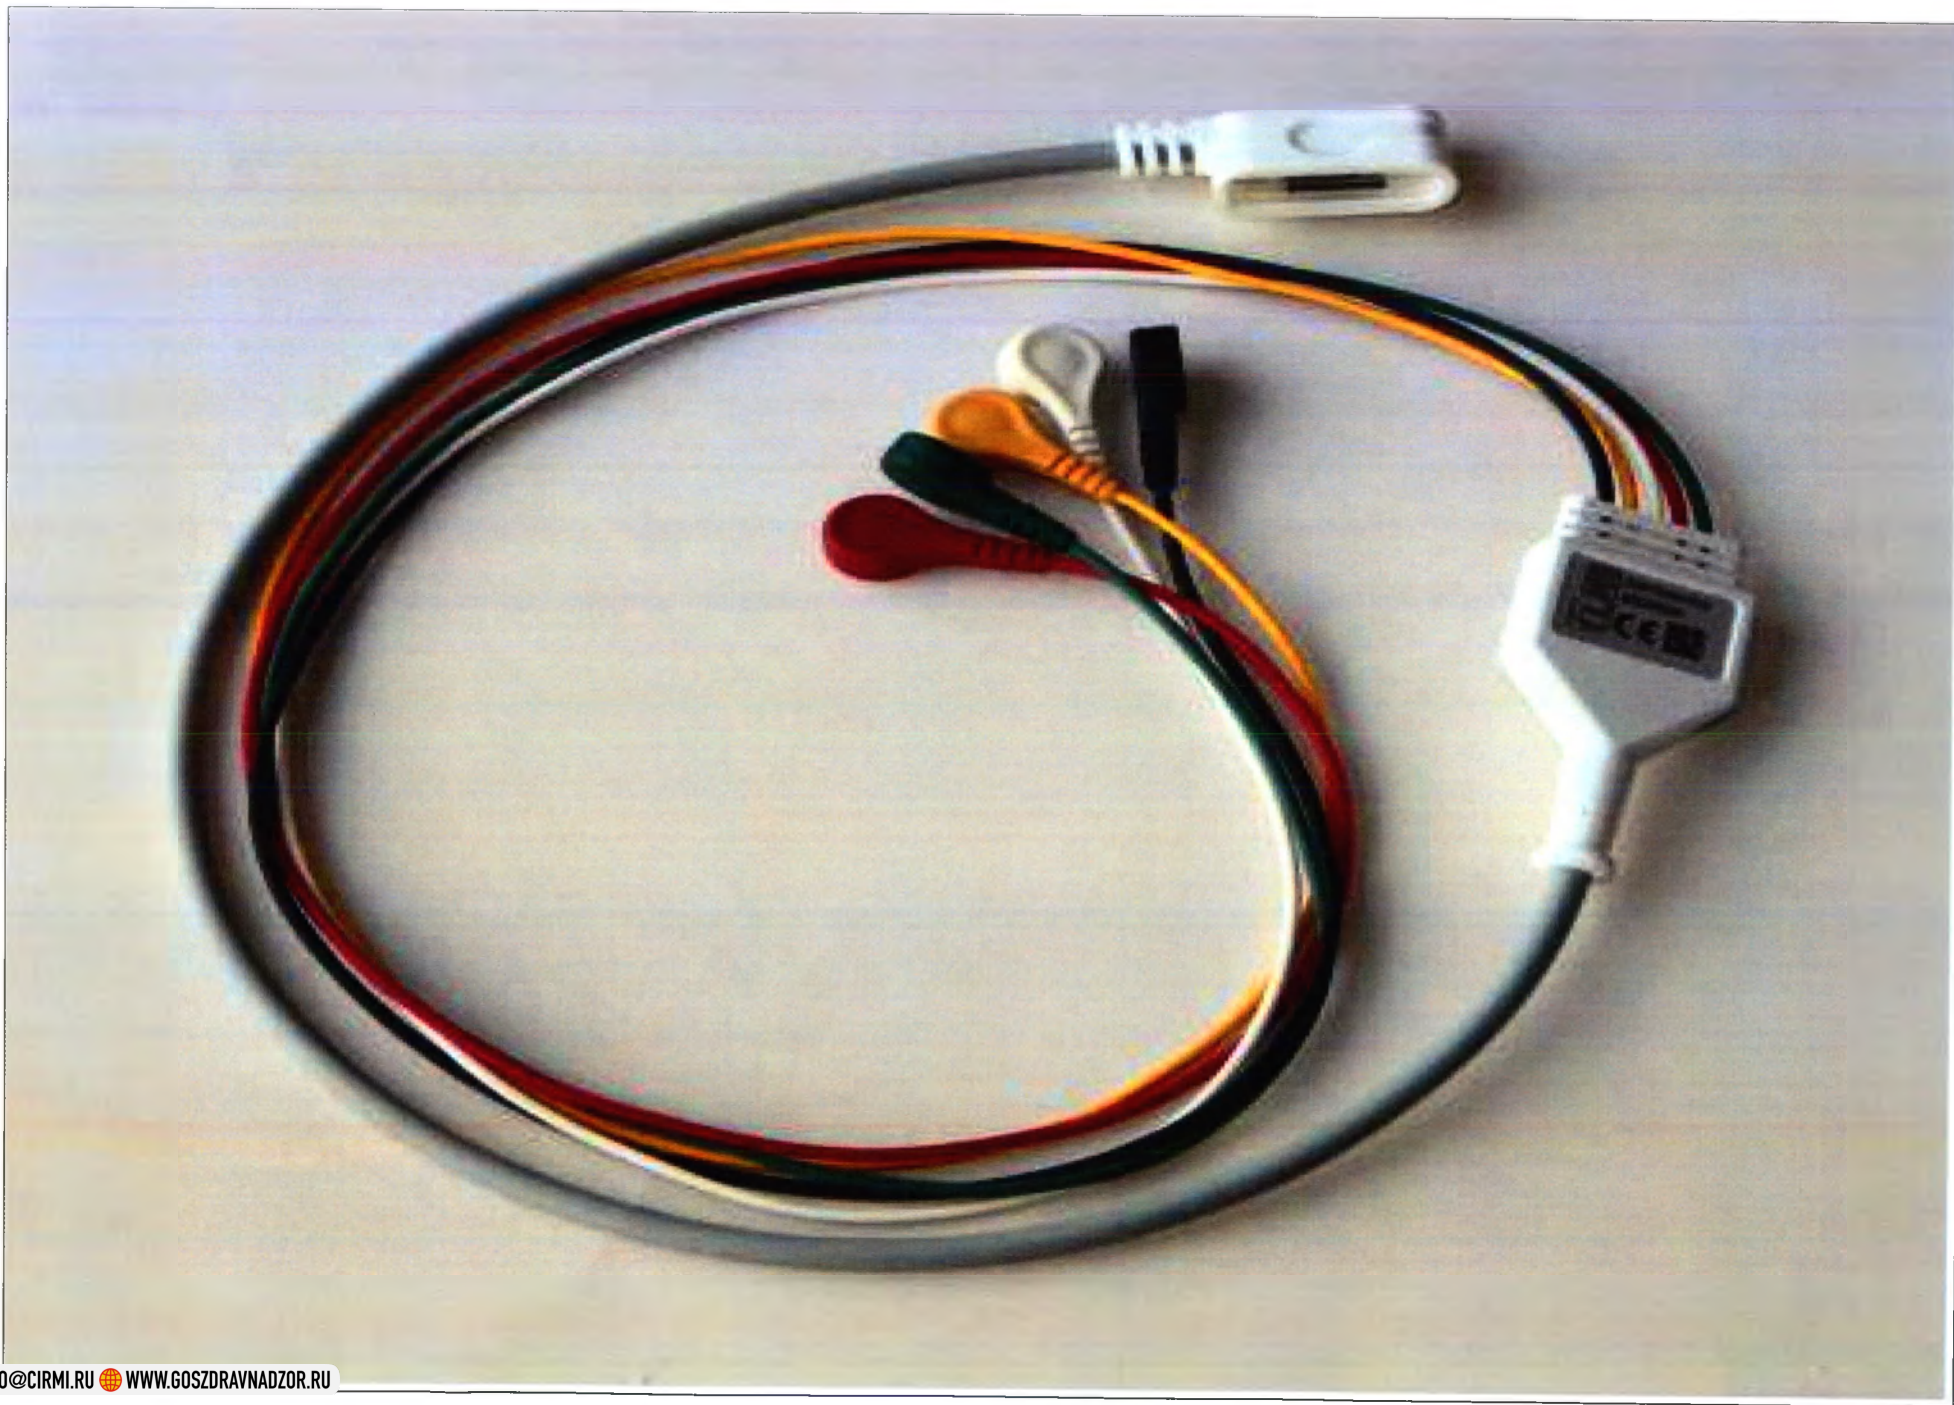


Принадлежности:

6. Кабель ЭКГ, 7 проводов электродов, 3 канала, стандарт IEC (не более 5 шт).

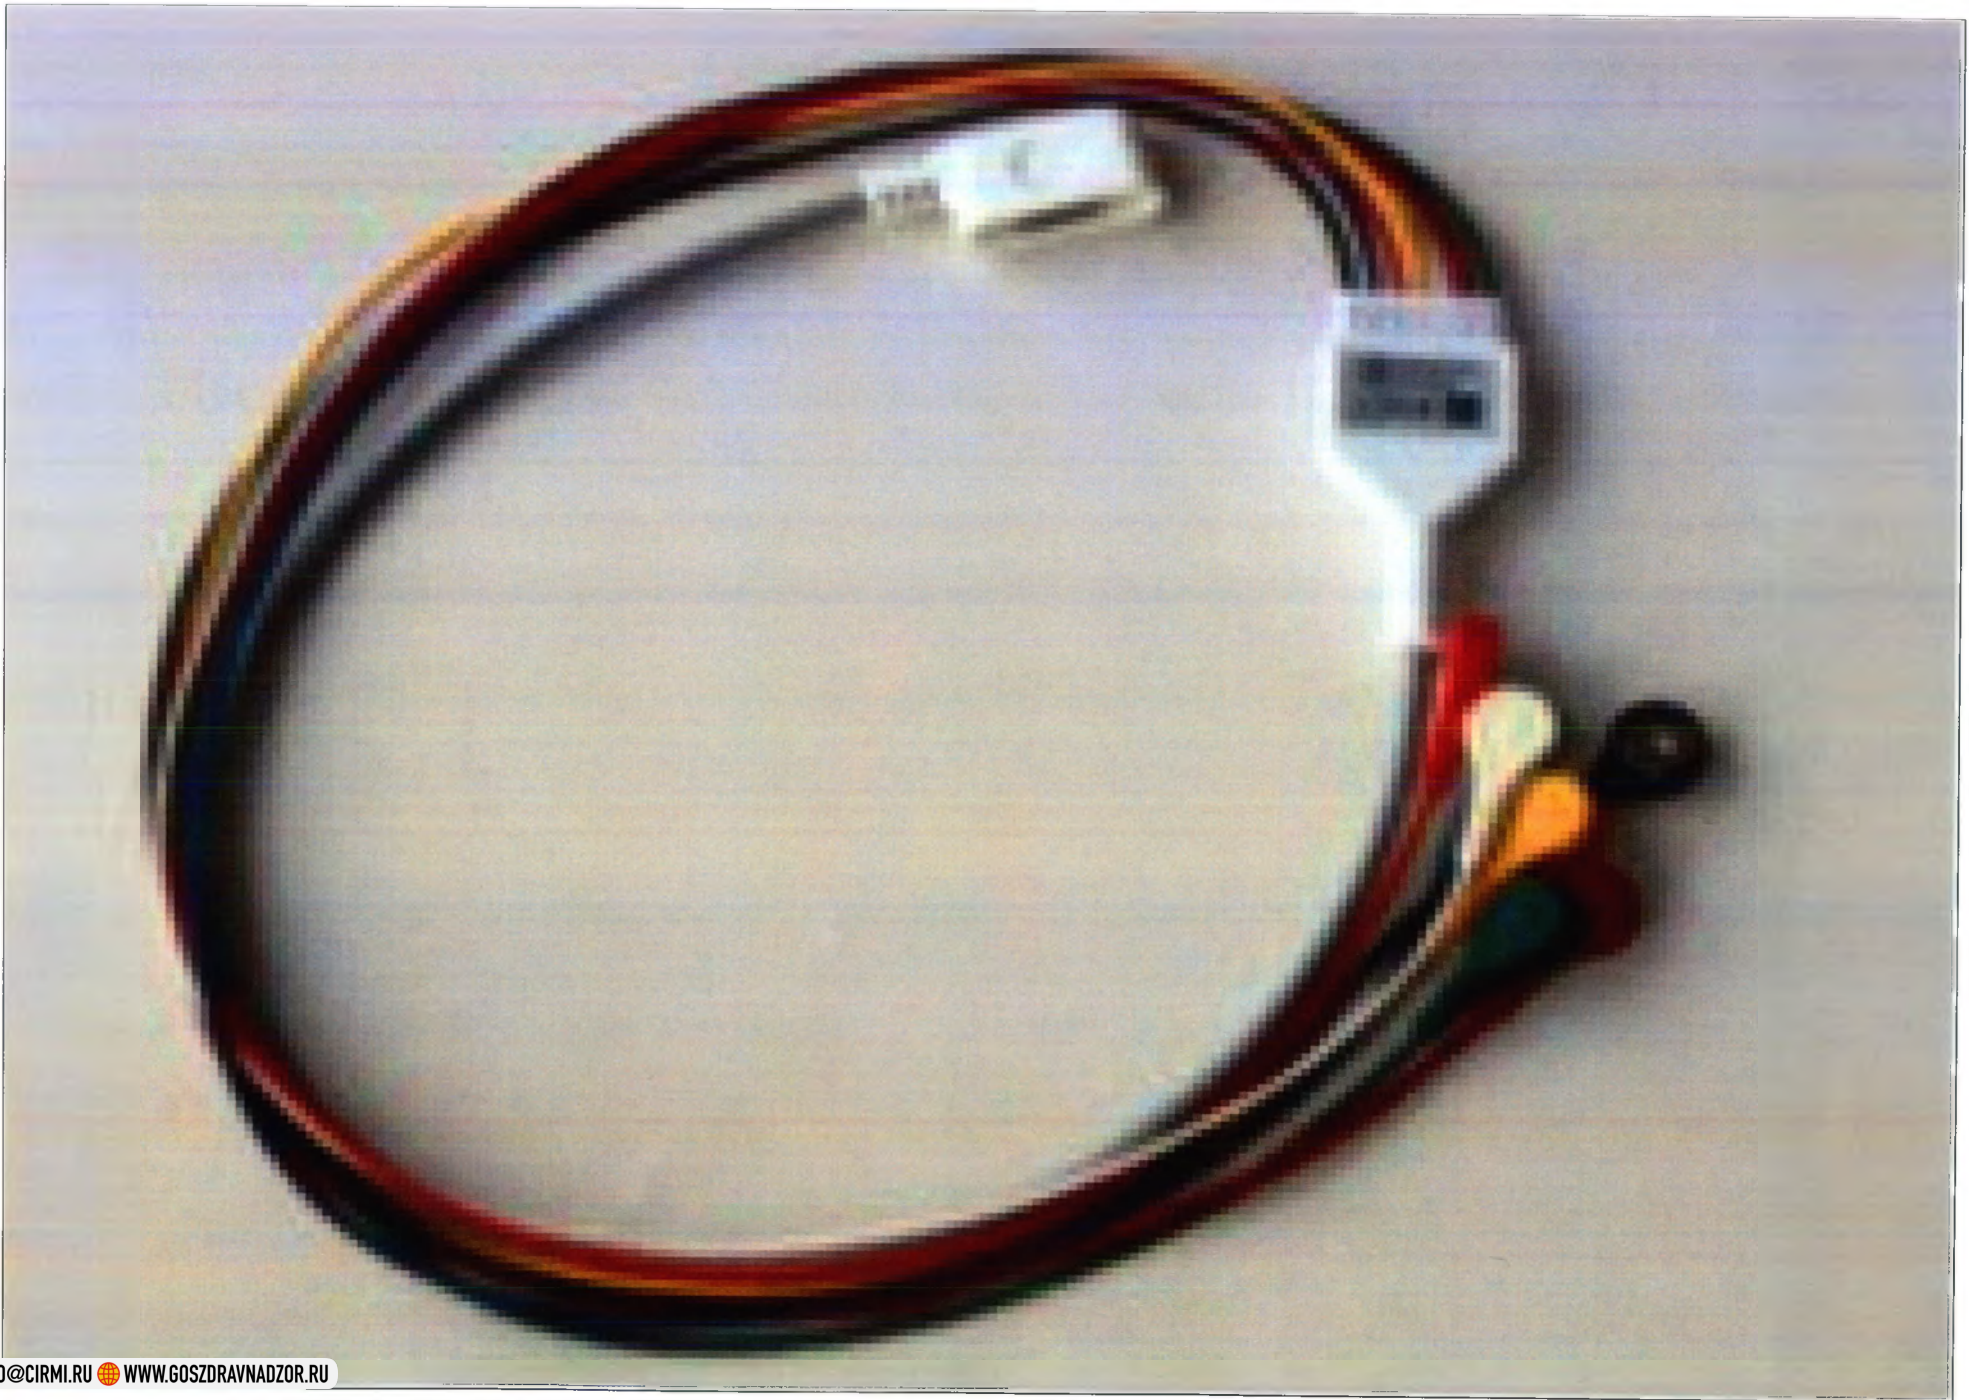


Принадлежности:

7. Кабель ЭКГ, 3 провода электродов, 3 канала, детский, стандарт АНА (не более 5 шт).

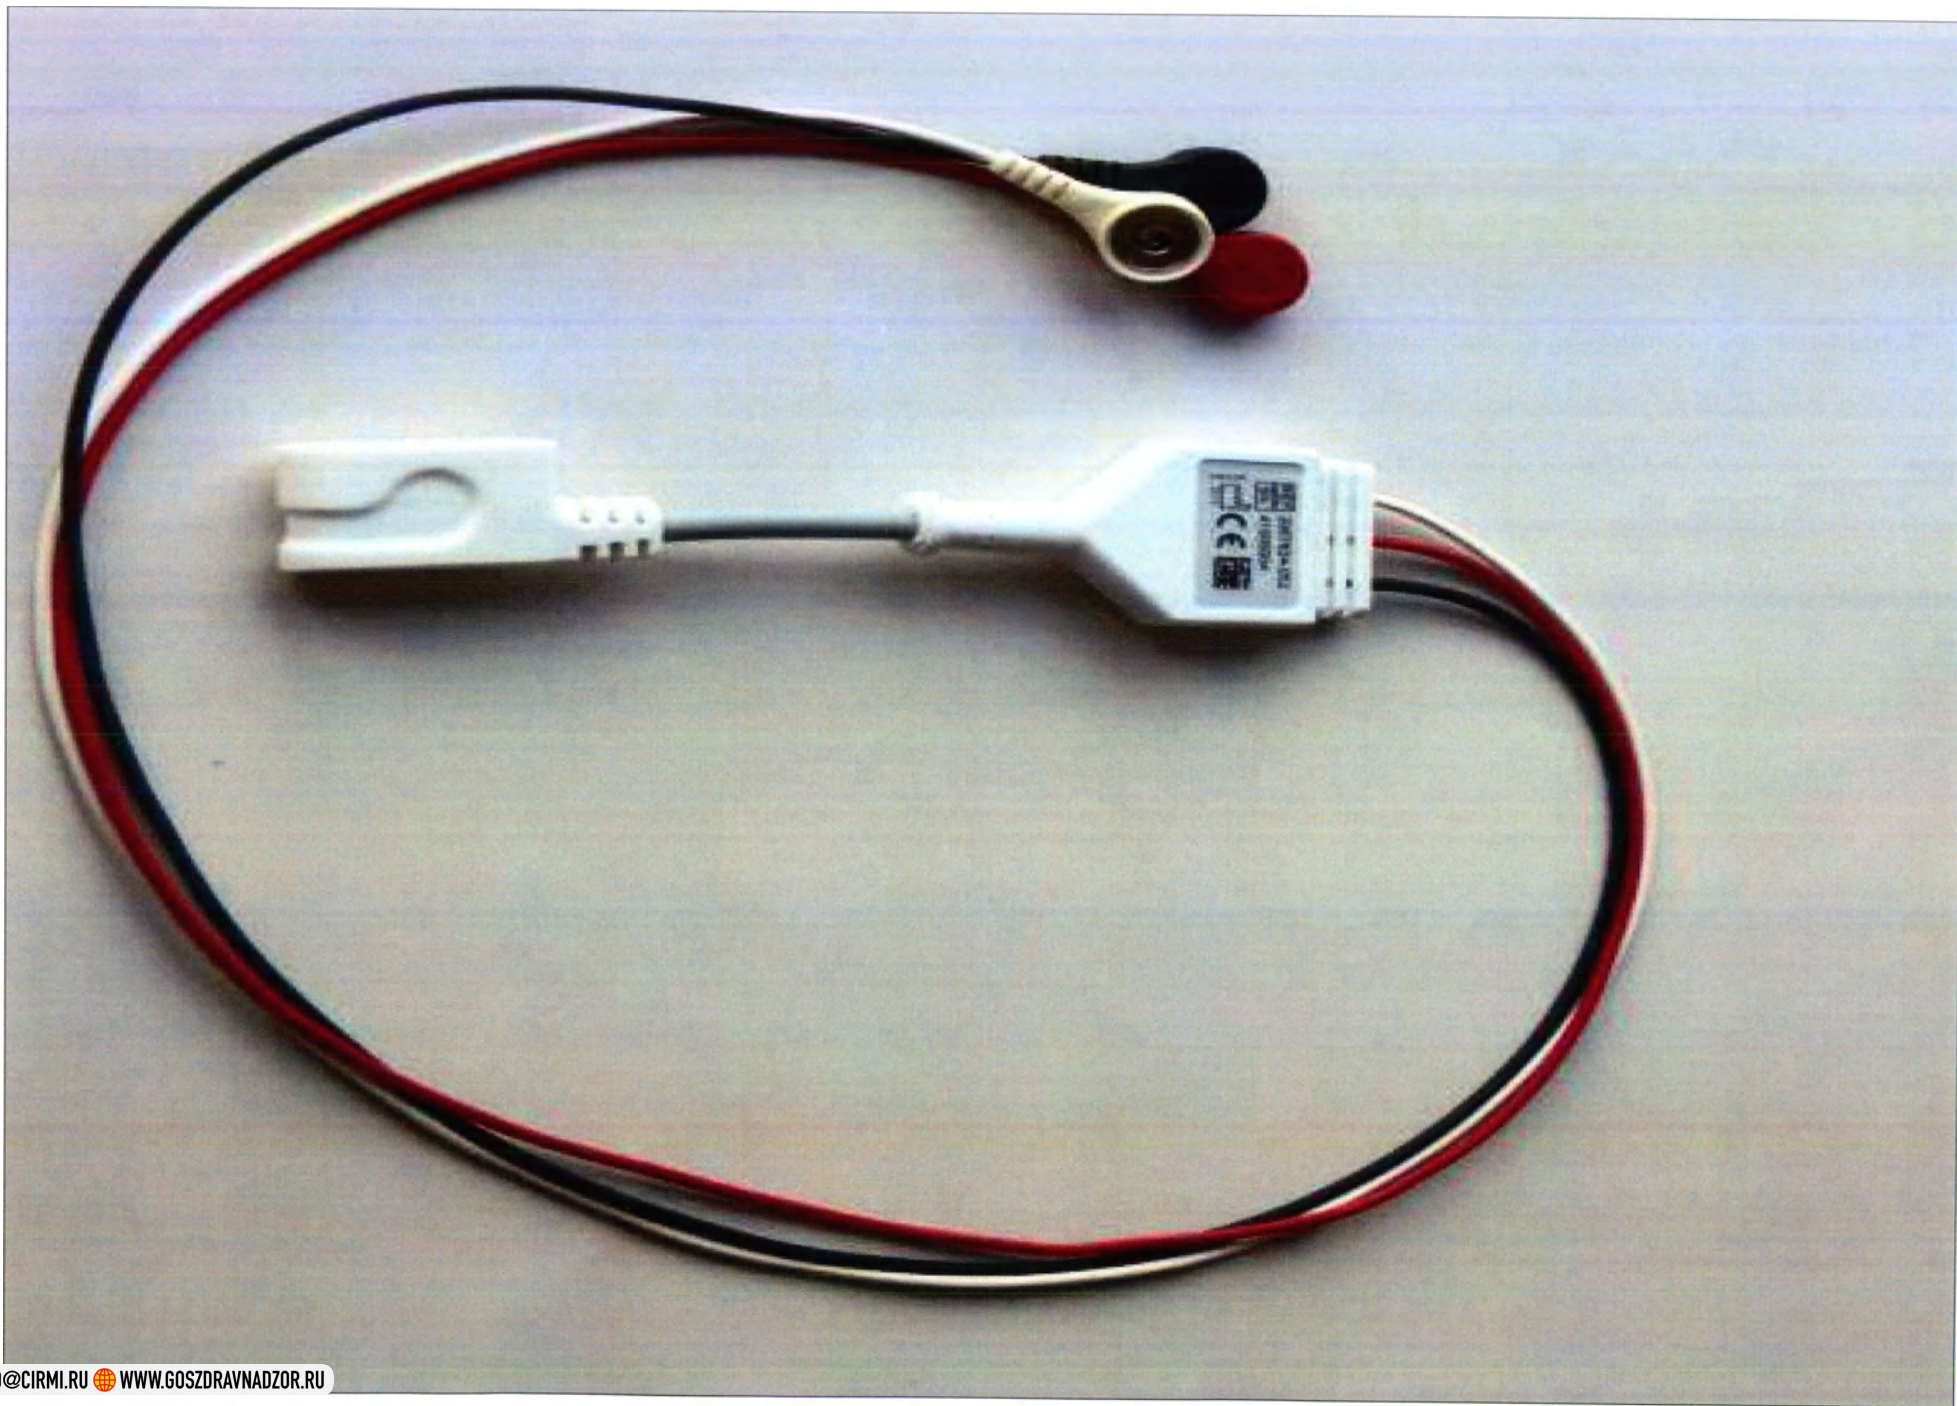


Принадлежности:

8. Кабель ЭКГ, 5 проводов электродов, 2 канала, детский, стандарт АНА (не более 5 шт).

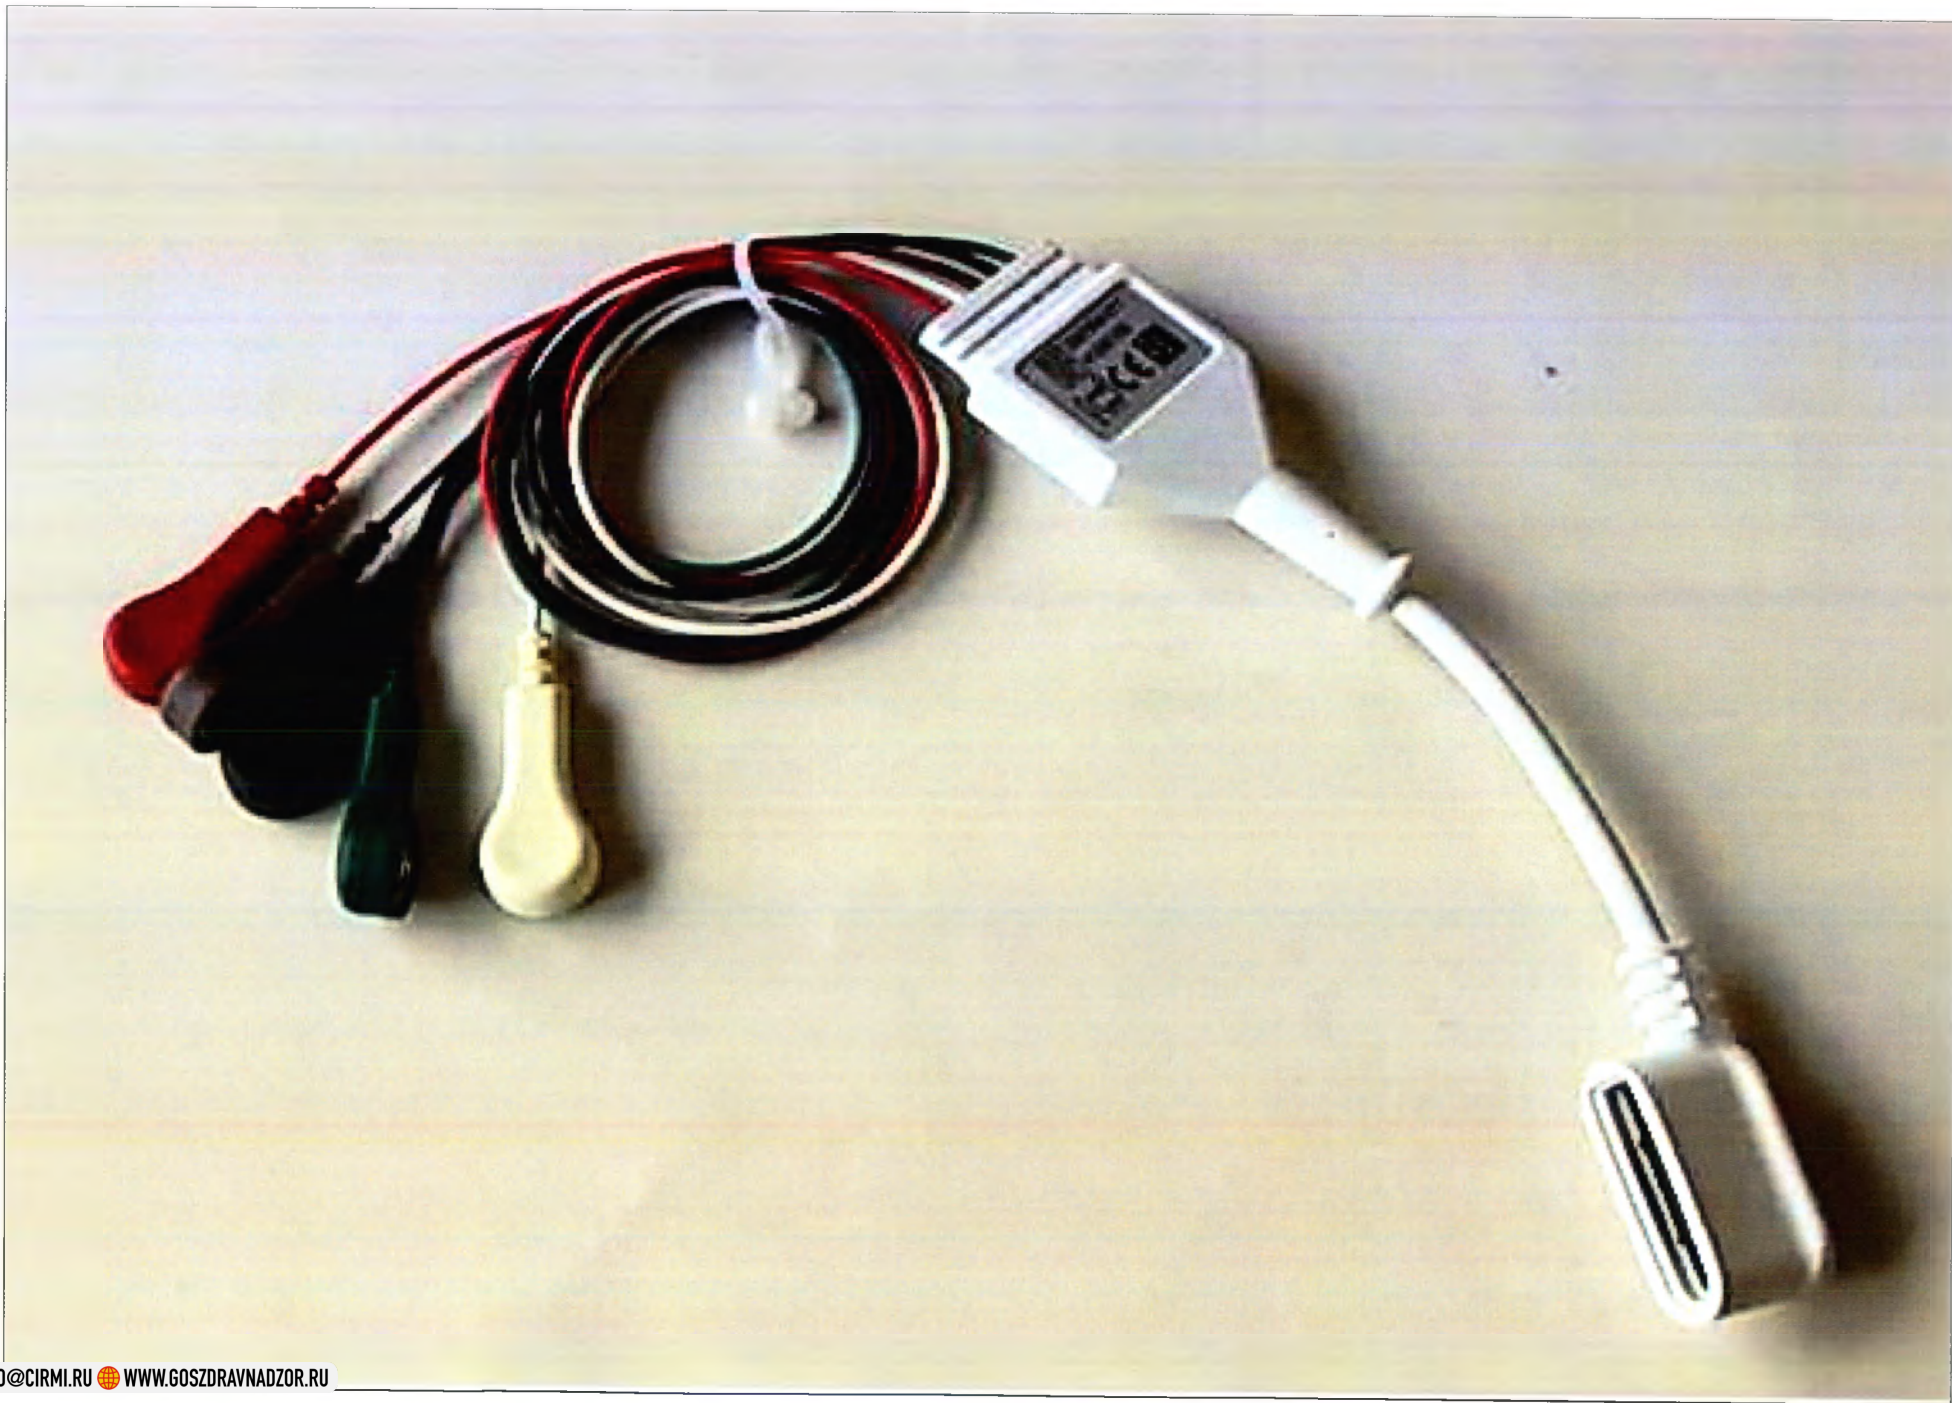


Принадлежности:

9. Кабель ЭКГ, 7 проводов электродов, 3 канала, детский, стандарт АНА (не более 5 шт).

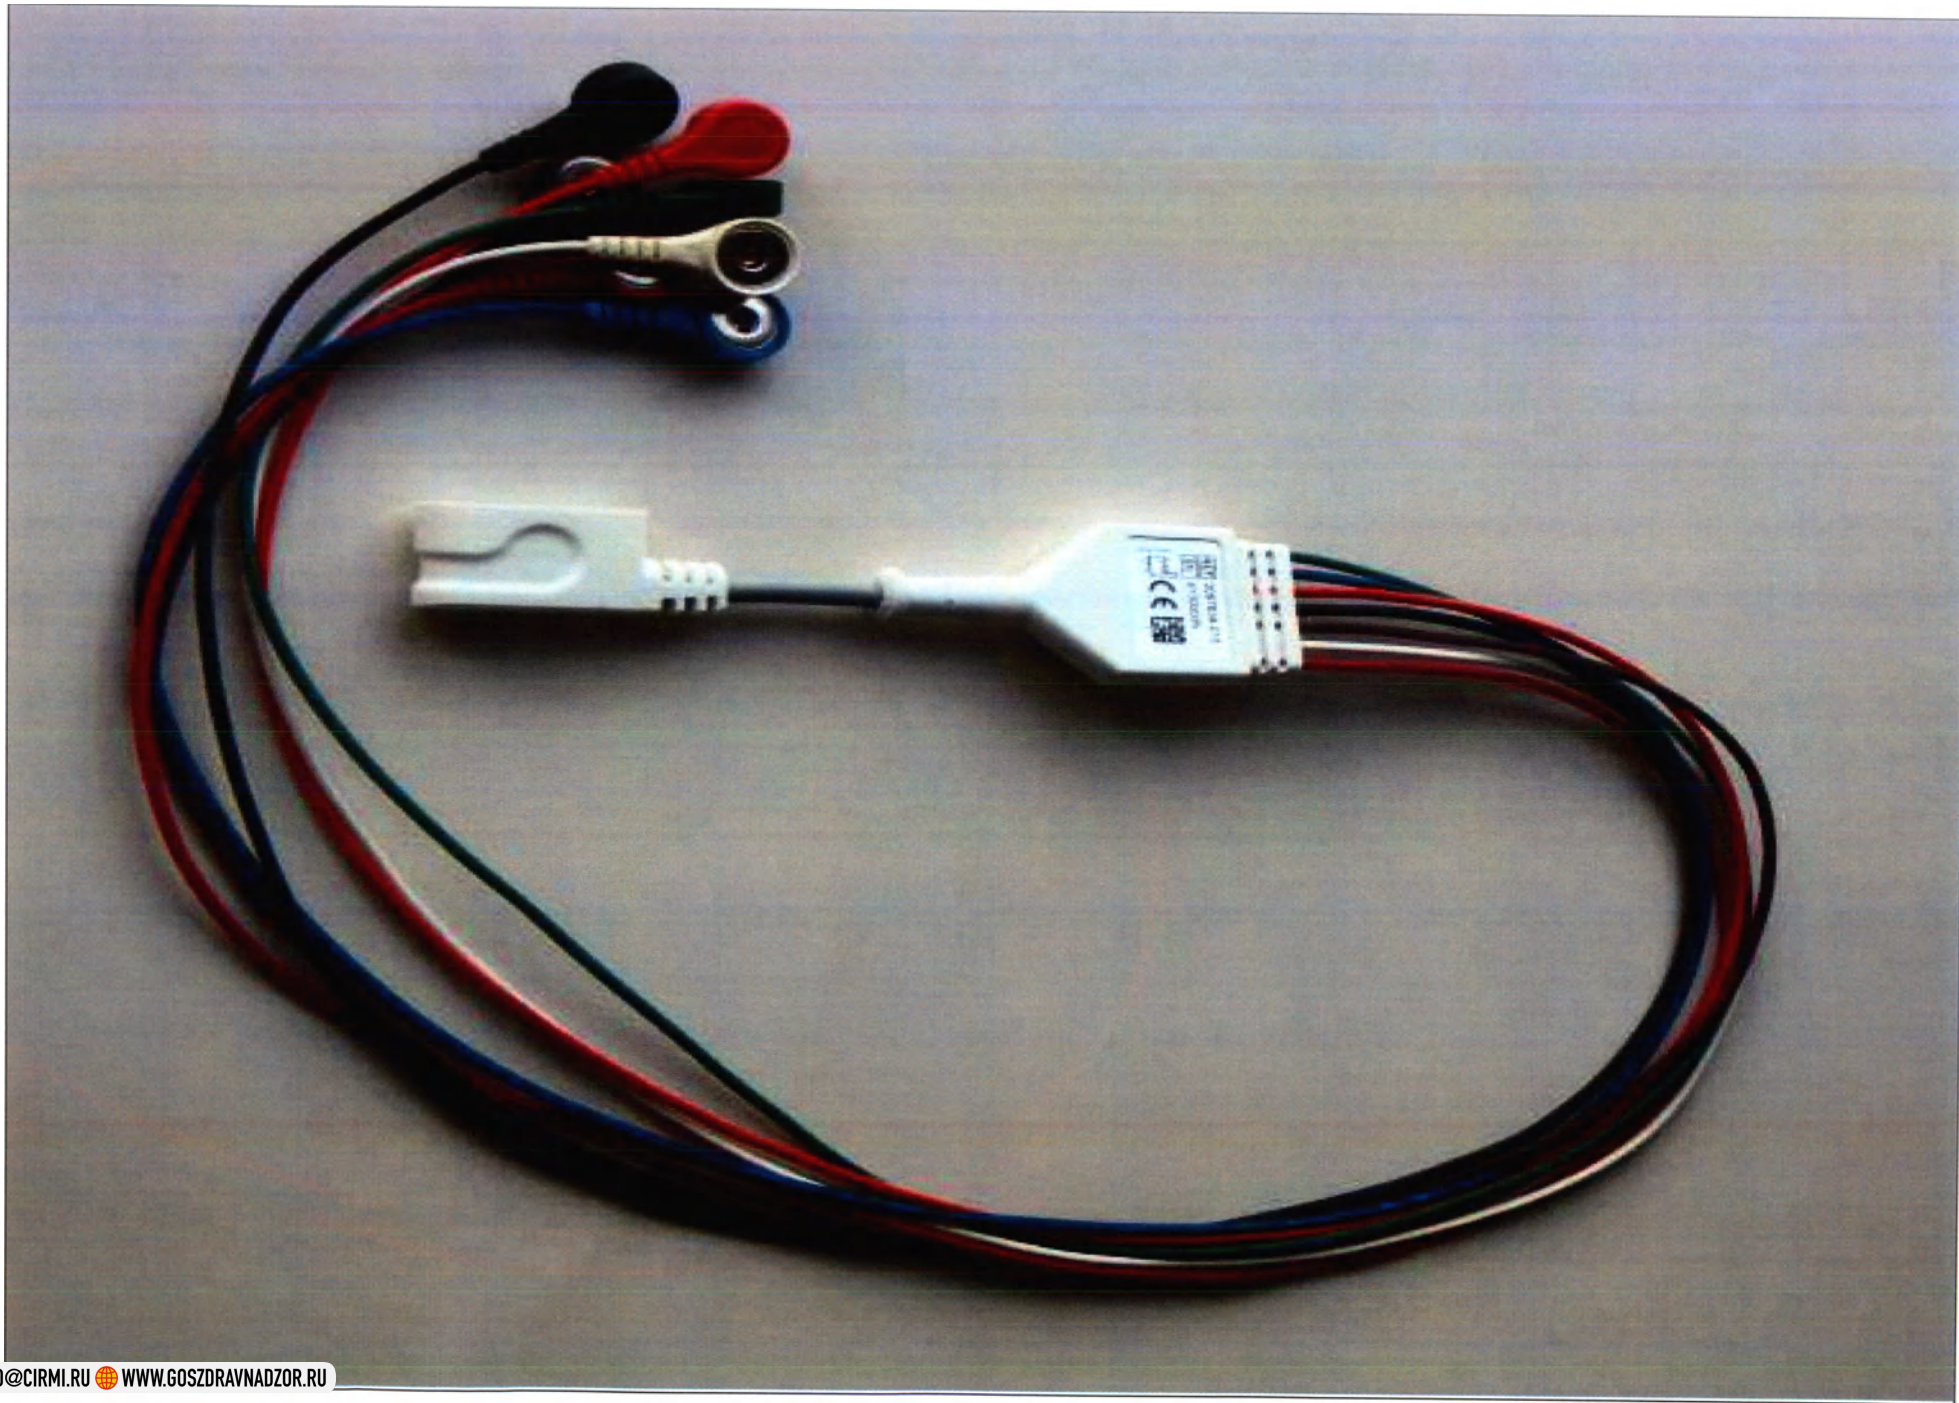


Принадлежности:

10. Кабель ЭКГ, 3 провода электродов, 3 канала, стандарт АНА (не более 5 шт).

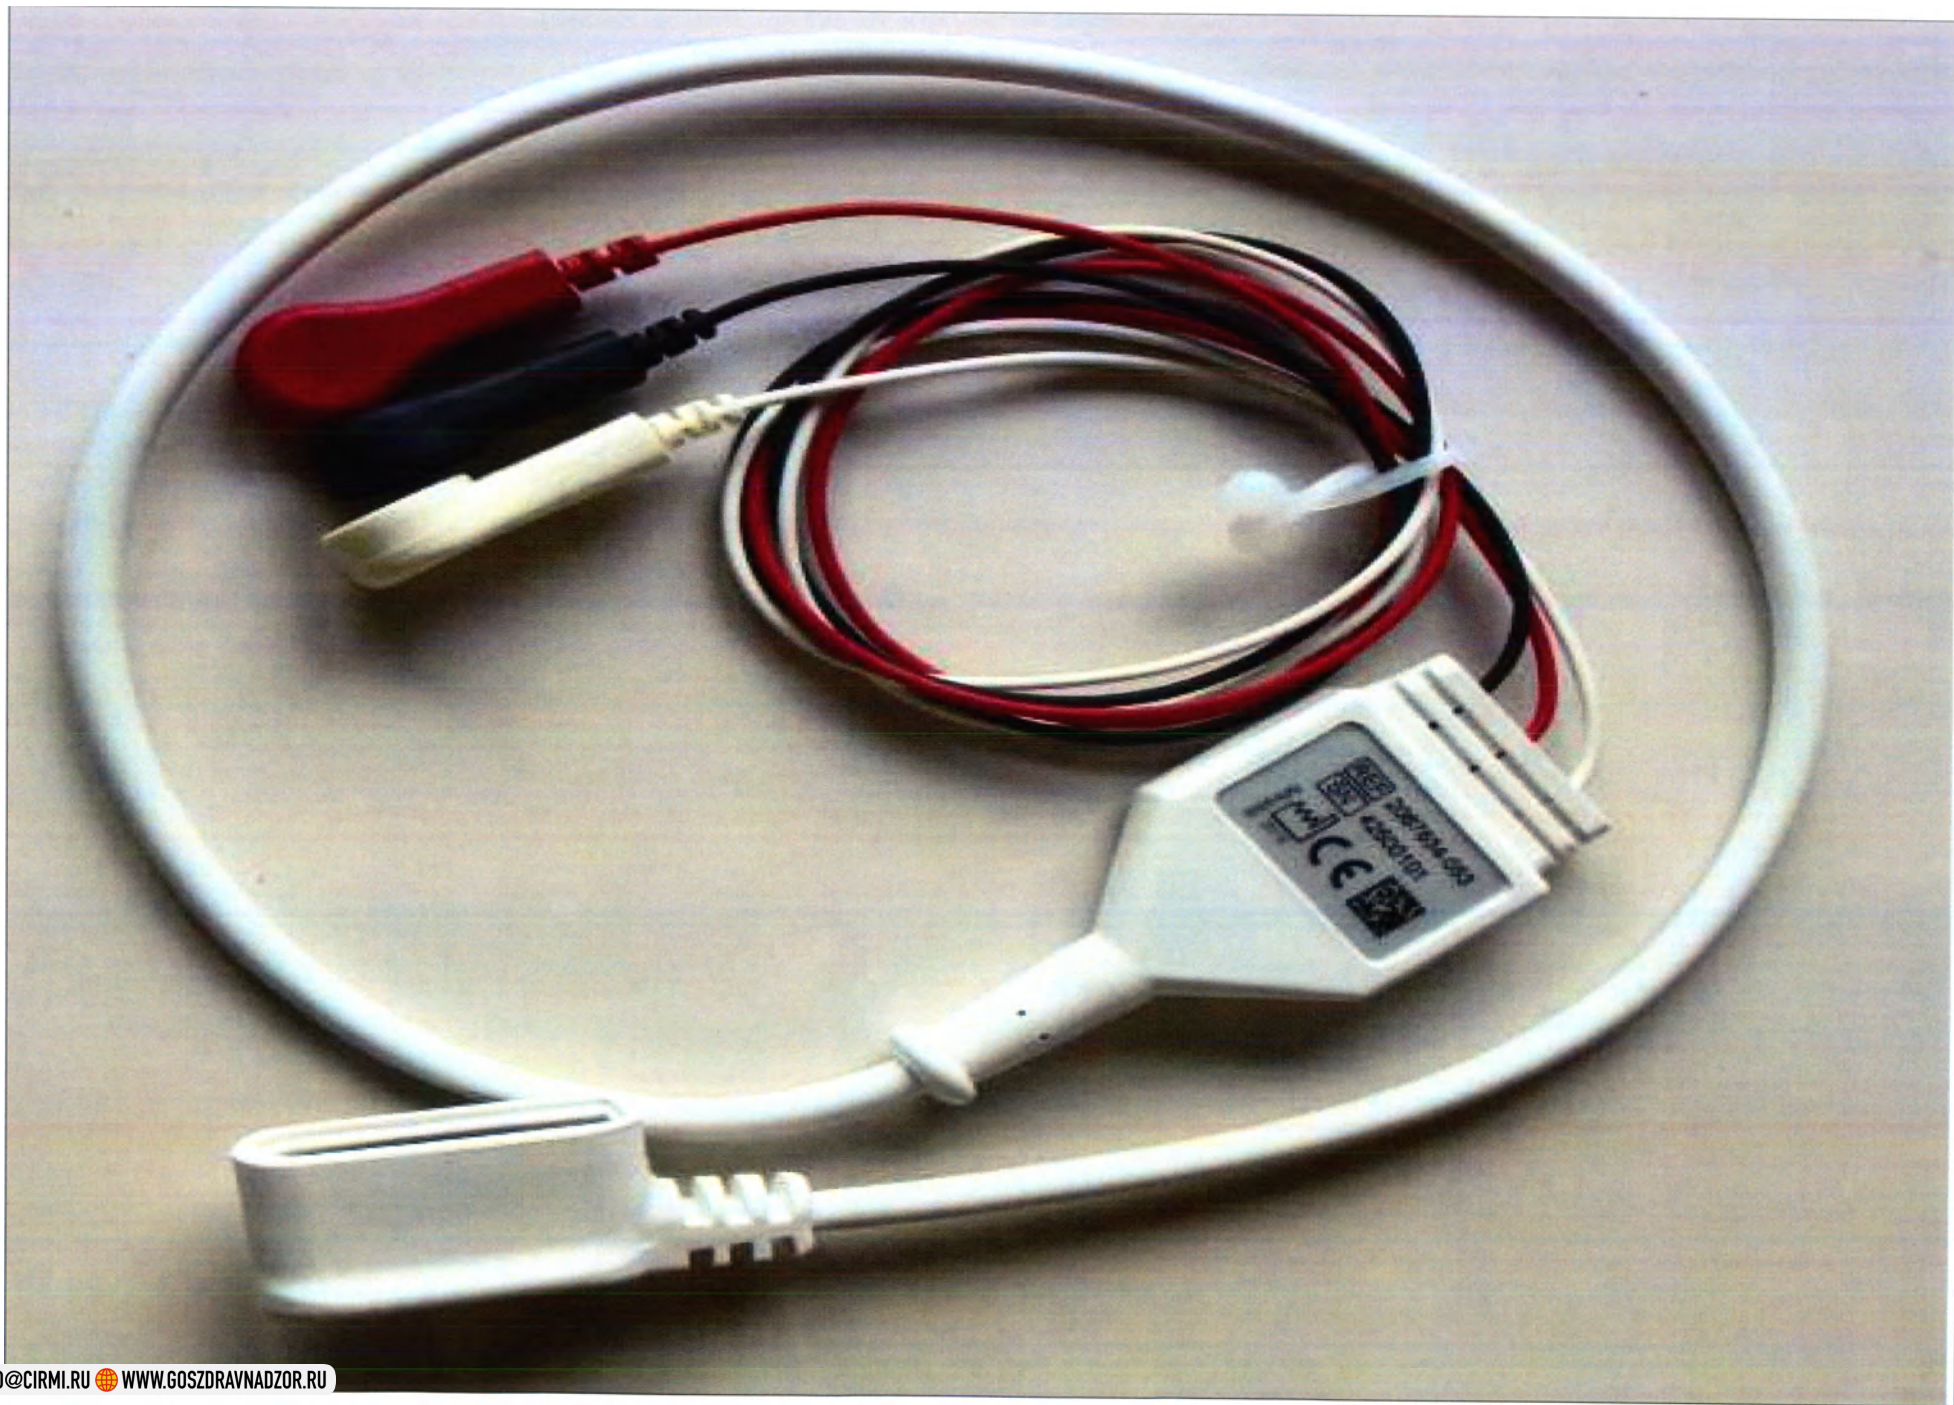

Принадлежности:

11. Кабель ЭКГ, 5 проводов электродов, 2 канала, стандарт АНА (не более 5 шт).

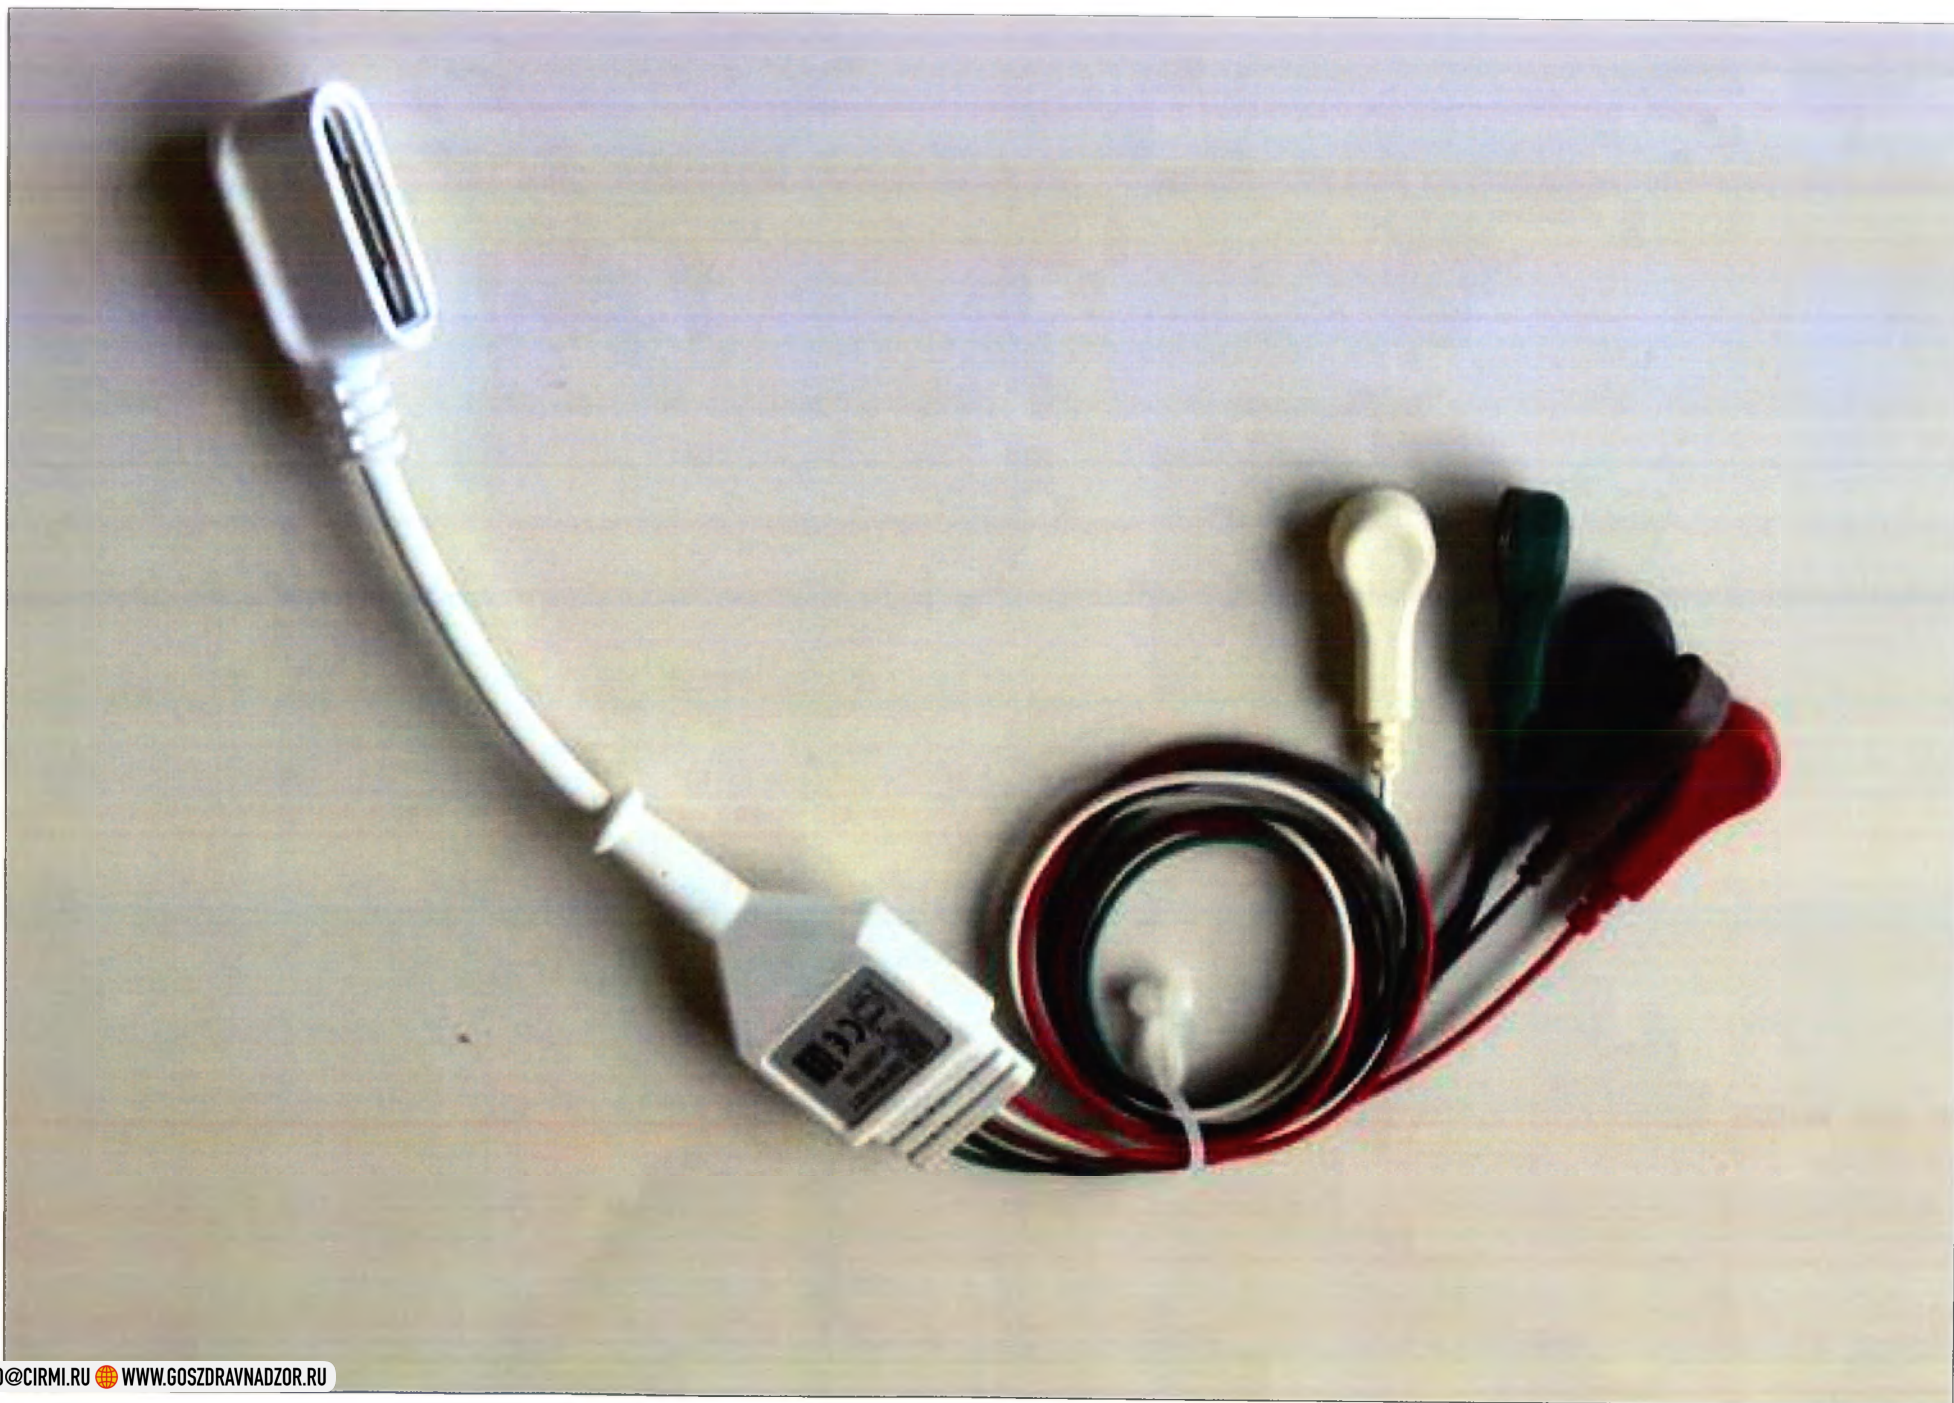

Принадлежности:

12. Кабель ЭКГ, 7 проводов электродов, 3 канала, стандарт АНА (не более 5 шт).



Принадлежности:

13. Чехол для устройства с плечевым и поясным ремнями (не более 5 шт.)




Принадлежности:

14. Чехол для SEER 1000 (не более 5шт.).



Принадлежности:

15. Электроды (одноразовые) (не более 5000 шт.).

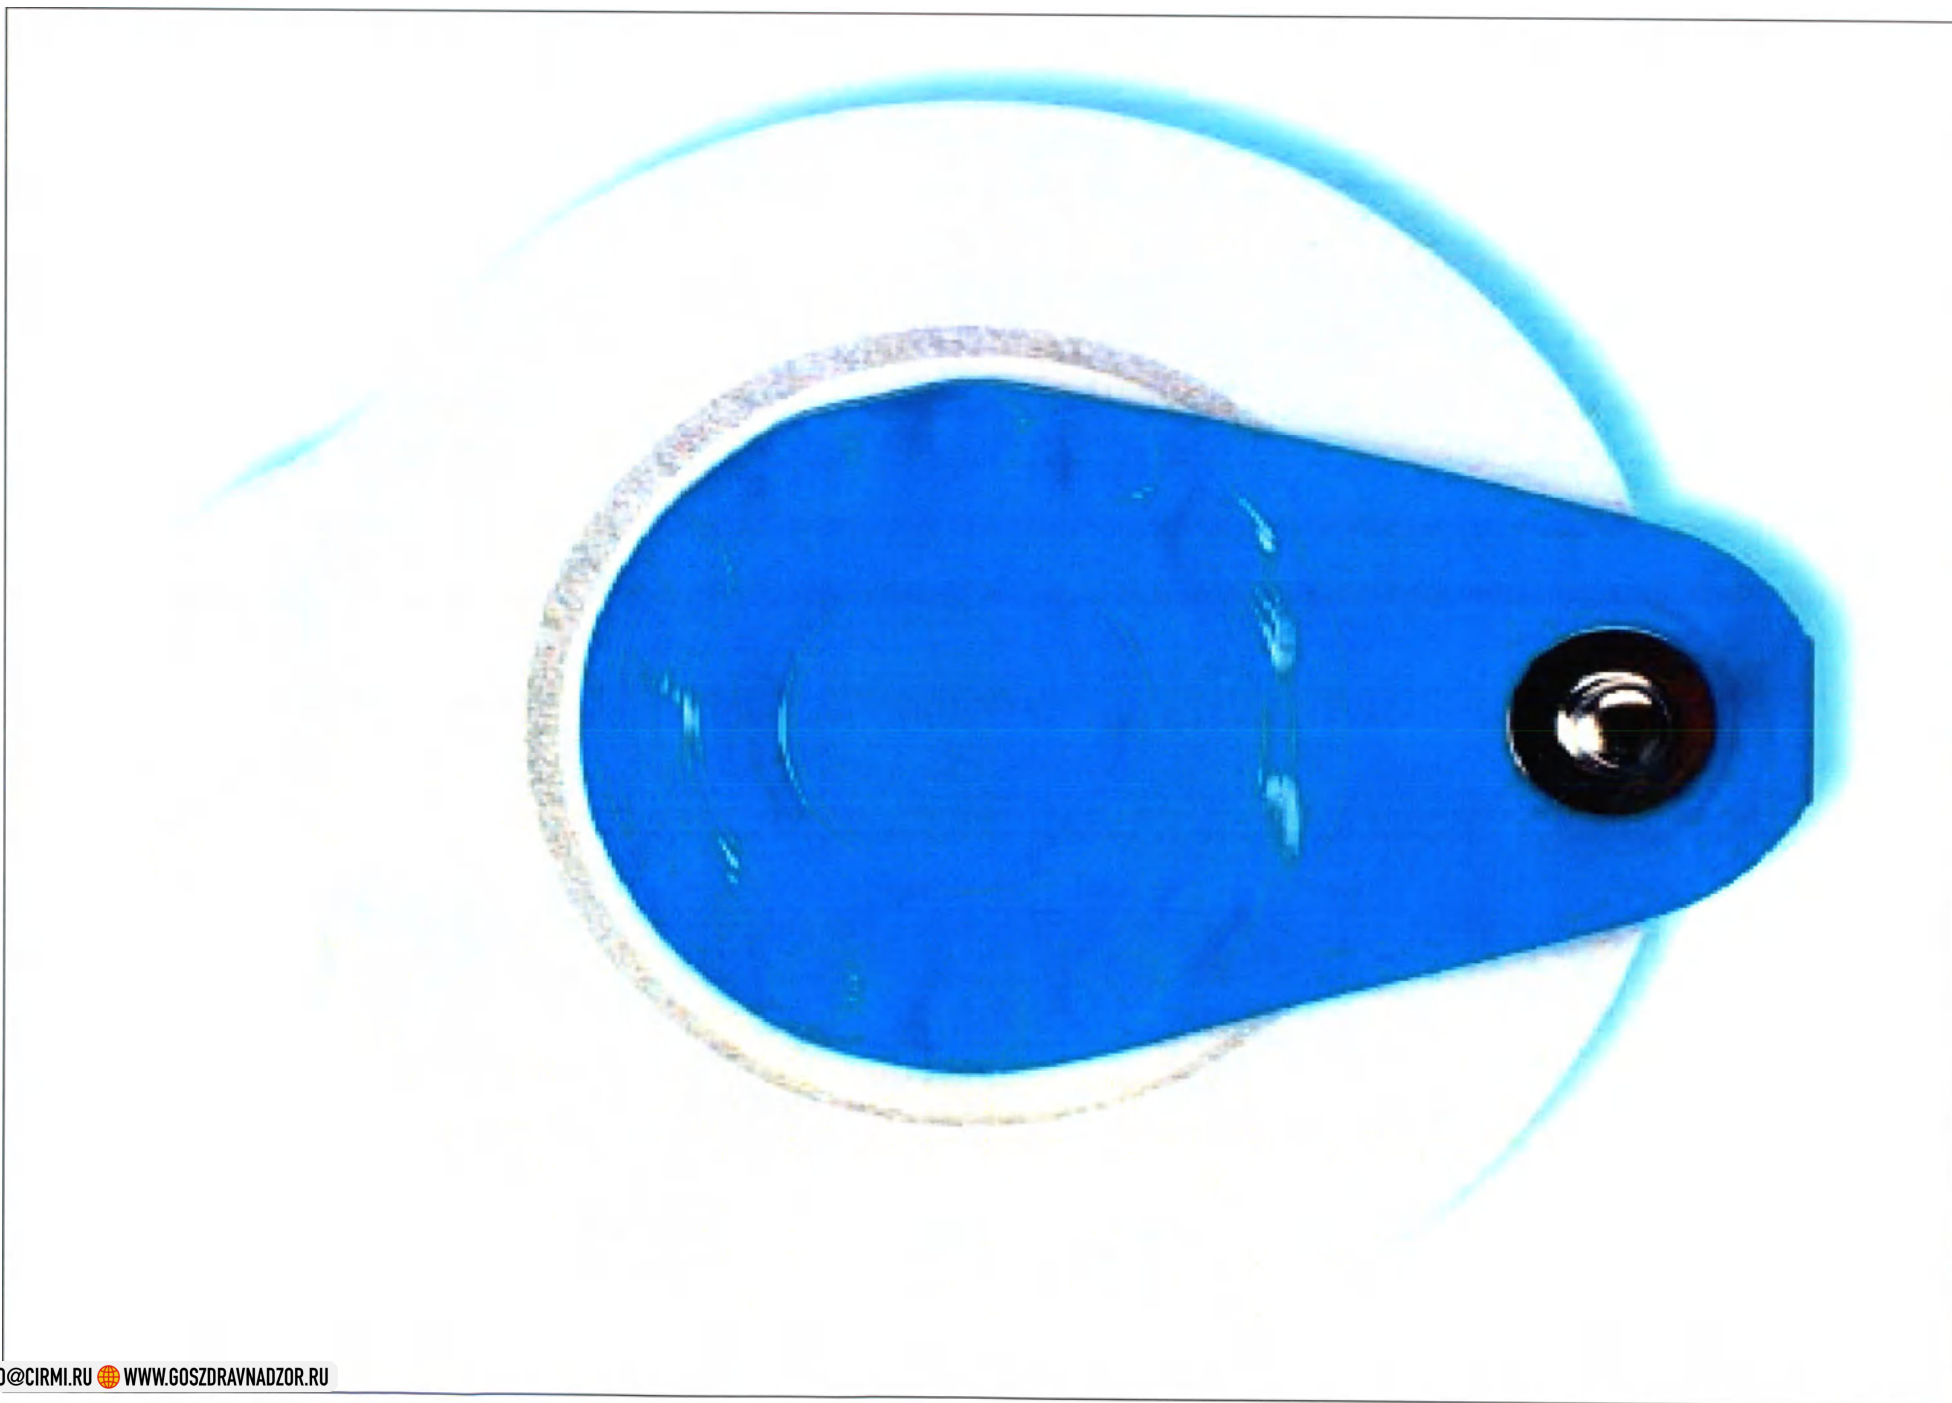

Принадлежности:

16. USB-кабель для передачи данных




Принадлежности:

17. Адаптер Bluetooth.




Принадлежности:

18.Набор аксессуаров для ЭКГ регистратора: 18.1 USB-кабель для передачи данных

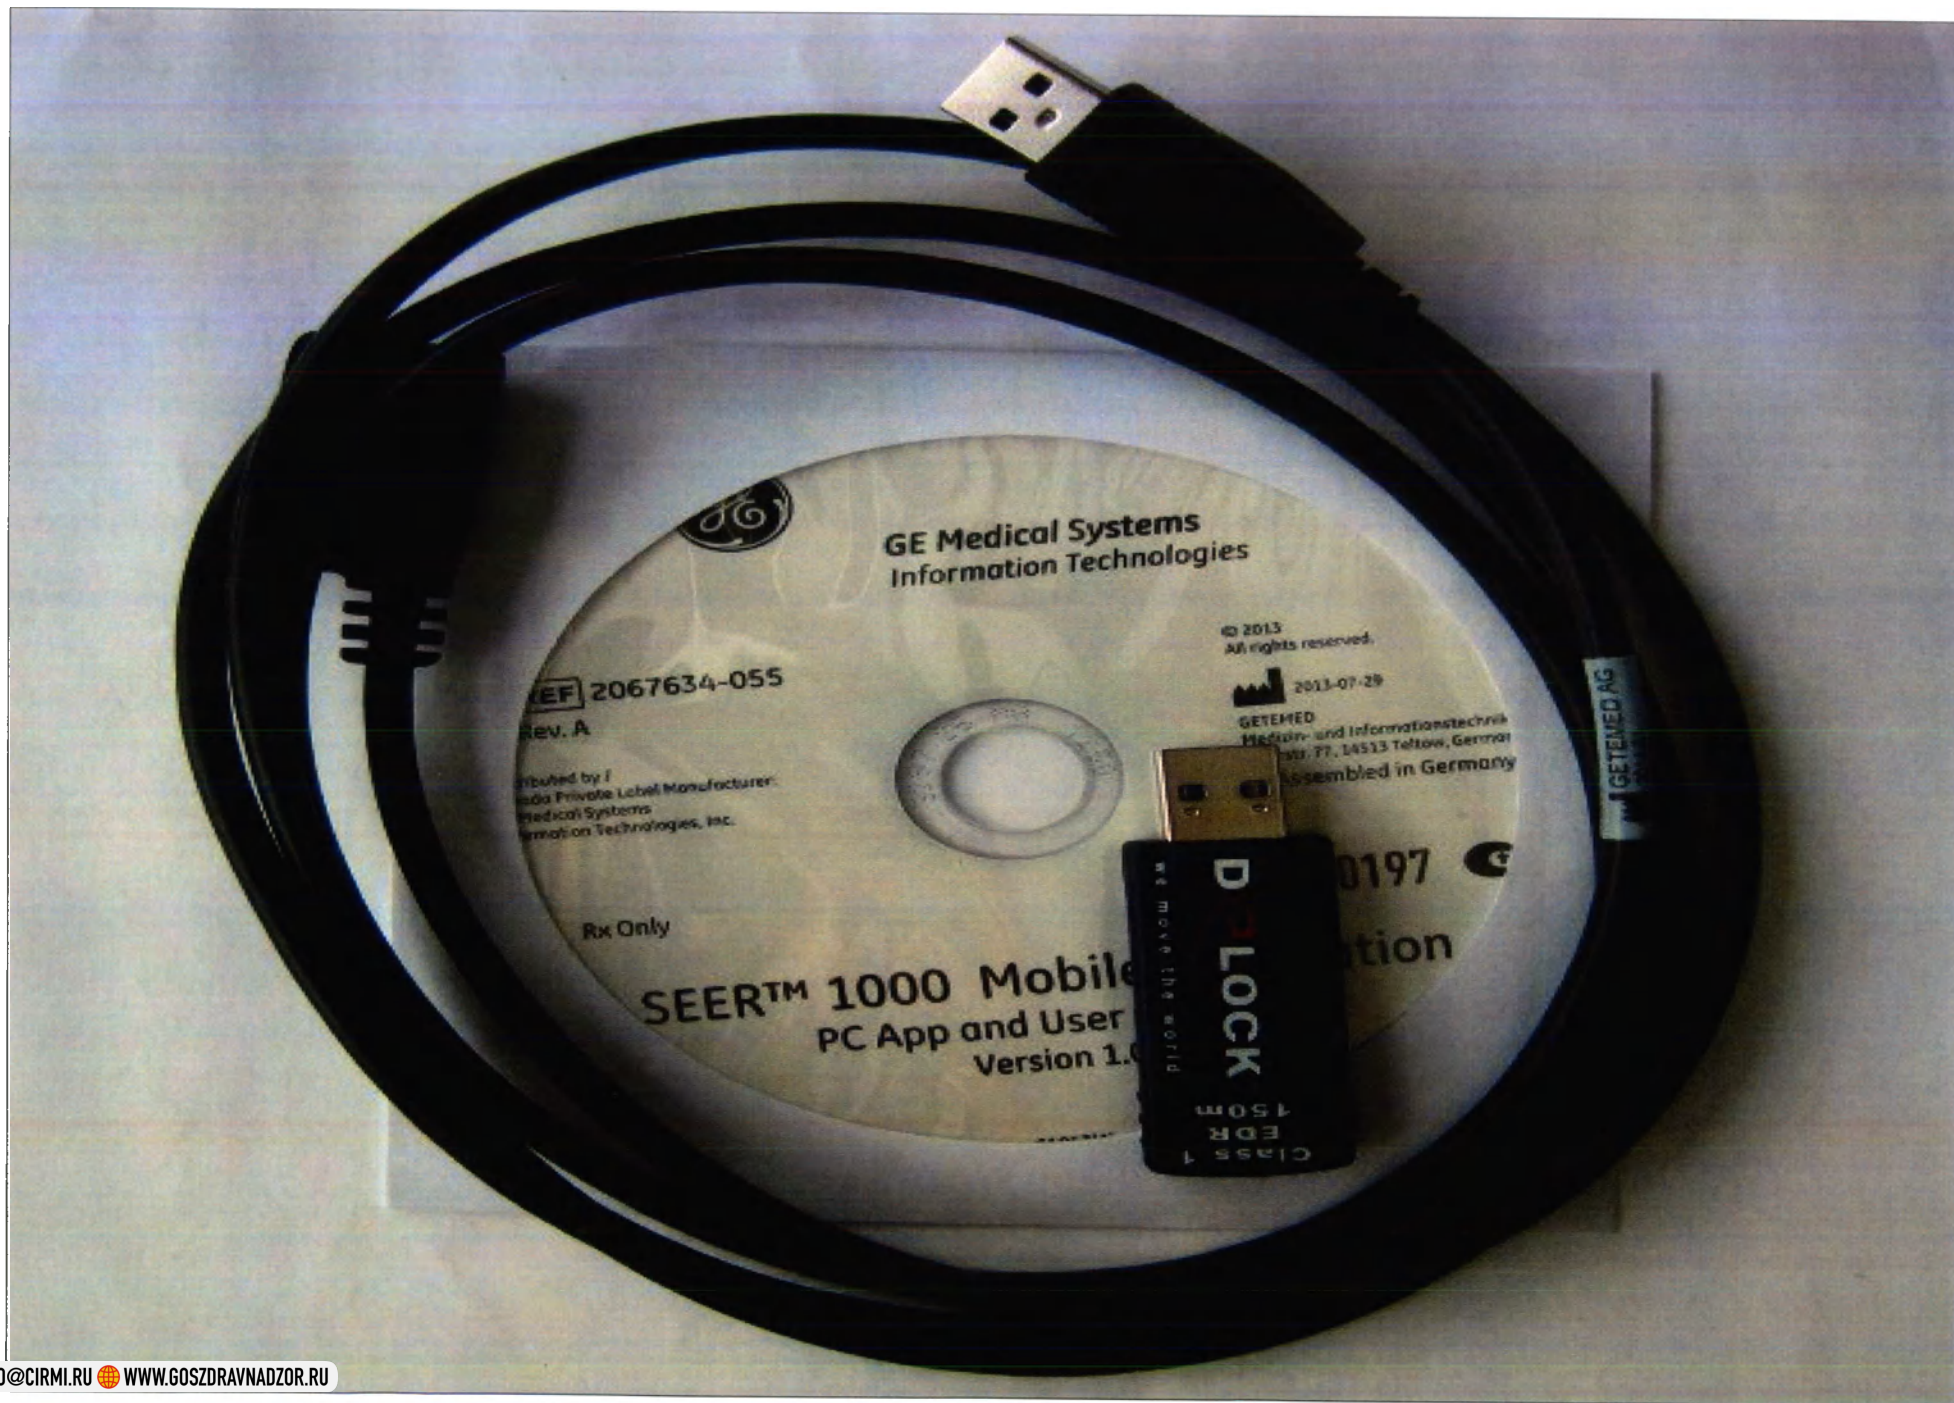


Принадлежности:

18.Набор аксессуаров для ЭКГ регистратора: 18.2 Приложение для ПК.

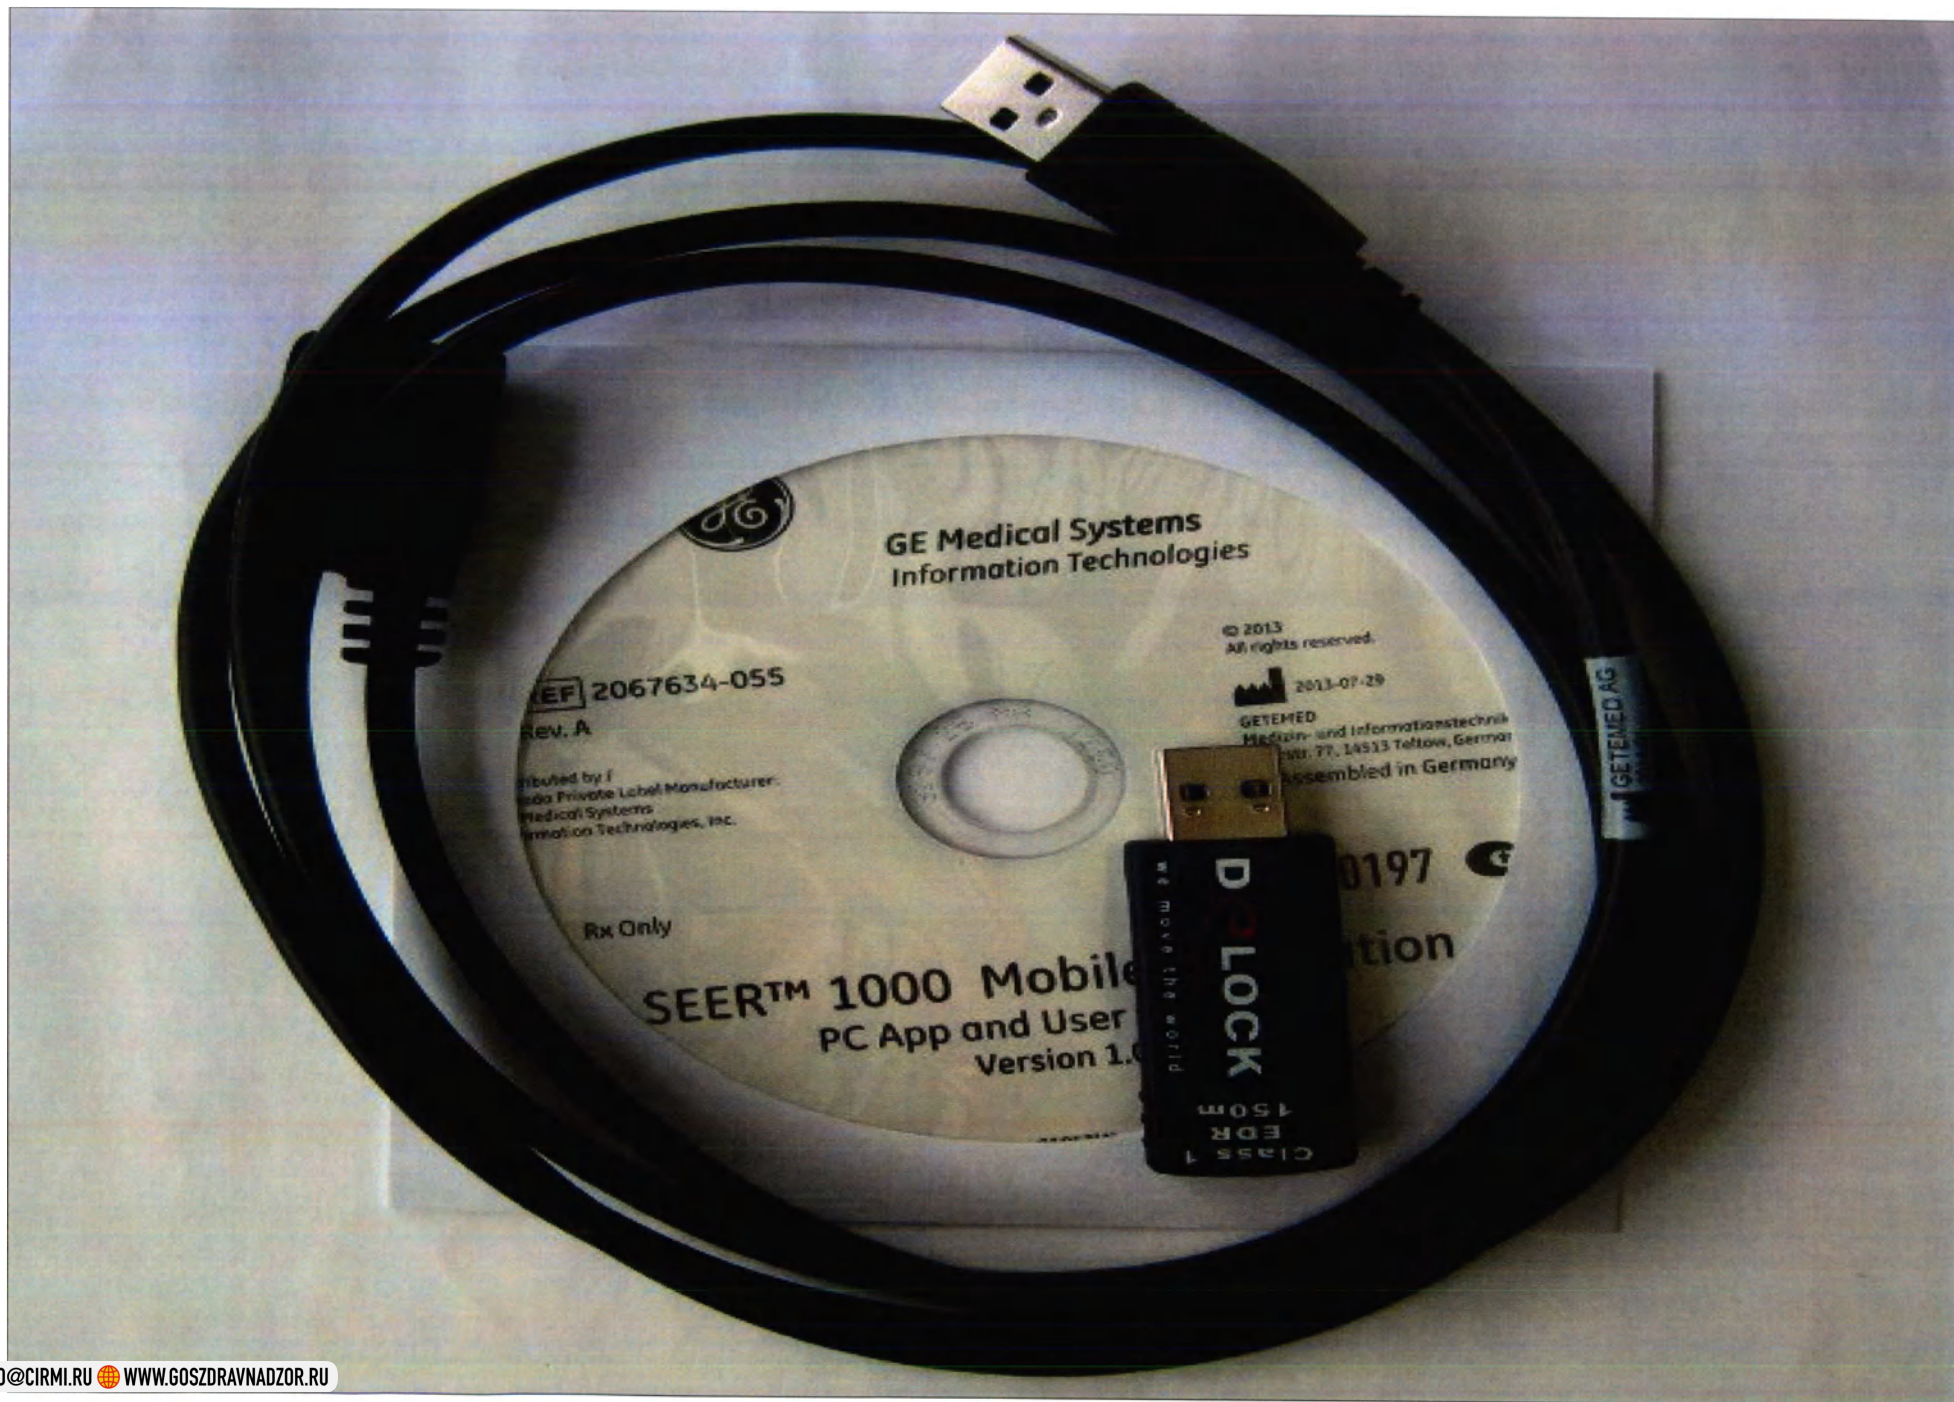

Принадлежности:

18.Набор аксессуаров для ЭКГ регистратора: 18.3 Адаптер Bluetooth.

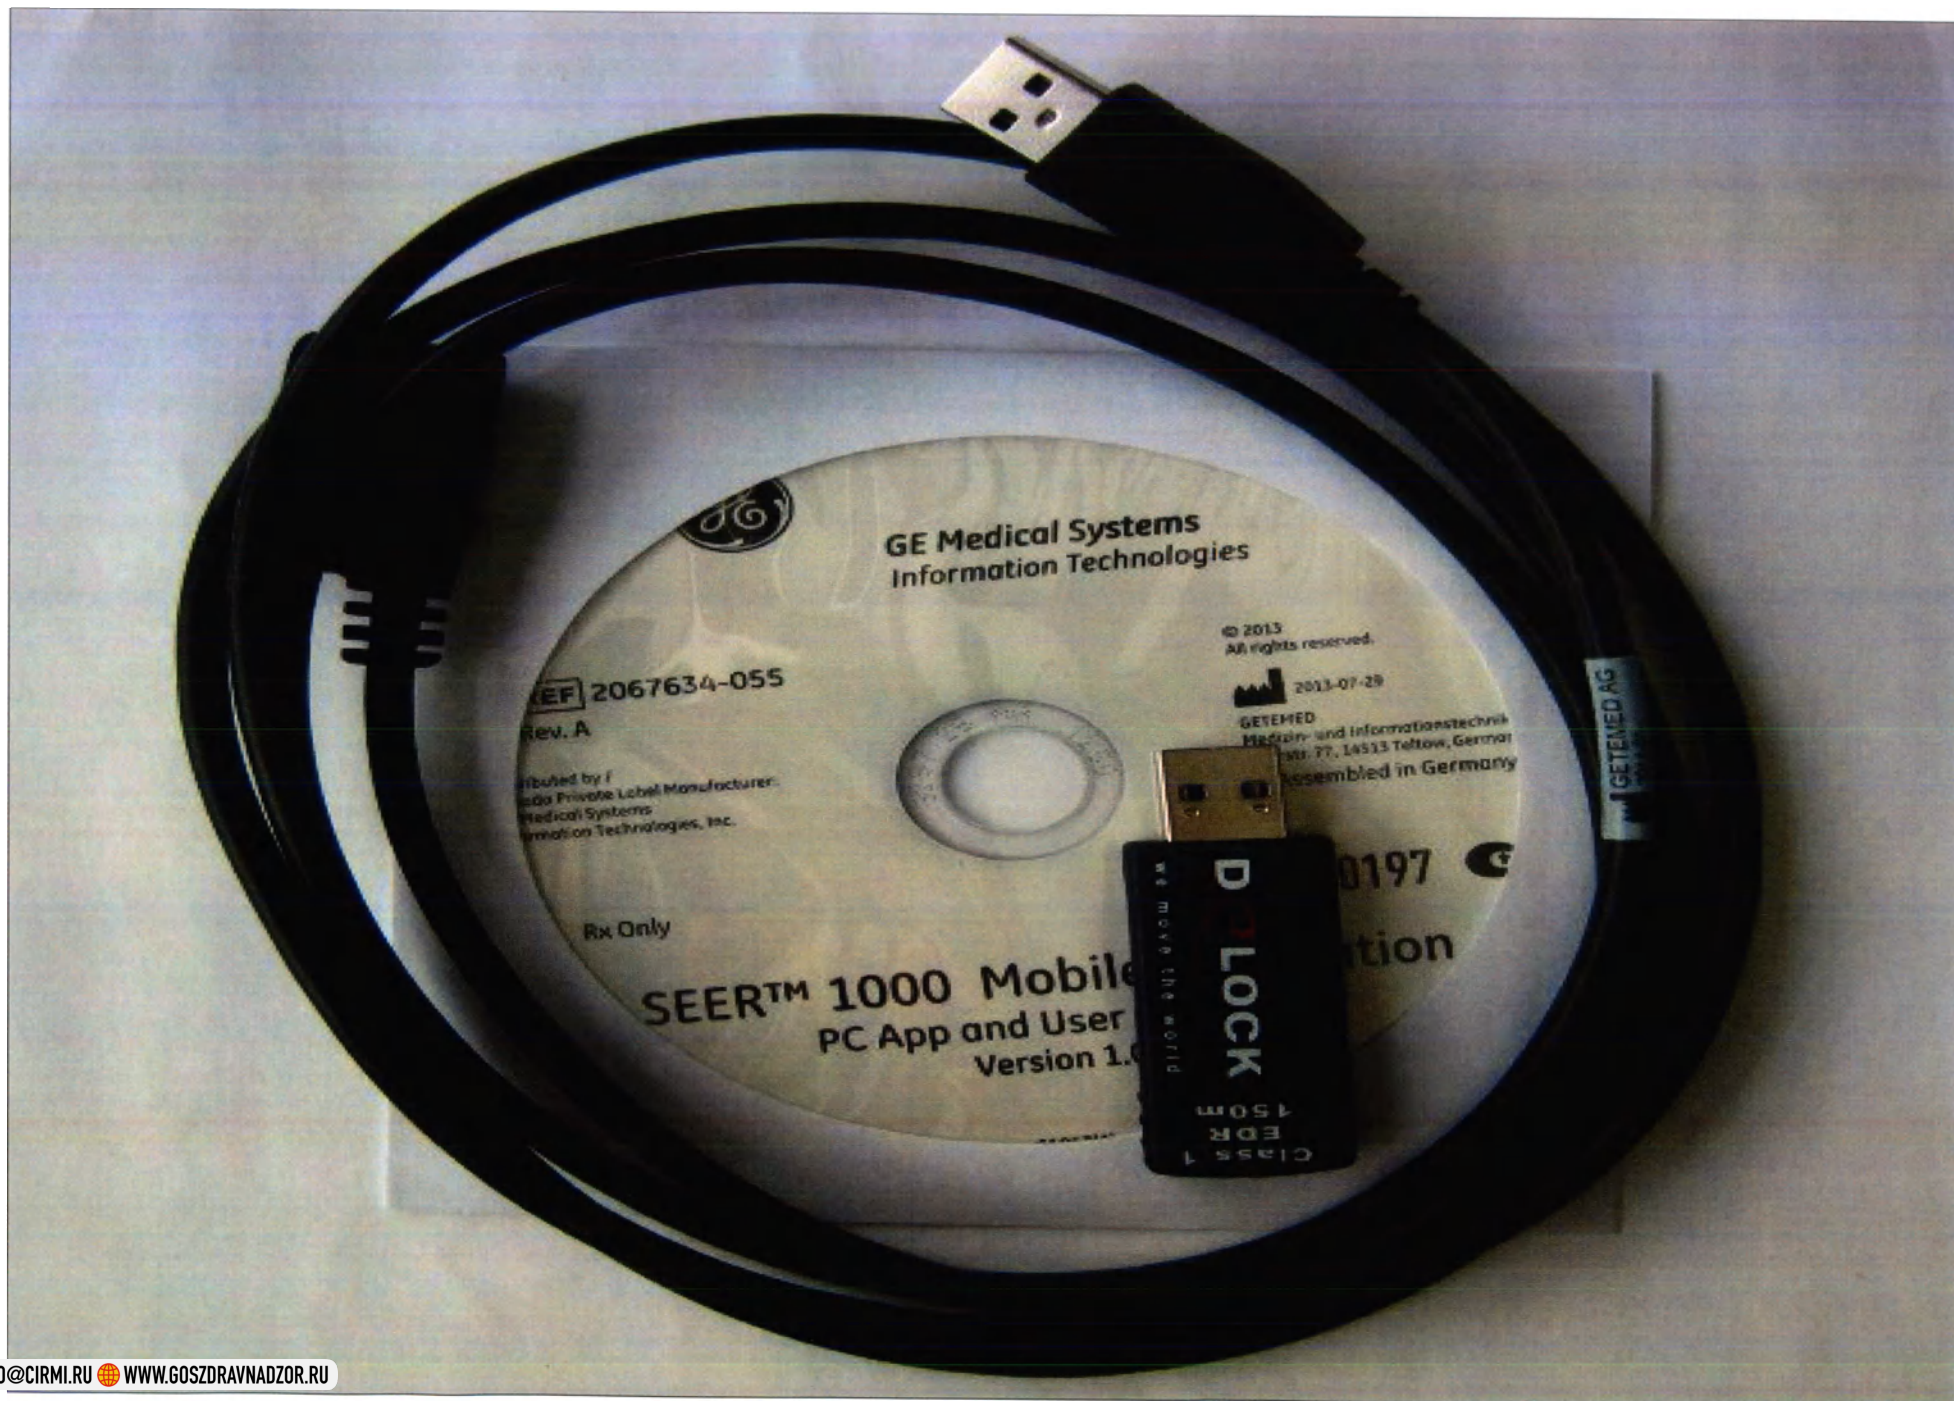


Принадлежности:

19. Набор аксессуаров для передачи данных: 19.1 Приложение для ПК.




Принадлежности:

19. Набор аксессуаров для передачи данных: 19.2 Адаптер Bluetooth.

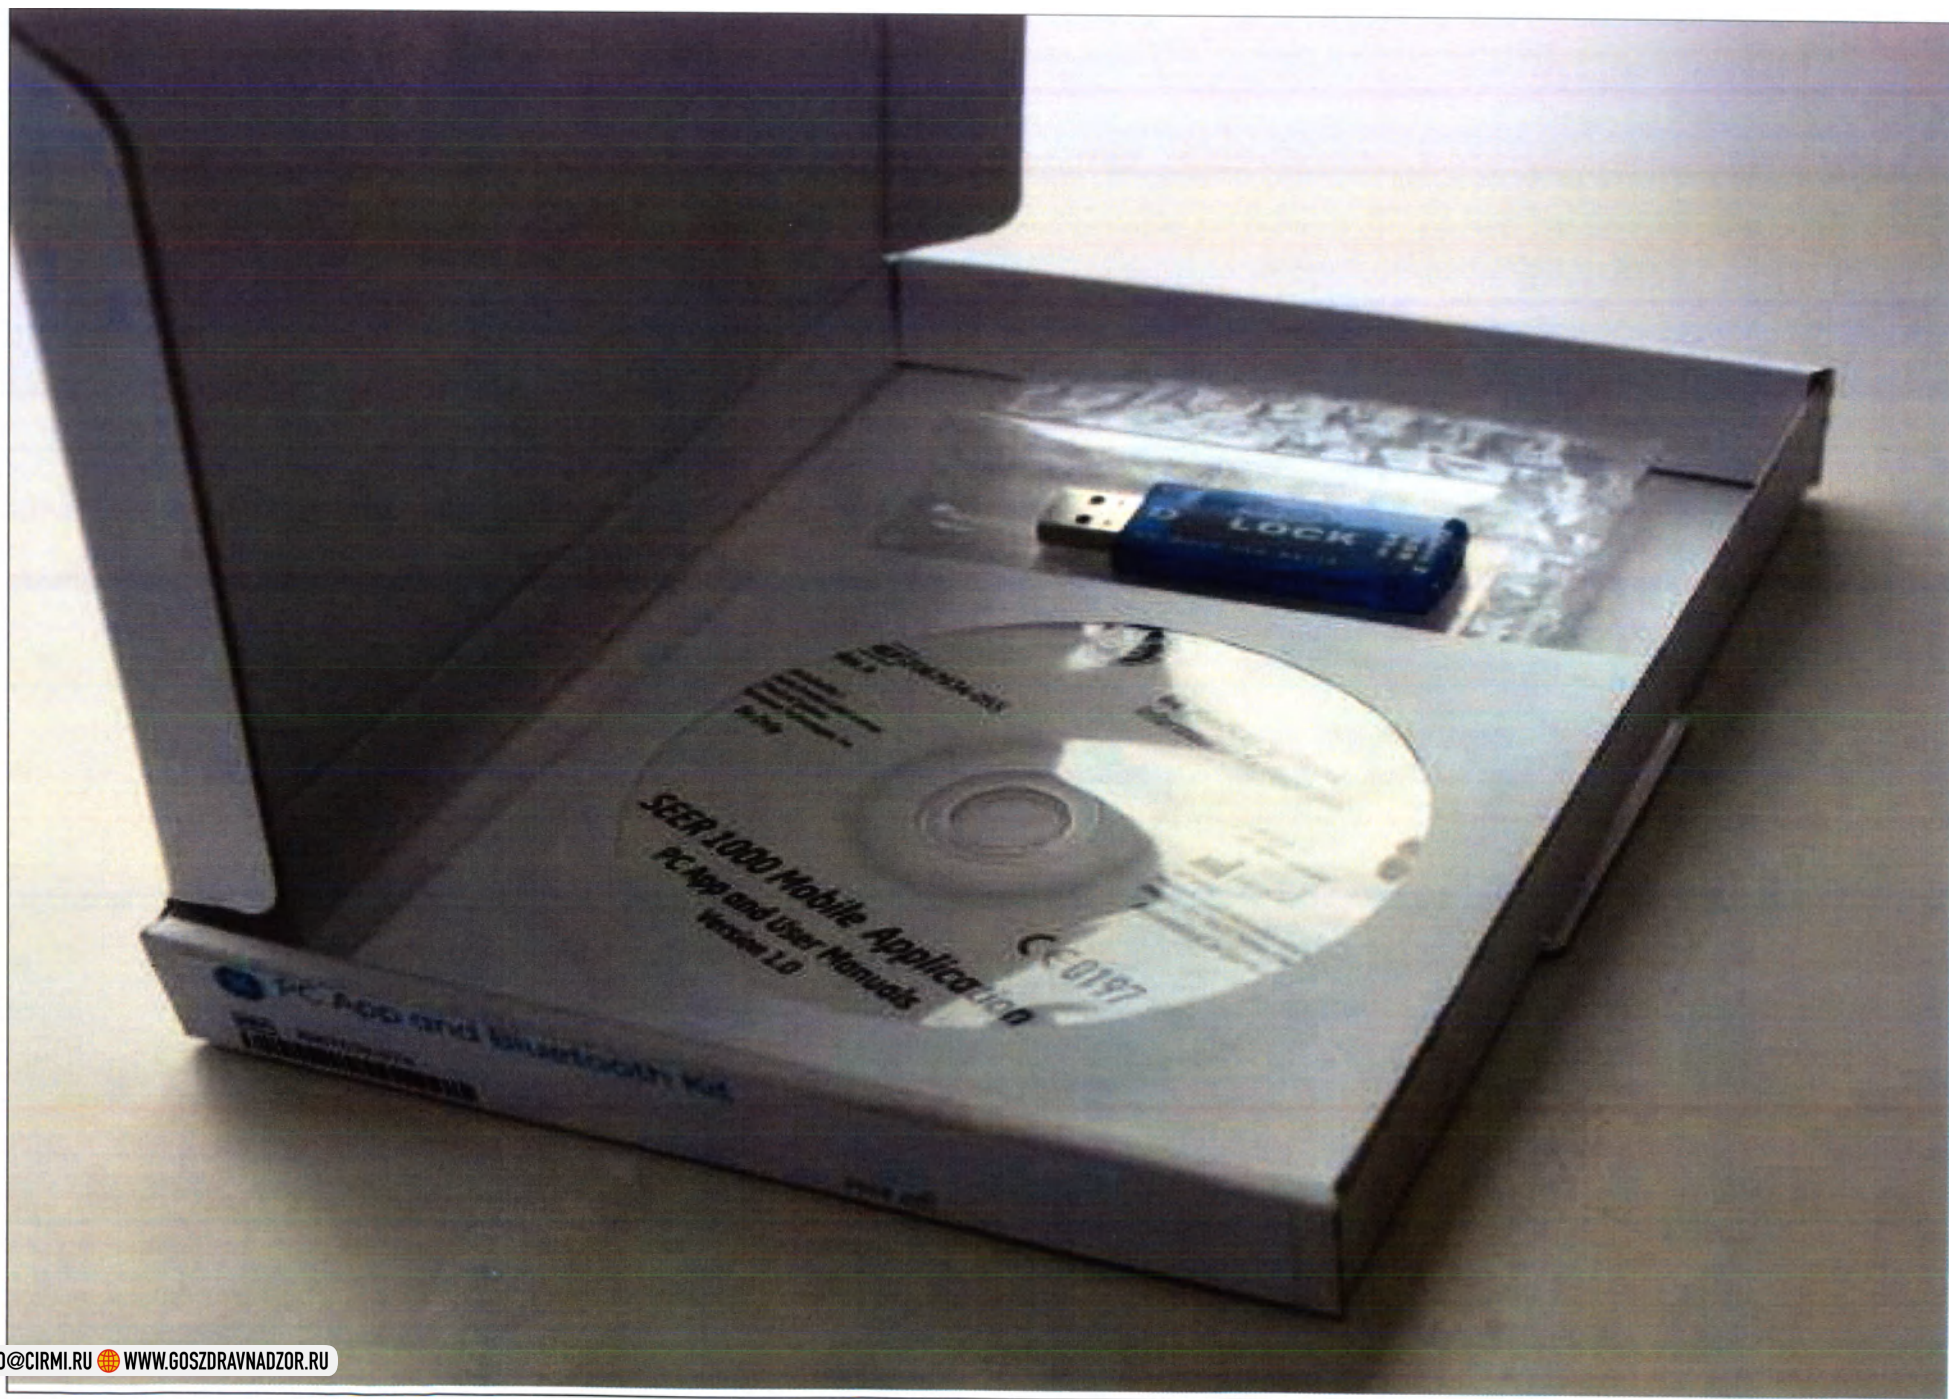

Принадлежности:

20. Крышка батарейного отсека SEER 1000 (не более 5 шт.).

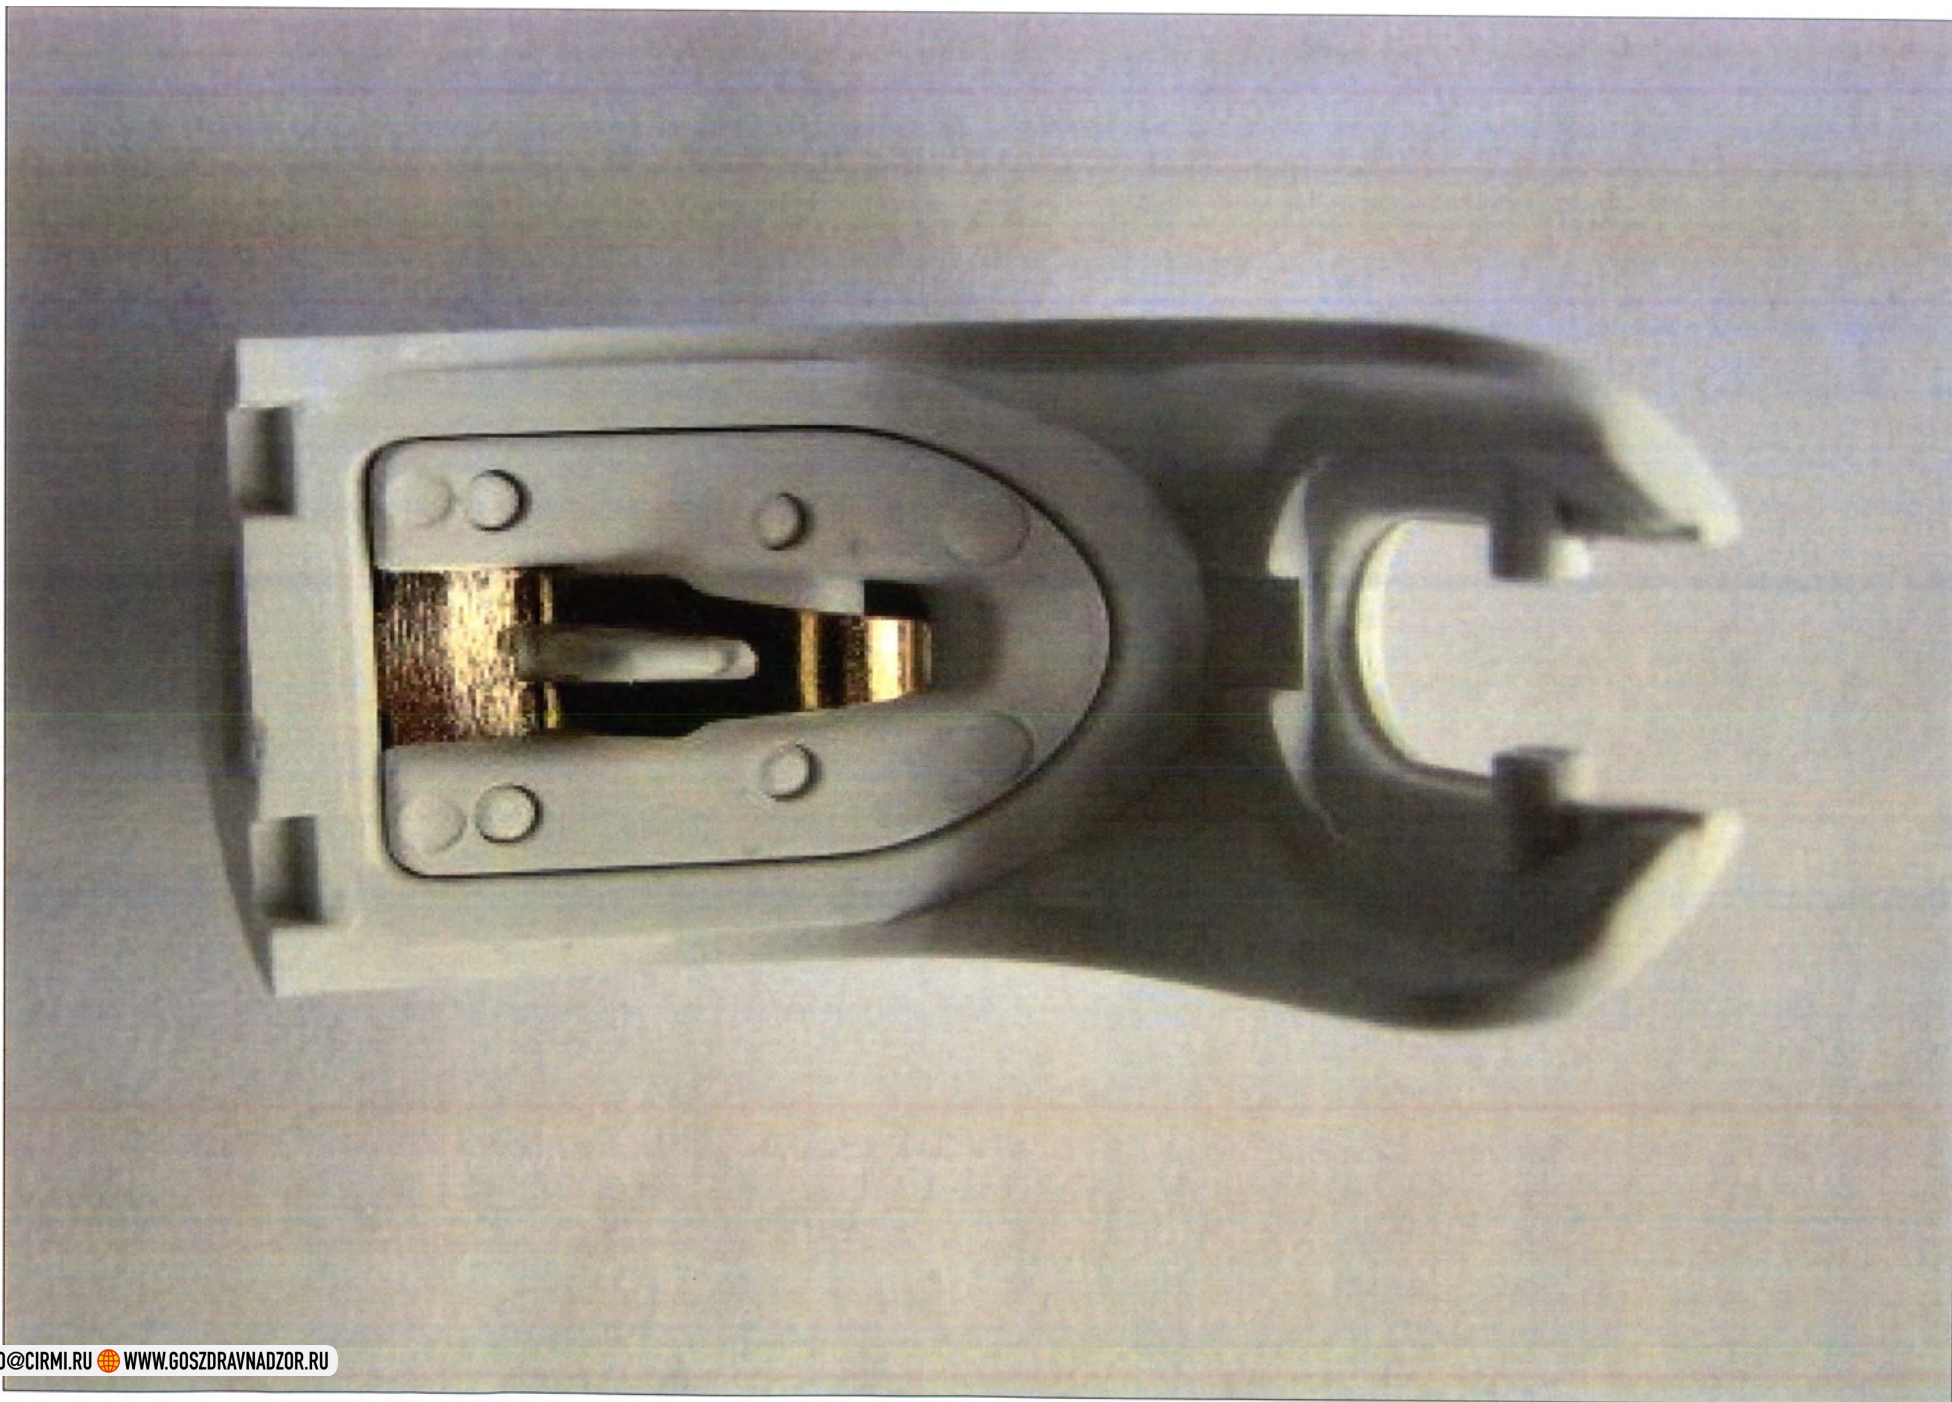


Принадлежности:

21. Клипса для ремня чехла SEER 1000. (не более 5 шт.).




Принадлежности:

22. Программное обеспечение для анализа ЭКГ на оптических или электронных носителях, или код активации на бумажном носителе (не более 5 шт).

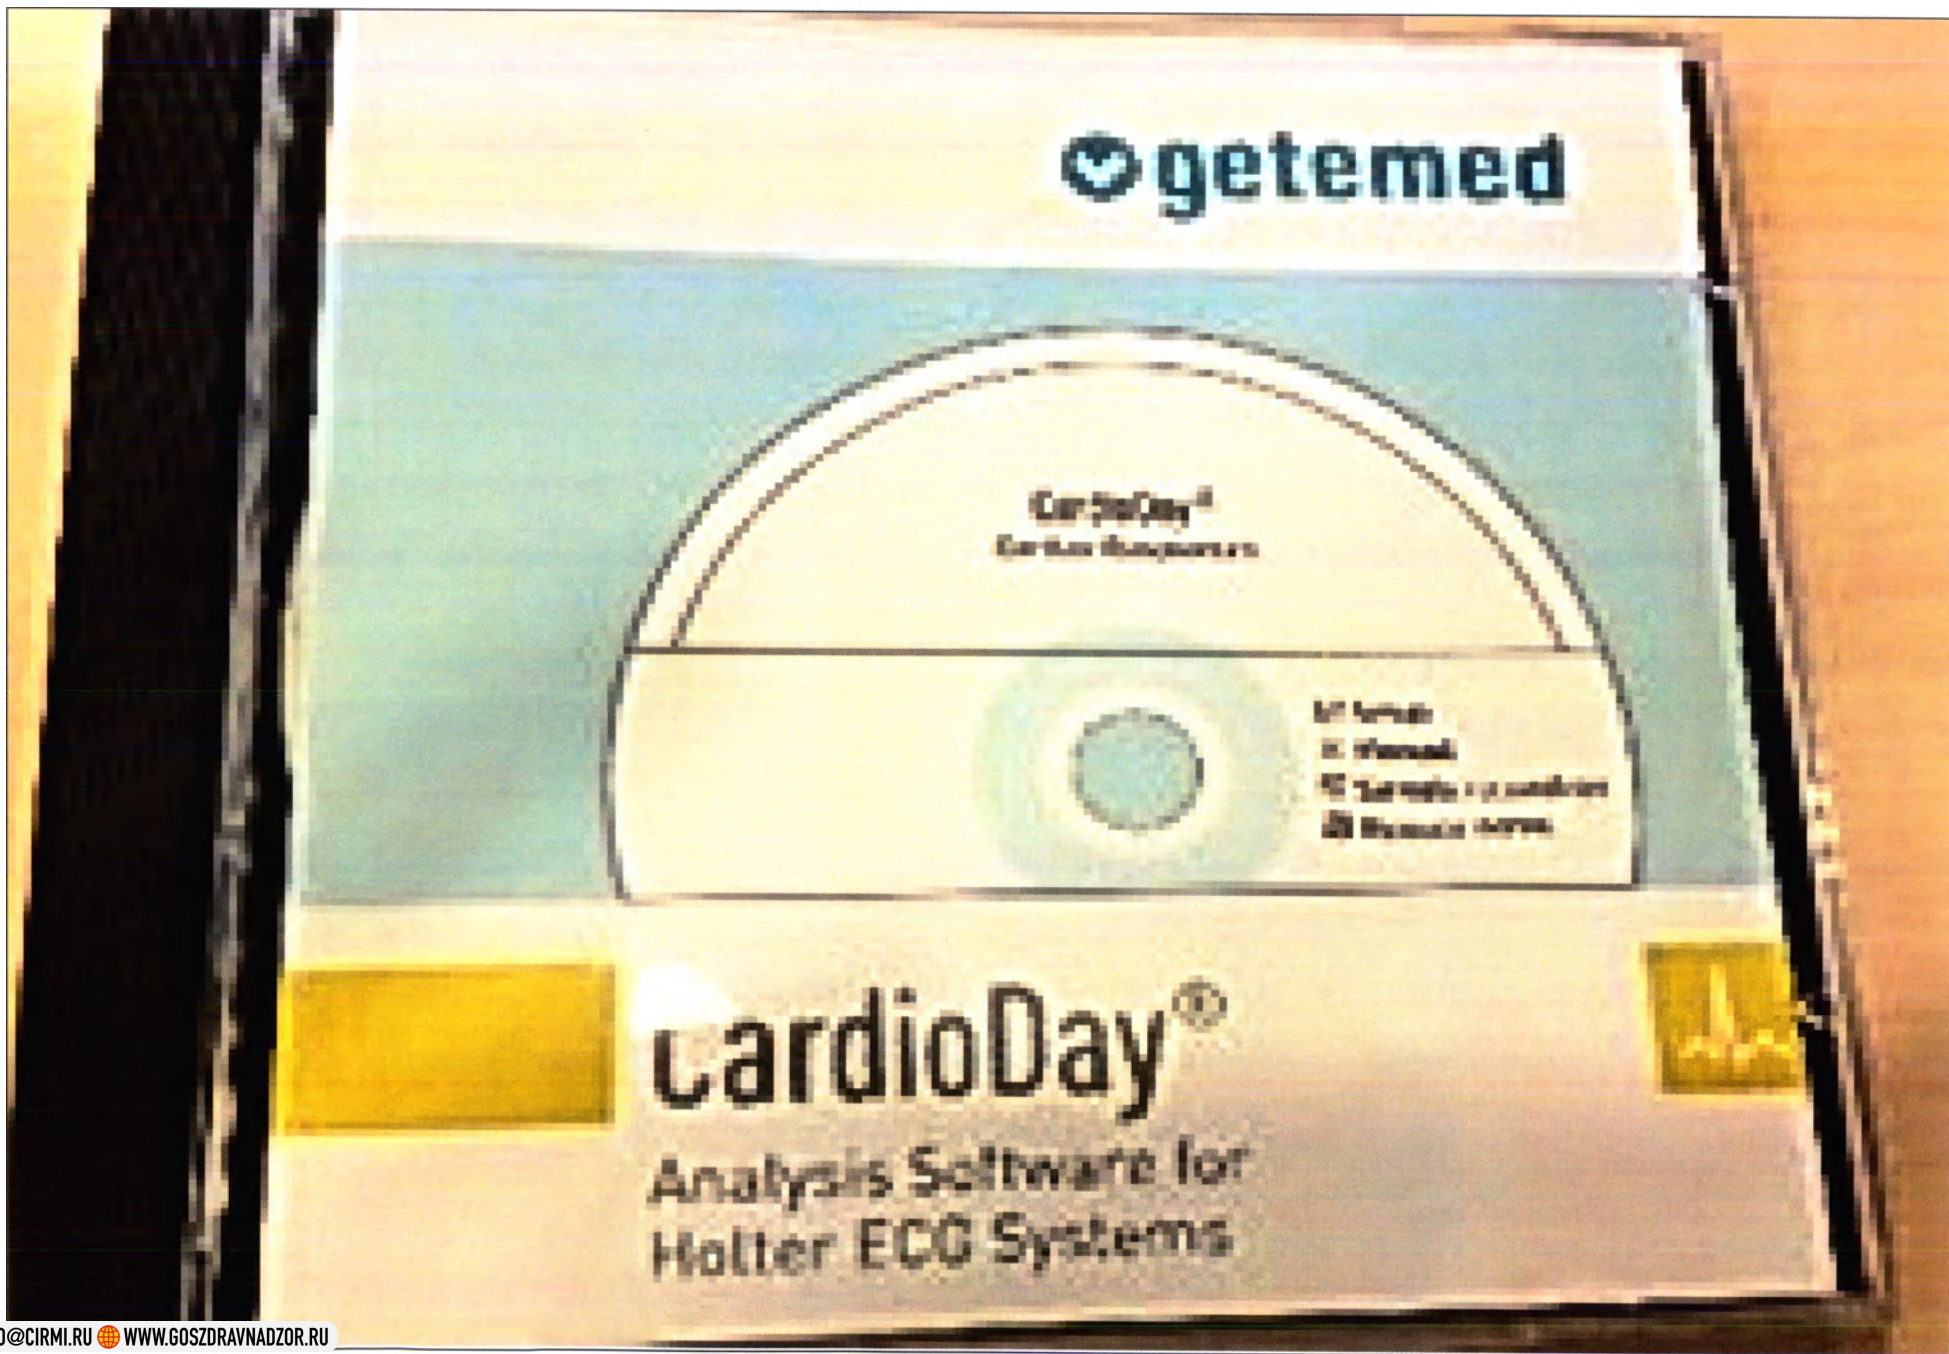


Принадлежности:

23. Опция программного обеспечения на оптических или электронных носителях, или код активации на бумажном носителе для установки обновлений (не более 5 шт).

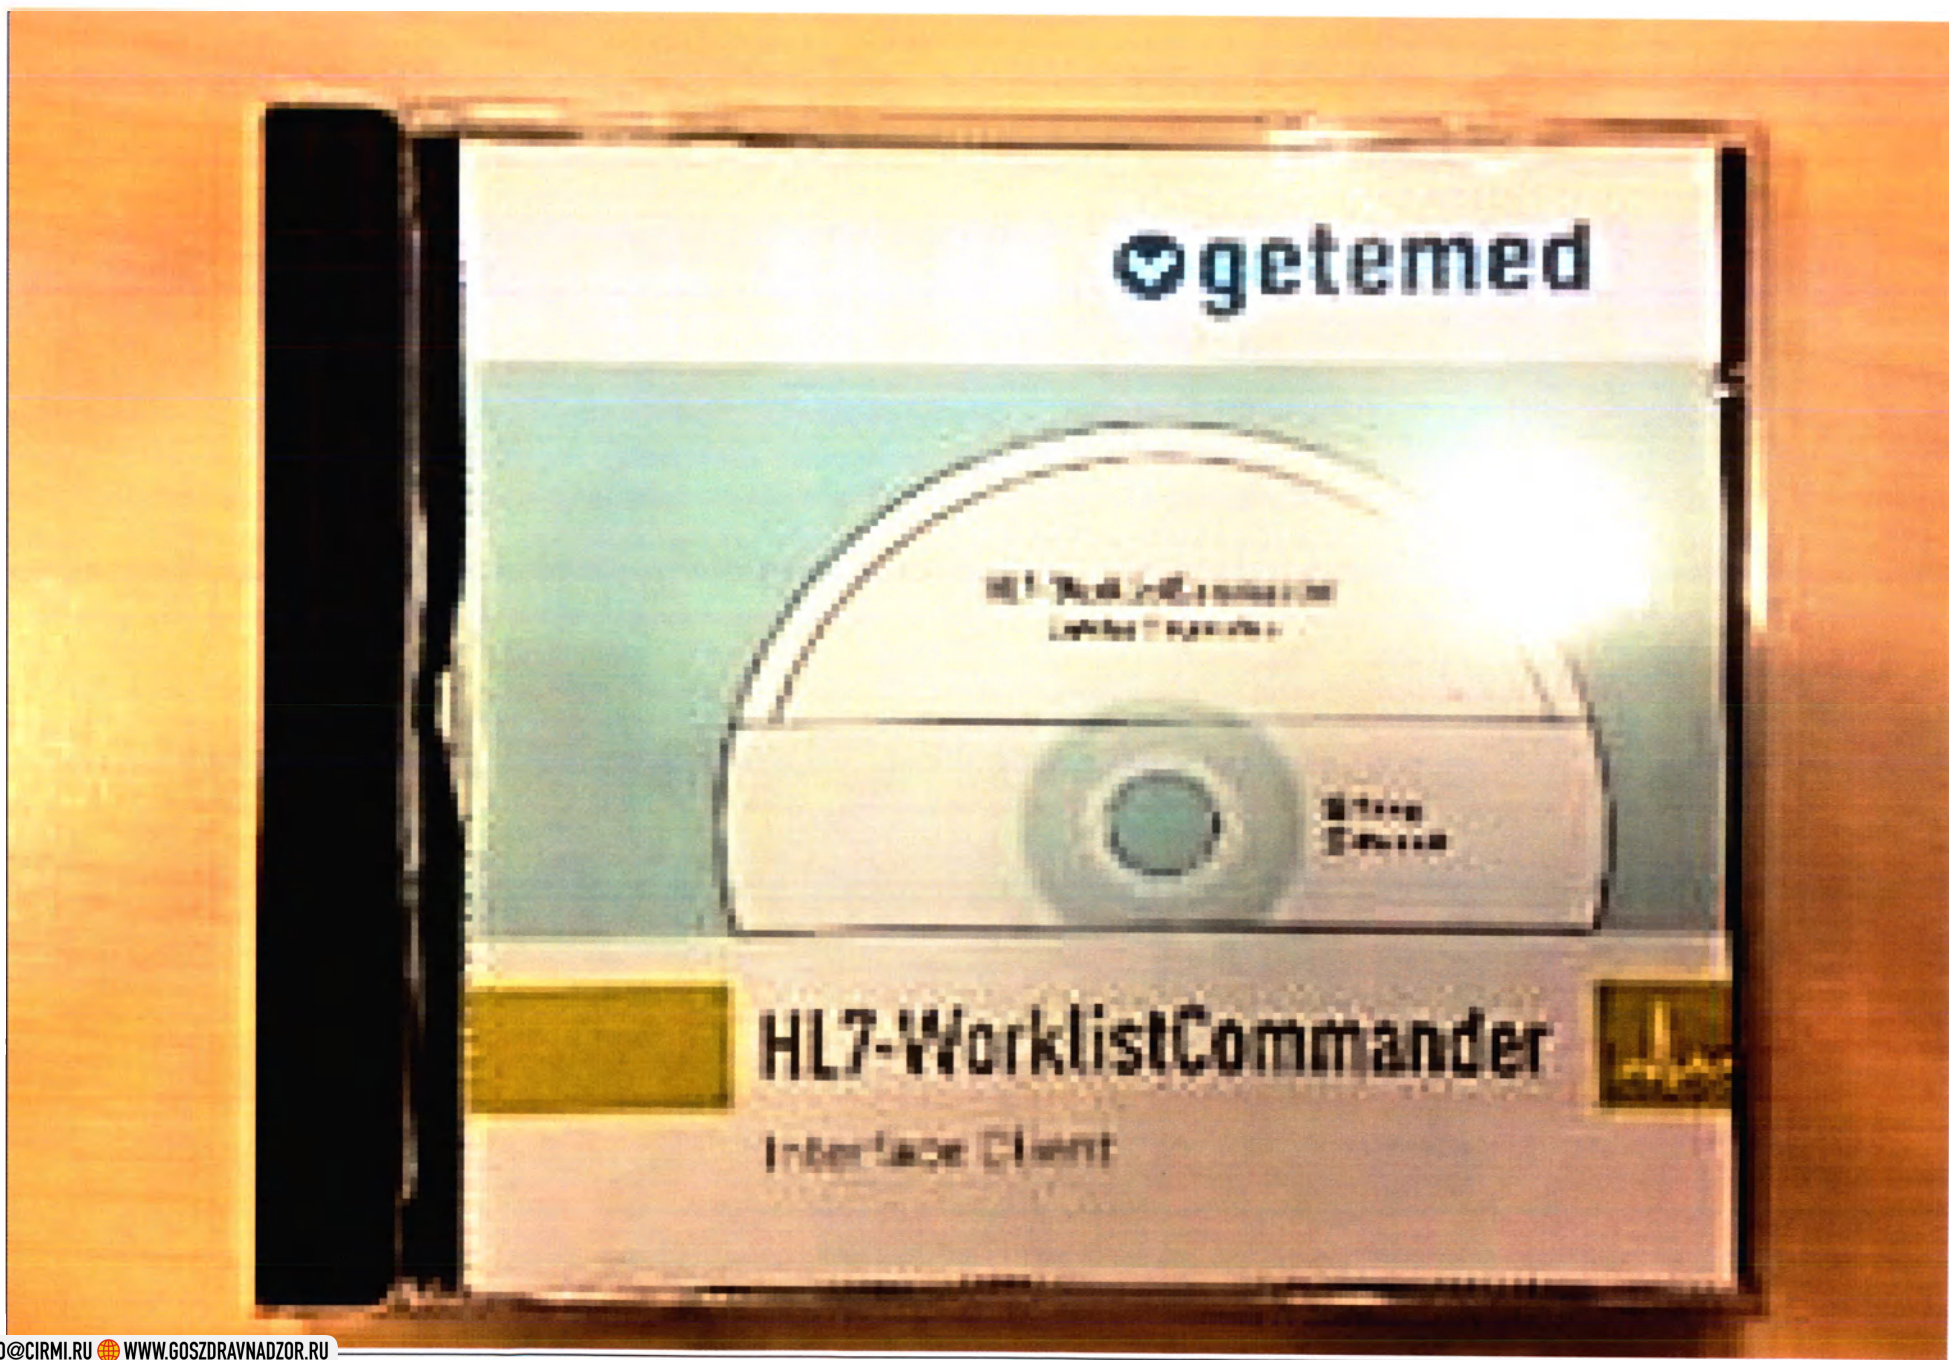

Принадлежности:

24. Приложение для ПК.

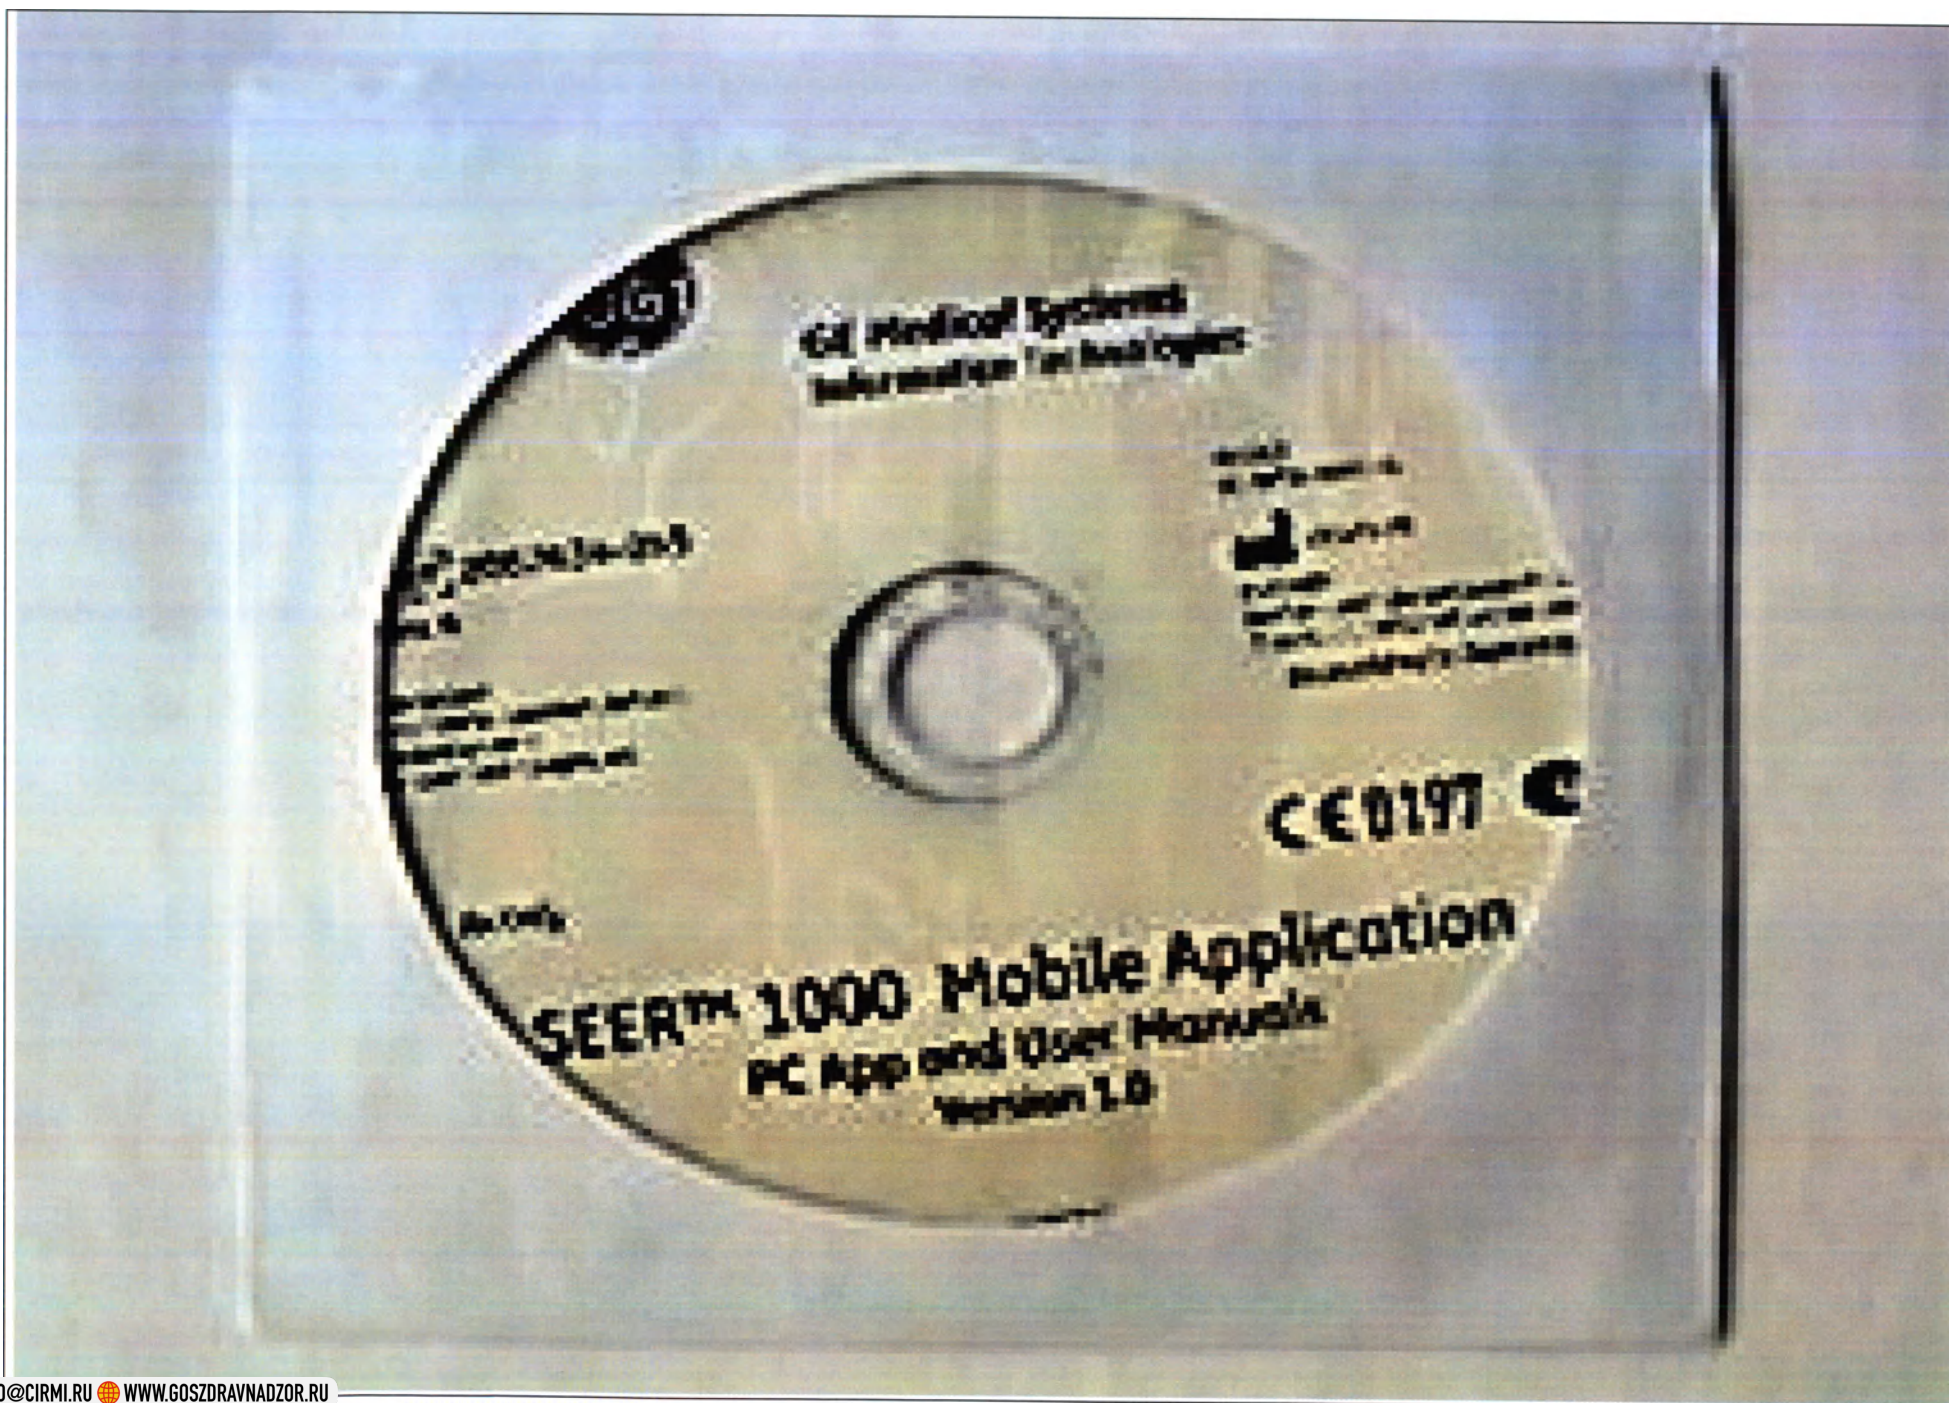

Принадлежности:

25. Модуль памяти (не более 10 шт.).



Принадлежности:

26. Элементы питания (не более 10 шт.).



Принадлежности:

26. Элементы питания (не более 10 шт.).



106 JANUARY 1990

1. Тестирование на предмет наличия в системе вредоносных программ.
2. Проверка целостности файлов.
3. Проверка даты и времени загрузки и установки.
4. Проверка целостности файлов.

Download the app on the App Store or Google Play. www.cer.com



Information Technology Analyst
The University of New South Wales



ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ



1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.



Исследования не проводились

Элемент		Описание
1	Кнопка «События»	- Нажмите и удерживайте нажатой, пока не раздастся сигнал для включения/выключения регистратора - Удерживайте нажатой в течение примерно одной секунды, чтобы запустить запись или отметить событие. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. - Нажмите и удерживайте нажатой во время записи, пока не раздастся звуковой сигнал для активации Bluetooth
2	Светодиод кнопки «События»	- Горит зеленым цветом: готов к запуску записи - Мигает зеленым цветом: выполняется запись - Горит желтым цветом: предвещает запись, сокращена - Мигает желтым цветом: низкое напряжение батареи
3	Разъем для USB-кабеля и кабеля ЭКГ	- Следите за тем, чтобы отмеченные кружком на изображении метки располагались друг напротив друга - Для выполнения записи подключите кабель ЭКГ - Для загрузки данных и записи подключите USB-кабель
4	Светодиод электродов	- Горит зеленым цветом: электроды подключены правильно - Горит желтым: электроды подключены неправильно
5	Крышка батарейного отсека	Разместите батарею пополам, чтобы полностью поместить в регистратор.
6	Фиксатор батарейного отсека	Чтобы открыть отсек, сдвиньте фиксатор батарейного отсека.

Указание: если регистратор имеет дефект, необходимо позвонить сервисной службе, светодиоды кнопки "Событие" и светодиод электрода по очереди мигают желтым и зеленым цветом. Информацию о сервисном обслуживании см. в инструкциях по эксплуатации.


ВНИМАНИЕ: если USB-кабель или кабель Энг вставлен неправильно, это может стать причиной повреждения, в инструкции по эксплуатации.



Знаете ли вы, что крупнейшие производители автомобилей и компьютеров в США, Канаде и Великобритании уже используют технологию **Intel® vPro™** для обеспечения безопасности своих систем? Intel® vPro™ – это решение для защиты информации, которое позволяет защитить данные, хранящиеся в памяти, от кражи и повреждения. Intel® vPro™ – это решение для защиты информации, которое позволяет защитить данные, хранящиеся в памяти, от кражи и повреждения. Intel® vPro™ – это решение для защиты информации, которое позволяет защитить данные, хранящиеся в памяти, от кражи и повреждения.

28. Справочник аксессуаров и принадлежностей SEER 1000.

28. Справочник аксессуаров и принадлежностей SEER 1000.

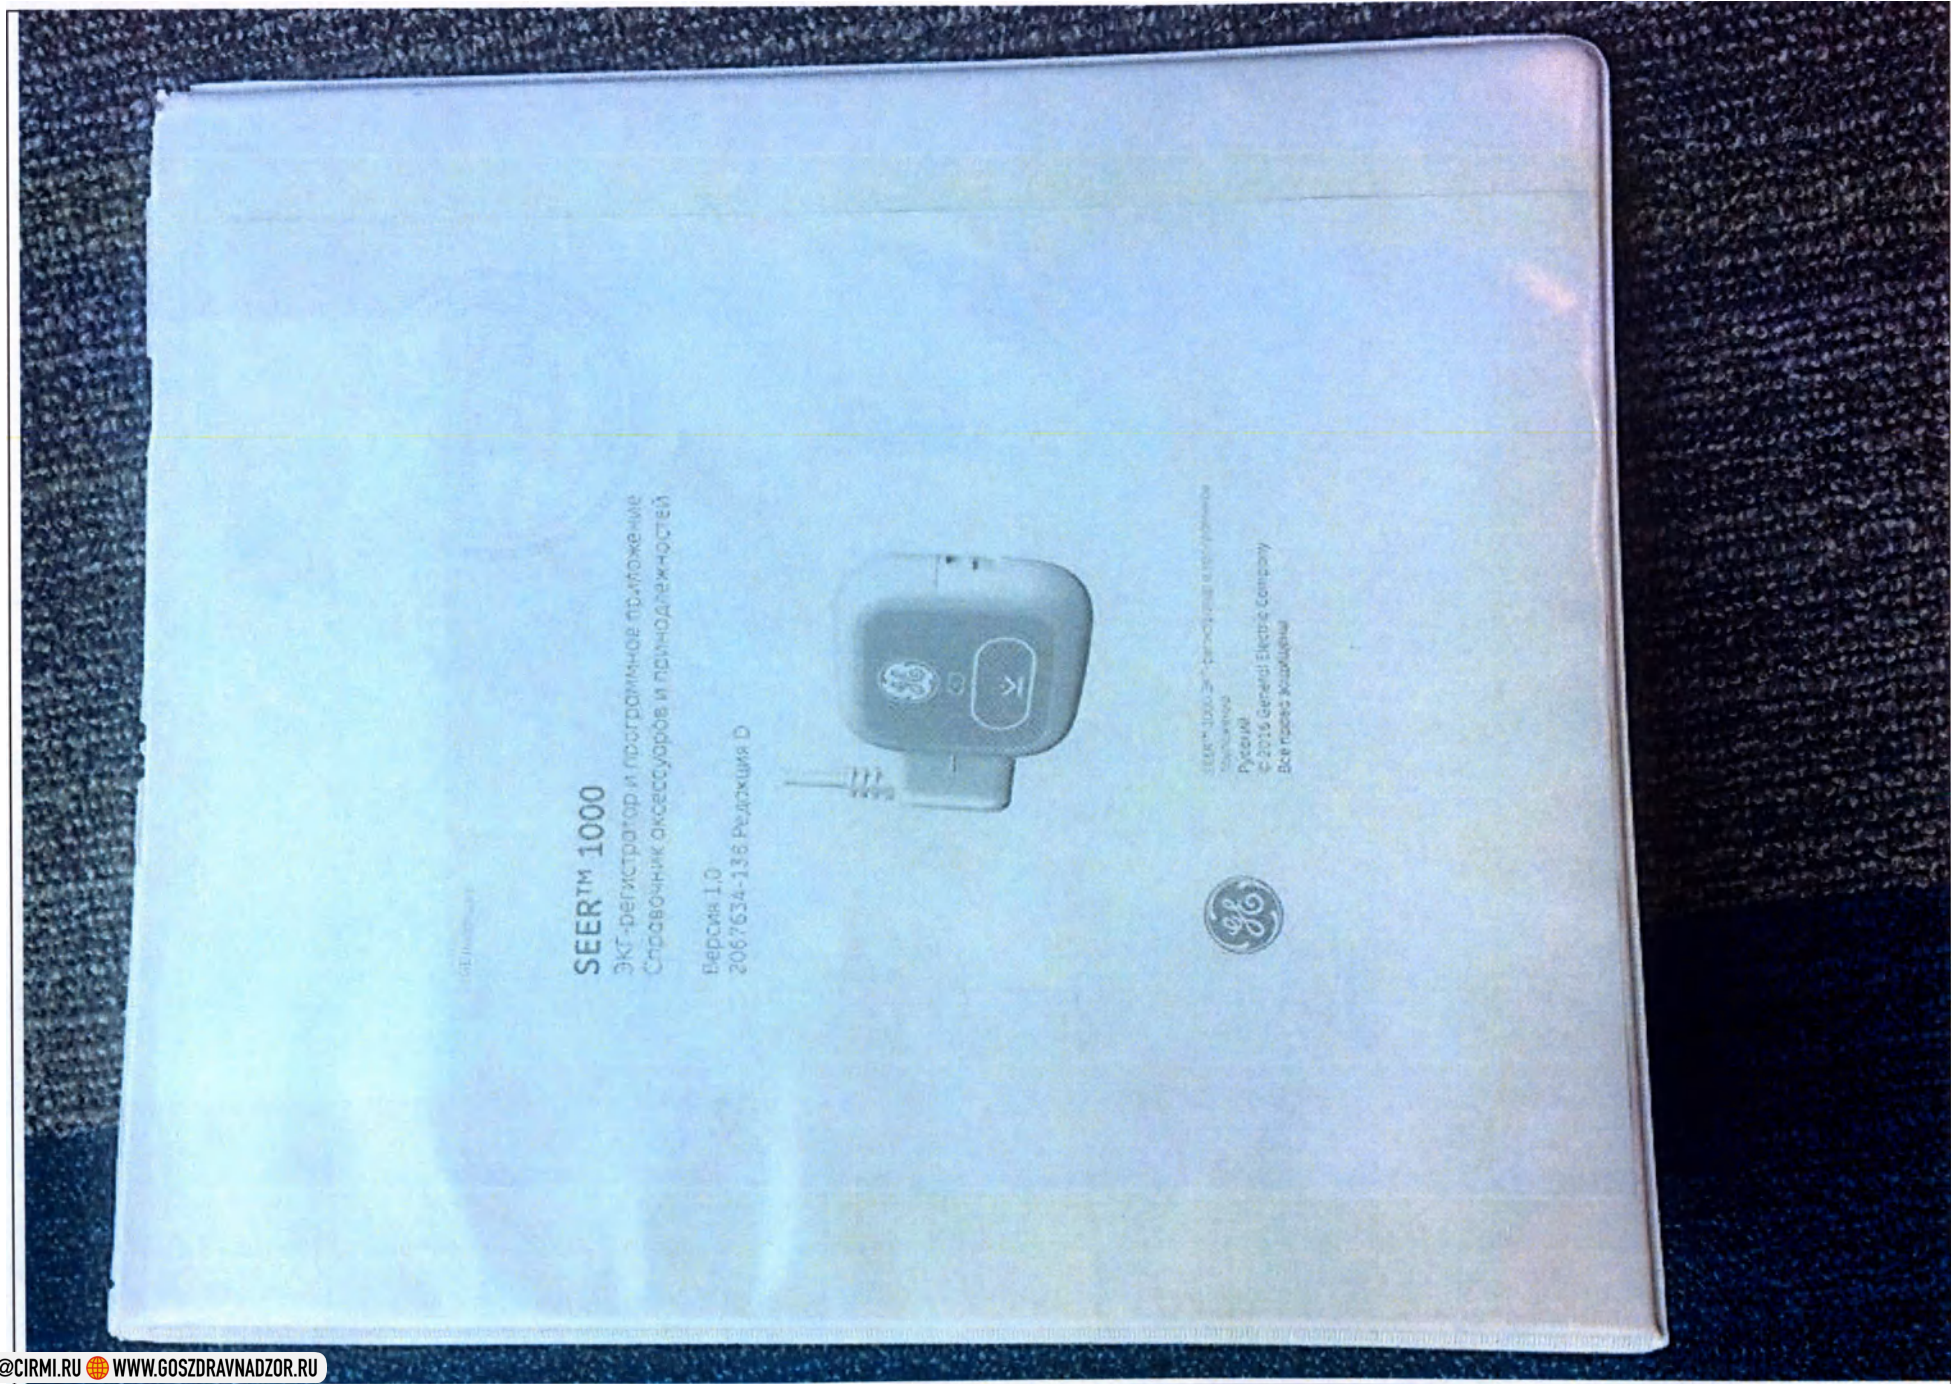

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 40 листа (ов)

Менеджер по контролю качества и мониторингу
безопасности медицинского оборудования
Россия и СНГ

И.А. Суханова Суханова И.А.

