

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЛОМАКО»


А.А. Алиев

« 01 » декабря 2015 г.



Фотографии изделия медицинского назначения

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»

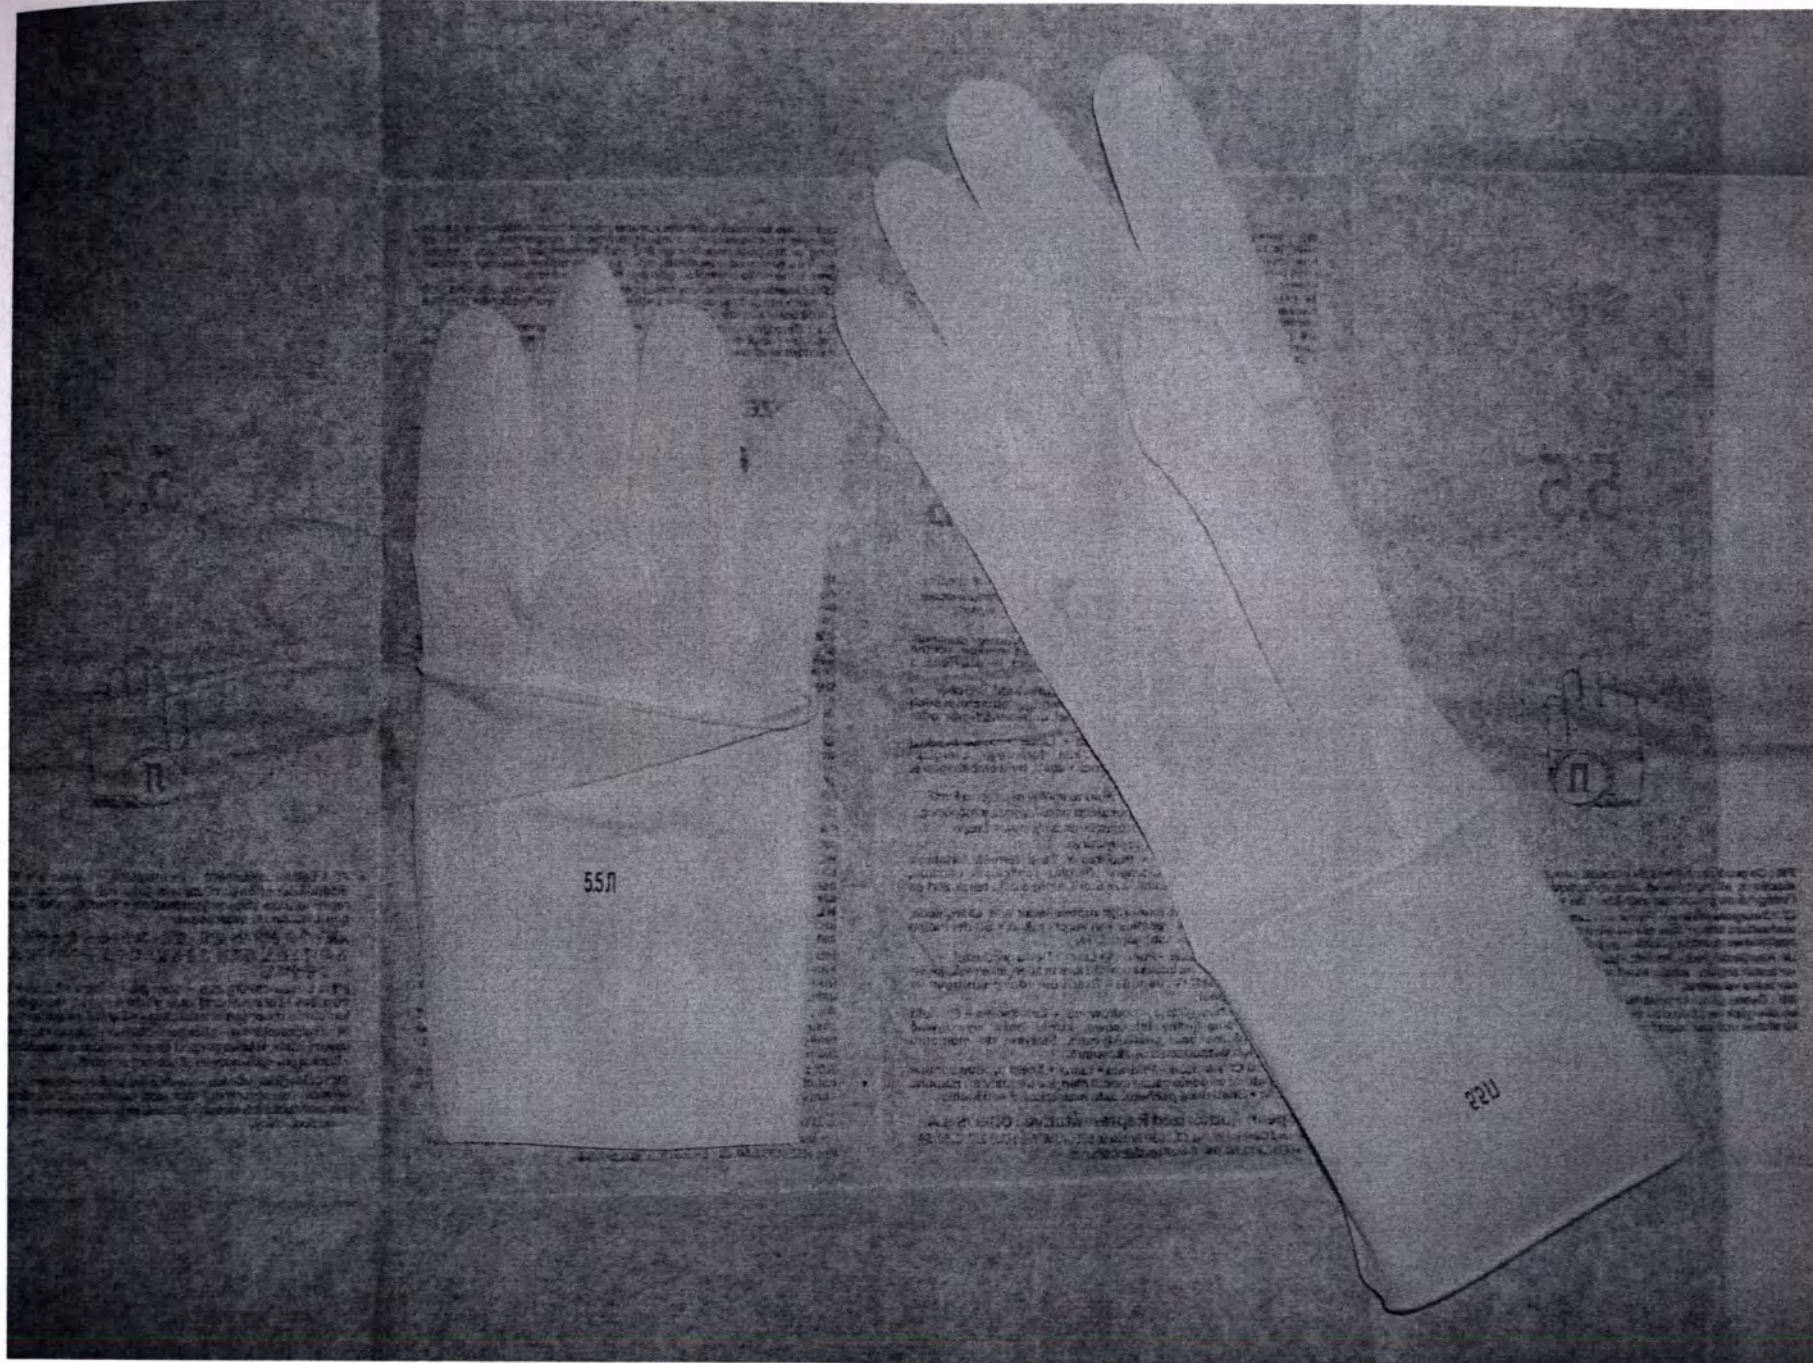

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0855

LOT 085515-010 2015-10 2018-10 085515010042 5.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные, с валяком, анатомические Intouch Lite
 INTW0855 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



ОДНОРАЗОВЫЕ



1 ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
 потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
 Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

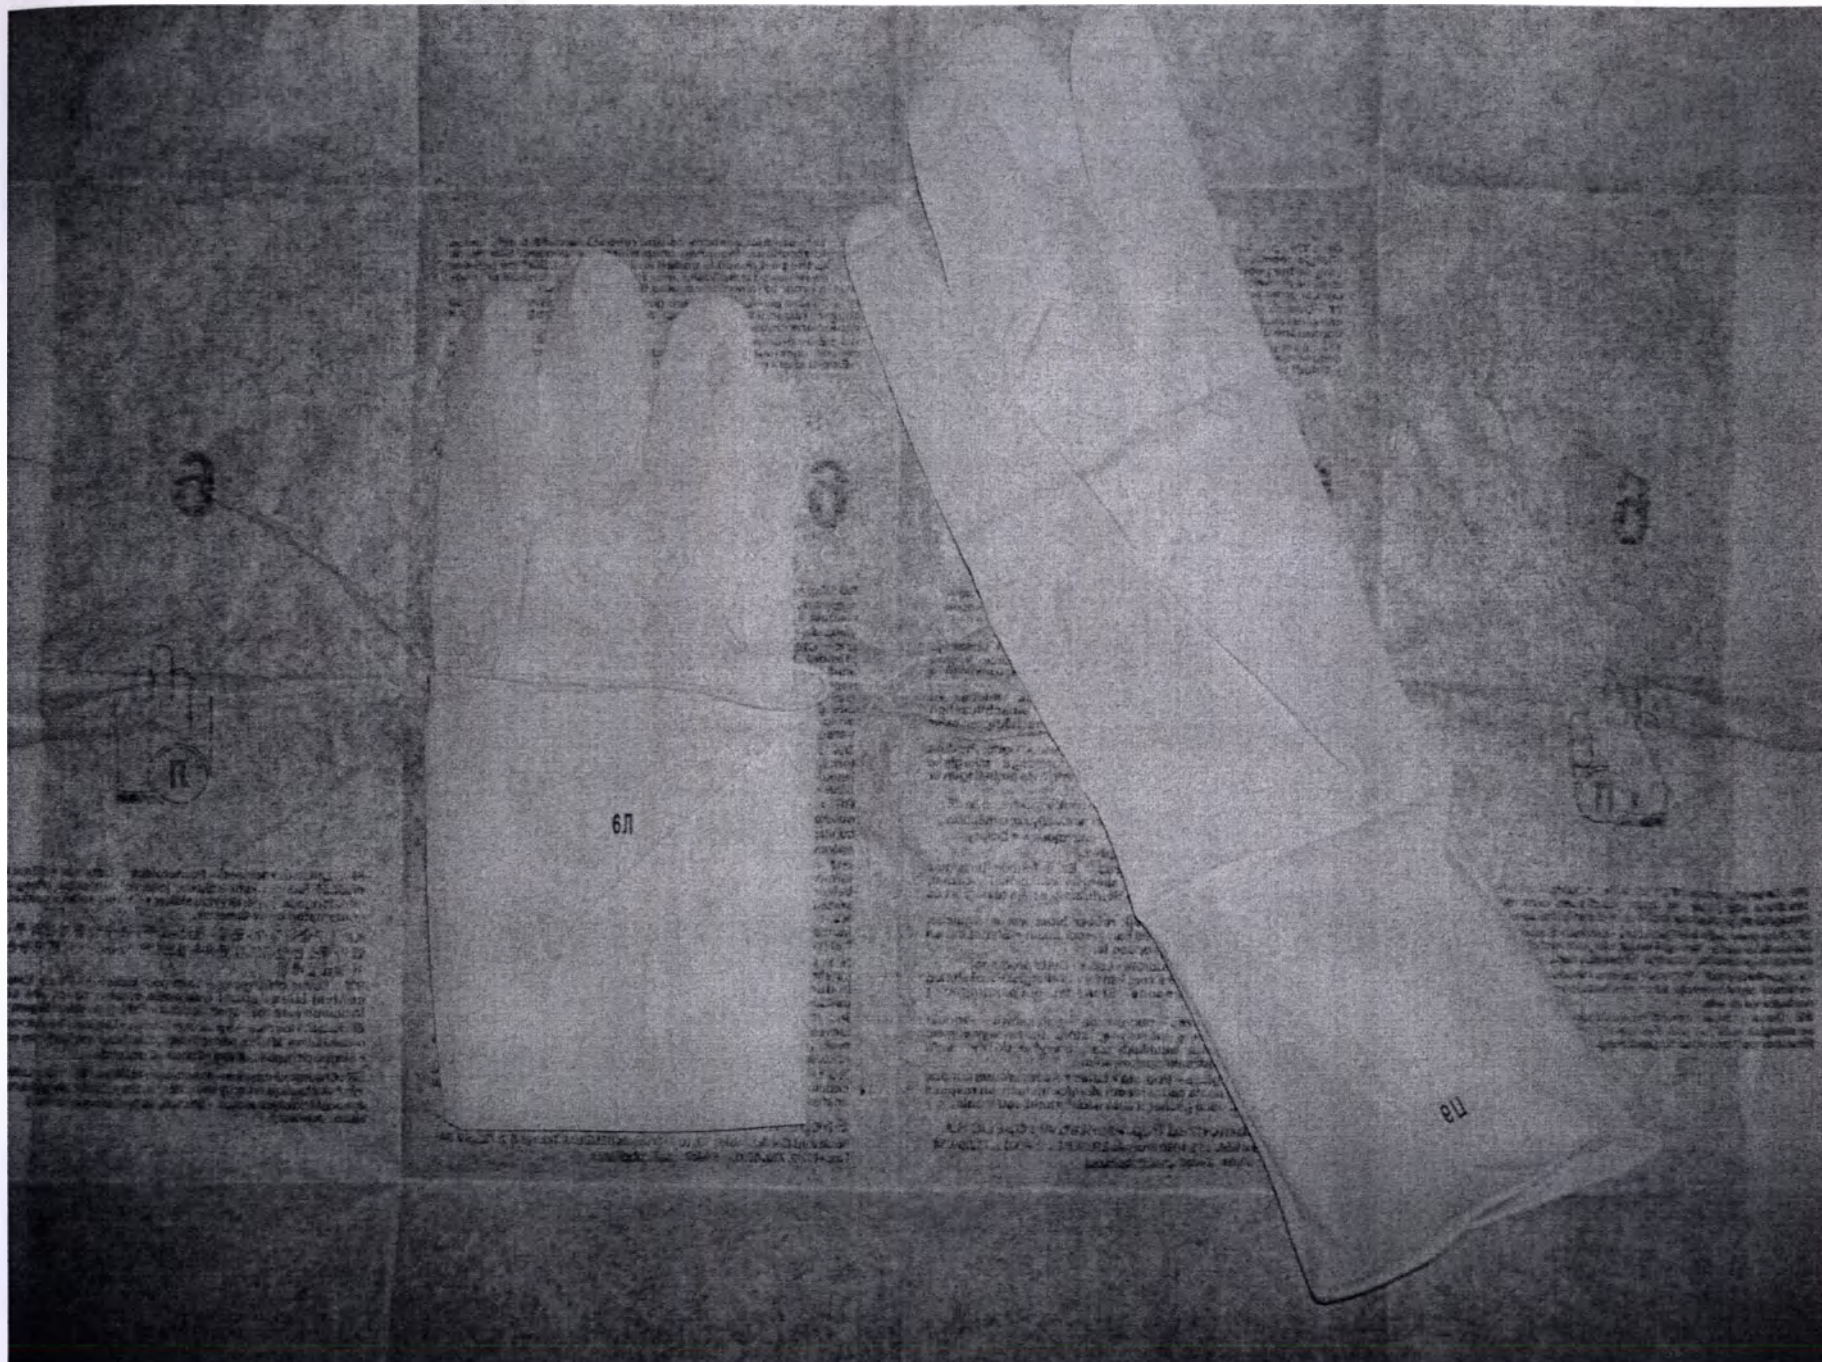

LOT SN SIZE

086015-010 2015-10 2018-10 086015010051 6

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные, с загибом, анатомические Intouch Lite
INTW0860 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



ОДНОРАЗОВЫЕ



1 ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

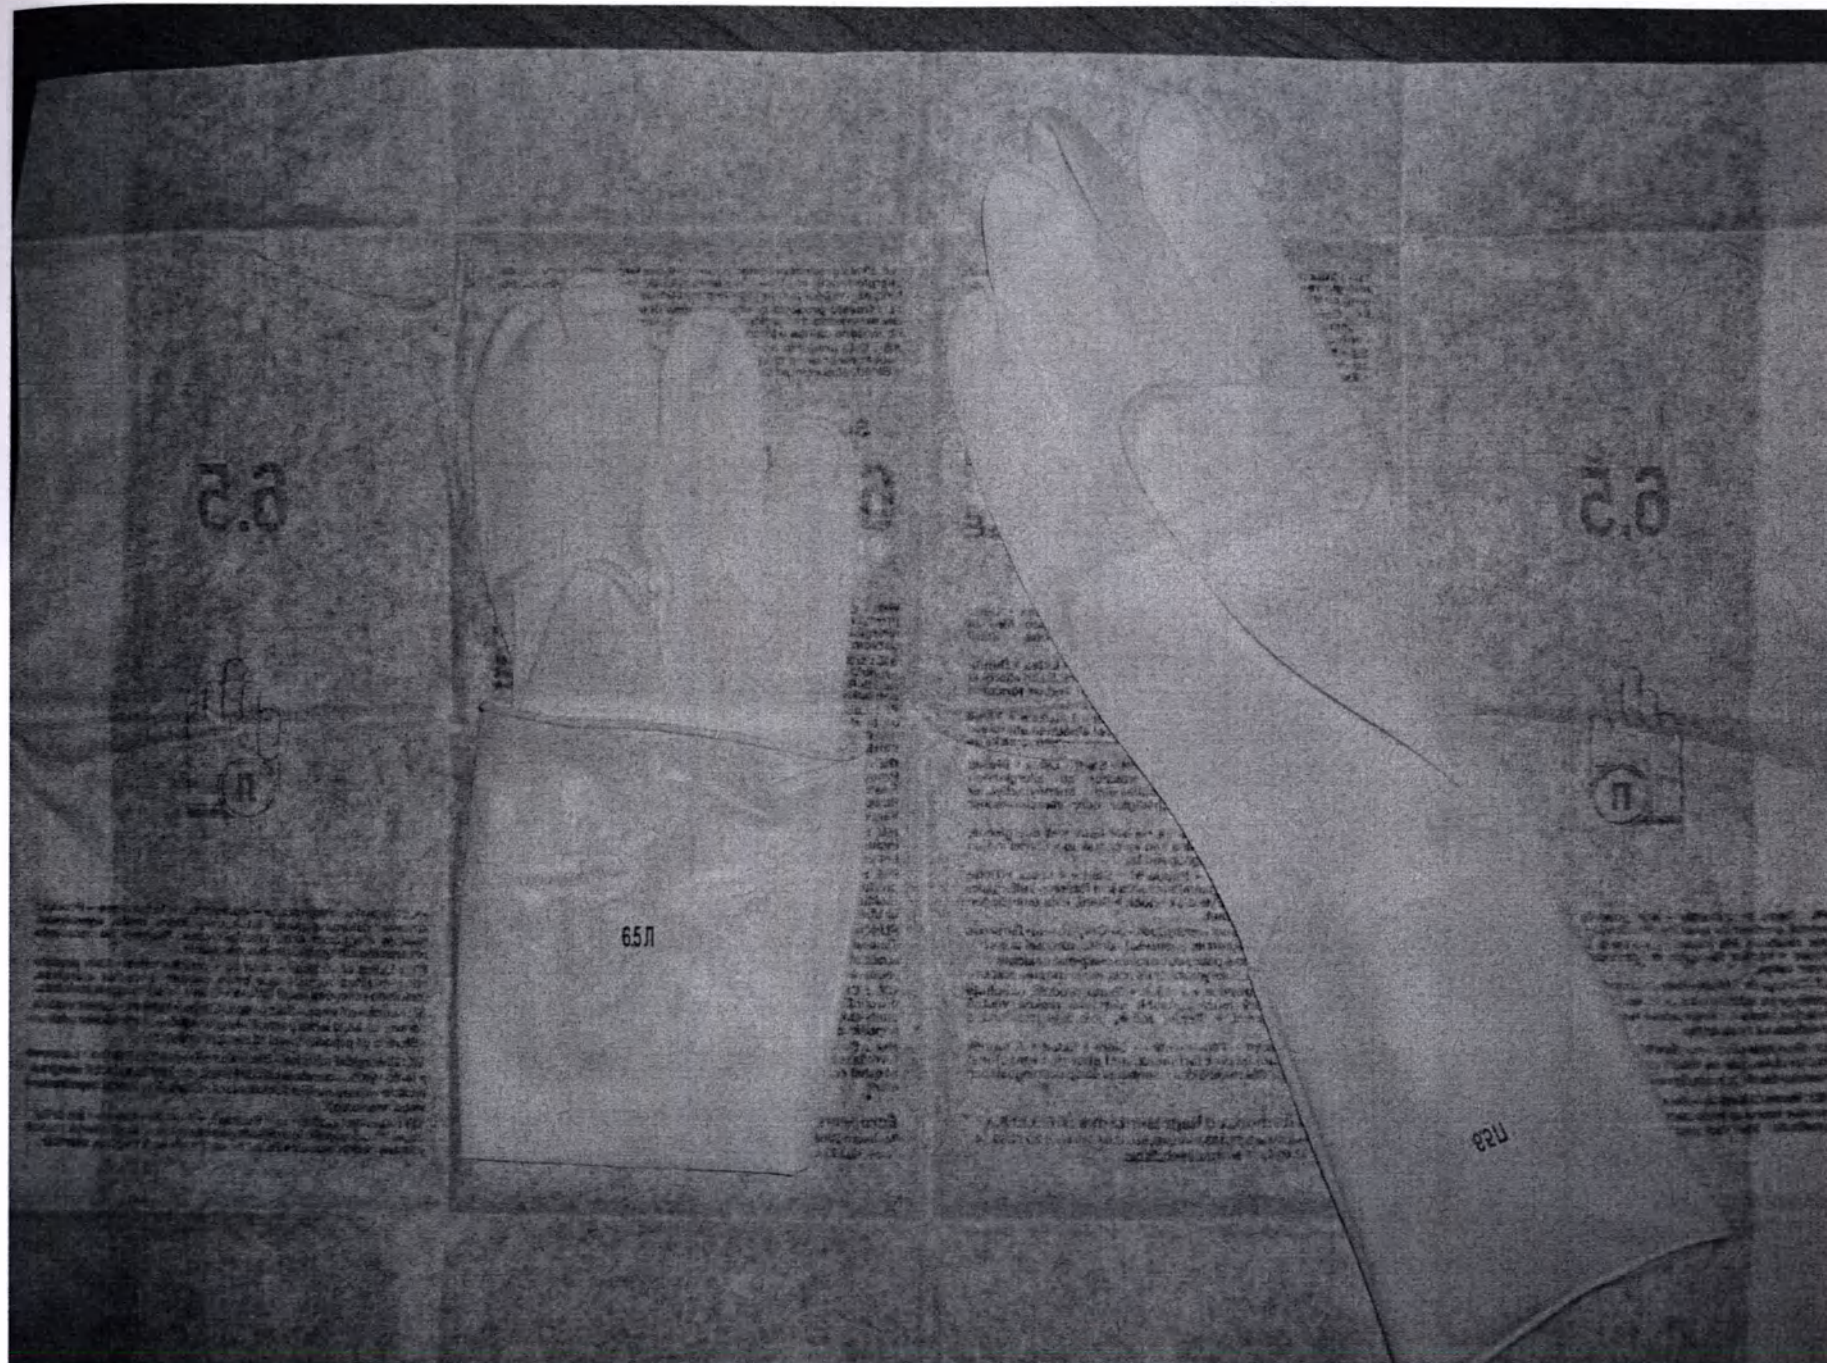

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0865

LOT 086515-010 2015-10 2018-10 086515010061 \$N SIZE 6.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные, С-лином, анатомические Intouch Lite
 INTW0865 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



“ОДНОРАЗОВЫЕ”



100 ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО. Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/4, Jalan Meru, 41050
 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
 потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
 Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

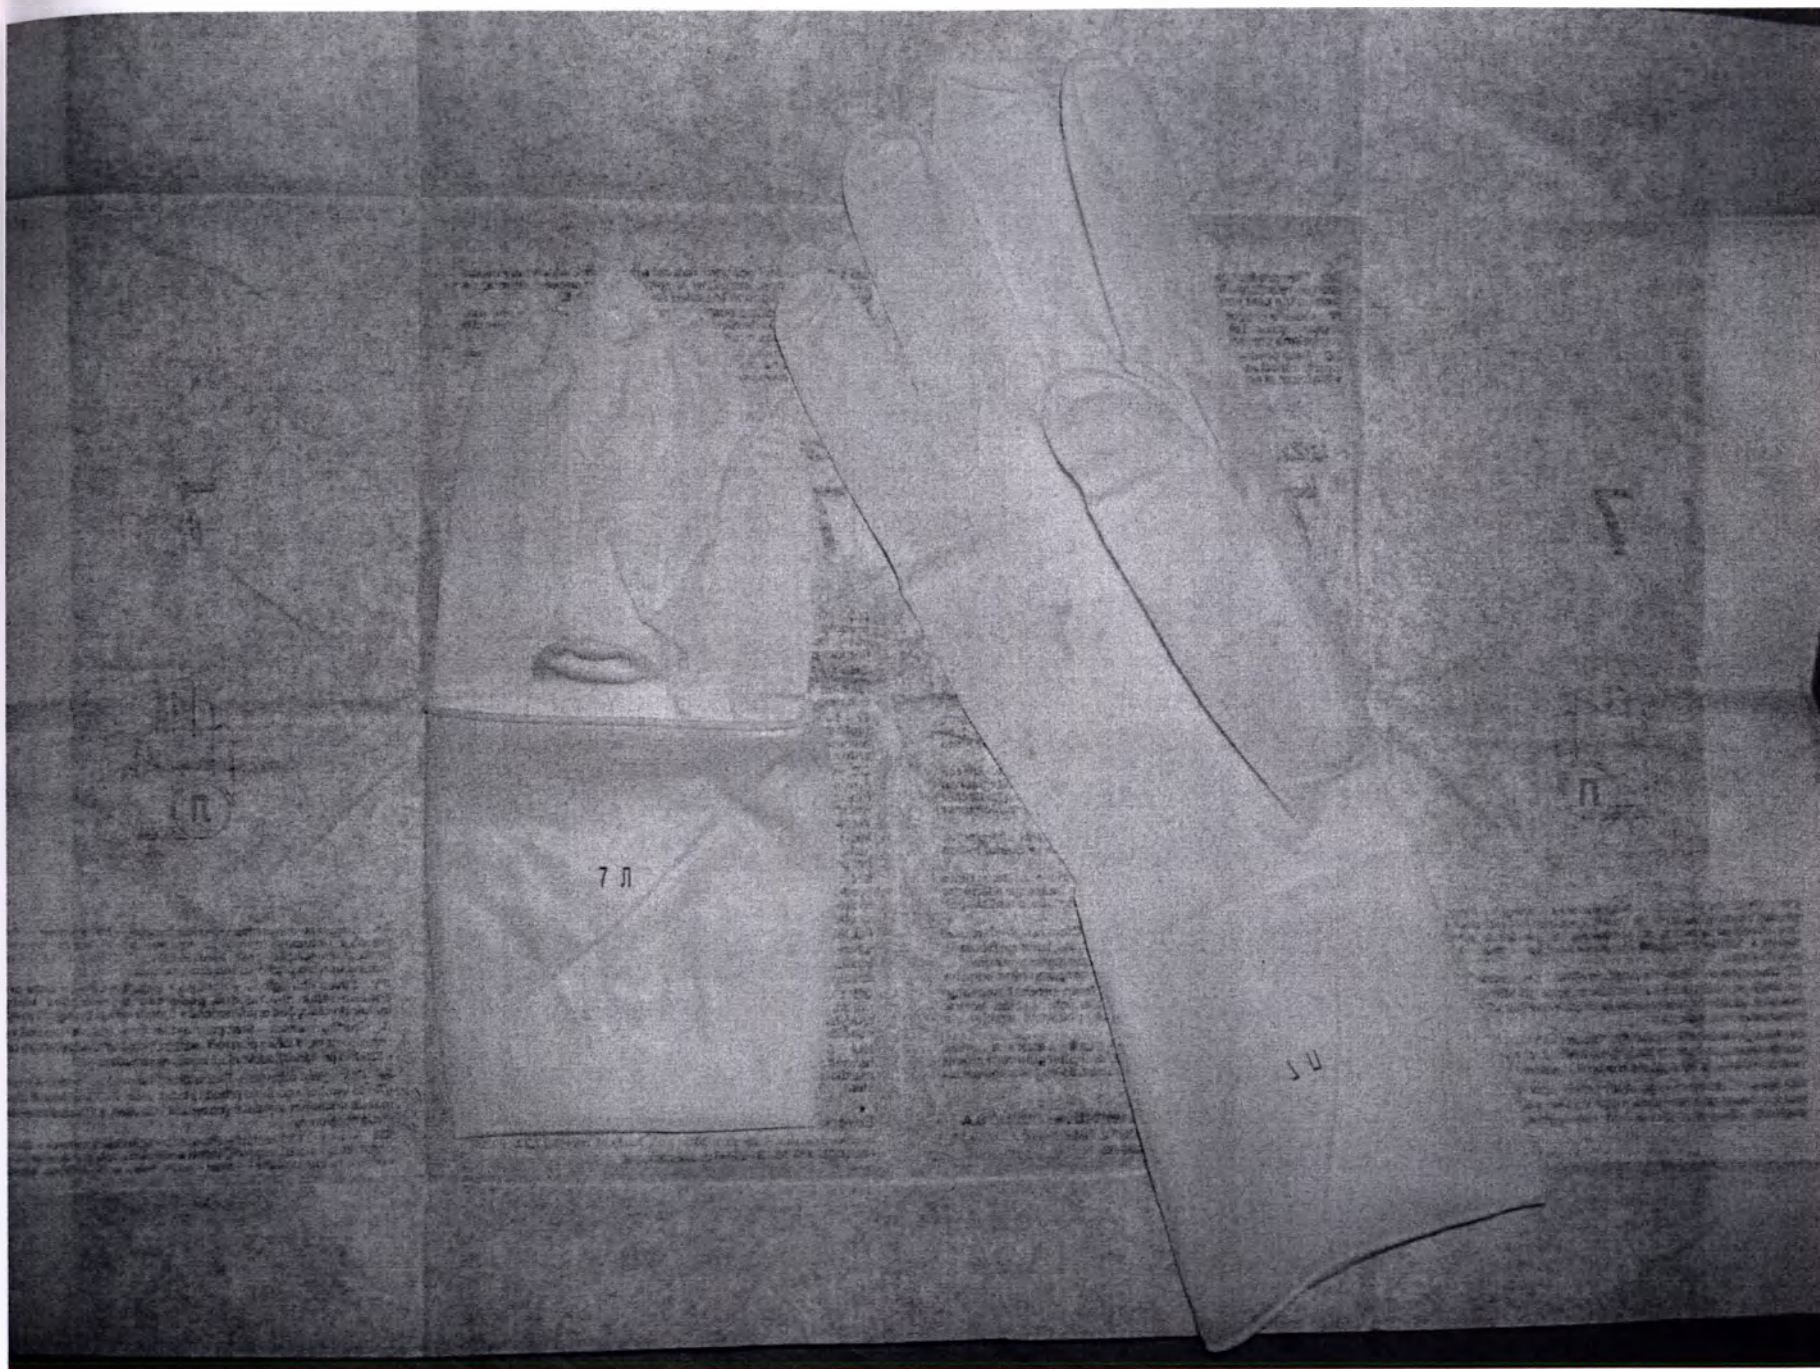

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0870

LOT 087015-010 2015-10 2018-10 087015010068

SIZE 7

SN

7

INTW0870

iNtTouch

Перчатки хирургические стерильные, латексные, одноразовые «iNtTouch»
текстурированные, с пальцами, анатомическое iNtTouch Life
INTW0870
ГОСТ Р 52235-2004

STERILE R

CE 0086

2

ОДНОРАЗОВЫЕ

LATEX

1 ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может
вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5088 & 5089, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная авторитетным изданием и удостоверяющим требованием
потребителя и от имени, товар не имеет качества, ООО «ПЛОМАКО», 196128
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0870

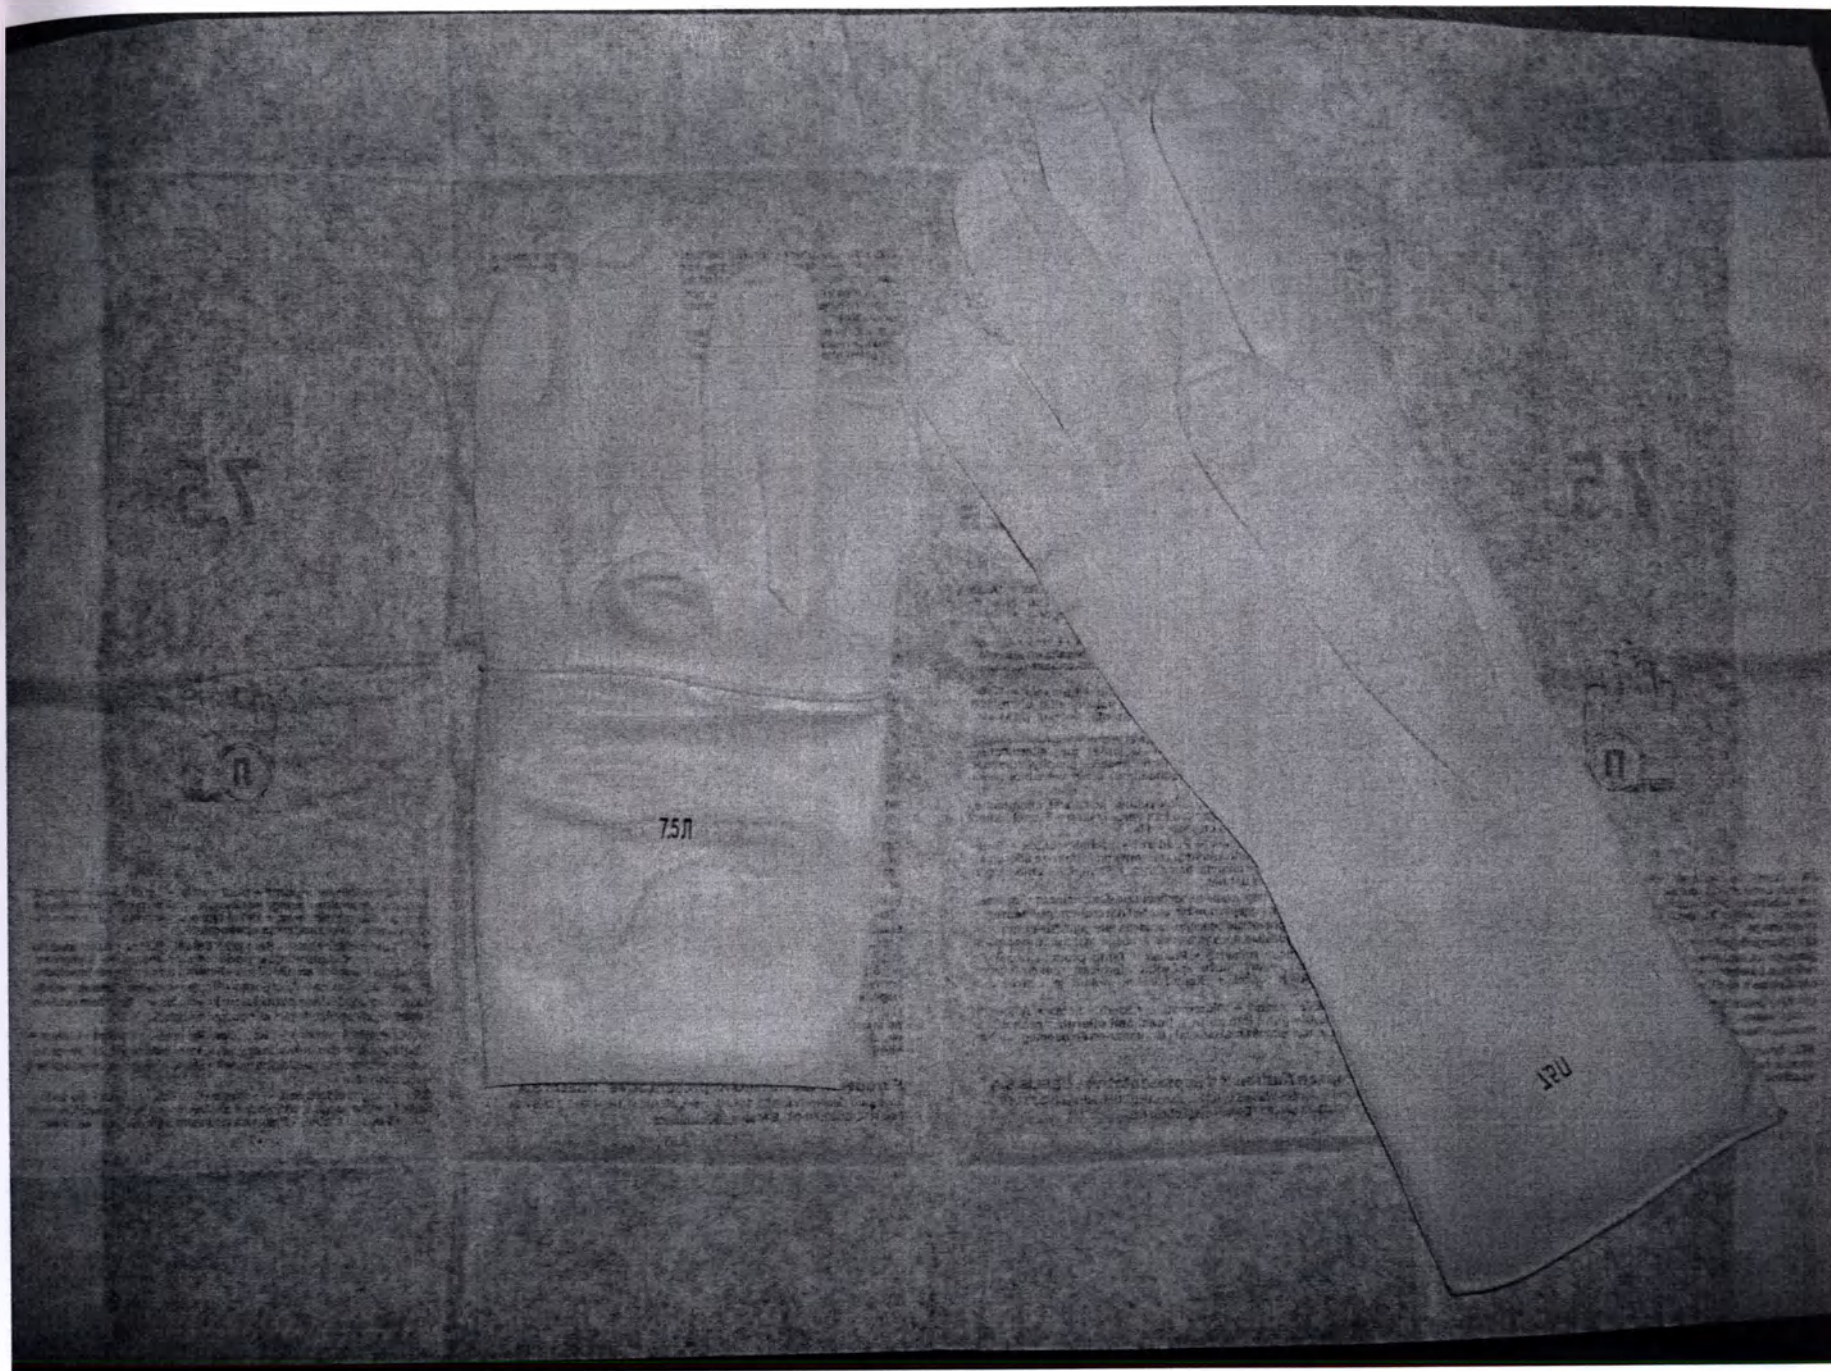

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0875

LOT



SN

SIZE

087515-010 2015-10 2018-10 087515010074 7.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite
INTW0875 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



ОДНОРАЗОВЫЕ



1 ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

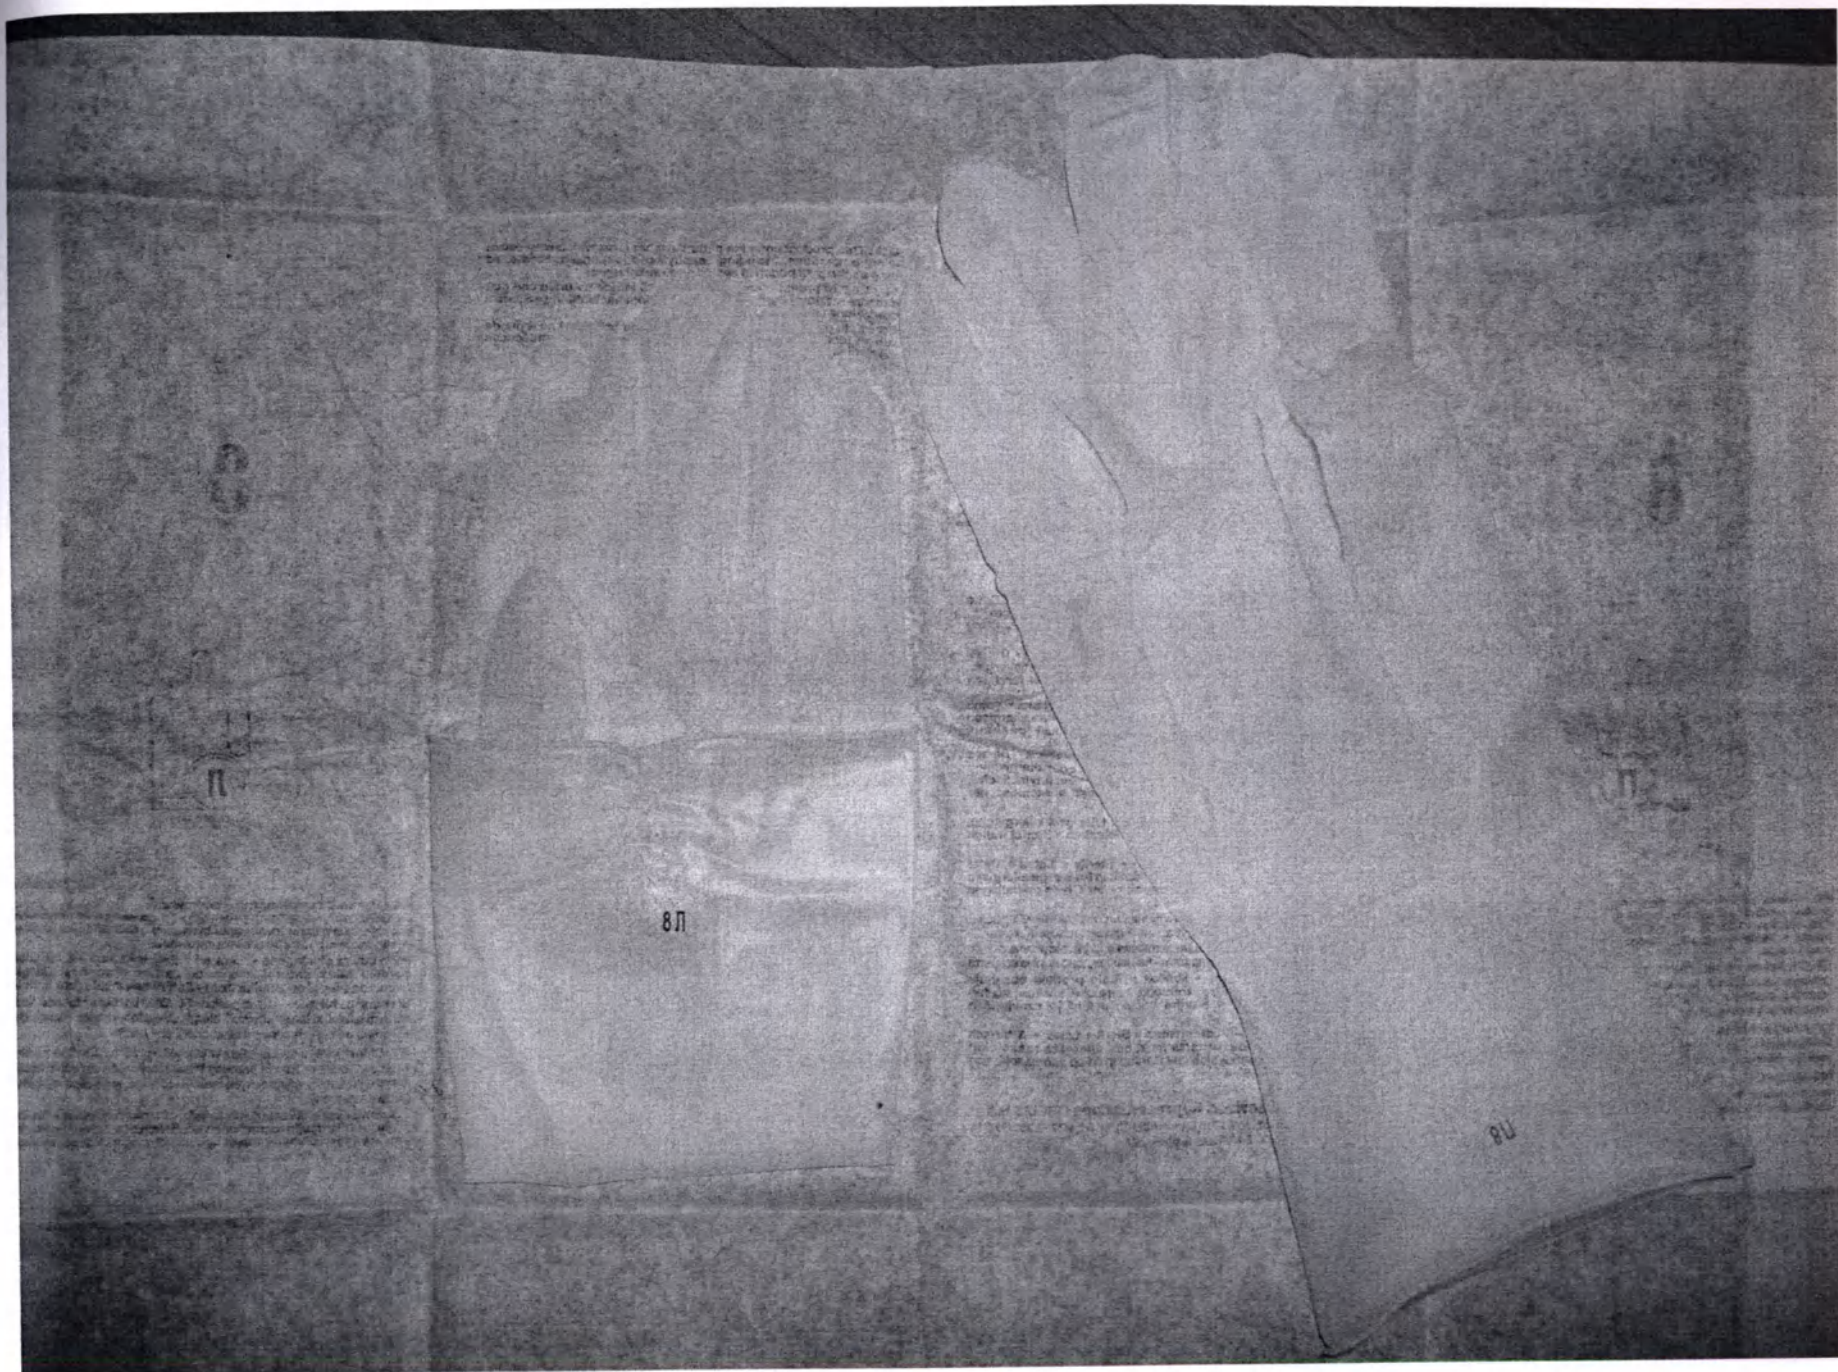

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0880

LOT



S.N

SIZE

088015-010 2015-10 2018-10 088015010083

8

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite

INTW0880

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0085



"ОДНОРАЗОВЫЕ"



1 ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

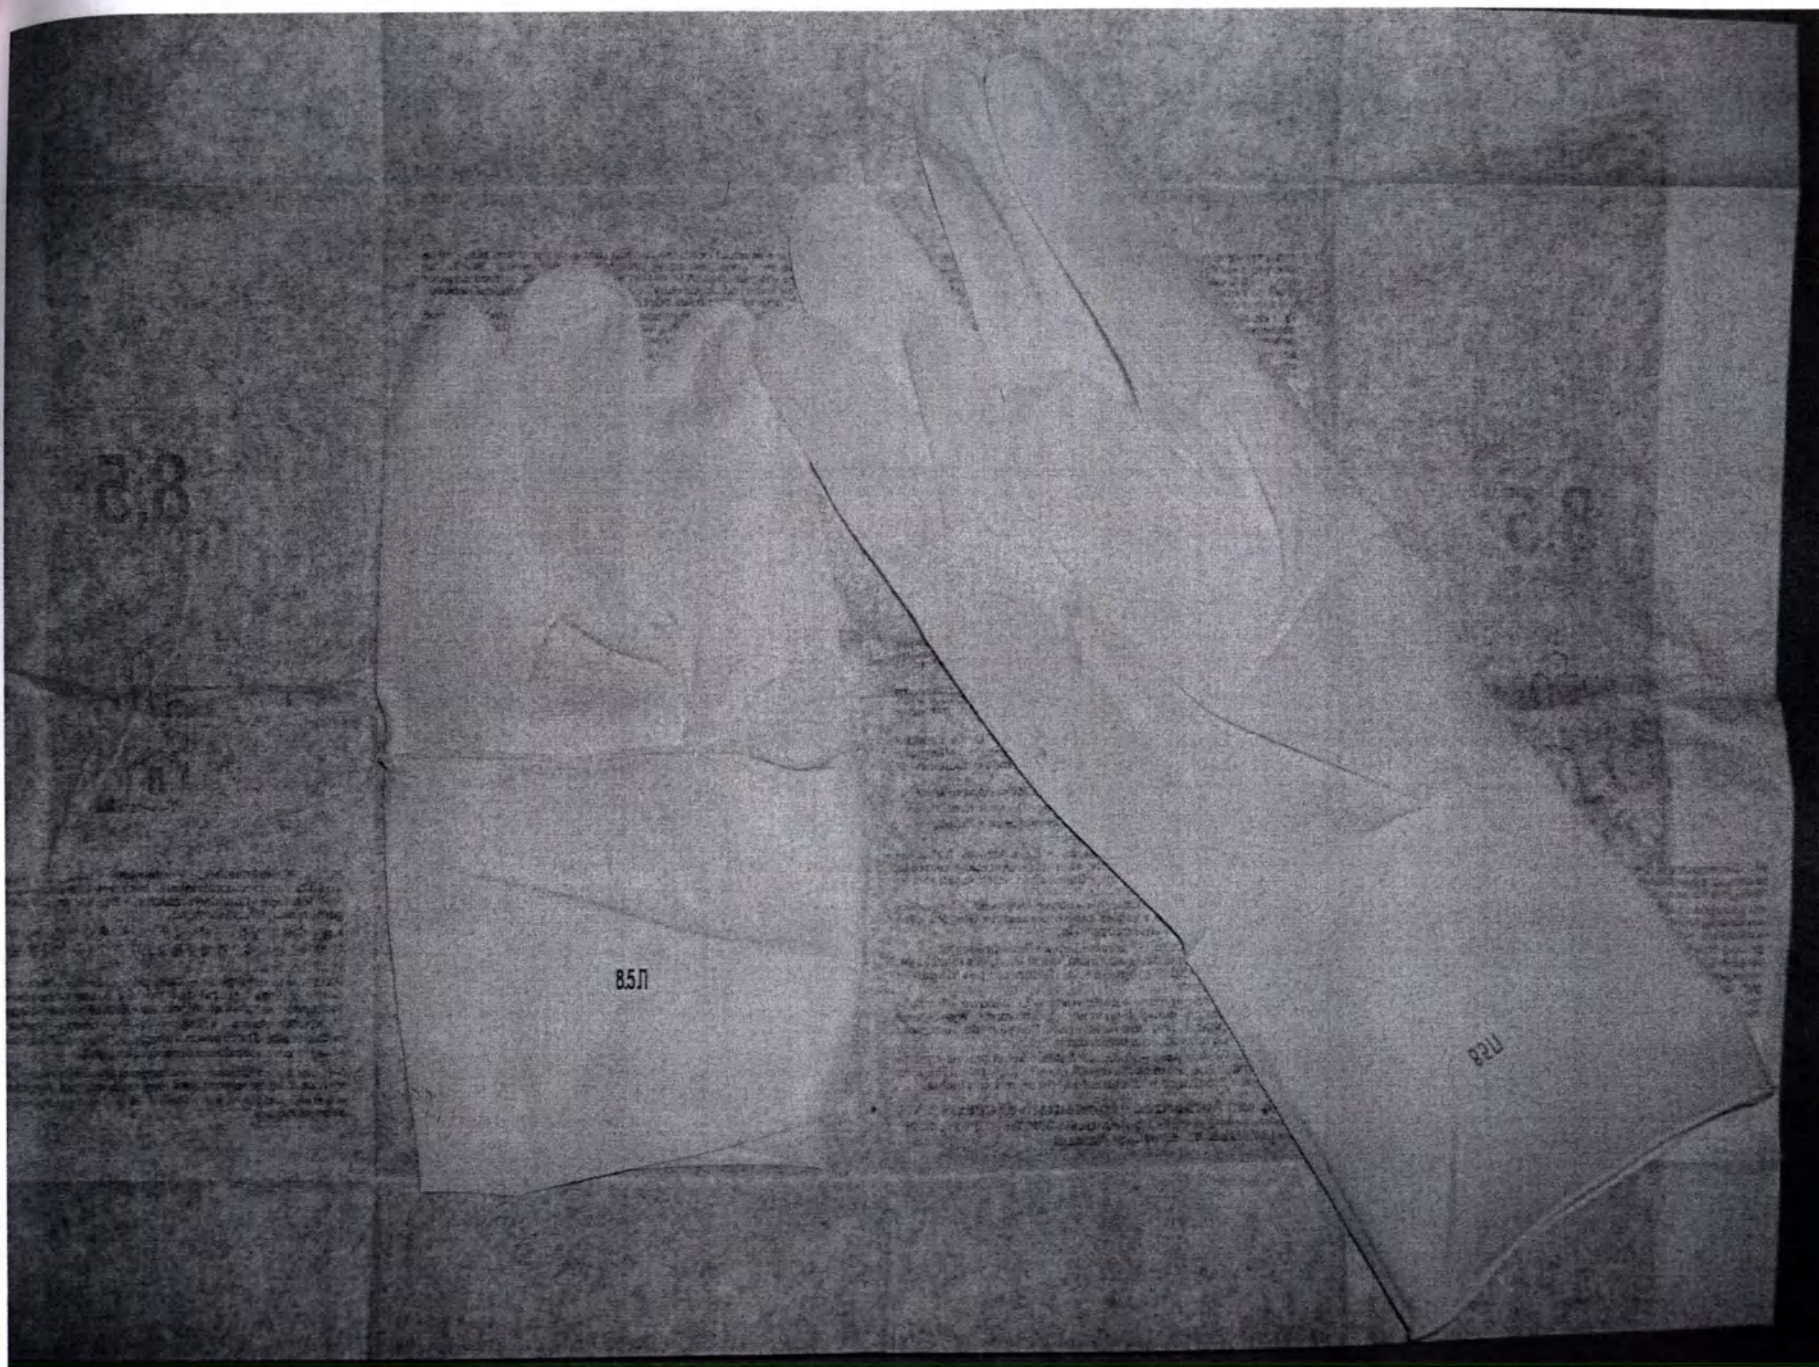

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0885

LOT 088515-010 2015-10 2018-10 088515010089 SN SIZE 8.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Life
INTW0885 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

2

ОДНОРАЗОВЫЕ

LATEX

1 ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/4, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные, с валиком, анатомические Intouch Lite INTW0890

LOT  SN  SIZE
089015-010 2015-10 2018-10 089015010095 9

intouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные односторонние «intouch»
текстурированные, с пальцами, анатомические Intouch Life
INTW0890

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0036

2

LATEX

100 ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может


вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ППОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавский дом 5, корпус 2А, офис 604-А

Упаковка для перчаток INTW0890

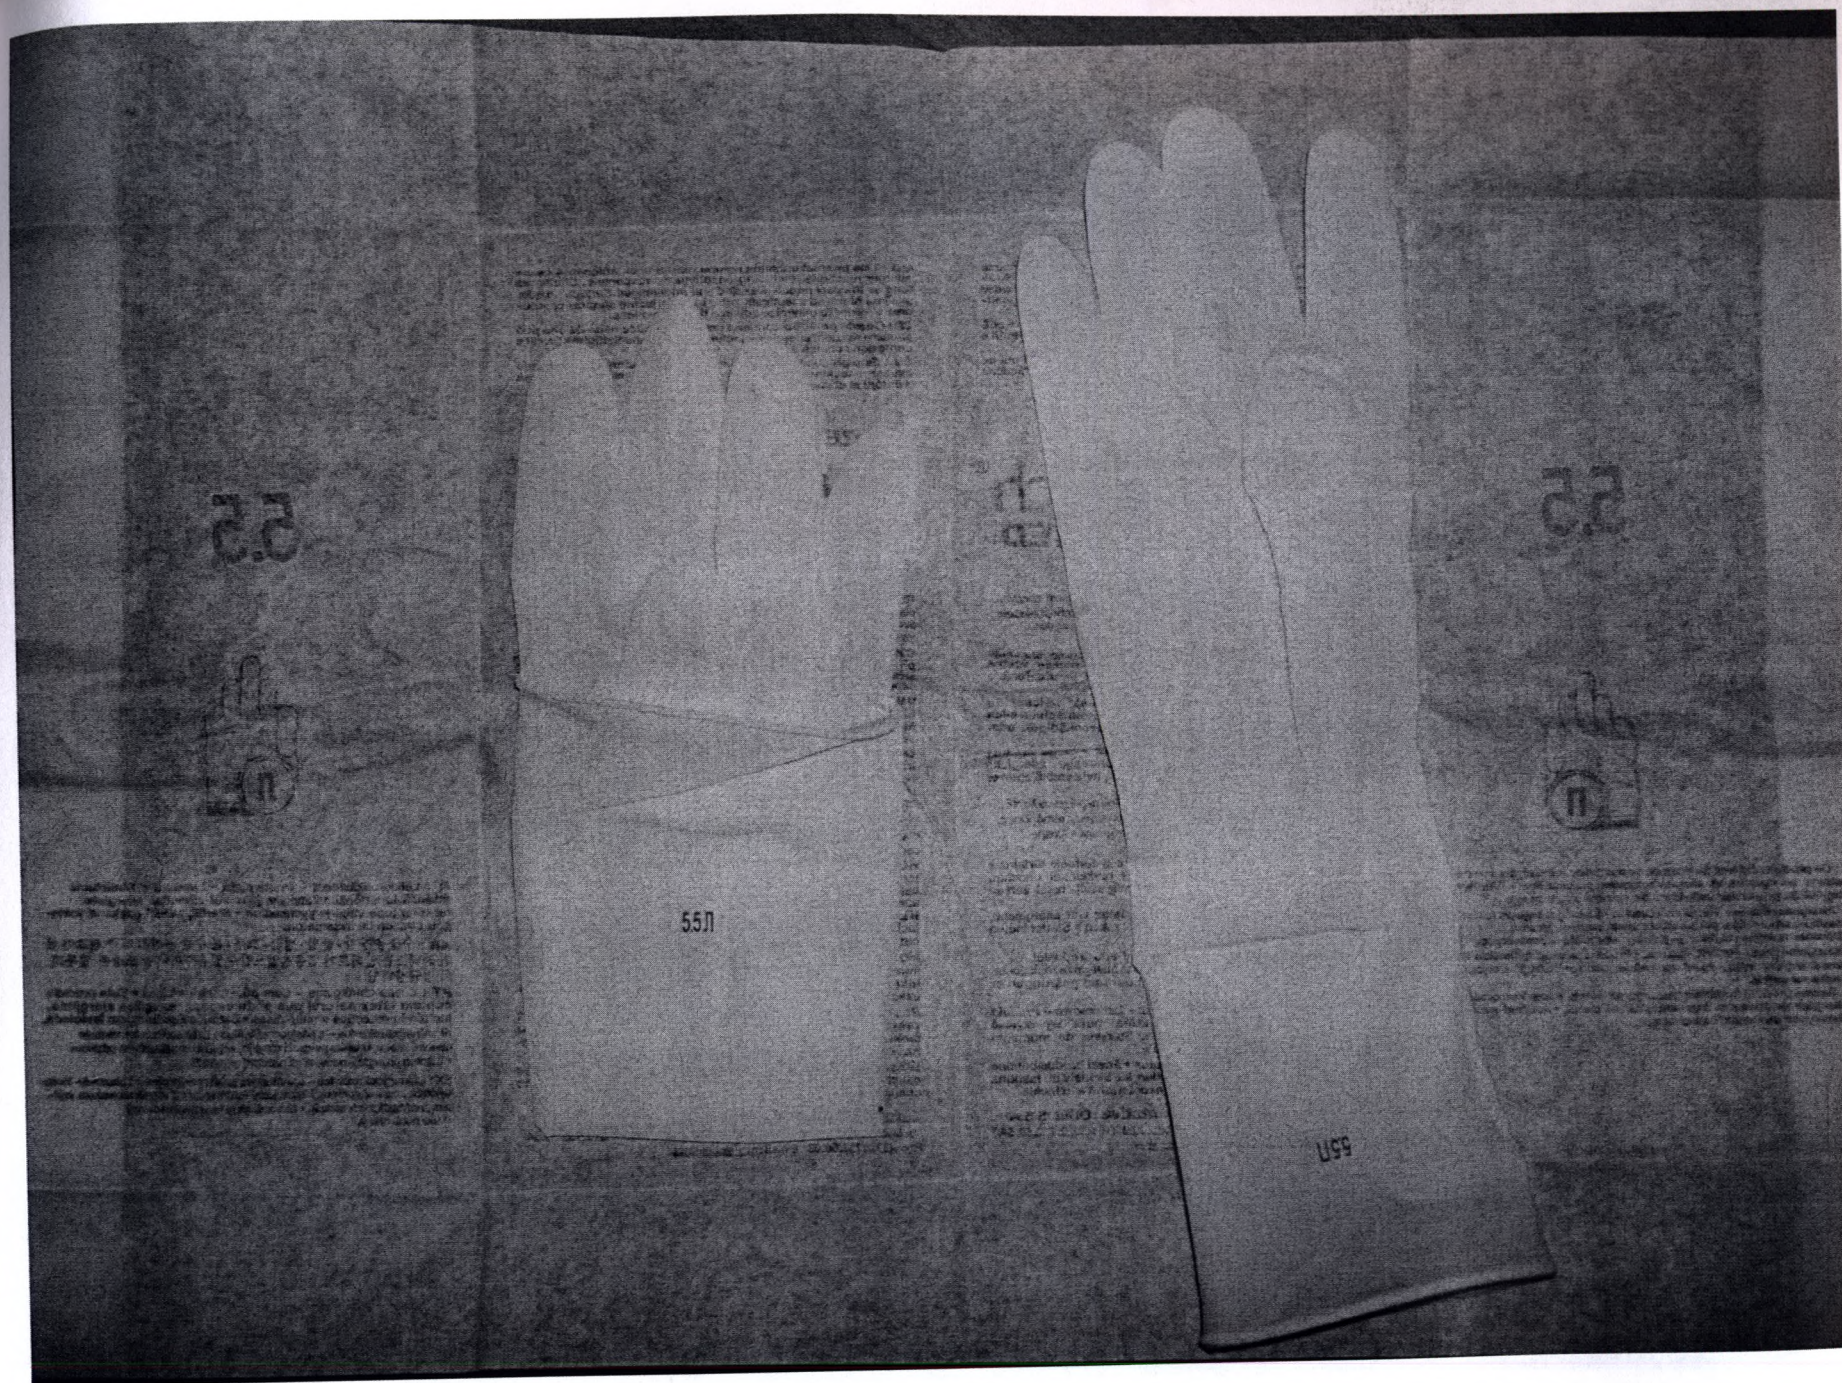

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0155

LOT 015515-010 2015-10 2018-10 015515010140 SN SIZE 5.5

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered
INTW0155 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086



ОДНОРАЗОВЫЕ




100
ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

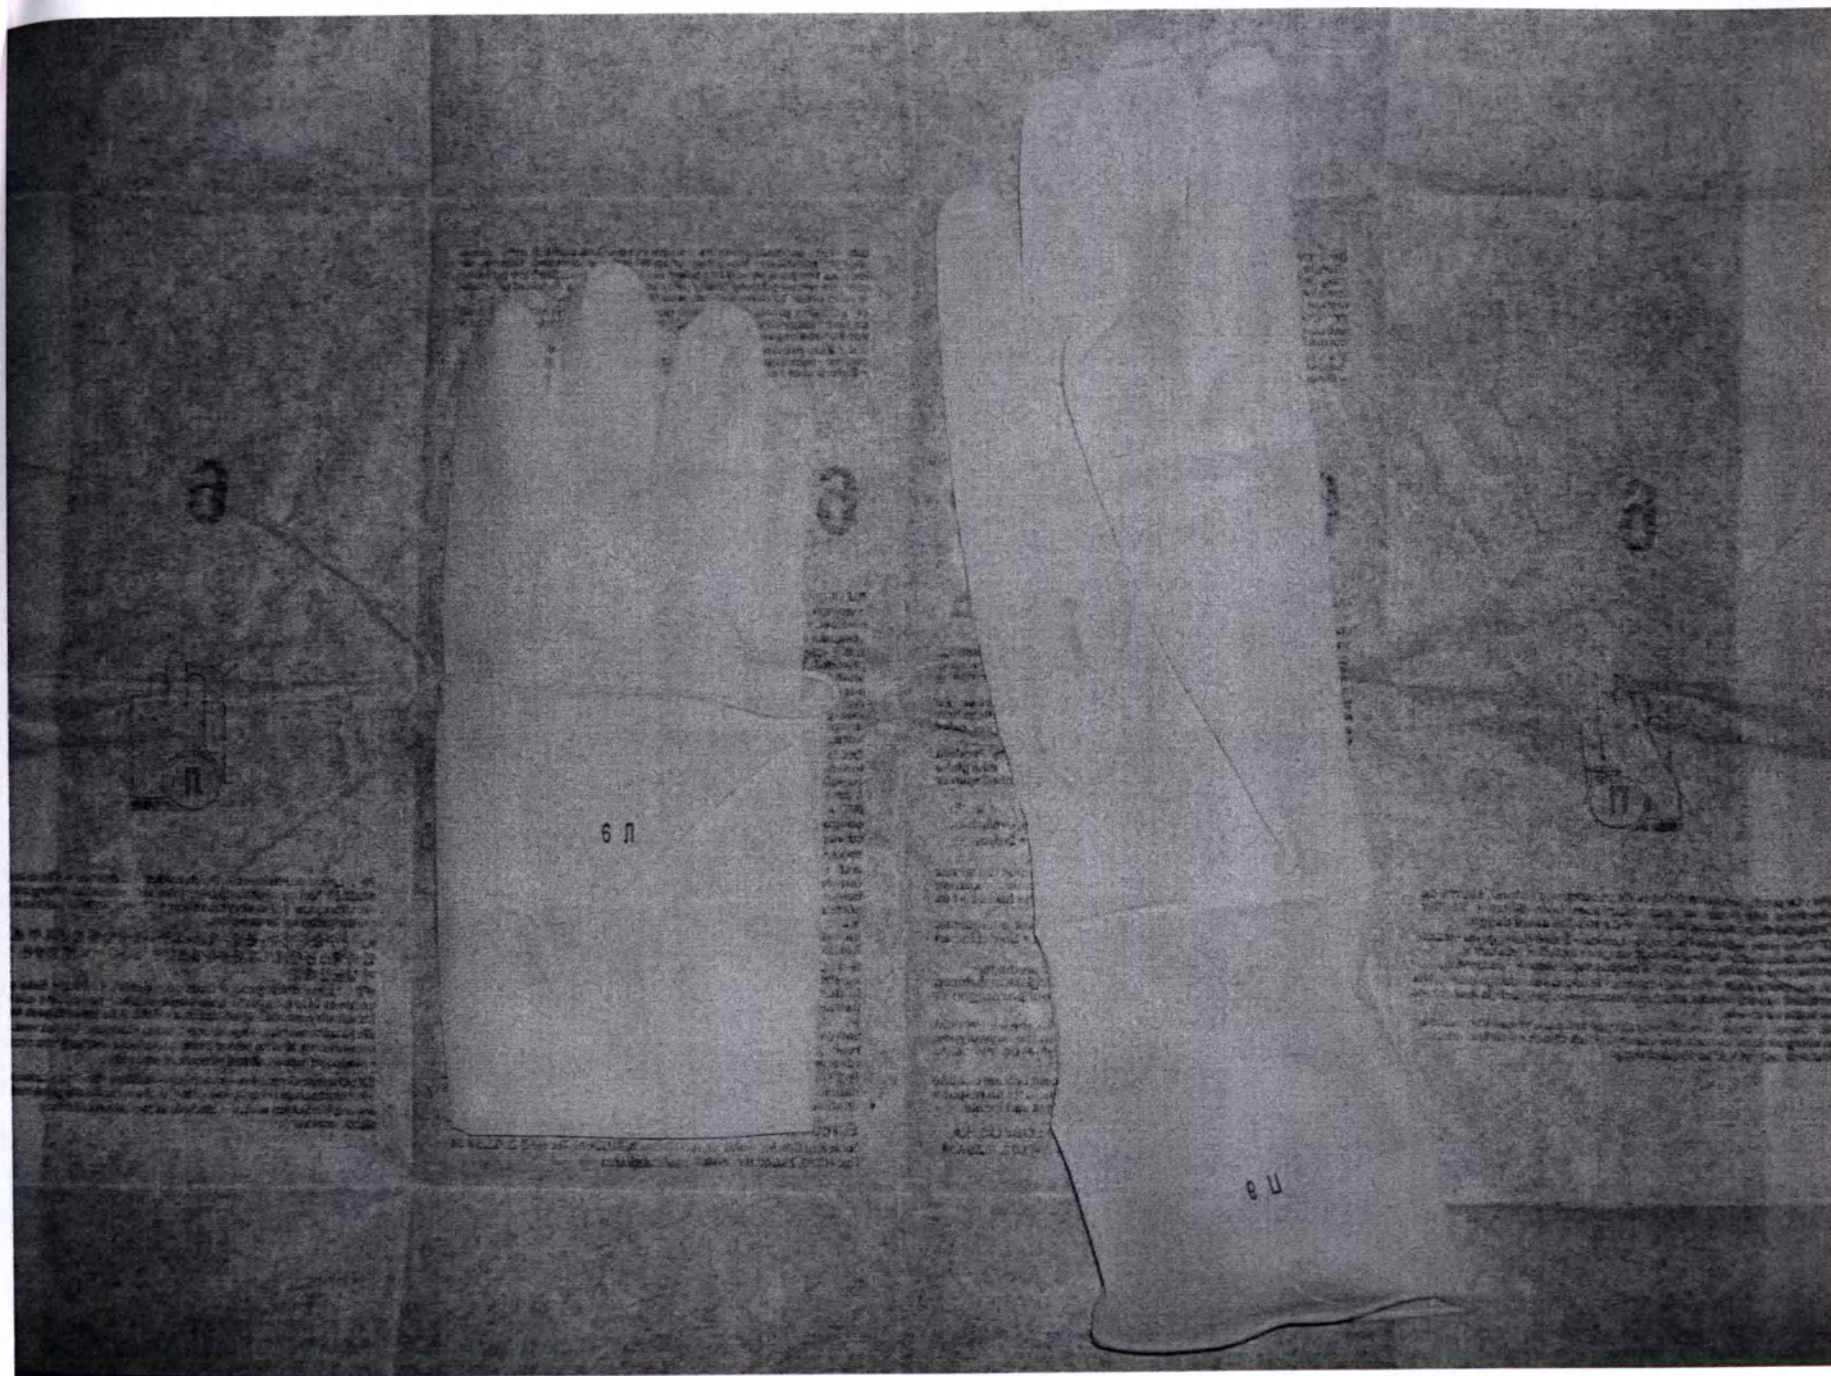


Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0160



SIZE

016015-010 2015-10 2018-10 016015010152

6

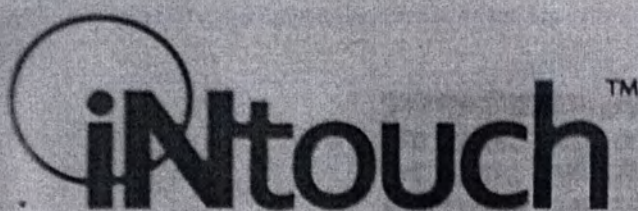

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered
 INTW0160 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086

ОДНОРАЗОВЫЕ

100
ПАРА


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать
 аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
 потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
 Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0160

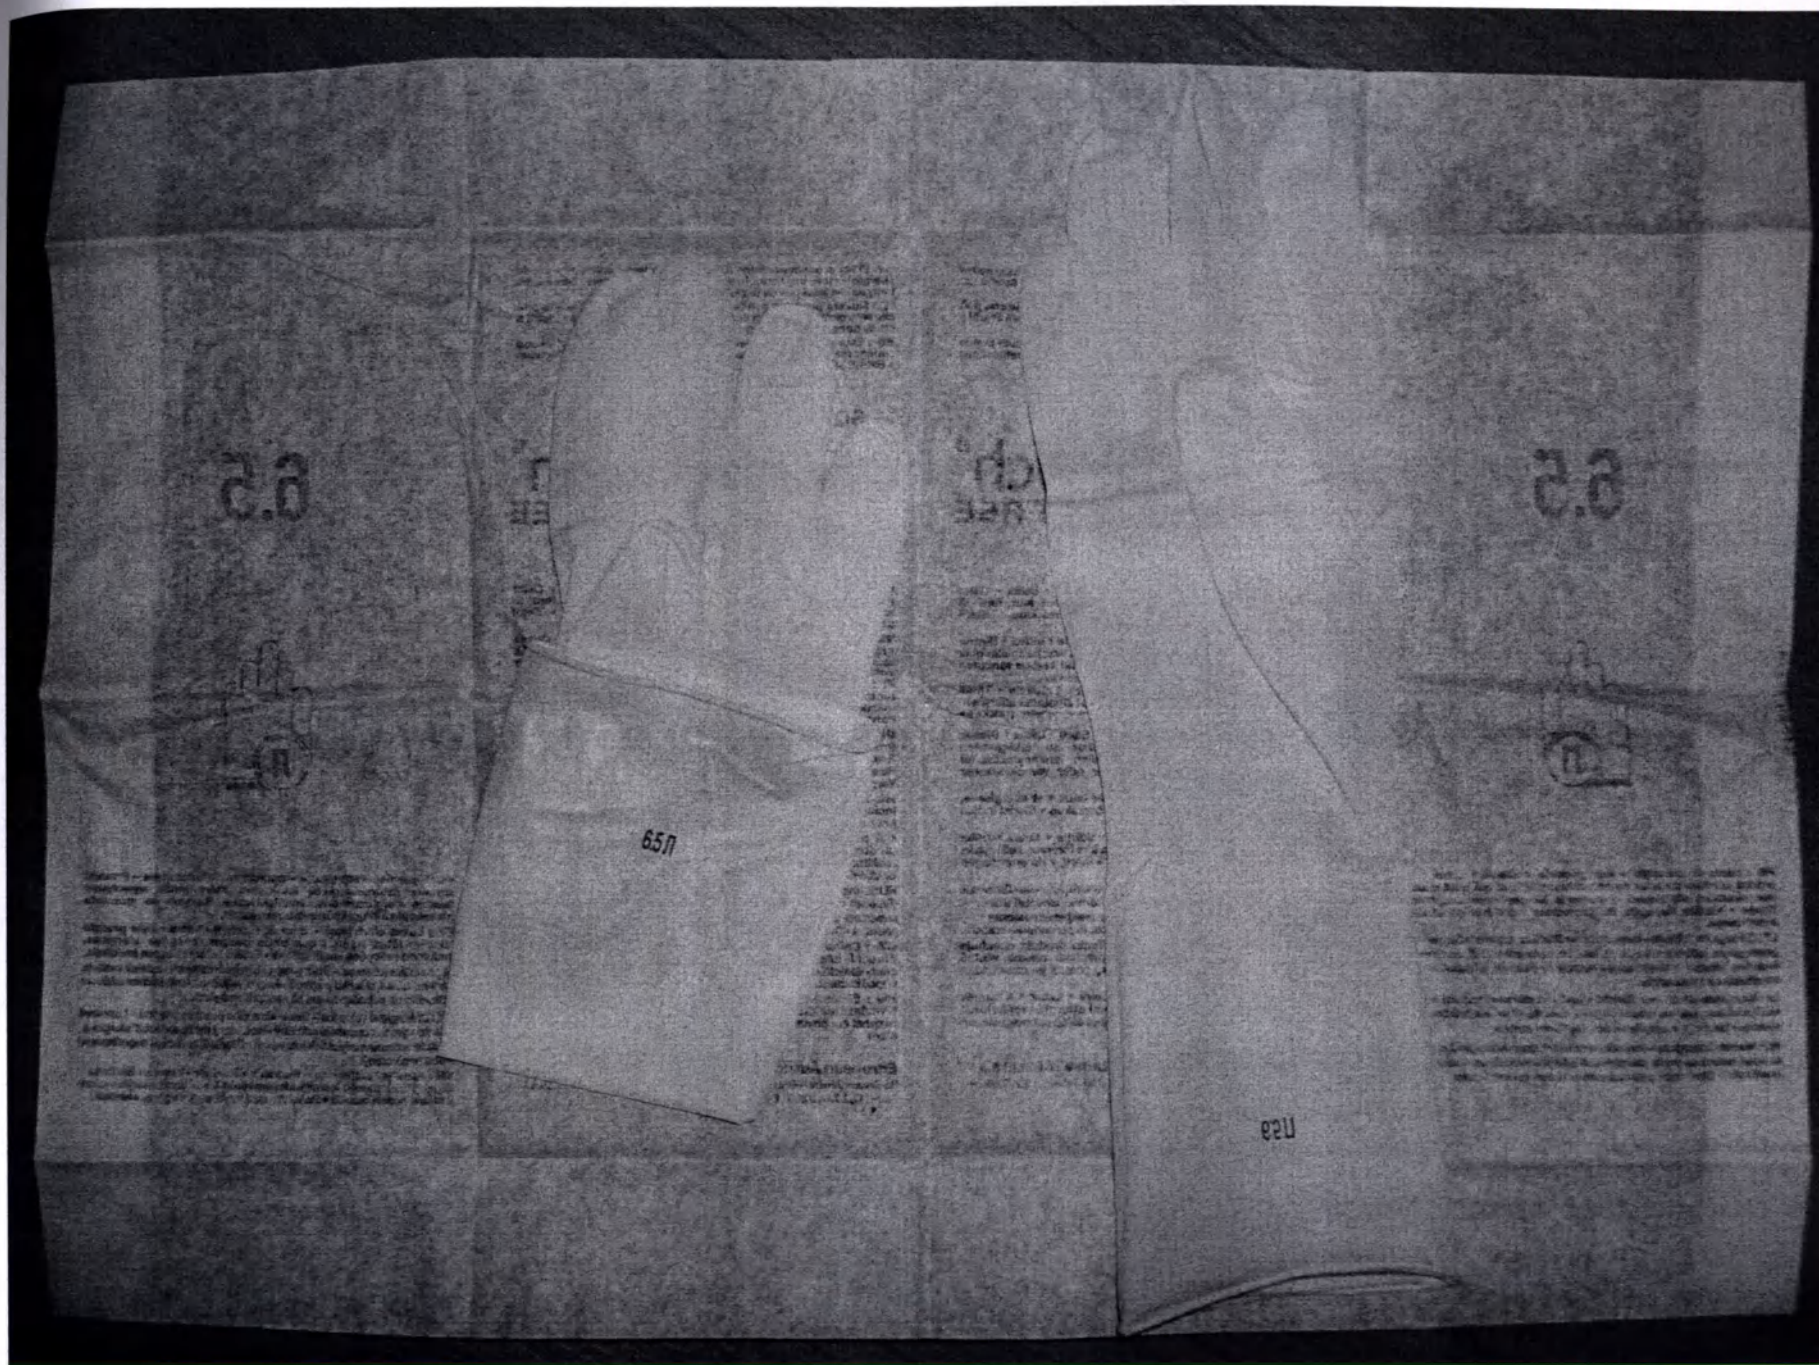

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0165



SIZE

016515-010 2015-10 2018-10 016515010167


6.5

iNtouchTM

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered

INTW0165

ГОСТ Р 52238-2004



0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"




1 ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

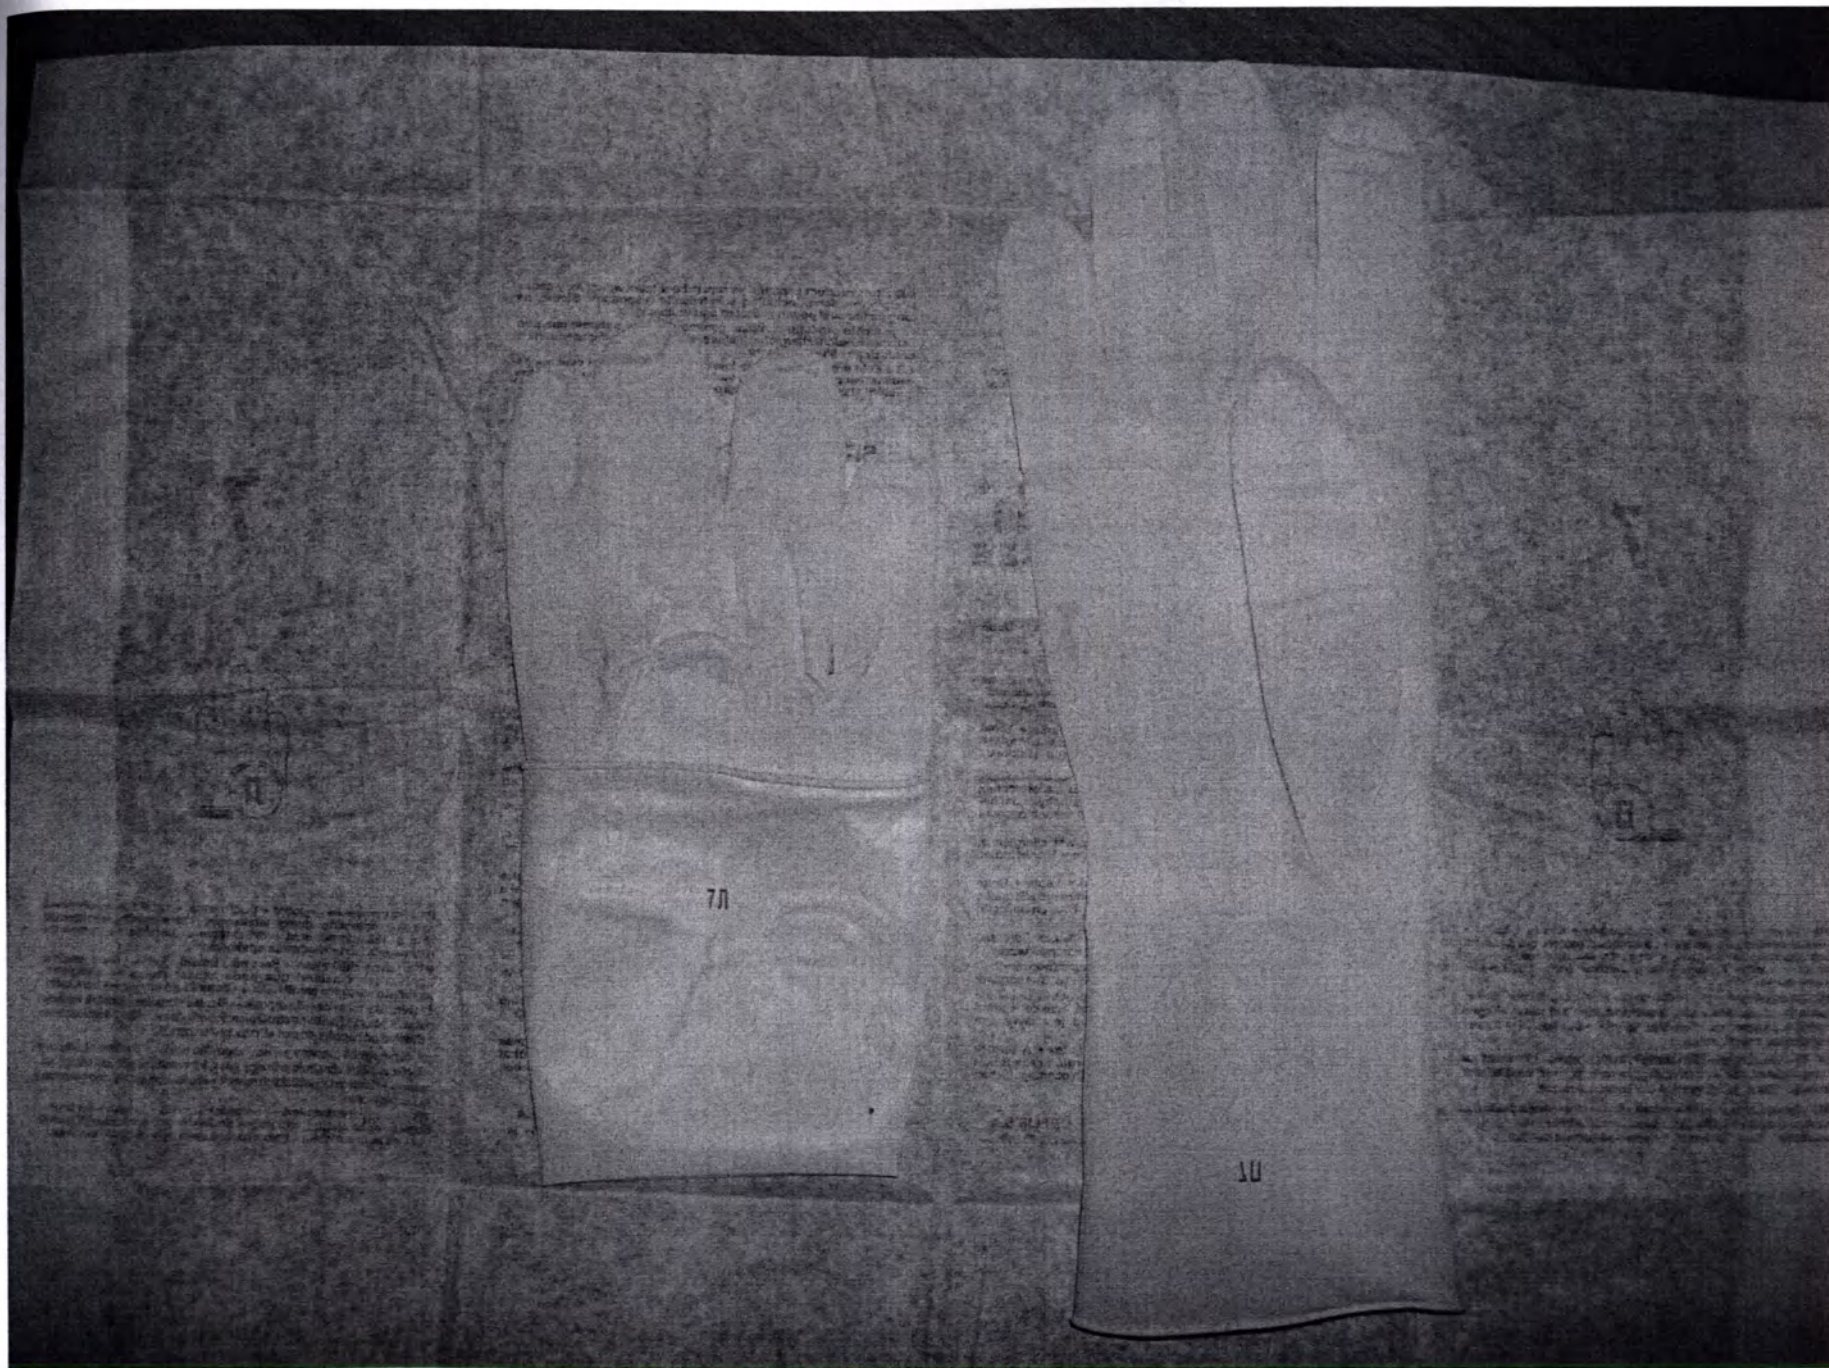

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0170

LOT 017015-010 2015-10 2018-10 SN 017015010181 SIZE 7

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered

INTW0170

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"




100
ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

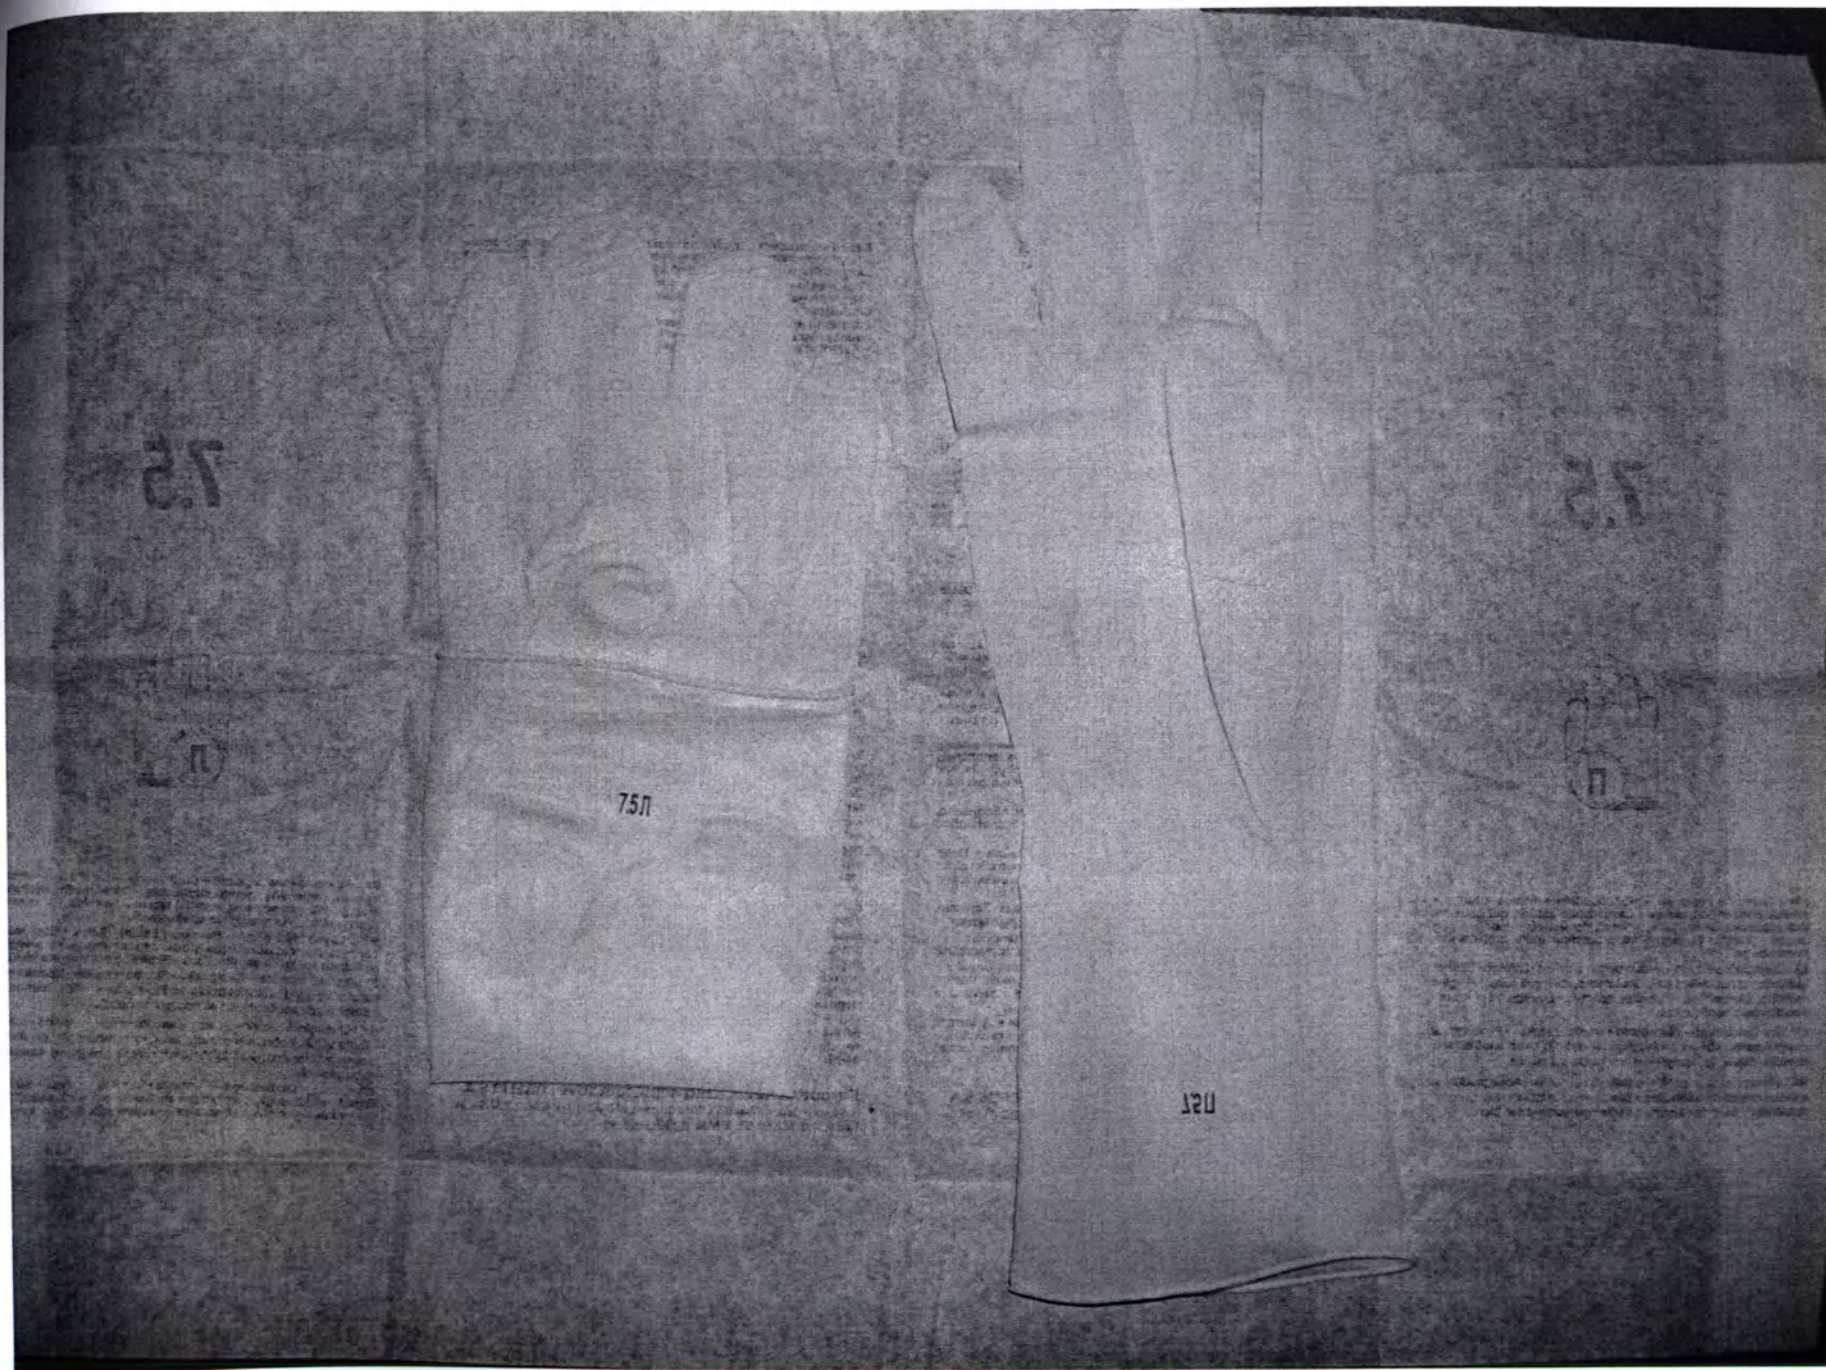

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0175

LOT 017515-010 2015-10 2018-10 SN 017515010191 SIZE 7.5

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered

INTW0175


ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"




100
ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

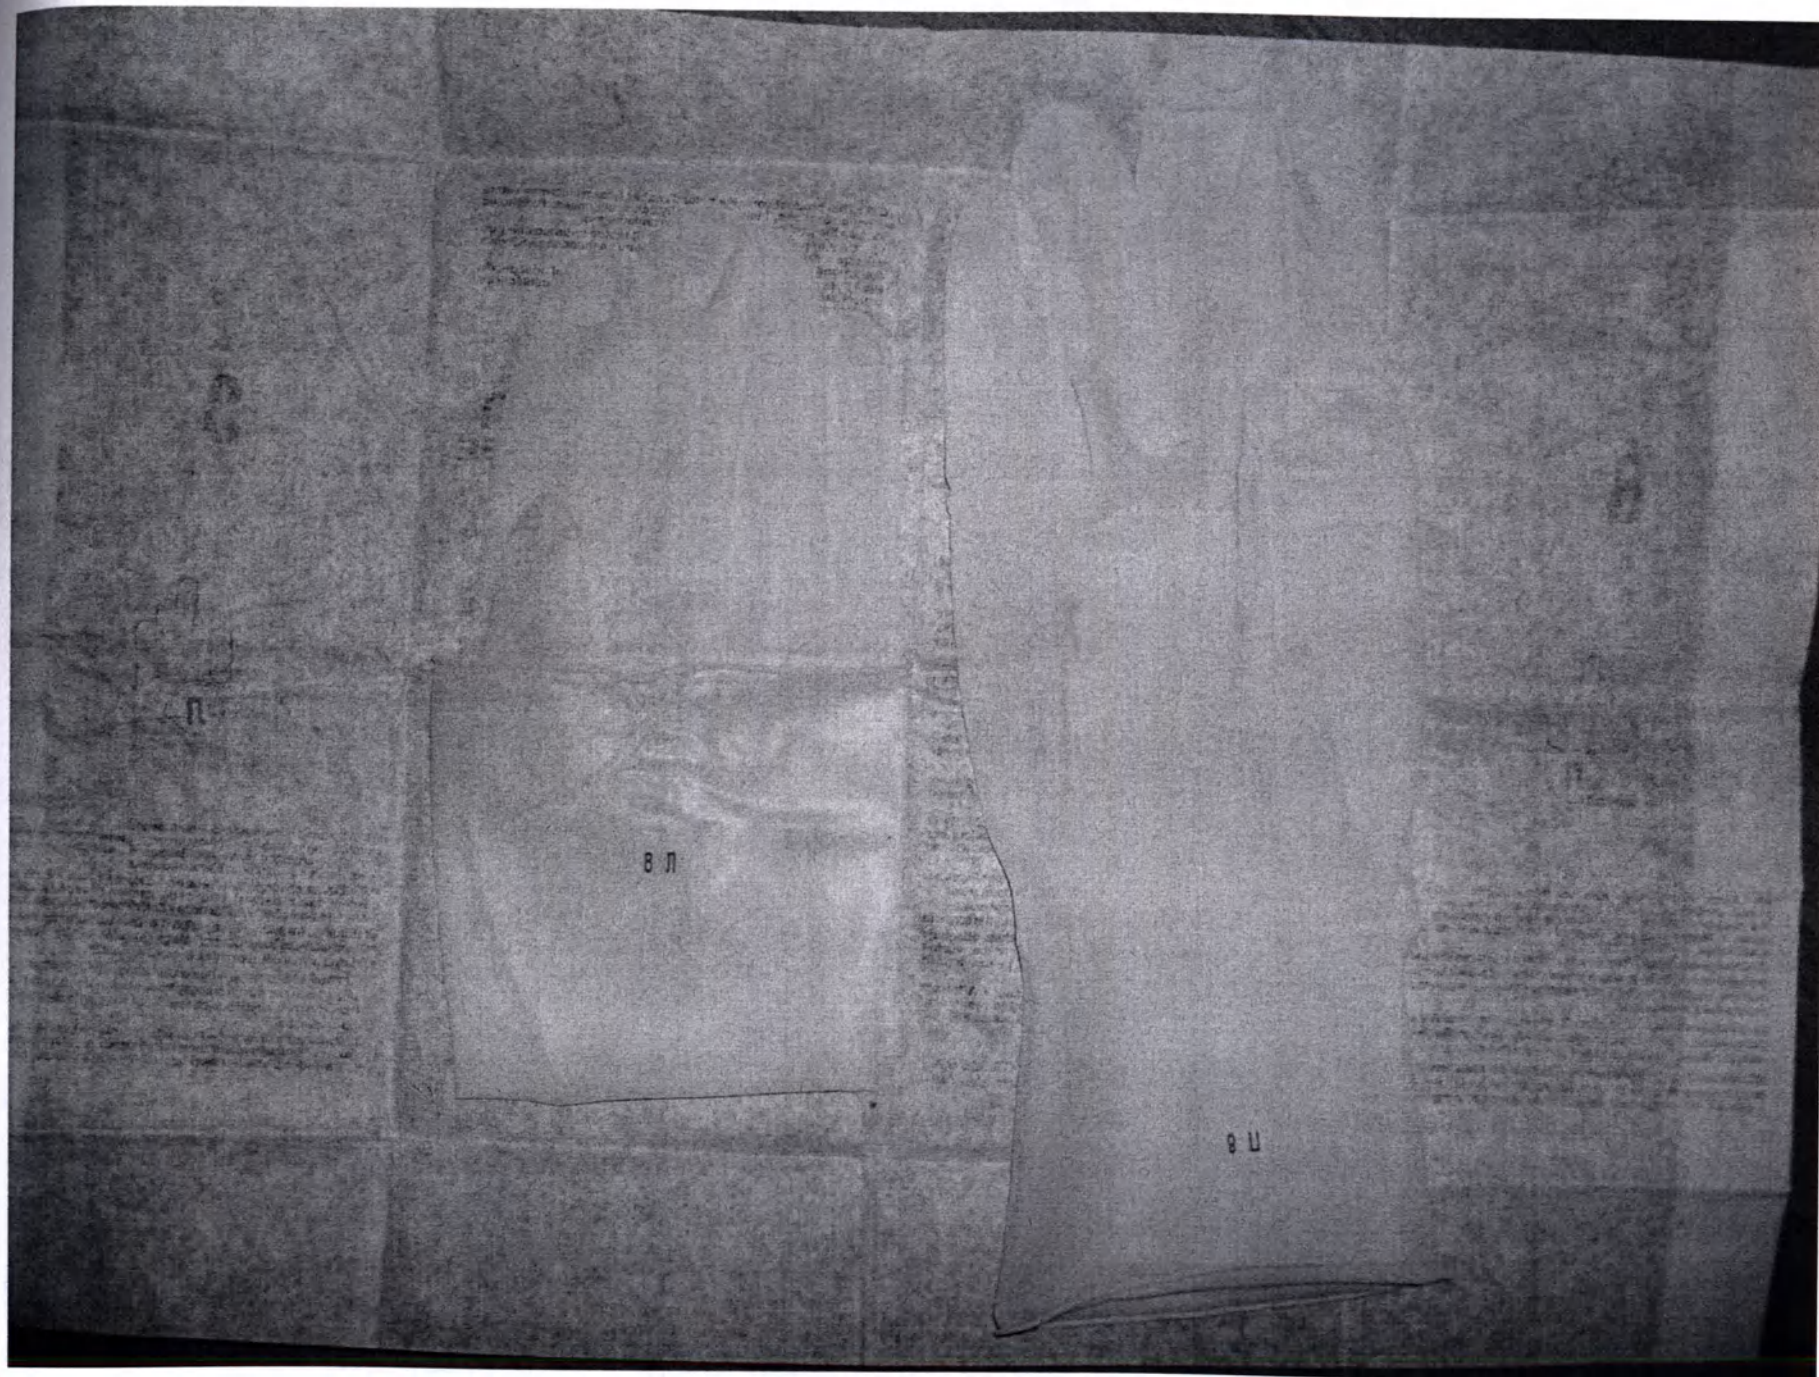

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0180

LOT 2015-10 2018-10 018015010199 SIZE 8

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered

INTW0180

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"




100
ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО. Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

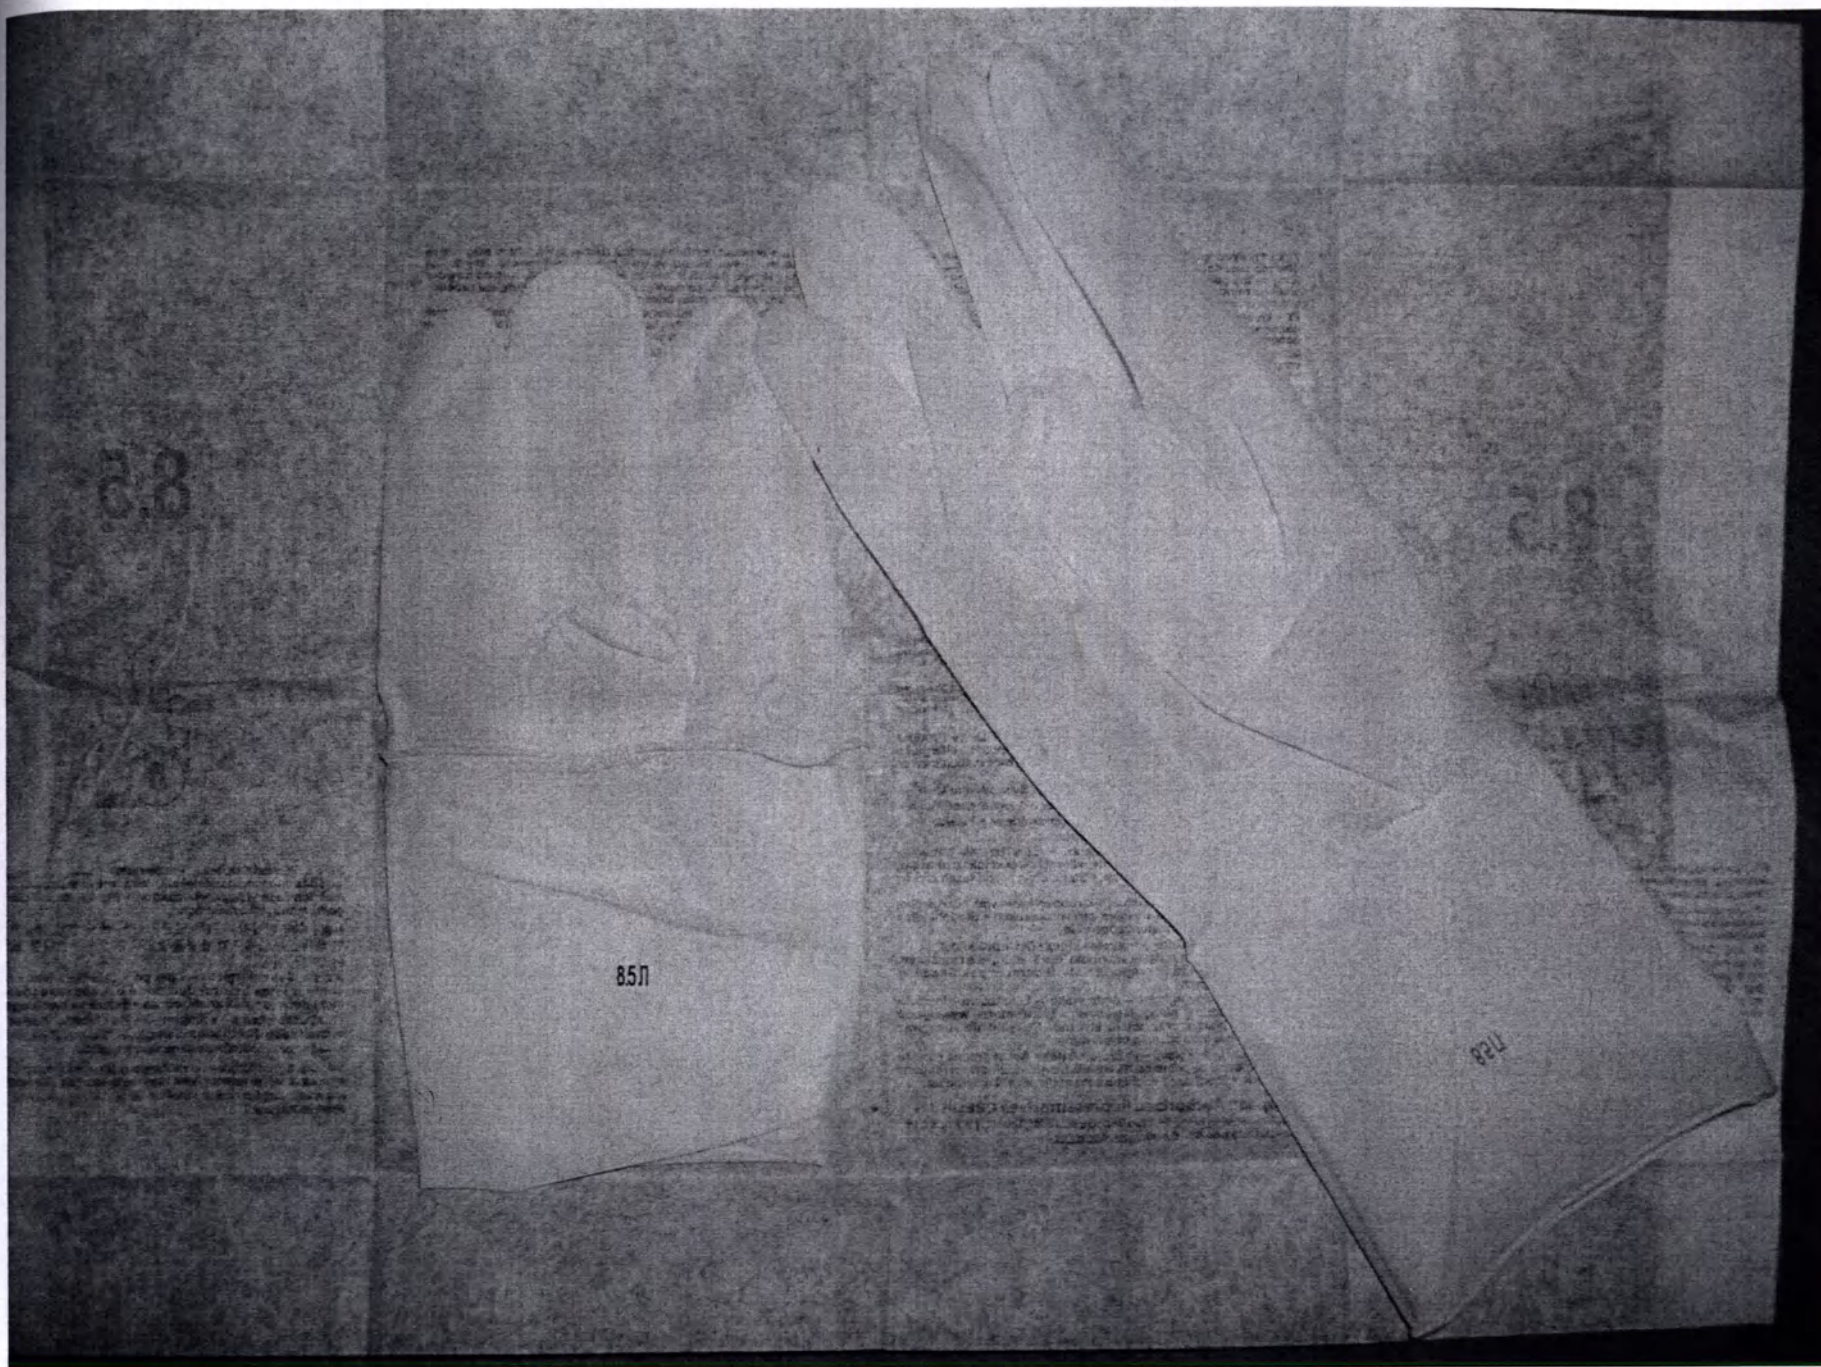

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0185

LOT 018515-010 2015-10 2018-10 SN 018515010207 SIZE 85

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered
INTW0185 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE
0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"



100
ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered INTW0190

LOT 019015-010 2015-10 2018-10 SN 019015010220 SIZE 9

iNtouch™

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, с валиком, анатомические Intouch Powdered
INTW0190 ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



"ОДНОРАЗОВЫЕ"




1 ПАРА

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

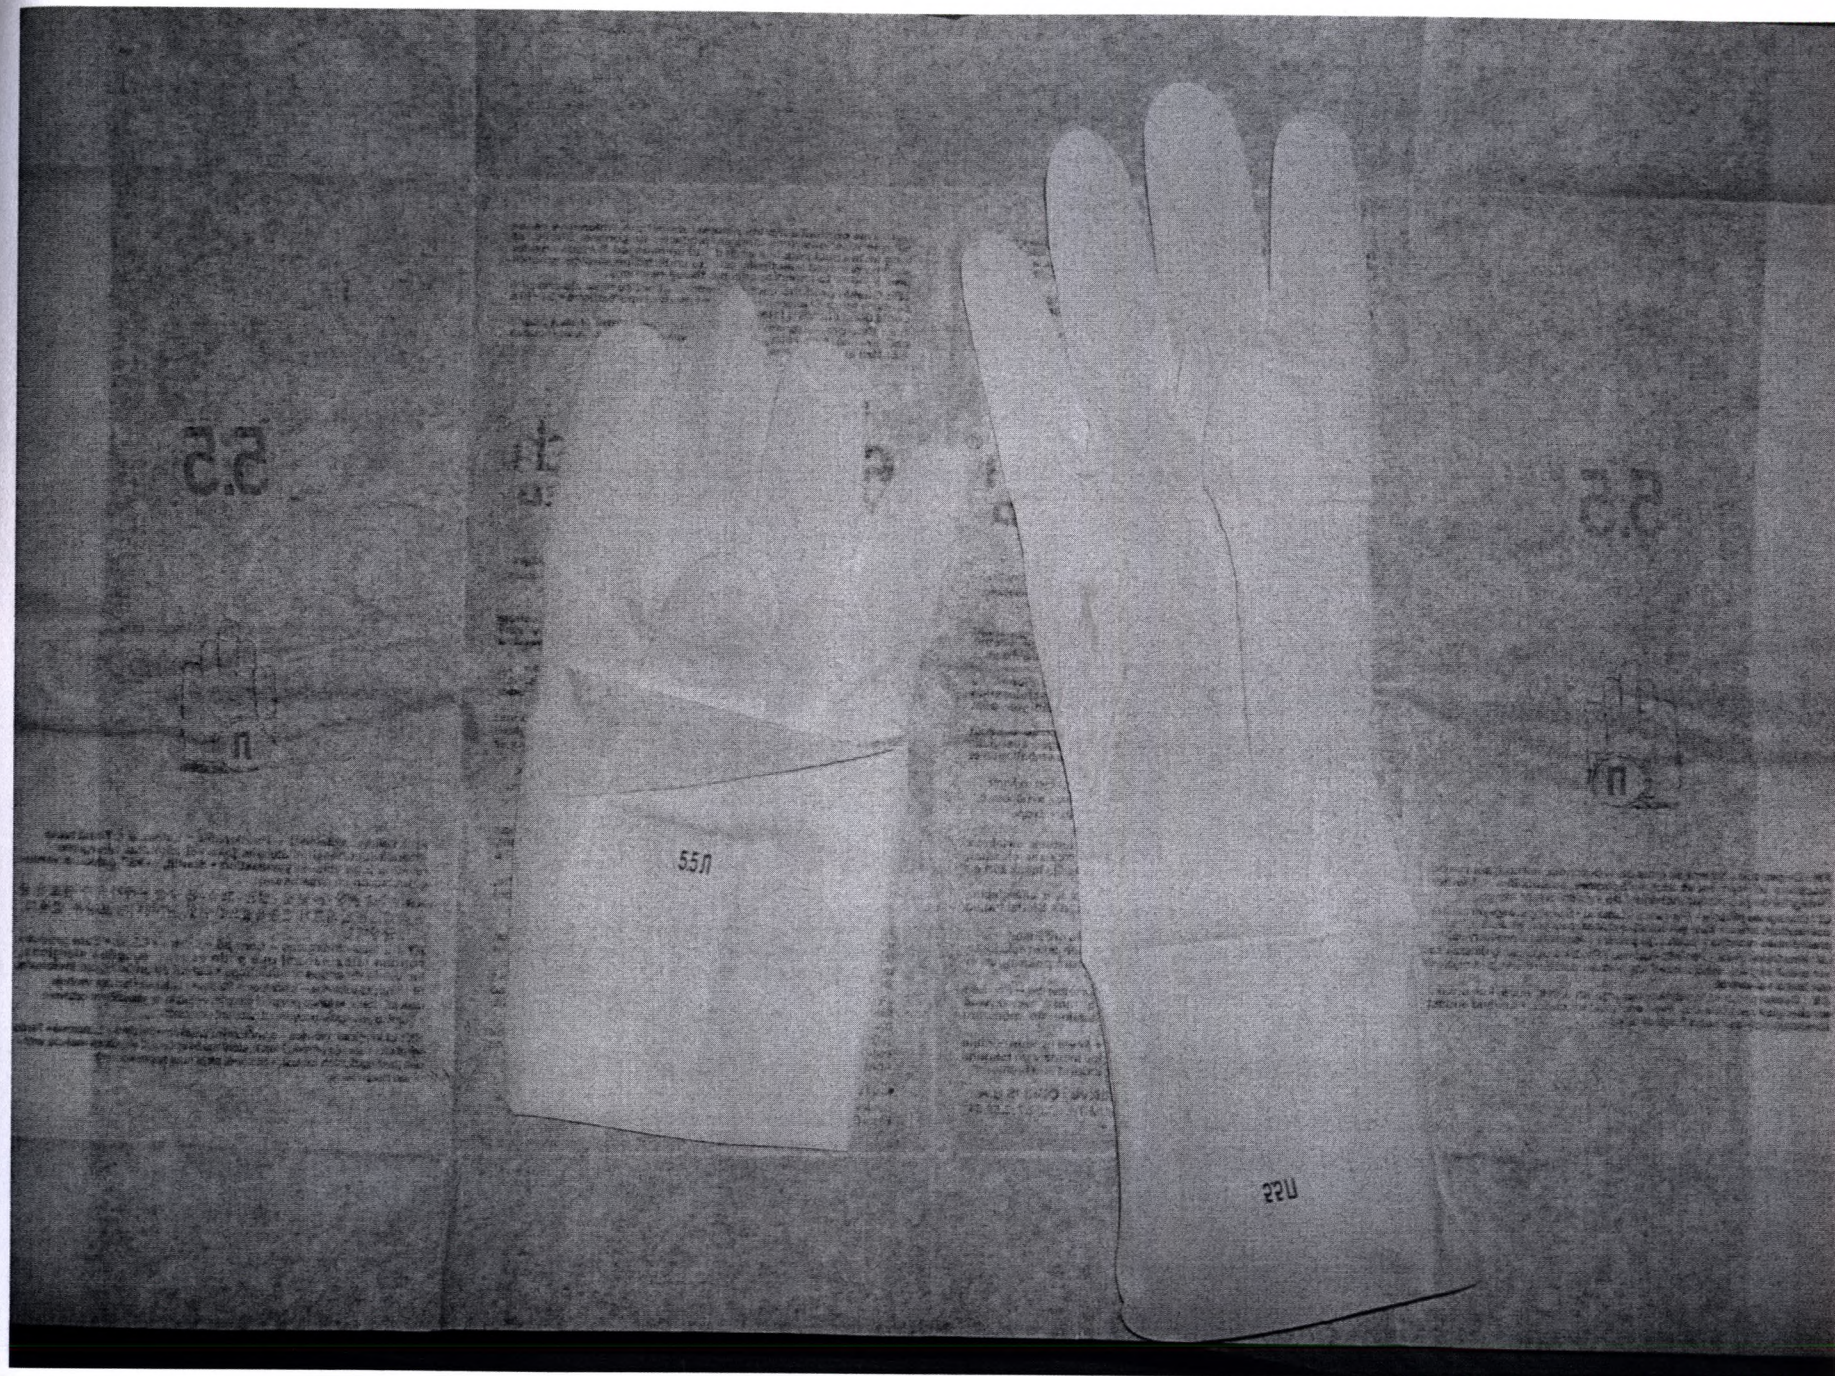

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0255







 025515-010 2015-10 2018-10 025515010300 5.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
 INTW0255 ГОСТ Р 52238-2004



"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

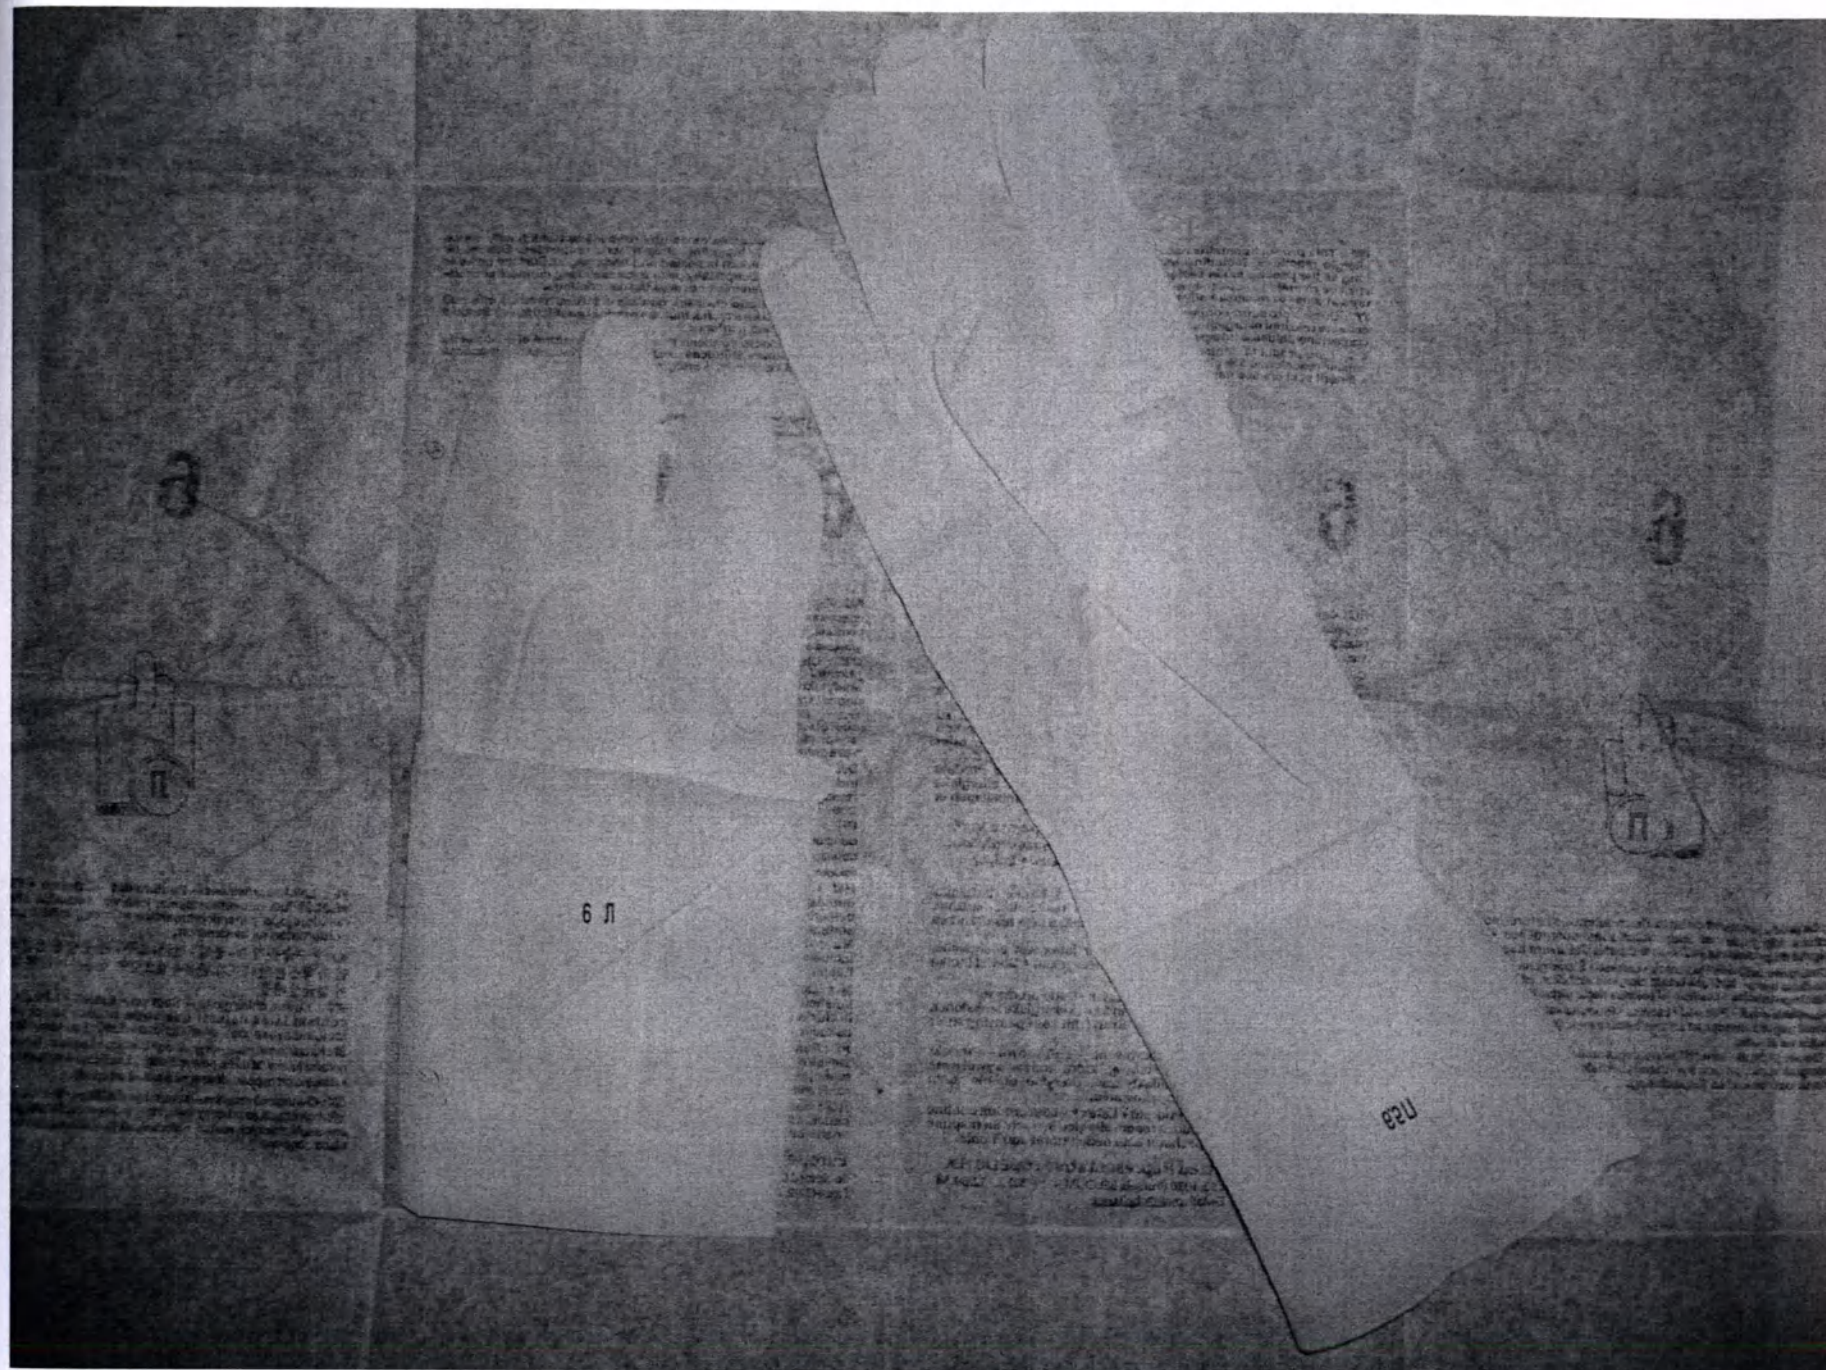

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0260

LOT

MM

Y

SN


SIZE

026015-010 2015-10 2018-10 026015010315

6

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
INTW0260 ГОСТ Р 52238-2004

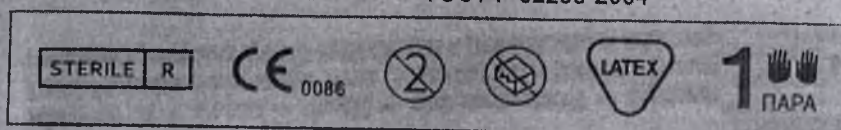

"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/4, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

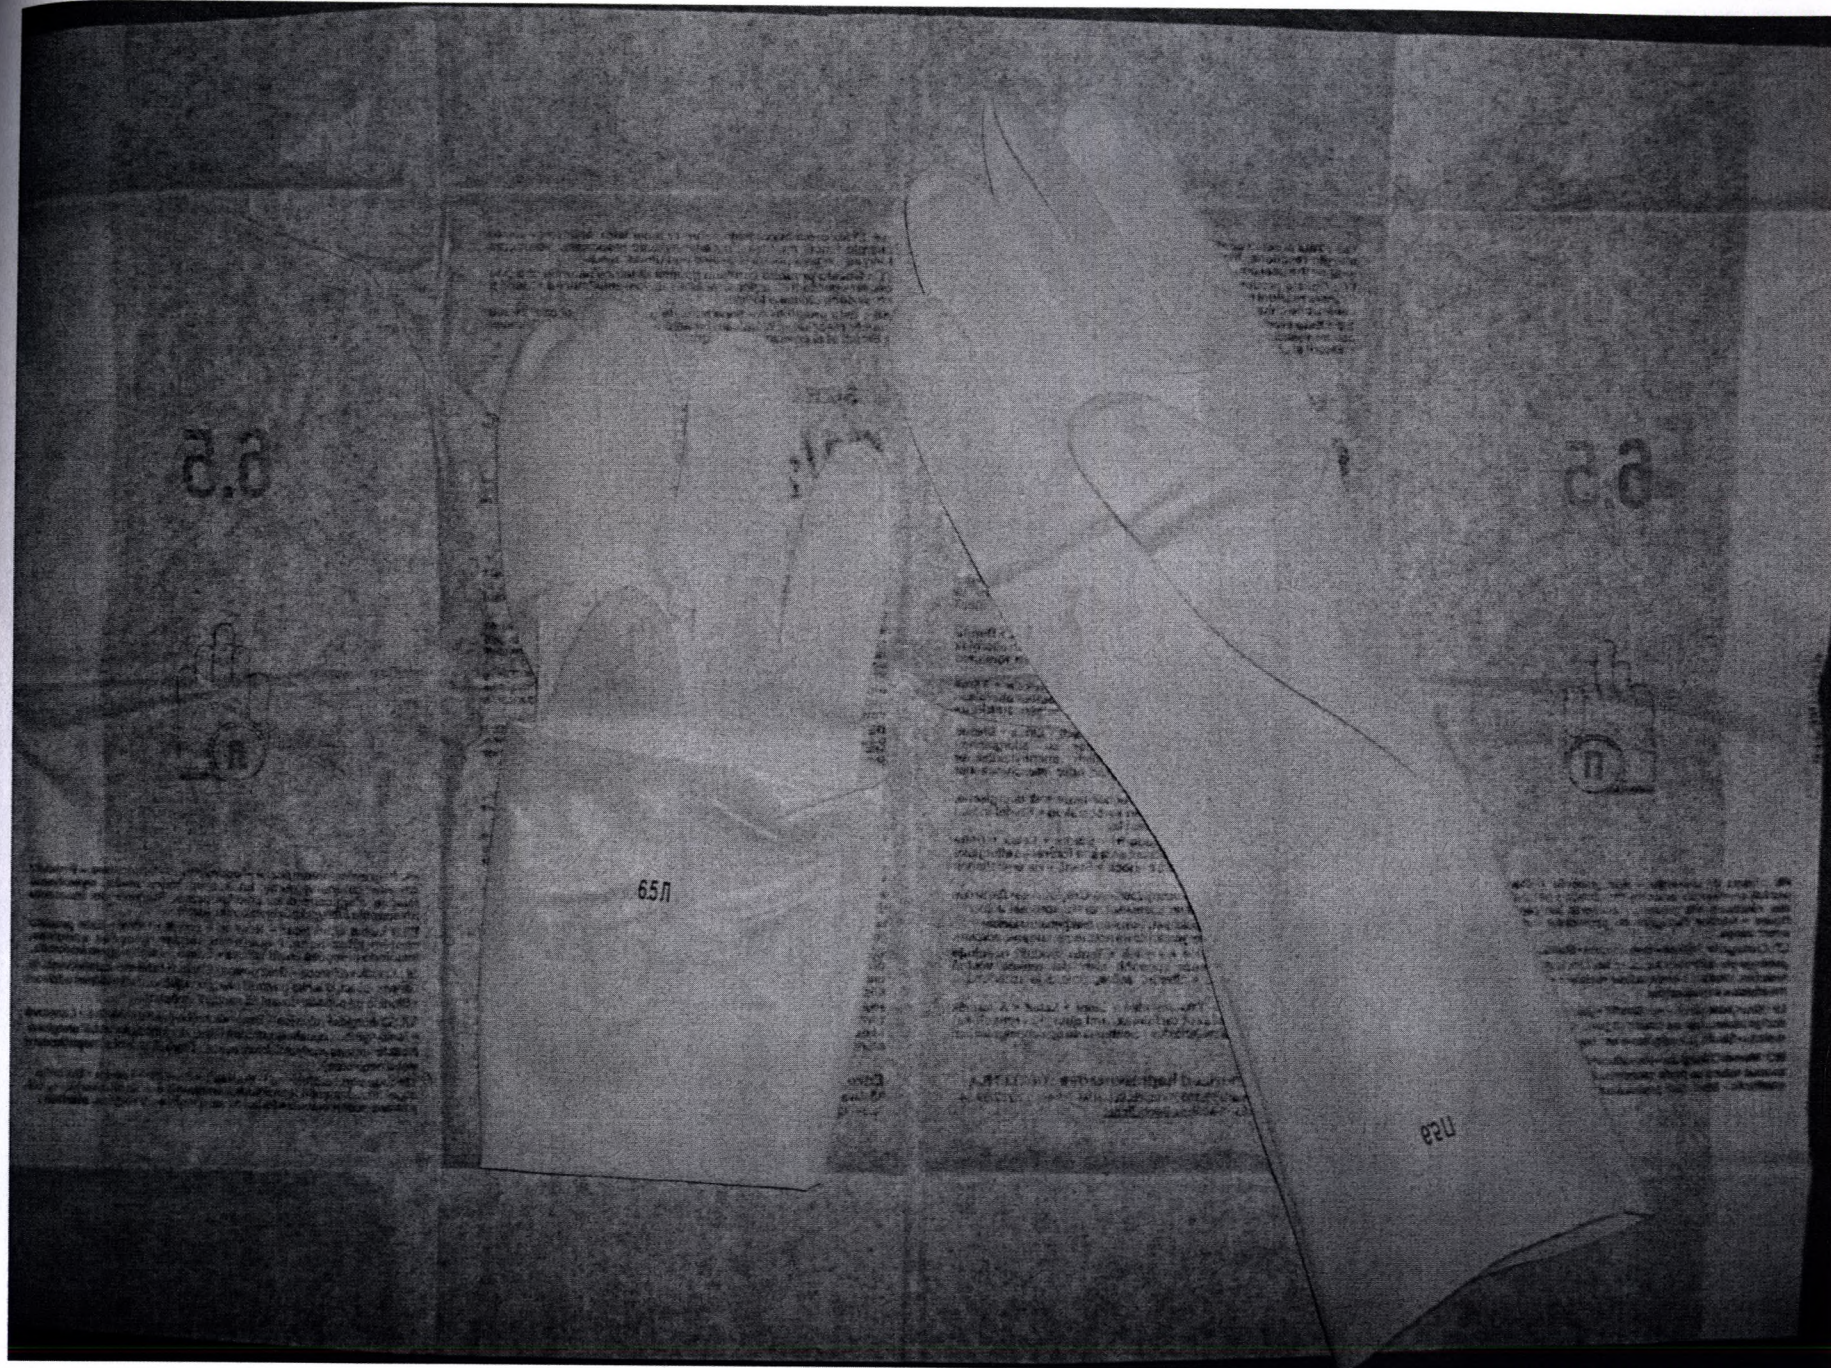

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0265







 026515-010 2015-10 2018-10 026515010330 6.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
 INTW0265 ГОСТ Р 52238-2004



"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

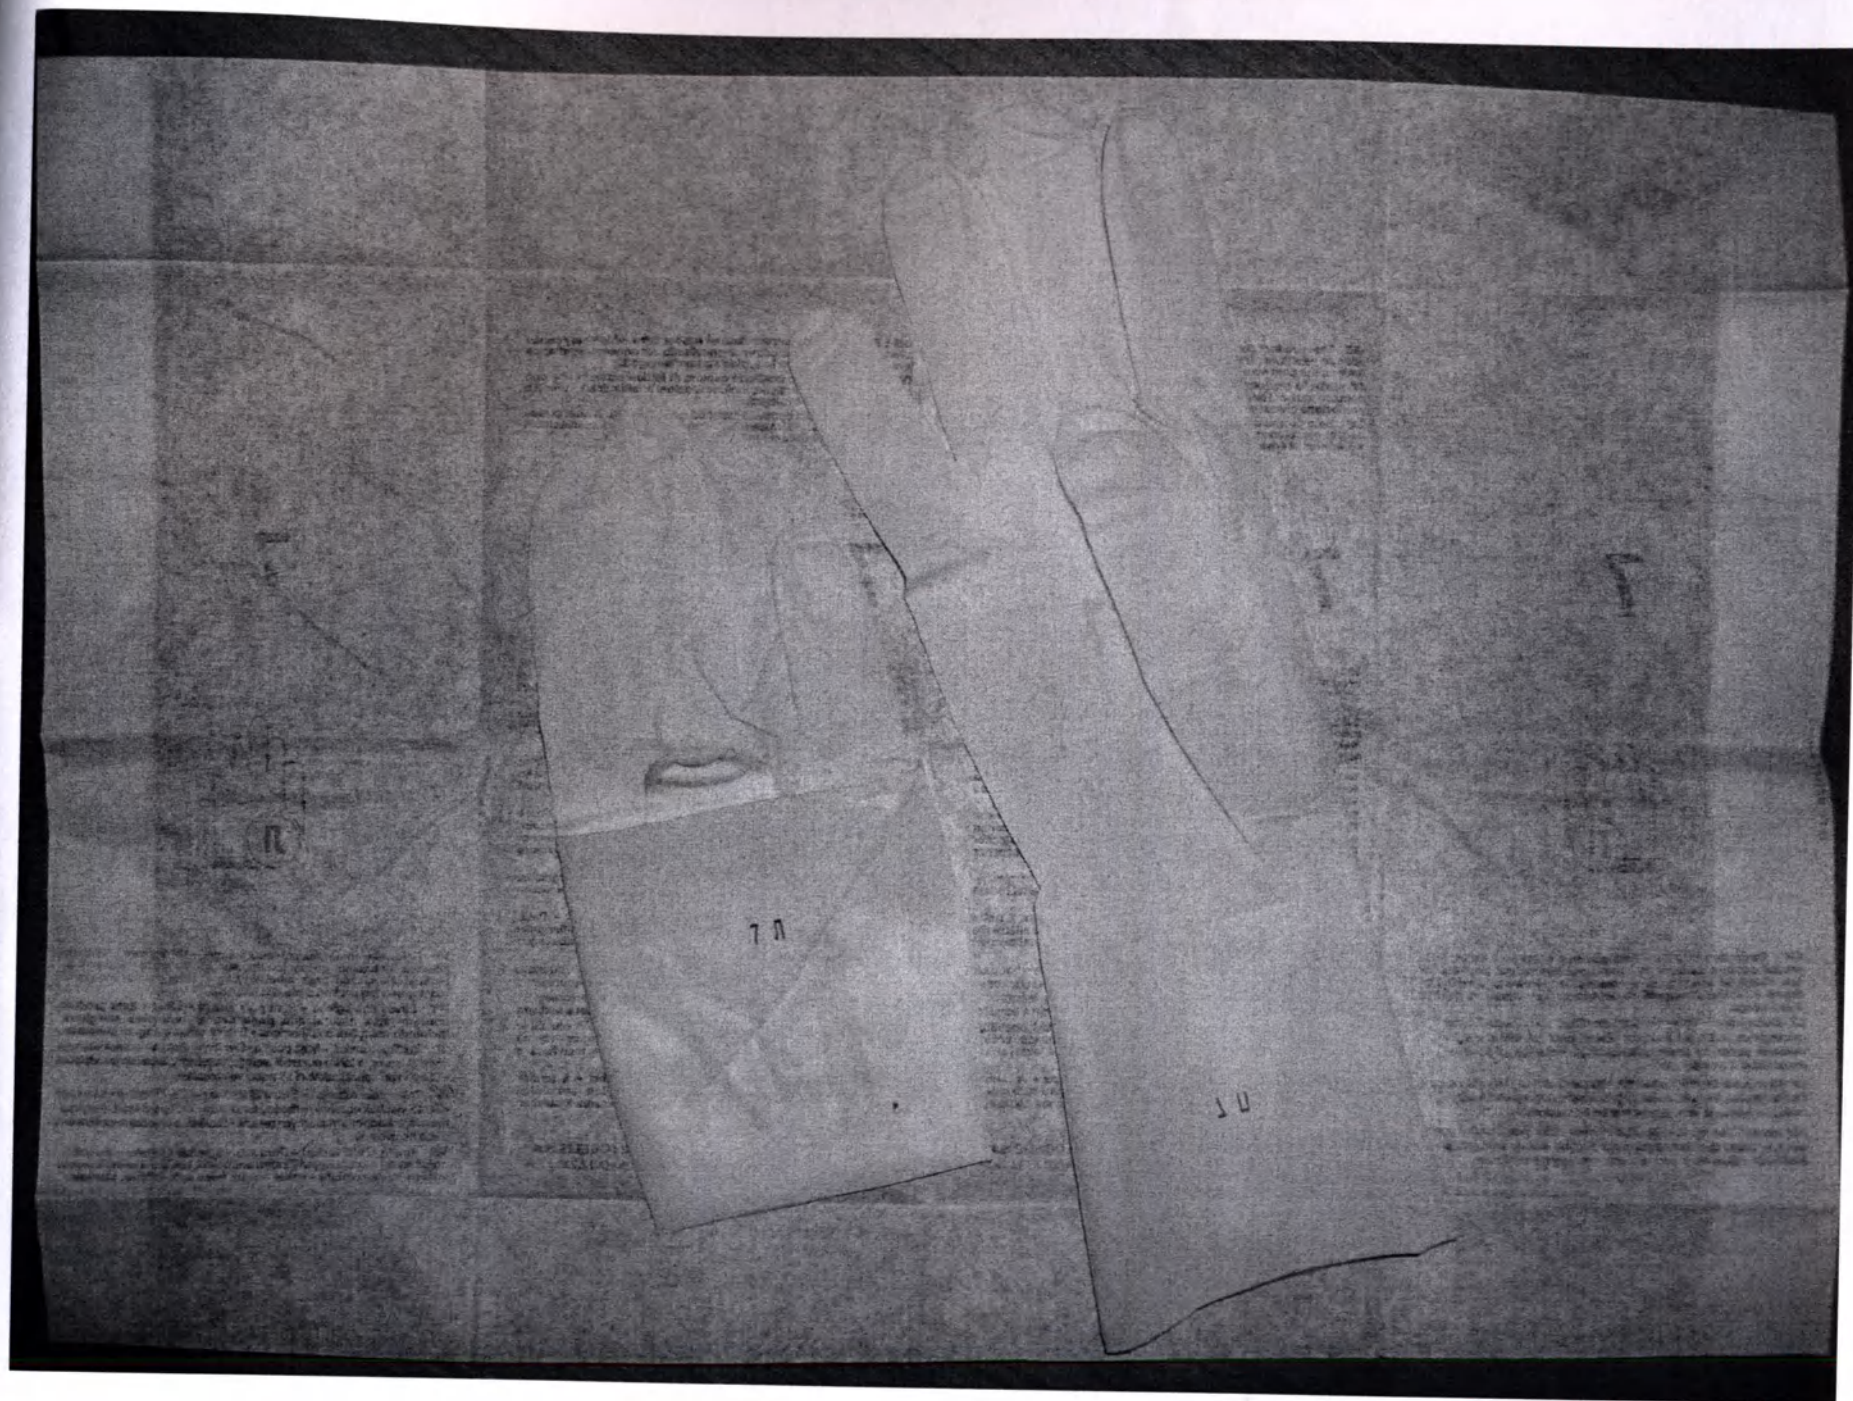


Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0270

LOT 027015-010 2015-10 2018-10 027015010342 SIZE 7

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
INTW0270 ГОСТ Р 52238-2004

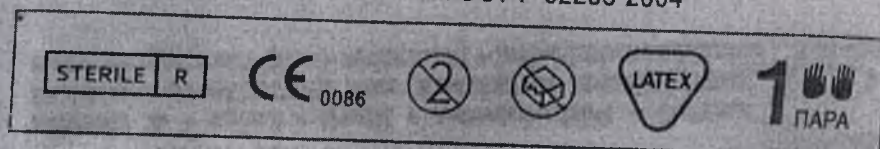

"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

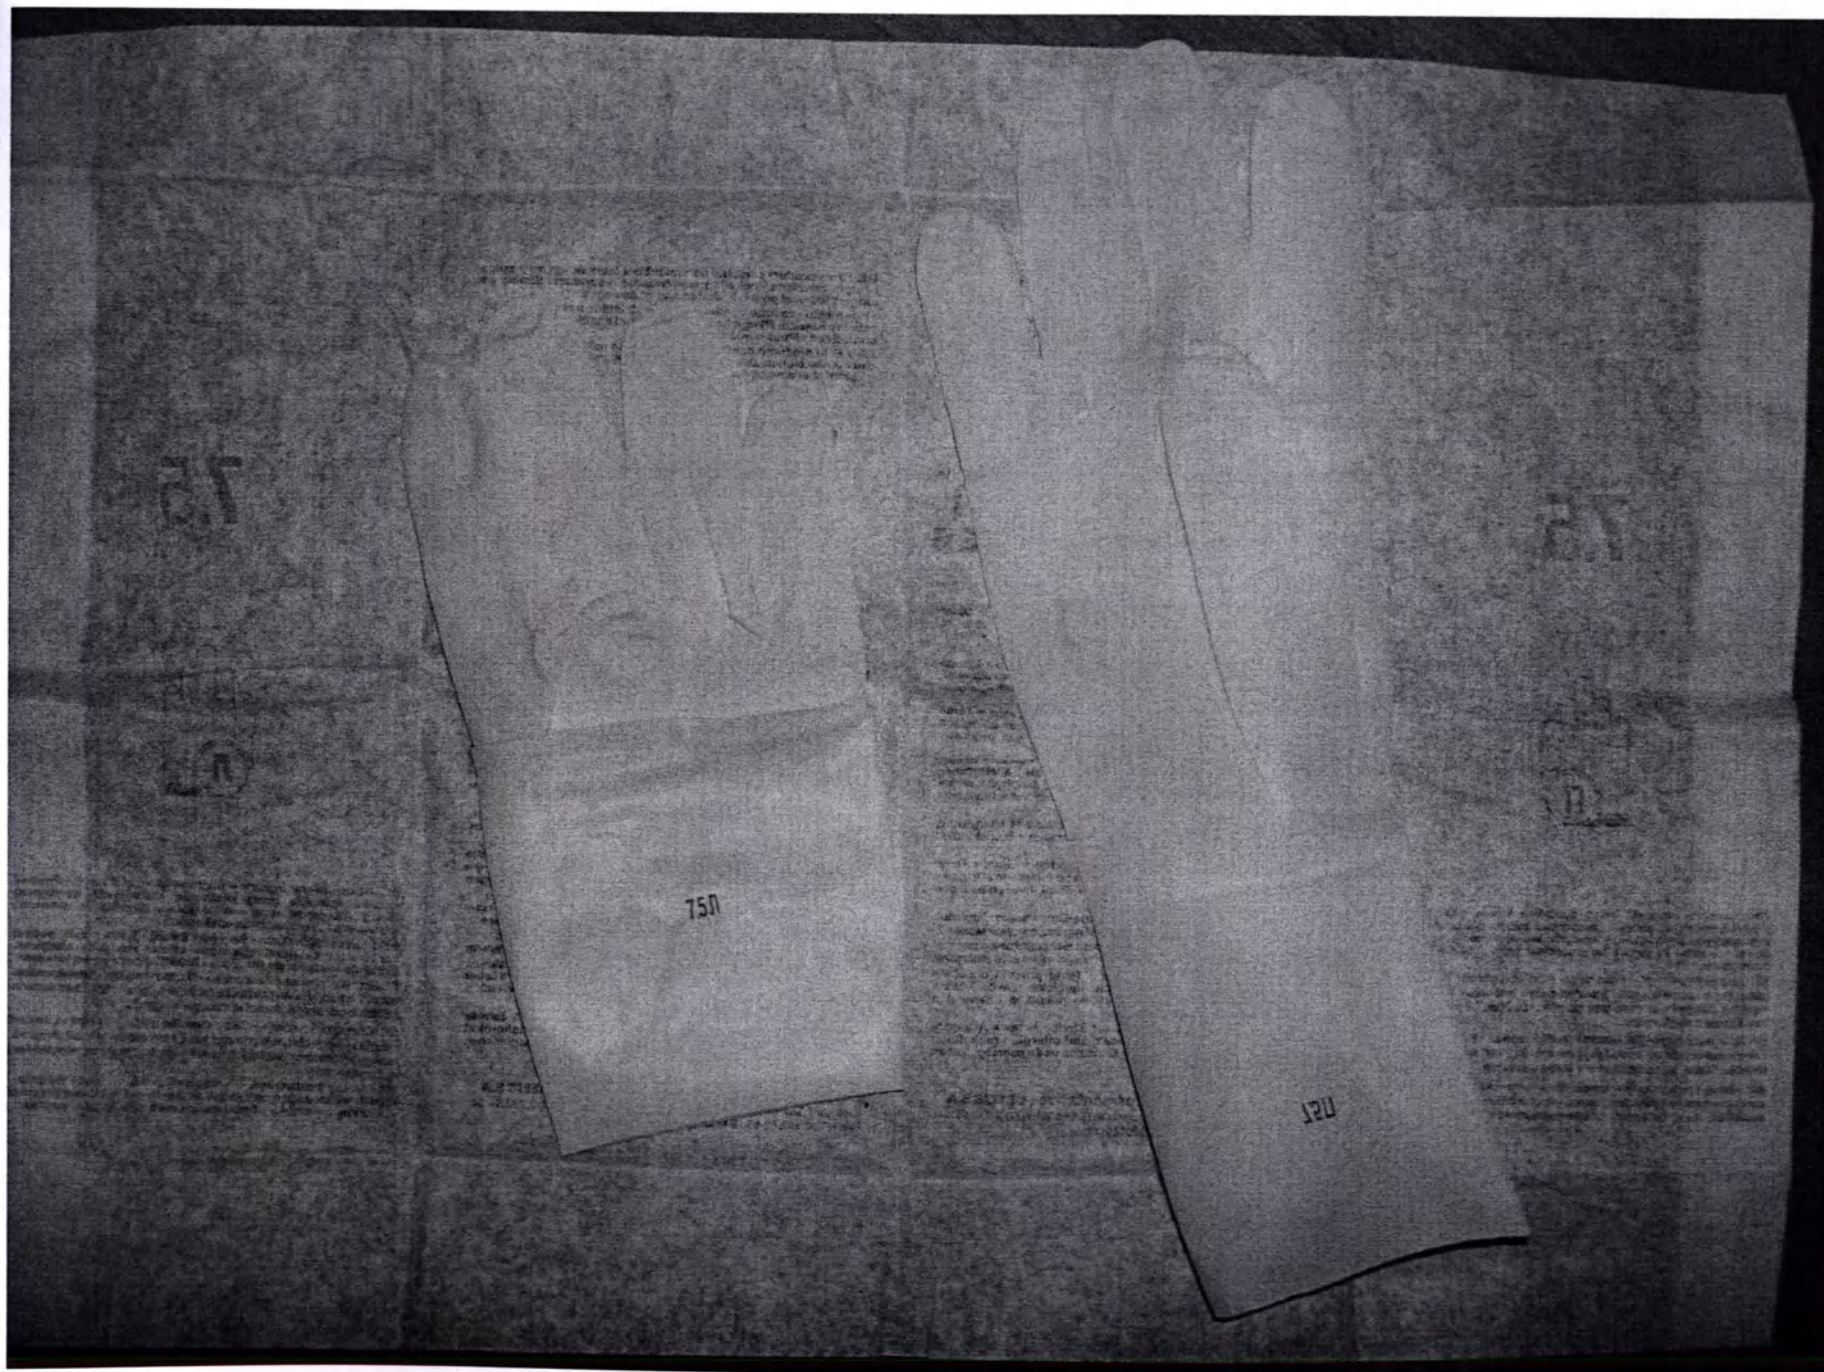


Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0275

LOT 027515-010 2015-10 2018-10 027515010361 SIZE 7.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
INTW0275 ГОСТ Р 52238-2004



"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

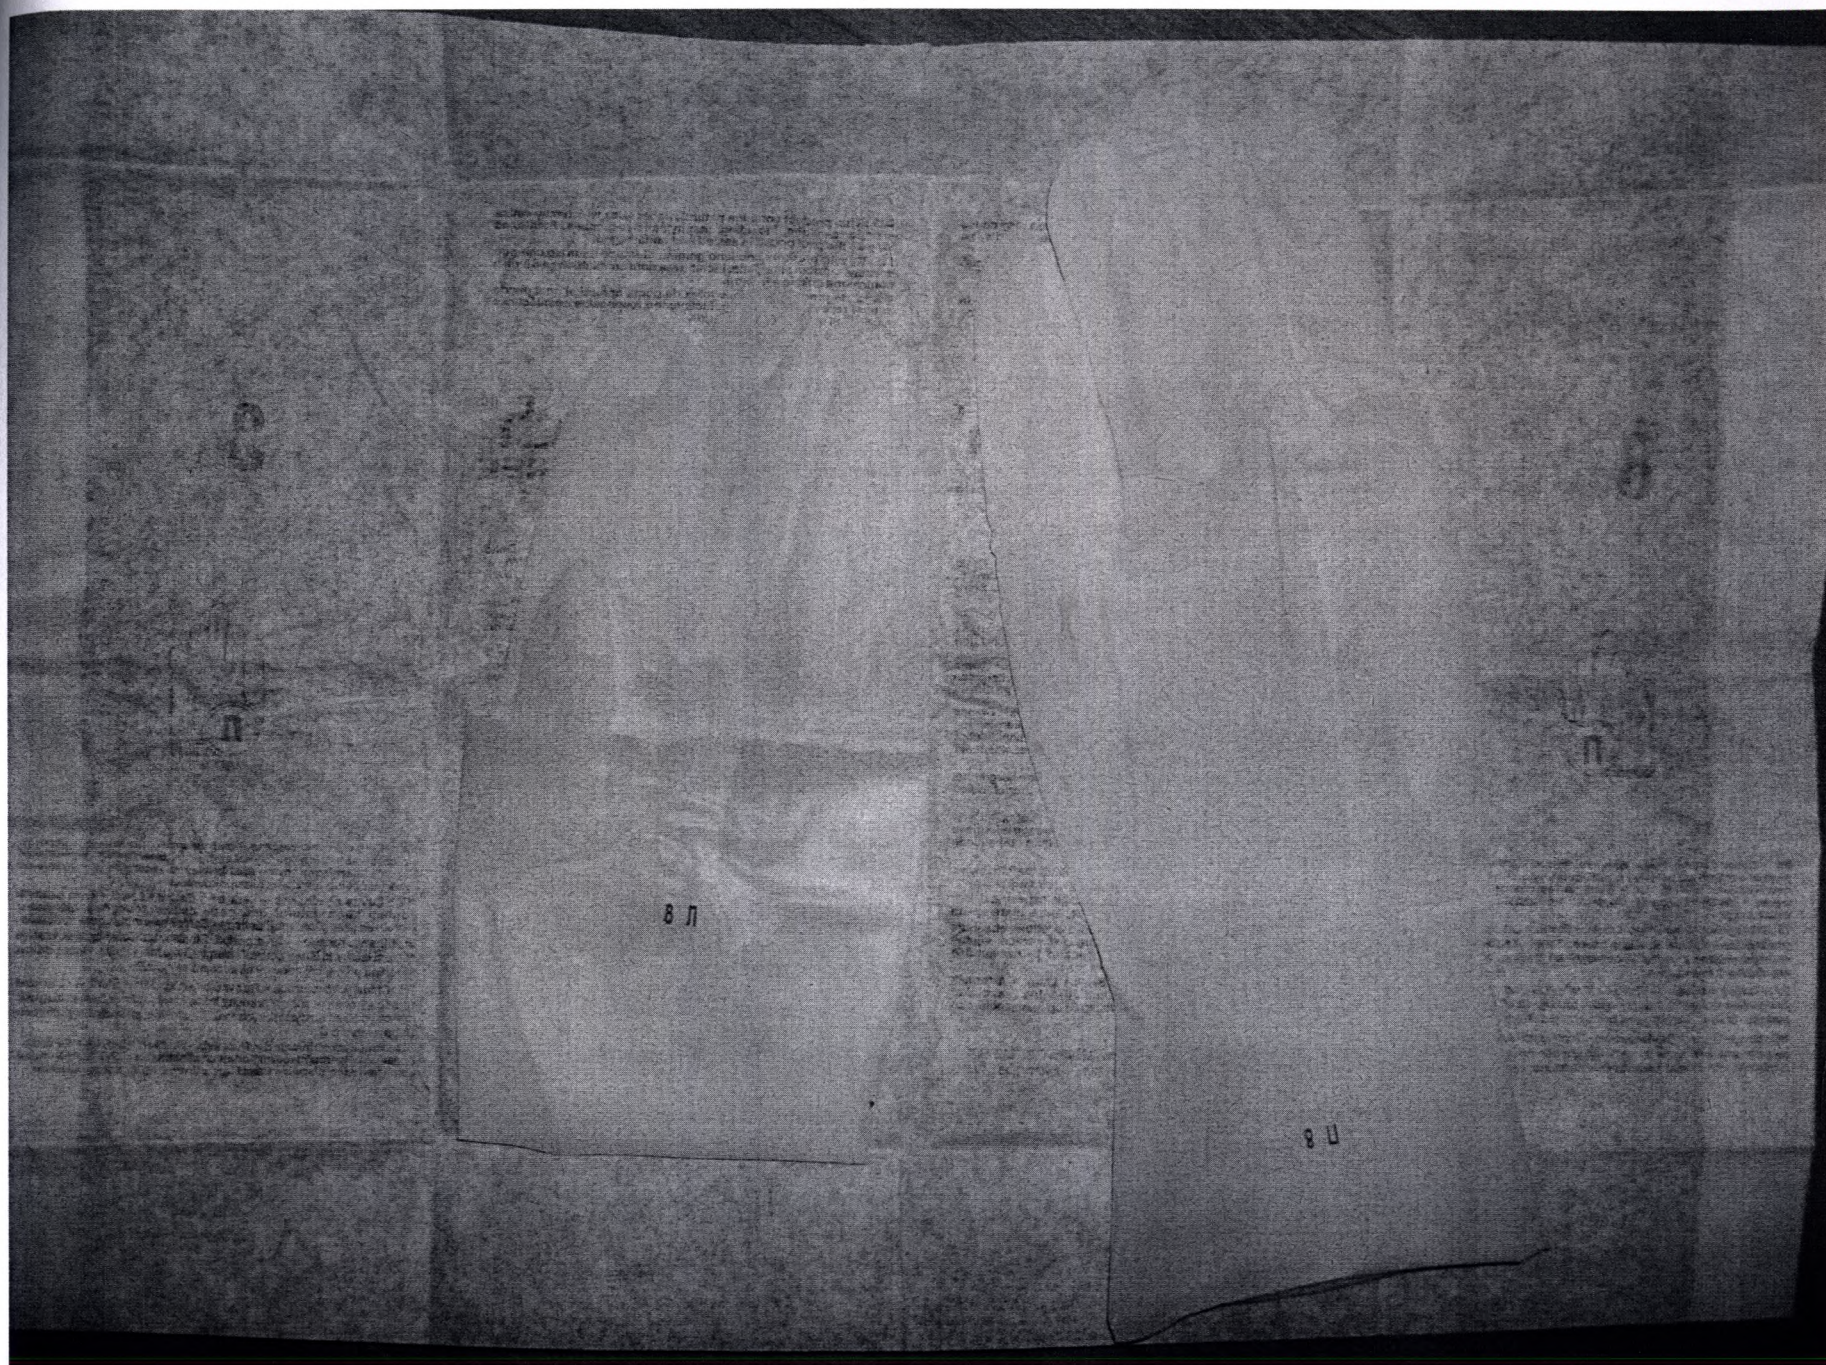


Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0280

LOT 028015-010 2015-10 2018-10 028015010375 SIZE 8

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
INTW0280 ГОСТ Р 52238-2004

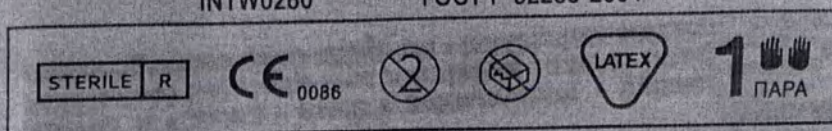

"ОДНОРАЗОВЫЕ"


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может
вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

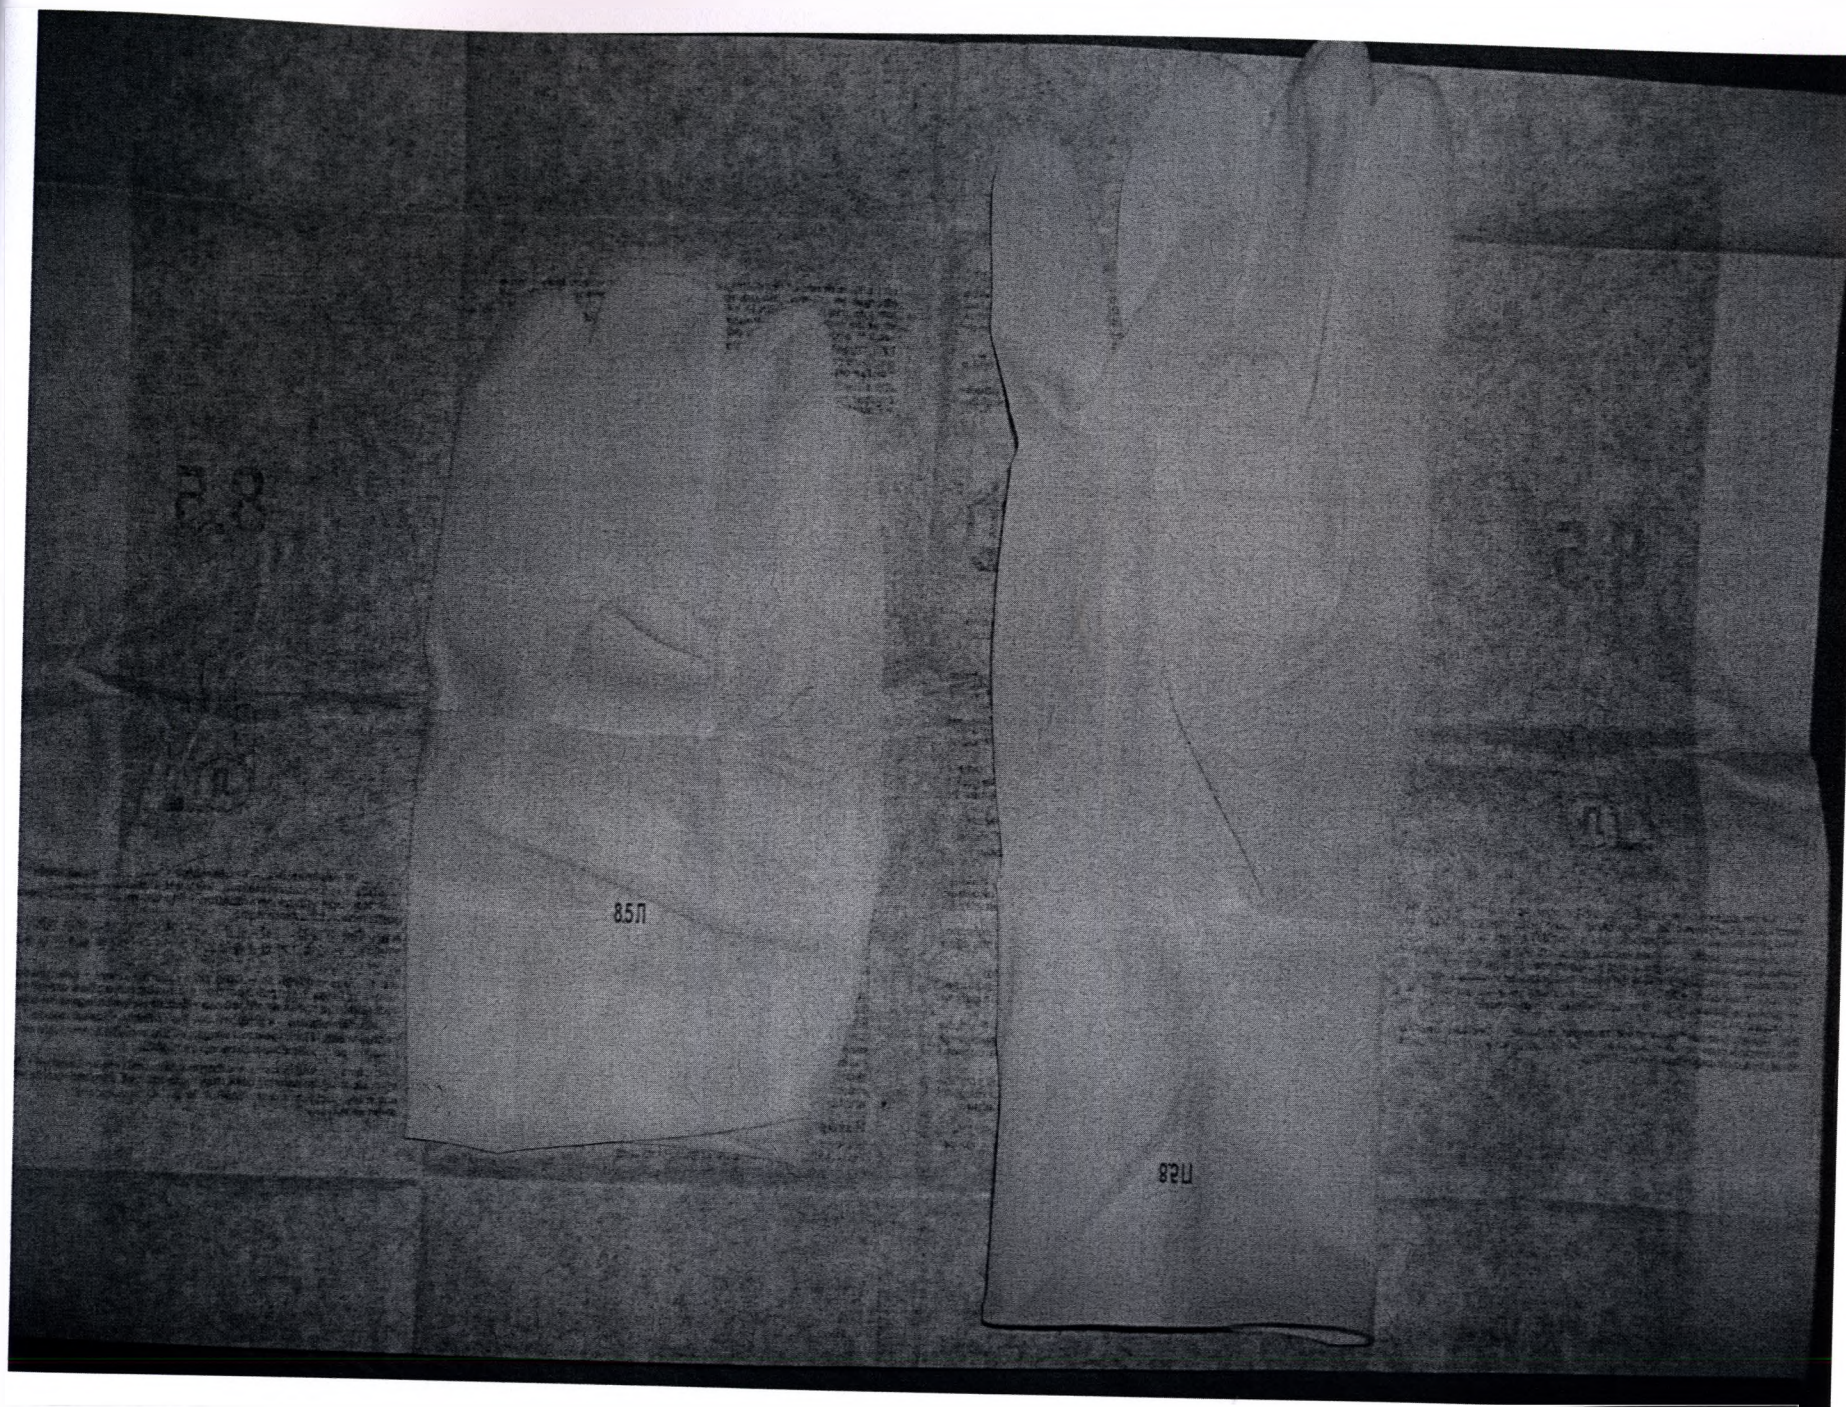


Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0285

LOT 028515-010 2015-10 2018-10 028515010386 SIZE 8.5

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
INTW0285 ГОСТ Р 52238-2004

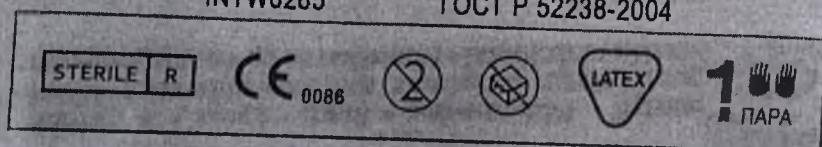

"ОДНОРАЗОВЫЕ"

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может
вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan. Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch» текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered INTW0290







 029015-010 2015-10 2018-10 029015010394 9

iNtouch®

Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные одноразовые «iNtouch»
 текстурированные на пальцах, без валика, анатомические Intouch Powdered
 INTW0290 ГОСТ Р 52238-2004



"ОДНОРАЗОВЫЕ"

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.

 WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 ½, Jalan Meru, 41050
 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
 потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
 Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

ООО «ГЛОМАКО»

Итого в настояще документе
49 листа (ов)

Генеральный директор
Алиев А.А.

