

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЛОМАКО»

А.А. Алиев

« 29 » мая 2015 г.




Фотографии изделия медицинского назначения

Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные одноразовые «iNtouch»




Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0955

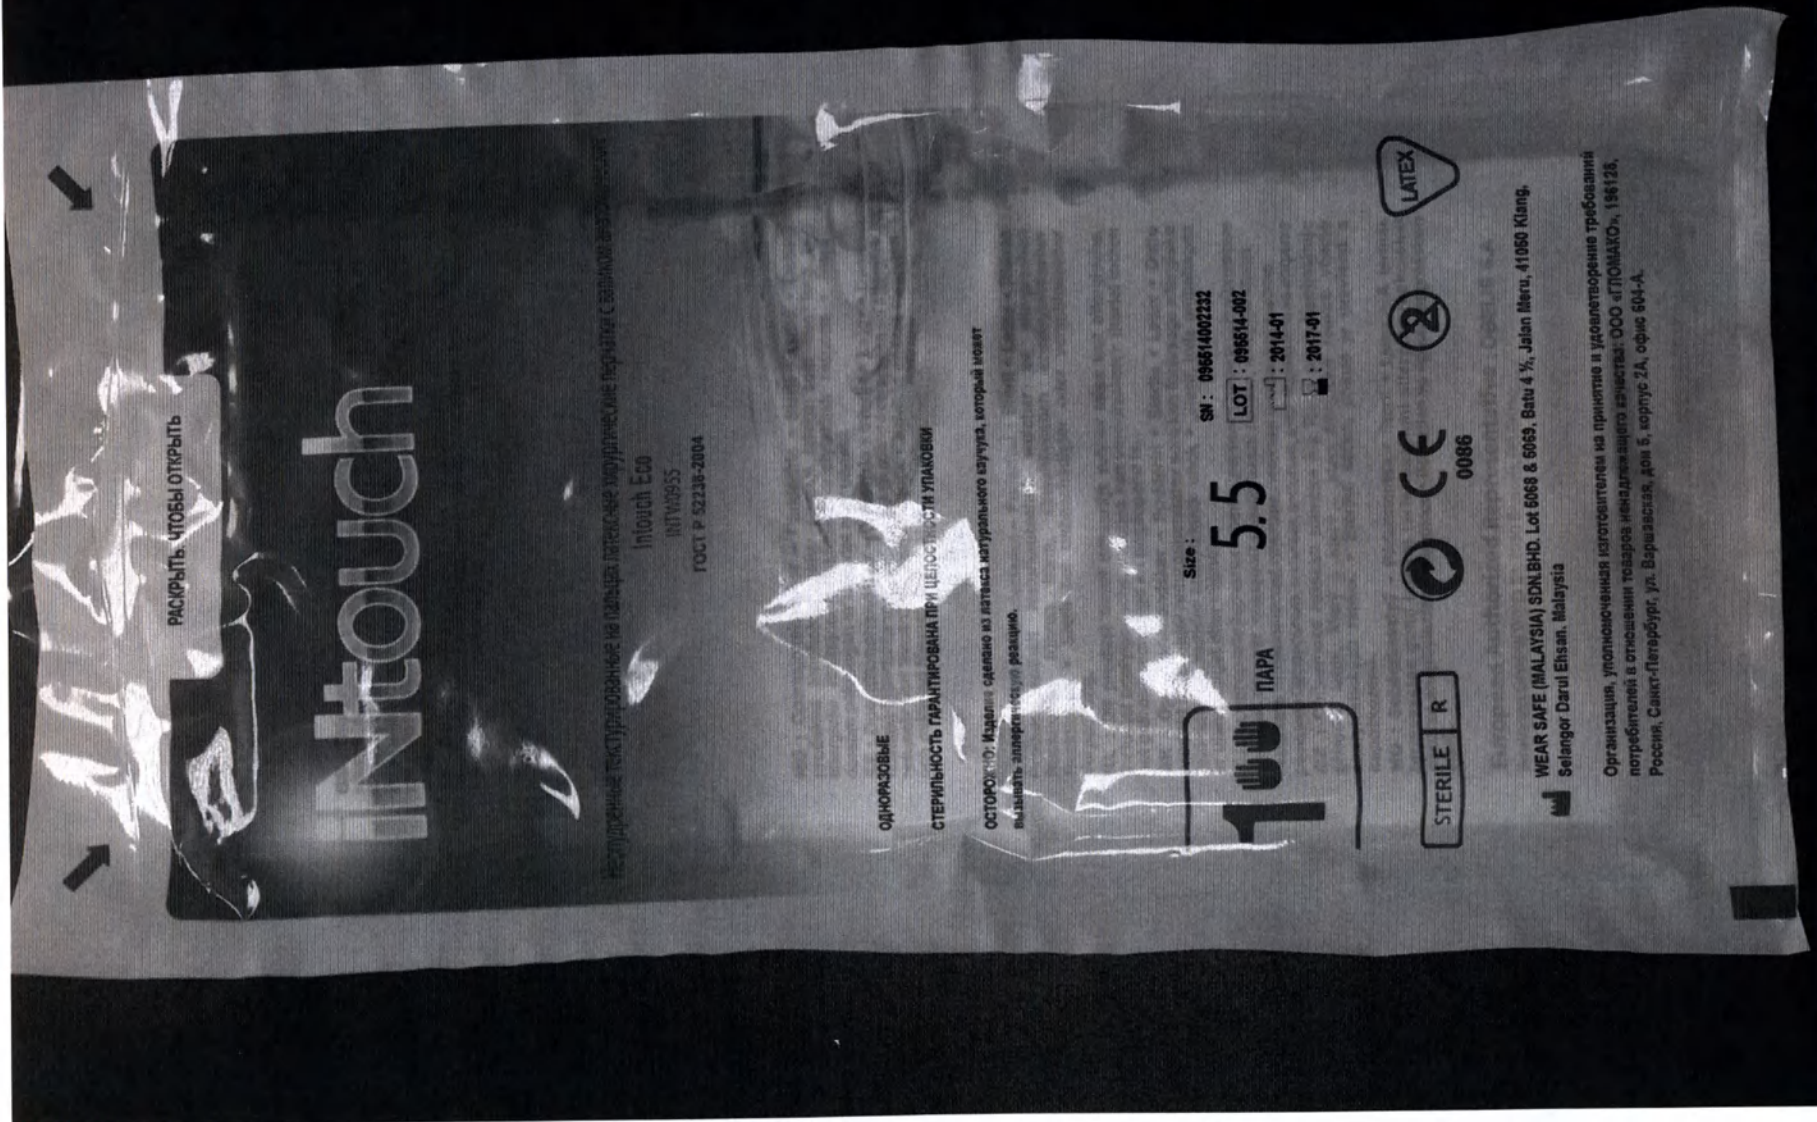

Упаковка для перчаток INTW0955




Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0960

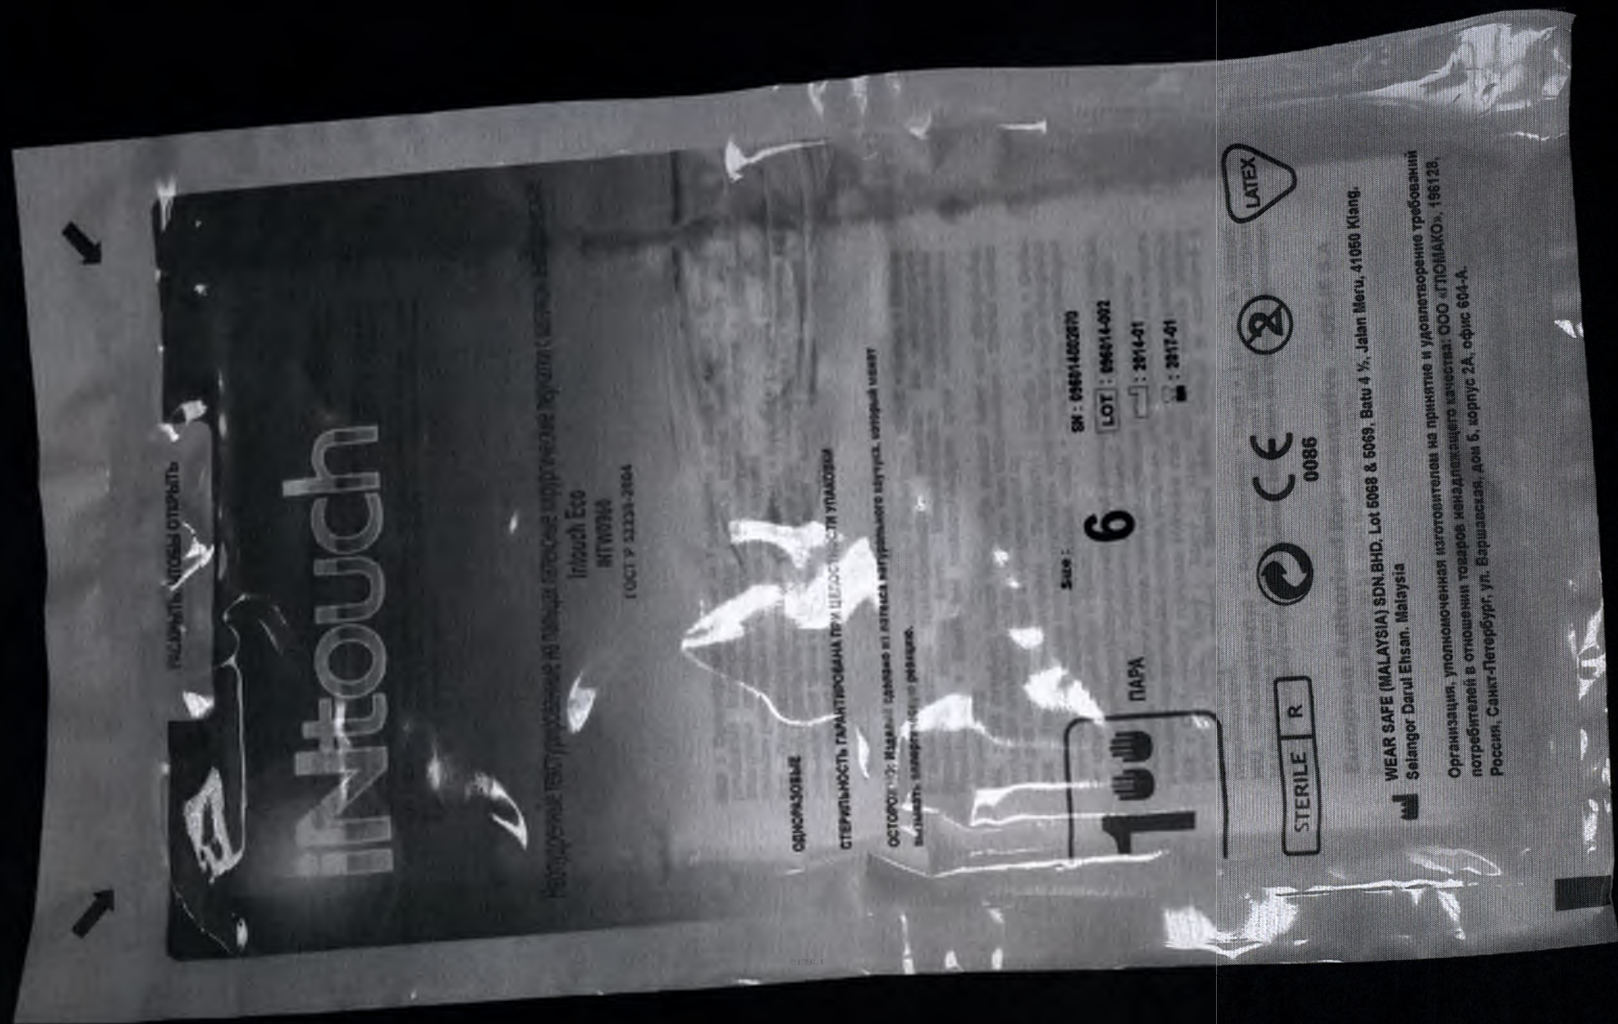

Упаковка для перчаток INTW0960

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0965

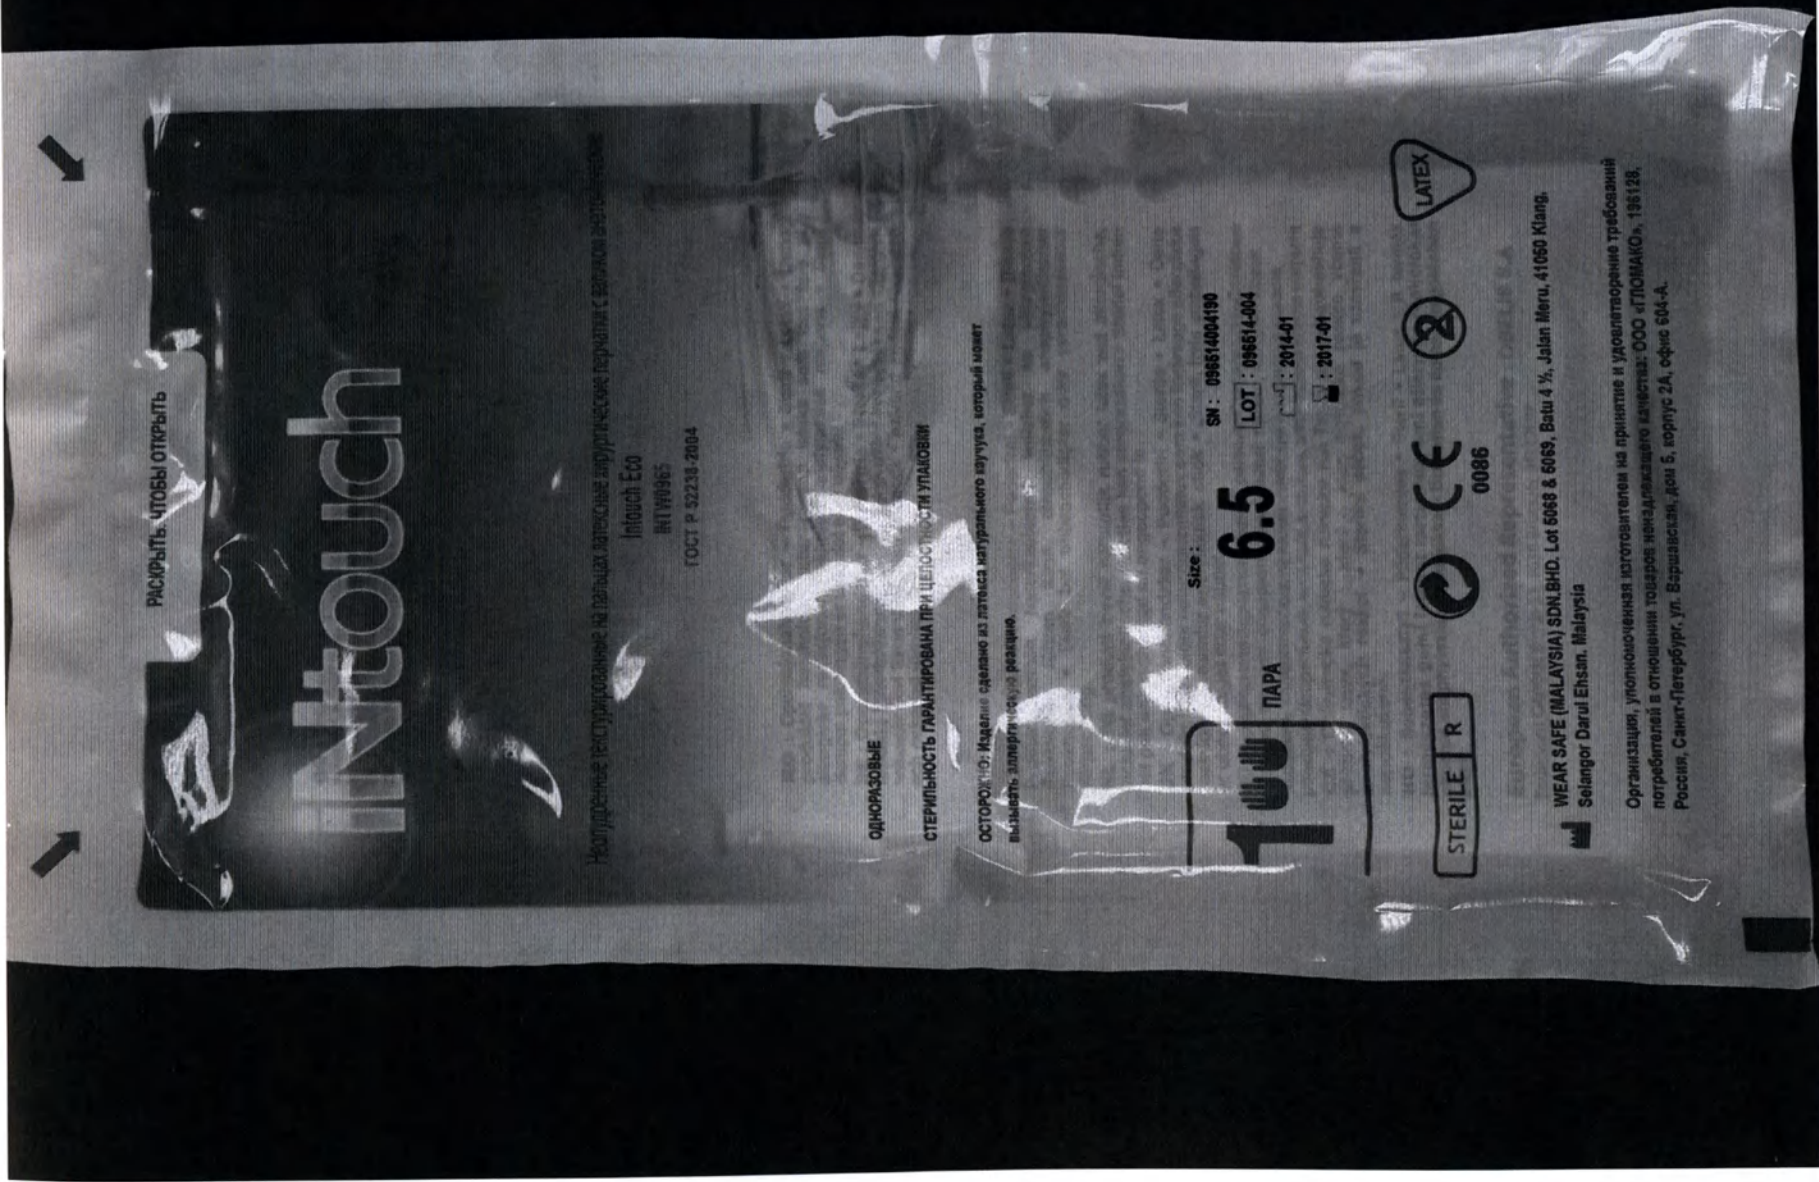

Упаковка для перчаток INTW0965



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0970

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

INTouch

Неслучайные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомической формы

Intouch Eco
INTW0970
ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



ПАРА

Size :

7

SN : 097014006111

LOT : 097014-006

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE
0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

G-PO-SINTPF-F-R1



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0975

Упаковка для перчаток INTW0975

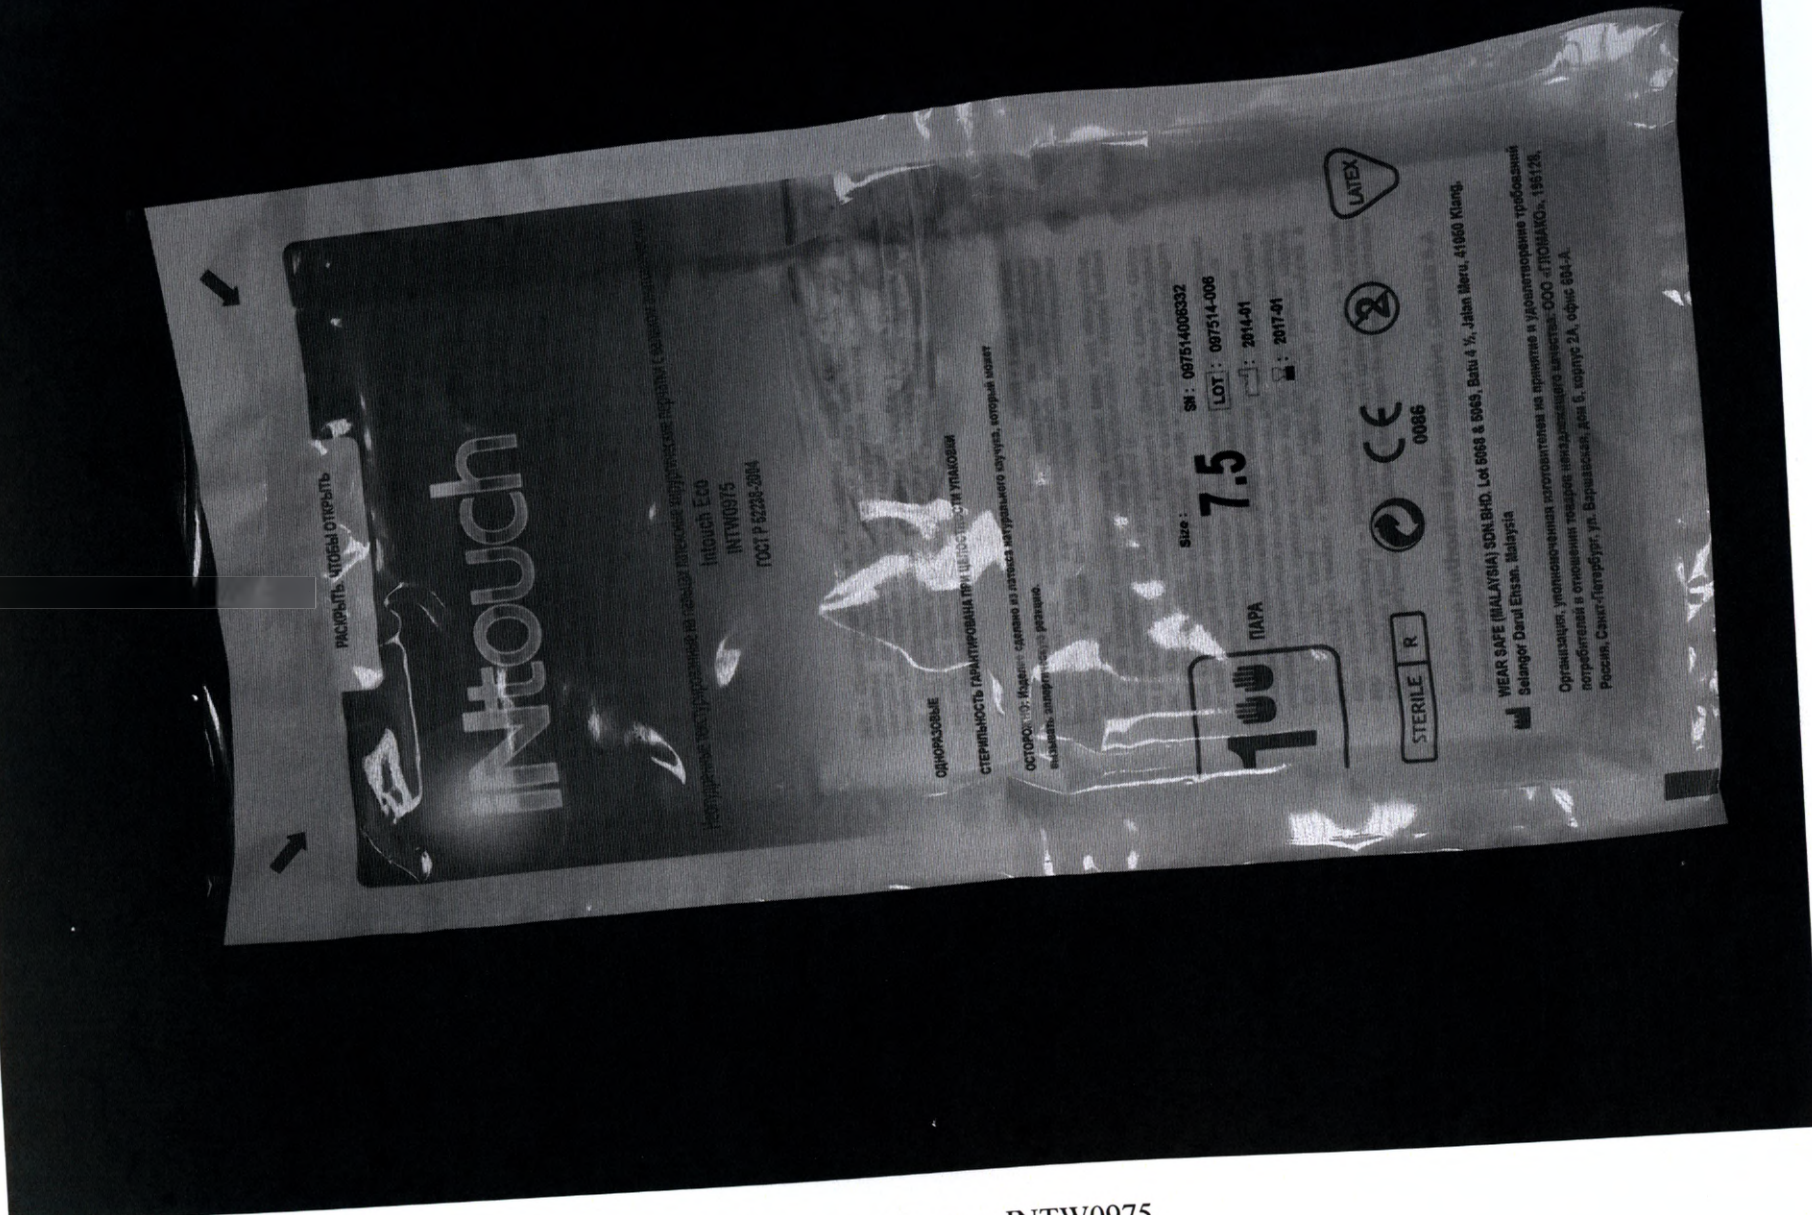



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0980

РАСКРЫТЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Неодрированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком запястья

Intouch Eco

INTW0980

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



Size :

8

SN : 097614004415

LOT : 098014-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE

0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров надлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0980



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0985

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Нестерильные текстурированные латексные хирургические перчатки с высоким анатомическим

Intouch Eco

INTW0985

GOST Р 57238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size :

8.5

ПАРА

SN : 098514001271

LOT : 098514-001

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE

0096




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 6068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ПТОСЛАВ», 196126, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варахская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А


Упаковка для перчаток INTW0985



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Eco INTW0990

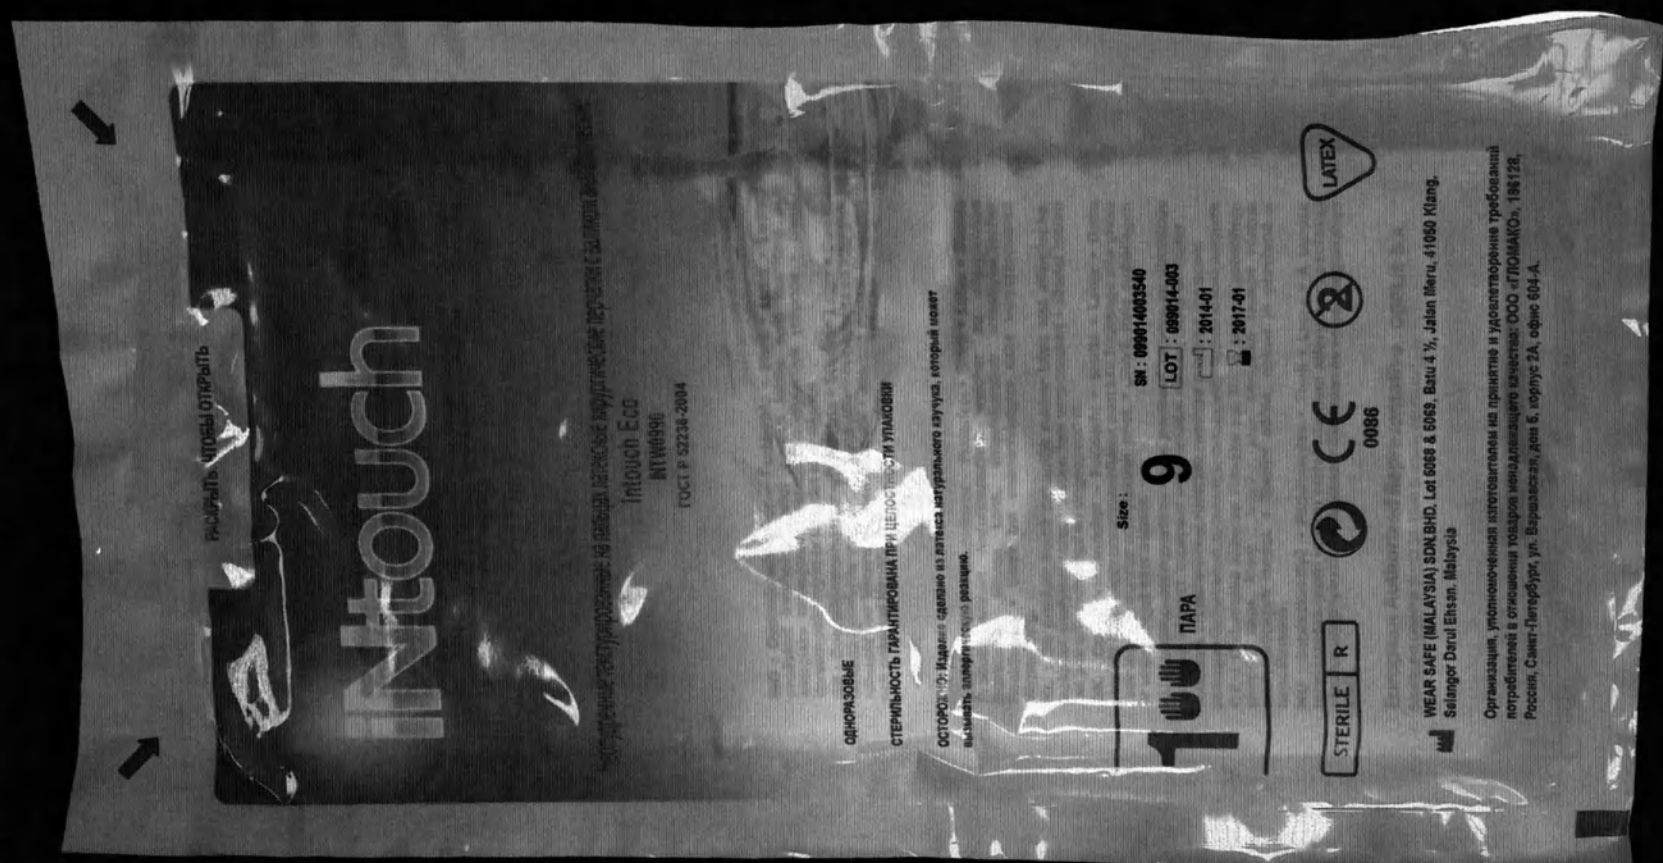

Упаковка для перчаток INTW0990

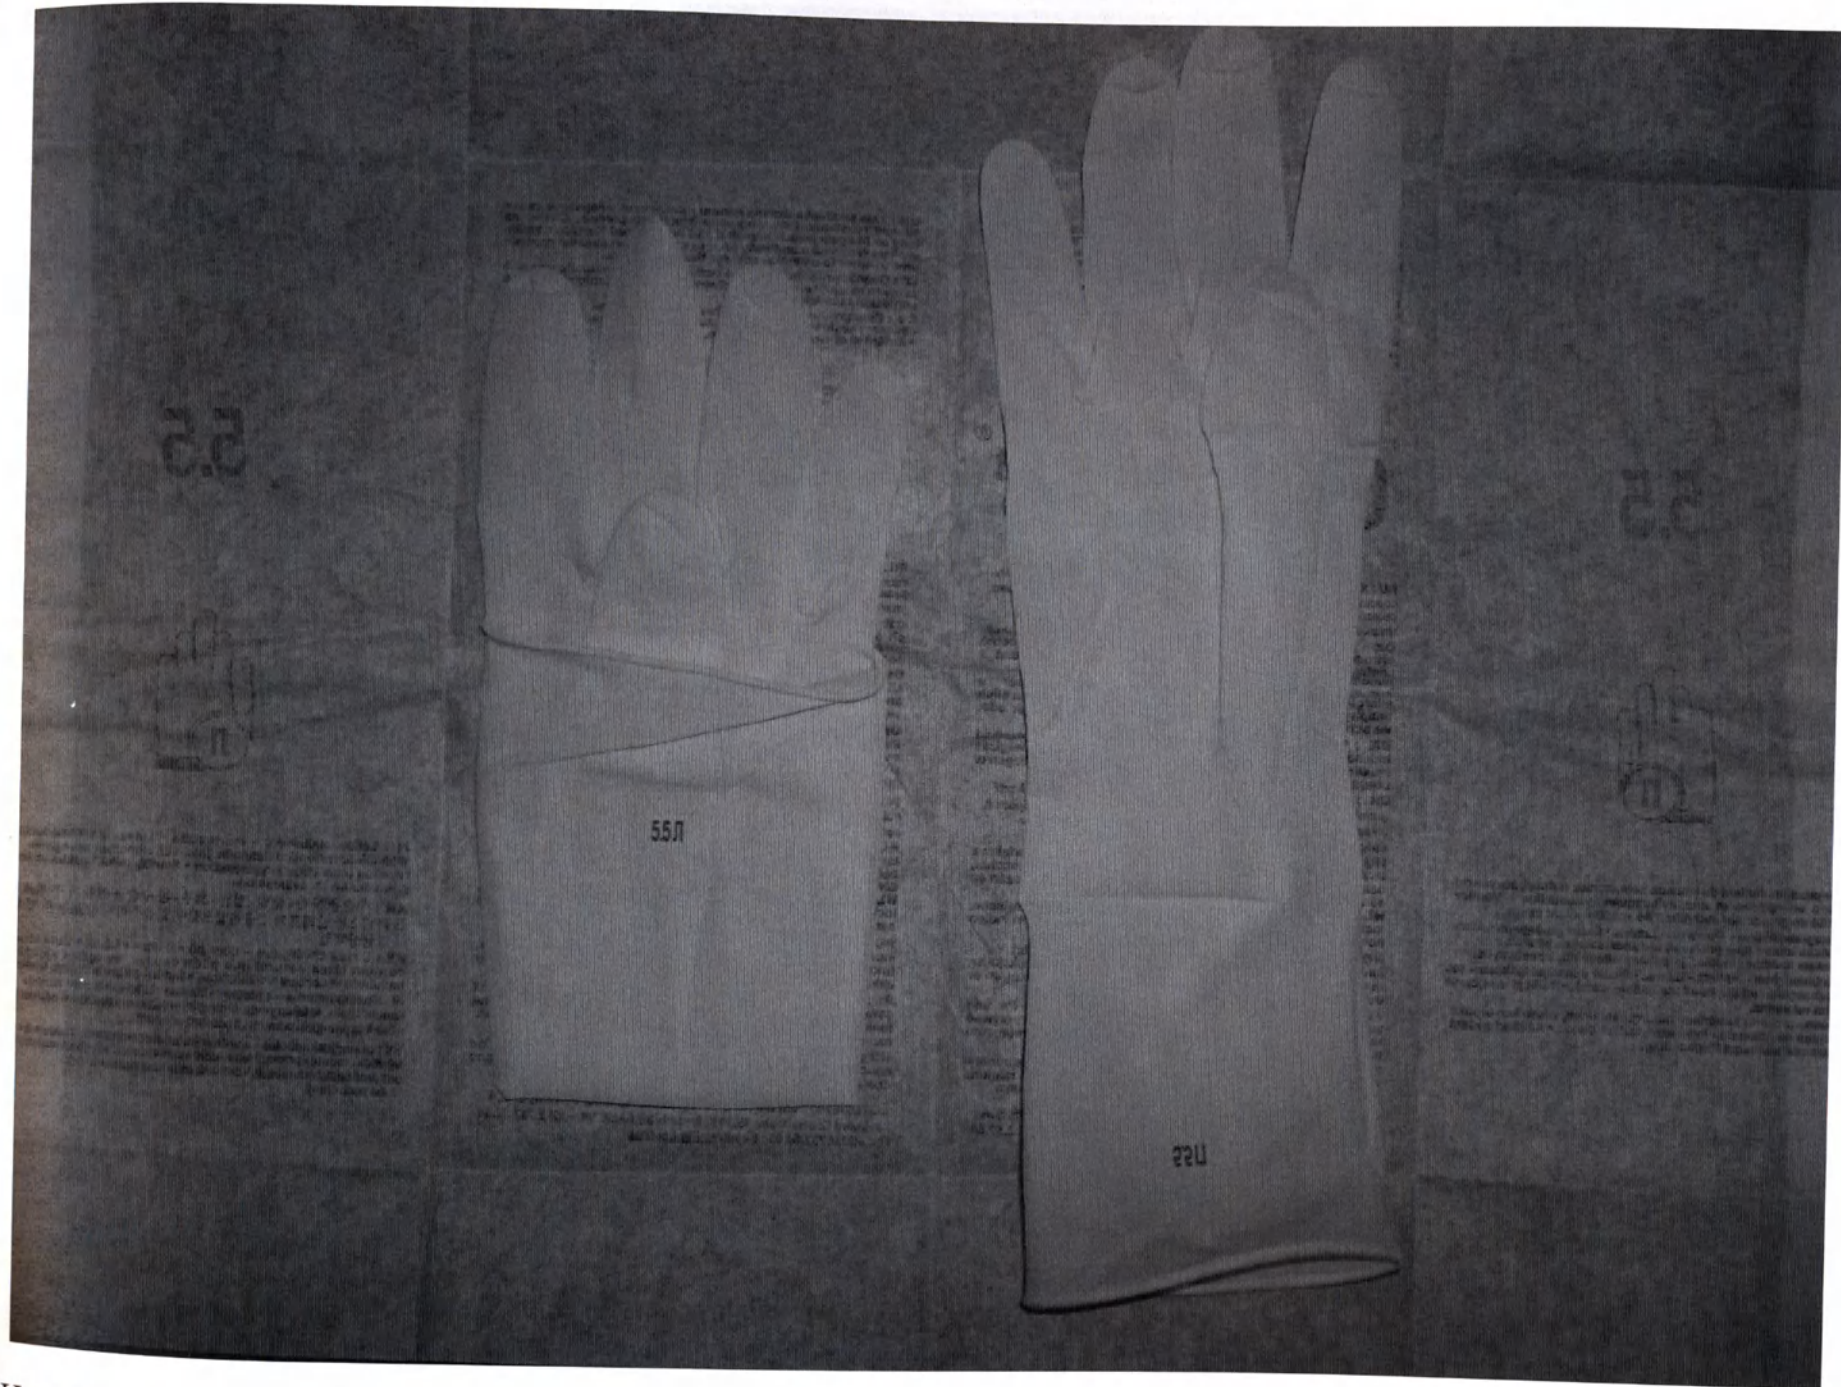

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0555

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :
5.5

SN : 055514001315

LOT : 055514-001

Exp : 2014-01

Exp : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0555

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 6066 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0555

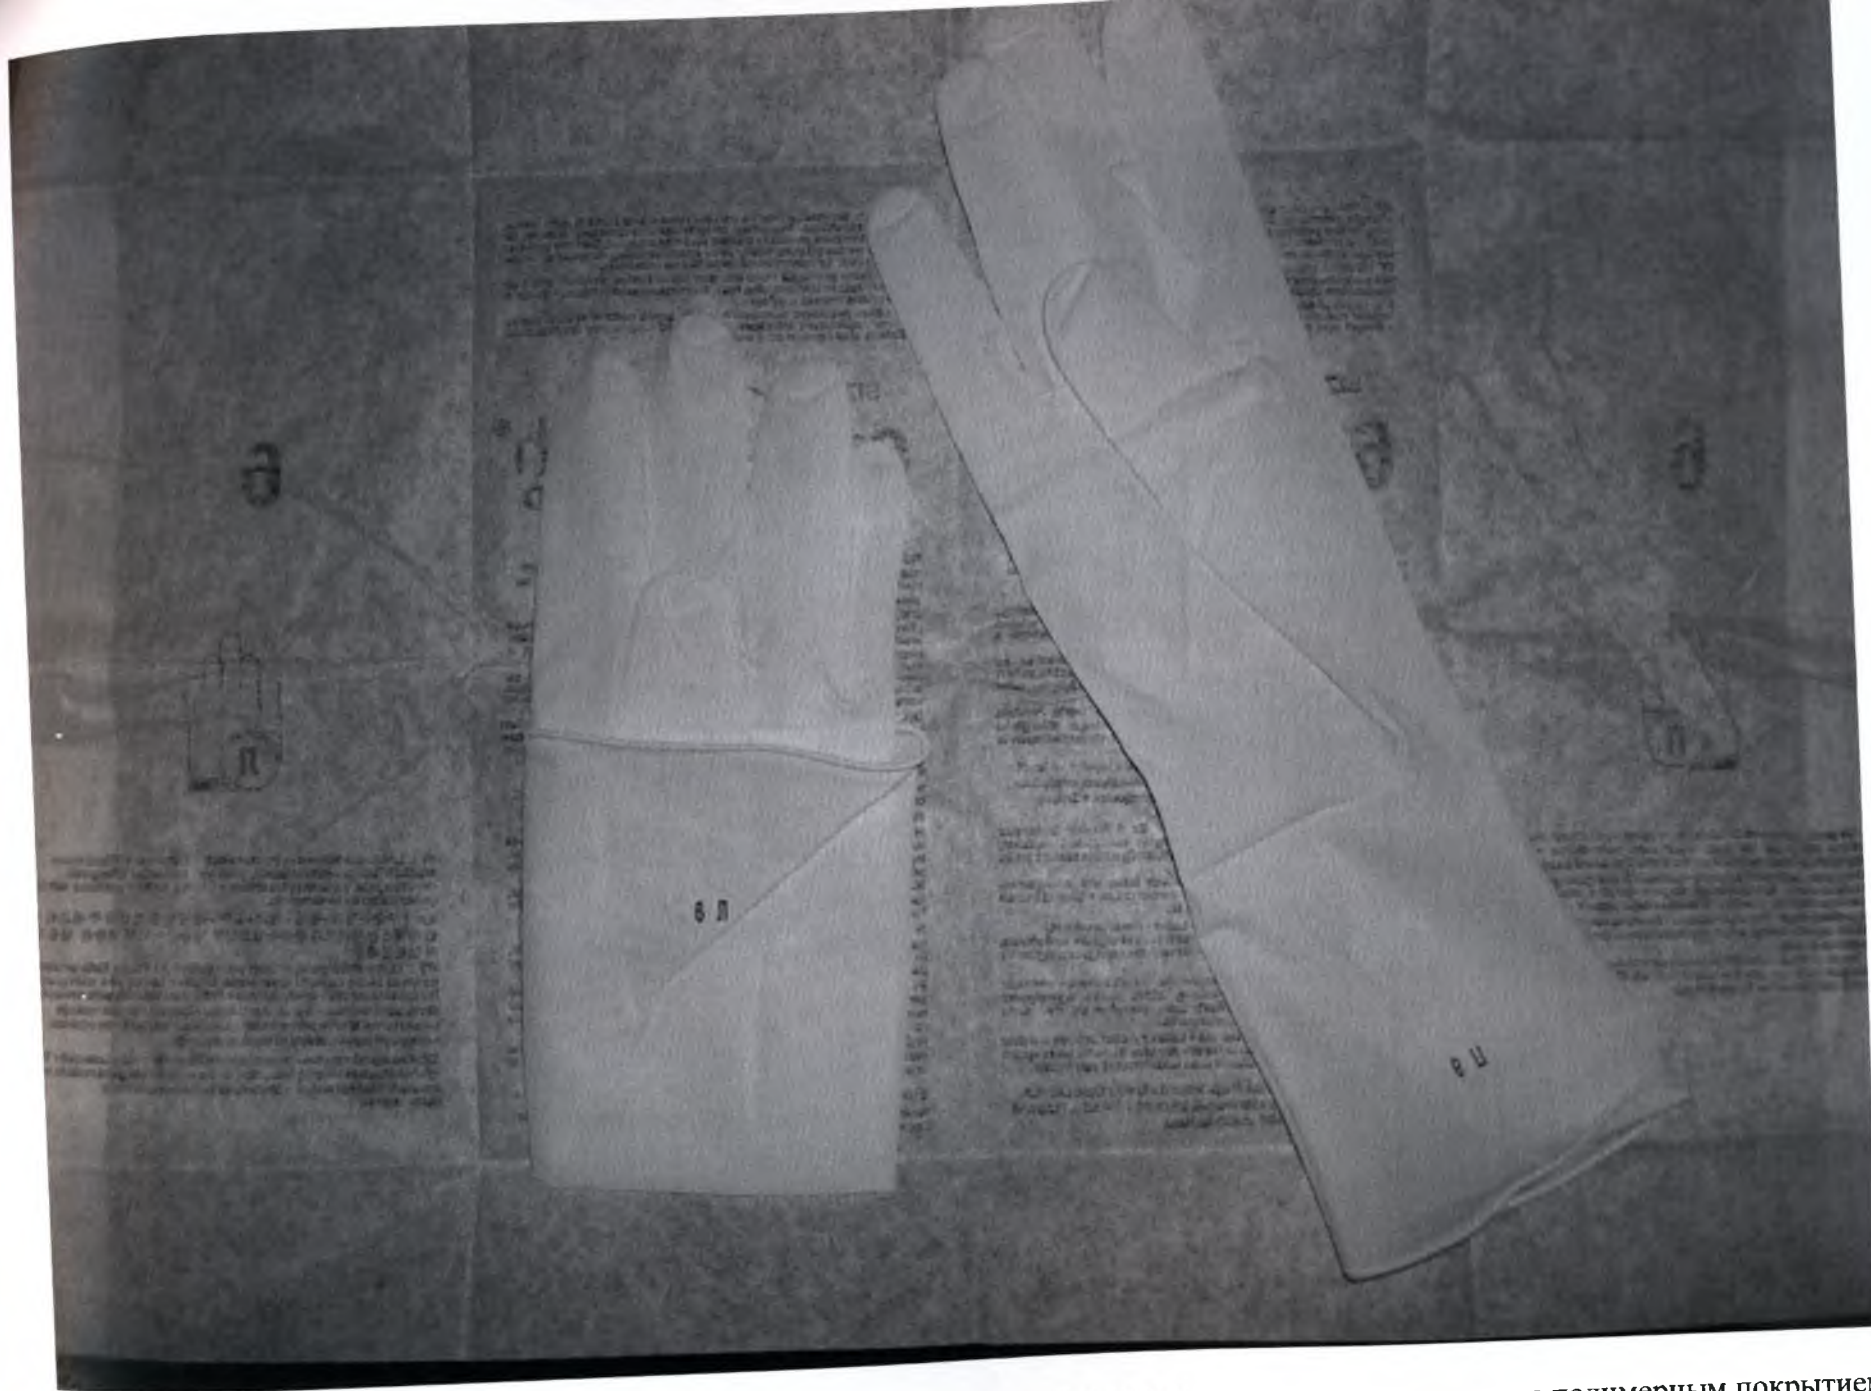

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0560

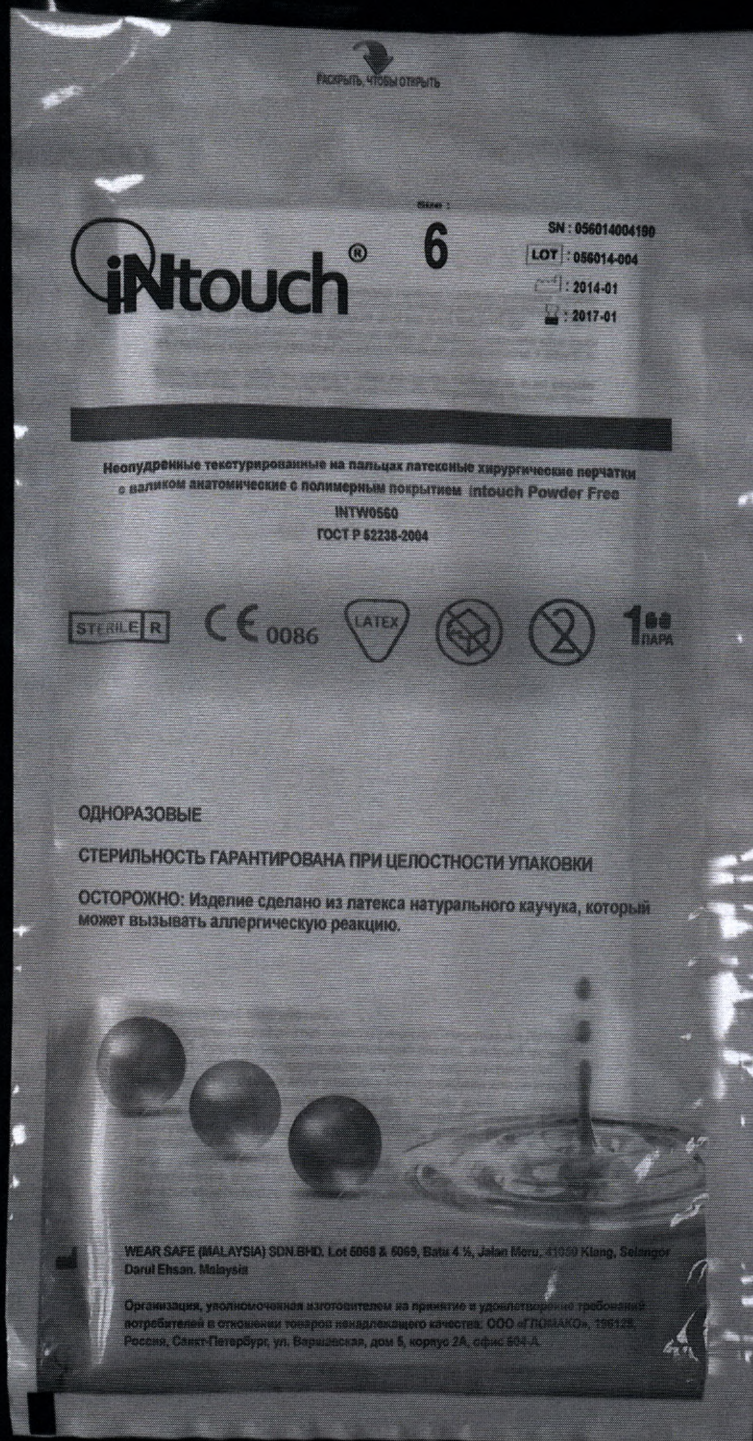



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0565

iNtouch®

Size :
6.5

SN : 056514005293

LOT : 056514-005

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0565

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086




100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

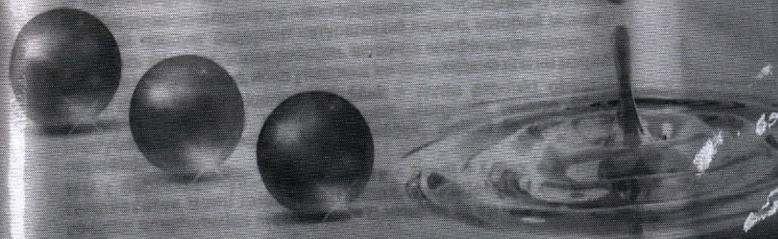

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

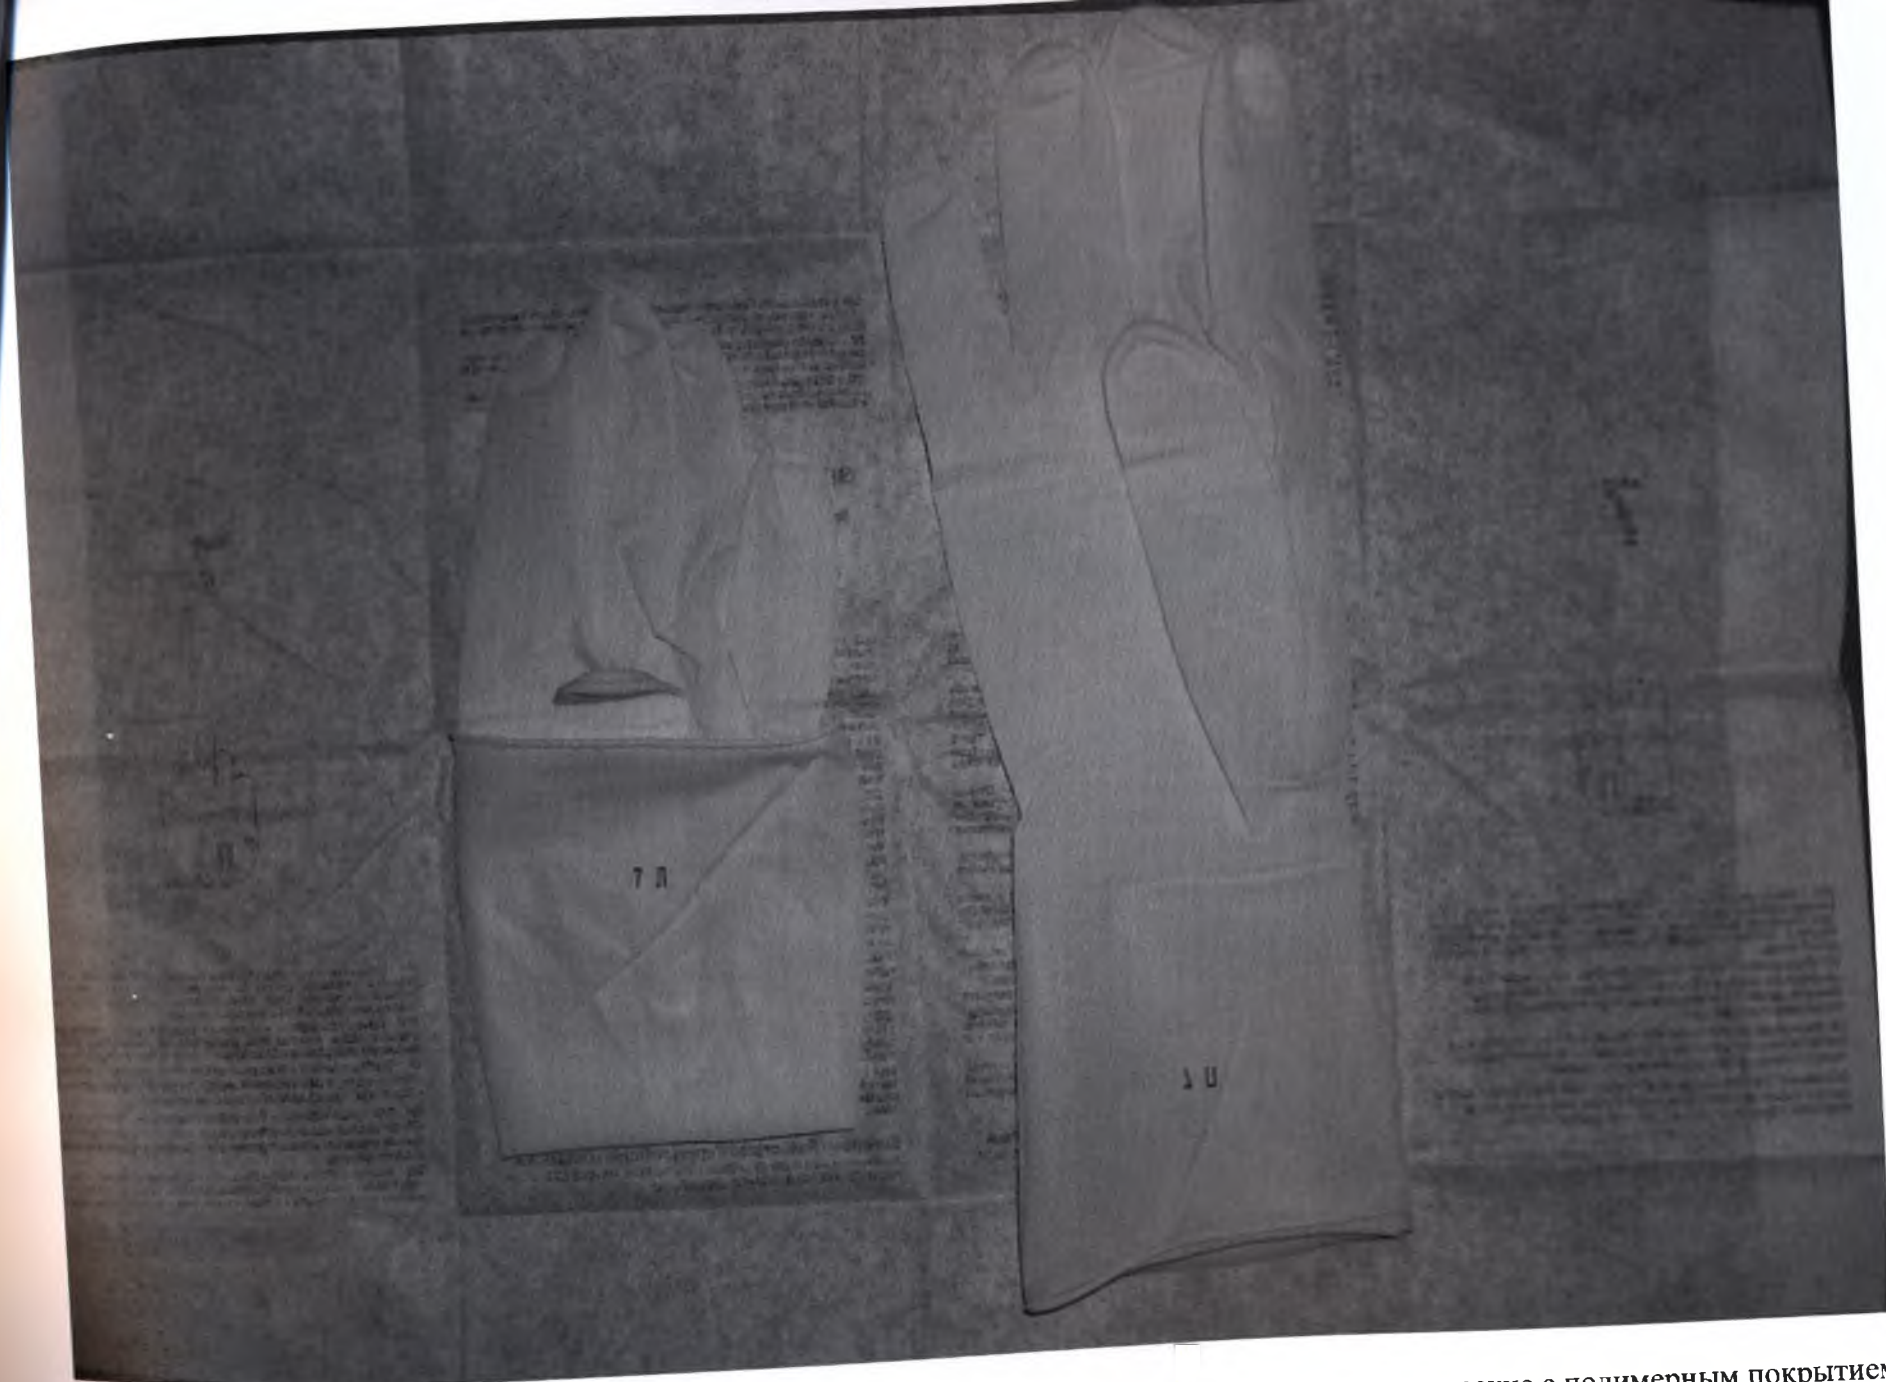

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0570

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size: 7

SN: 057014004356

LOT: 057014-004

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0570

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196125,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А.

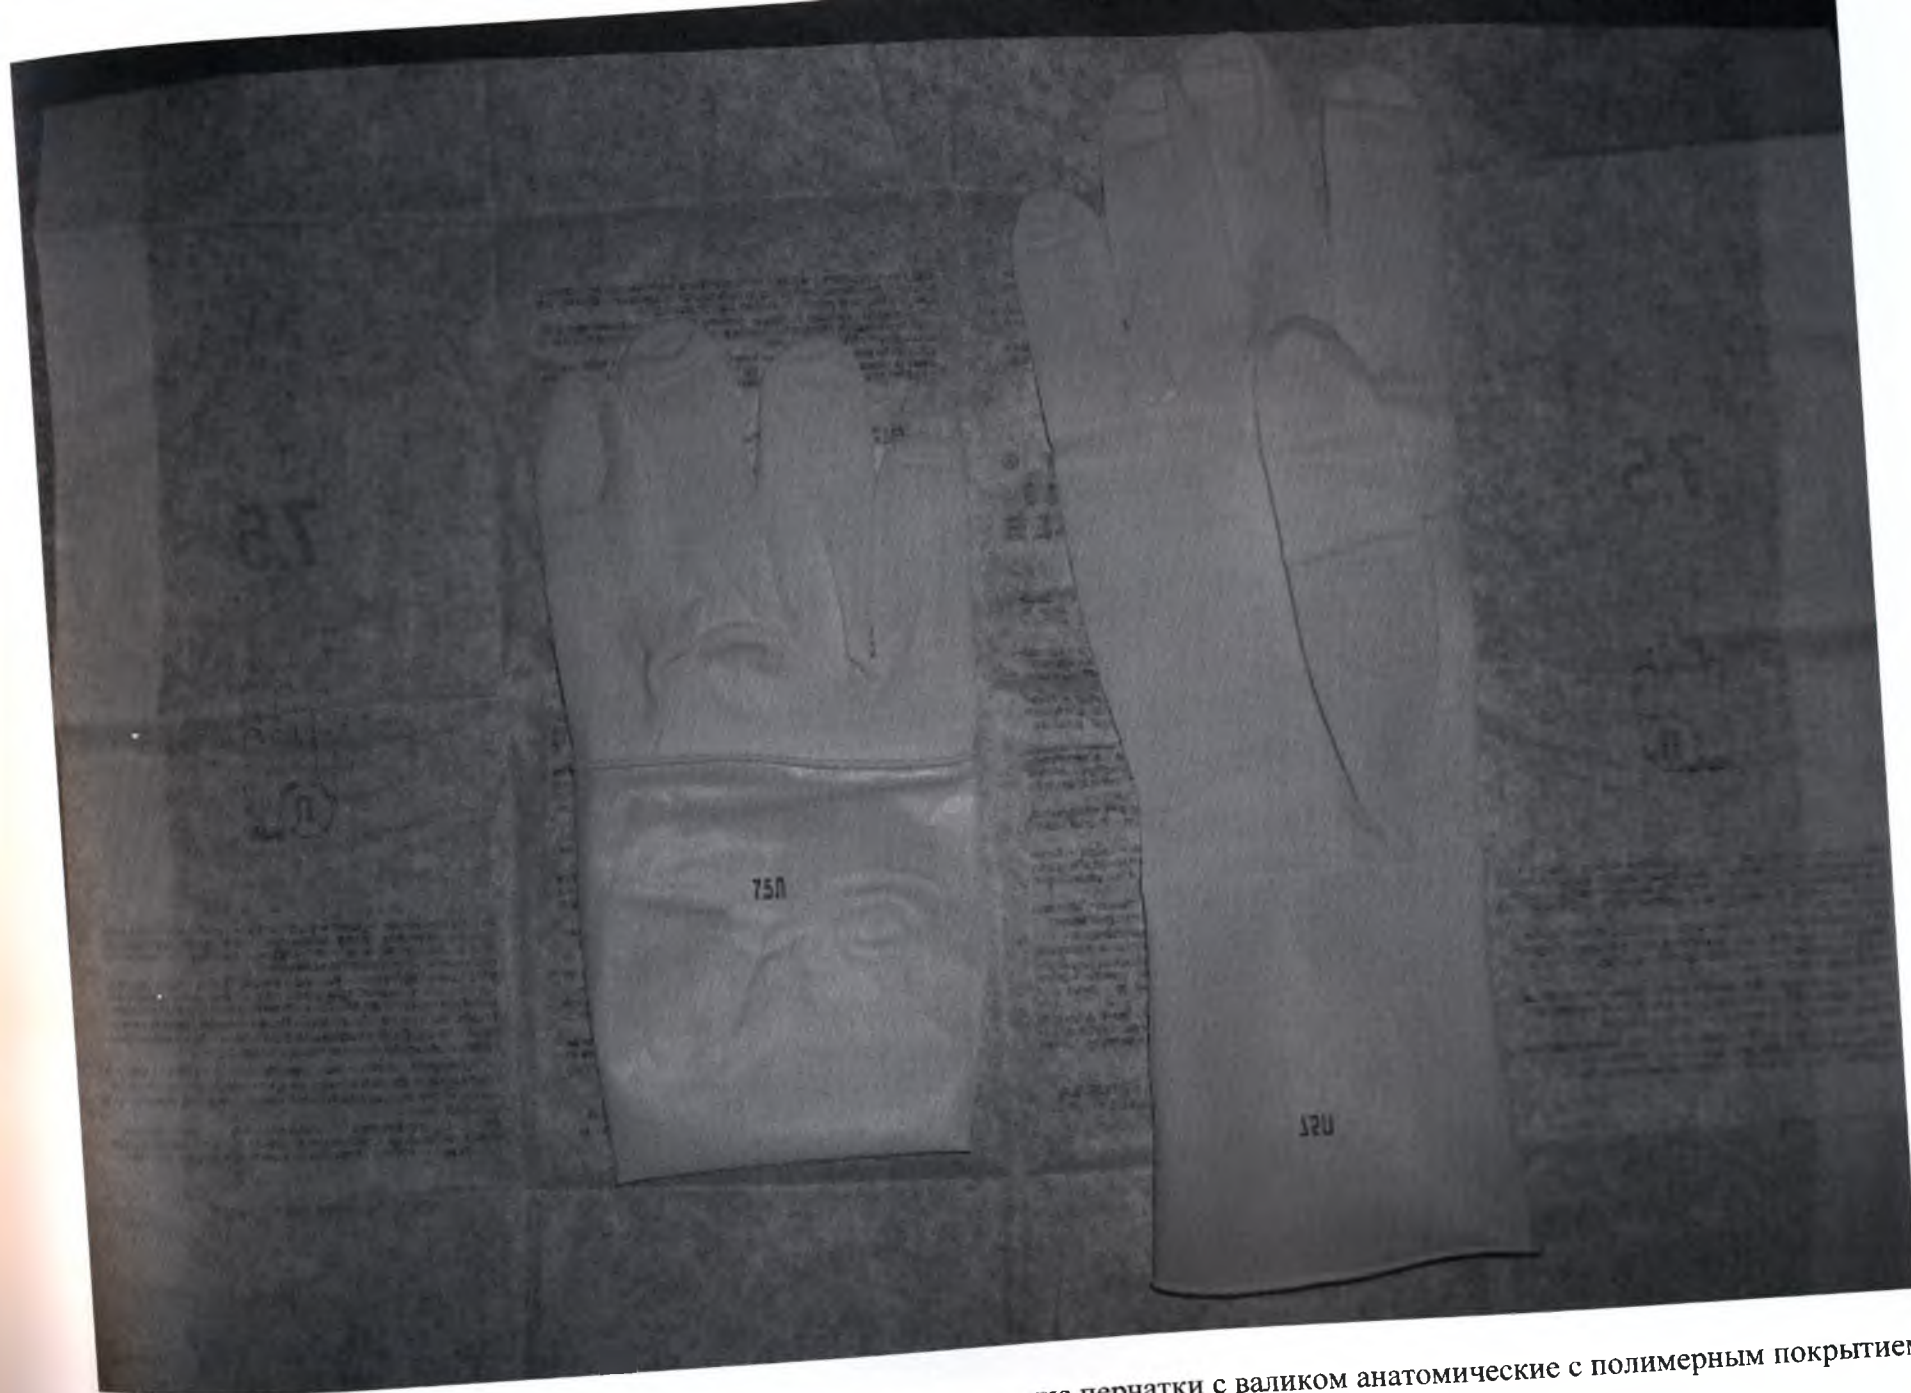

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0575

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch® 7.5

SN : 057514003178

LOT : 057514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0575

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196126,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504-А

Упаковка для перчаток INTW0575

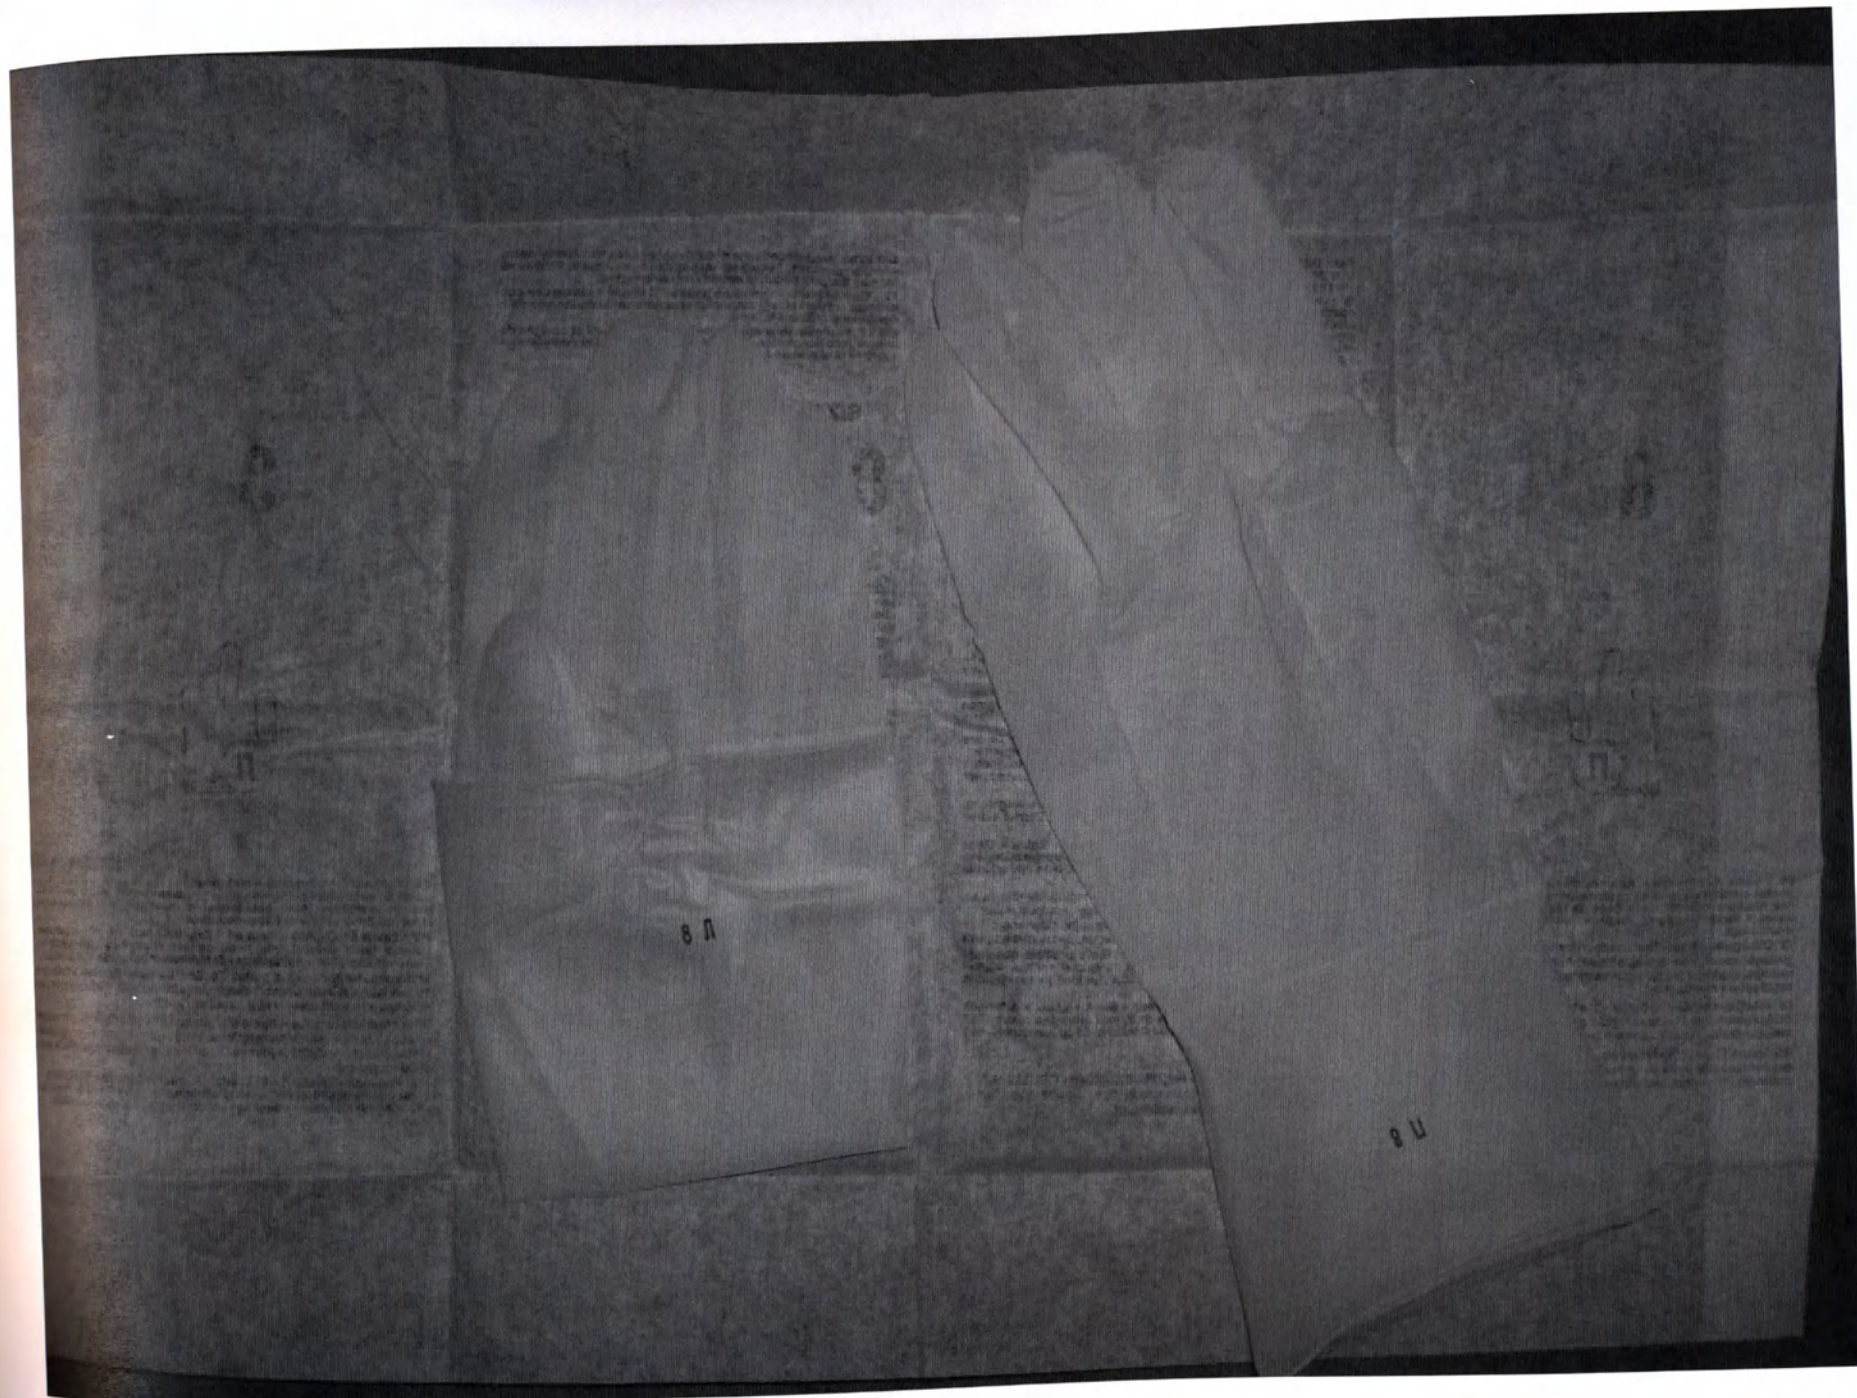

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0580

Упаковка для перчаток INTW0580

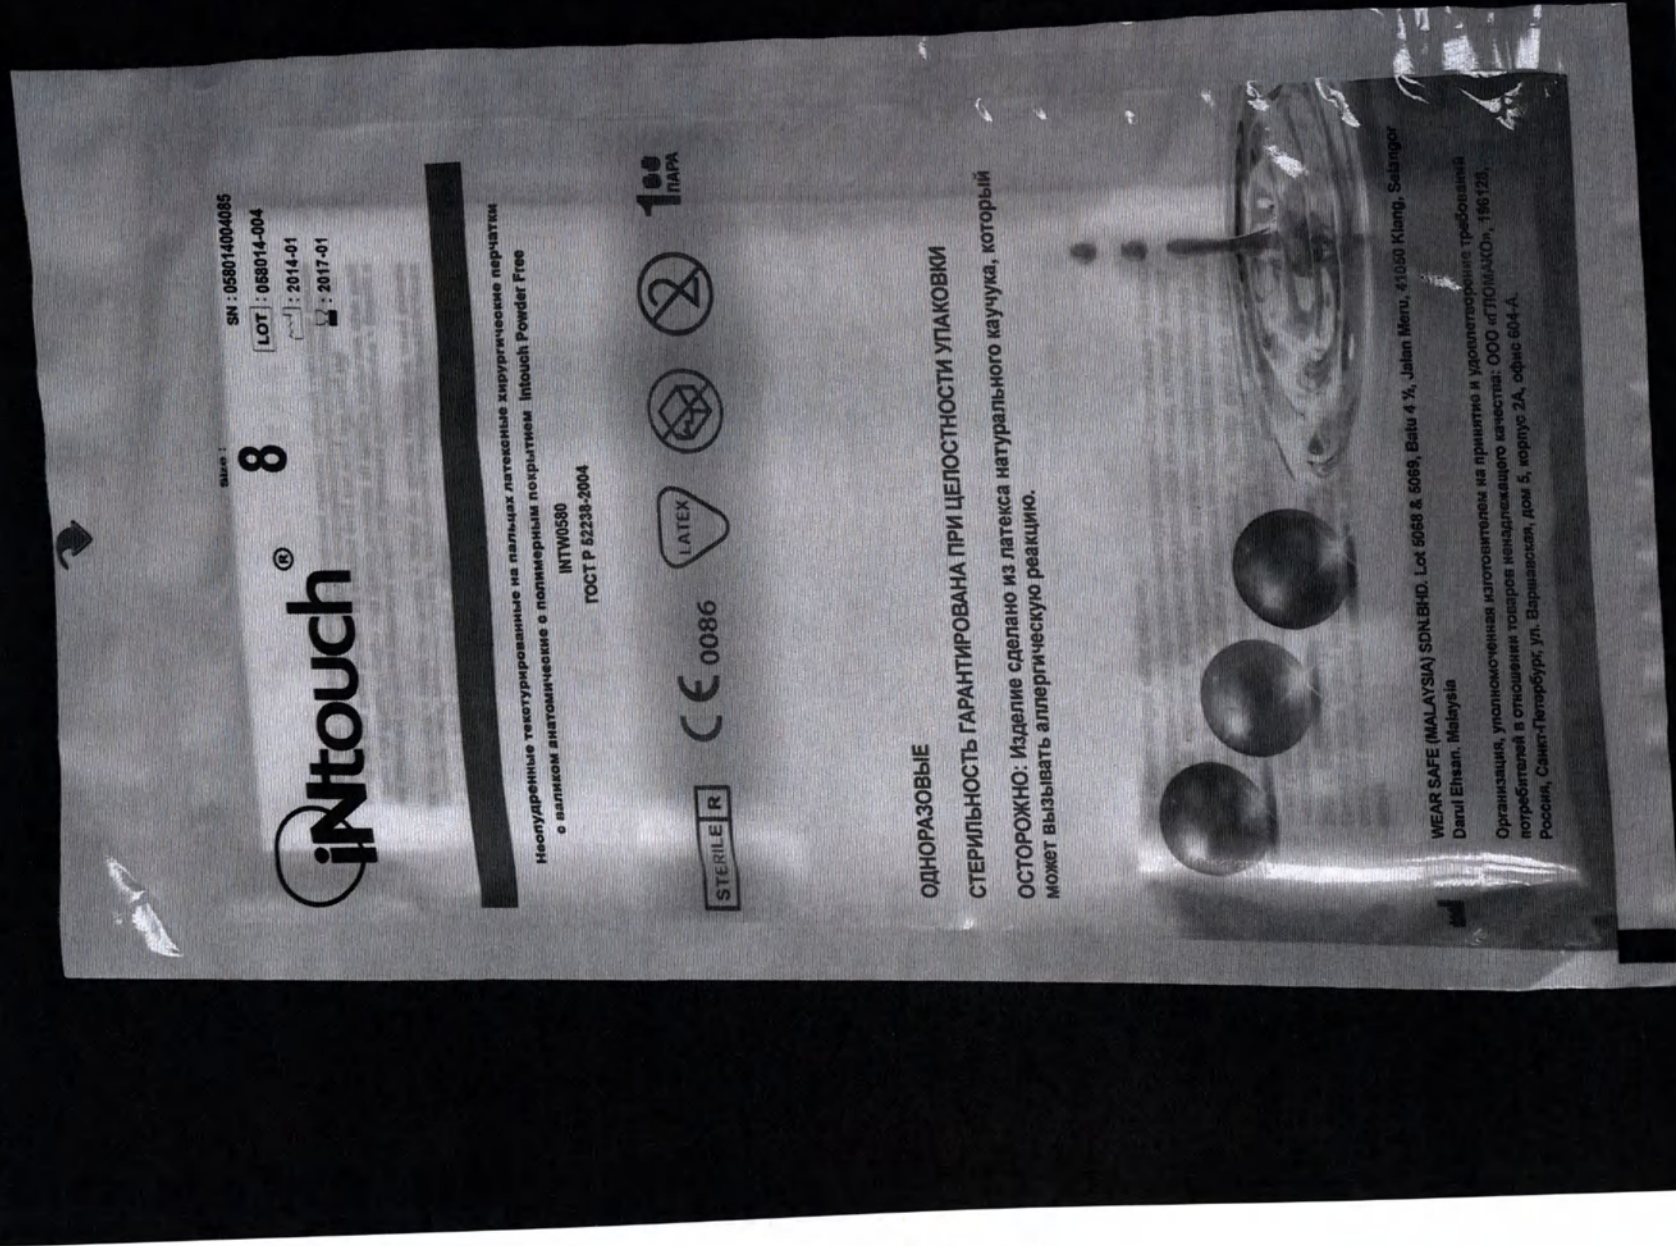

iNtouch®

Size: **8**

SN: 058014004085

LOT: 058014-004

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с полиуретановым покрытием Intouch Powder Free

INTW0580

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX




100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛЮСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

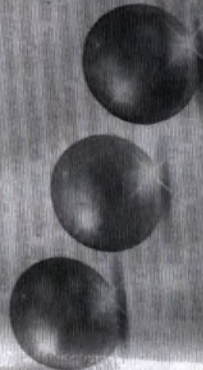

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5058 & 5059, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ПЮМАТОР», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 3А, офис 604-А.

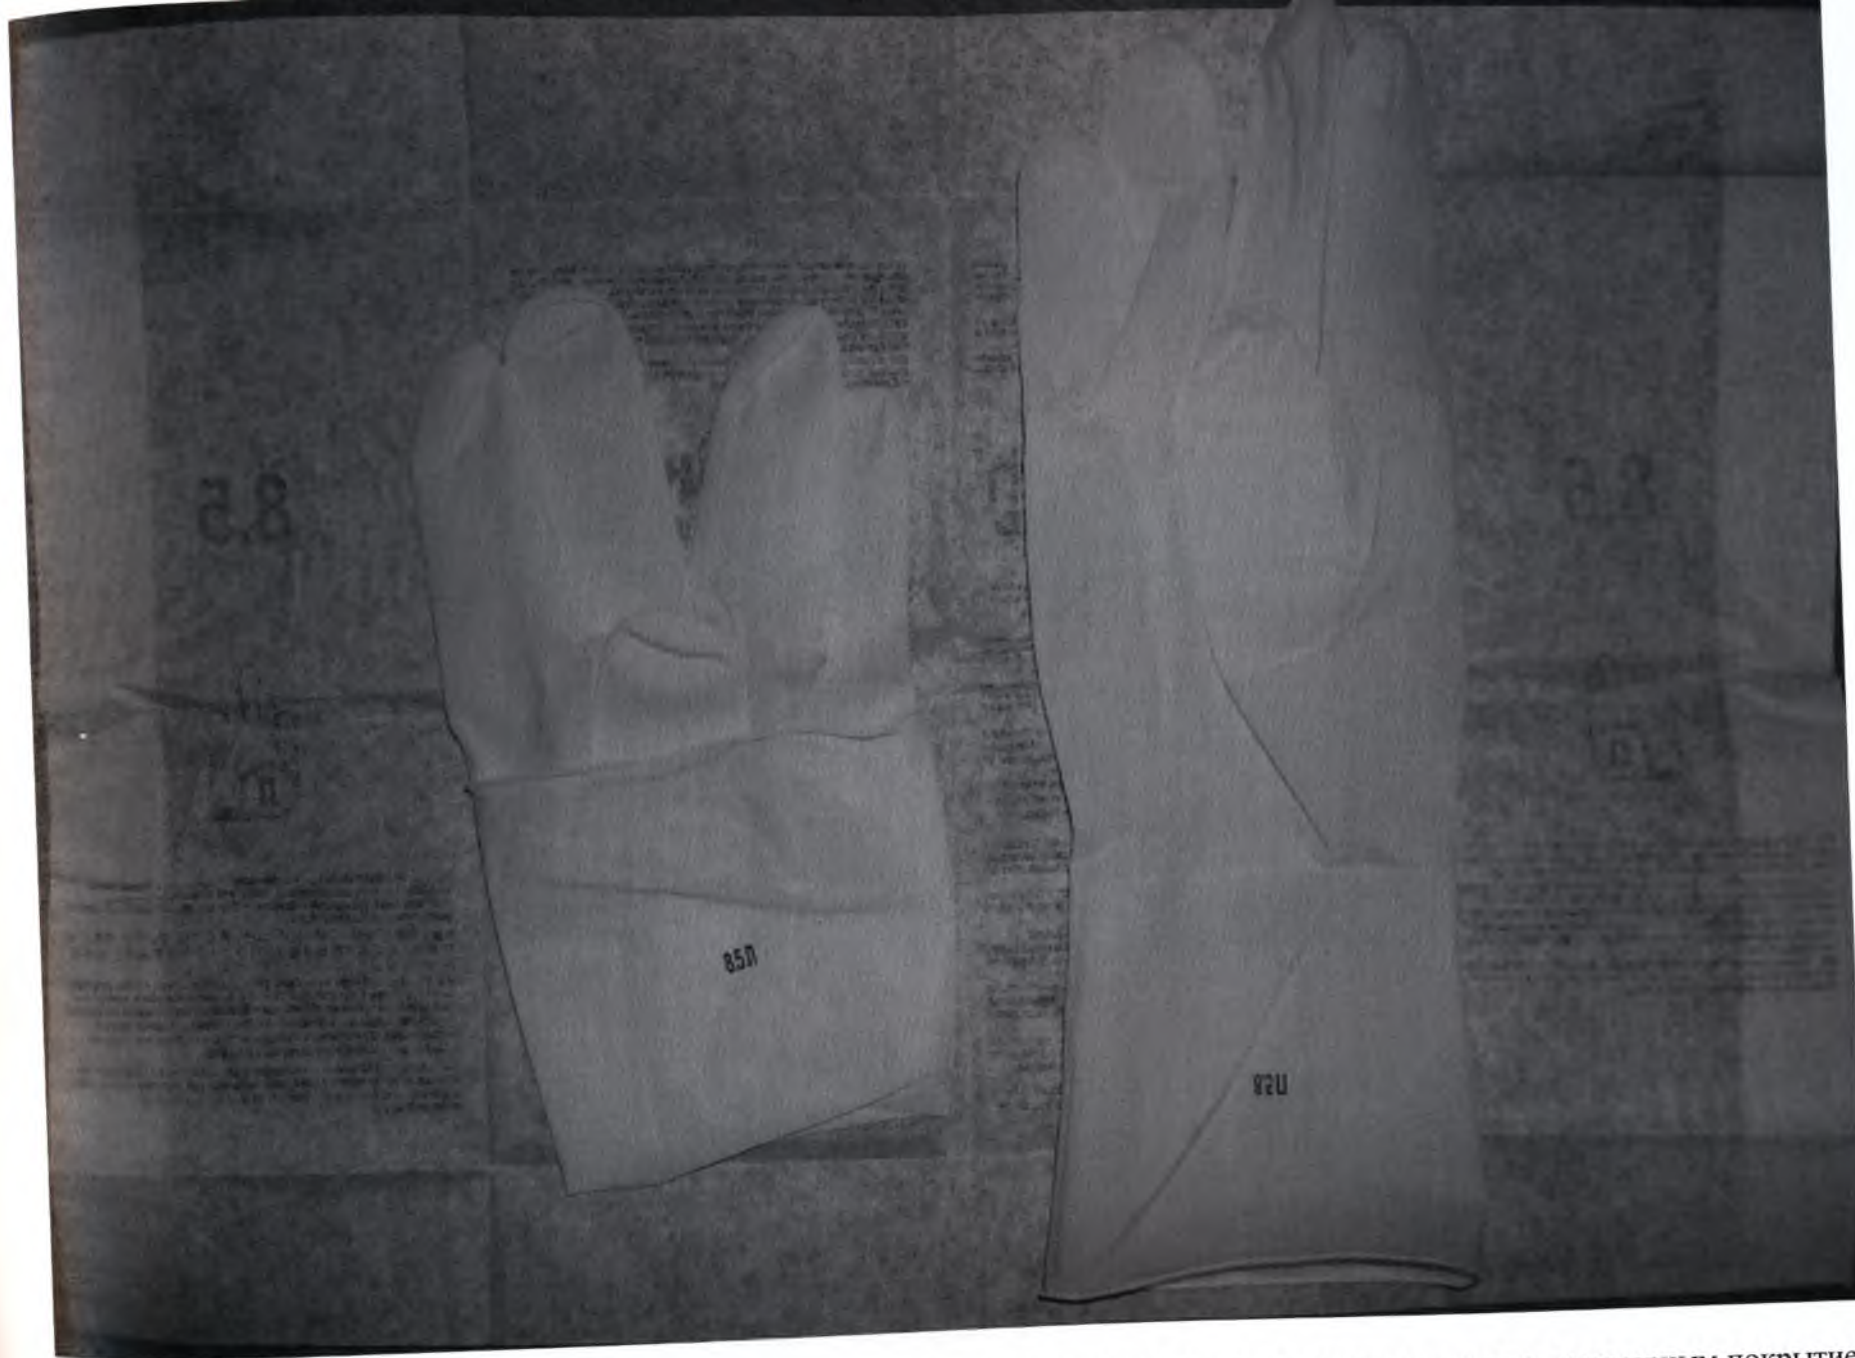

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0585

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size 1
8.5

SN : 058514004296

LOT : 058514-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с напиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0585

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086



1st
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

Упаковка для перчаток INTW0585



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с полимерным покрытием
Intouch Powder Free INTW0590

Упаковка для коробки INTW0590

Рисковать, чтобы открыть

iNtouch®

Size :
9

SN : 059014004301

LOT : 059014-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические с полимерным покрытием Intouch Powder Free

INTW0590

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX




100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

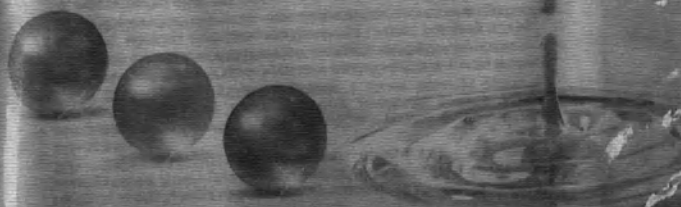

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров надлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196120,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

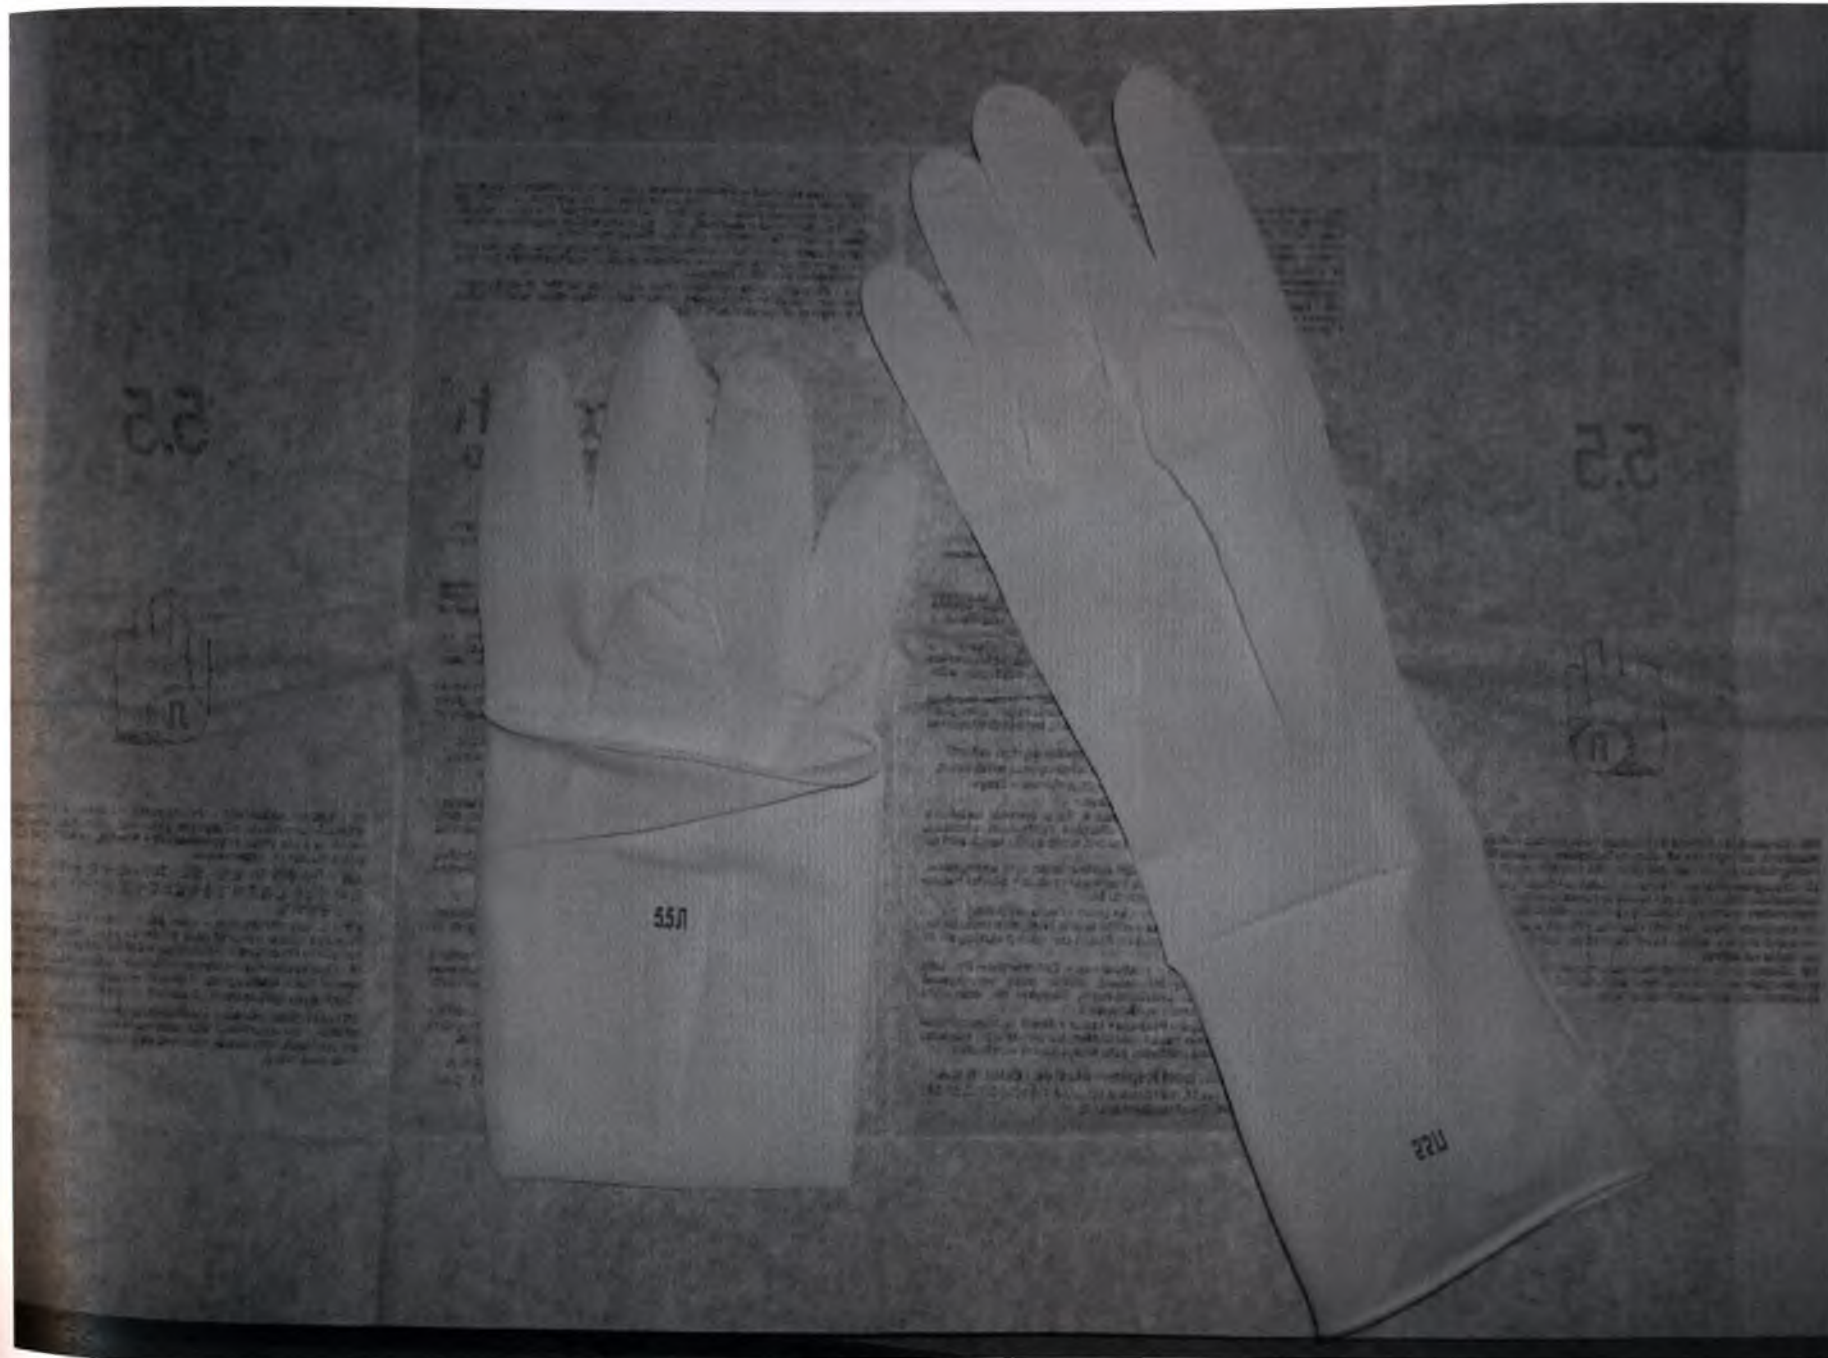

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free INTW0455

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size: 5.5

SN: 045514001042

LOT: 045514-001

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free
INTW0455
ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 6069 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 158126, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0455

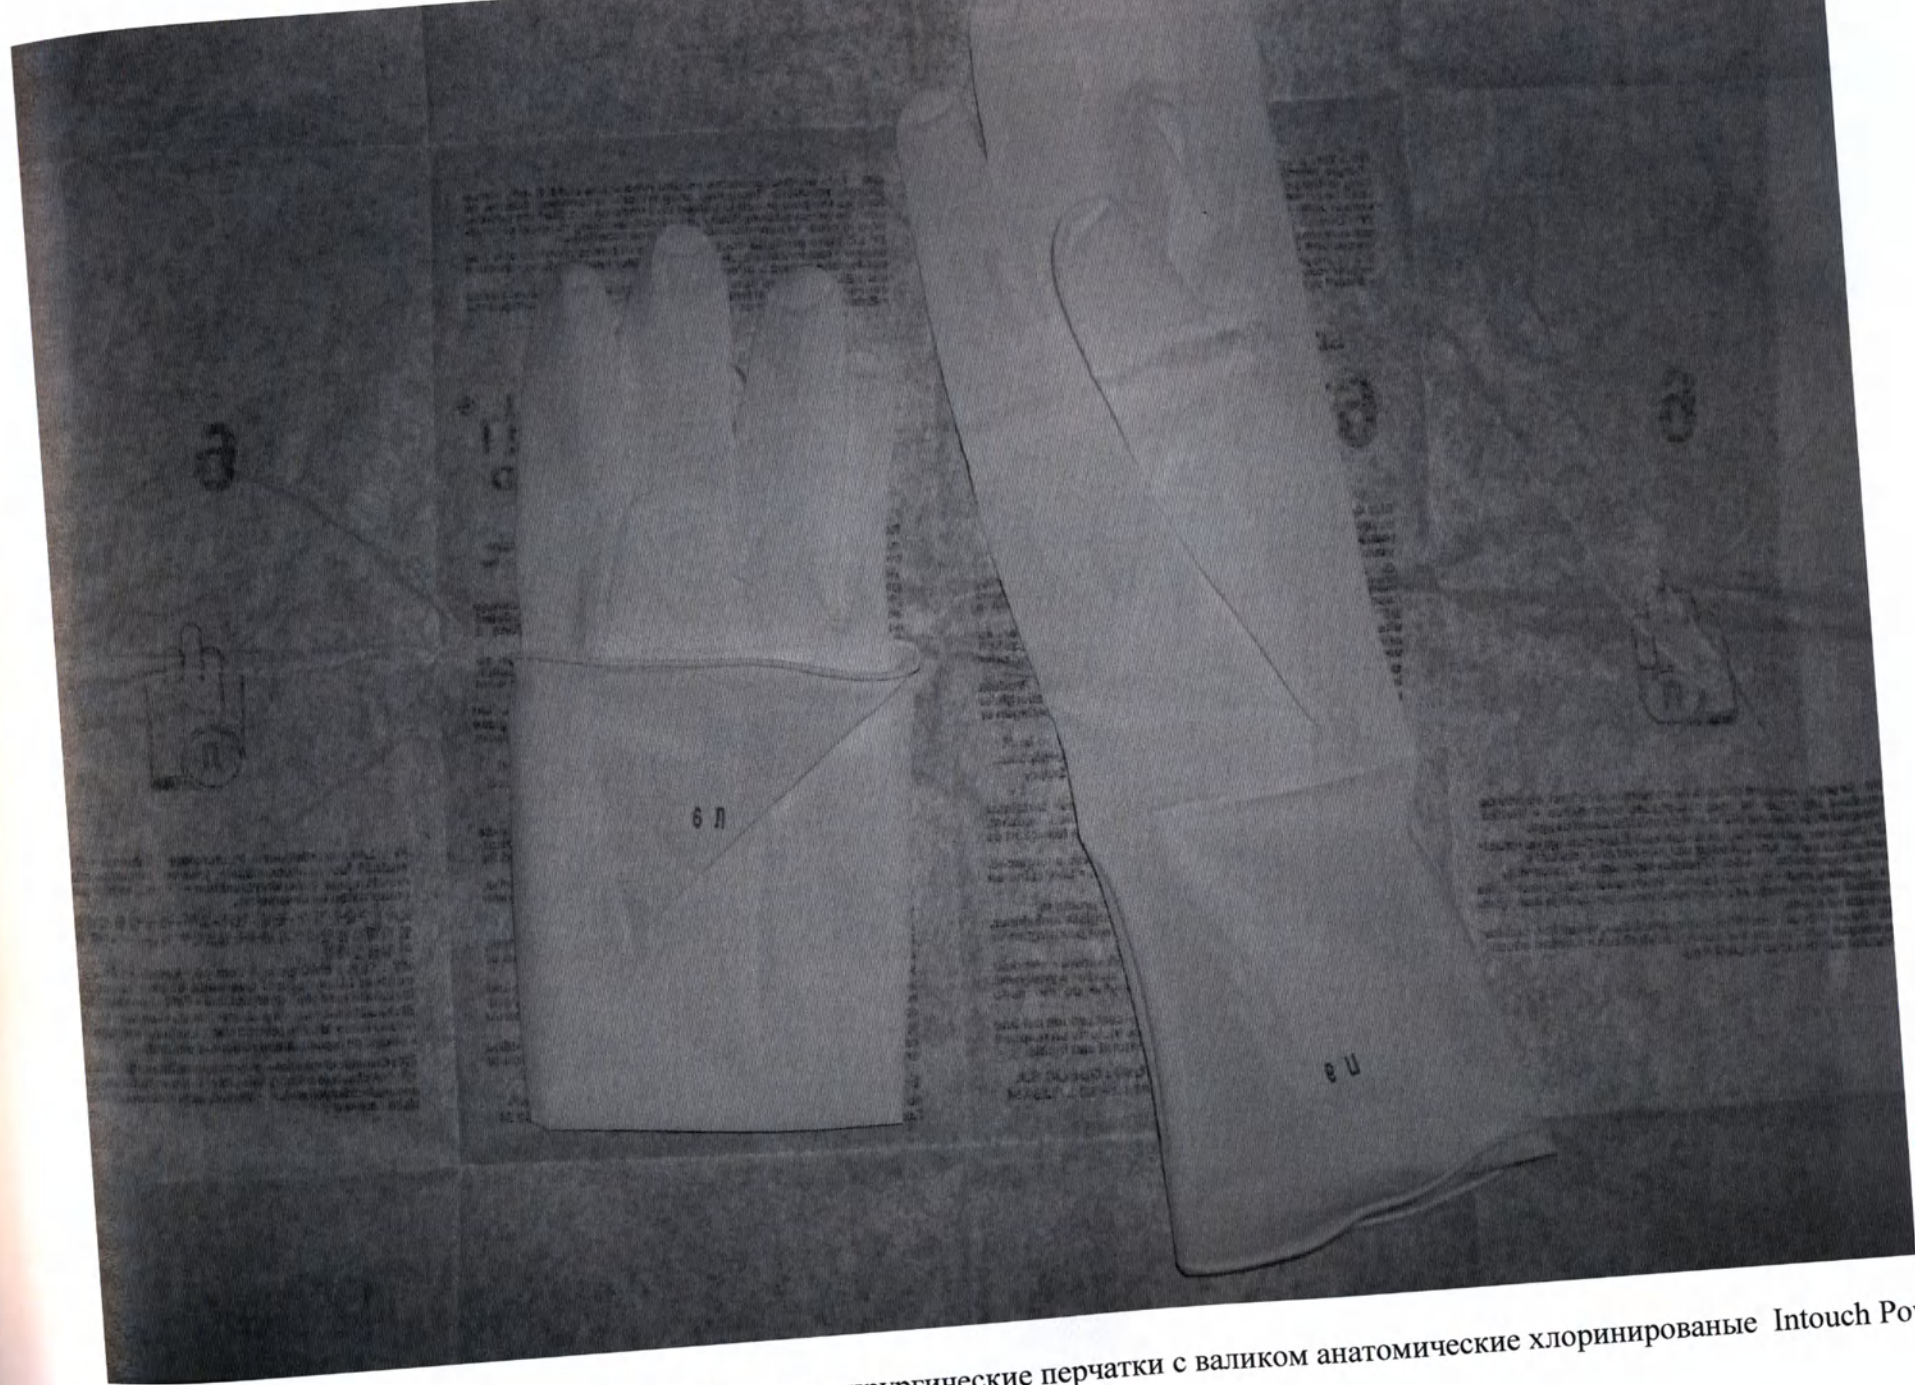

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder
Free INTW0460

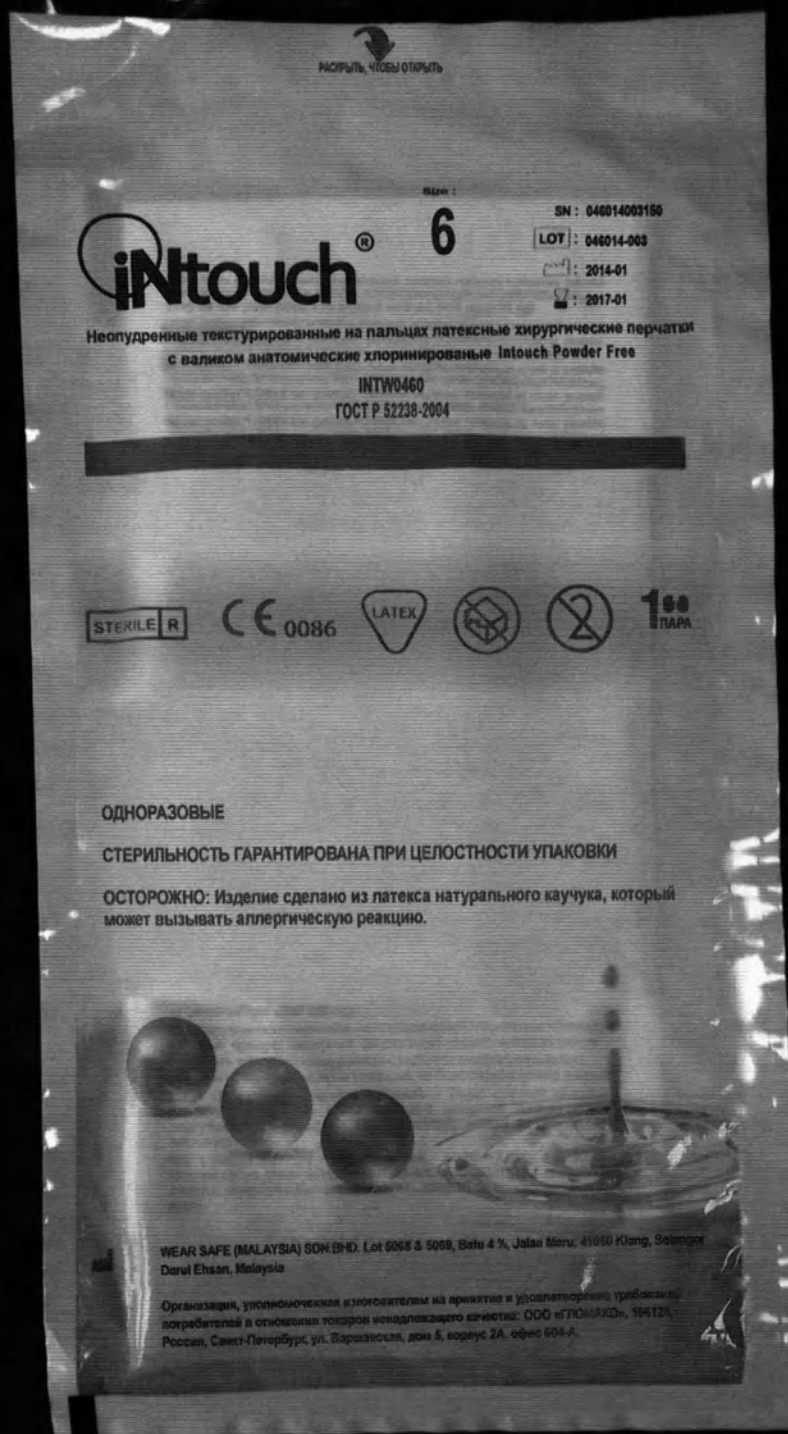

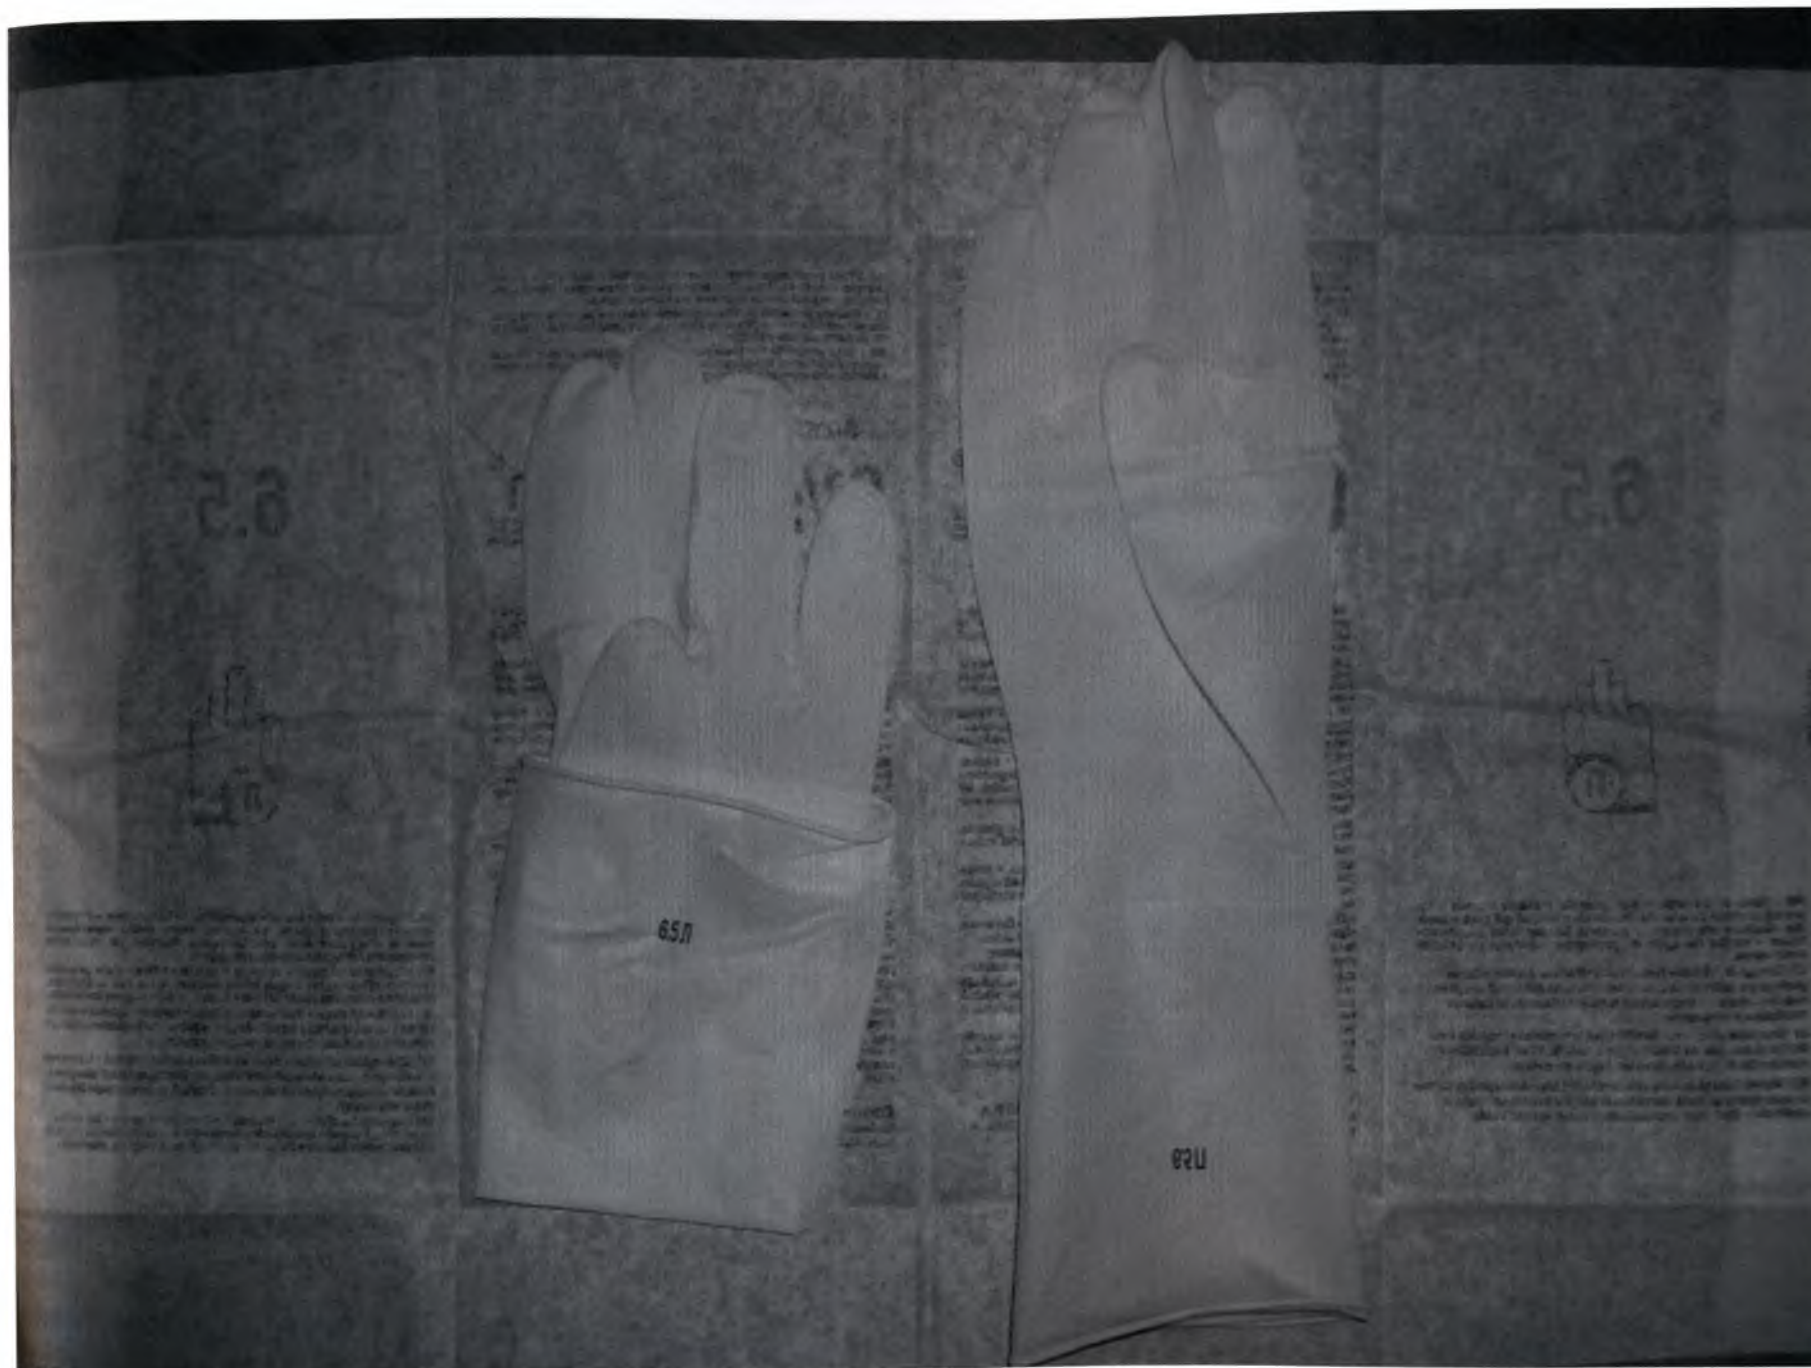

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free INTW0465

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size : 6.5

SN : 046514003379

LOT : 046514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free
INTW0465
ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX




100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

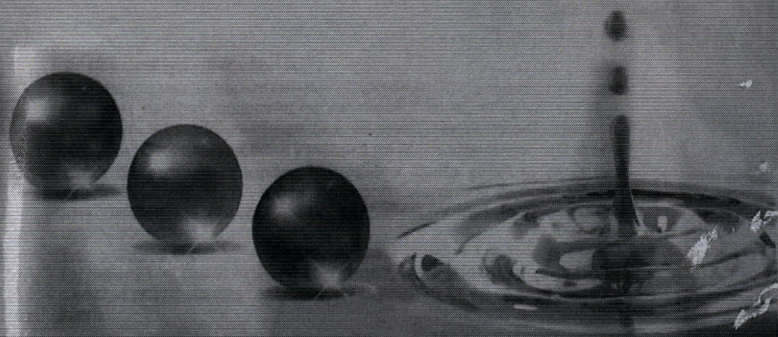

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5066 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛЮМАКО», 186128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0465

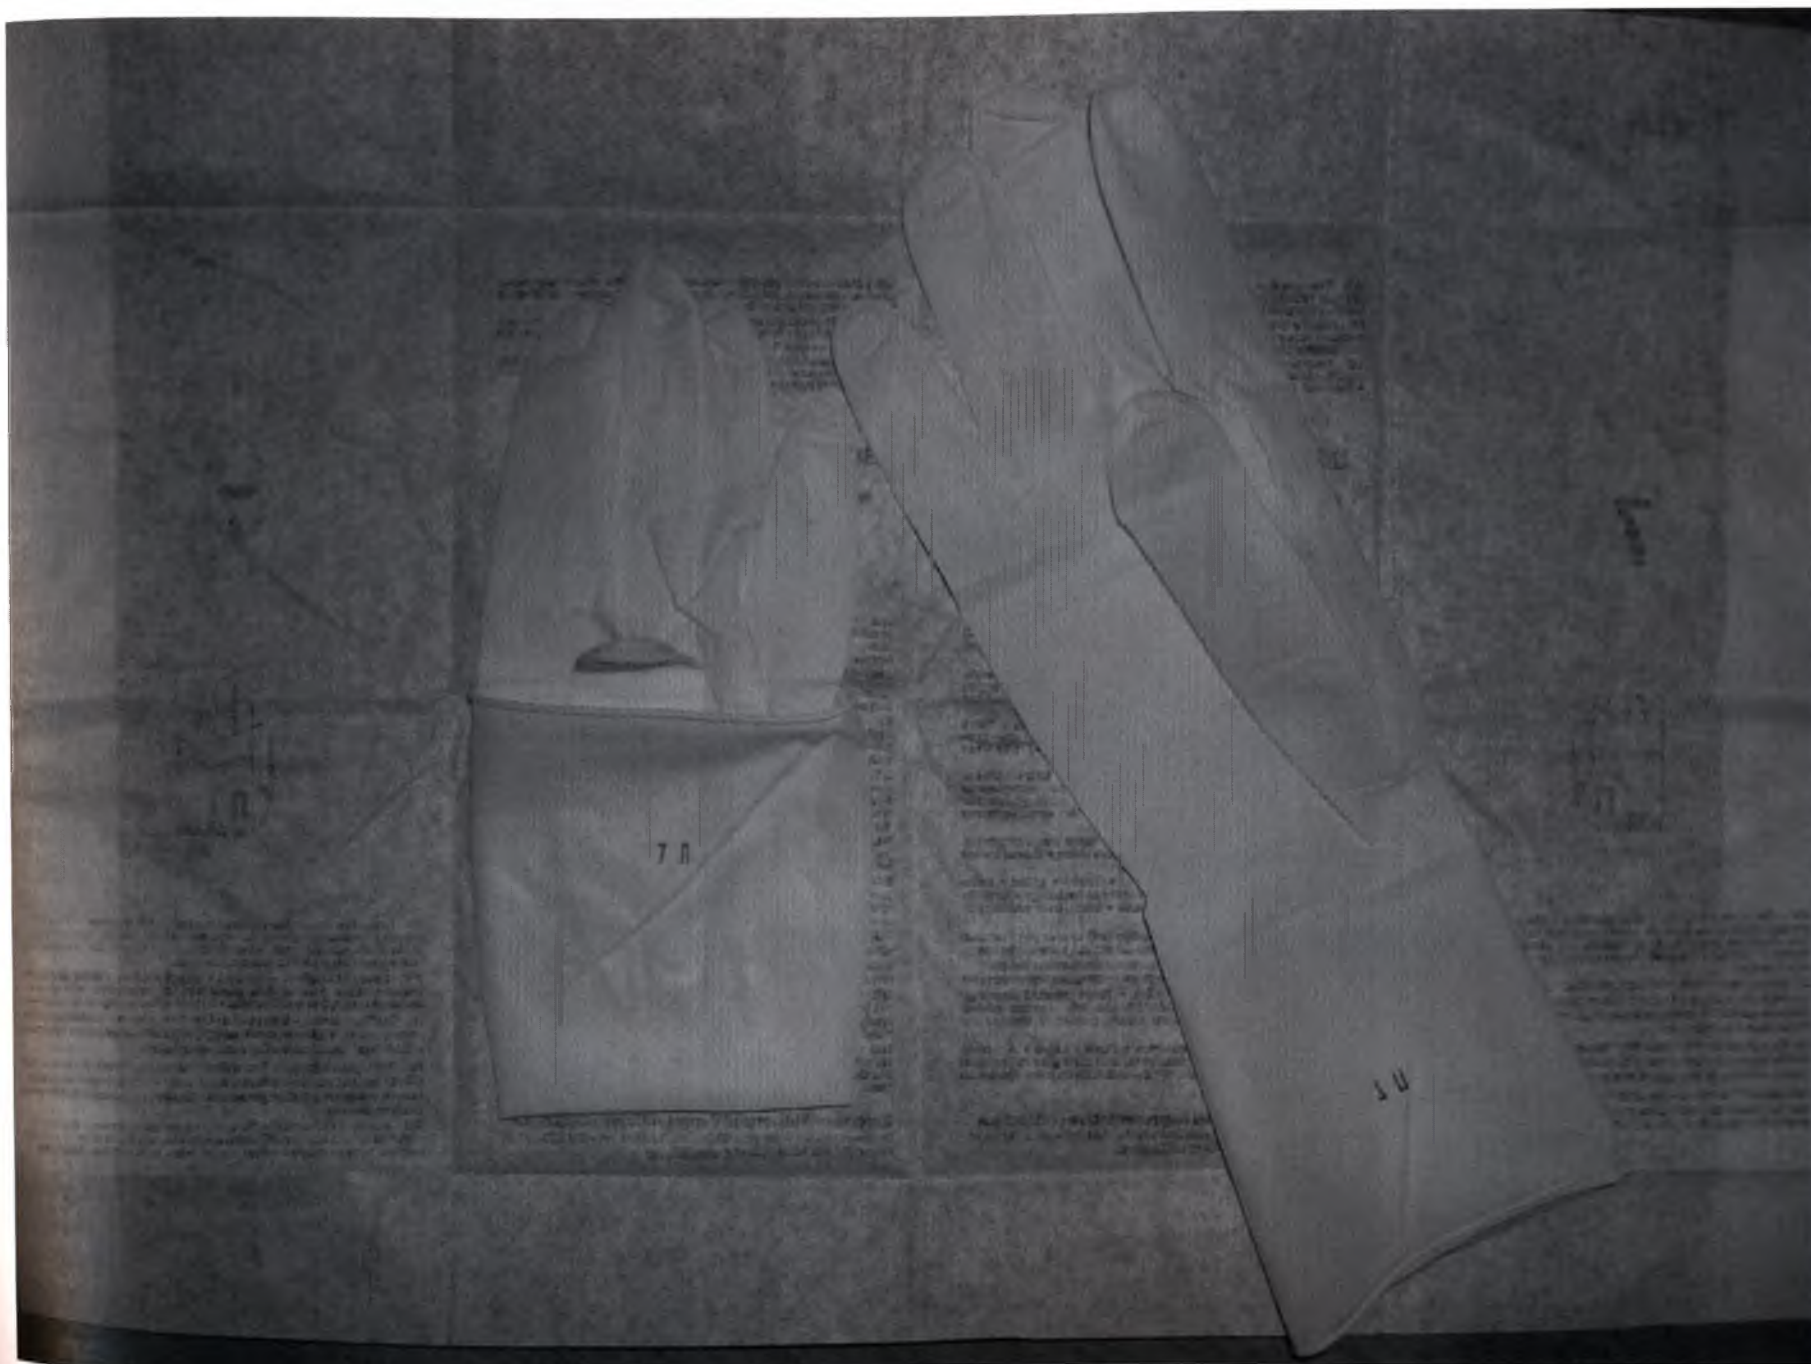

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free INTW0470

разорвать, чтобы открыть

Size :

7

iNtouch®

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомических хлорированных Intouch Powder Free

INTW0470

ГОСТ Р 52238-2004

SN : 047014003583

LOT : 047014-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R

CE

0086

LATEX



100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.





WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «ПРИМАКО», 196128
Россиа, Санкт-Петербург, ул. Вирвильская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder
Free INTW0475

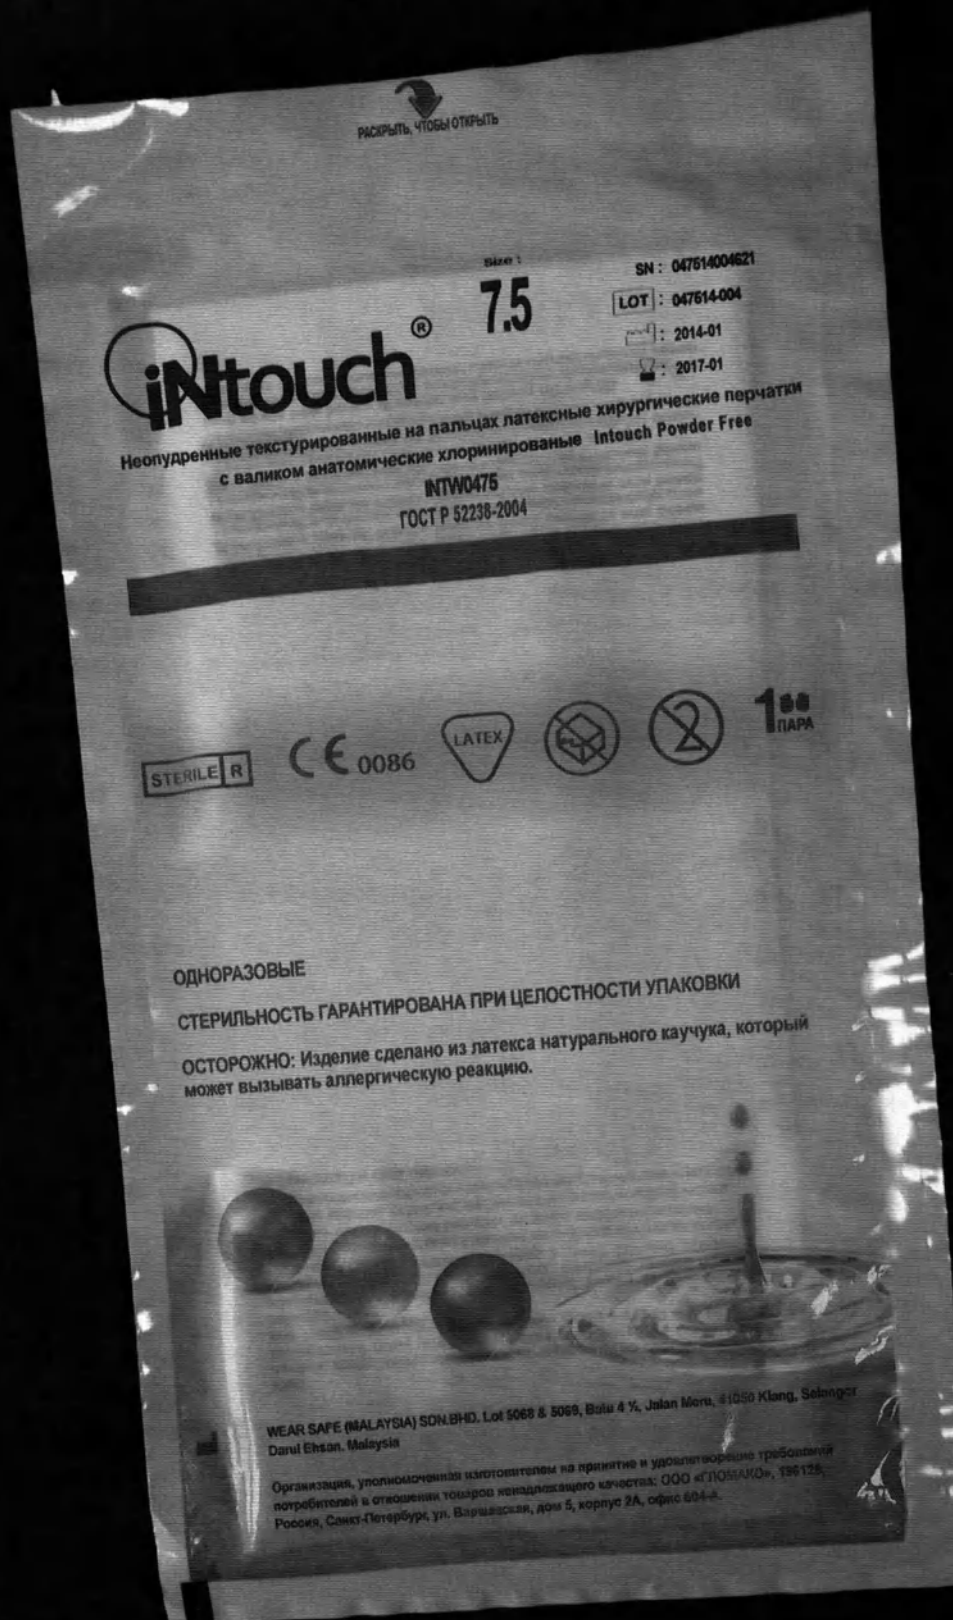

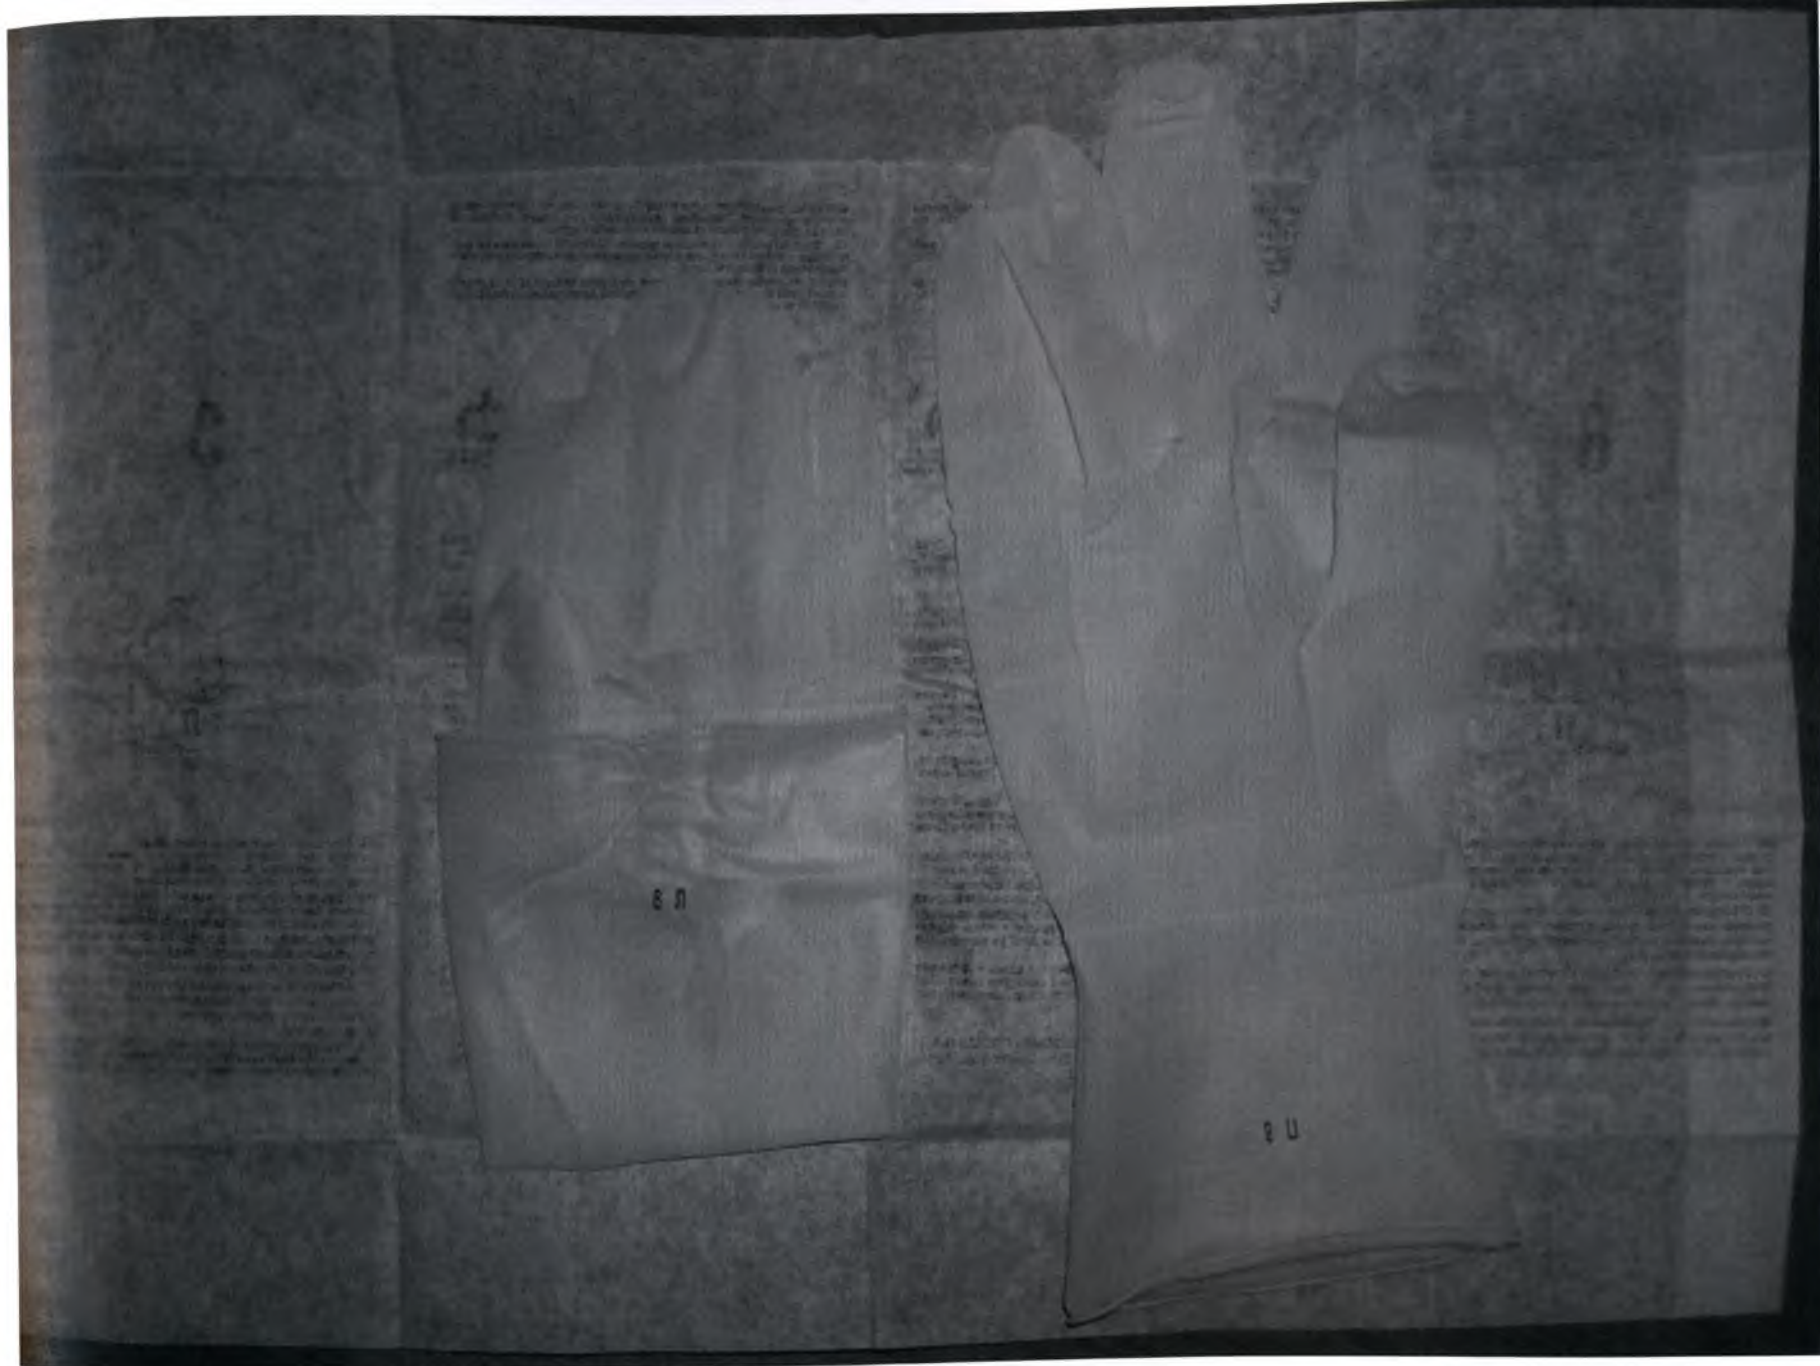

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free INTW0480

Упаковка для перчаток INTW0480

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :

8

SN : 048014002410

LOT : 048014-002

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free

INTW0480

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корпус 2А, офис 504-А.

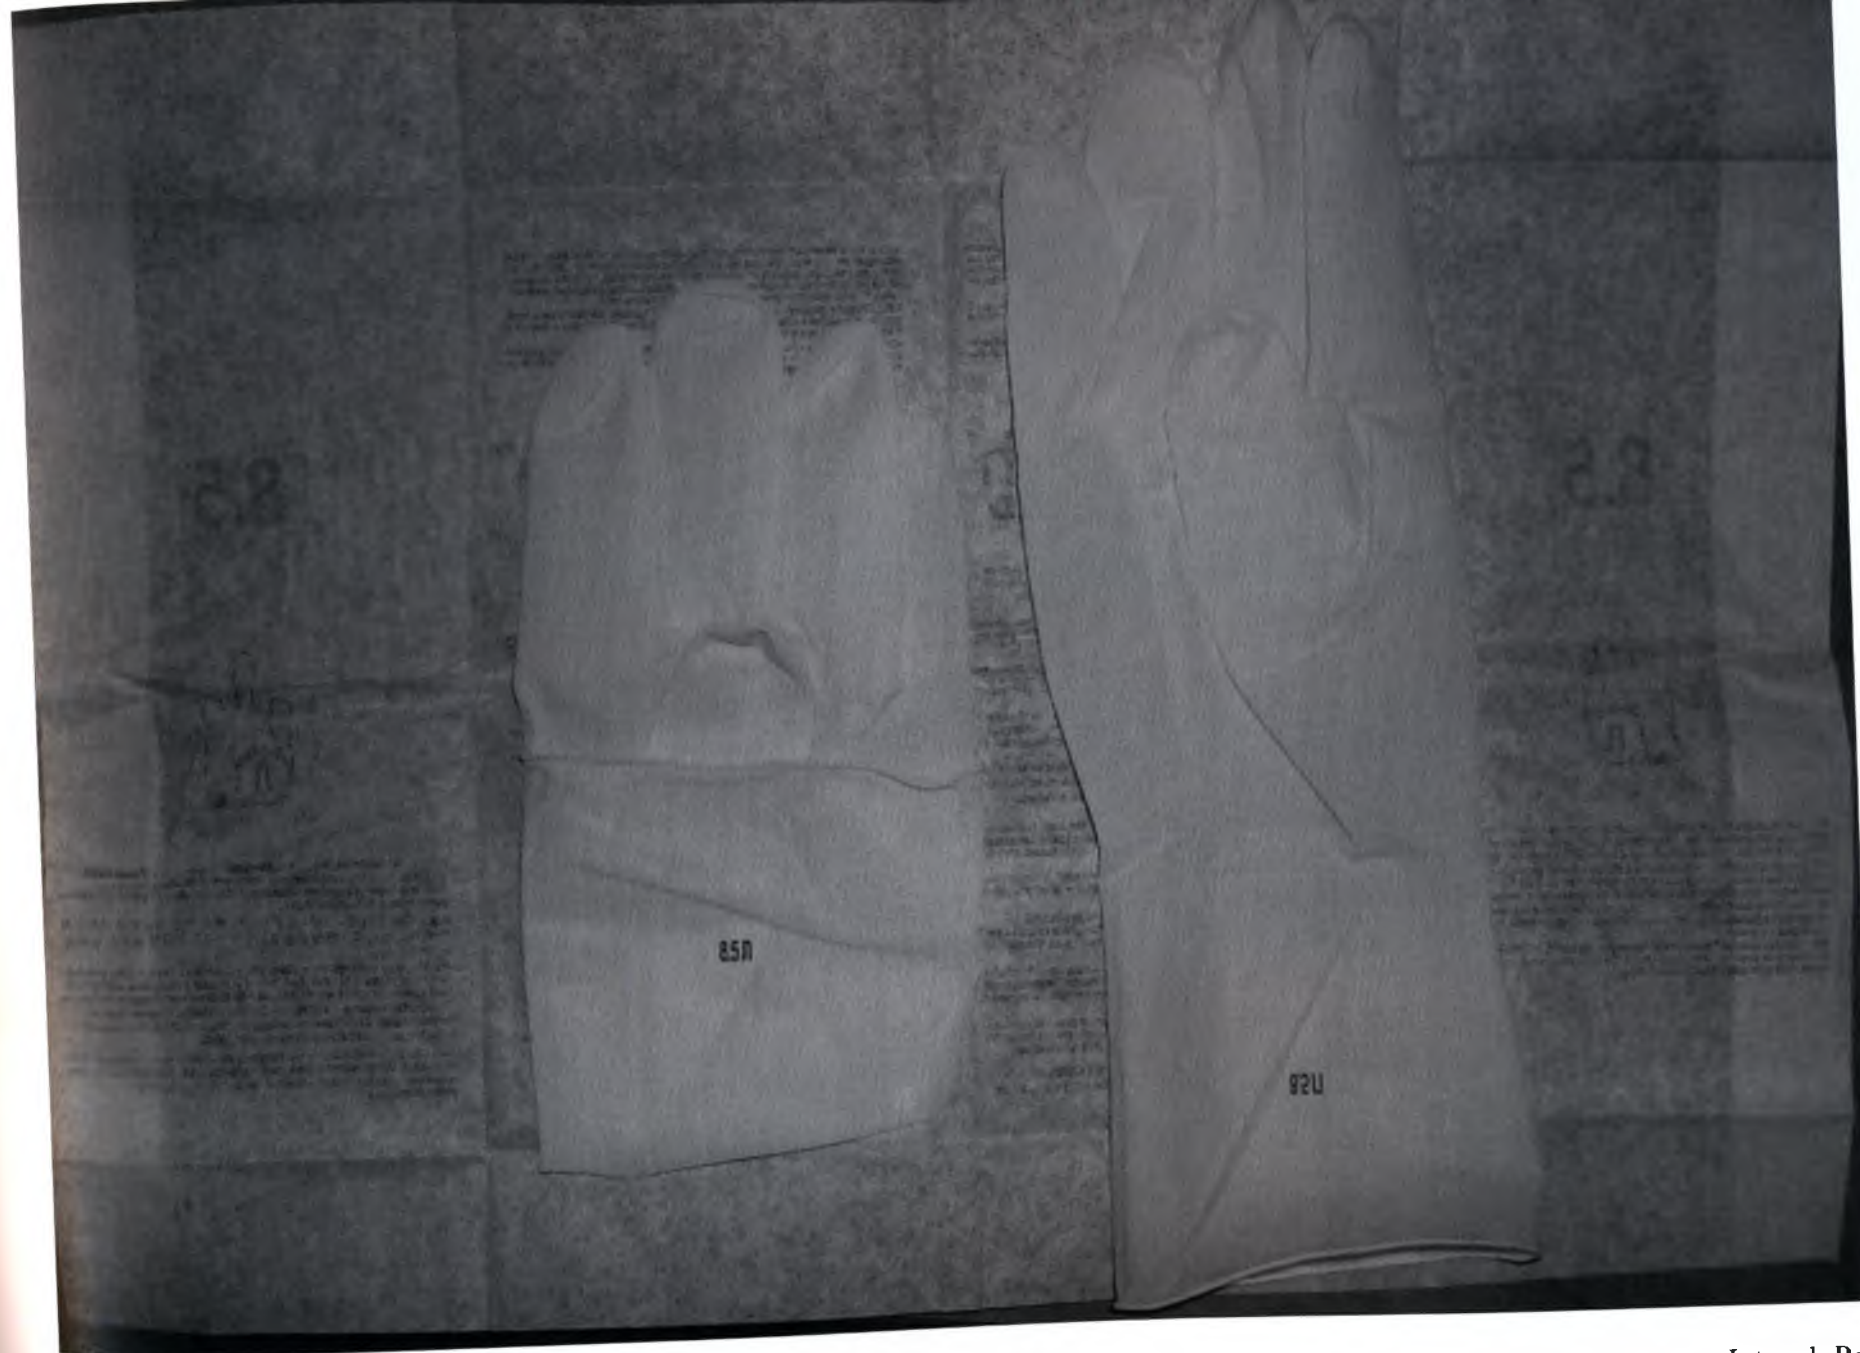

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder
Free INTW0485

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size: 8.5

SN: 048514004536

LOT: 048514-004

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки
с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free

INTW0485

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 186125,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504-А.



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические хлоринированные Intouch Powder Free INTW0490

Упаковка для перчаток INTW0490

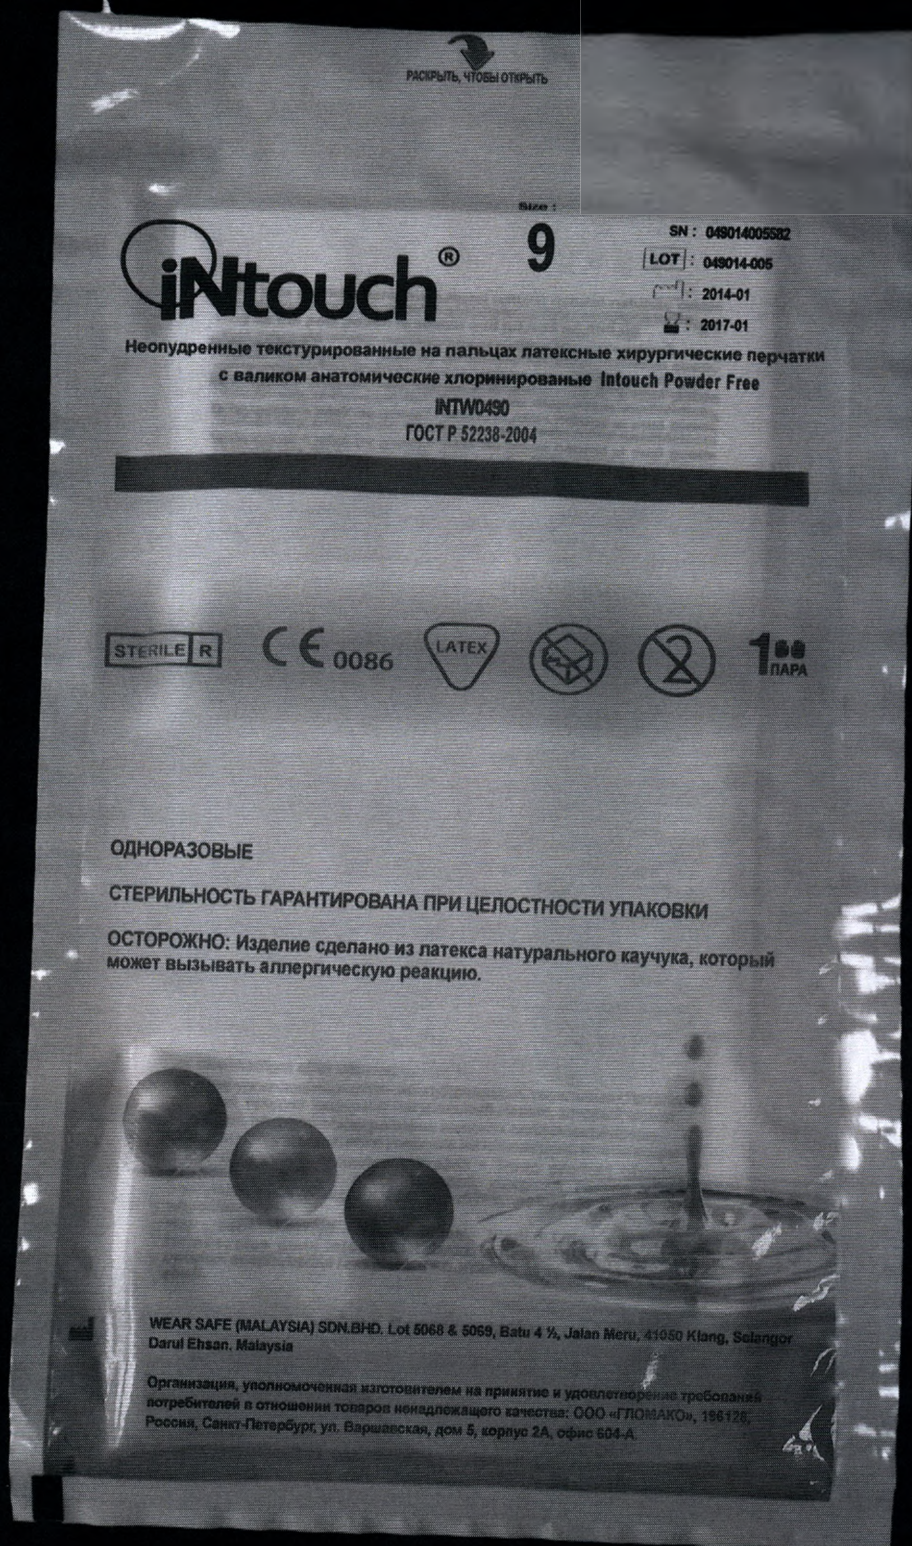



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1155

РАСКРЫТЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Натуральные латексные перчатки Intouch MEXX с ультрамелкой пористостью

INTW1155

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size :

5.5

ПАРА

SN : 115514003359

LOT : 115514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R




0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров надлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 195128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Вязовская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А.


Упаковка для перчаток INTW1155

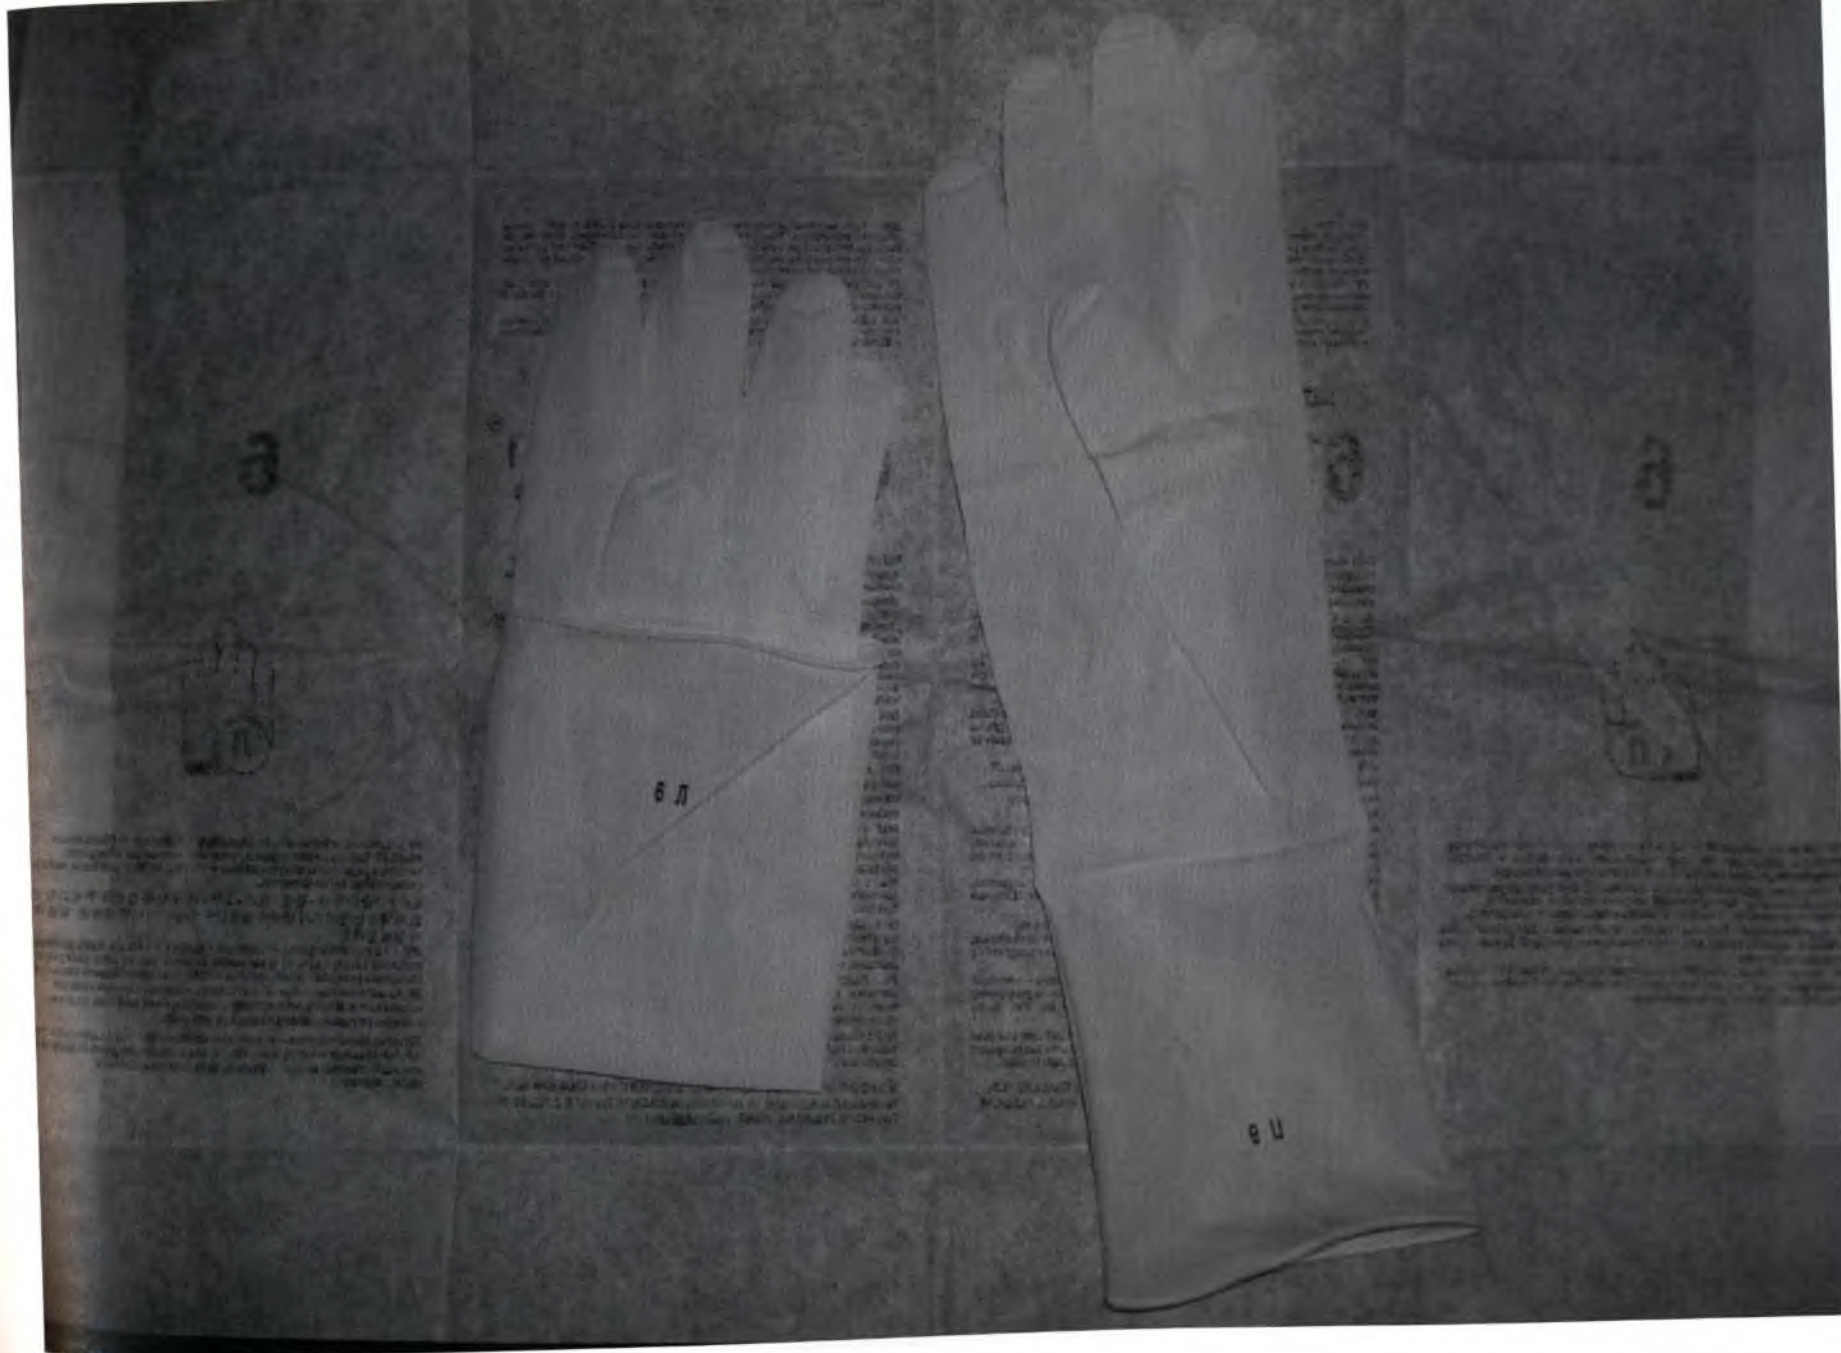

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1160

Упаковка для перчаток INTW1160

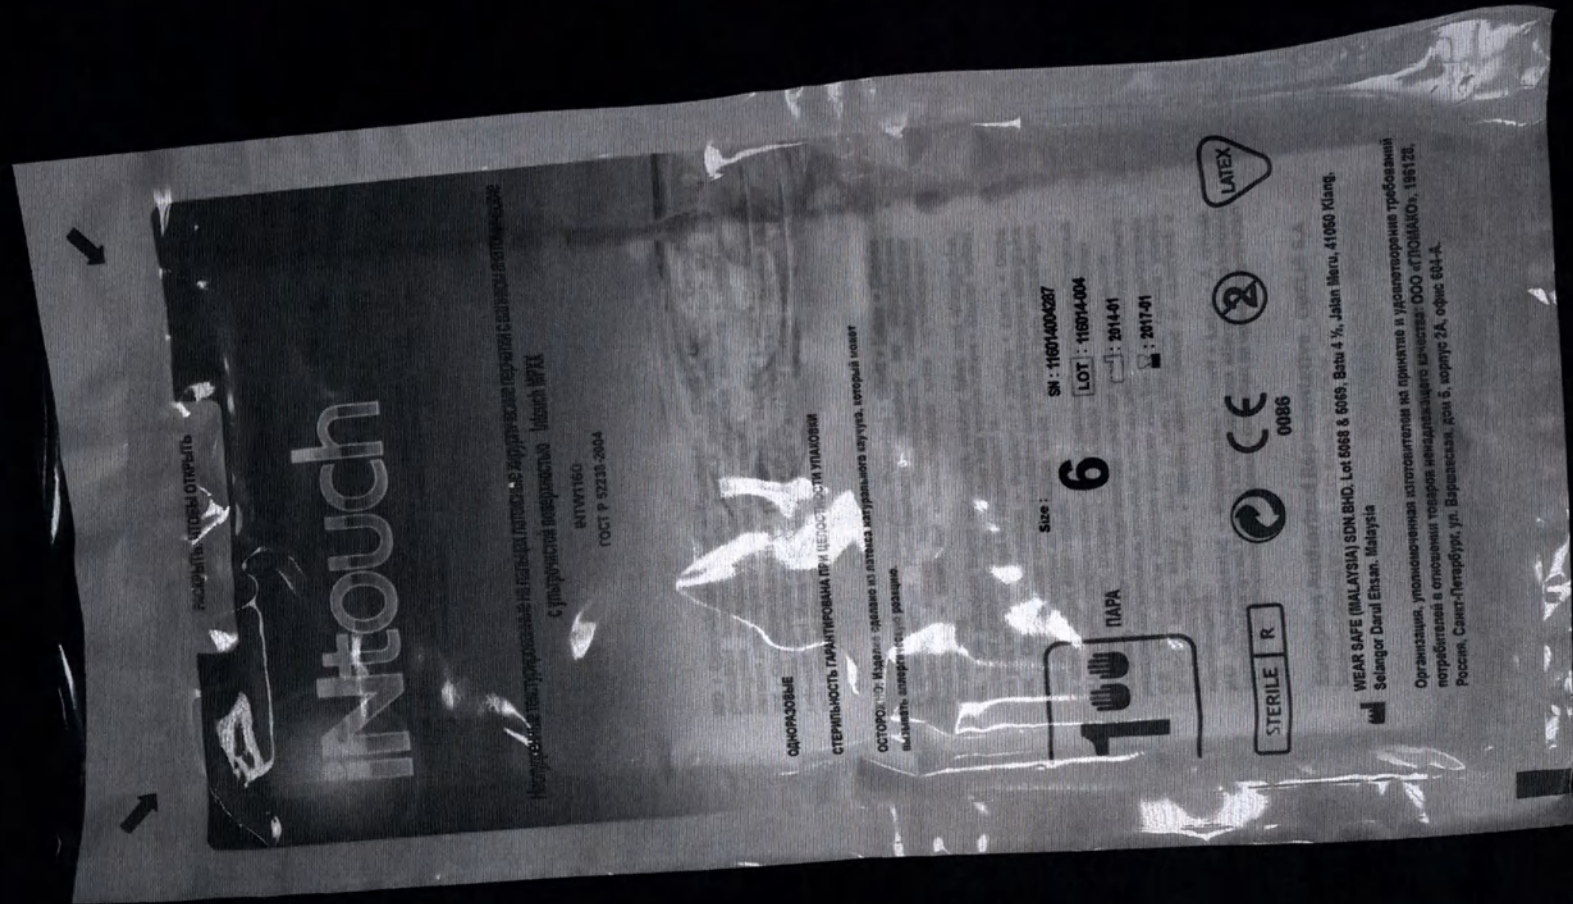

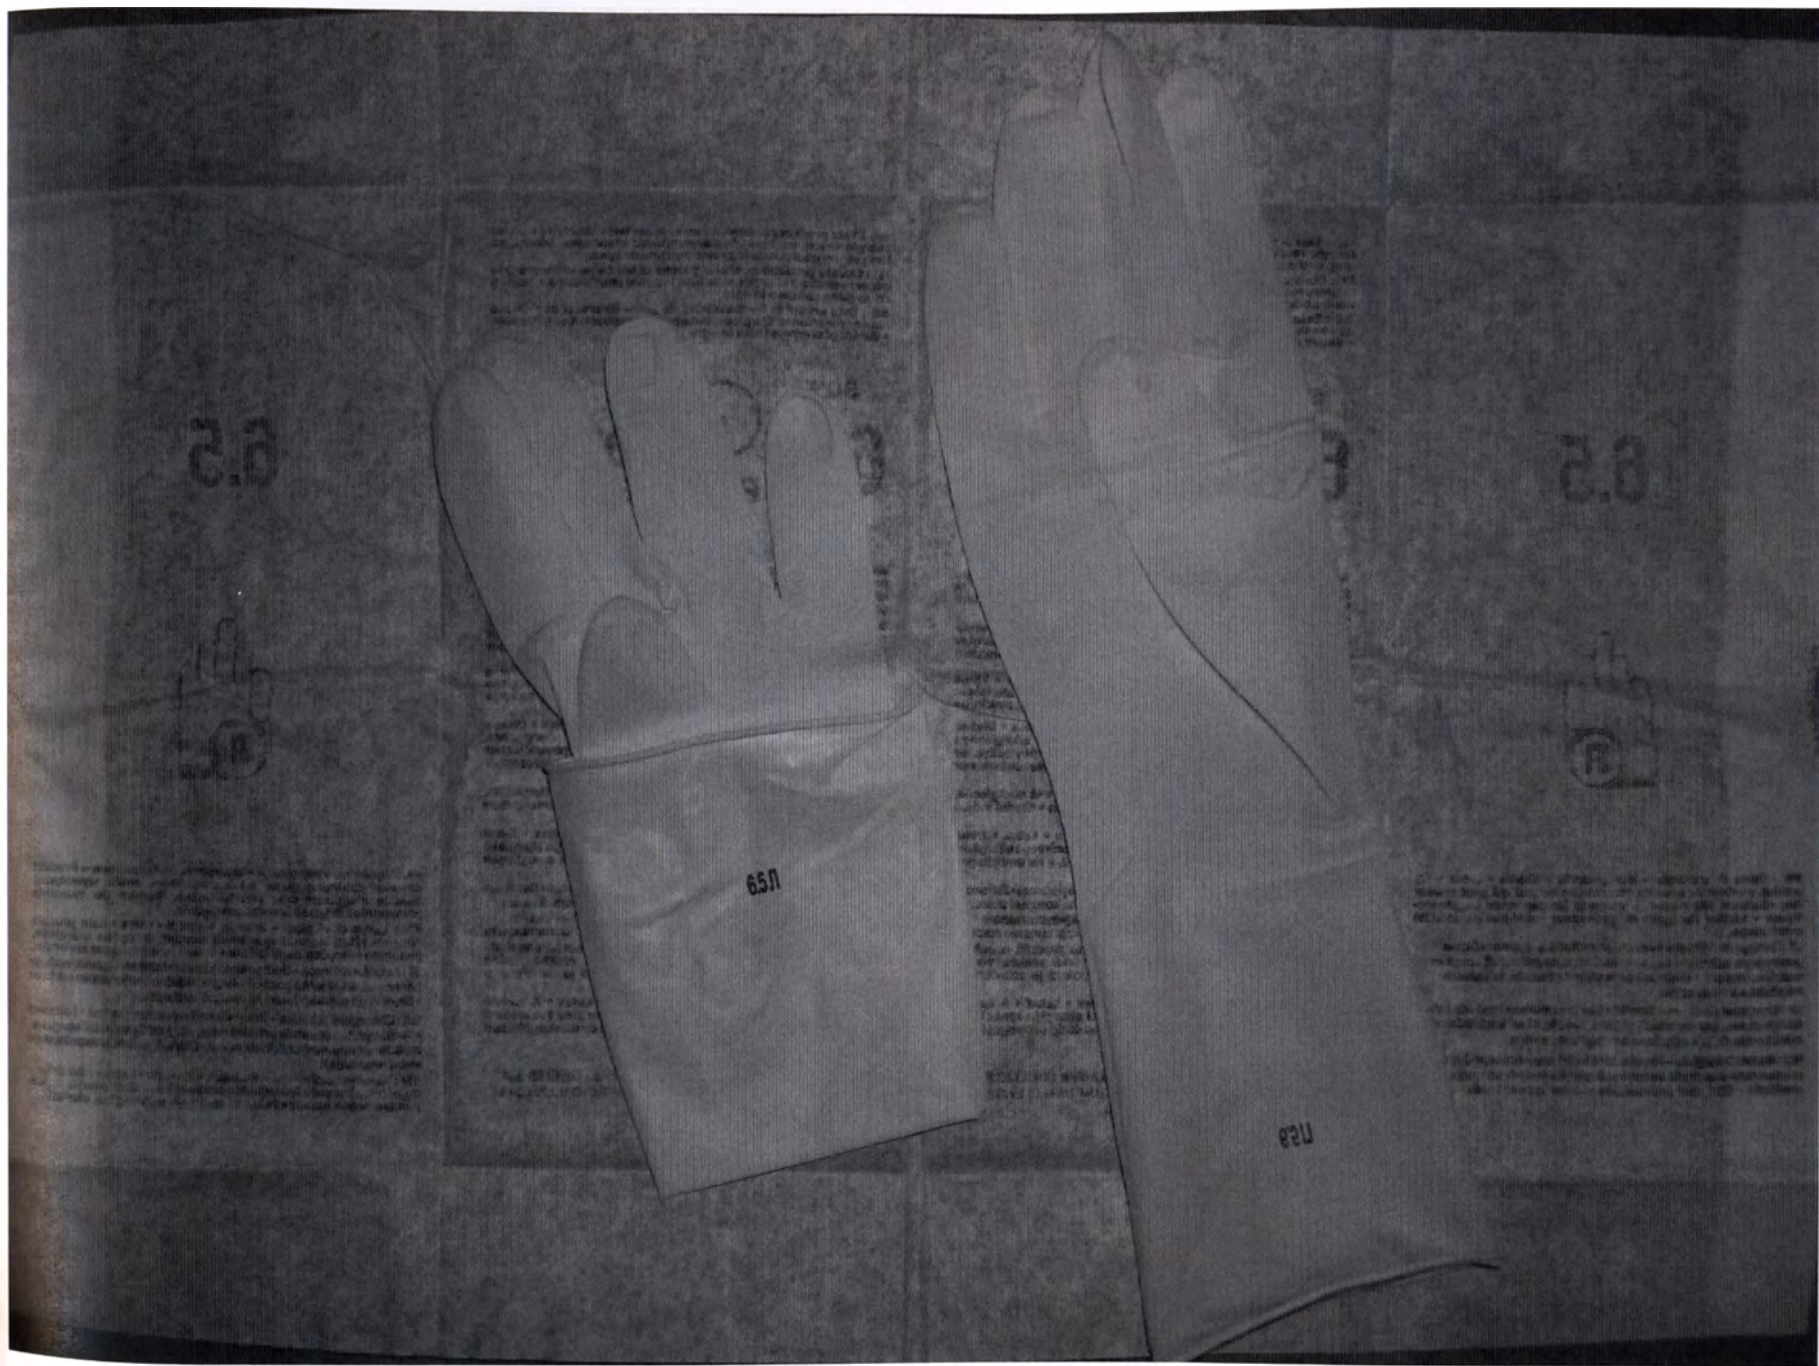

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1165

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

INTouch

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиками анатомической с ультрочистой поверхностью Intouch MP XX

INTW1165

ГОСТ Р 52236-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



ПАРА

Size :

6.5

SN : 116514002168

LOT : 116514-002

2014-01

2017-01

STERILE R




CE
0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

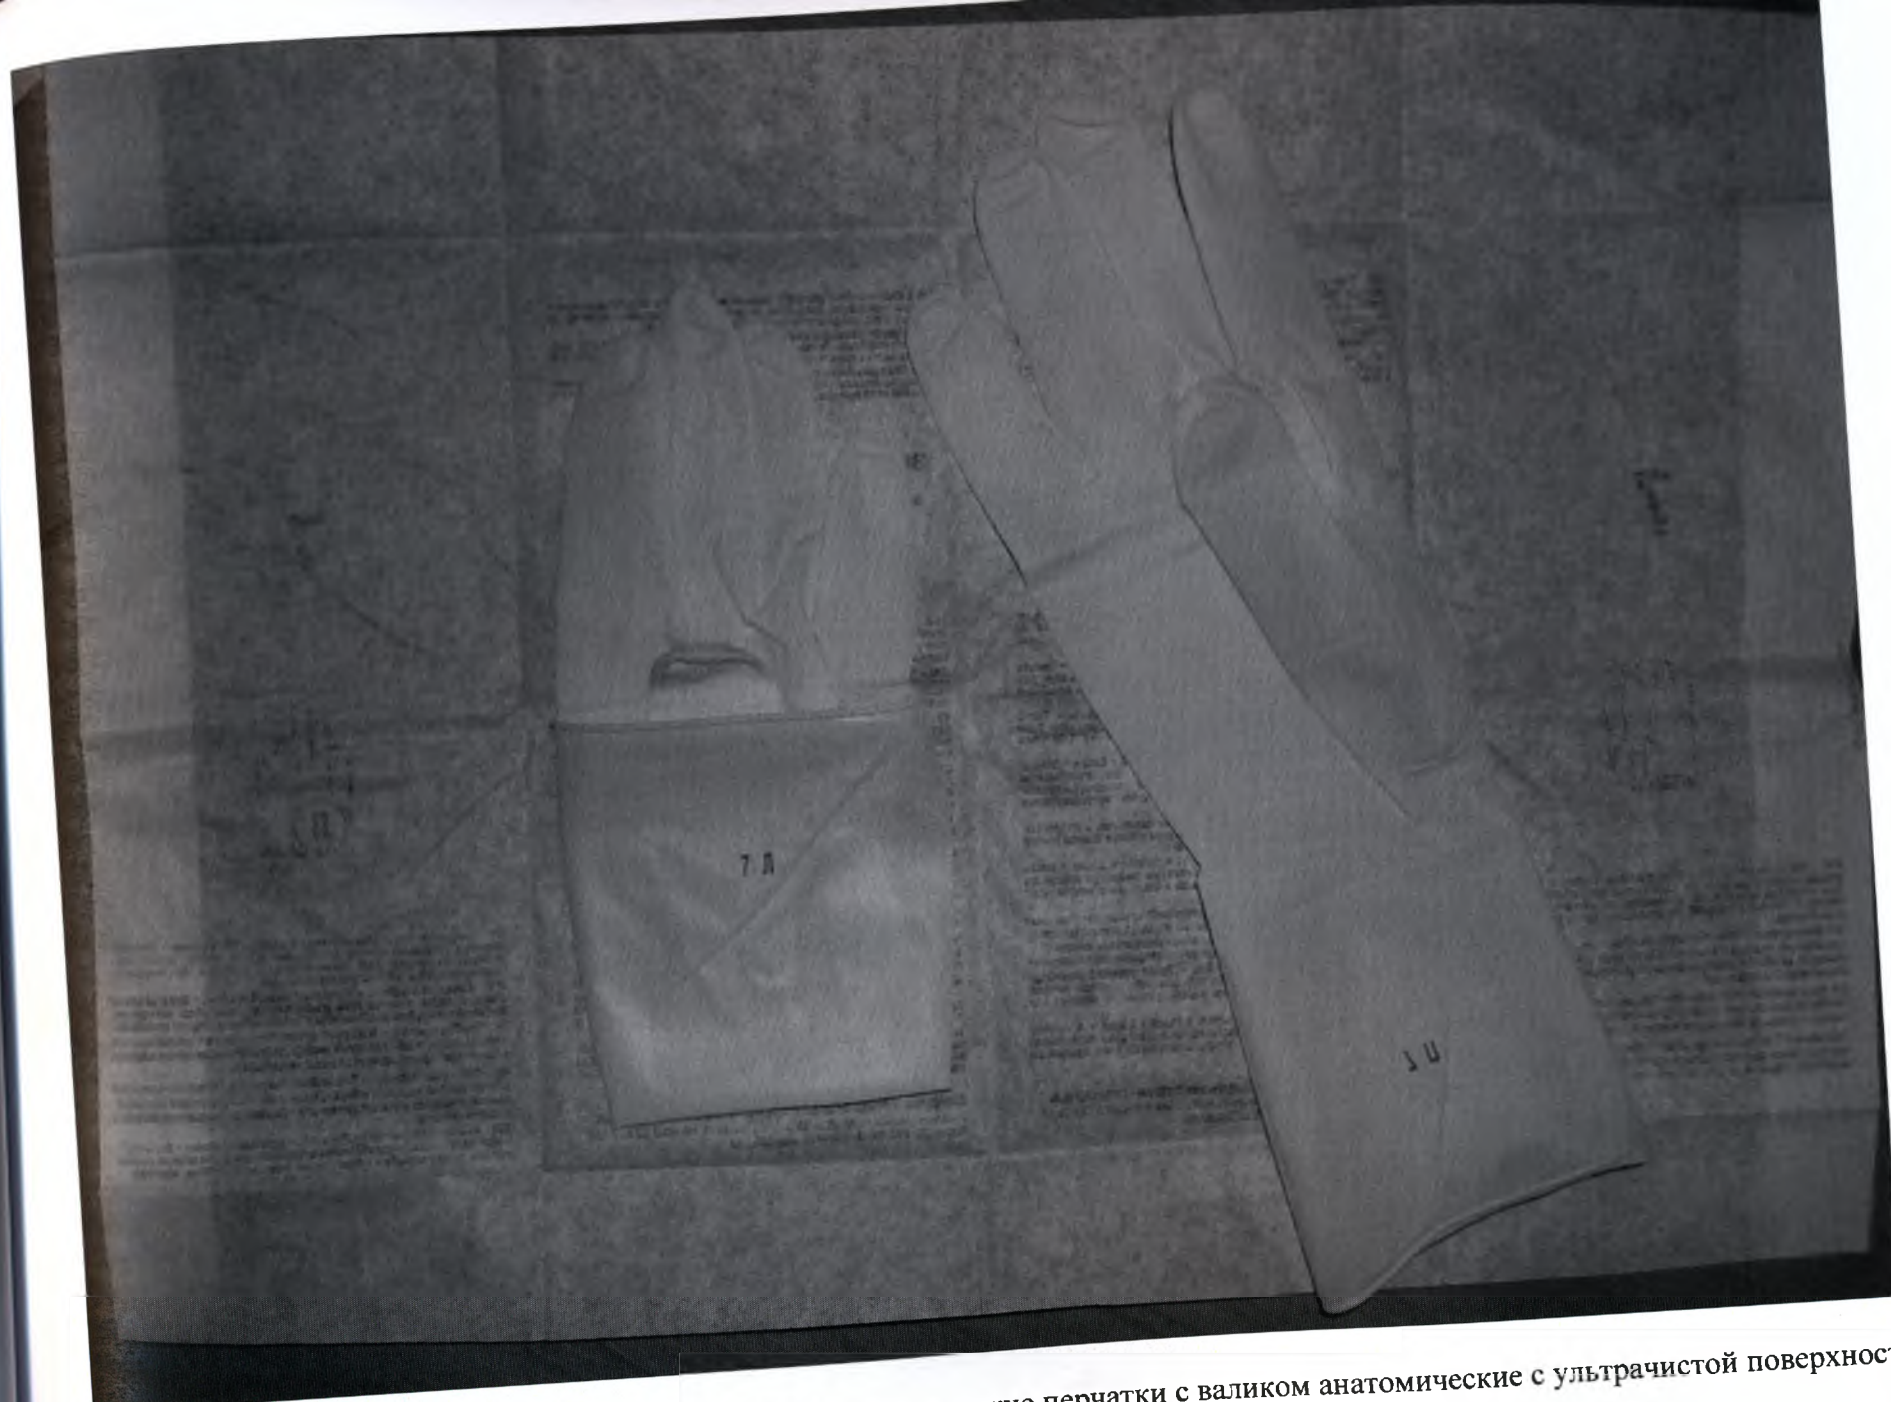

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1170

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Носительные перчатки из латекса Intouch MFX с усиленной поверхностью

INTW1170

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size:

7

ПАРА

SN: 117014005091

LOT: 117014-005

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01



STERILE R



CE 0086




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОБАЛКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 6, корпус 2А, офис 504-А.

G-PO-SNTPFF-R1

Упаковка для перчаток INTW1170

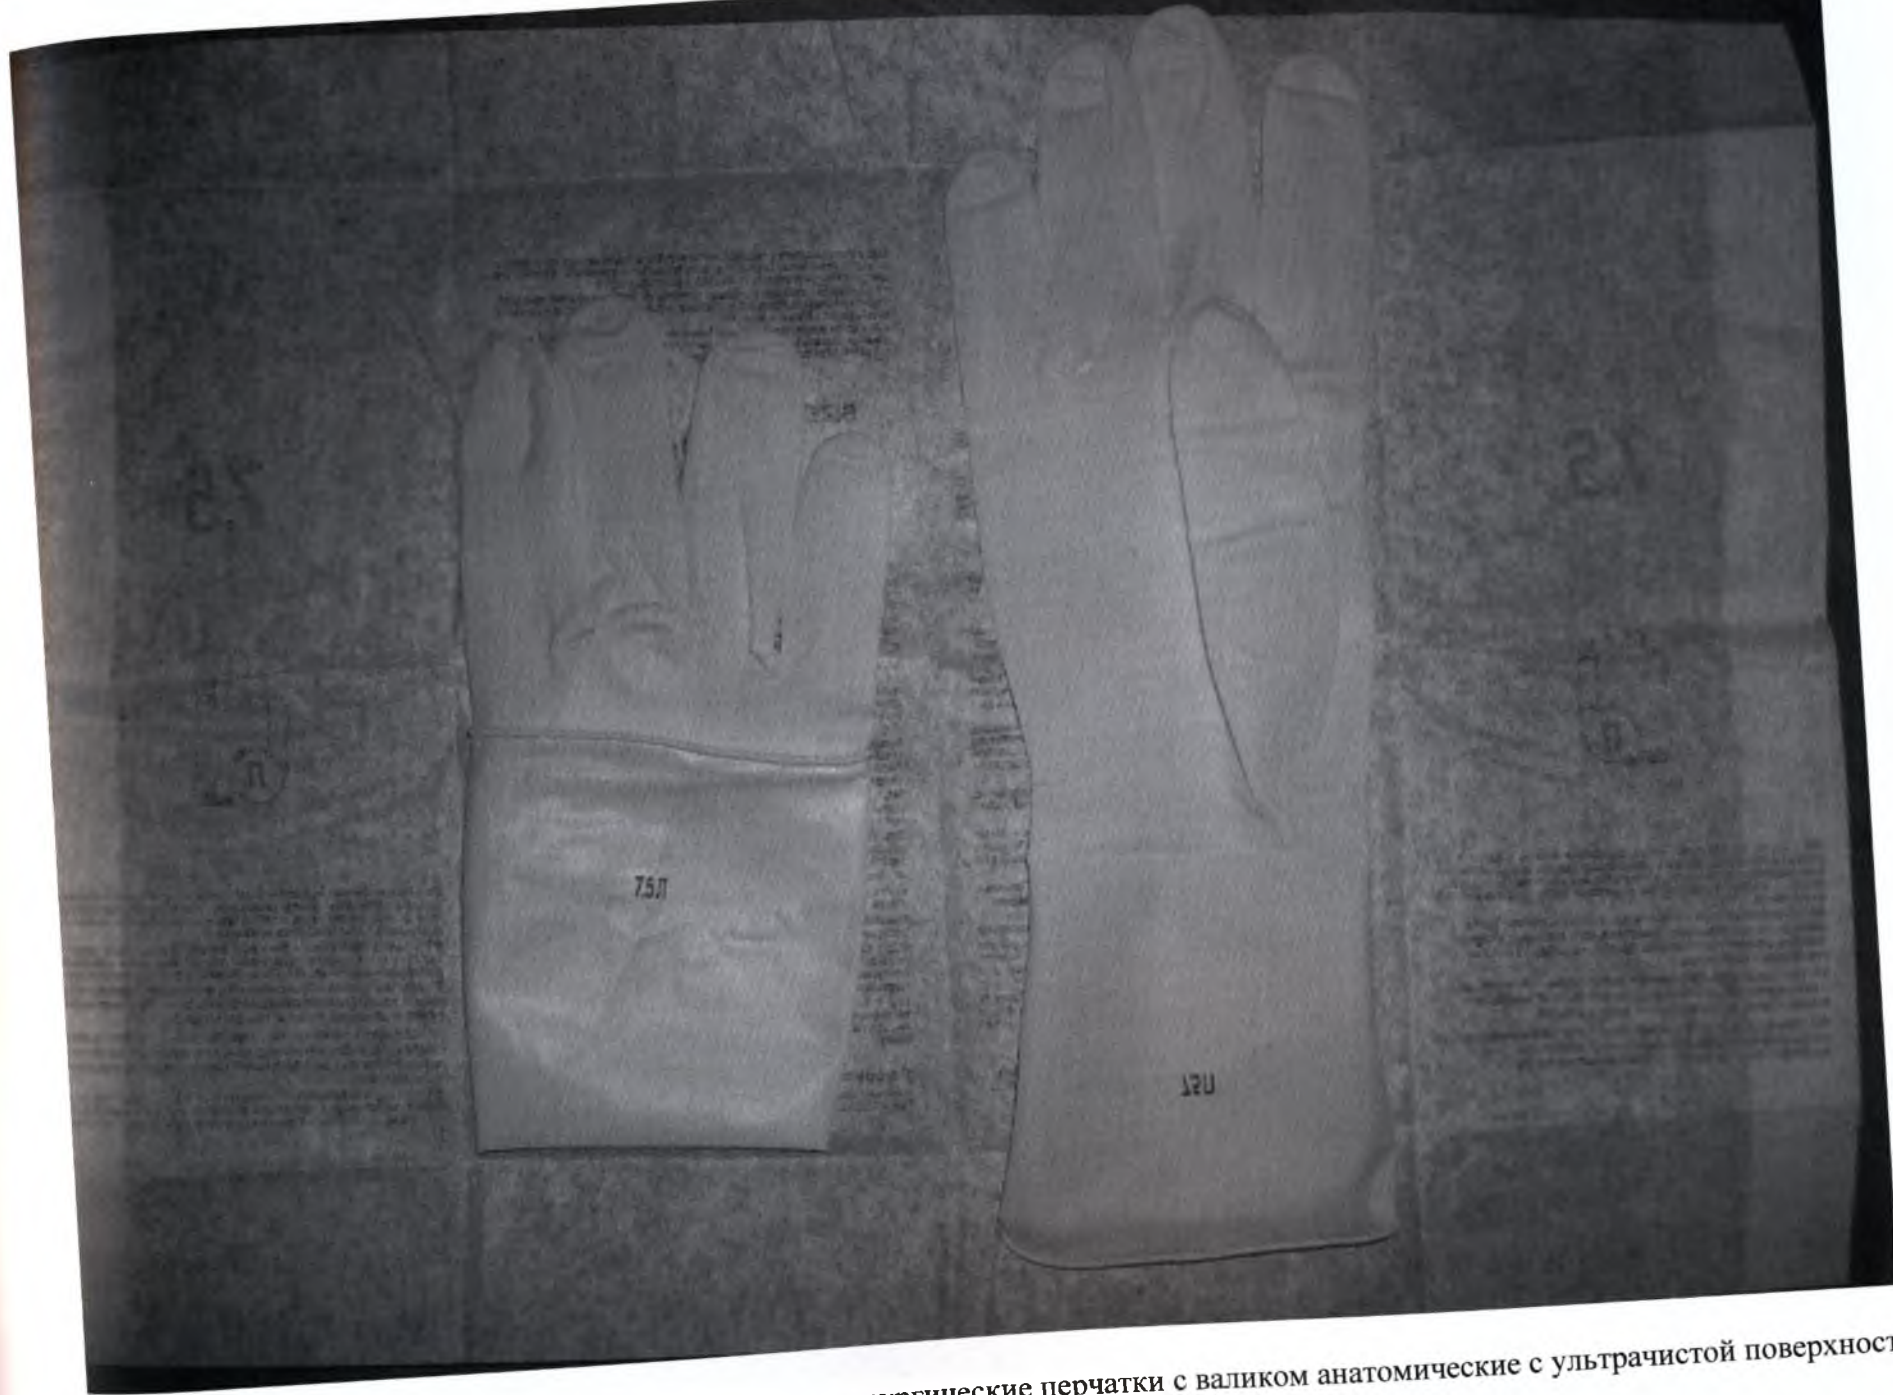

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1175

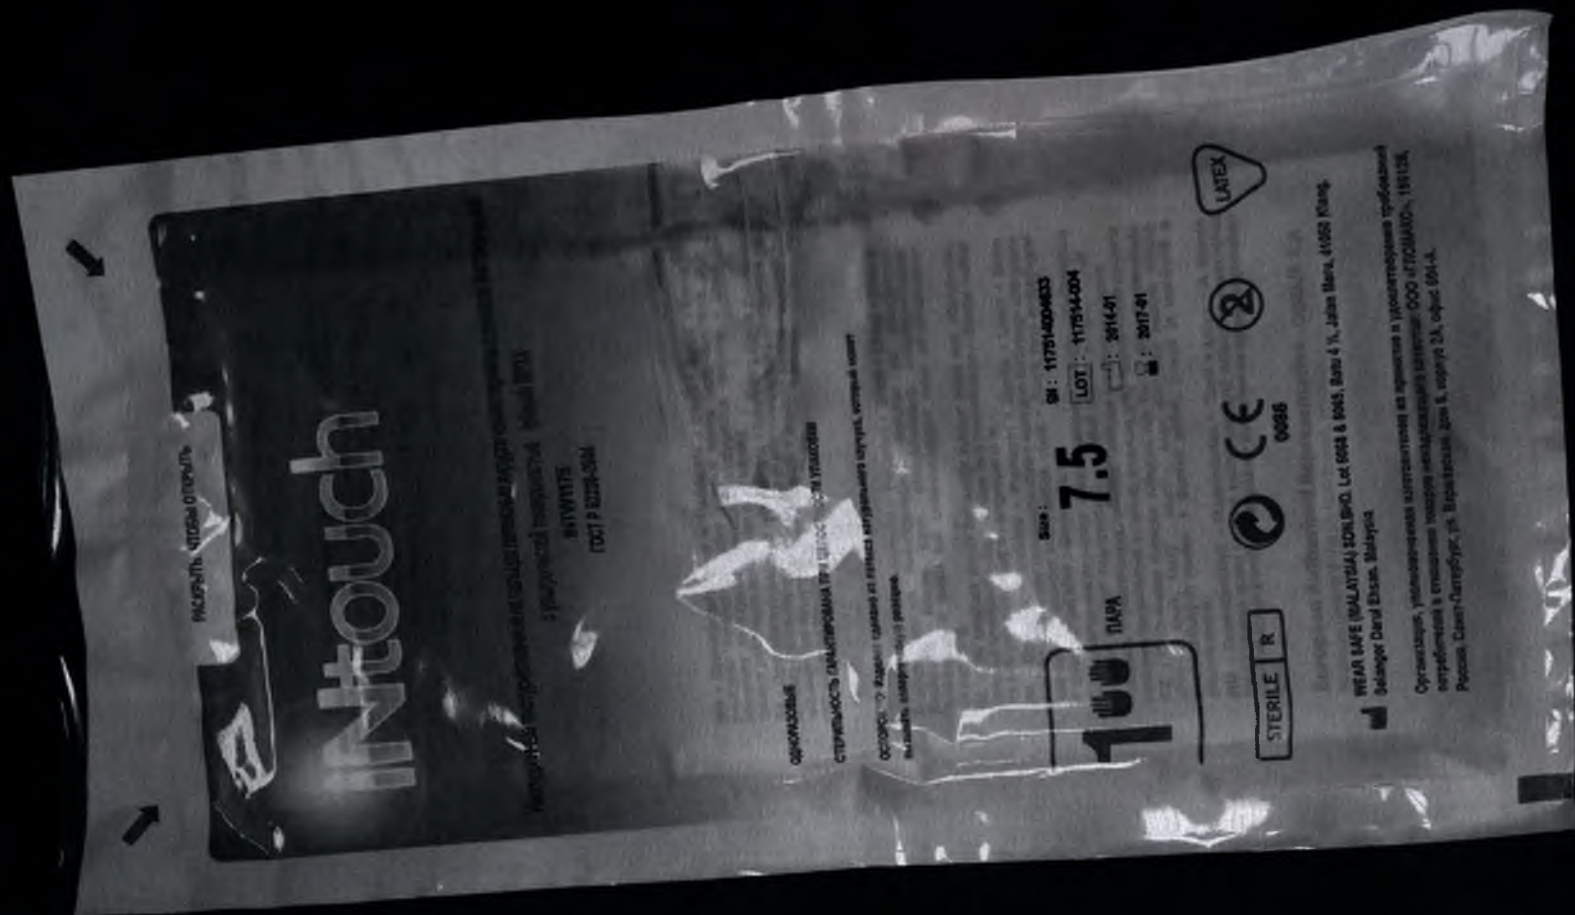

Упаковка для перчаток INTW1175



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1180

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Неслучайное тестирование на наличие латексных перчаток с латексом и латексом
с ультратонкой перчаткой Intouch MPX

INTW1180

ГОСТ Р 62238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может
вызывать аллергическую реакцию.

Size :

8

SN : 118014006365

LOT : 118014-006

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

ПАРА


STERILE R



CE 0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang.



Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW1180



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1185

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

INTOUCH

Нескользящая текстура поверхности на пальцах латексных перчаток обеспечивает надежное сцепление с инструментами и оборудованием.
с ультрамягкой пористостью Intouch AIR-X

INTW1185

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size :

8.5

ПАРА

SN : 118514003189

LOT : 118514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01



STERILE R



CE

0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 6068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang.


Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавский, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW1185



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические с ультрачистой поверхностью
Intouch MPXX INTW1190

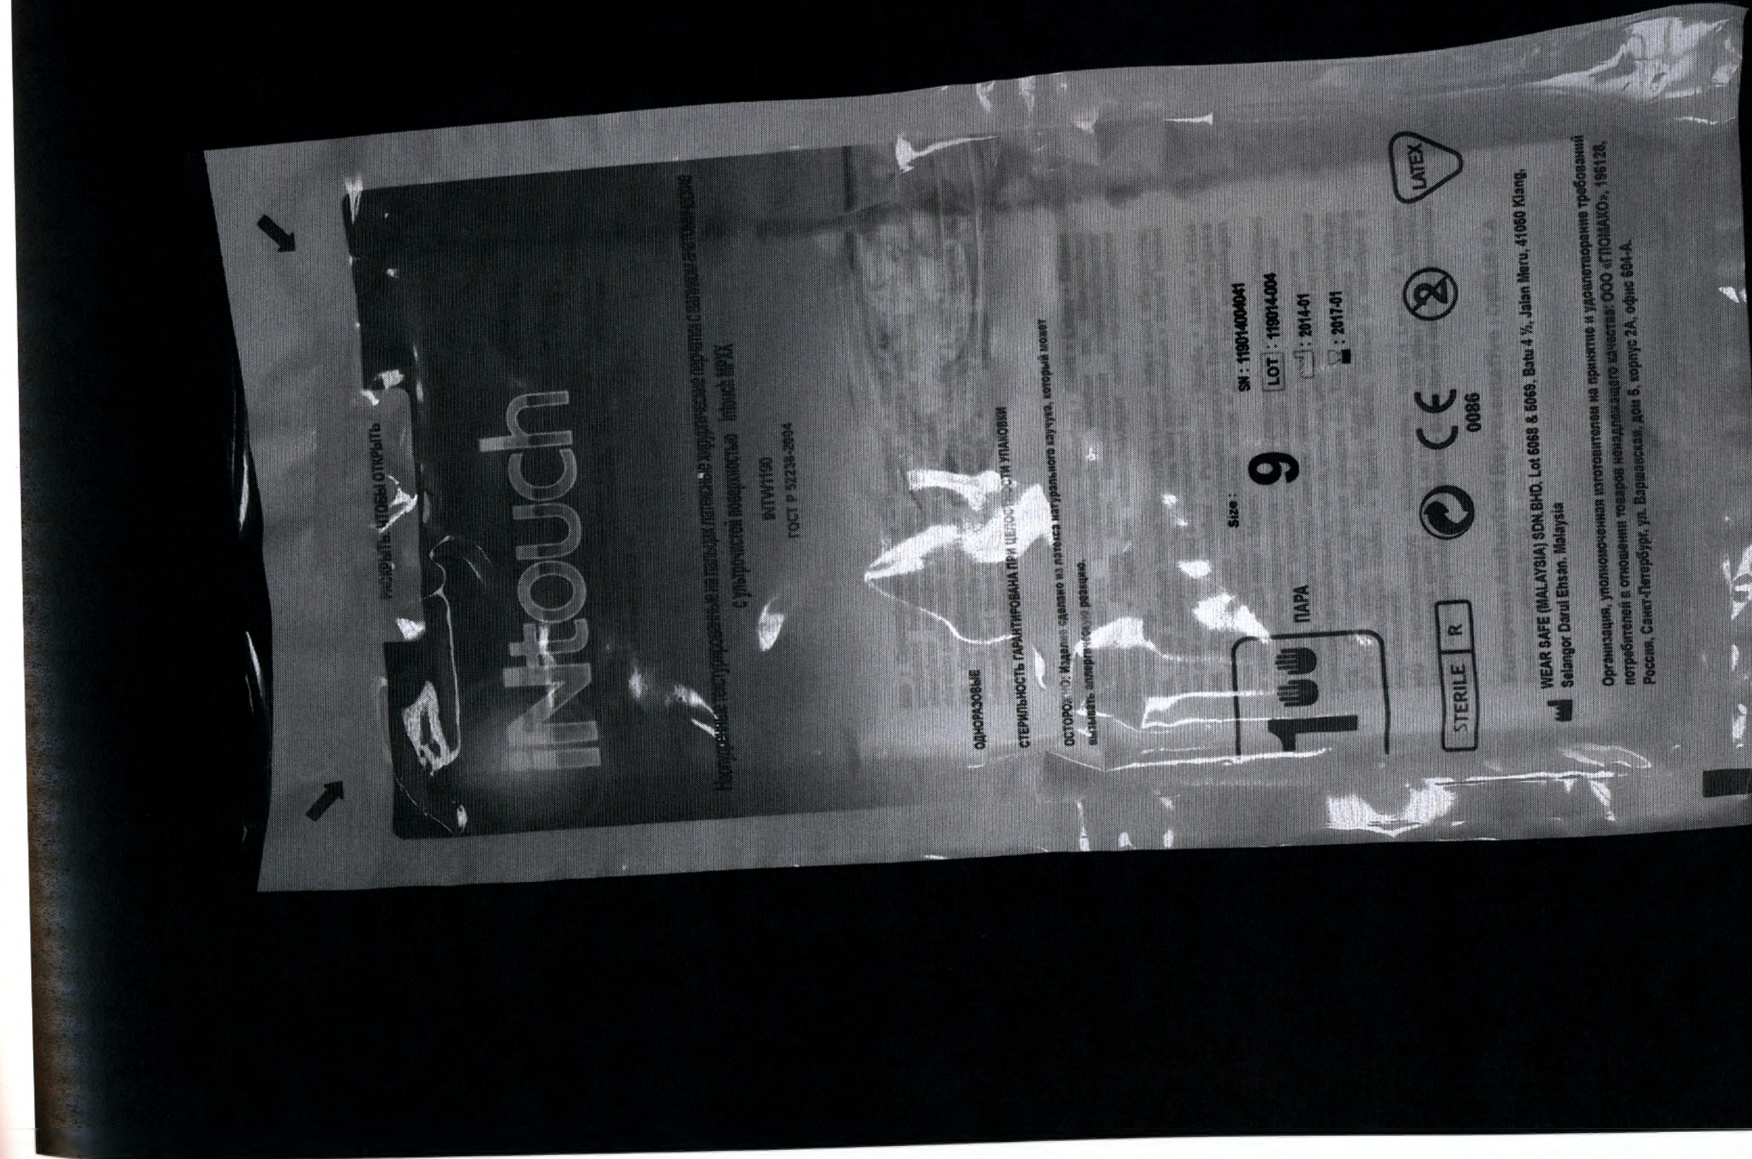

Упаковка для перчаток INTW1190



Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1255

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :
5.5

SN : 125514002240

LOT : 125514-002

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные и уточненные на пальцах латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro
INTW1255

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086




100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

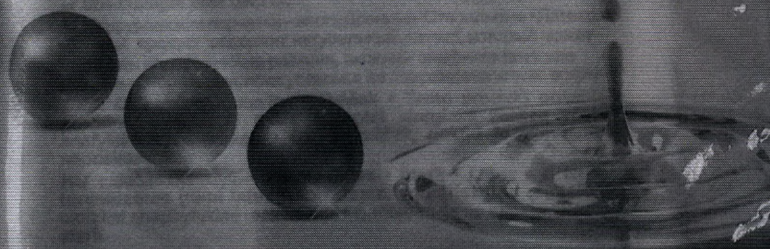


WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW1255

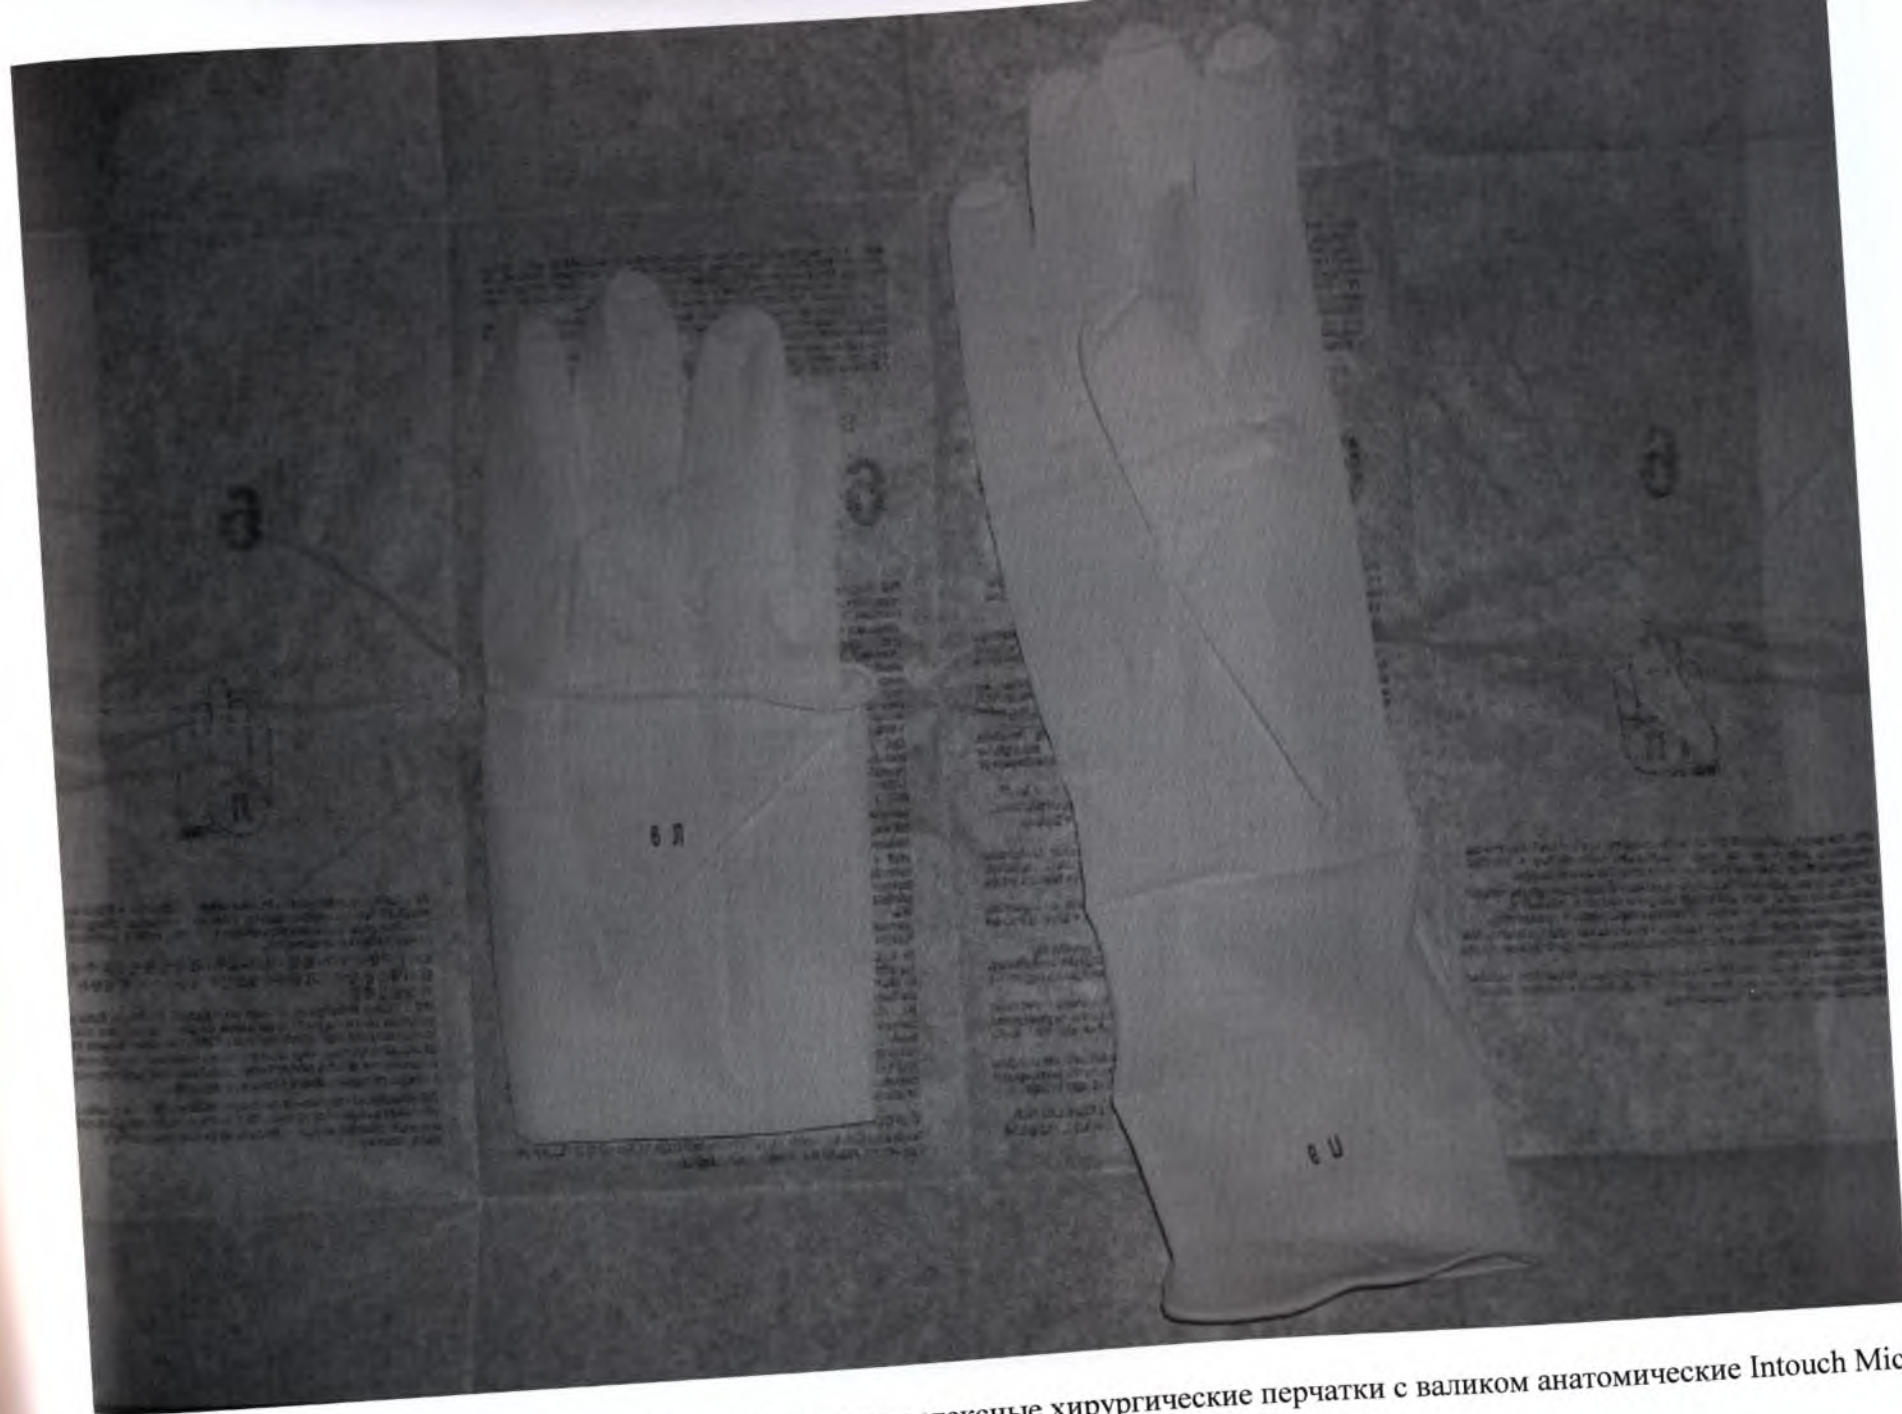

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1260

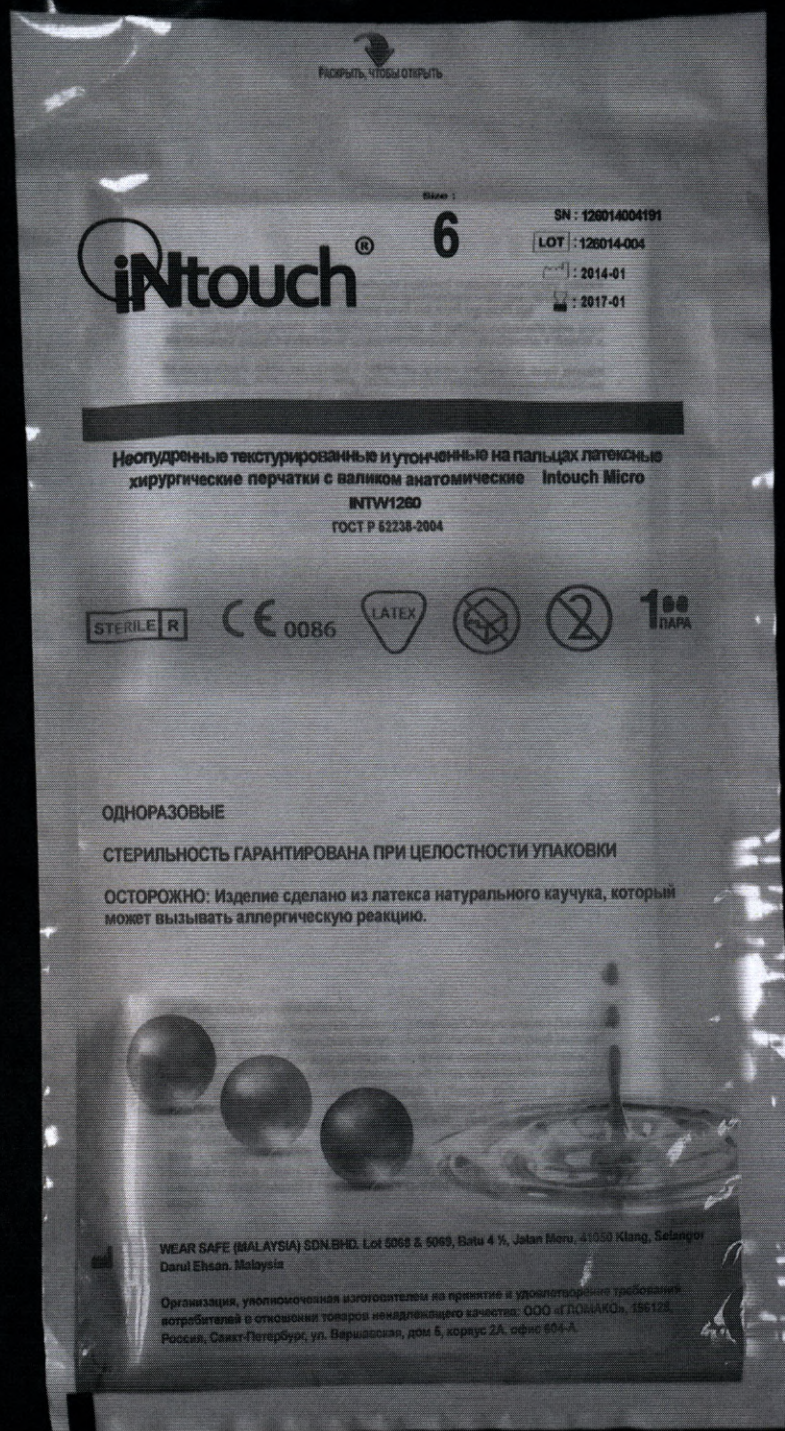

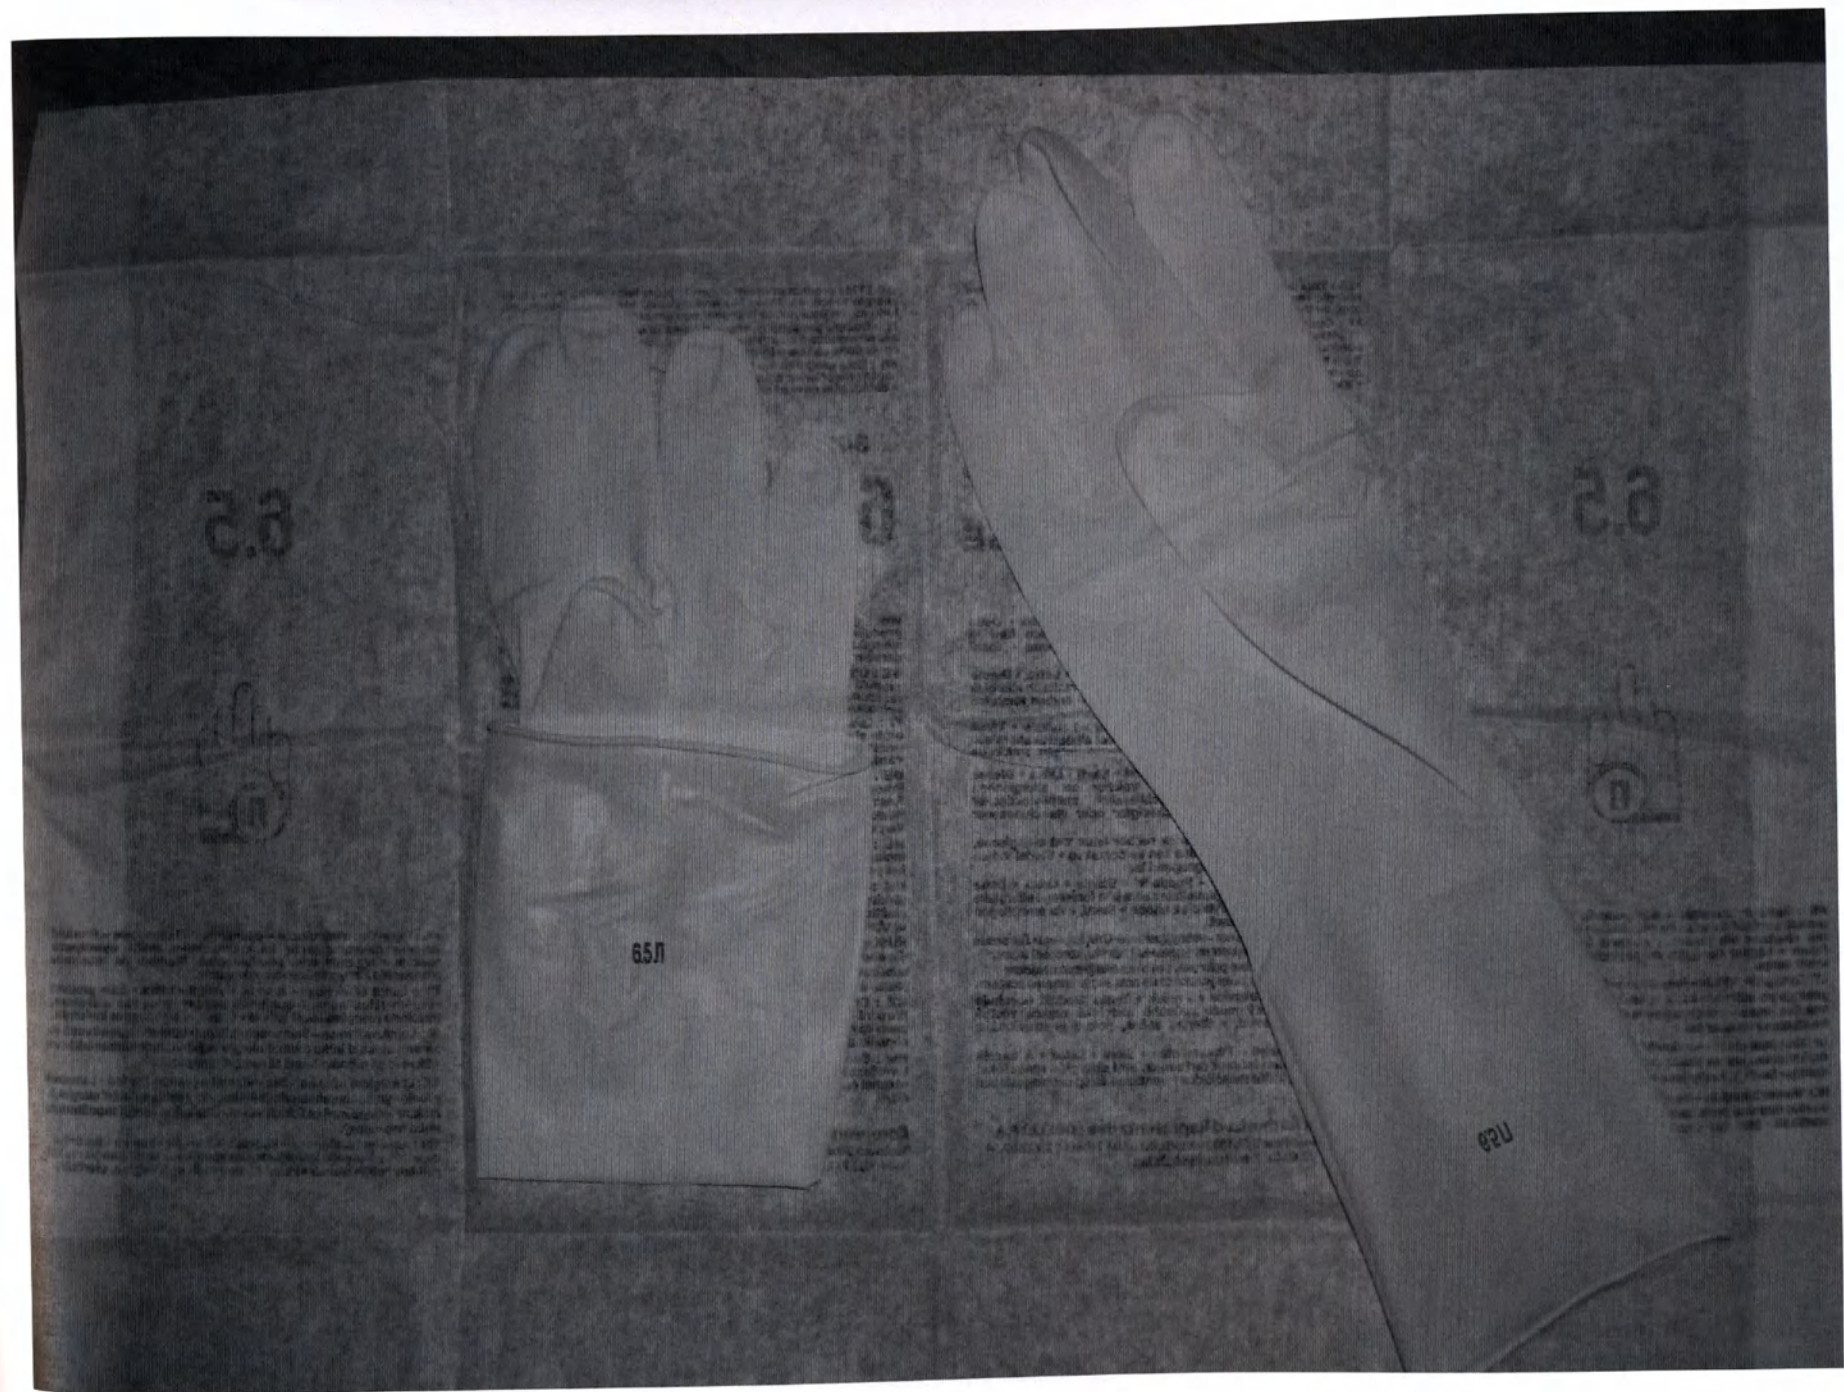

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1265

iNtouch®

Size : **6.5**

SN : 126514003136

LOT : 126514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro

INTW1265

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Merv, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

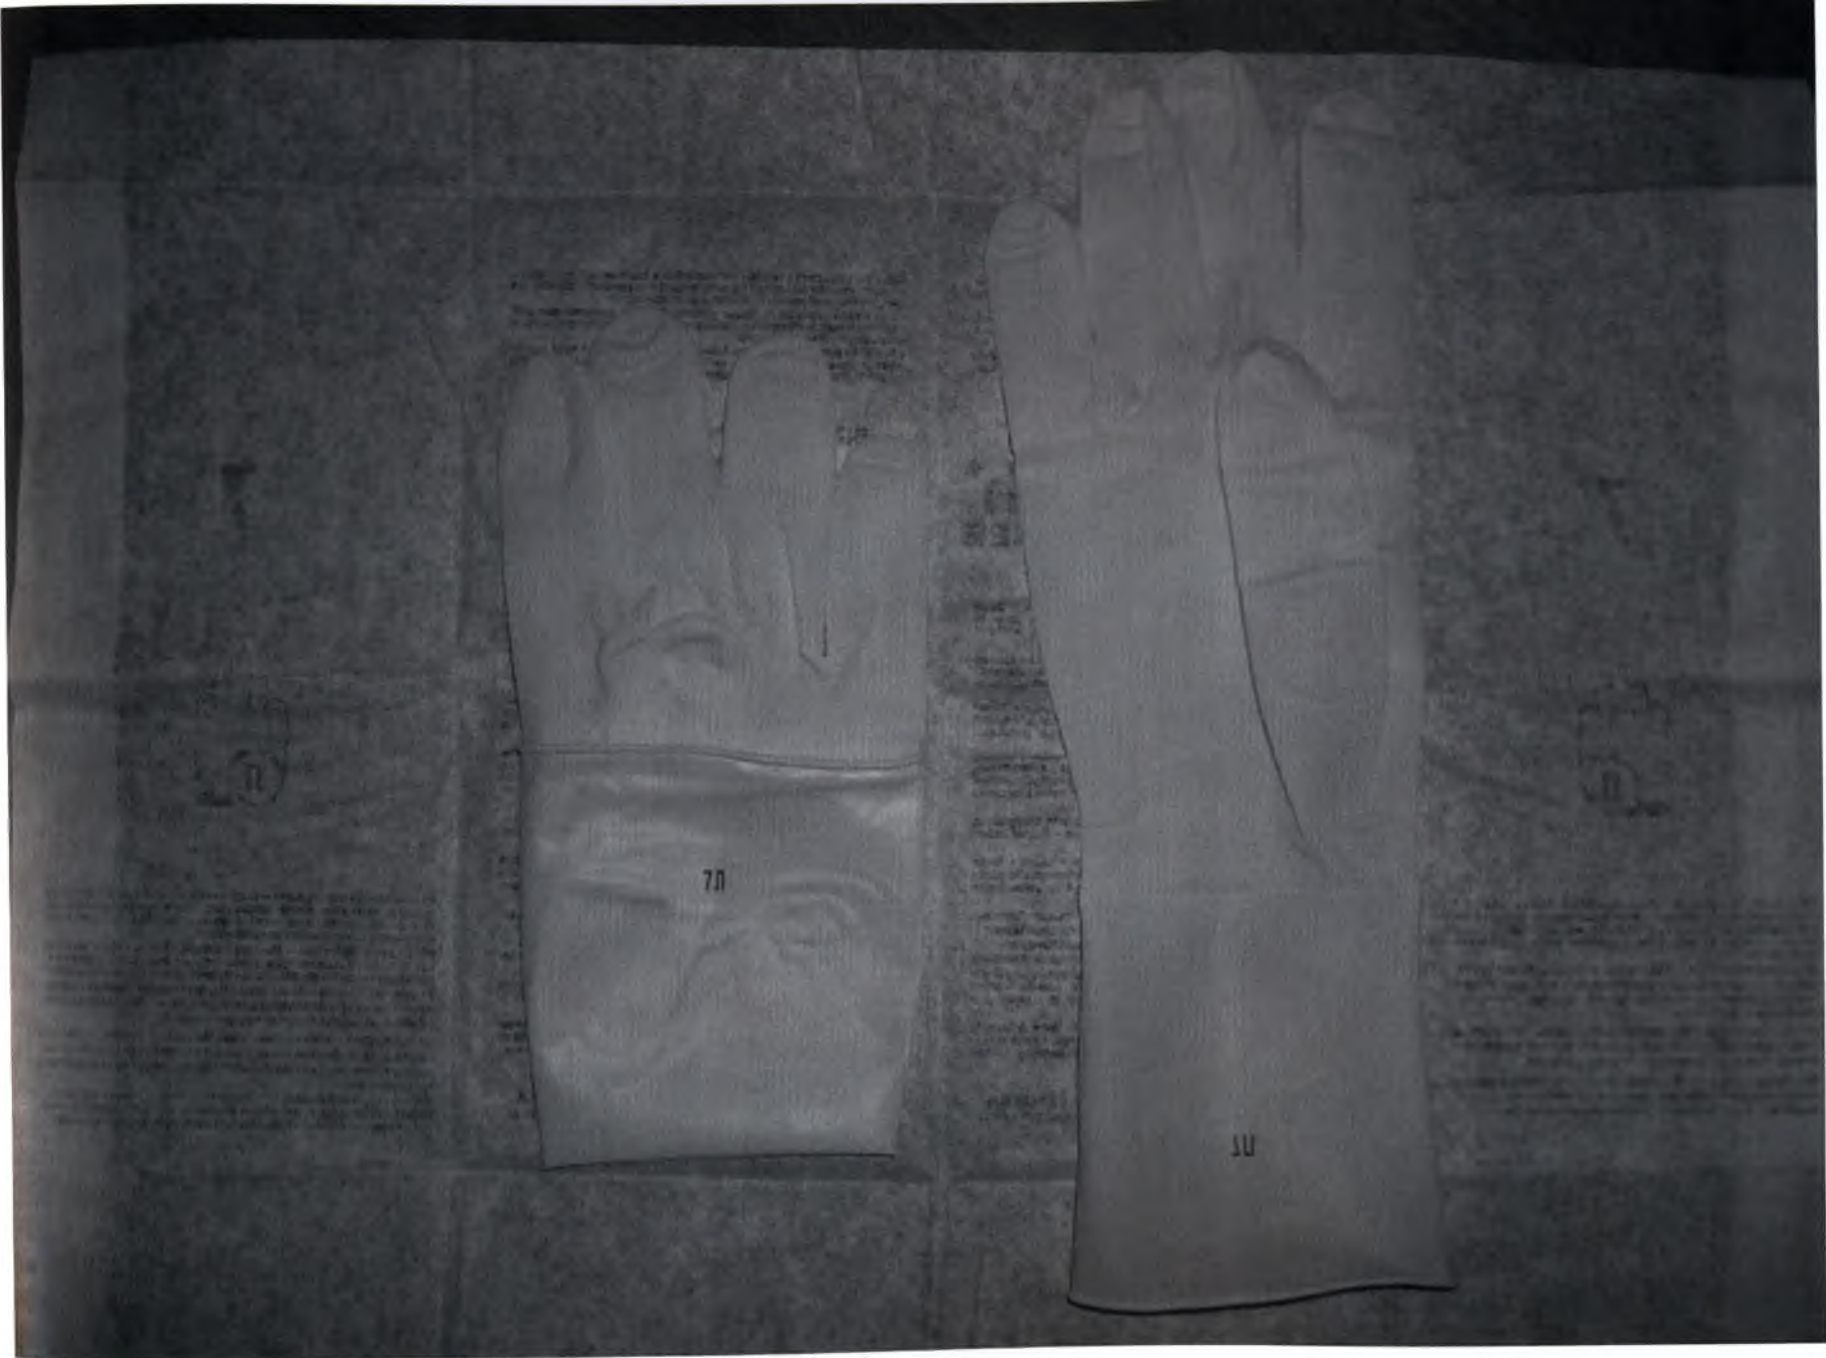

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1270

раскрыть, чтобы открыть

SN : 127014003305

LOT : 127014-003

EXP : 2014-01

LOT : 2017-01

size :

7

intouch®

Неопудренные текстурированные и утолщенные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro

INTW1270

ГОСТ Р 82238-2004

100
ПАРА

STERILE R

CE 0086

LATEX




ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который


может вызывать аллергическую реакцию.

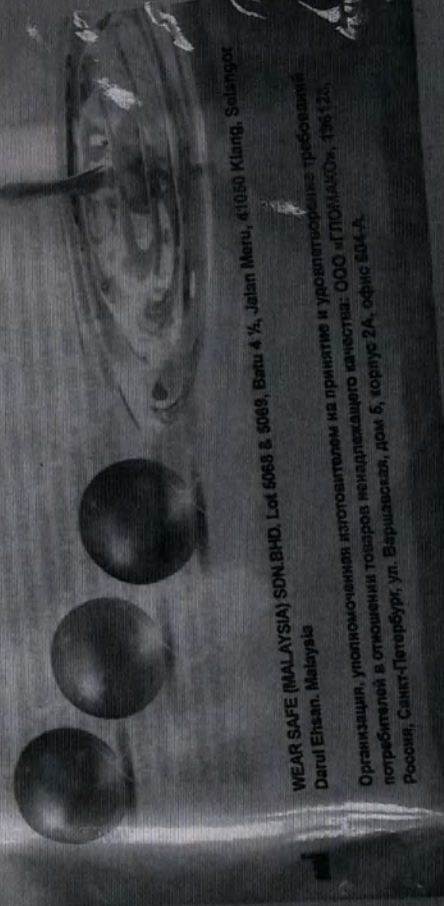

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD, Lot 6065 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504А.

Упаковка для перчаток INTW1270

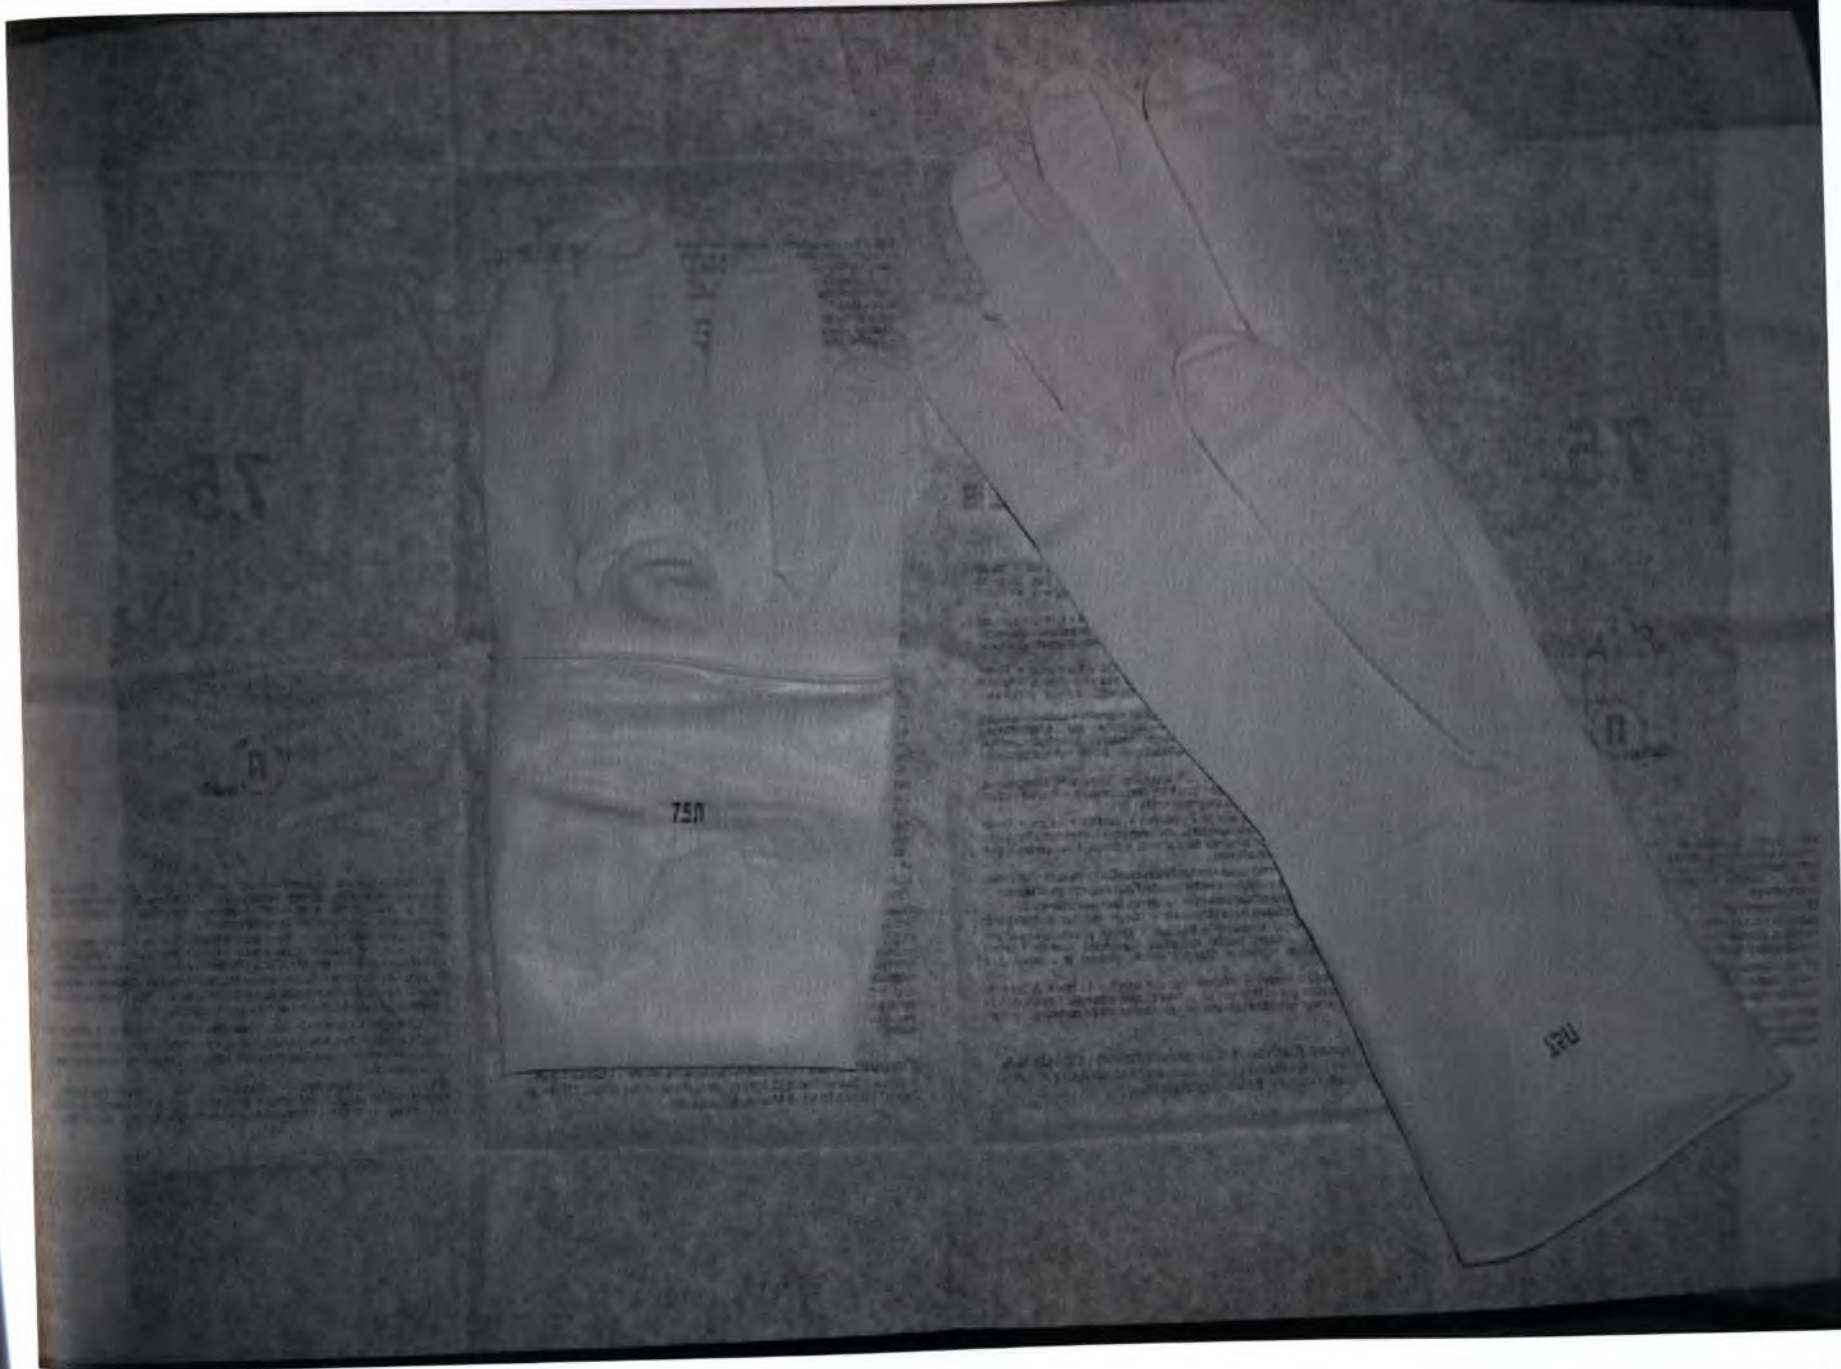

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1275

Упаковка для перчаток INTW1275

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size: 7.5

SN: 127614002457

LOT: 127614-002

EXP: 2014-01

EXP: 2017-01

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro

INTW1275

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086




100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

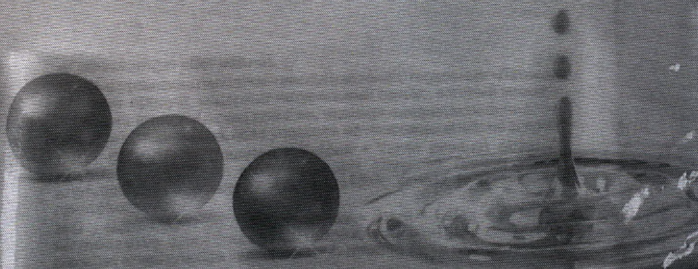

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504-А.

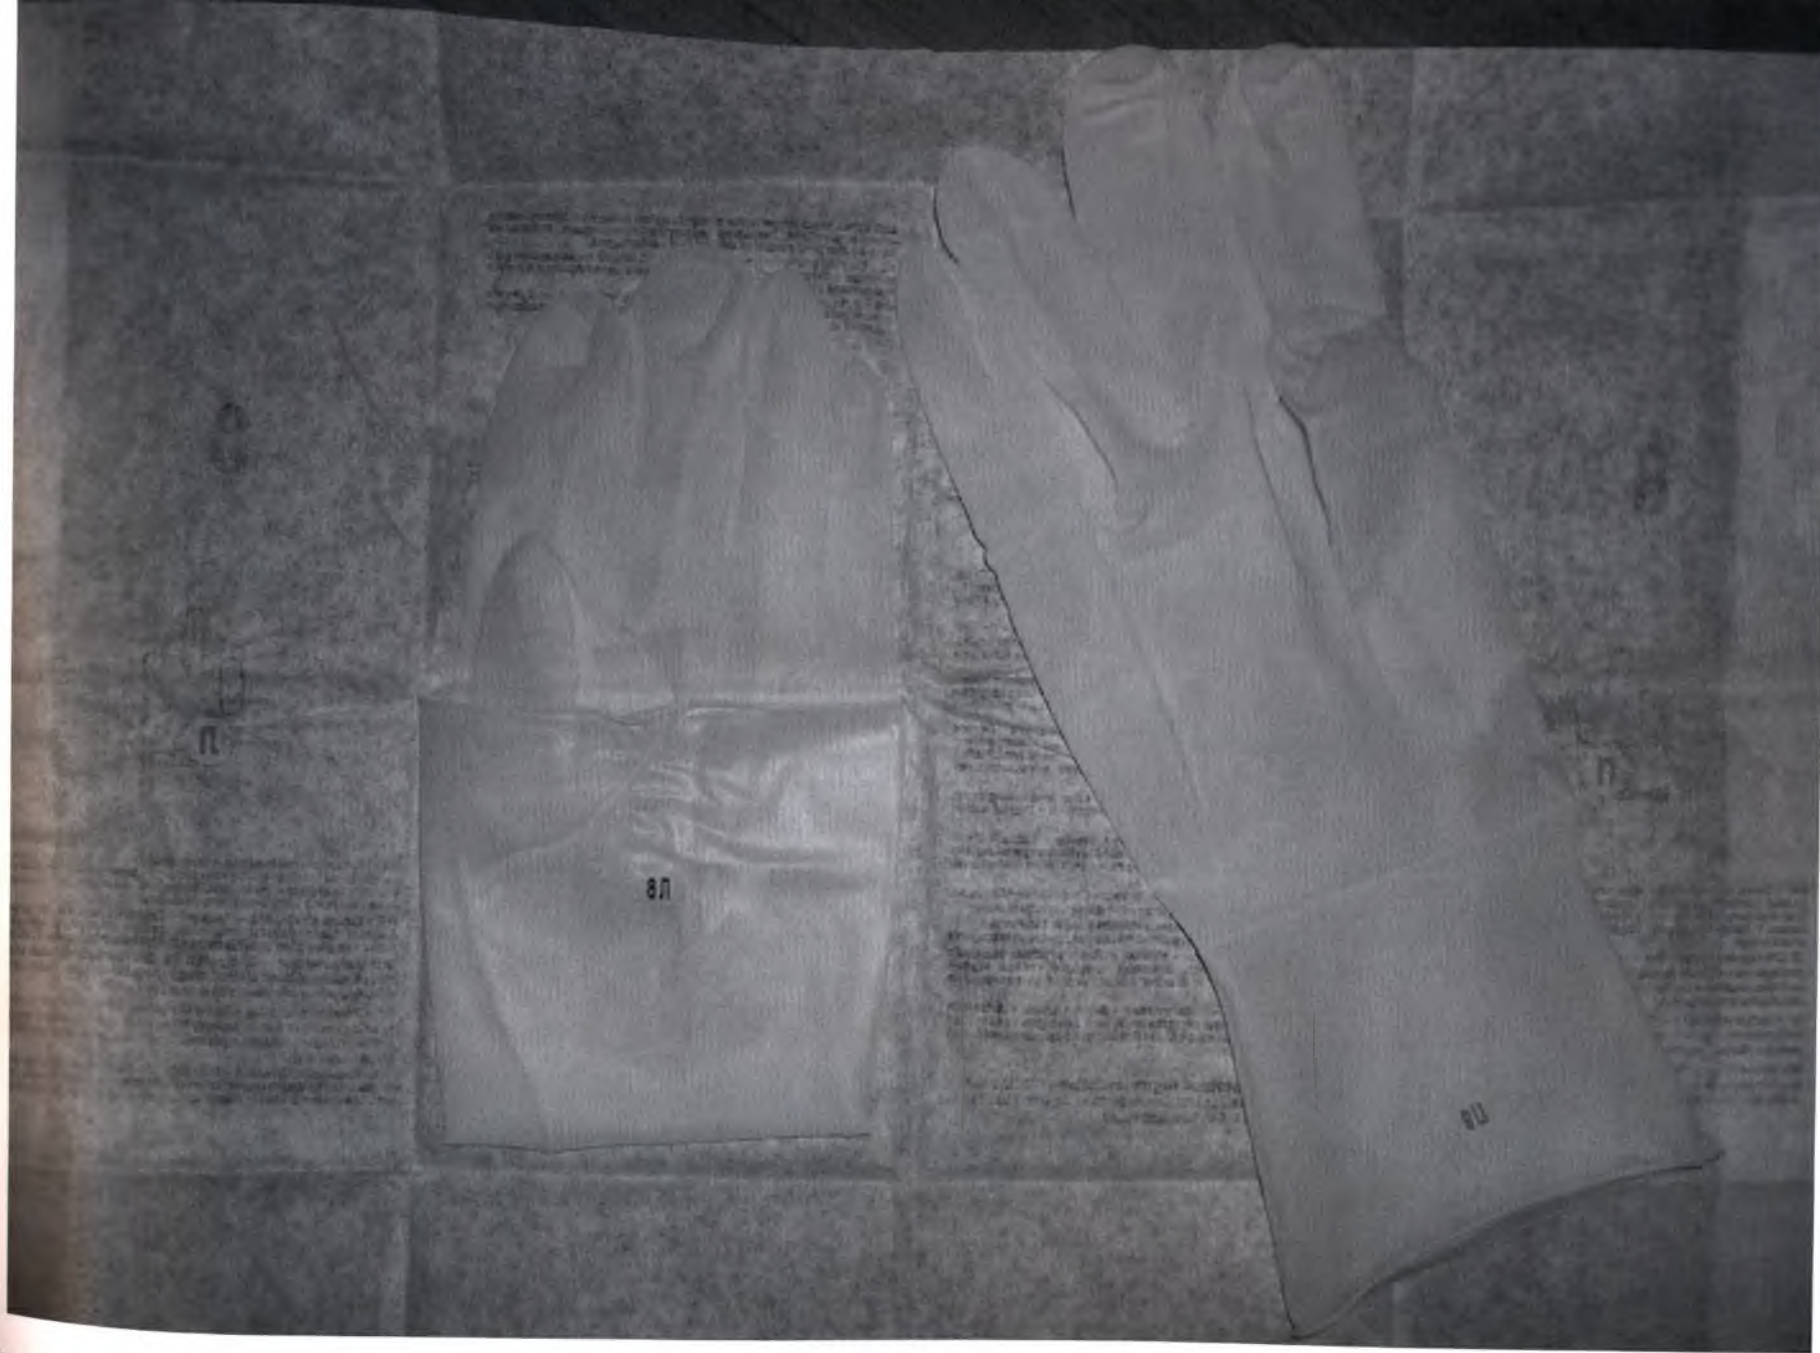

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1280

iNtouch®

Size :

8

SN : 128014006134

LOT : 128014-006

2014-01

2017-01

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro

INTW1280

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX




100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

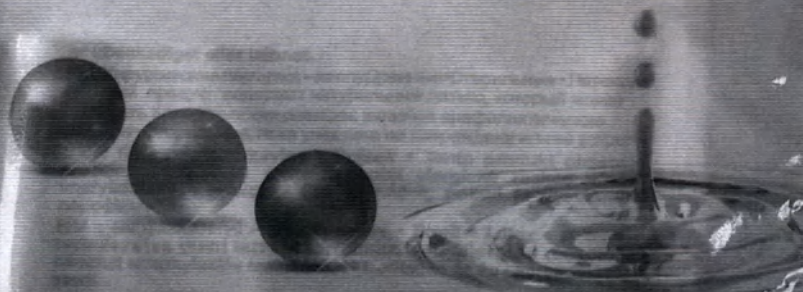

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1285

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :
8.5

SN : 128514004527

LOT : 128514-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro

INTW1285

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров надлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.



Неопудренные текстурированные и утонченные на пальцах латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Micro INTW1290

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

9

SN : 129014003423

LOT : 129014-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопреновые текстурированные и утонченные на пальцах латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические iNtouch Micro

INTW1290

ГОСТ Р 62238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100
DAPS

ОДНОРАЗОВЫЕ


СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Mera, 41010 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на продажу и обслуживание продукции
потребителей в отношении товаров вандициальной клиники: ООО «ЦИРМИ», 154124
Россиа, Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 8, корпус 2А, офис 504.3

Упаковка для перчаток INTW1290

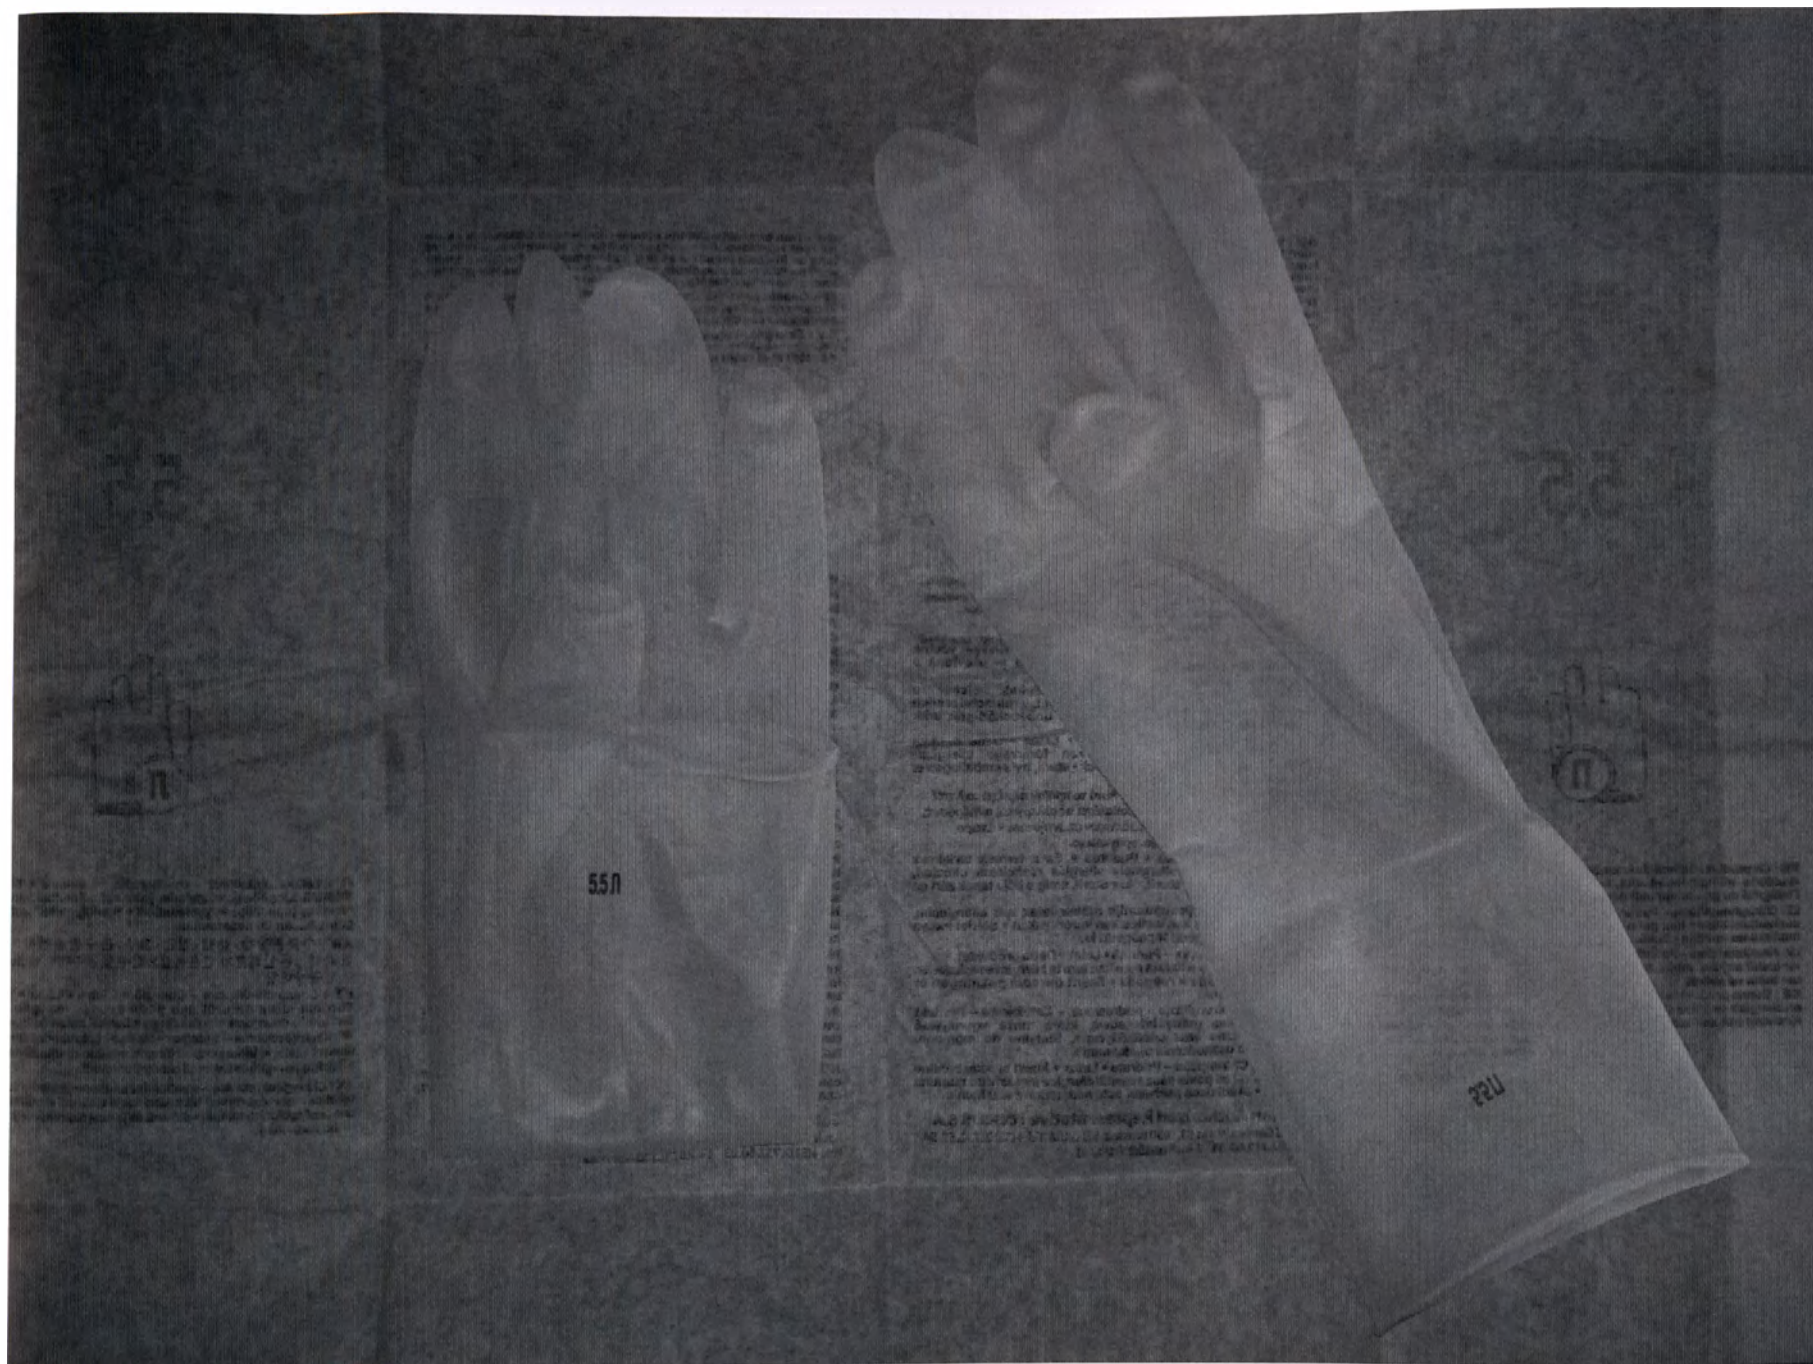

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0355

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :

5.5

SN : 035514004114

LOT : 035514-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide

INTW0355

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX




100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

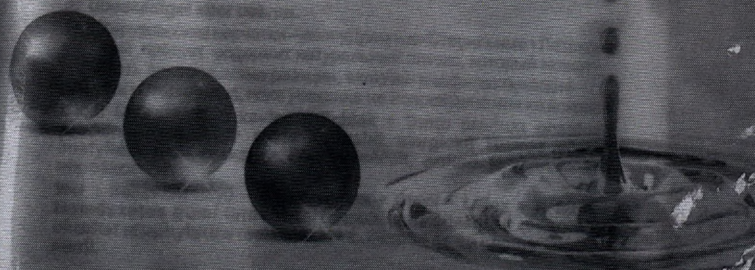


WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 195120, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0355

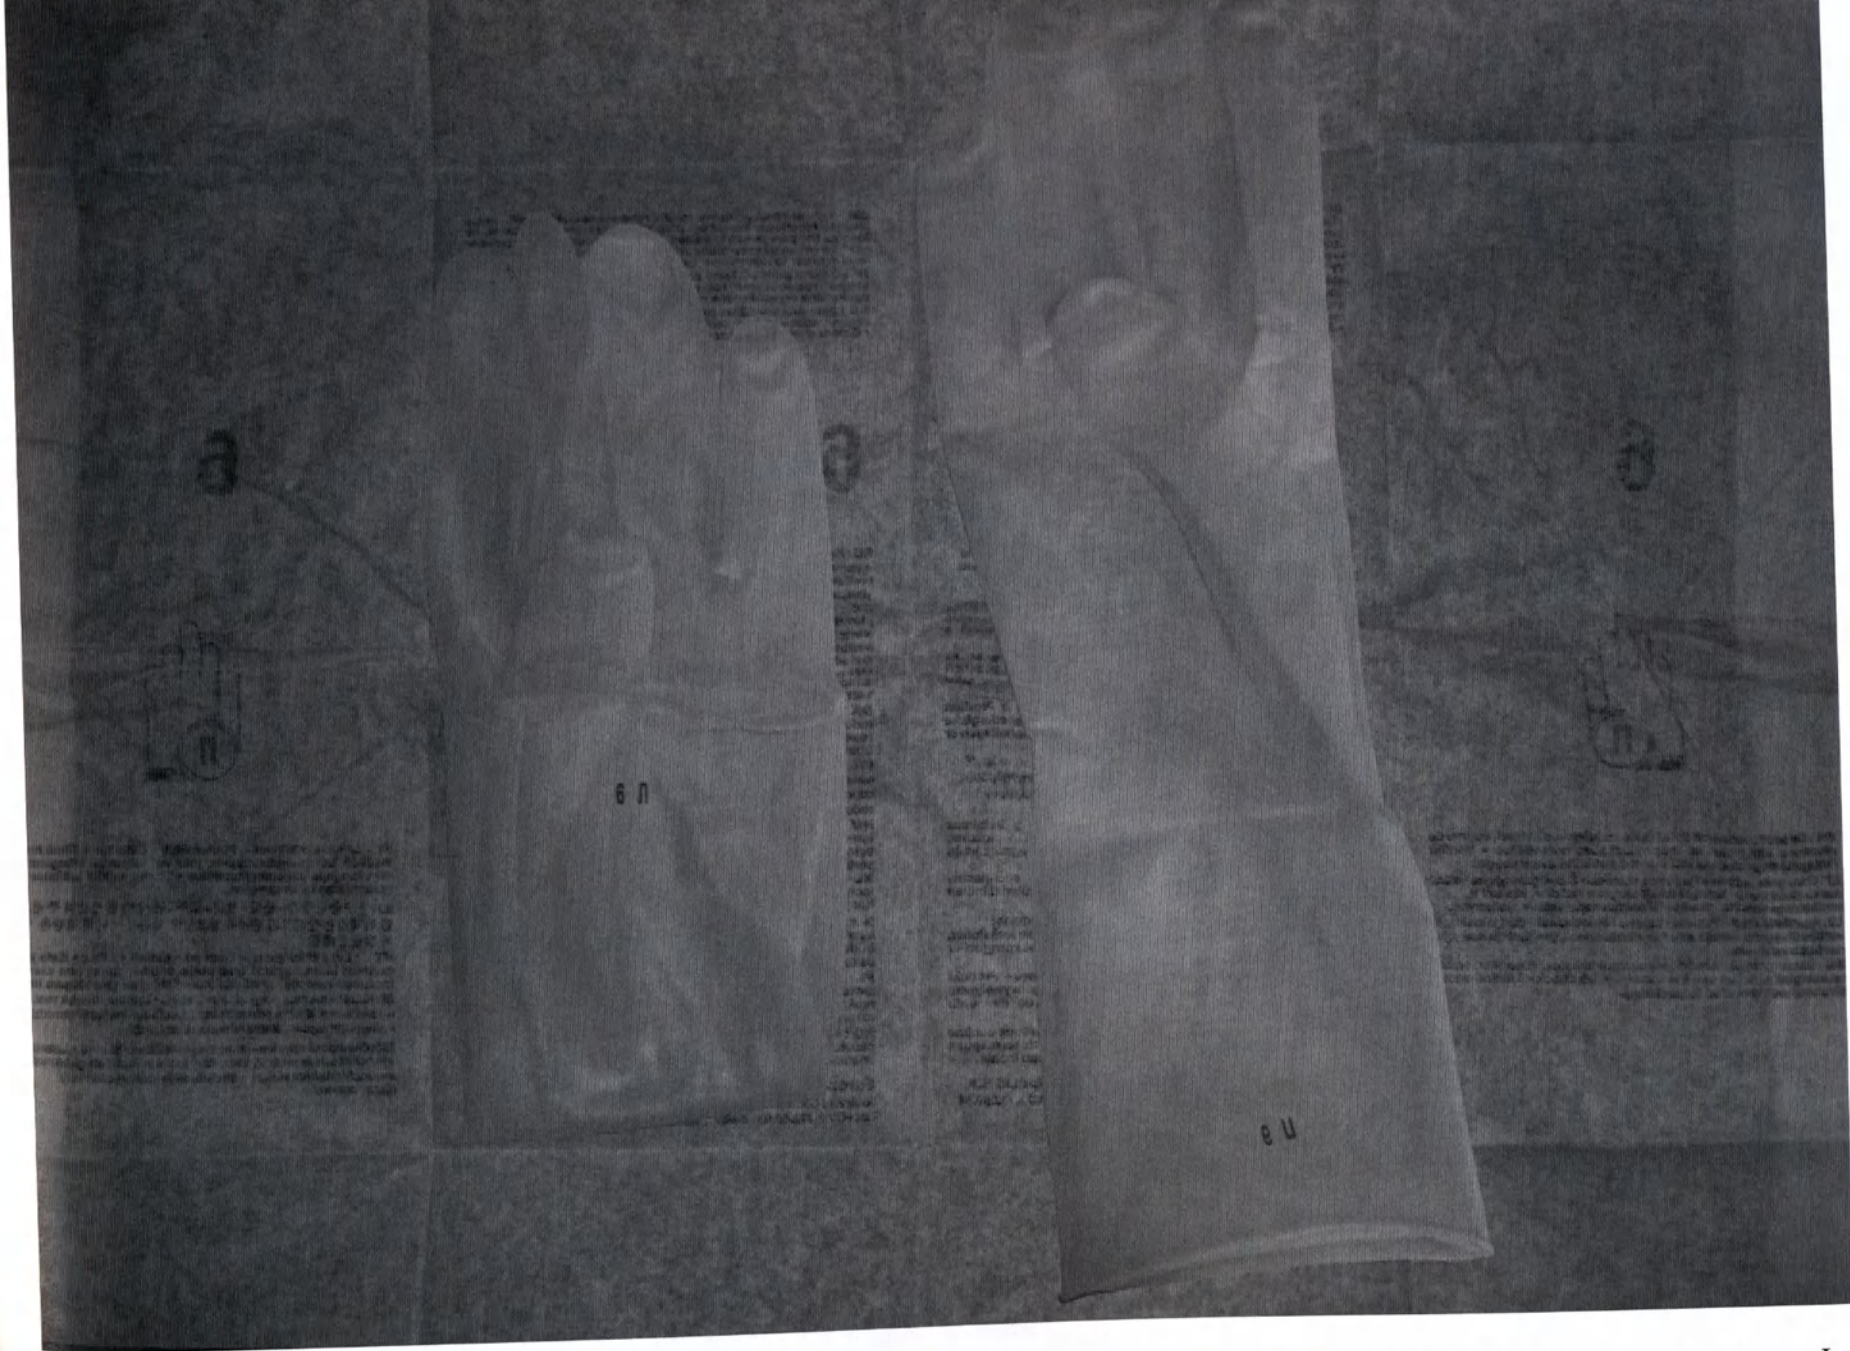

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide INTW0360

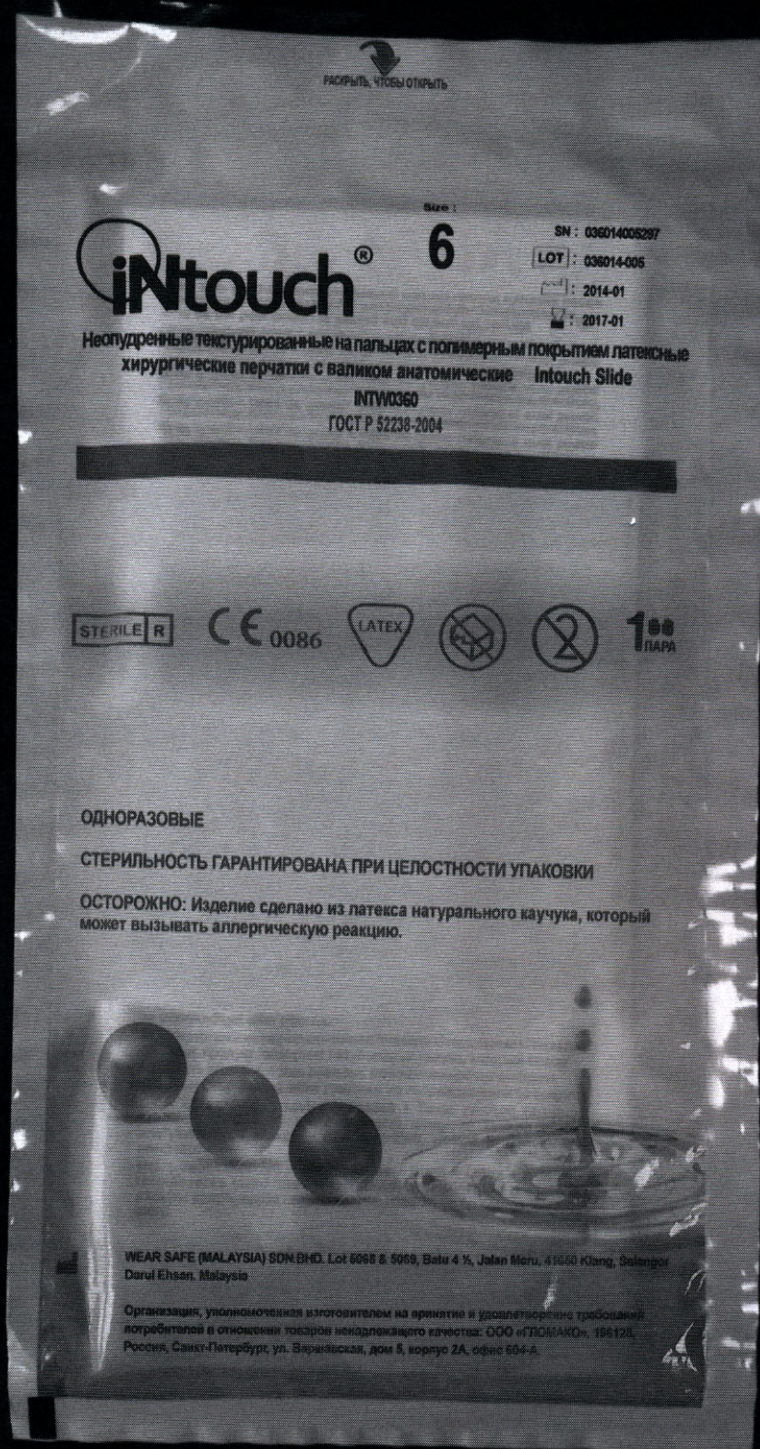

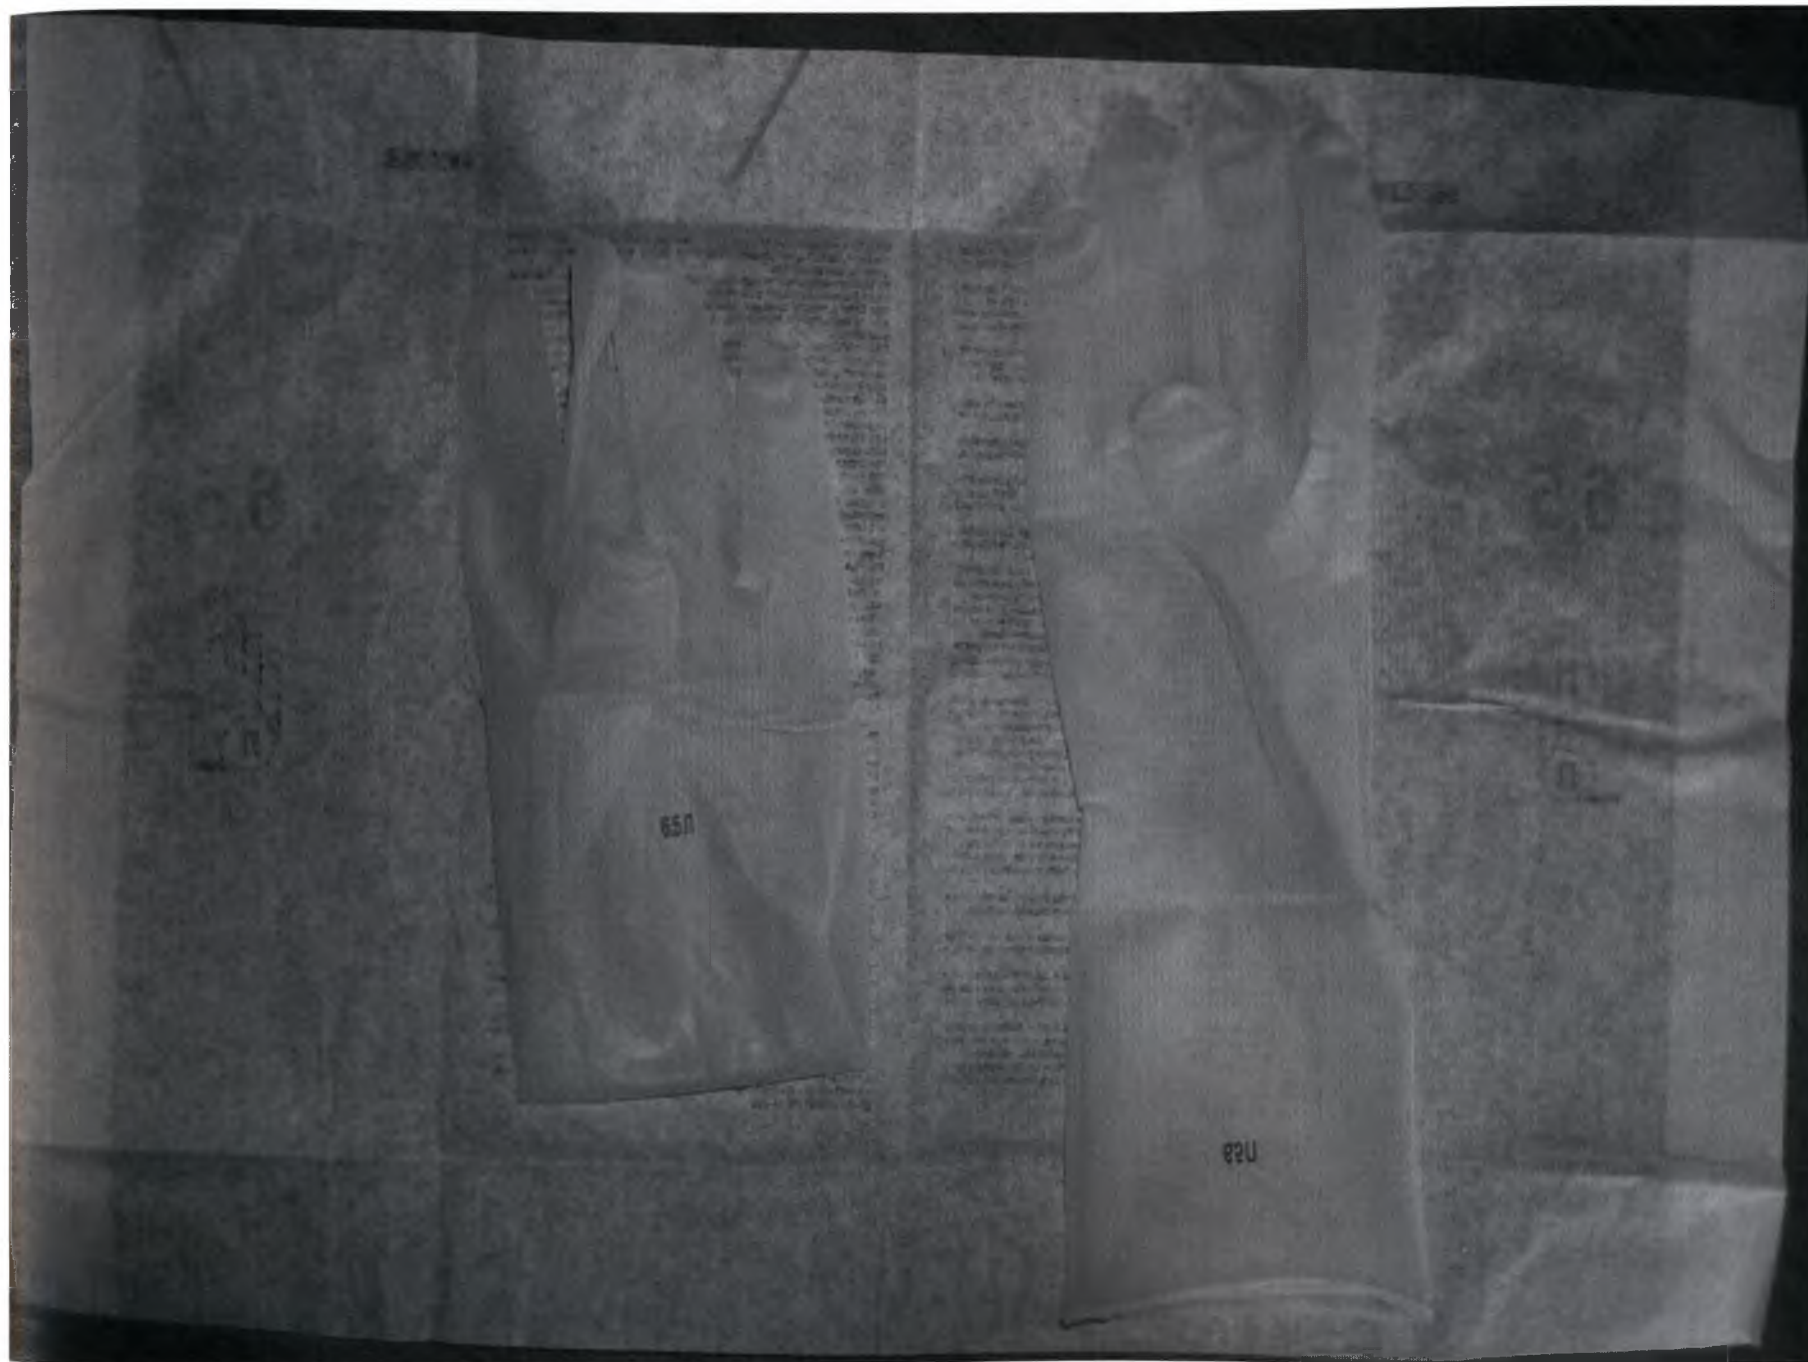

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0365

↑
РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :
6.5

SN : 036514004480

LOT : 036514-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide

INTW0365

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41060 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196120,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 804-А.

Упаковка для перчаток INTW0365



Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide INTW0370

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :

7

SN : 037014004032

LOT : 037014-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide

INTW0370

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD, Lot 5065 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ЦИПМИ», 196120, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 804-А.

Упаковка для перчаток INTW0370

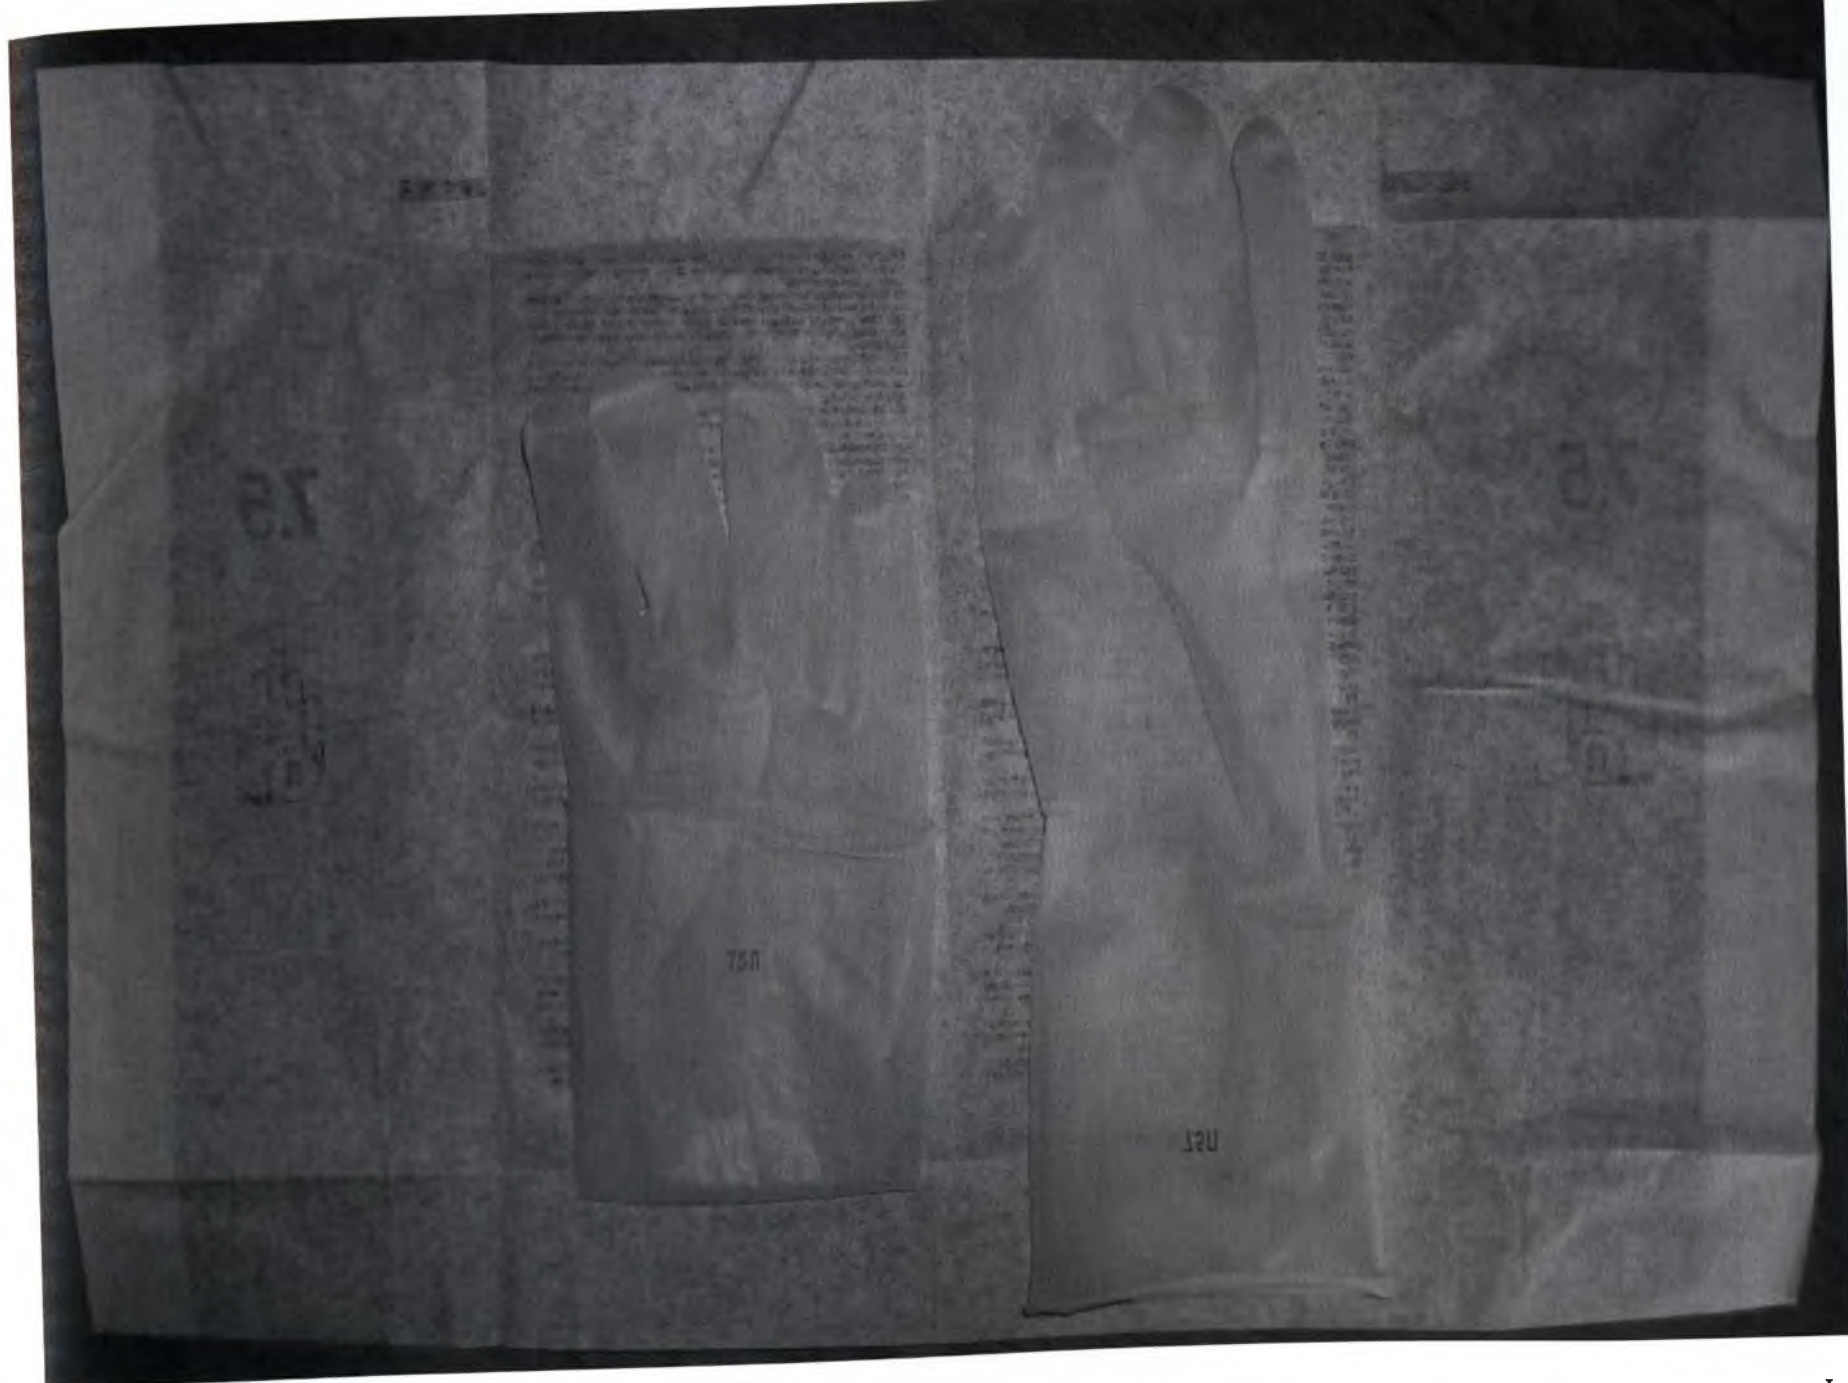

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0375

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch® 7.5

SN : 037514002141

LOT : 037514-002

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide

INTW0375

ГОСТ Р 52236-2004

STERILE R

CE 0086

LATEX



100 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОБАКО», 196126, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504-А.


Упаковка для перчаток INTW0375

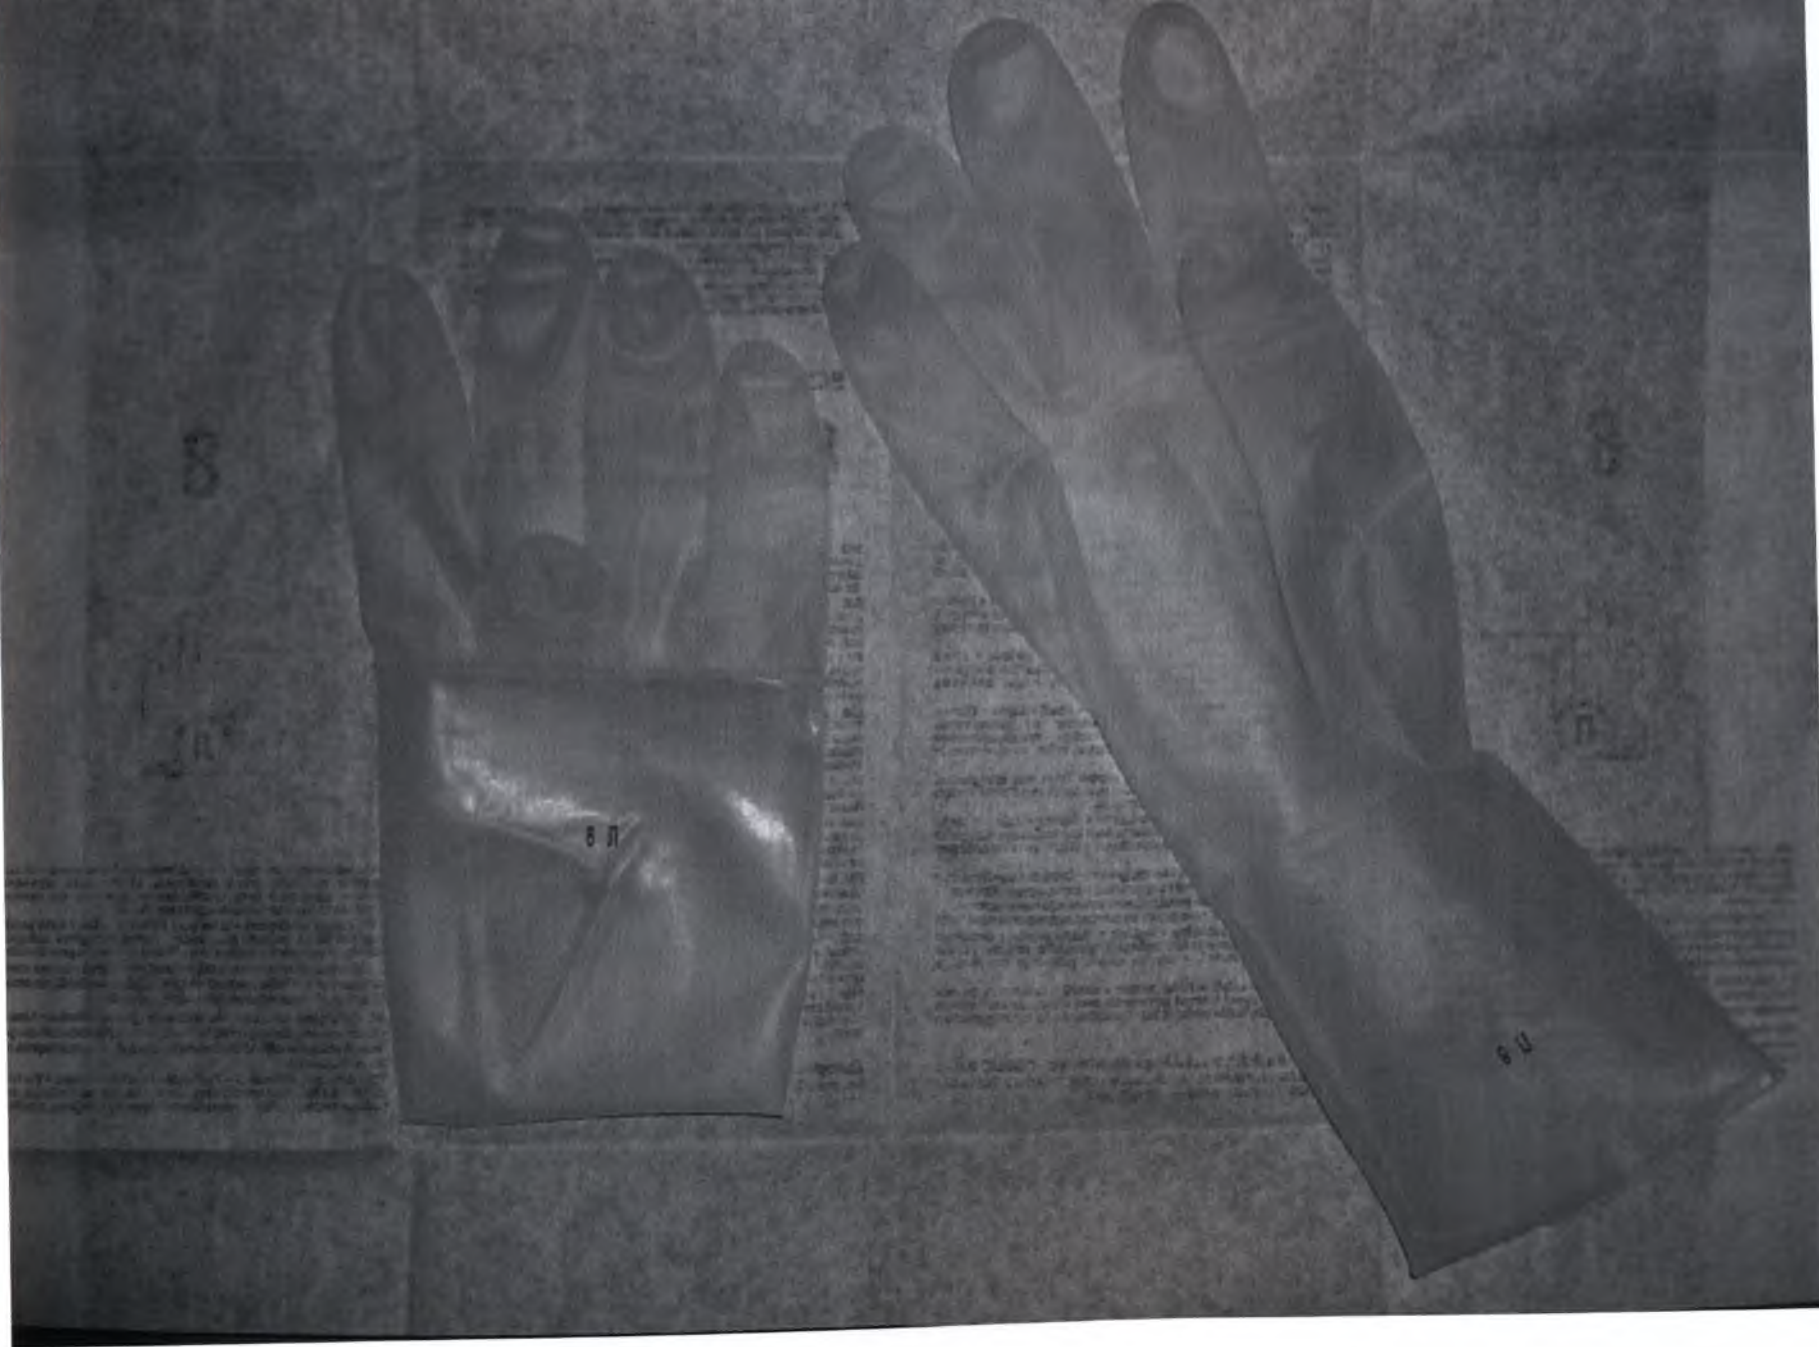

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0380


↑
раскрыть, чтобы открыть

intouch®
Size: **8**
SN: 03801400353
LOT: 038014-004
EXP: 2014-01
Σ: 2017-01
Неспудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide
INTW0380
ГОСТ Р 52238-2004

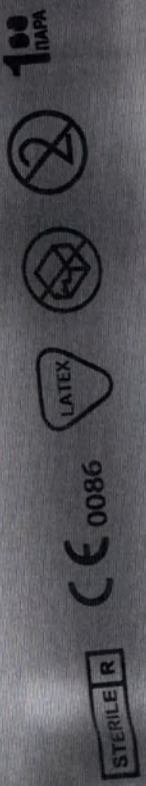


100
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ
СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.

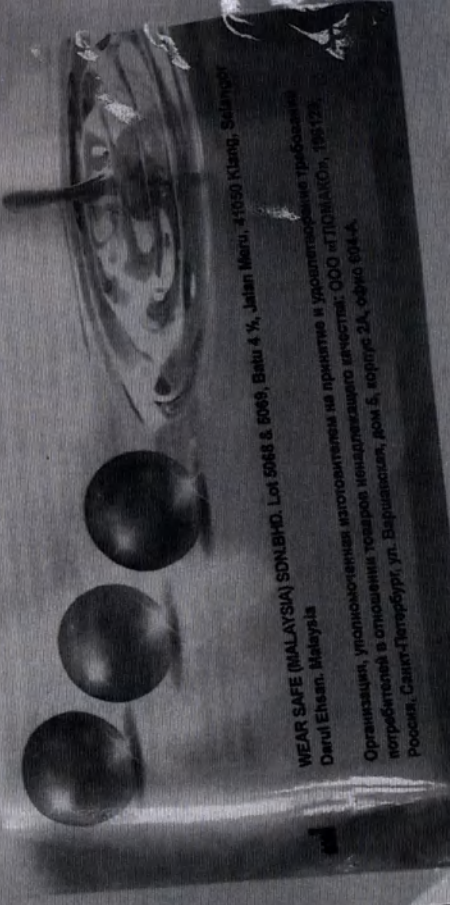

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и урегулирование требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ТОМАКО», 196128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ваврушская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А

Упаковка для перчаток INTW0380

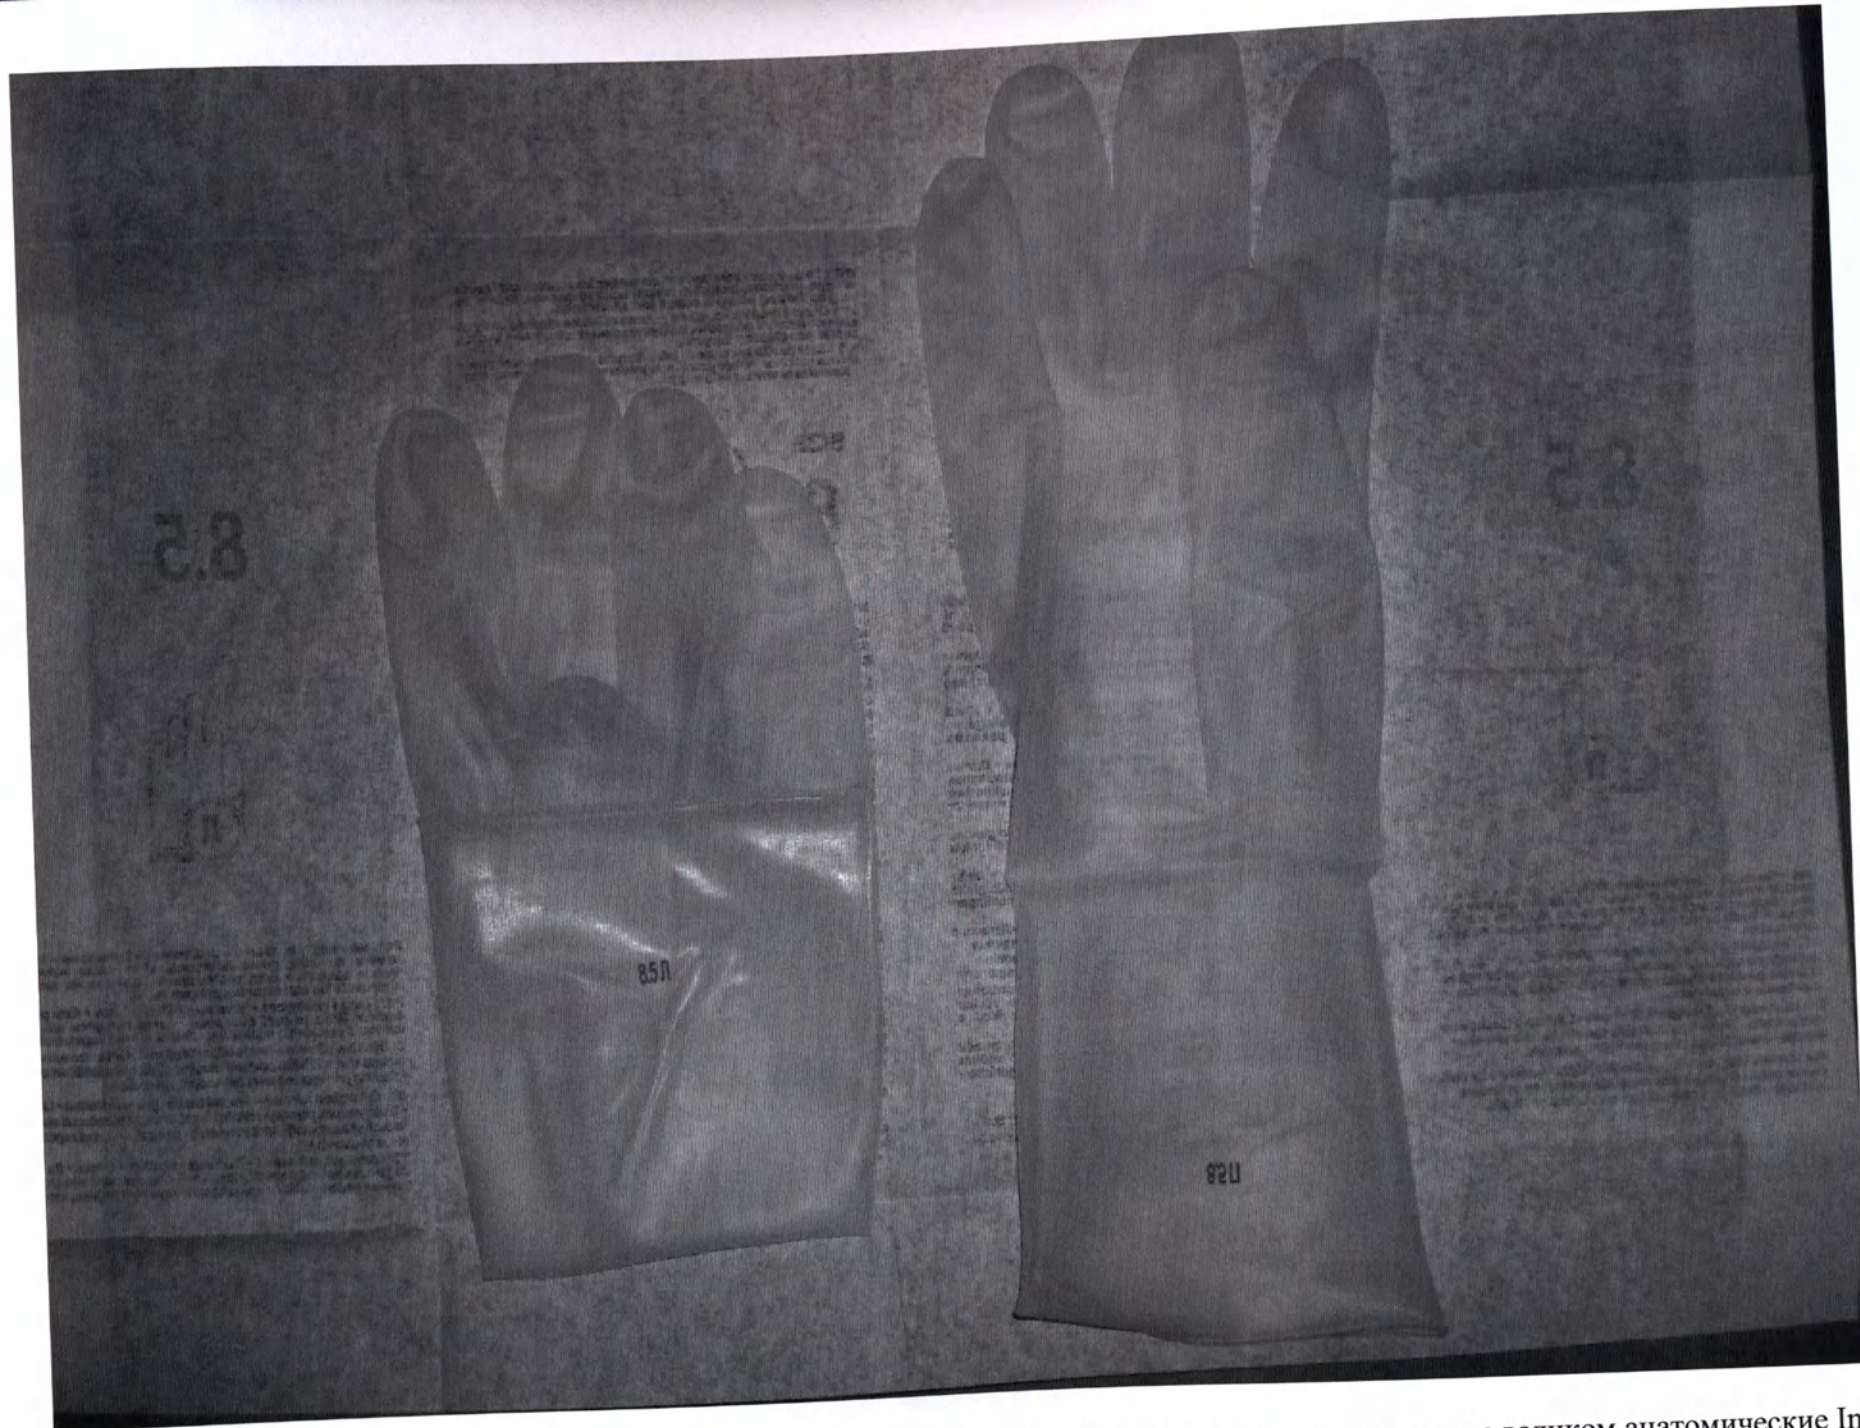

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0385

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

iNtouch®

Size :
8.5

SN : 038514005074

LOT : 038514-005

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные
хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch Slide

INTW0385

ГОСТ Р 52238-2004

STERILE R

CE 0086



100%
ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызывать аллергическую реакцию.



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196120
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 504 А.

Упаковка для перчаток INTW0385



Неопудренные текстурированные на пальцах с полимерным покрытием латексные хирургические перчатки с валиком анатомические Intouch
Slide INTW0390



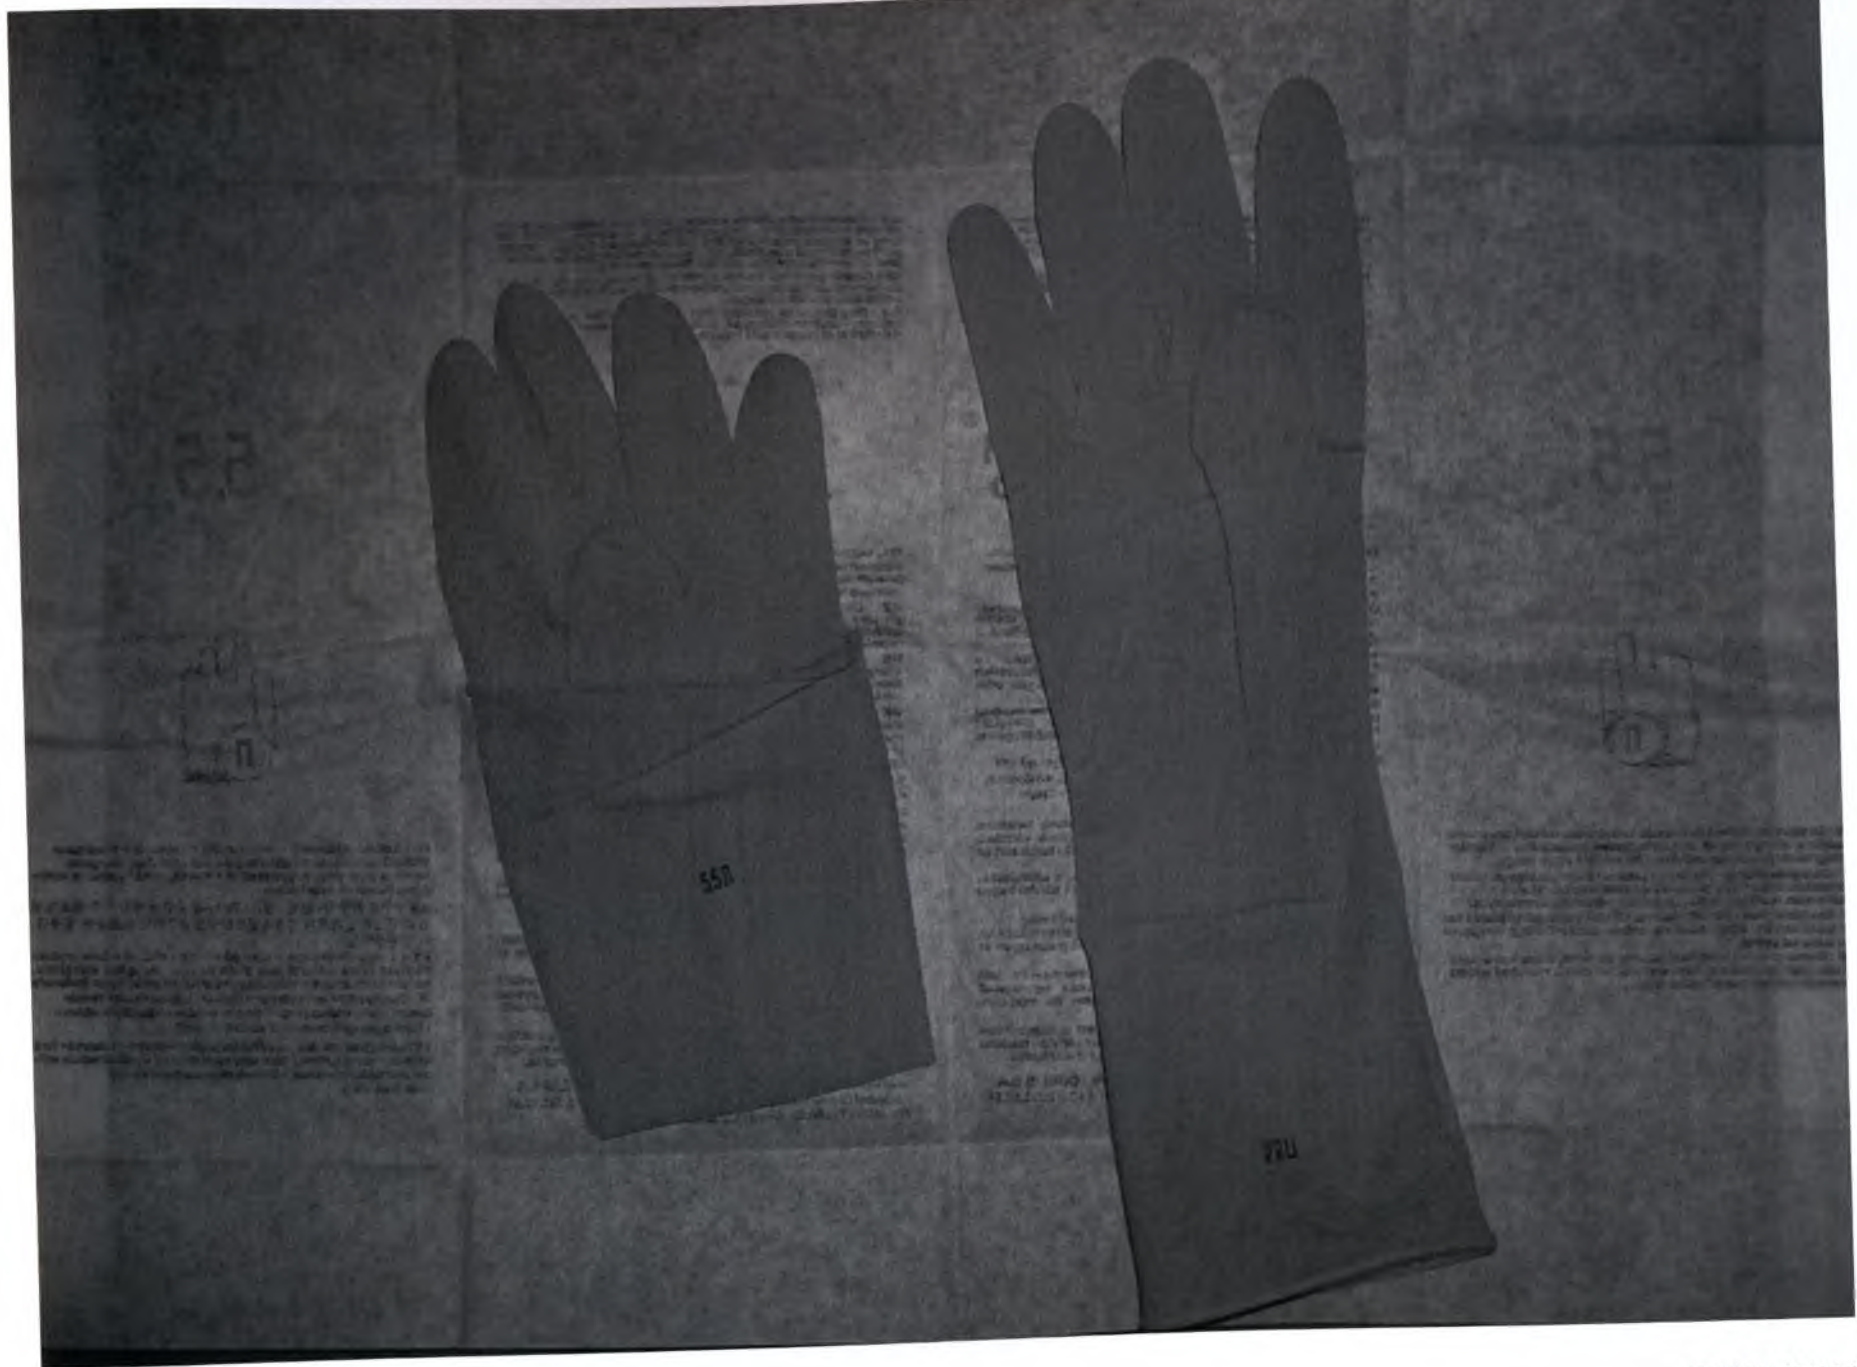

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0755

РАСКРЫТЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Наступательная текстурированная ладонь из полиуретана латексного каучука для дополнительной защиты с мягкой эластичной ладонью Intouch Grip

INTW0755

ГОСТ Р 52233-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию.

Size :

5.5

ПАРА

SN : 075514003056

LOT : 075514-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE

0086



LATEX


WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD. Lot 5068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества ООО «ГЛОБАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0755



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические
Intouch Spot INTW0760

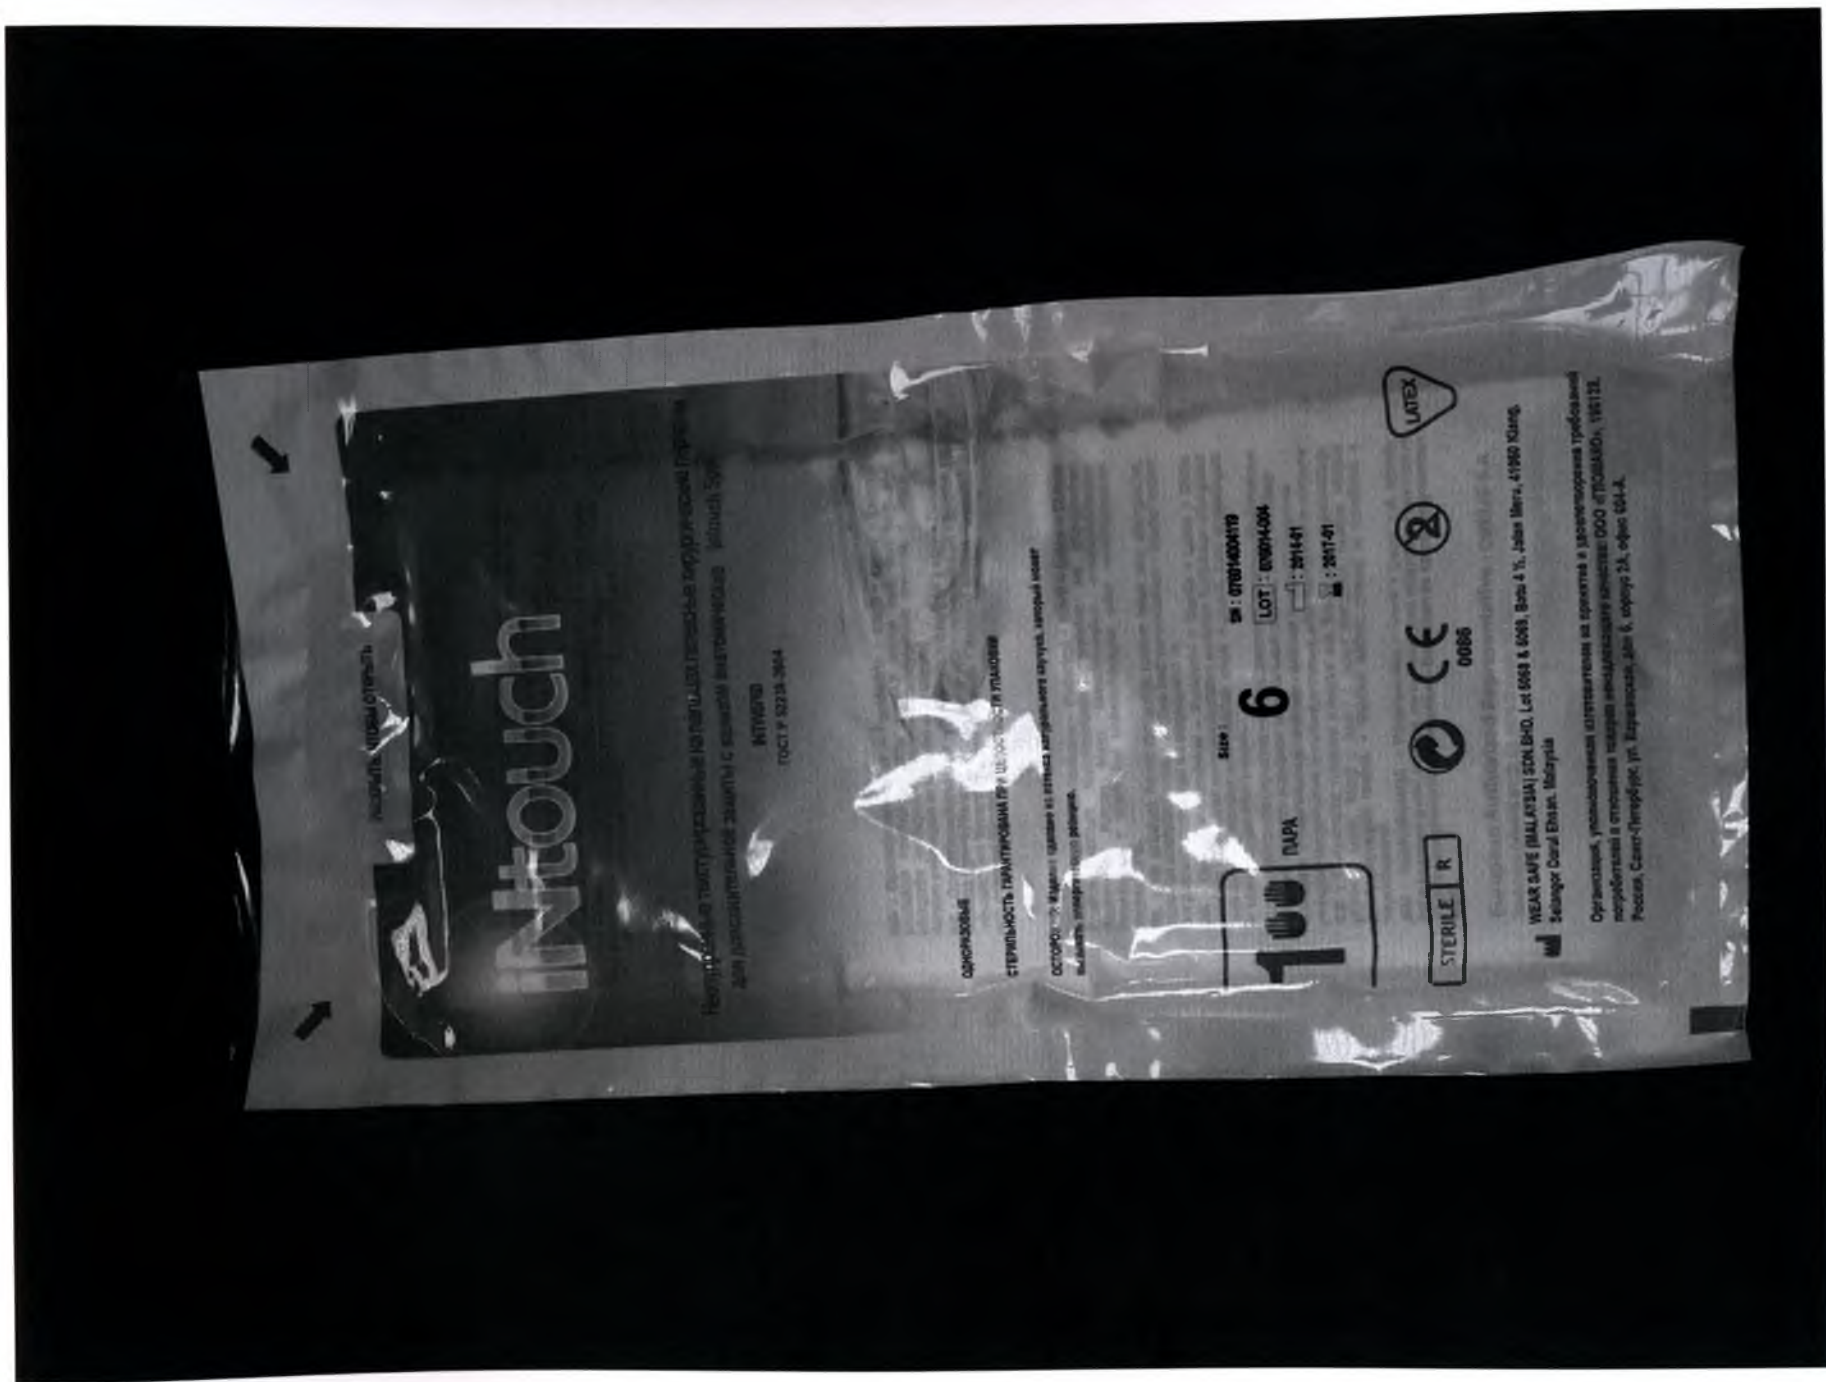

Упаковка для перчаток INTW0760



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0765

РАСКРУТИТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Intouch

Раскрутите верхнюю часть упаковки, чтобы открыть перчатки. Не используйте перчатки, если вы заметили повреждение или дефекты. Для дополнительной защиты с внутренней стороны перчаток нанесен слой латекса.

INTW0765

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size:

6.5

ПАРА

SN : 076514001232

LOT : 076514-001

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



0086




WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 6068 & 6069, Batu 4 1/2, Jalan Maru, 41060 Klang.

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на продажу и дополнительное тестирование потребителей в отношении товаров, принадлежащих к классу СОО (ПРОМЫСЛ., 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А

Упаковка для перчаток INTW0765

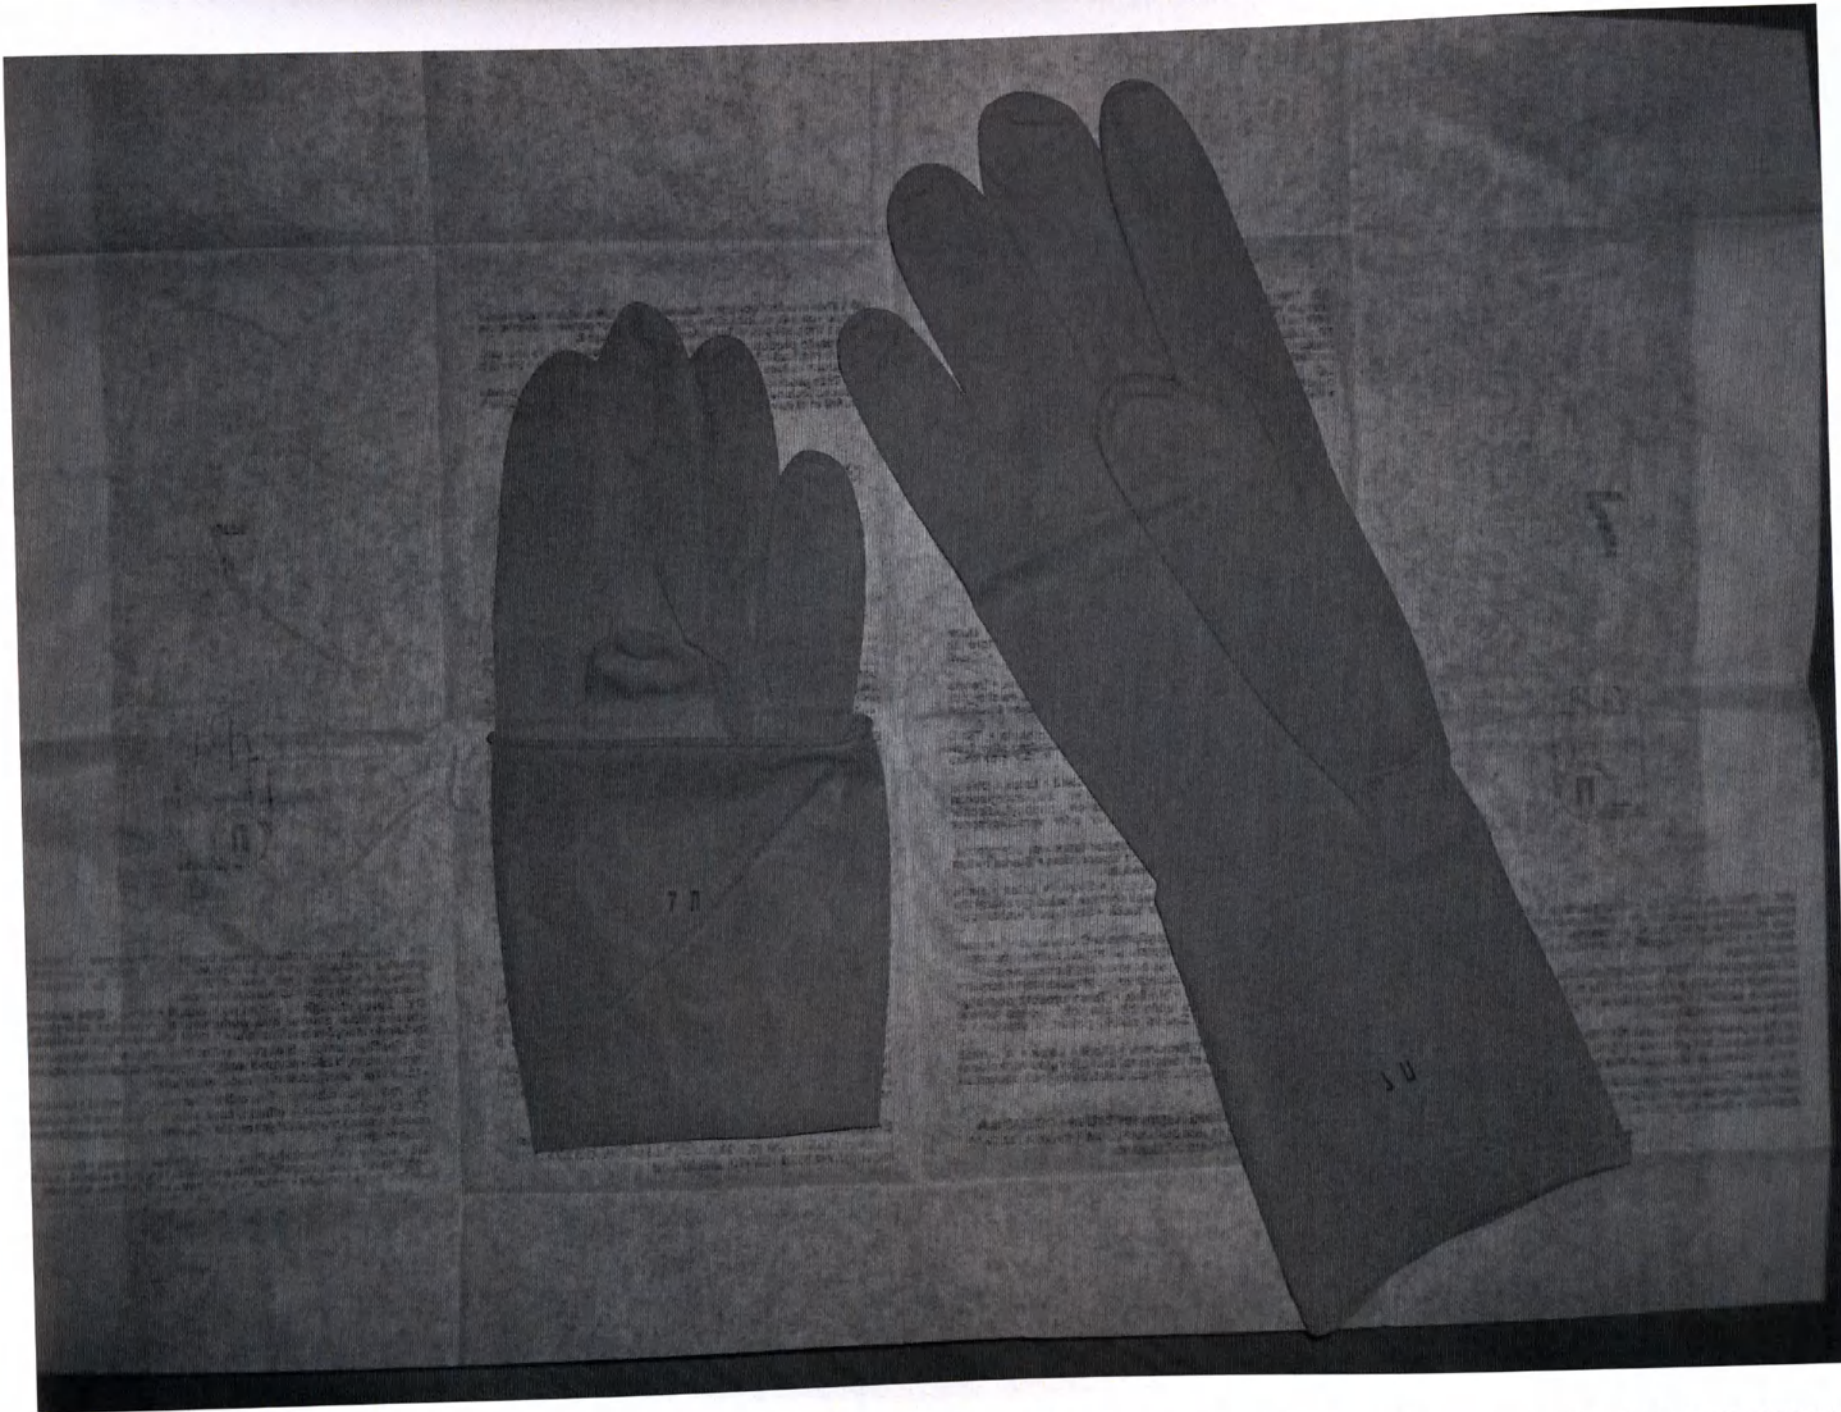

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0770

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

INTouch

Нестерильные перчатки, изготовленные из латекса, предназначены для использования в качестве барьерной защиты с высоким анатомическим профилем.

INTW0770

ГОСТ Р 62238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



ПАРА

Size :

7

SN : 077014004162

LOT : 077014-004

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE
0086



WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia


Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Баршавская, дом 6, корпус 2А, офис 604-А.

G-PO-SINTPF-F-R1


Упаковка для перчаток INTW0770




Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0775

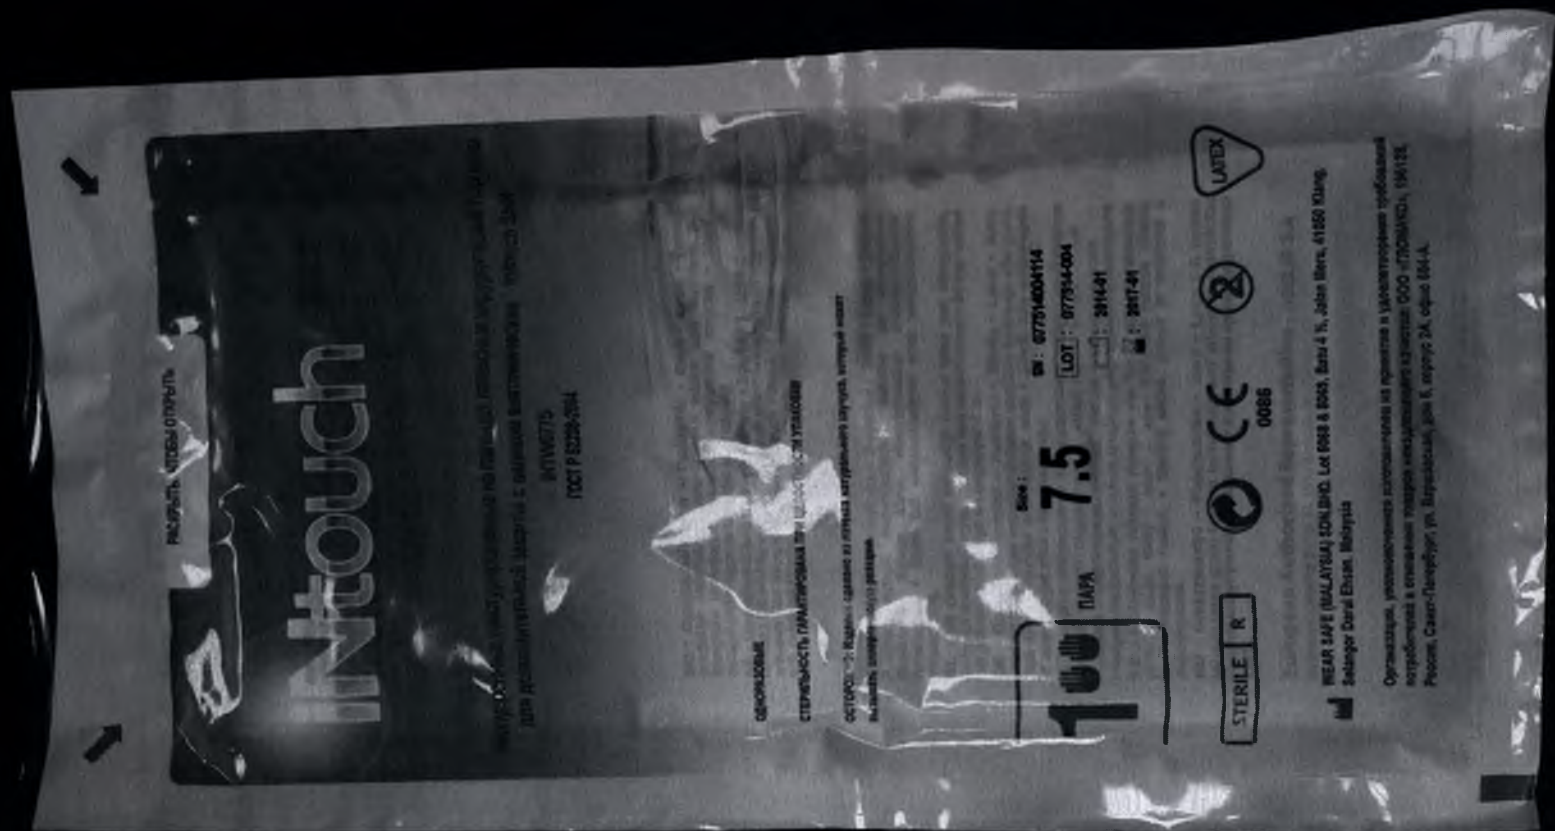

Упаковка для перчаток INTW0775

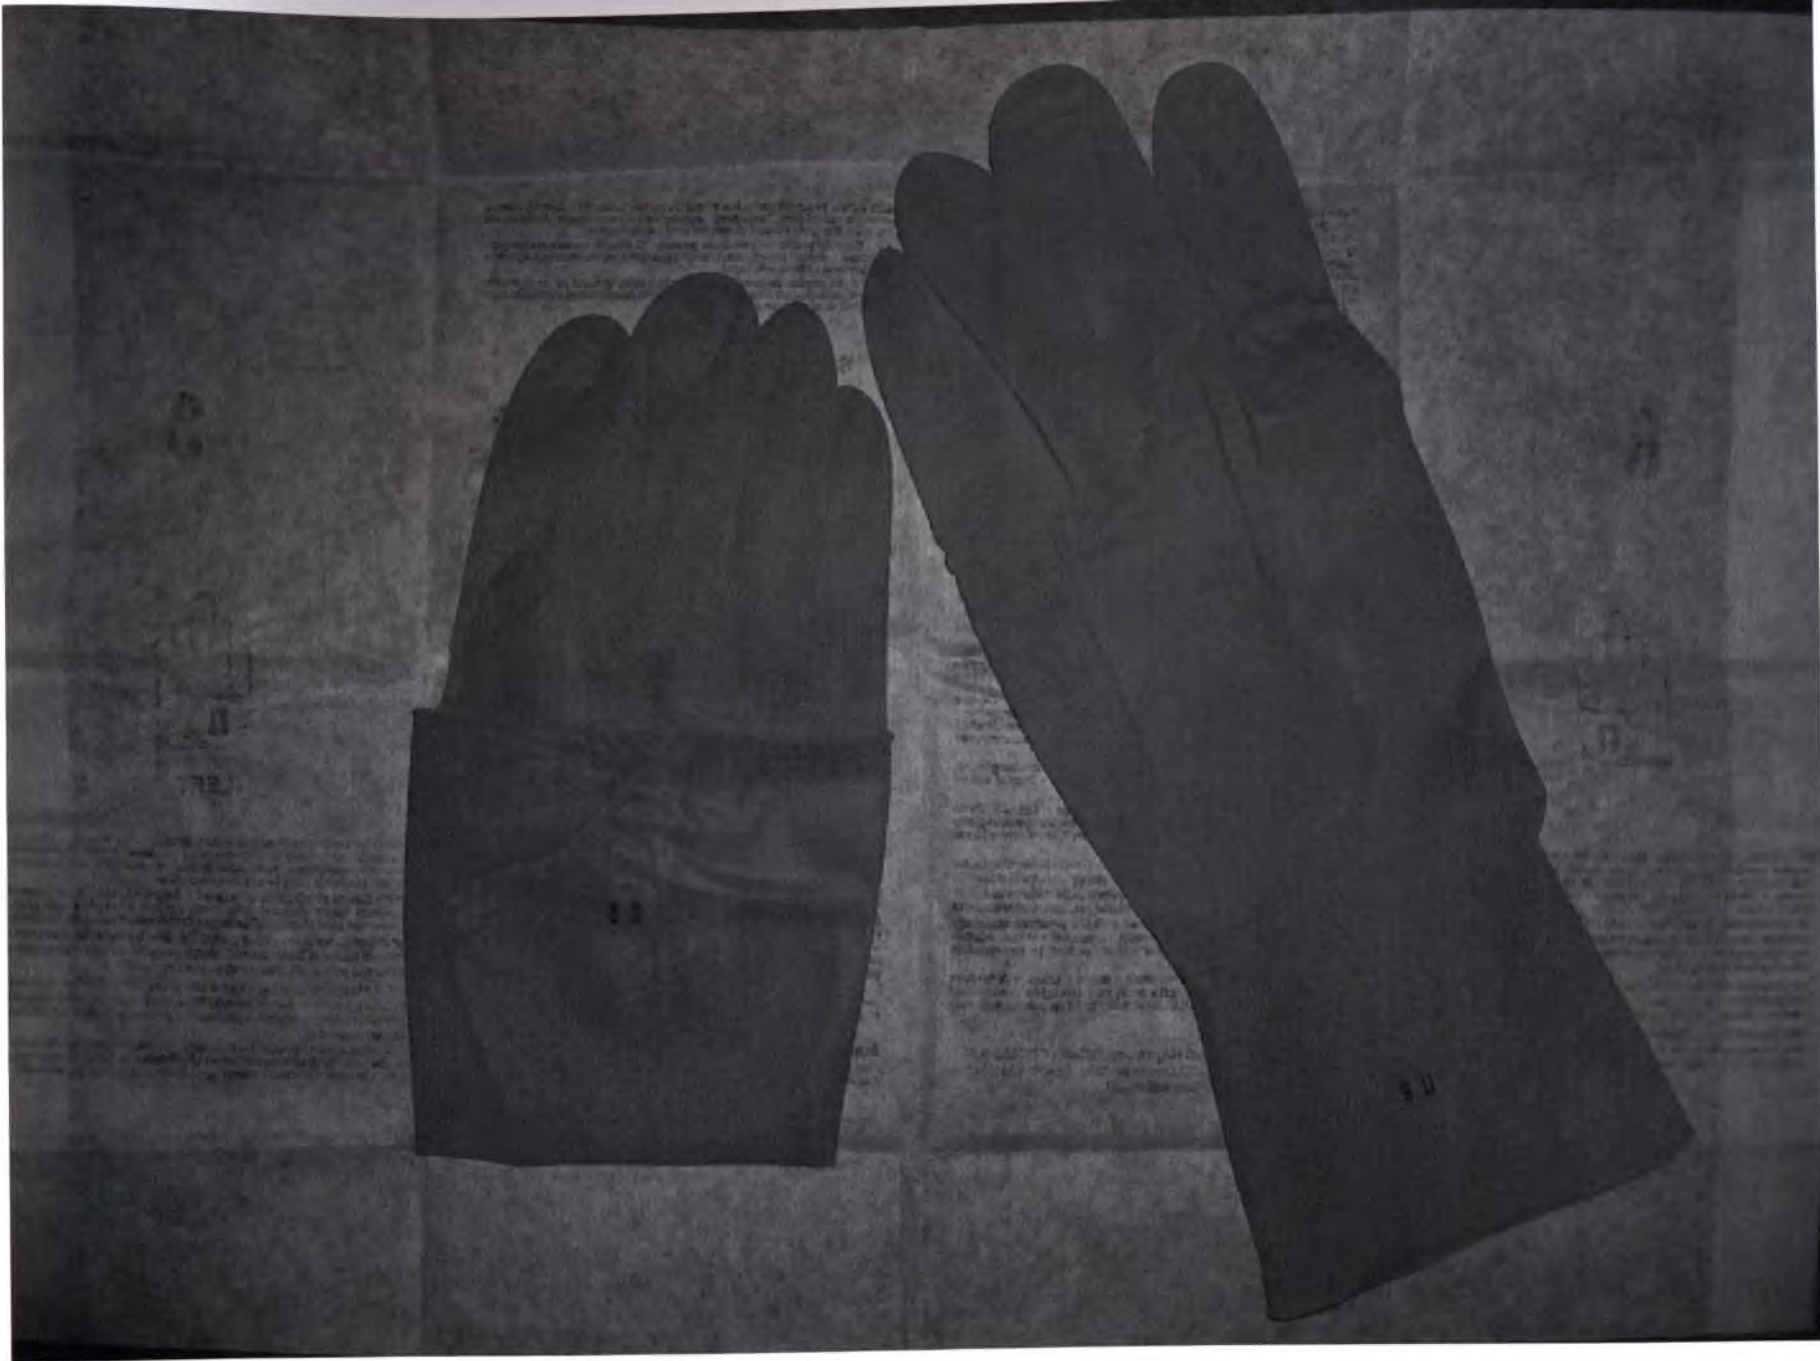

Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0780

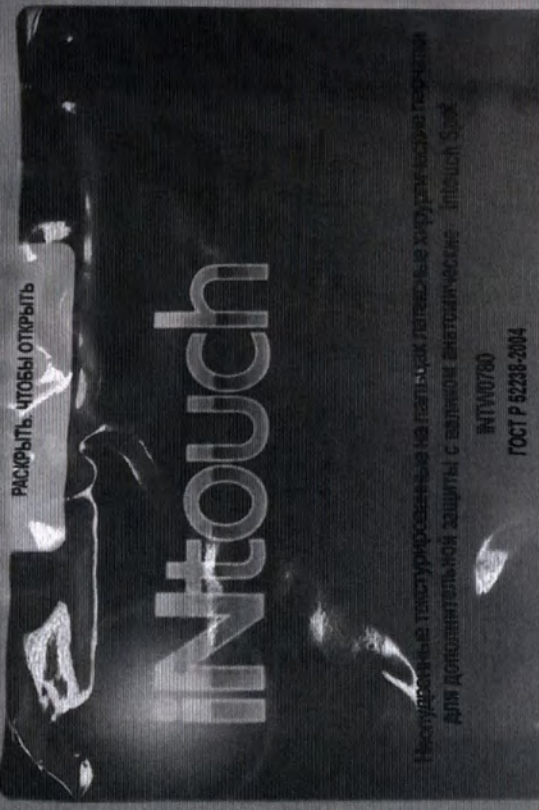

Несудорожно транспортируйте на пальчик латекса хирургические перчатки
для дополнительной защиты с барьером анатомического Intouch Safe


INTW0780

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может
вызывать аллергическую реакцию.



Size :

8

SN : 078014003311

LOT : 078014-003

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE 0086



LATEX

WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 195128,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0780



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0785

РАСКРЫТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

INTOUCH

Нескользящая текстурированная напальчатая латексная перчатка с усилением для дополнительной защиты с валиком снотомиячелана. INtouch 360

INTW0785

ГОСТ Р 52238-2004

ОДНОРАЗОВЫЕ

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Size :

8.5

ПАРА

SN : 076514002041

LOT : 076514-002

EXP : 2014-01

EXP : 2017-01

STERILE R



CE

0086

2

LATEX


WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. Lot 5068 & 5069, Batu 4 1/2, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «ГЛОМАКО», 195128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток INTW0785



Неопудренные текстурированные на пальцах латексные хирургические перчатки для дополнительной защиты с валиком анатомические Intouch Spot INTW0790

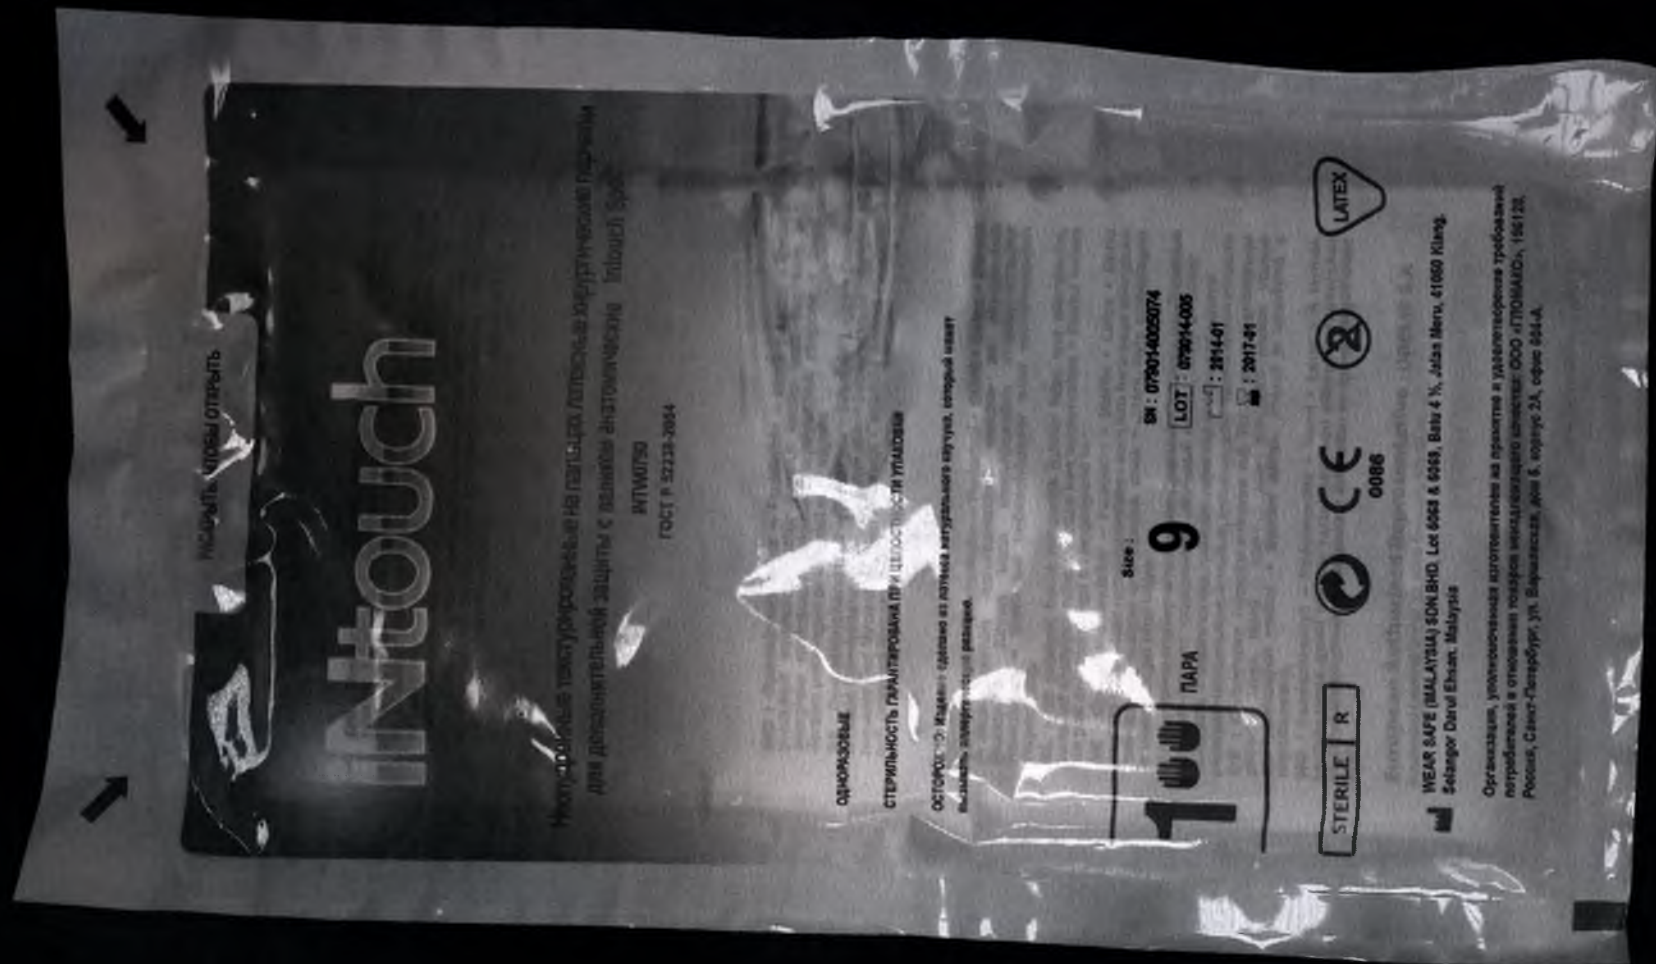

Упаковка для перчаток INTW0790

ООО «ГЛОМАКО»

Итого в настояще документе
113 листа (ов)

Генеральный директор
Алиев А.А.

