

ФОТО

Реагентов и материалов расходных

для анализатора иммунофлюоресцентного AQT90 FLEX.

Производства Radiometer Medical ApS (Радиометр Медикал АпС,) Дания

Адрес: Akandevøj 21 DK-2700 Bronshøj Denmark (Акандевей 21 Бронсхей ДК-2700 Дания)

Тел.: +45 38 27 38 27, факс.: +45 38 27 27 11, электронный адрес: radiometer@radiometer.dk

Набор тестов TnI (TnI Test Kit)



Набор тестов TnT (TnT Test Kit)



Набор тестов CKMB (CKMB Test Kit)



Набор тестов Myoglobin (Myo Test Kit)



Набор тестов NT-proBNP (NT-proBNP Test Kit)



Набор тестов bhCG (bhCG Test Kit)



Набор тестов CRP (CRPTestKit)



Набор тестов D-dimer (D-dimer TestKit)



Блок растворов (Solution Pack)



Калибровочный картридж TnI (TnI Cal.Cartridge)



Калибровочный картридж CKMB (CKMB Cal.Cartridge)



Калибровочный картридж Myoglobin (Myo Cal.Cartridge)



Калибровочный картридж NT-proBNP (NT-proBNPCal.Cartridge)



Калибровочный картридж bhCG (bhCGCal.Cartridge)



Калибровочный картридж CRP (CRPCal. Cartridge)



Калибровочный картридж D-dimer (D-dimerCal.Cartridge)



Калибровочный картридж TnT (TnTCal.Cartridge)



Раствор Контроля Качества Уровень 1 (MultiCHECK level 1)




Раствор Контроля Качества Уровень 2 (MultiCHECK level 2)




Раствор Контроля Качества Уровень 3 (MultiCHECK level 3)




Раствор Контроля Качества D-dimer Уровень 1 (D-dimerCHECK level 1)

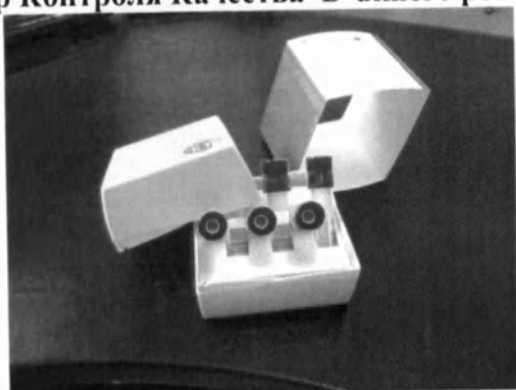


Раствор Контроля Качества D-dimer Уровень 2 (D-dimerCHECK level 2)

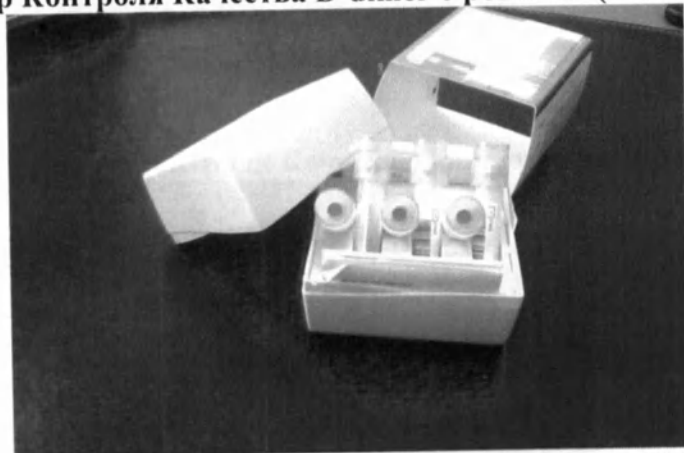


Раствор Контроля Качества bhCG Уровень 1 (bhCGCHECK level 1)

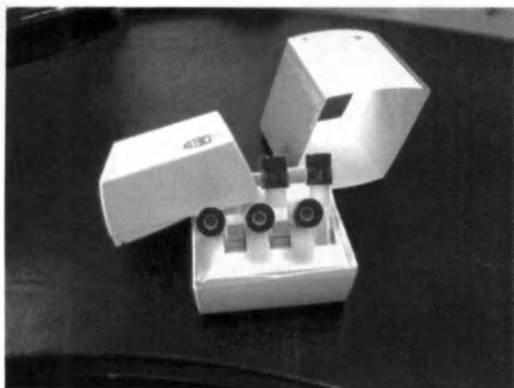


Раствор Контроля Качества bhCG Уровень 2 (bhCGCHECK level 2)

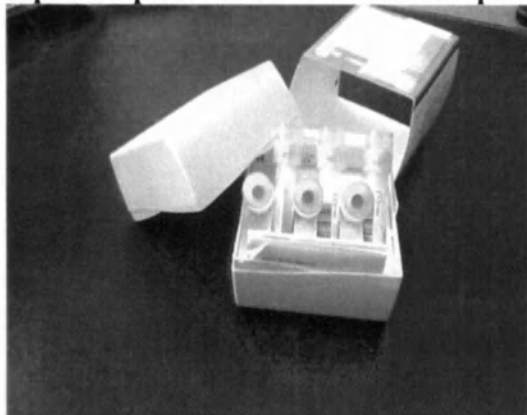


Раствор Контроля Качества TnT Уровень 1 (TnTCHECK level 1)

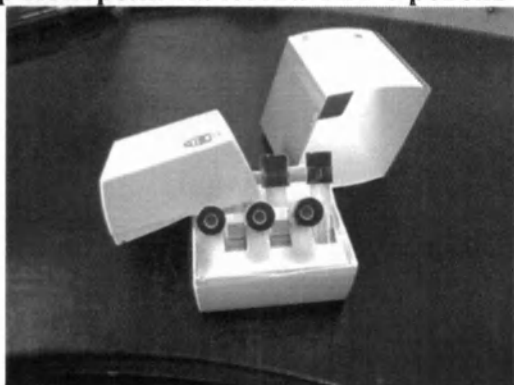

Раствор Контроля Качества TnT Уровень 2 (TnTCHECK level 2)

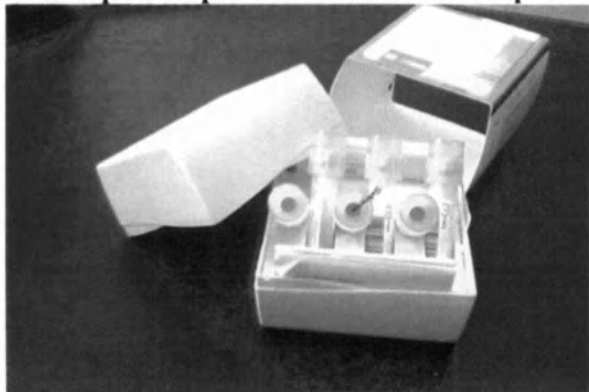

Раствор Контроля Качества TnT Уровень 3 (TnT CHECK level 3)

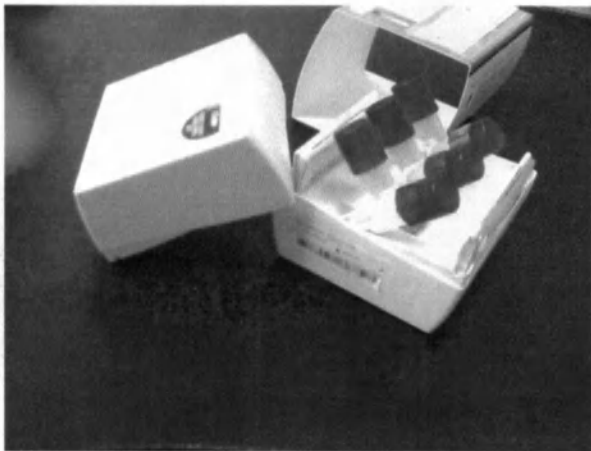

Раствор Контроля Качества CRP Уровень 1 (CRP CHECK level 1)



Раствор Контроля Качества CRP Уровень 2 (CRP CHECK level 2)



Набор пустых контейнеров для AQT90 FLEX (AQT90 FLEX EmptyTubeKit)



Чистящий раствор для AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Cleaning Tube Solution)



Фоновый картридж для AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Blank Cartridge)



Глава представительства
Компании «Радиометр Медикал АпС»



С. Р. Айрапетян

Сшито и заверено печатью 7
(силь) лист об


РАДИОМЕТР
MEDICAL APS
Глава представительства
Компании «Радиометр Медикал
АпС» С. Р. Айрапетян