

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации общего белка
в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом
«ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-066-94568735-2018**

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

REF B 06.04

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 2 x 250 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:
0063



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 2 x 250 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prilivskaya 20 2614 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 250 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



08042304320063

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
REF B 06.04
REF B 06.14
биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек ыт in vitro диагностика үшін



РЕАГЕНТ 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
REF B 06.04
REF B 06.14
биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек ыт in vitro диагностика үшін



РЕАГЕНТ 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек ыт in vitro диагностика үшін



КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек ыт in vitro диагностика үшін



КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

REF B 06.14

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 4 x 250 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 250 ml

Calibrator: 3 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

EC REP

EVERGIC EUROPE
Pilsenstrasse 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 250 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



06142304200063

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.04
REF B 06.14

биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.04
REF B 06.14

биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.04
REF B 06.14

биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.04
REF B 06.14

биуретовый
реагент
биуреттік реагент

250 мл 2°C 8°C

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл 2°C 8°C

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл 2°C 8°C

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл 2°C 8°C

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



REF B 06.74-1.150

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 5 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 5 x 40 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessaplaats 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 5 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



90002304000063



LB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.74-1.150

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.74-1.150

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.74-1.150

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.74-1.150

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.74-1.150

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 06.714-1.150

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 12 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 12 x 40 мл
Calibrator: 2 x 2 мл

LOT 0063
2024.04

EMERGO EUROPE
Pharmazentrum 20 2014 AP
The Hague The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 12 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



98002203240051

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ [REF] В 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Коополэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ [REF] В 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Коополэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ [REF] В 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Коополэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ [REF] В 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Коополэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ [REF] В 06.714-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Коополэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital
Development

КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital
Development

REF В 06.74-1.200

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 5 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 5 x 20 мл
Calibrator: 2 x 2 мл

LOT 0063

2024.04

IVD

ECIREP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

КЗ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 5 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



90012209280056



0.5 1

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF В 06.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF В 06.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF В 06.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF В 06.74-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF В 06.74-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



REF B 06.714-1.200

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 8 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 8 x 20 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

IVD

EC REP

ENERGO EUROPE
Rijnswaagweg 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 8 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін



98012209280056



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл


LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корп
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл


LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл


LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл


LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ REF B 06.714-1.200

20 мл


LOT 0063

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



РЕАГЕНТ 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

REF B 06.74-1.300

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 4 x 52 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 52 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063



Vital Development Corporation
Dorogoy v Kamenskuyu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.04

IVD

ECIREP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

КЗ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 52 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А



90022210290057



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.300

РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.300

РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.300

РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.300

РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 06.714-1.300

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 10 x 52 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия:
0063



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 10 x 52 мл
Calibrator: 2 x 2 мл

LOT 0063

2024.04

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 10 x 52 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін



96022210290057

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



[LOT] 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



[LOT] 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



[LOT] 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.714-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



[LOT] 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР
ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л
[LOT] 0533
годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital

КАЛИБРАТОР
ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л
[LOT] 0533
годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Vital

REF B 06.74-1.420

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 4 x 72 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 1818/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063
Дата выпуска: 2023.04
Годен до: 2024.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 72 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

IVD

LOT 0063

2024.04

EC REP

EMERGO EUROPE
Prilassestraat 20 2514 AP
The Hague The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 72 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



90032210290057



O.B 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



O.B 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



O.B 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.420



РЕАГЕНТ 1


72 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



O.B 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-1.420



РЕАГЕНТ 1


72 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін


Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



REF В 06.714-1.420

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 8 x 72 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04

Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 8 x 72 мл
Calibrator: 2 x 2 мл

LOT 0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.04

IVD

EC REP

EVERGO EUROPE
Pharmazeutisch 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

КЗ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 8 x 72 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



ОБ

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-1.420



РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБ

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-1.420



РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБ

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-1.420



РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия



РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

REF В 06.714-1.420

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0063



годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

REF В 06.74-1.600

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 4 x 68 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 68 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Pruissengracht 20, 2014 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 68 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



0.6

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.6

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-1.600

РЕАГЕНТ 1


68 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.6

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-1.600

РЕАГЕНТ 1


68 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



0.6

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-1.600

РЕАГЕНТ 1


68 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

REF B 06.714-1.600

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 8 x 68 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:
0063



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 8 x 68 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Pinnerweg 20, 2014 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018

02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 8 x 68 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



067411501802030198



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1


ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1


ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей


0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей


КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л
LOT 0533
годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ
2 мл
70 г/л
LOT 0533
годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

REF B 06.724-1.600

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом



Реагент №1: 15 x 68 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:
0063



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 15 x 68 ml
Calibrator: 3 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.04

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

K2 ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 15 x 68 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



067411501802030198



0.5 1


ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1


ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.724-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

19

REF В 06.74-2.200

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 40 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.04

IVD

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

КЗ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



90041802030198



0.6 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.6 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.6 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.6 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

REF B 06.74-2.300

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 8 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 8 x 40 мл
Calibrator: 2 x 2 мл

LOT 0063
2024.04

IVD

EMERGO EUROPE
Pharmaceuticals 20, 2014 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 8 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



90051802030198



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

REF В 06.74-3.400.24

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 4 x 66 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063

Дата выпуска: 2023.04

Годен до: 2024.04

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 4 x 66 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

IVD

EC REP

EUROD EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 66 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.24

66 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.24

66 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.24

66 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.24

66 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF В 06.74-3.400.36

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 6 x 40 ml

Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki, 56 A, 194359
St. Petersburg, Russia

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-3.400.36

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИБРАТОР

0.5 1



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИБРАТОР

0.5 1



REF В 06.74-4.270

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 3 x 64 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:



Дата выпуска:



Годен до:

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 3 x 64 ml

Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

ENERGO EUROPE
Pilsenerstraat 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 64 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



067411501802030198



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

Годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

Годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

Годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 06.714-4.270

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 8 x 64 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 8 x 64 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

EVERGO EUROPE
Phinassegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

ECIREP

КЗ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 8 x 64 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБ 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБ 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.714-4.270

РЕАГЕНТ 1

64 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

REF B 06.74-6.200

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 10 x 44 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:
0063



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 10 x 44 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 10 x 44 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



067411501802030198



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл



[LOT] 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

Только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

[REF] В 06.74-6.200

РЕАГЕНТ 1

44 мл



[LOT] 0063

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

Только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

[LOT] 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

Только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

[LOT] 0533

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

Только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

REF В 06.74-7.600

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 6 x 60 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 6 x 60 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

IVD

ECIREP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 60 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

0.5 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-7.600

РЕАГЕНТ 1 60 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

Годен до: 2025.02

Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 06.74-8.480

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке (плазме) крови
биуретовым методом

Реагент №1: 10 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия:
0063Дата выпуска:
2023.04Годен до:
2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 10 x 40 ml

Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



2024.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Prinsepsgracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша
биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 10 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



067411501802030198

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б
1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б
1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б
1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б
1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-8.480

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

REF B 06.74-9.8000

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 10 x 84 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT Серия: 0063

Дата выпуска: 2023.04

Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 10 x 84 ml
Calibrator: 3 x 2 ml

LOT 0063

2024.04

IVD

ECIREP

EMERGO EUROPE
Rijnsebaan 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 10 x 84 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литер А



087411501802030198



0.5

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

0.5

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

0.5

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

0.5

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

0.5

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл

LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-9.8000

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0063

годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital

REF B 06.74-10.25

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом

Реагент №1: 10 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 10 x 50 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

ENERGO EUROPE
Philipsweg 20, 2014 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 10 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198



OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

OB 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

РЕАГЕНТ 1

годен до: 2024.04

Дейін жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

2°C 8°C

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04
Толыққа для in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

О.Б 1

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 06.74-10.25

50 мл

LOT 0063

2°C 8°C

Годен до: 2024.04
Дейін жарамды: 2024.04
Толыққа для in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

2°C 8°C

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
Толыққа для in vitro диагностикасы үшін

Vital

КАЛИБРАТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ
ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл
70 г/л

LOT 0533

2°C 8°C


Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
Толыққа для in vitro диагностикасы үшін

Vital

REF В 06.74-11.200

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом



Реагент №1: 5 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
РЗН 2018/7781 от 02.11.2018 г.

LOT

Серия: 0063



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK TOTAL PROTEIN-VITAL

R1: 5 x 50 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0063



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 58 A 194356
St. Petersburg, Russia



2024.04

EC REP

EVERGO EUROPE
Princessesgracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

KZ ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-066-94568735-2018
02.11.2018 ж. РЗН 2018/7781

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жалпы ақуыз концентрациясын бойынша биуреттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 5 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0063
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.04

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

tek in vitro диагностикасы үшін



067411501802030198




ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-11.200

РЕАГЕНТ 1

50мл



LOT

0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей


ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-11.200

РЕАГЕНТ 1

50мл



LOT

0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-11.200

РЕАГЕНТ 1

50мл



LOT

0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-11.200

РЕАГЕНТ 1

50мл



LOT

0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

REF В 06.74-11.200

РЕАГЕНТ 1

50мл



LOT

0063

Годен до: 2024.04
Дейн жарамды: 2024.04

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT

0533

Годен до: 2025.02

Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ

ЖАЛПЫ АҚУЫЗ-ВИТАЛ

2 мл

70 г/л

LOT

0533

Годен до: 2025.02

Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
tek in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 36 листа(ов)

Генеральный директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов




2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации общего белка
в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом
«ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛЬ»,
ТУ 21.20.23-066-94568735-2018**




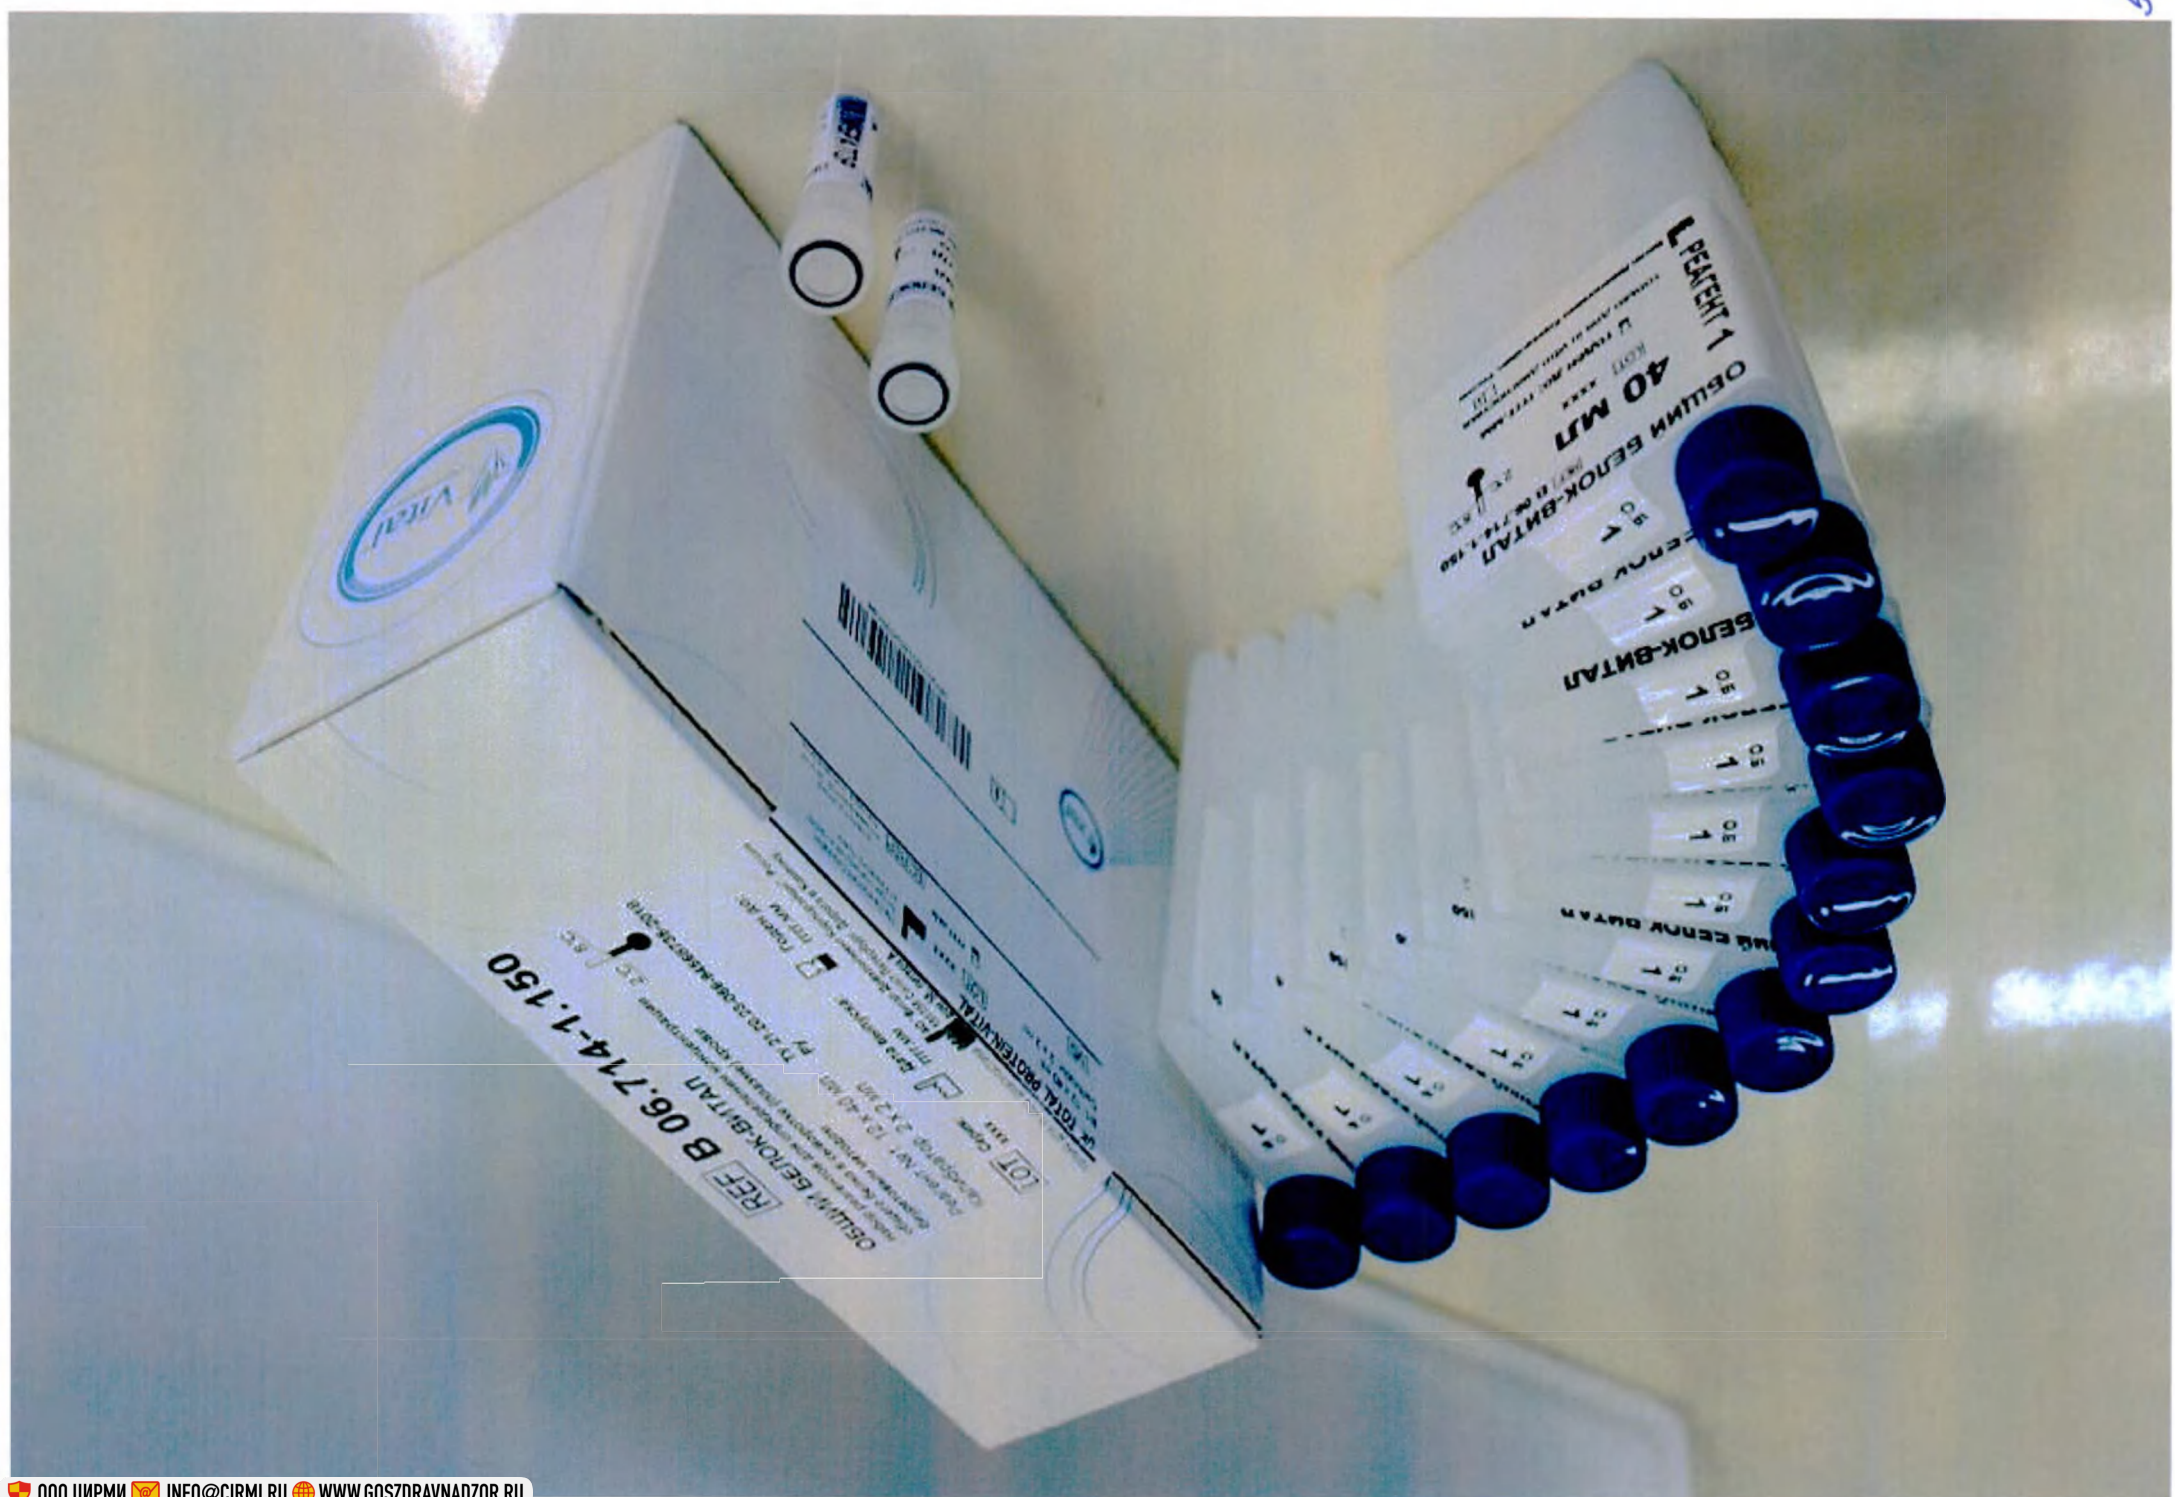











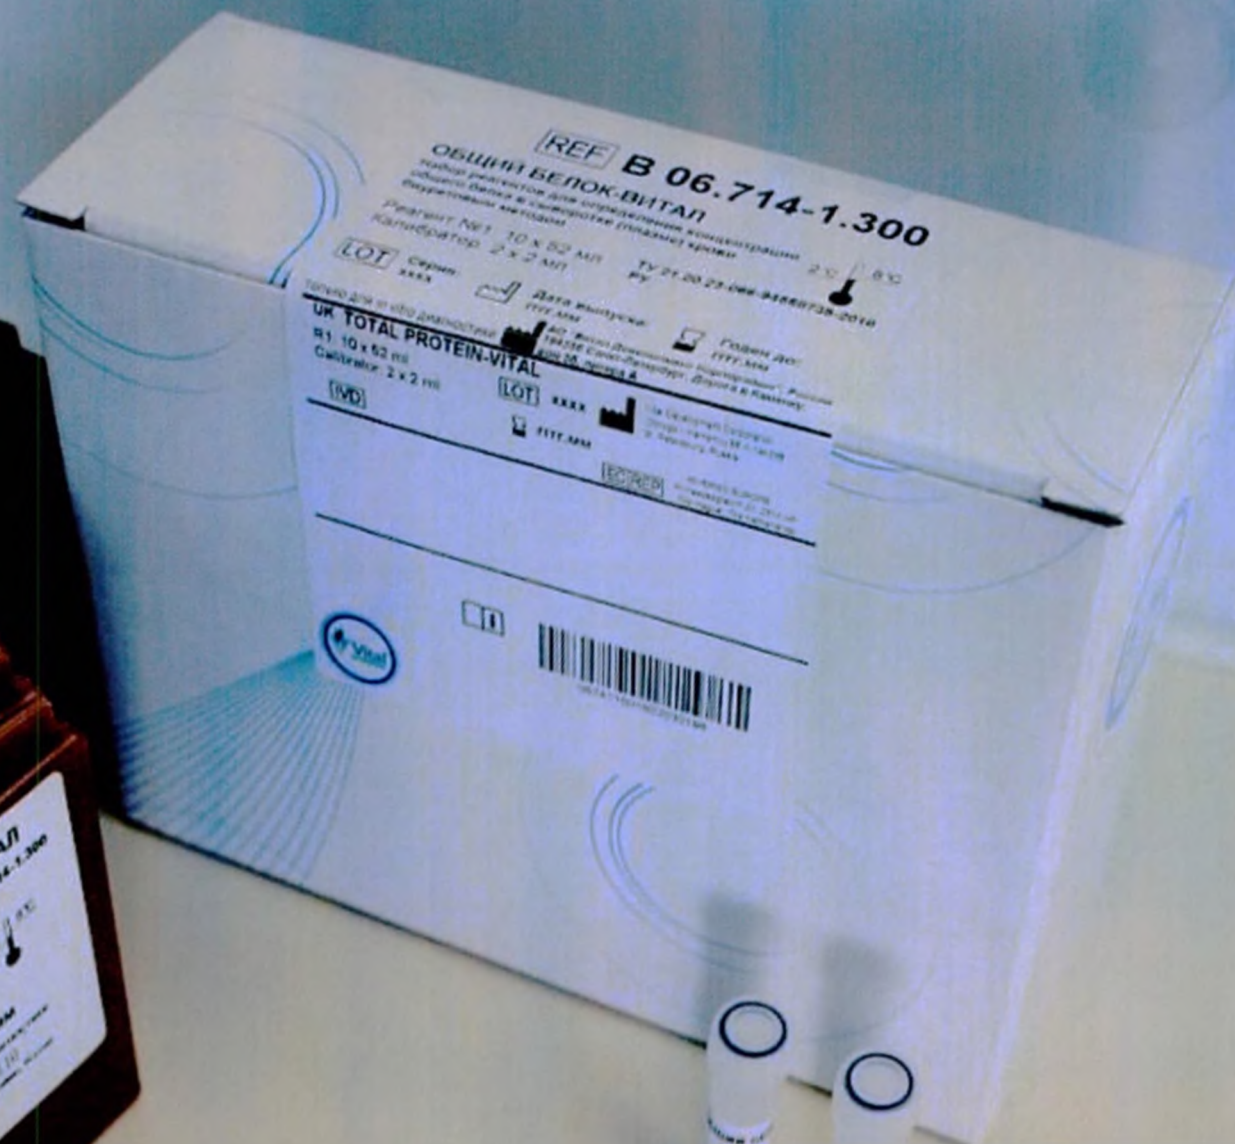

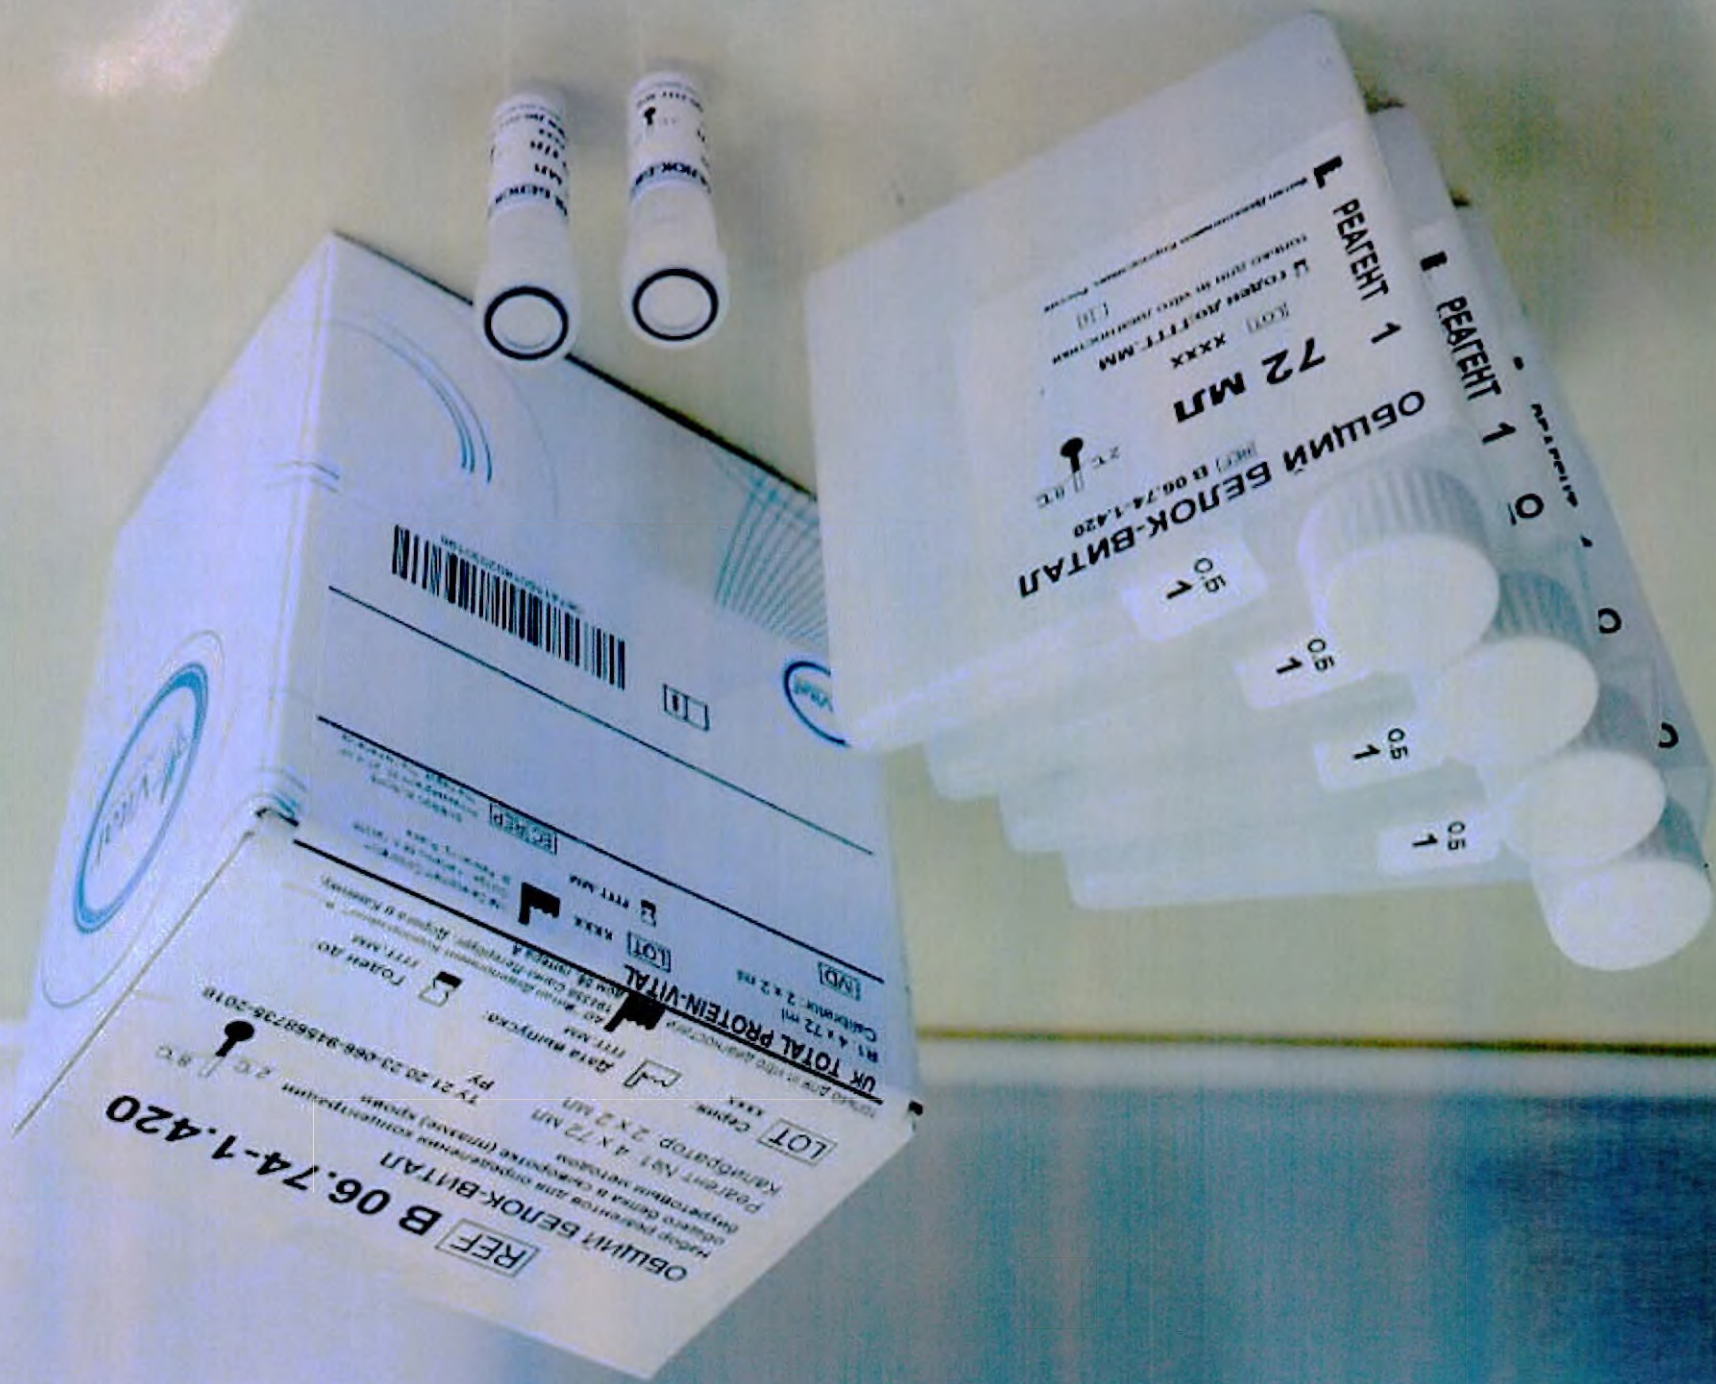

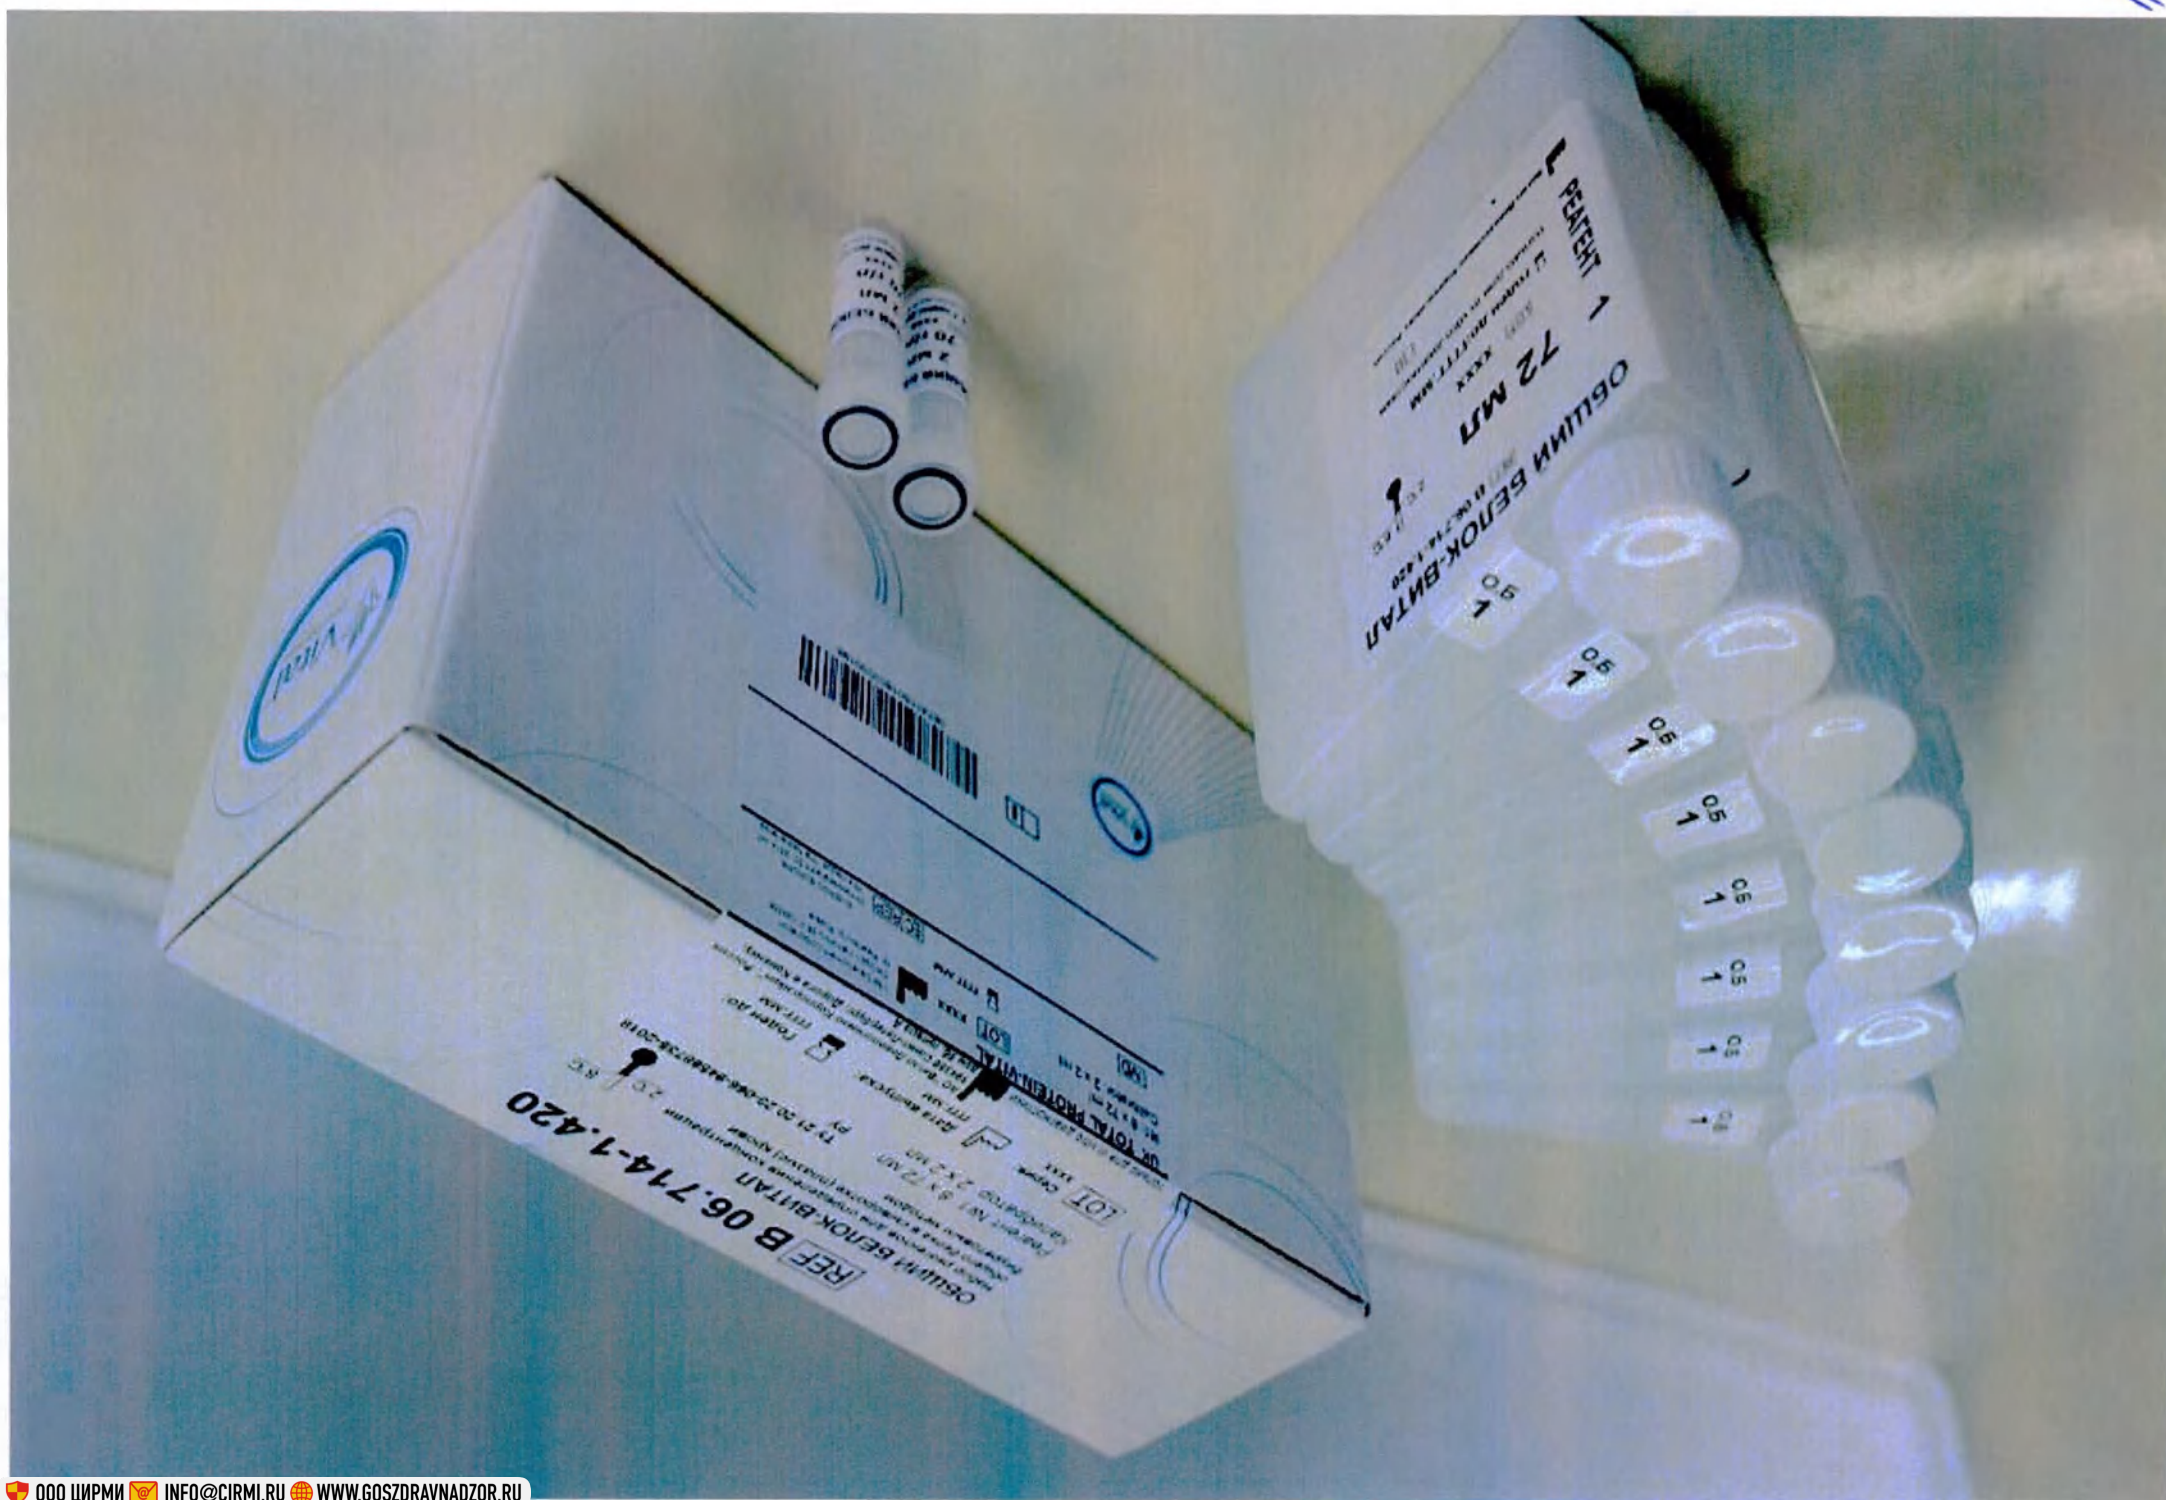


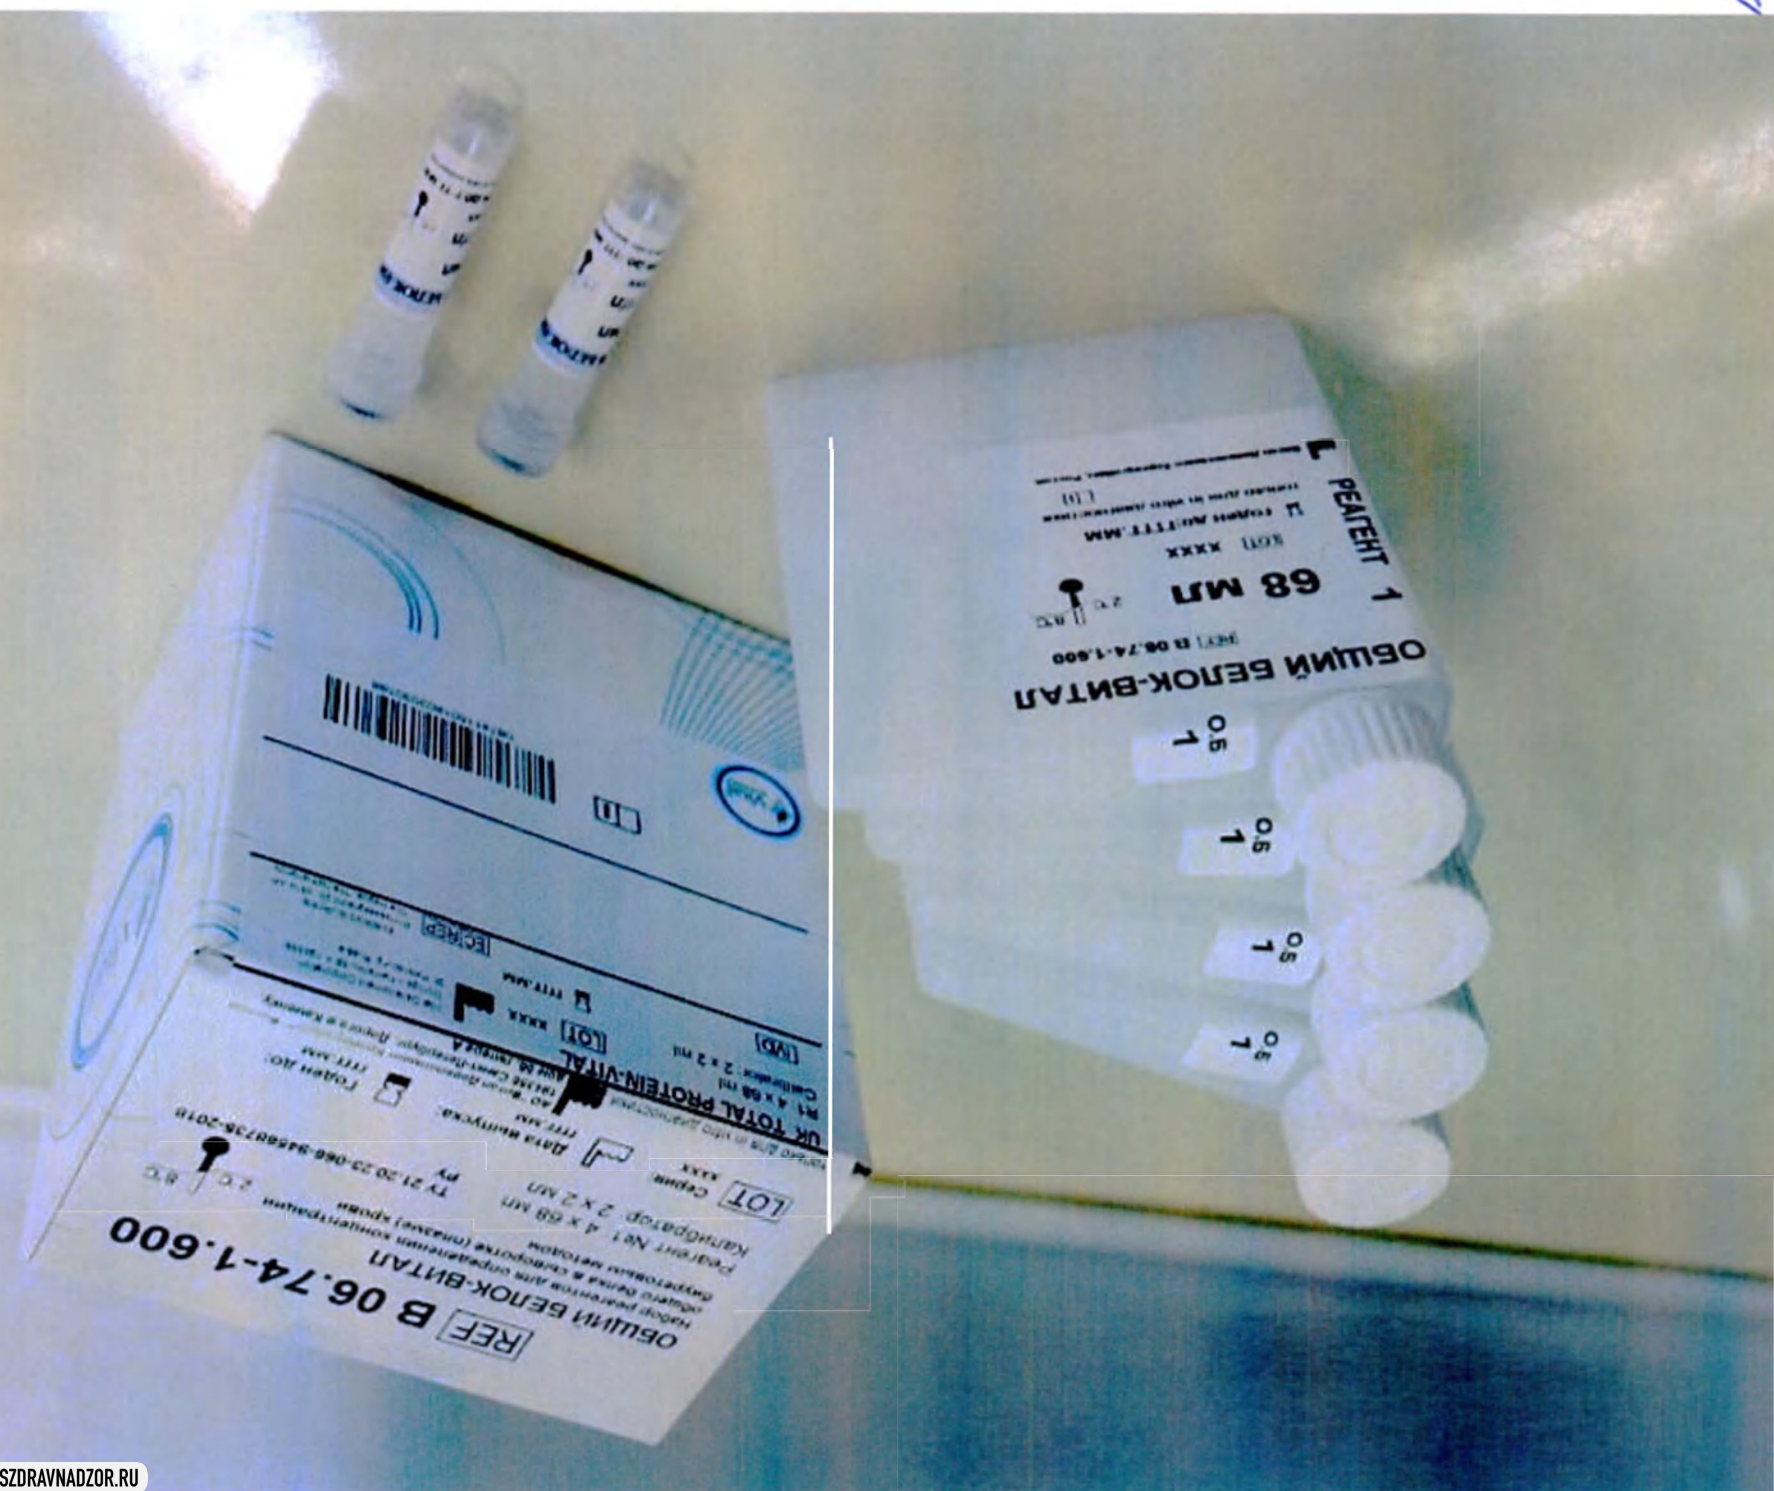


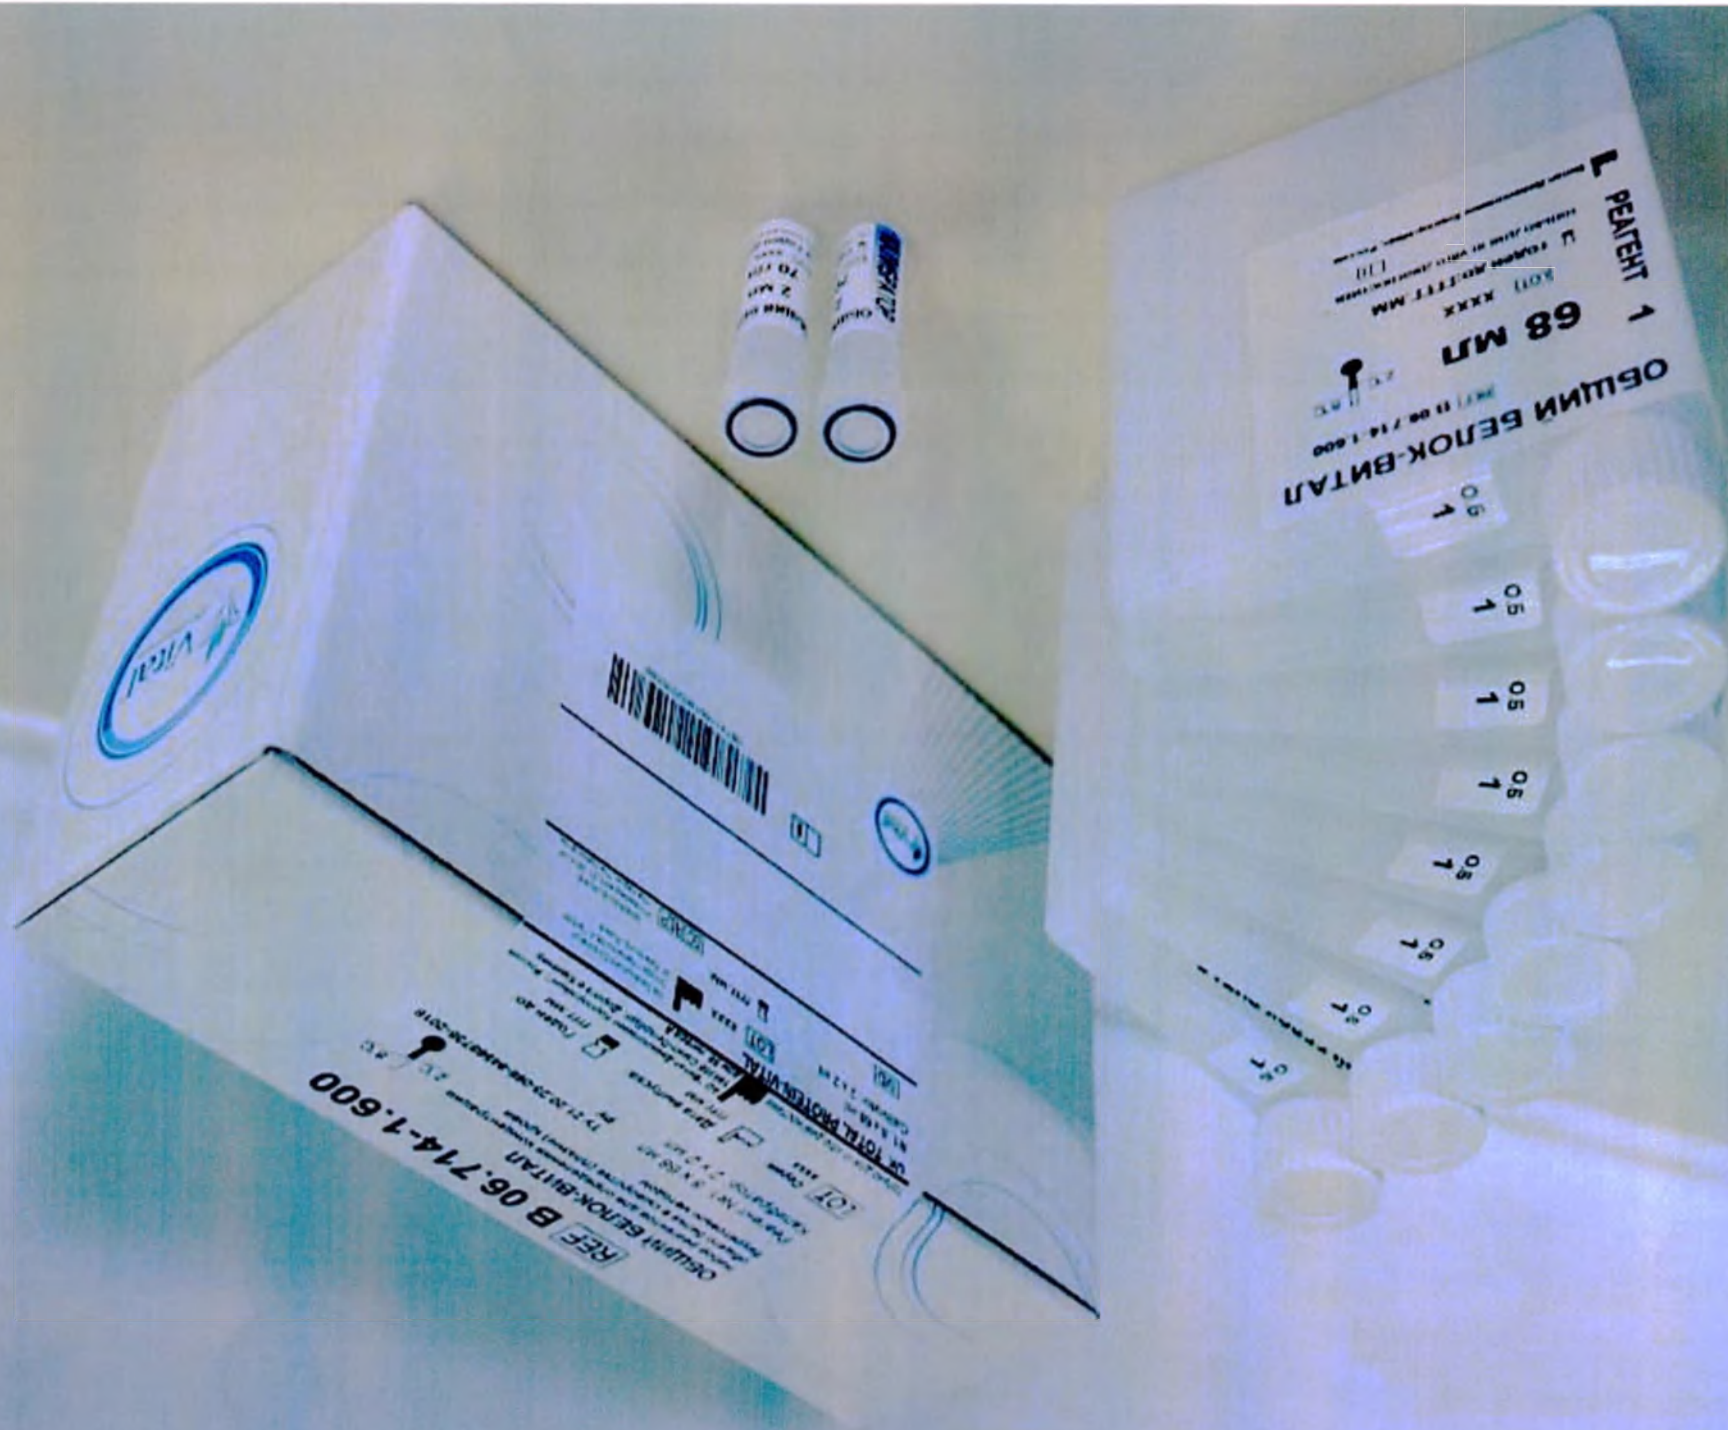






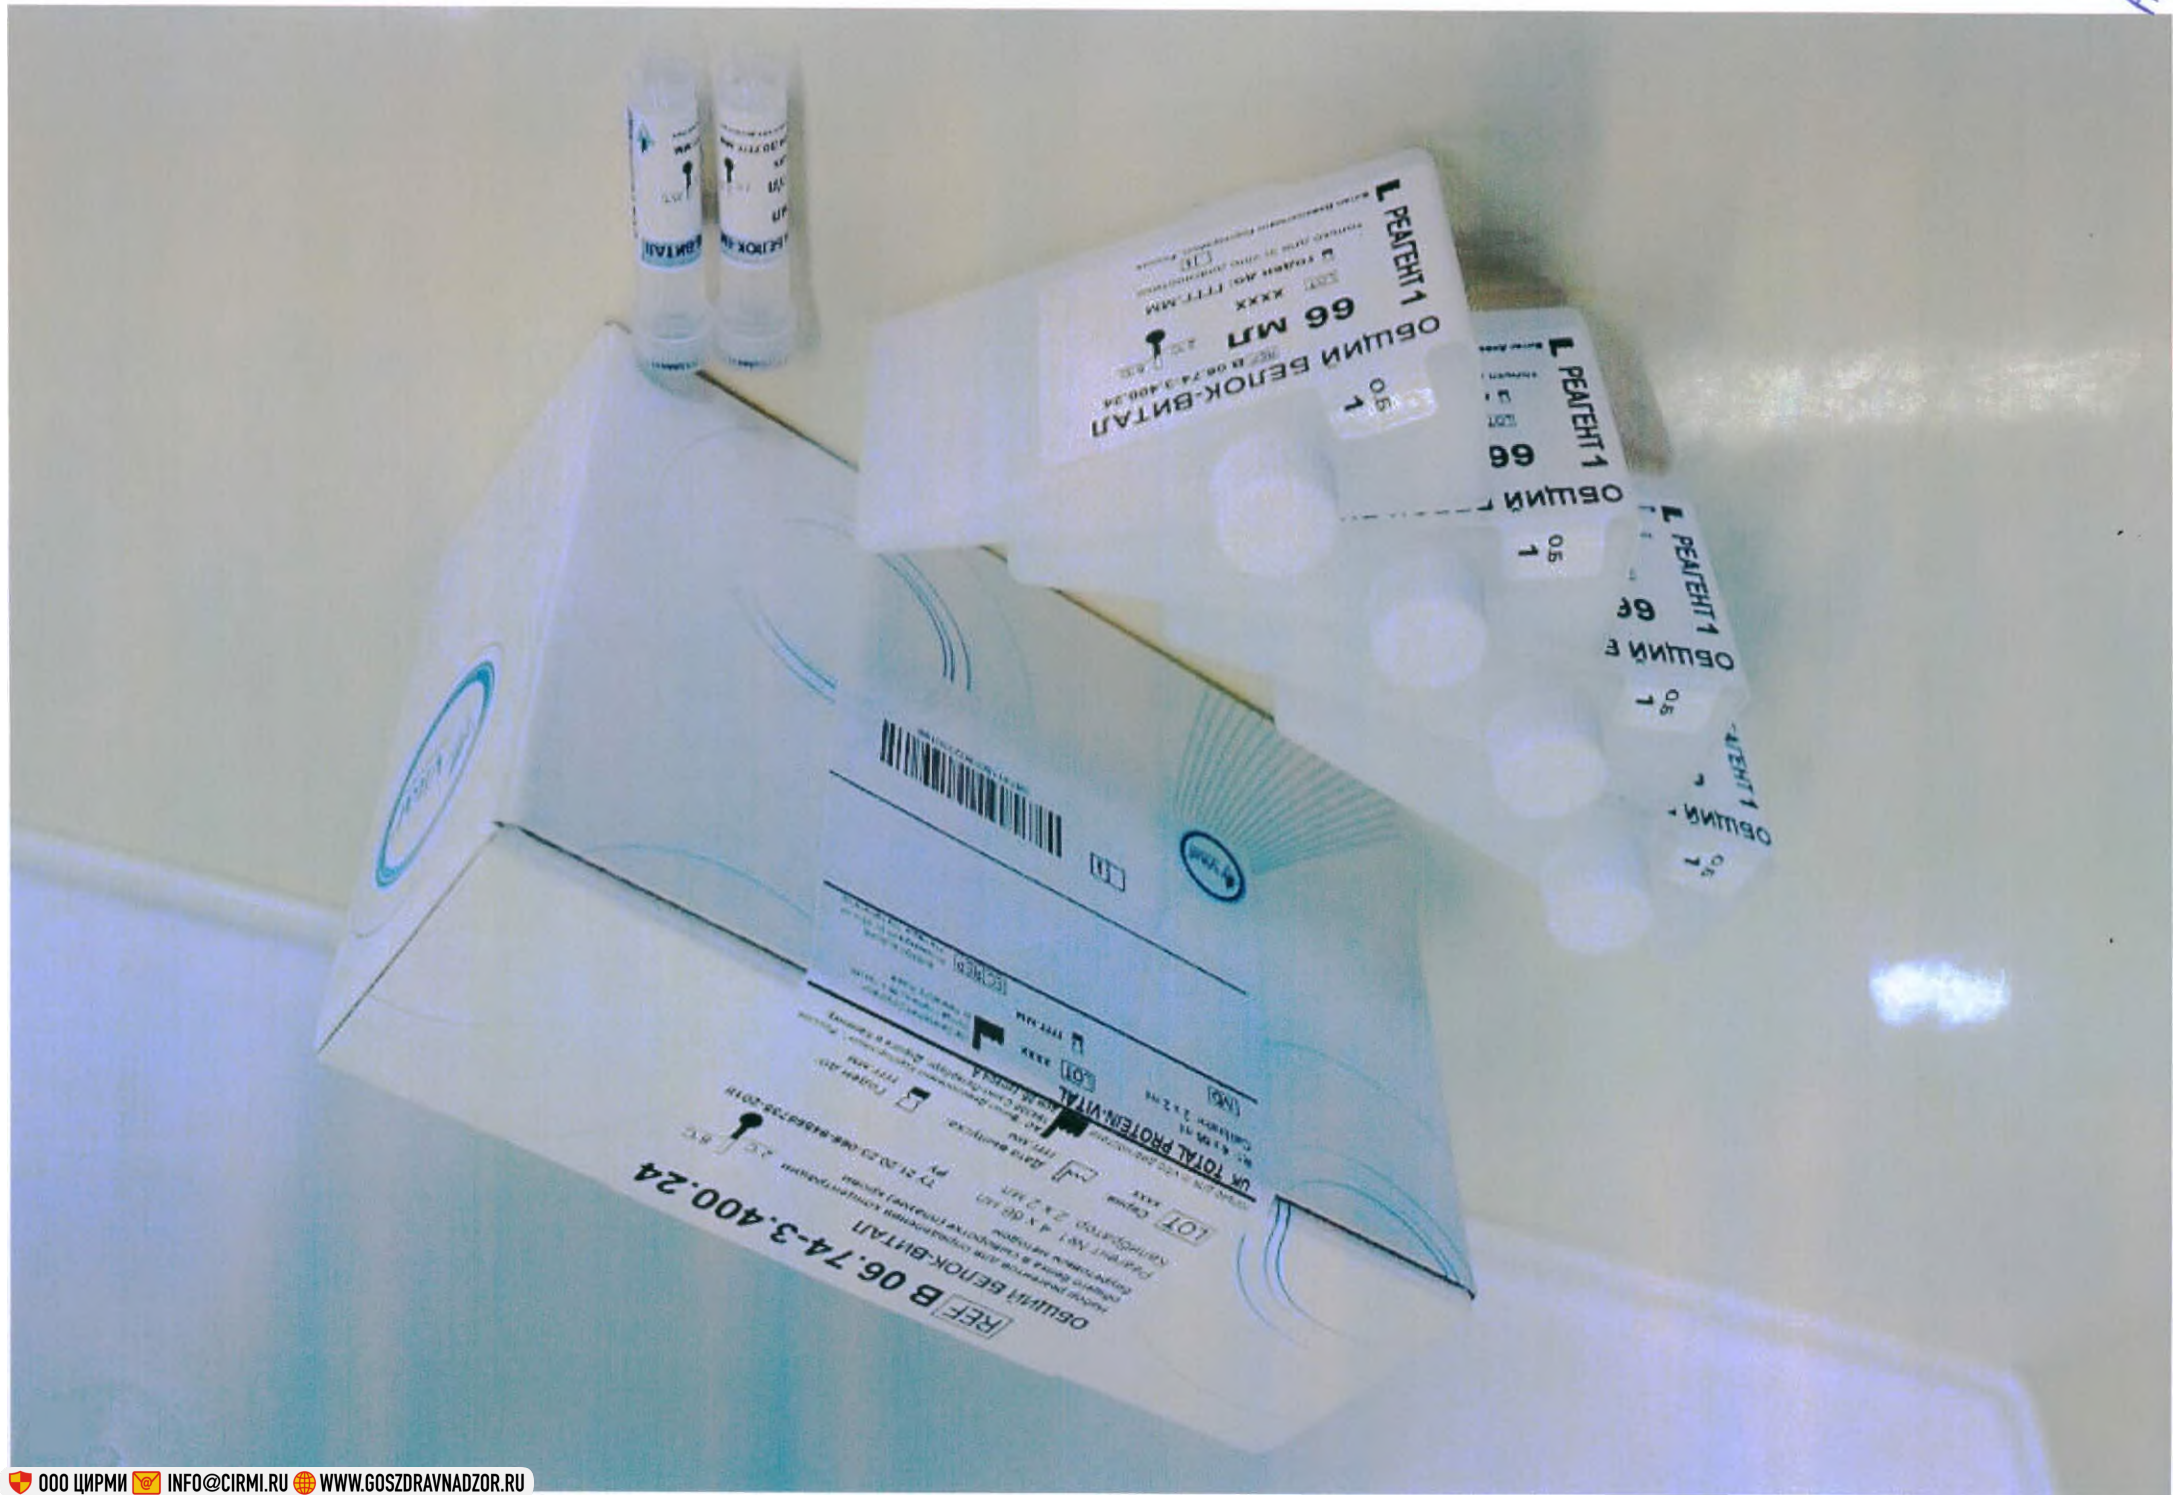

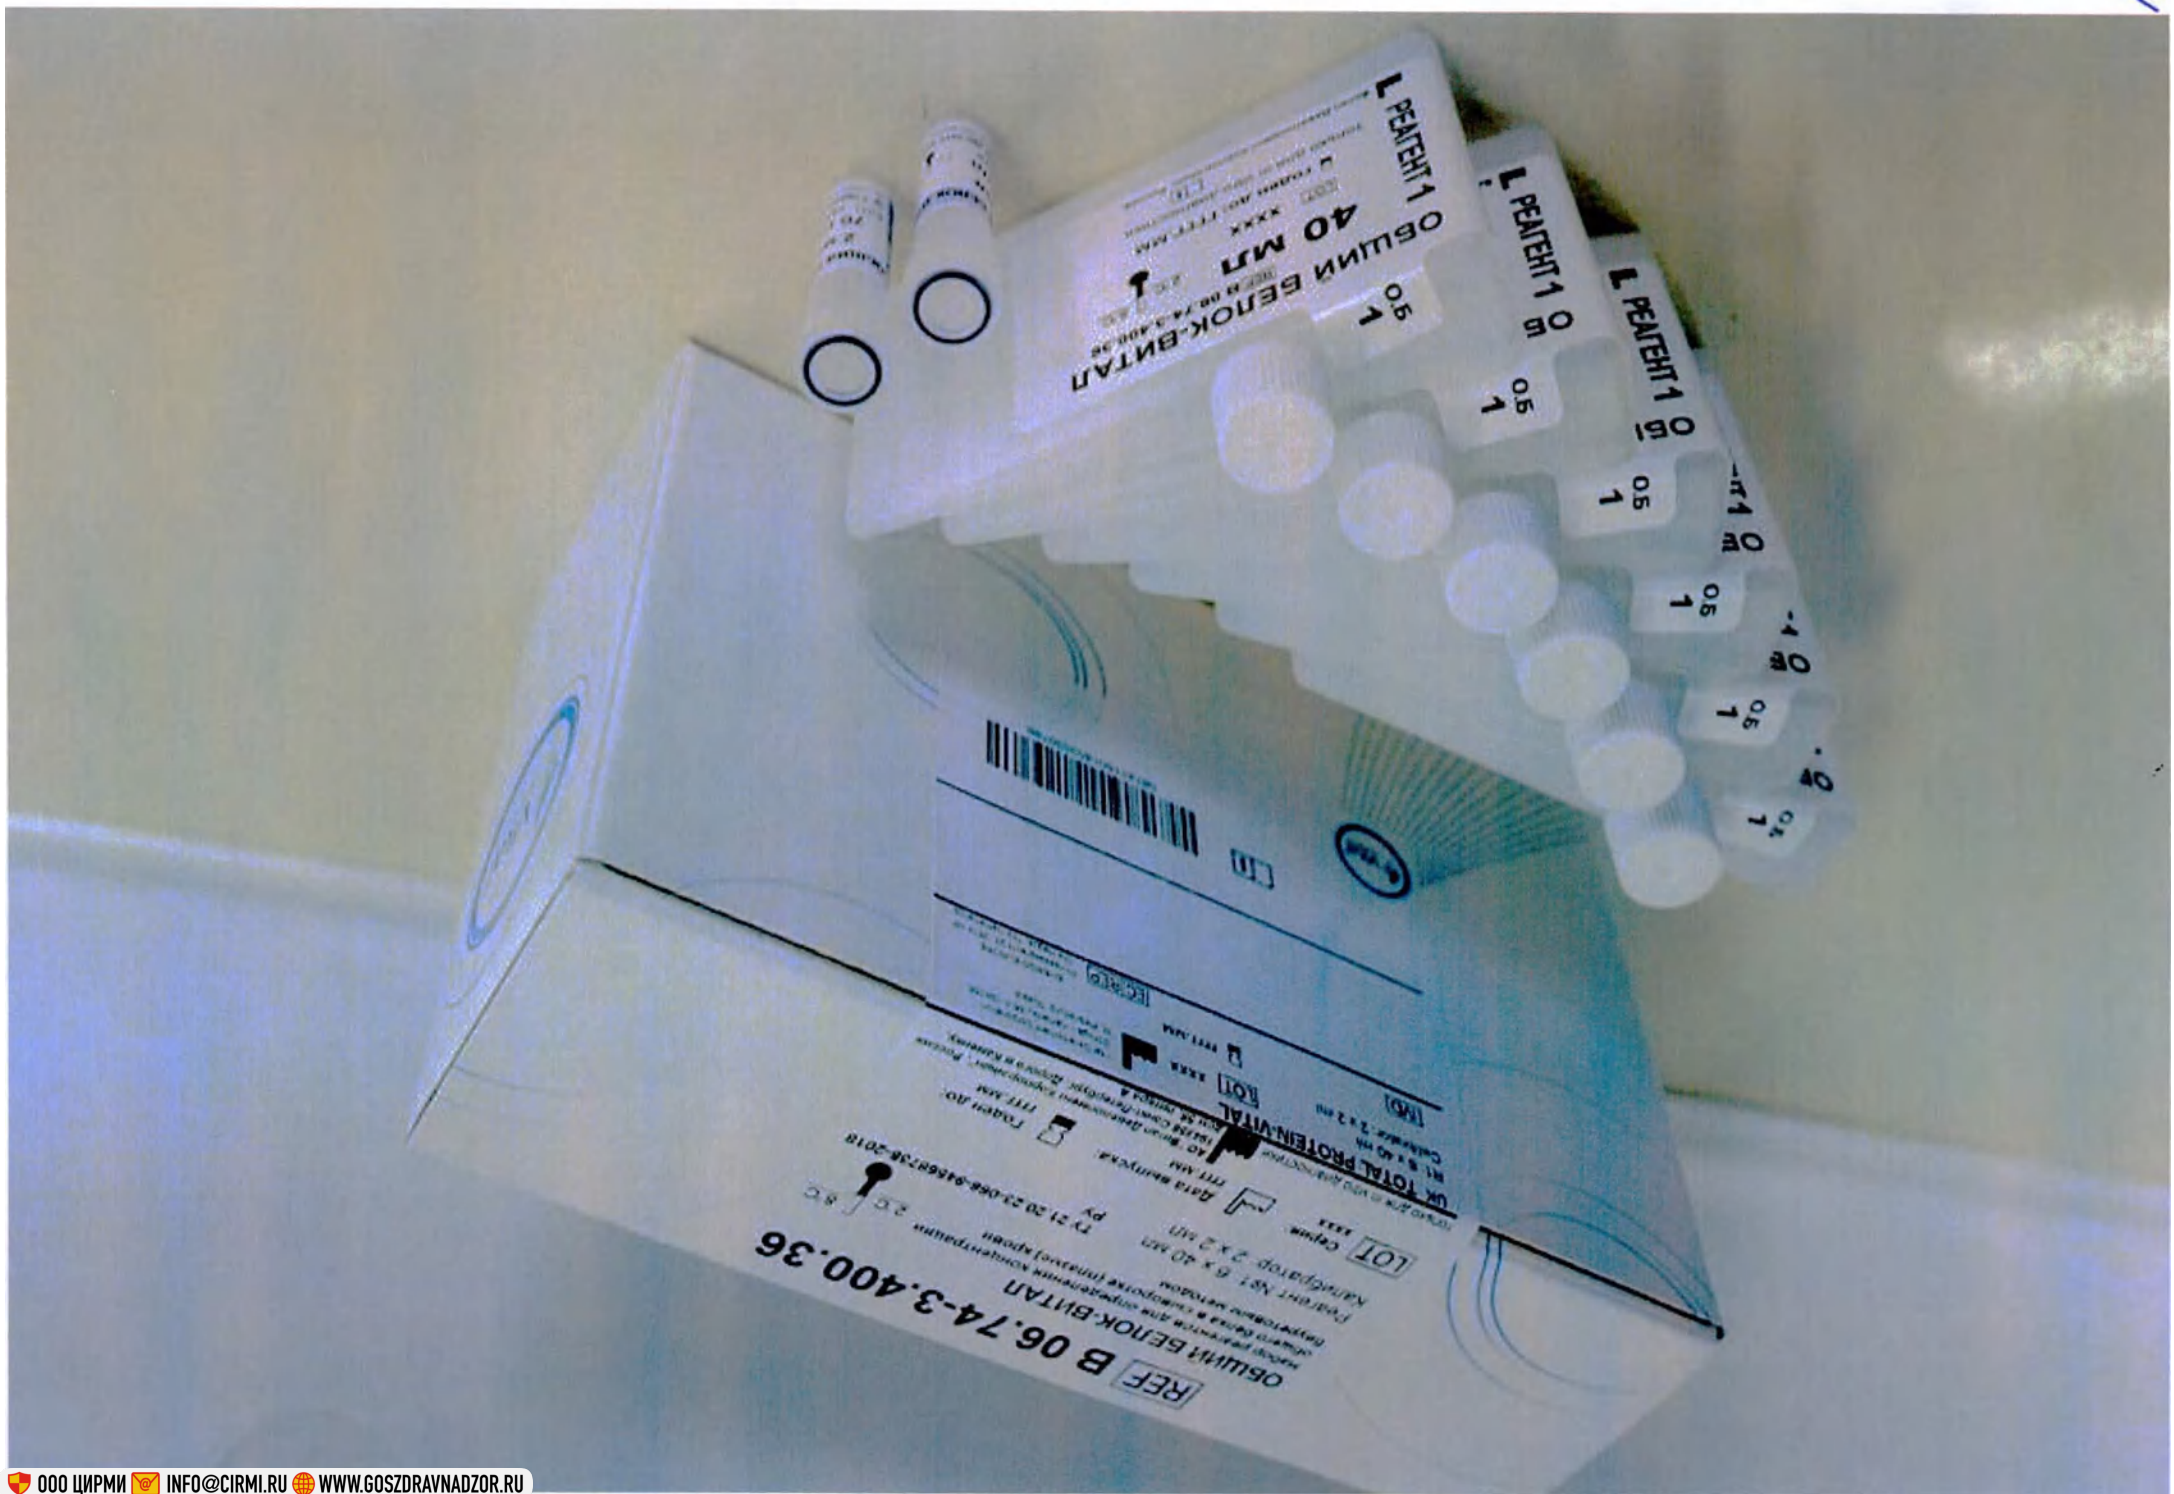






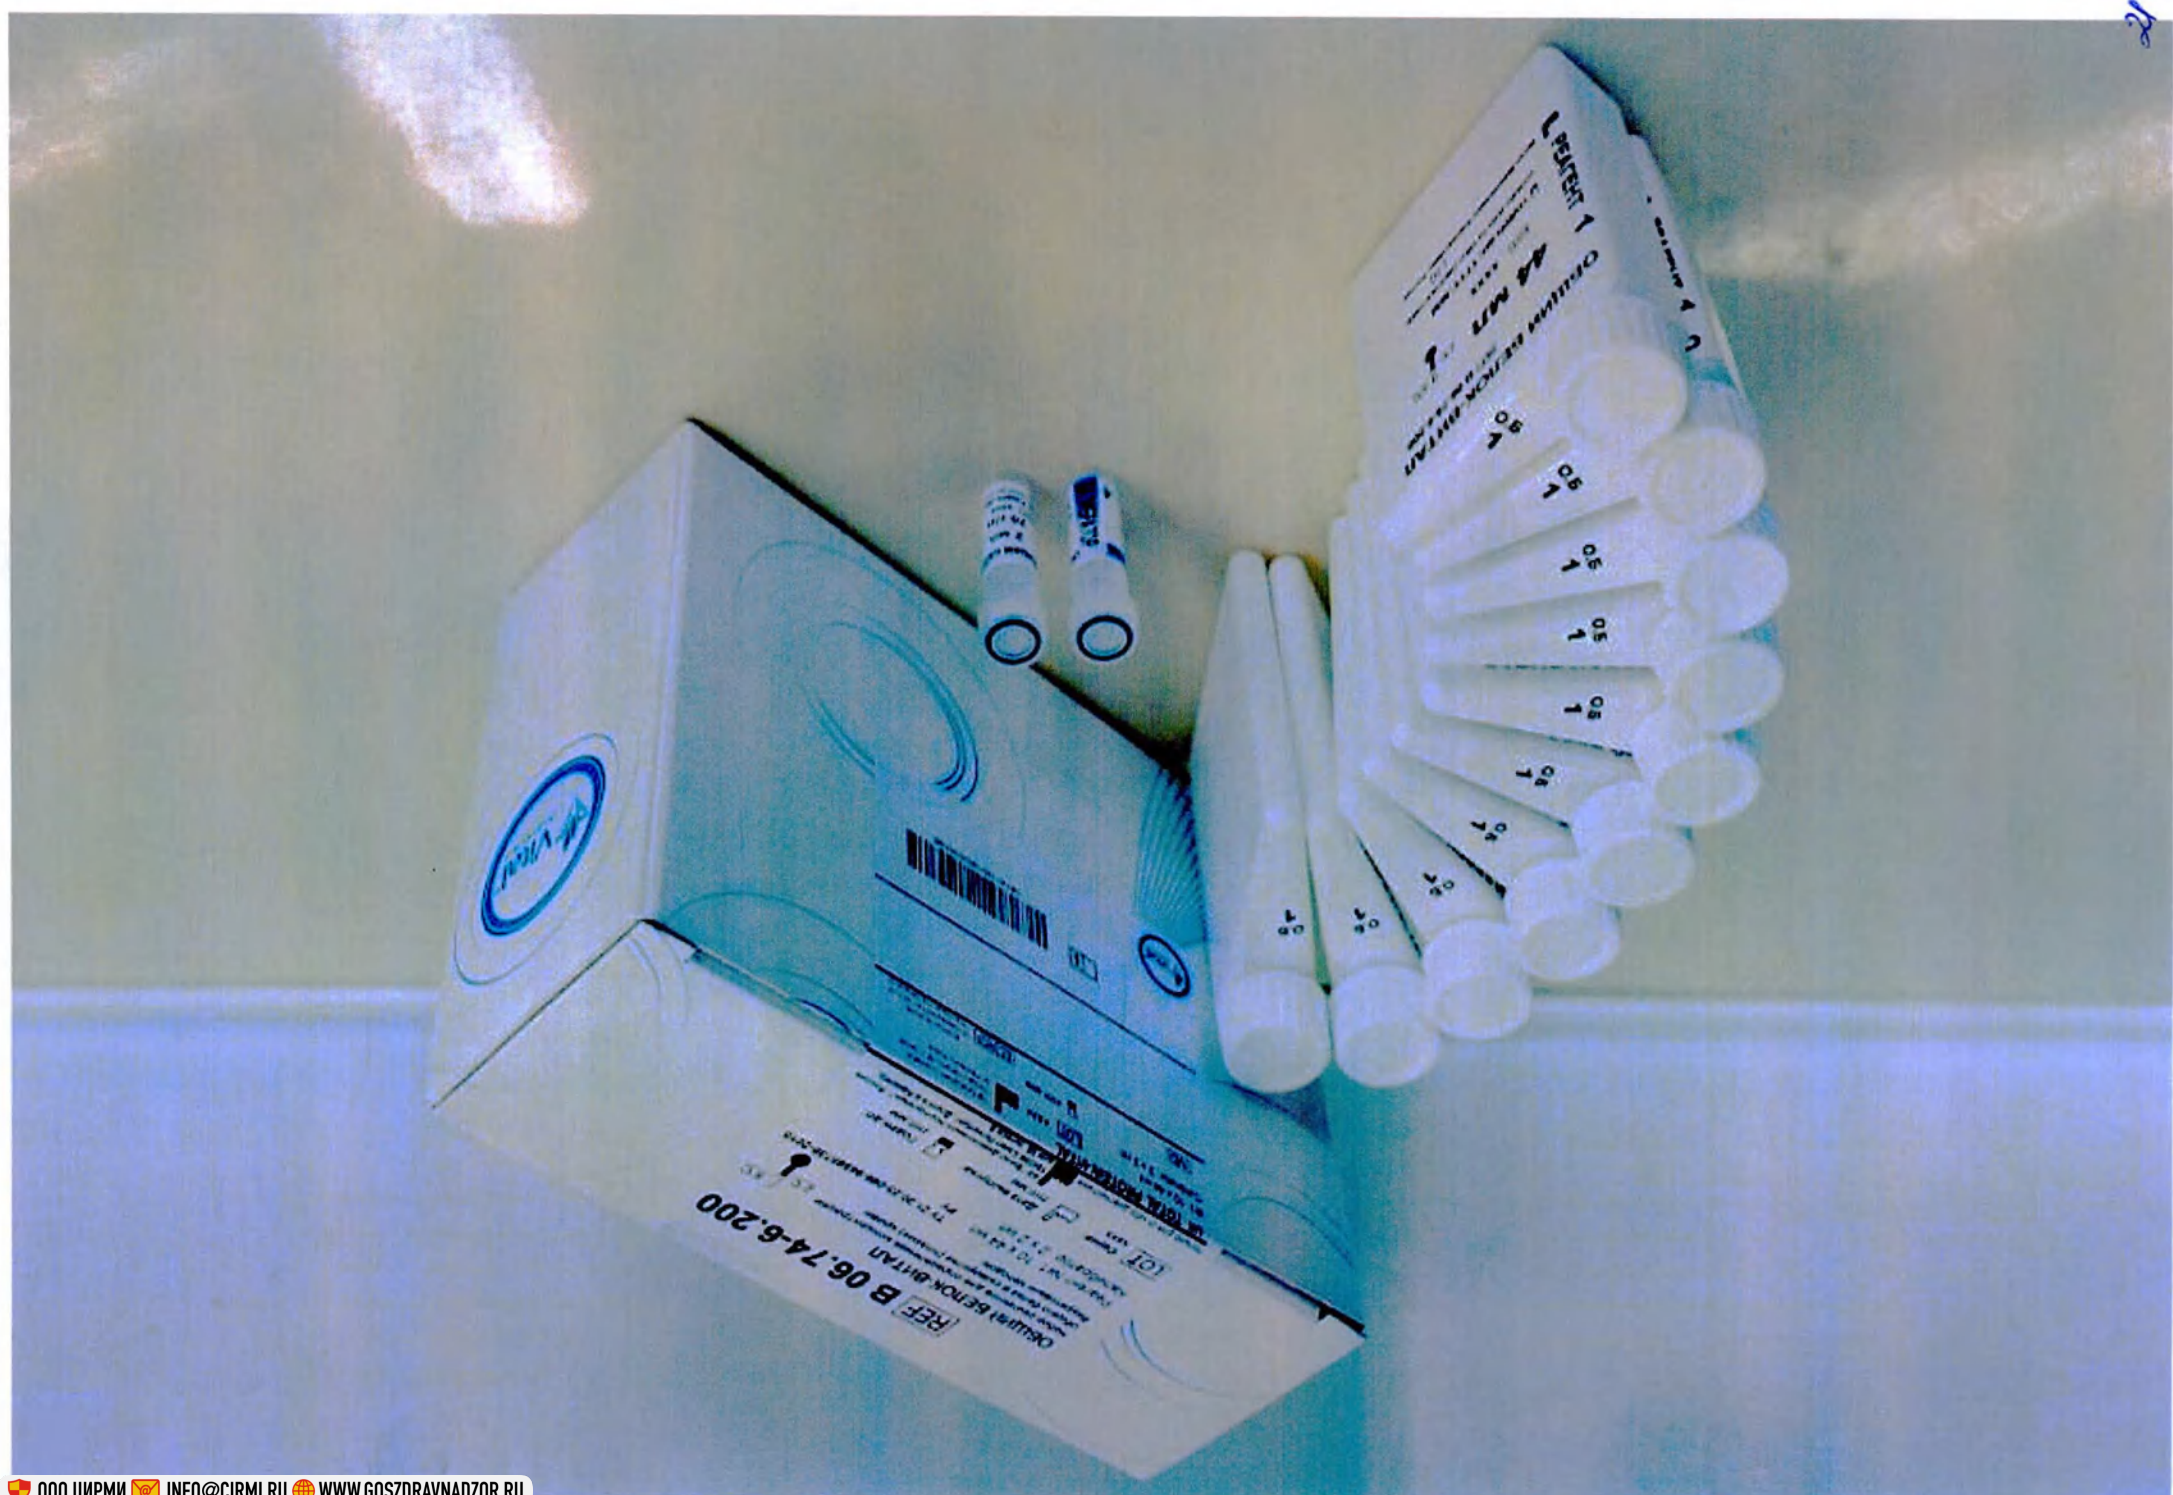





42

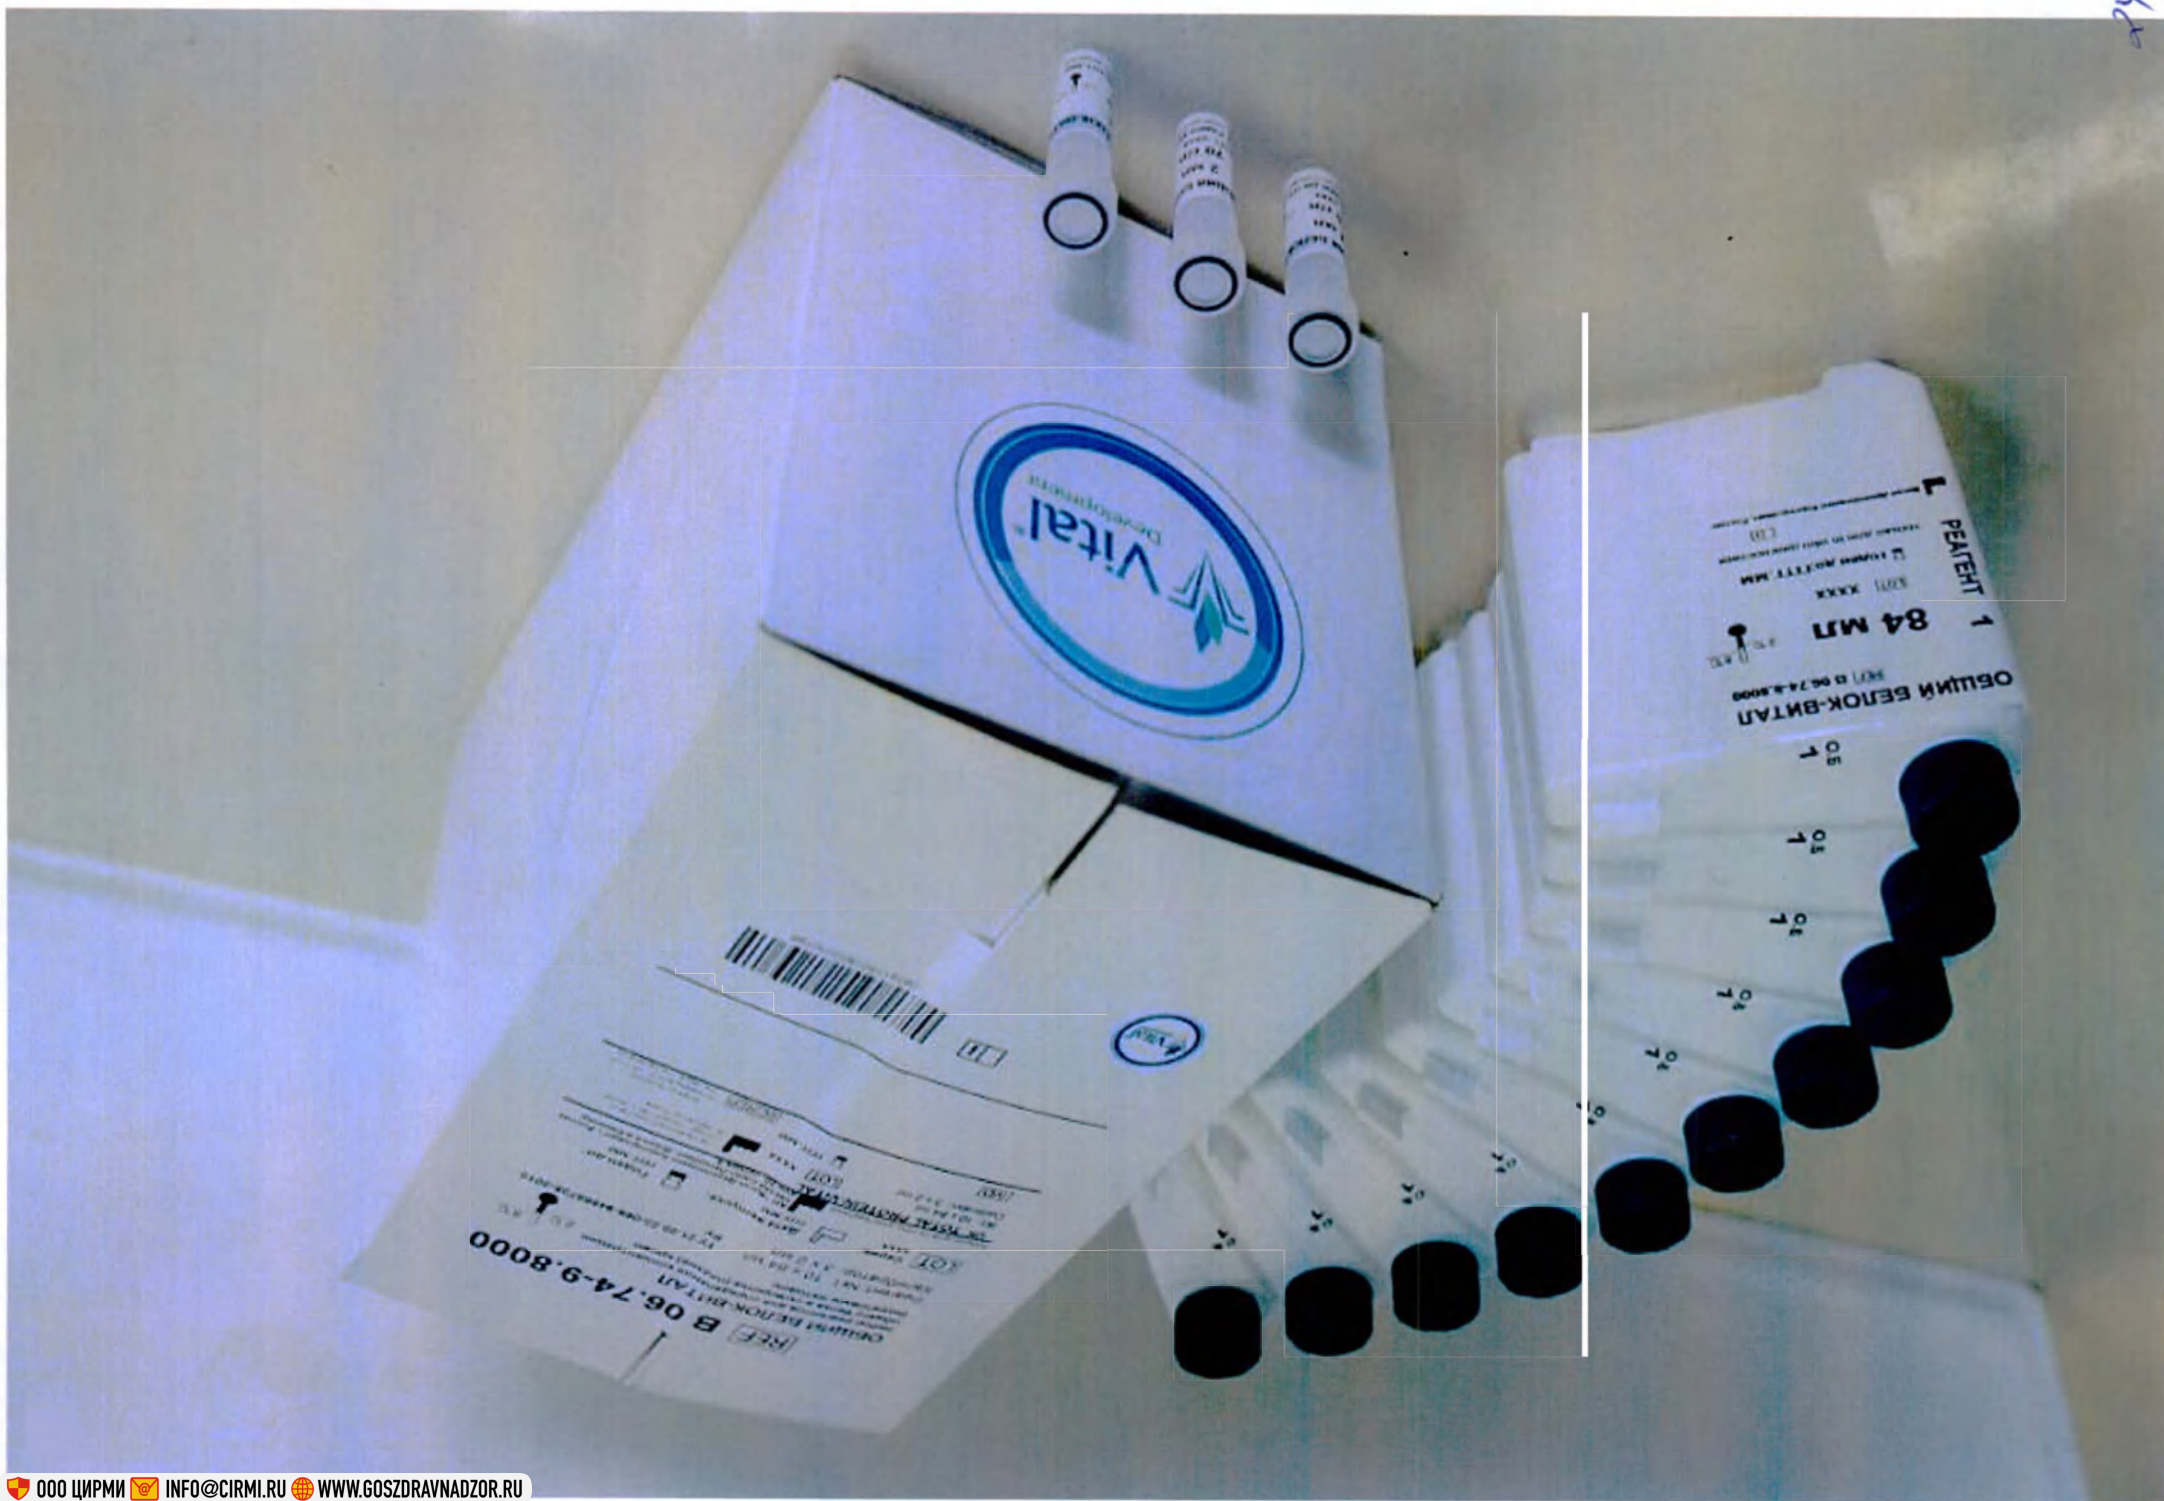



REF B 06.74-10.25

ENIGUNI ACTION-BITAI

UK TOTAL POTENTIAL



L PEATEHT 1 50
OELIMIN F 50
L PEATEHT 1 50
OELIMIN F 50
L PEATEHT 1 50
OELIMIN F 50
L PEATEHT 1 50
OELIMIN F 50
L PEATEHT 1 50
OELIMIN F 50

Handwritten signature



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 26 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.

