

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эндокарбон»

 С.Г. Милов



 августа 2018 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия:

«Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон»

по ЕКРБ.942519.300 ТУ»,

Производства компании ООО «Эндокарбон»

2018 год

КЕЙДЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА «ЭНДОКАРБОН»
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

ЕКРБ.942519.300 ТУ РЕГ.УД. _____ ОТ _____

REF КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР L.23.9.8-Endo.1-Ti

SN СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 000011

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2018-06

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2021-06




EndoCarbon

 ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-09-59
Факс +7 (8412) 38-09-68
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению




Асептично




Не использовать при
повреждении упаковки




Не стерилизовать
повторно



Запрет на
повторное
применение



Температурный
диапазон



Диапазон
влажности

КЕЙДЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА «ЭНДОКАРБОН»
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА


ЕКРБ.942519.300 ТУ РЕГ.УД. _____ ОТ _____

REF КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР C.12.14.7.0-Endo.3-Ti

SN СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 000046

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2018-06

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2021-06

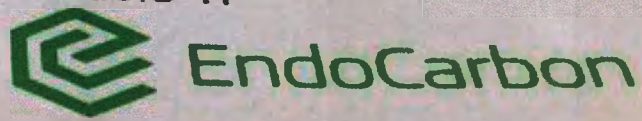

 ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-09-59
Факс +7 (8412) 38-09-68
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

STERILE | EO

НЕТОКСИЧНО



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению



Аллергенно




Не использовать при
повреждении упаковки




Не стерилизовать
повторно



Запрет на
повторное
применение



Температурный
диапазон



Диапазон
влажности

КЕЙДЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА «ЭНДОКАРБОН»

ГРУДНОГО ОТДЕЛА

ЕКРБ.942519.300 ТУ РЕГ.УД. _____ ОТ _____

REF КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР Th.23.9.8-Endo.2-Ti

SN СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 000047

DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2018-06

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2021-06



EndoCarbon



ООО «Эндокарбон»

440004, Россия

Пенза, ул. Центральная, 1

Тел. +7 (8412) 38-09-59


Факс +7 (8412) 38-09-68

E-mail: endocarbon@mail.ru

www.endocarbon.ru

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению



Апирогенно




Не использовать при
повреждении упаковки




Не стерилизовать
повторно



Запрет на
повторное
применение



Температурный
диапазон



Диапазон
влажности

Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон»
поясничного отдела

REF L.22.10.10-Endo.6-Peek

SN 000041

STERILE **EO**

2018.06

2021.06

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-02-59
E-mail: endocarbon@yandex.ru
www.endocarbon.ru

ЕКРБ.942519.300 ТУ
Рег. уд. _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Осторожно!
Обратиться к
инструкции по
применению

Аллергия

Не использовать при
повреждении упаковки

Не стерилизовать
повторно

Запрет на
повторное
применение

Температурный
диапазон
+5°C +40°C

Диапазон
влажности
0% 80%

Вариант маркировки индивидуальной тары медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон»
по ЕКРБ.942519.300 ТУ

Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон»
шейного отдела

REF C.12.15.5,3-Endo.4-Ti

SN 000099

 EndoCarbon

STERILE EO

 2018.06

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пискаревский ул. Центральная, 1
Тел: +7 (8412) 36-09-59
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

 2021.06

ЕКРБ 942519.300 TY
Рег. уд. _____ от _____

НЕТОКСИЧНО



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению



Антигорюче



Не использовать при
повреждении упаковки



Не стерилизовать
повторно



Запрет на
повторное
применение



Температурный
диапазон



Диапазон
влажности

Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон»
грудного отдела

REF Th.27.9.10-Endo.2-Ti

SN 000048

 EndoCarbon

STERILE EO

 2018.06

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-08-59
E-mail: endocarbon@yandex.ru
www.endocarbon.ru

НЕТОКСИЧНО

 2021.06

ЕКРБ.942519.300.TY
Рег. уд. _____ от _____



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению



Апирогенно



Не использовать при
повреждении упаковки



Не стерилизовать
повторно




Запрет на
повторное
применение




Температурный
диапазон



Диапазон
влажности

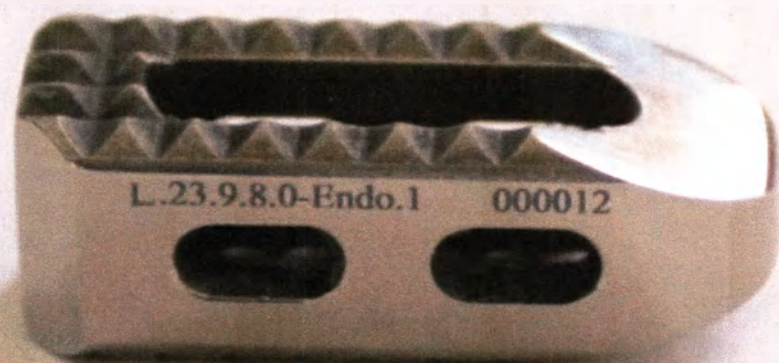

Вариант исполнения медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ, модель Endo.1

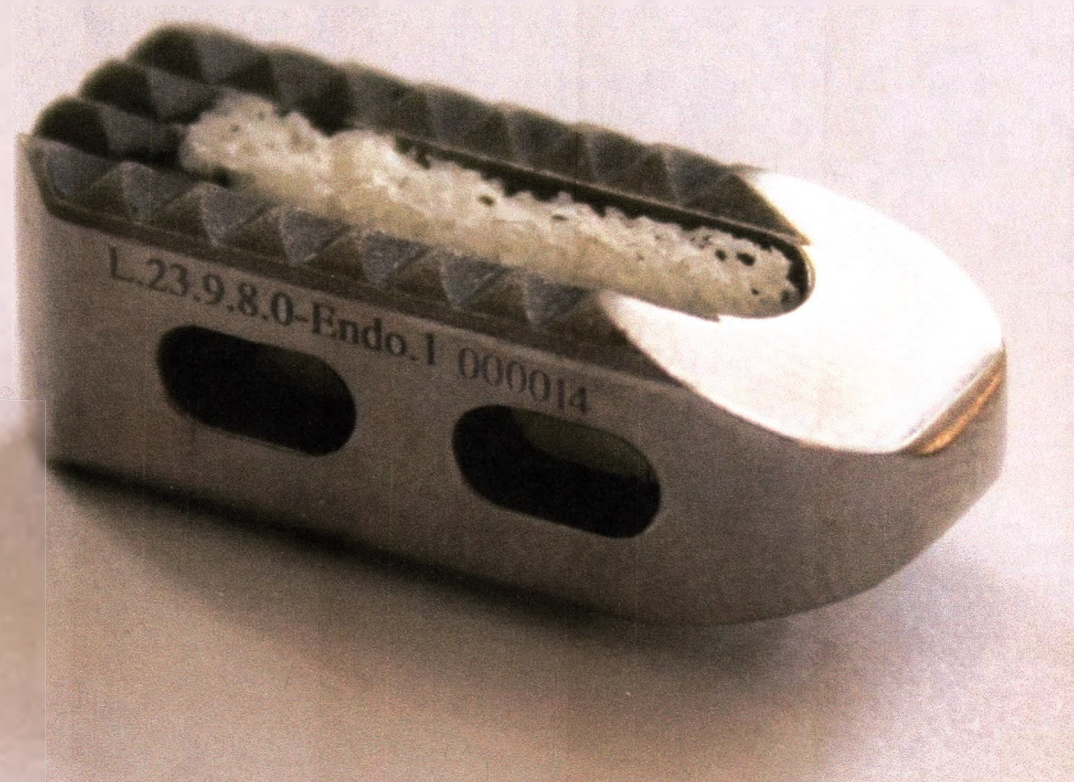



Вариант исполнения медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ, модель Endo.1



Вариант исполнения медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ, модель Endo.1



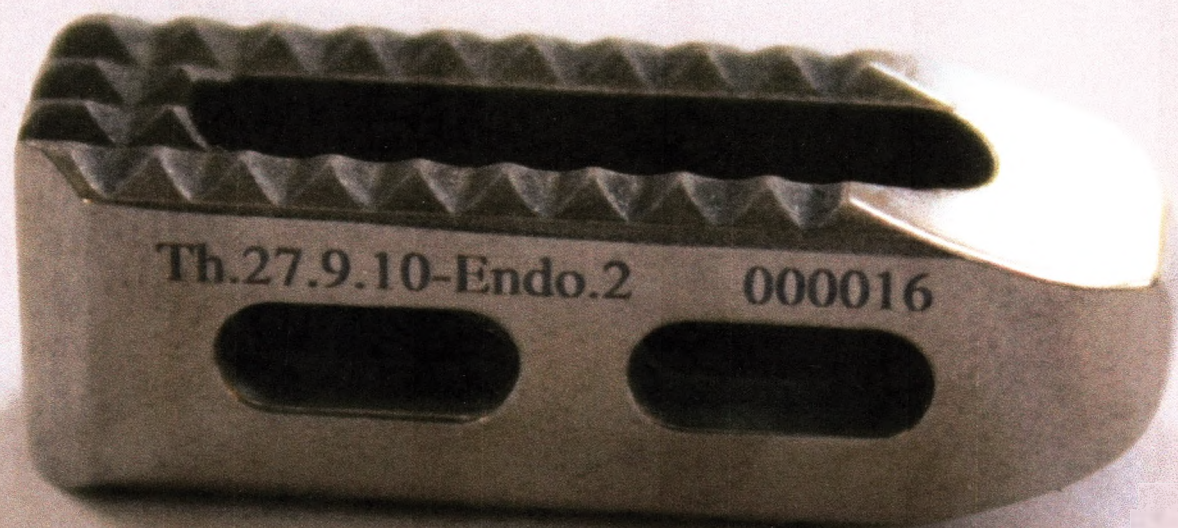


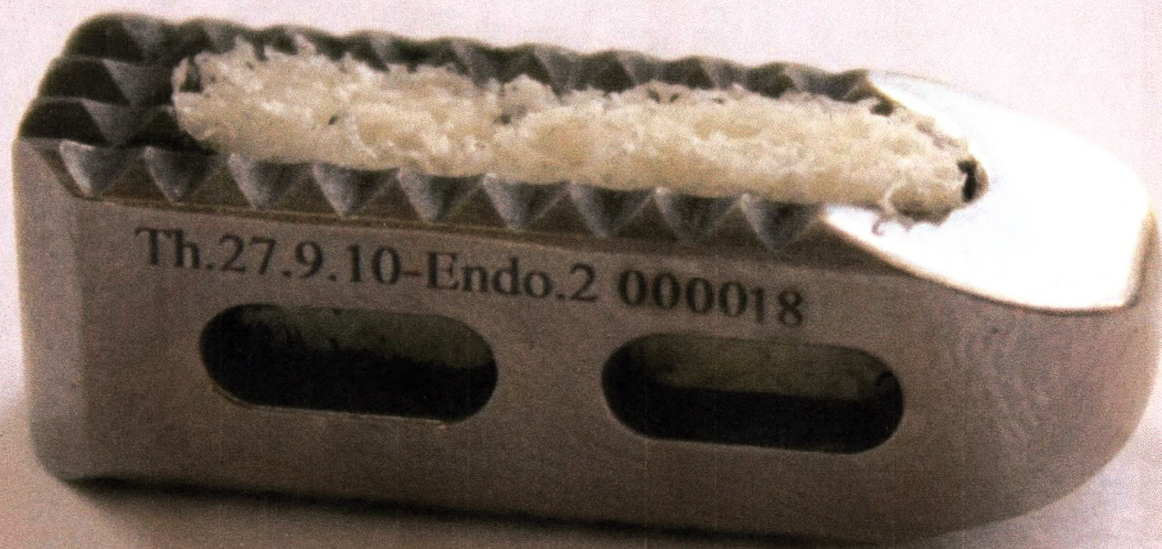







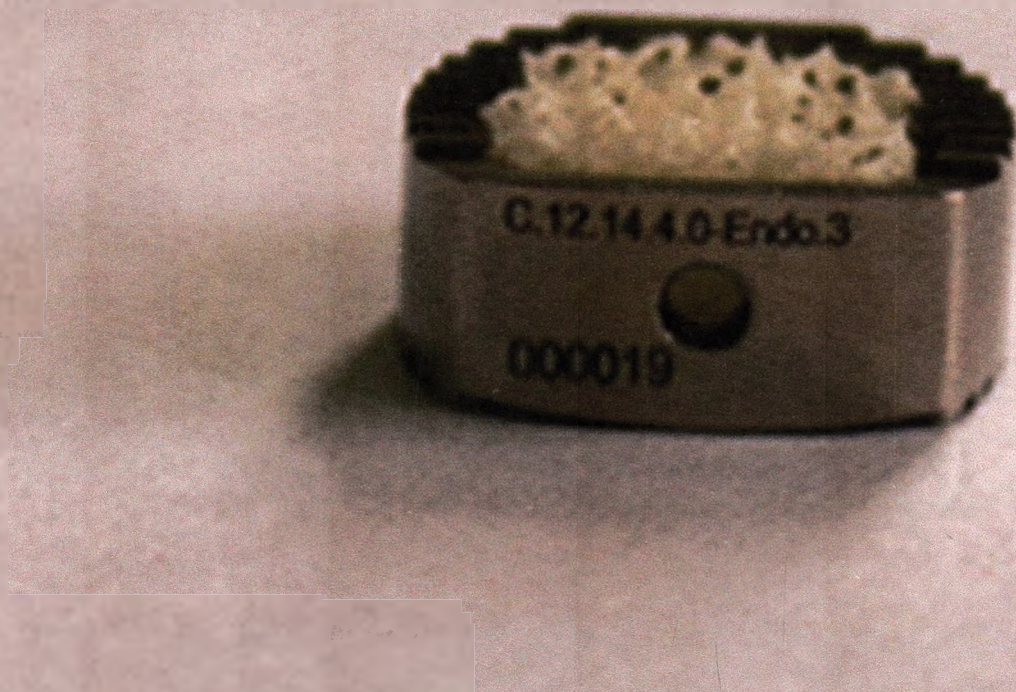



Вариант исполнения медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ, модель Endo.3












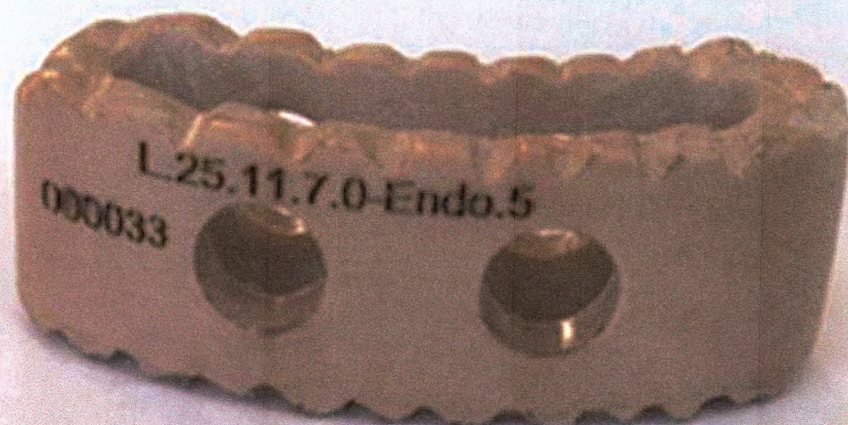







Вариант исполнения медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ, модель Endo.6



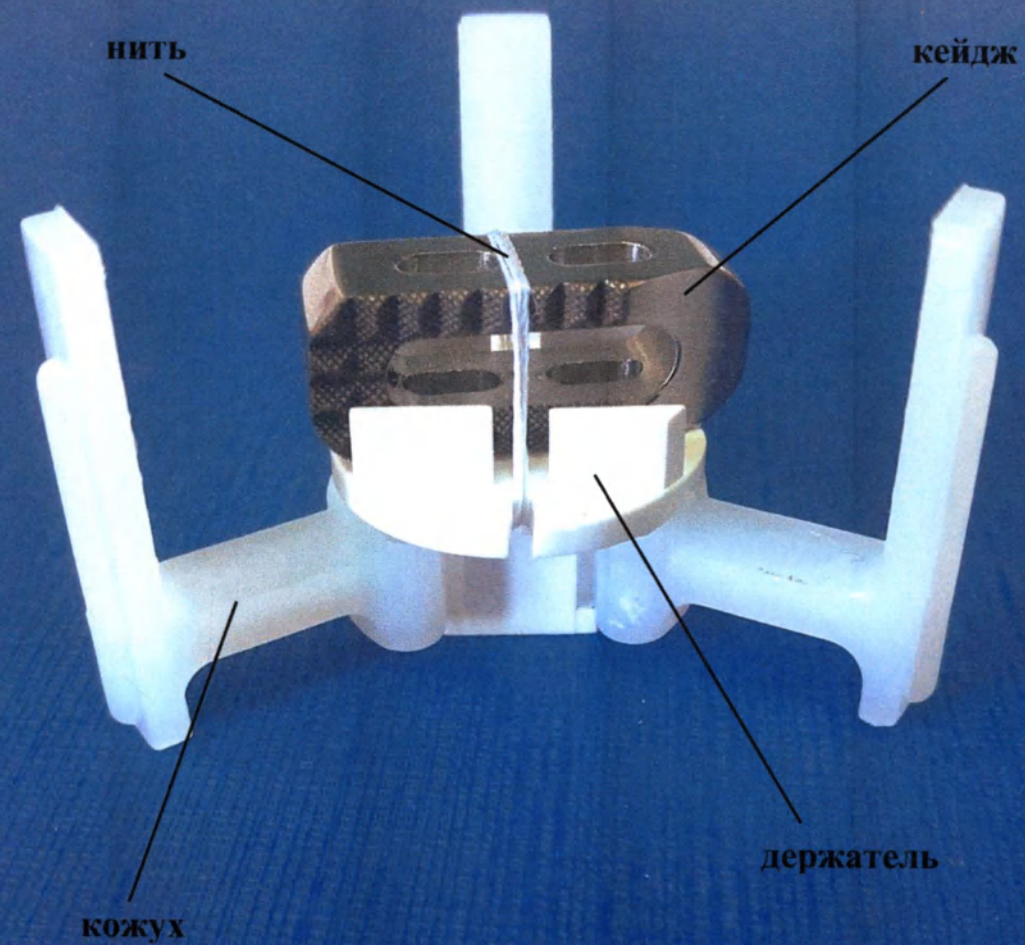

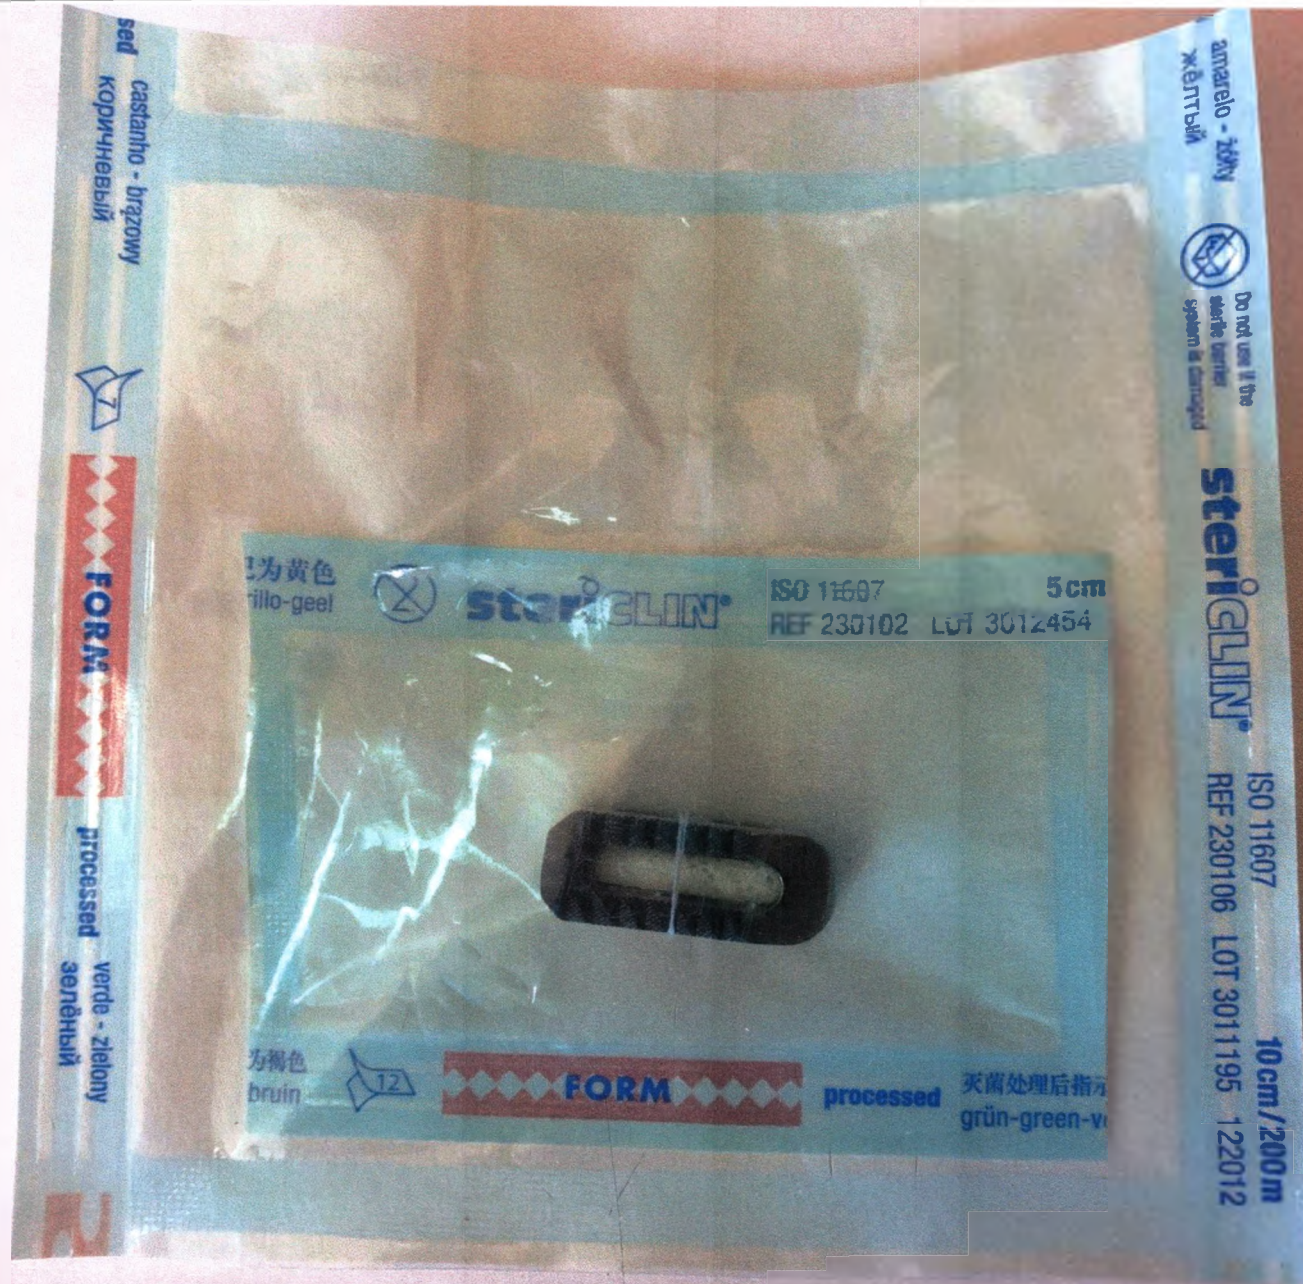

Вариант упаковки медицинского изделия «Кейдж межпозвонкового диска «Эндокарбон» по ЕКРБ.942519.300 ТУ с матриксом

КЕЙДЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА «ЭНДОКАРБОН»
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

ЕКРБ.942519.300 ТУ РЕГ.УД. _____ ОТ _____



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

L.23.9.8-Endo.1-Ti



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2018-06



СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

000011



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

2021-06







EndoCarbon




Не стерилизовать повторно



Запрет на повторное применение



Температурный диапазон



Диапазон влажности



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



Алиергенно



Не использовать при повреждении упаковки

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

прошнуровано и
скреплено печатью

33 листа

[Handwritten signature]

