



Р-ФАРМ

Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

ул.Берзарина, д.19, корп.1, Москва, 123154

Телефон: (+7 495) 956-79-37 (многоканальный)

Факс: (+7 495) 956-79-38

www.r-pharm.com; e-mail: info@rpharm.ru

ОГРН 1027739700020

ИНН/КПП 7726311464/774850001

Фотографические изображения медицинского изделия

Источники света эндоскопические с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Старший специалист отдела регистрации
Медицинского департамента АО «Р-Фарм»

Е.И. Геллах



Источник света эндоскопический XL-4450

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение

№ _____ **от** _____ **г.**



I. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: XL-4450 (макет маркировки на русском языке).



И. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: XL-4450.

Источник света эндоскопический PS2-HP

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.



I. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: PS2-HP (макет маркировки на русском языке).



1. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: PS2-HP.

Источник света эндоскопический BL-7000

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.



1. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: BL-7000 (макет маркировки на русском языке).




I. Источники света эндоскопические, варианты исполнения: BL-7000.



II. Принадлежности: 1. Лампы для источников света эндоскопических: LMP-FIL - не более 50 шт.



1. Лампы для источников света эндоскопических: LMP-SD- не более 50 шт.

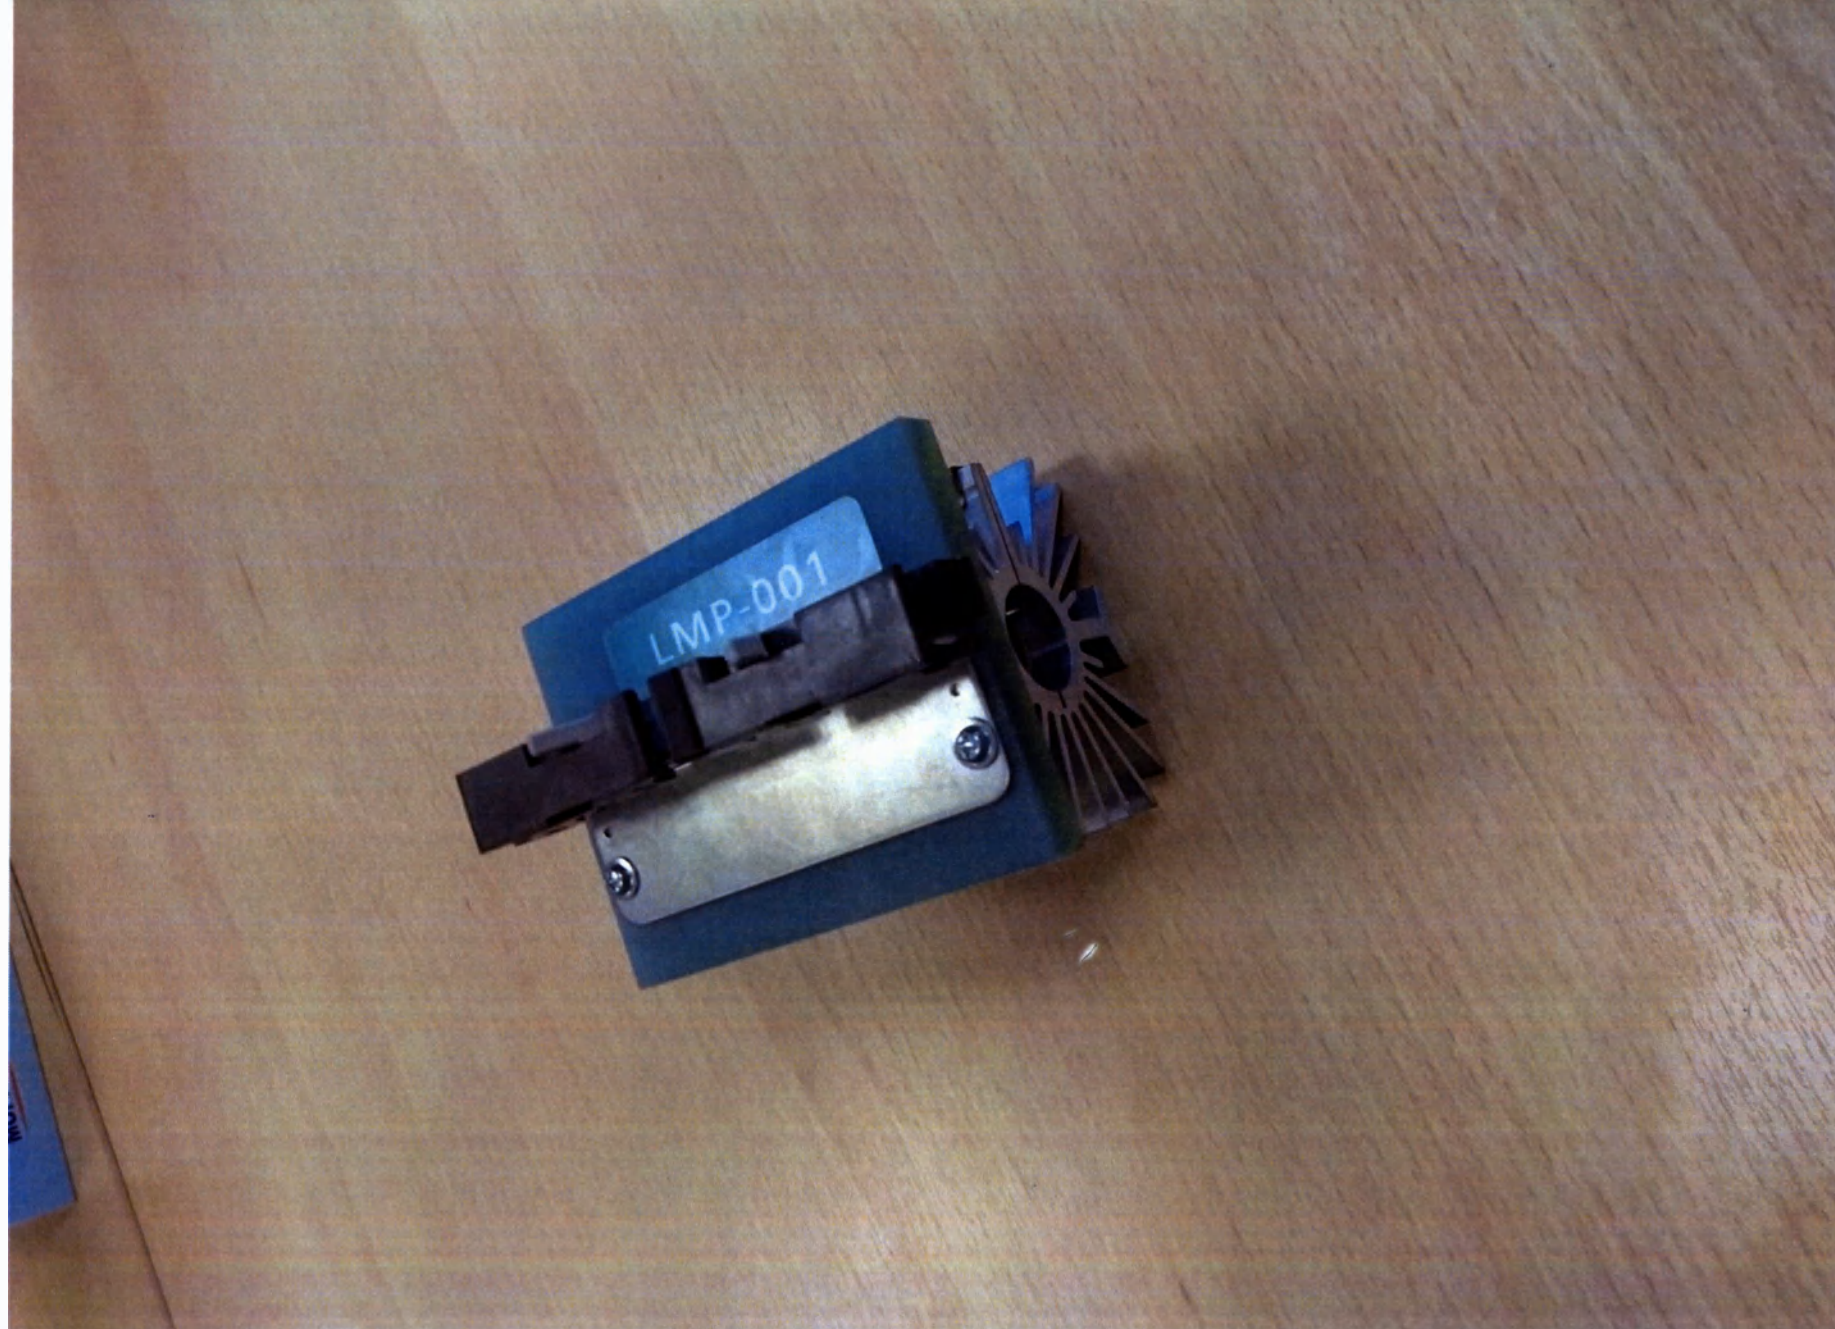


1. Лампы для источников света эндоскопических: LMP-001 - не более 50 шт.




1. Лампы для источников света эндоскопических: LMP-002 - не более 50 шт.




2. Резервуары для воды: WT-2 - не более 5 шт.

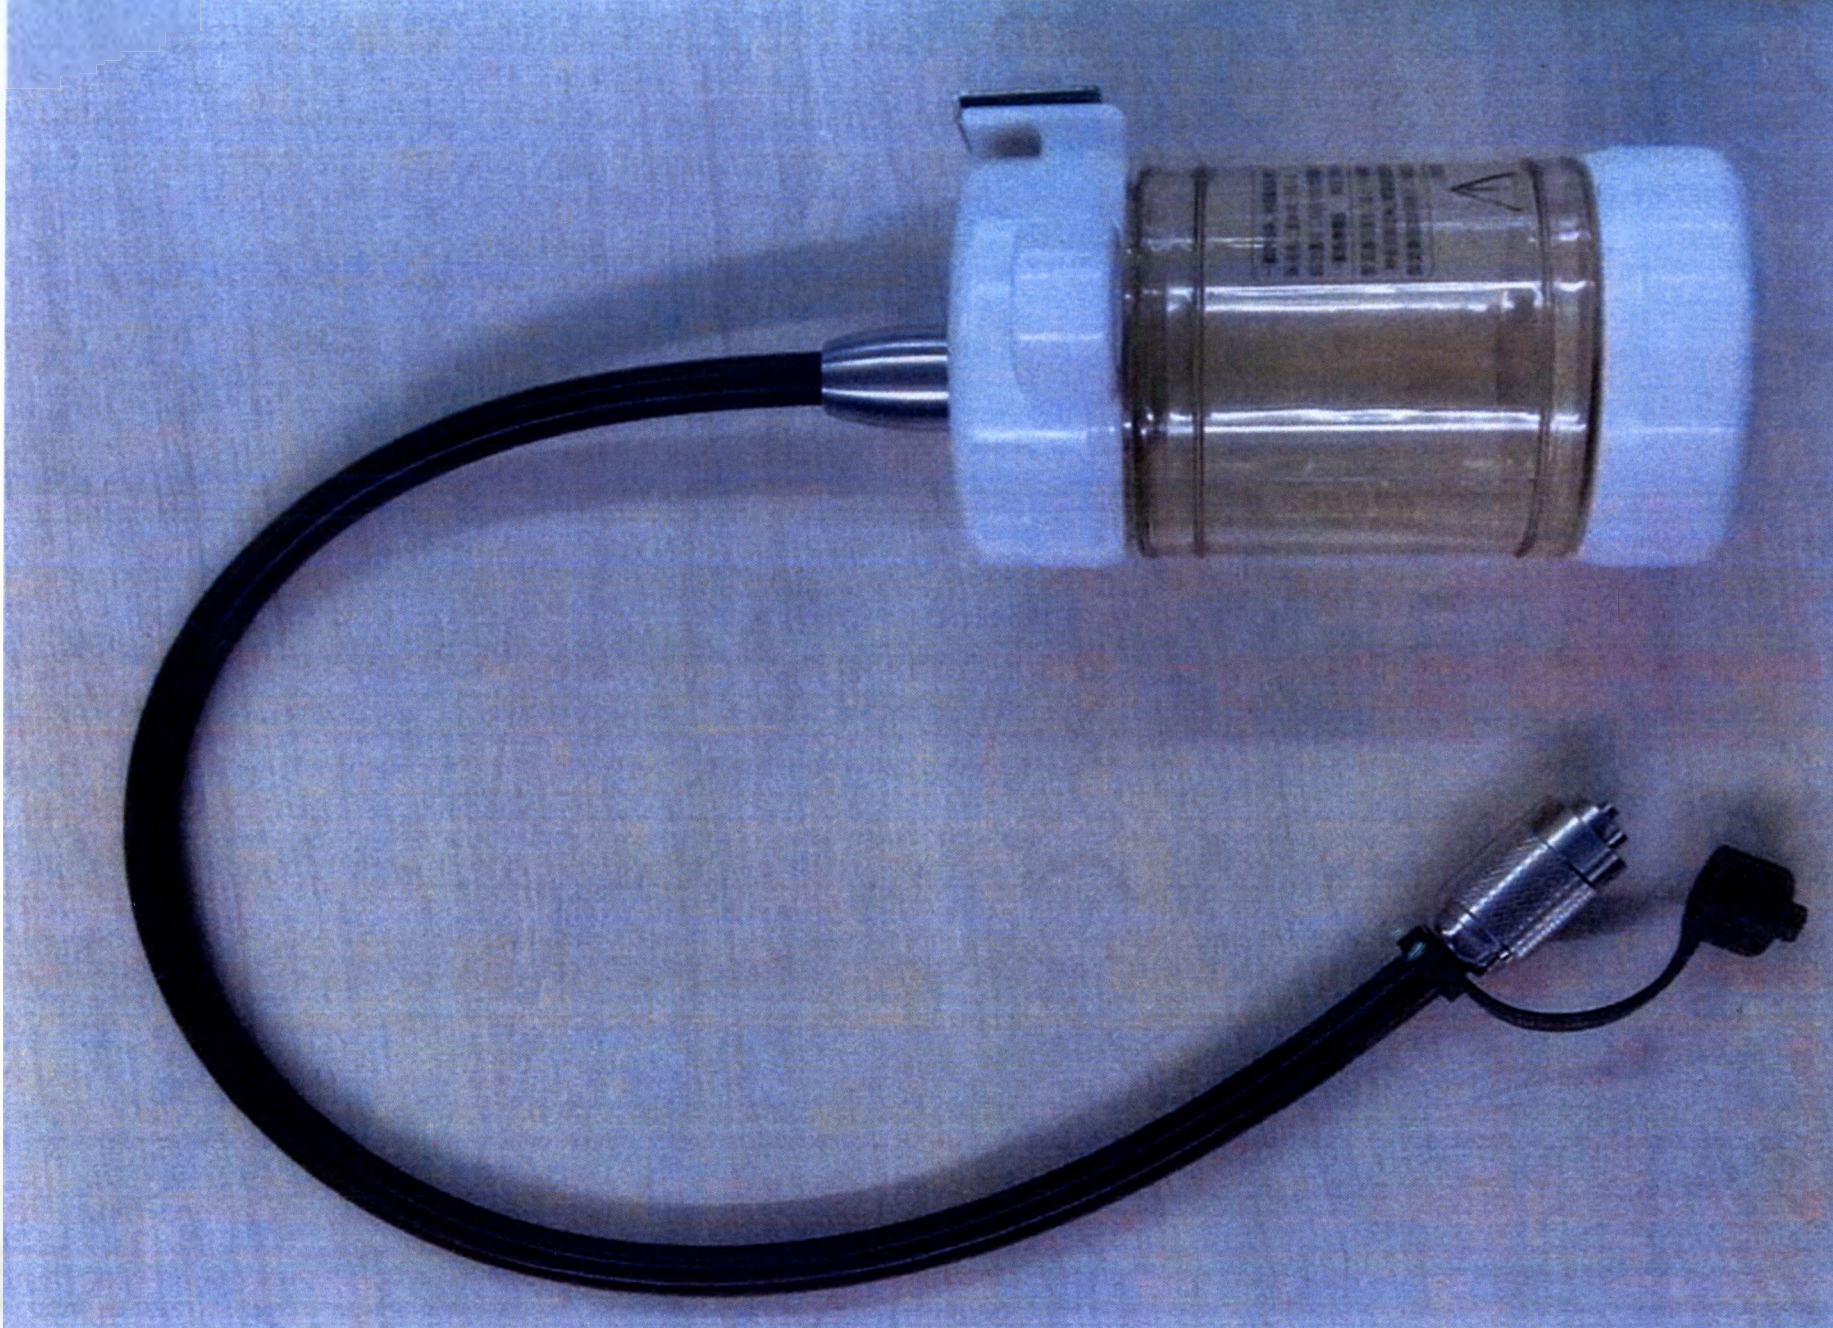

2. Резервуары для воды: WT-4 - не более 5 шт.

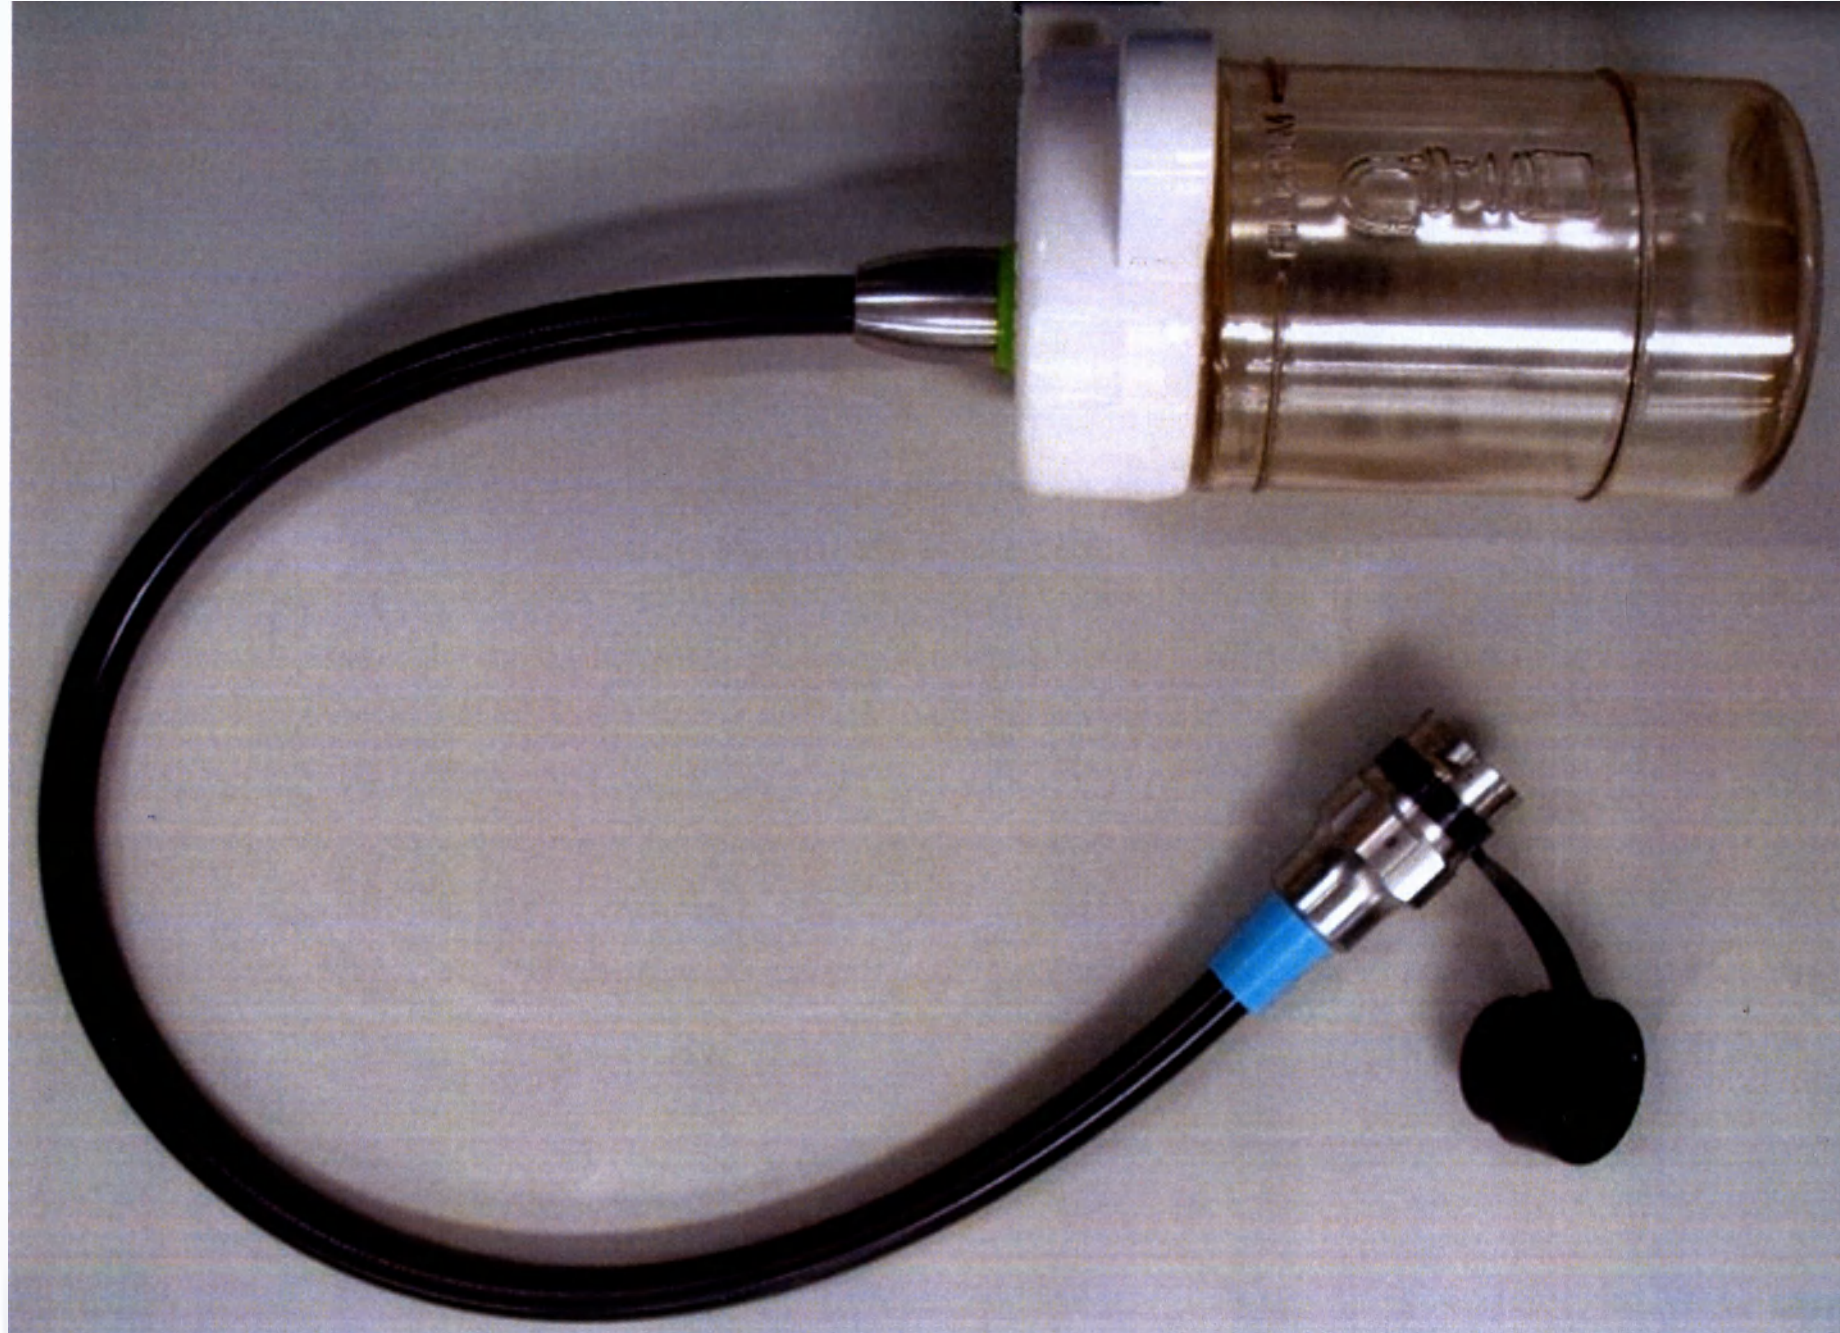

2. Резервуары для воды: WT-603 - не более 5 шт.

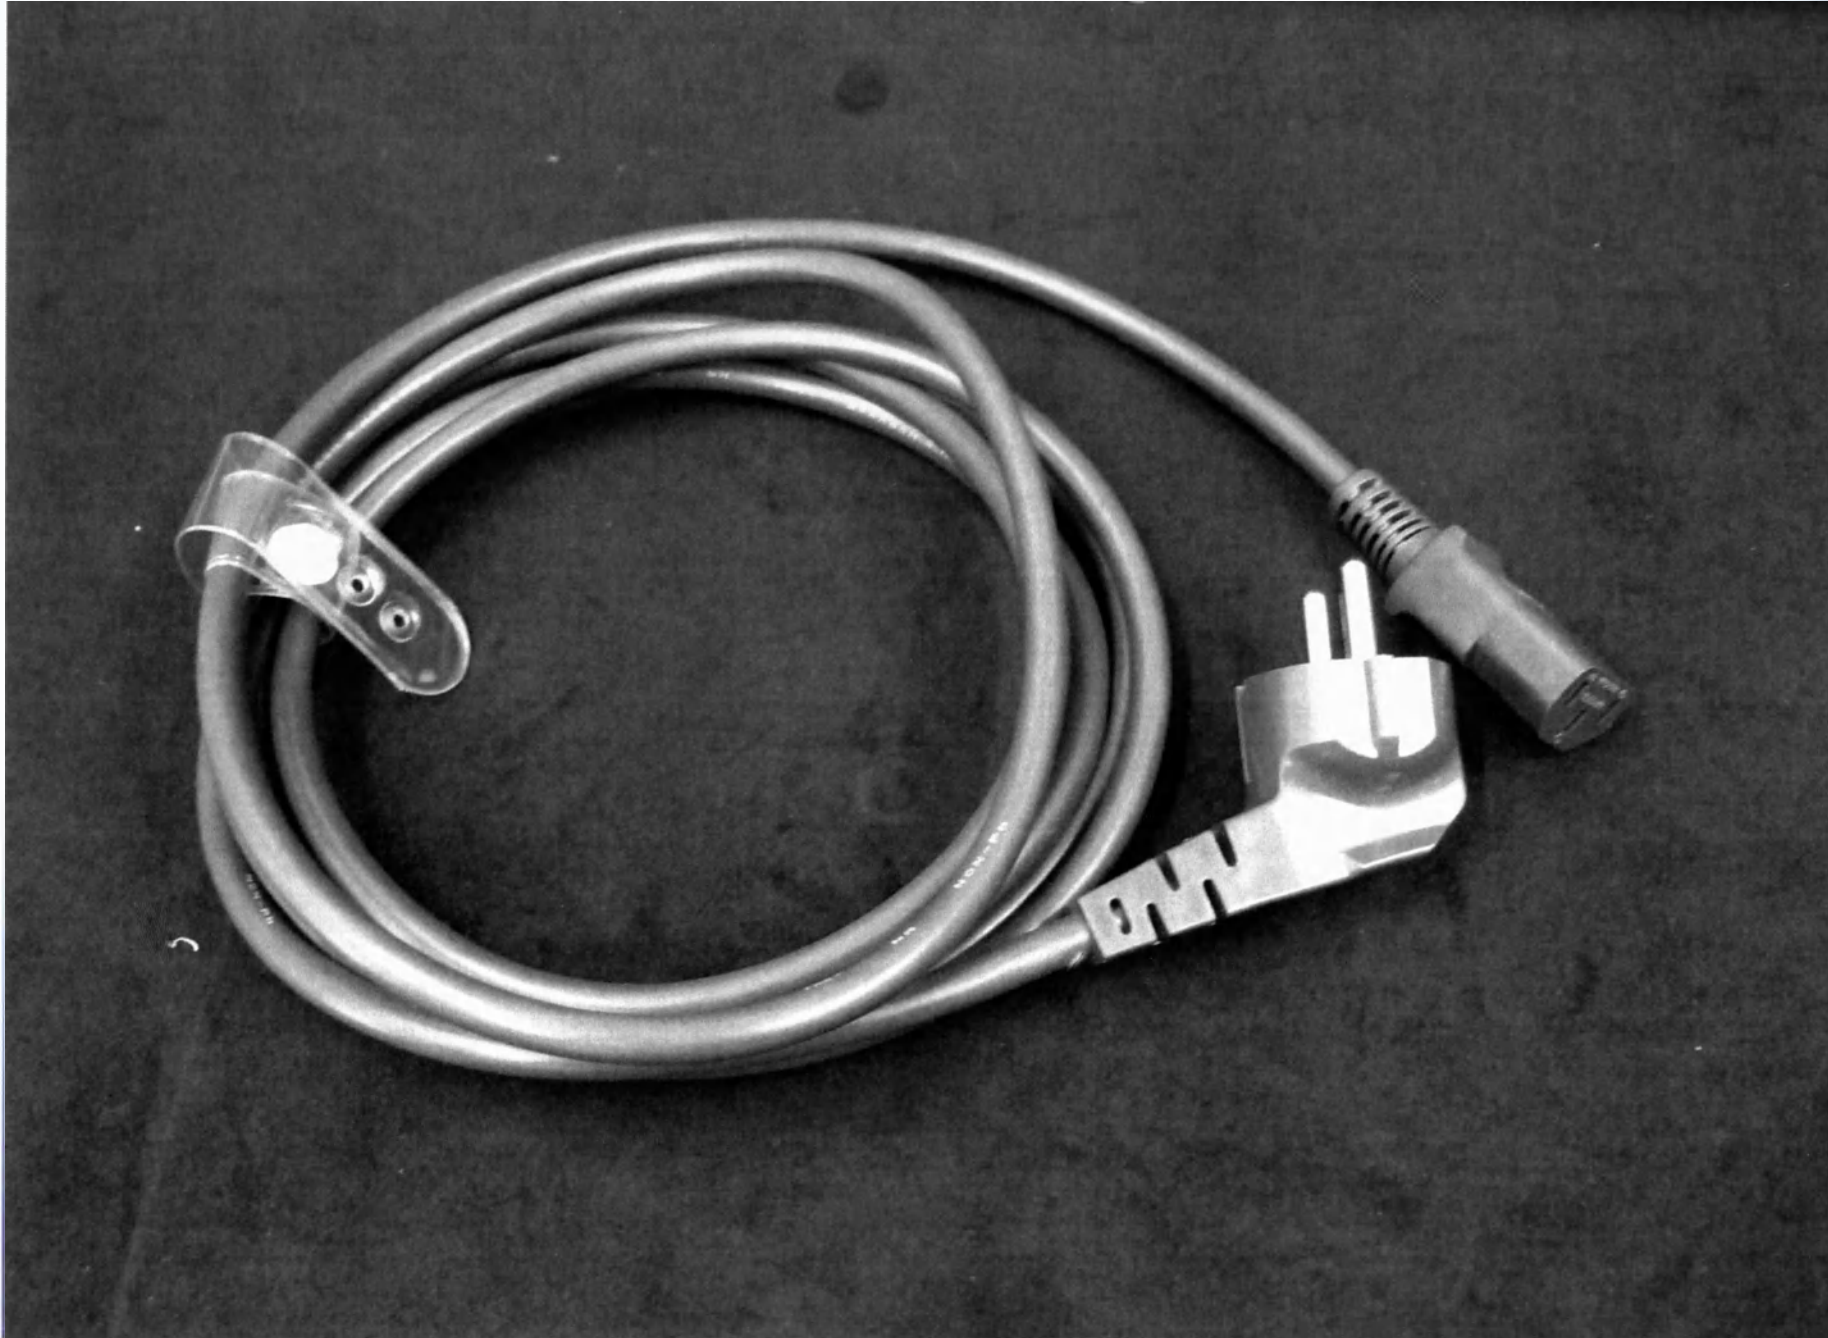

3. Кабель питания.

Русский

FUJIFILM

Источники света эндоскопические с принадлежностями

PS2-HP

PS2-HN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами изделия.



CE / CE 0123
PS2-HN PS2-HP



5. Тестер для проверки герметичности: LT-7 - не более 5шт.



5. Тестер для проверки герметичности: LT-7F - не более 5шт.

