


1

**Фотографические изображения внешнего вида
медицинского изделия:**


Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для
медицинских регистрирующих приборов
по ТУ 17.12.14-004-22261422-2017



Генеральный директор
ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг»
М.П.



подпись

Ковальчук Л.И.

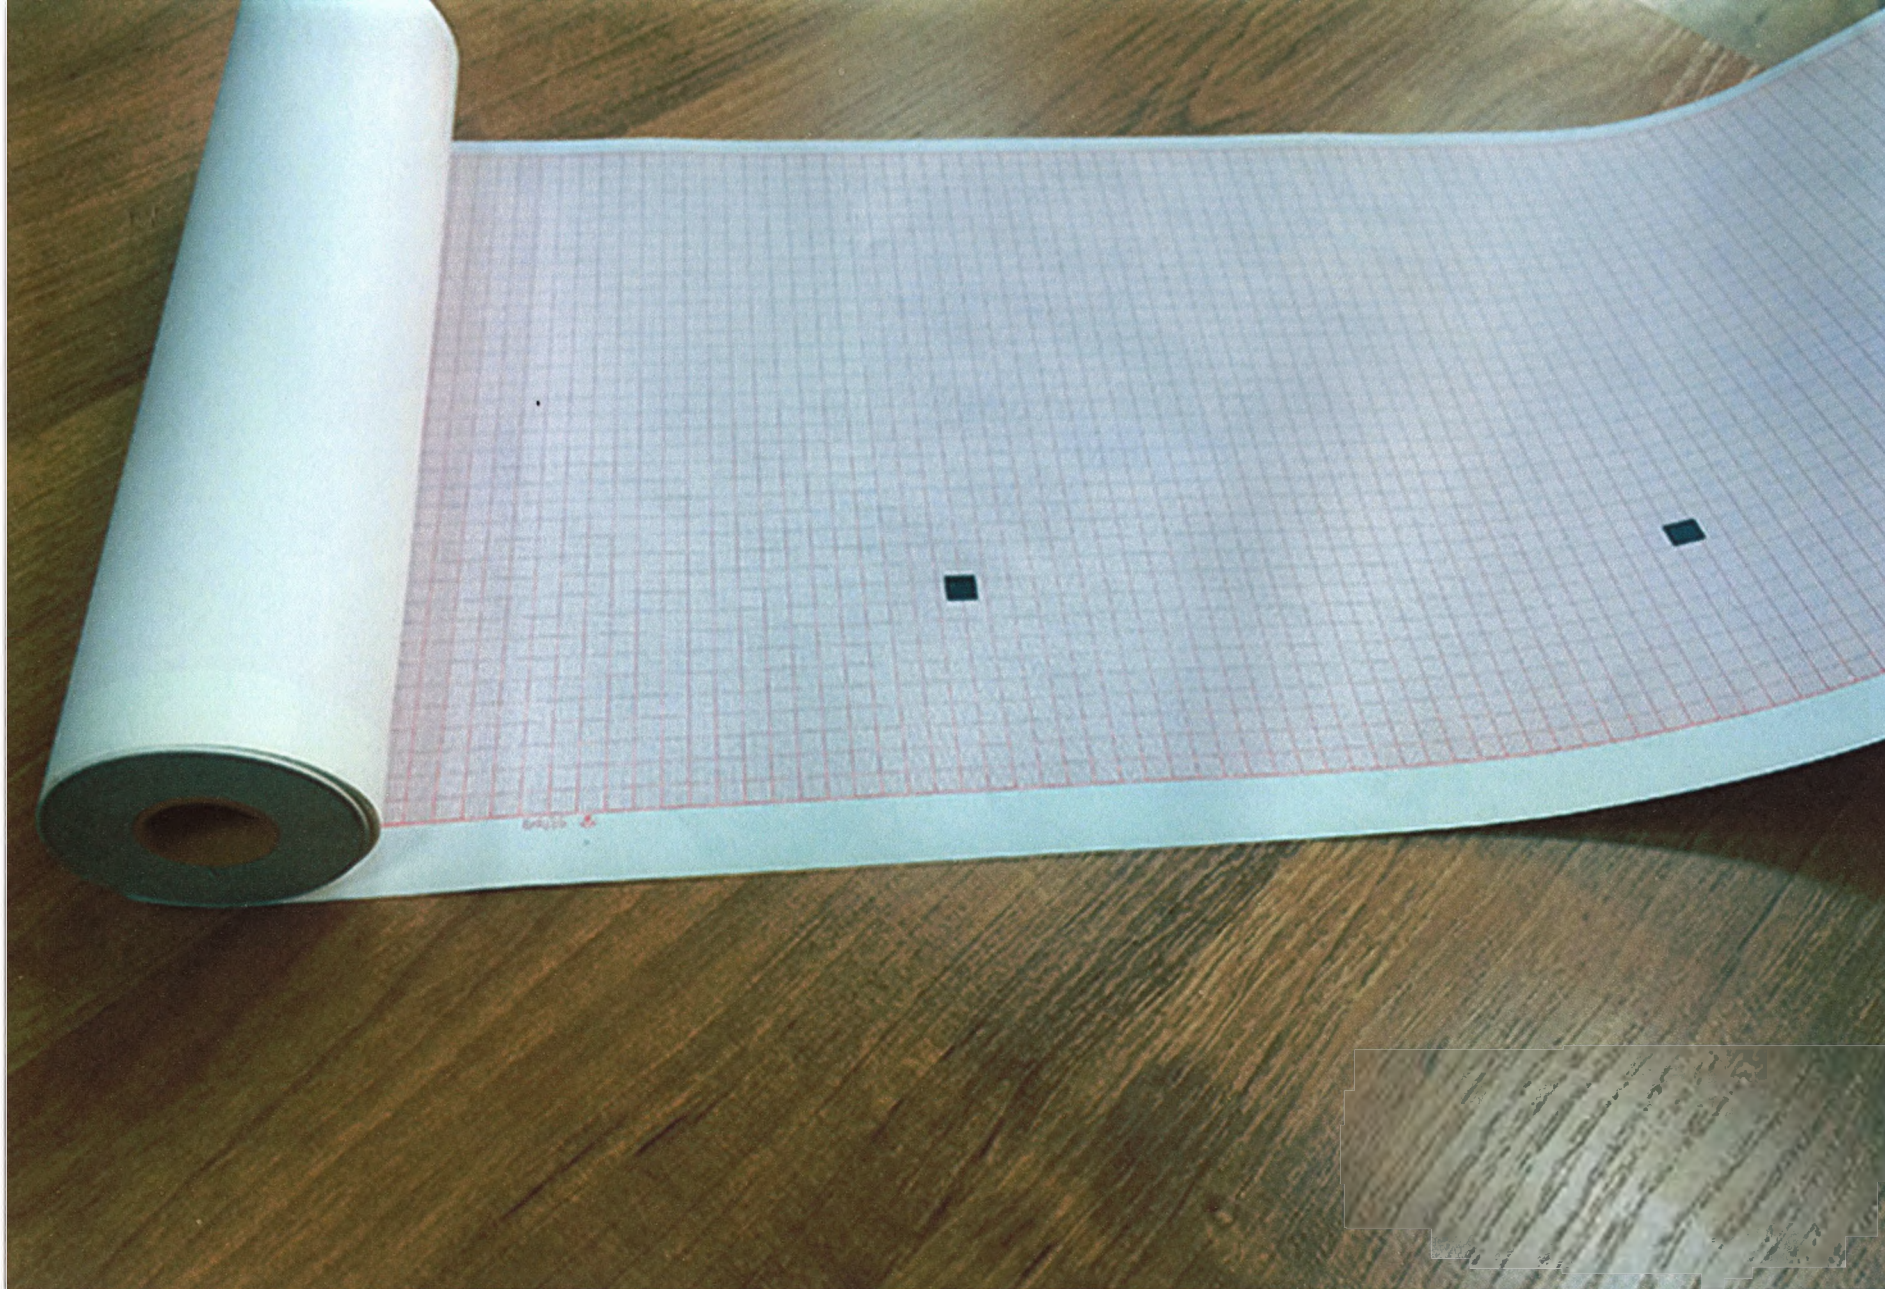


1. Ленты диаграммные в рулонах с нанесением диаграммной сетки,


втулку термослоем внутри рулона с фотометрической меткой

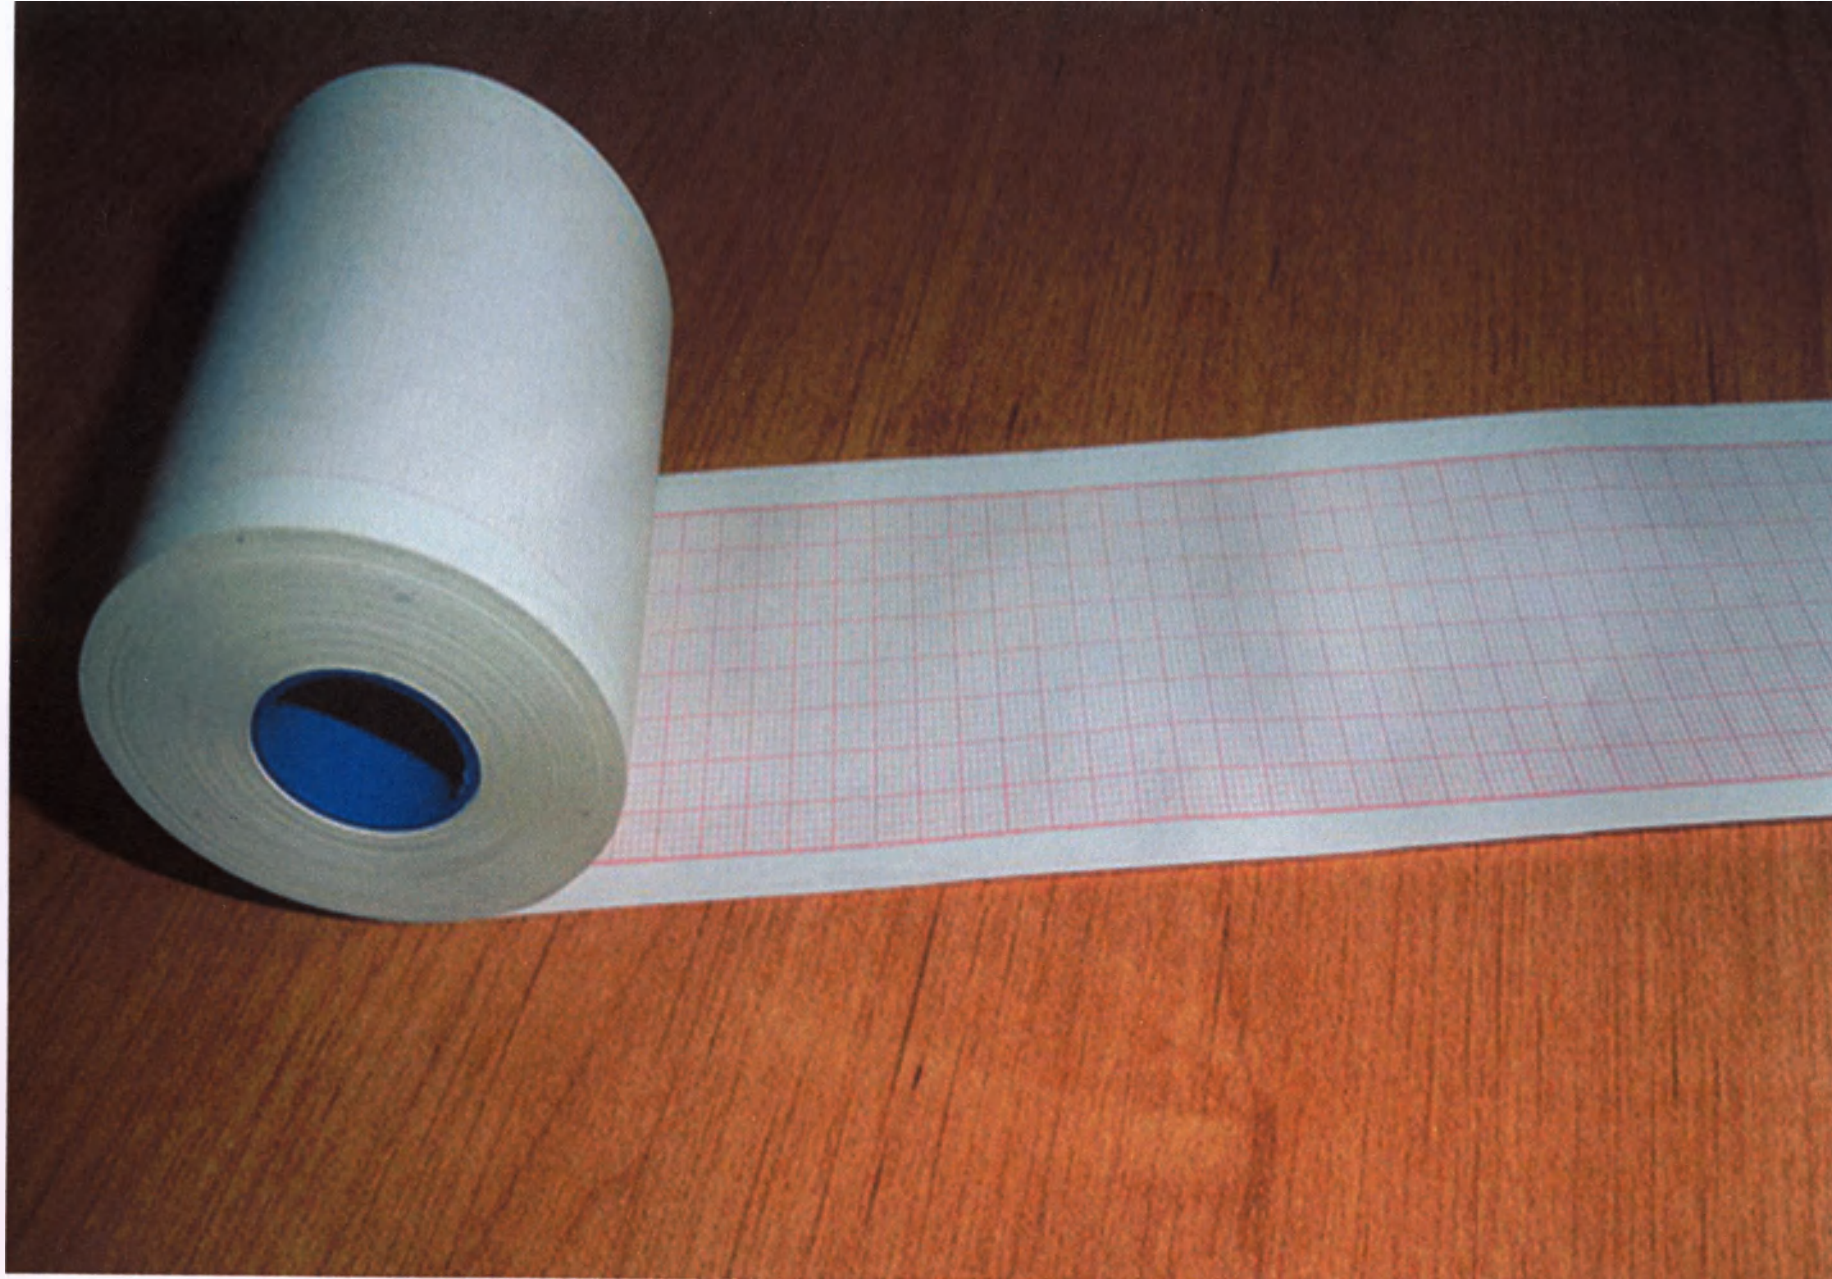

**2. Ленты диаграммные в рулонах с нанесением диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем внутри рулона без фотометрической метки**

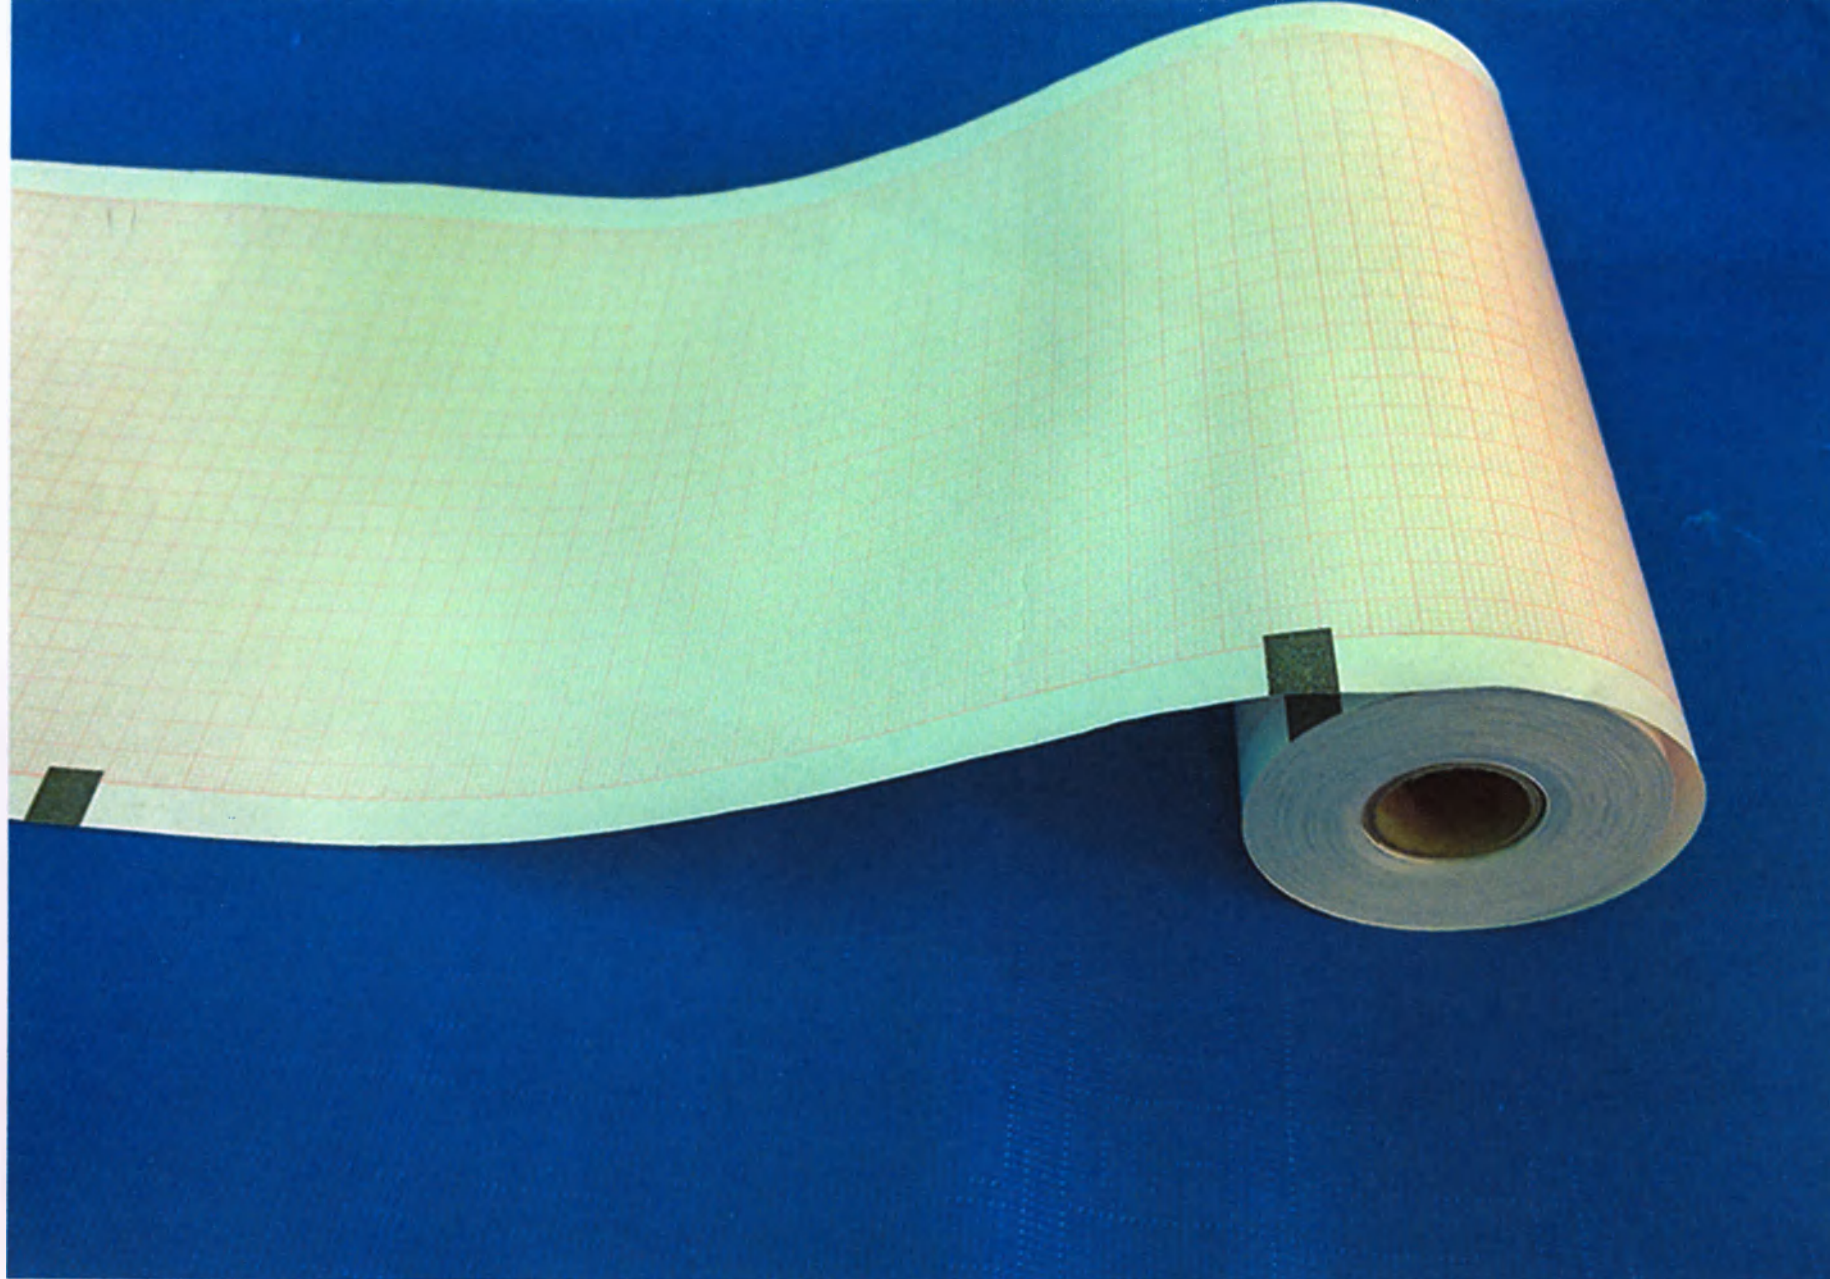


**3. Ленты диаграммные в рулонах с нанесением диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой**

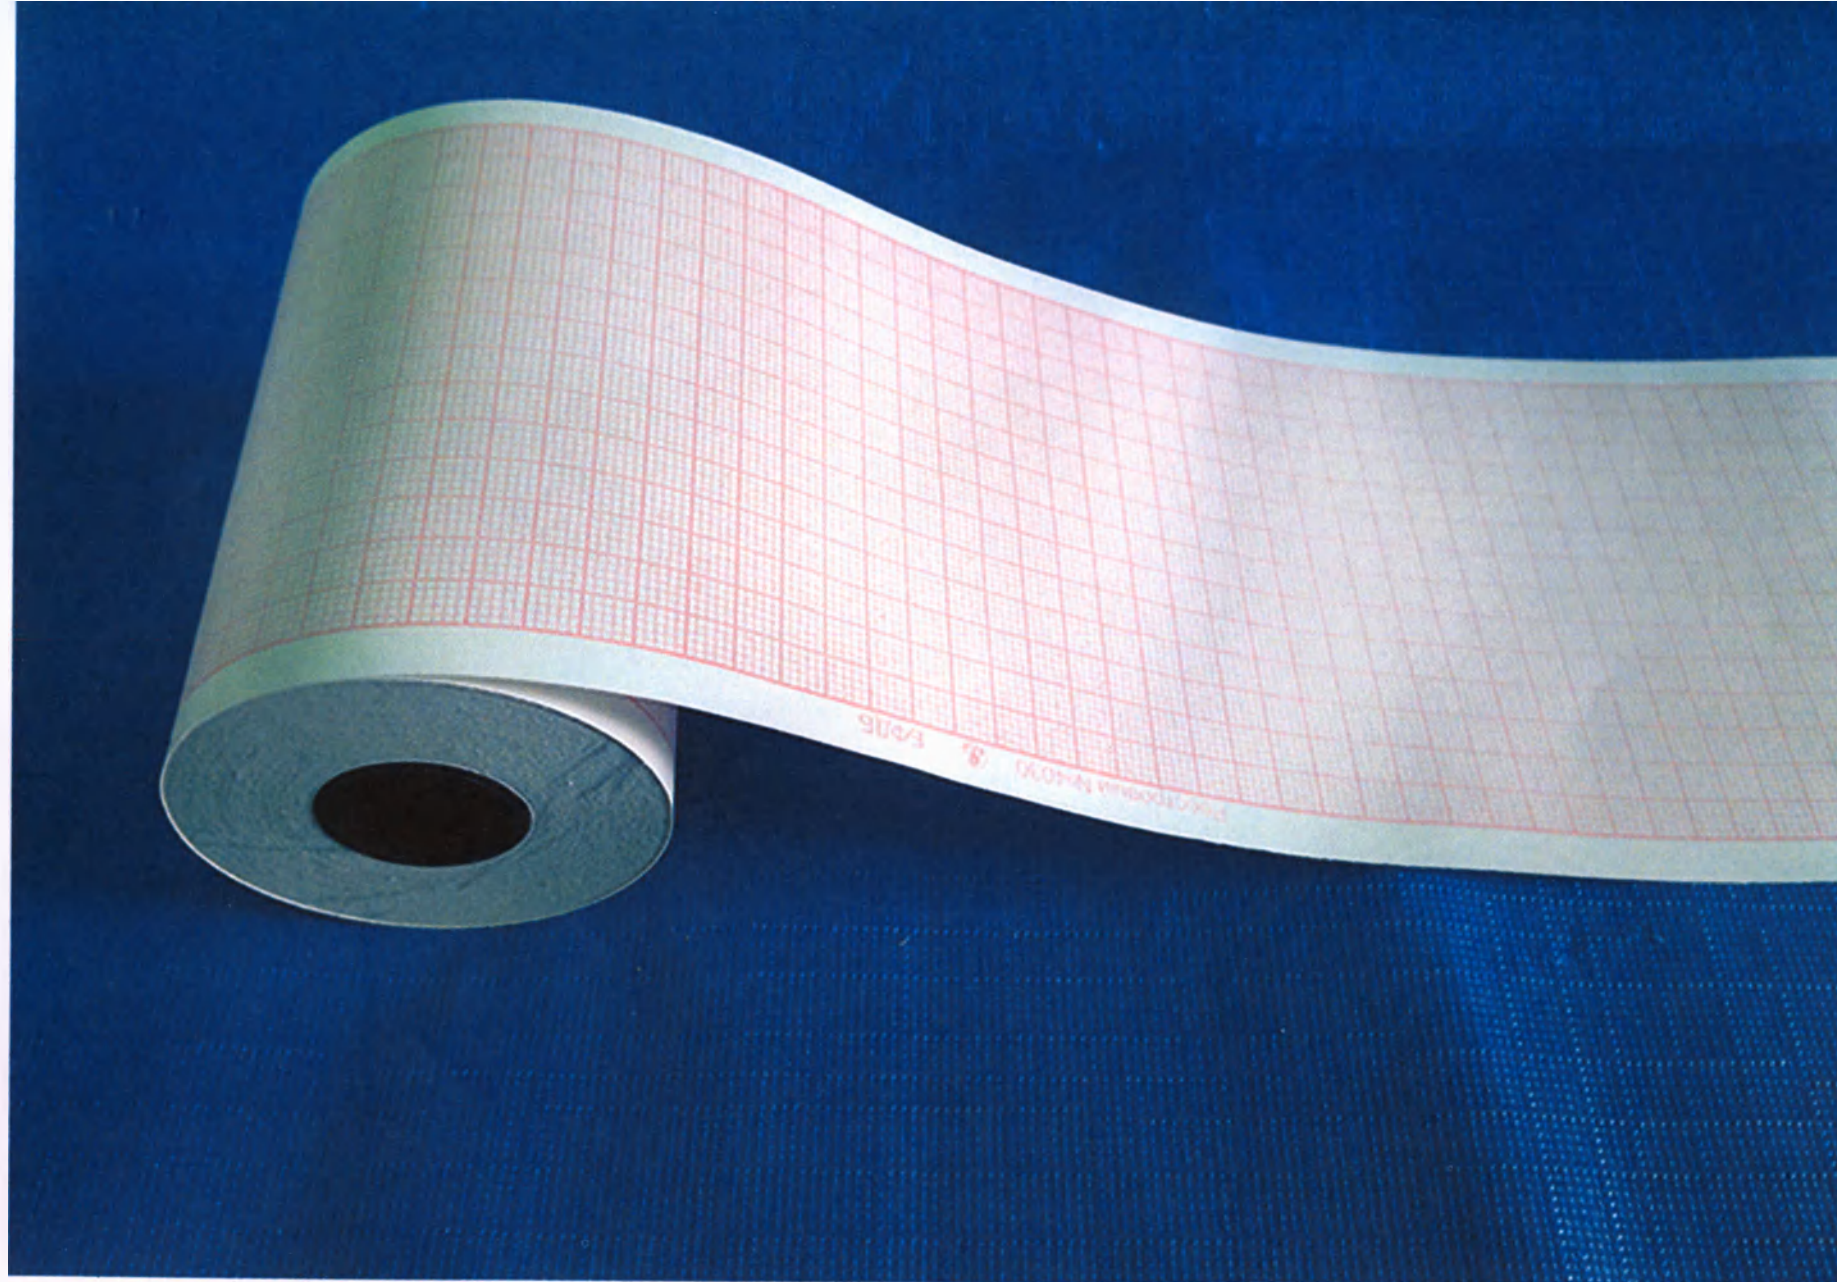


4. Ленты диаграммные в рулонах с нанесением диаграммной сетки,

намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки

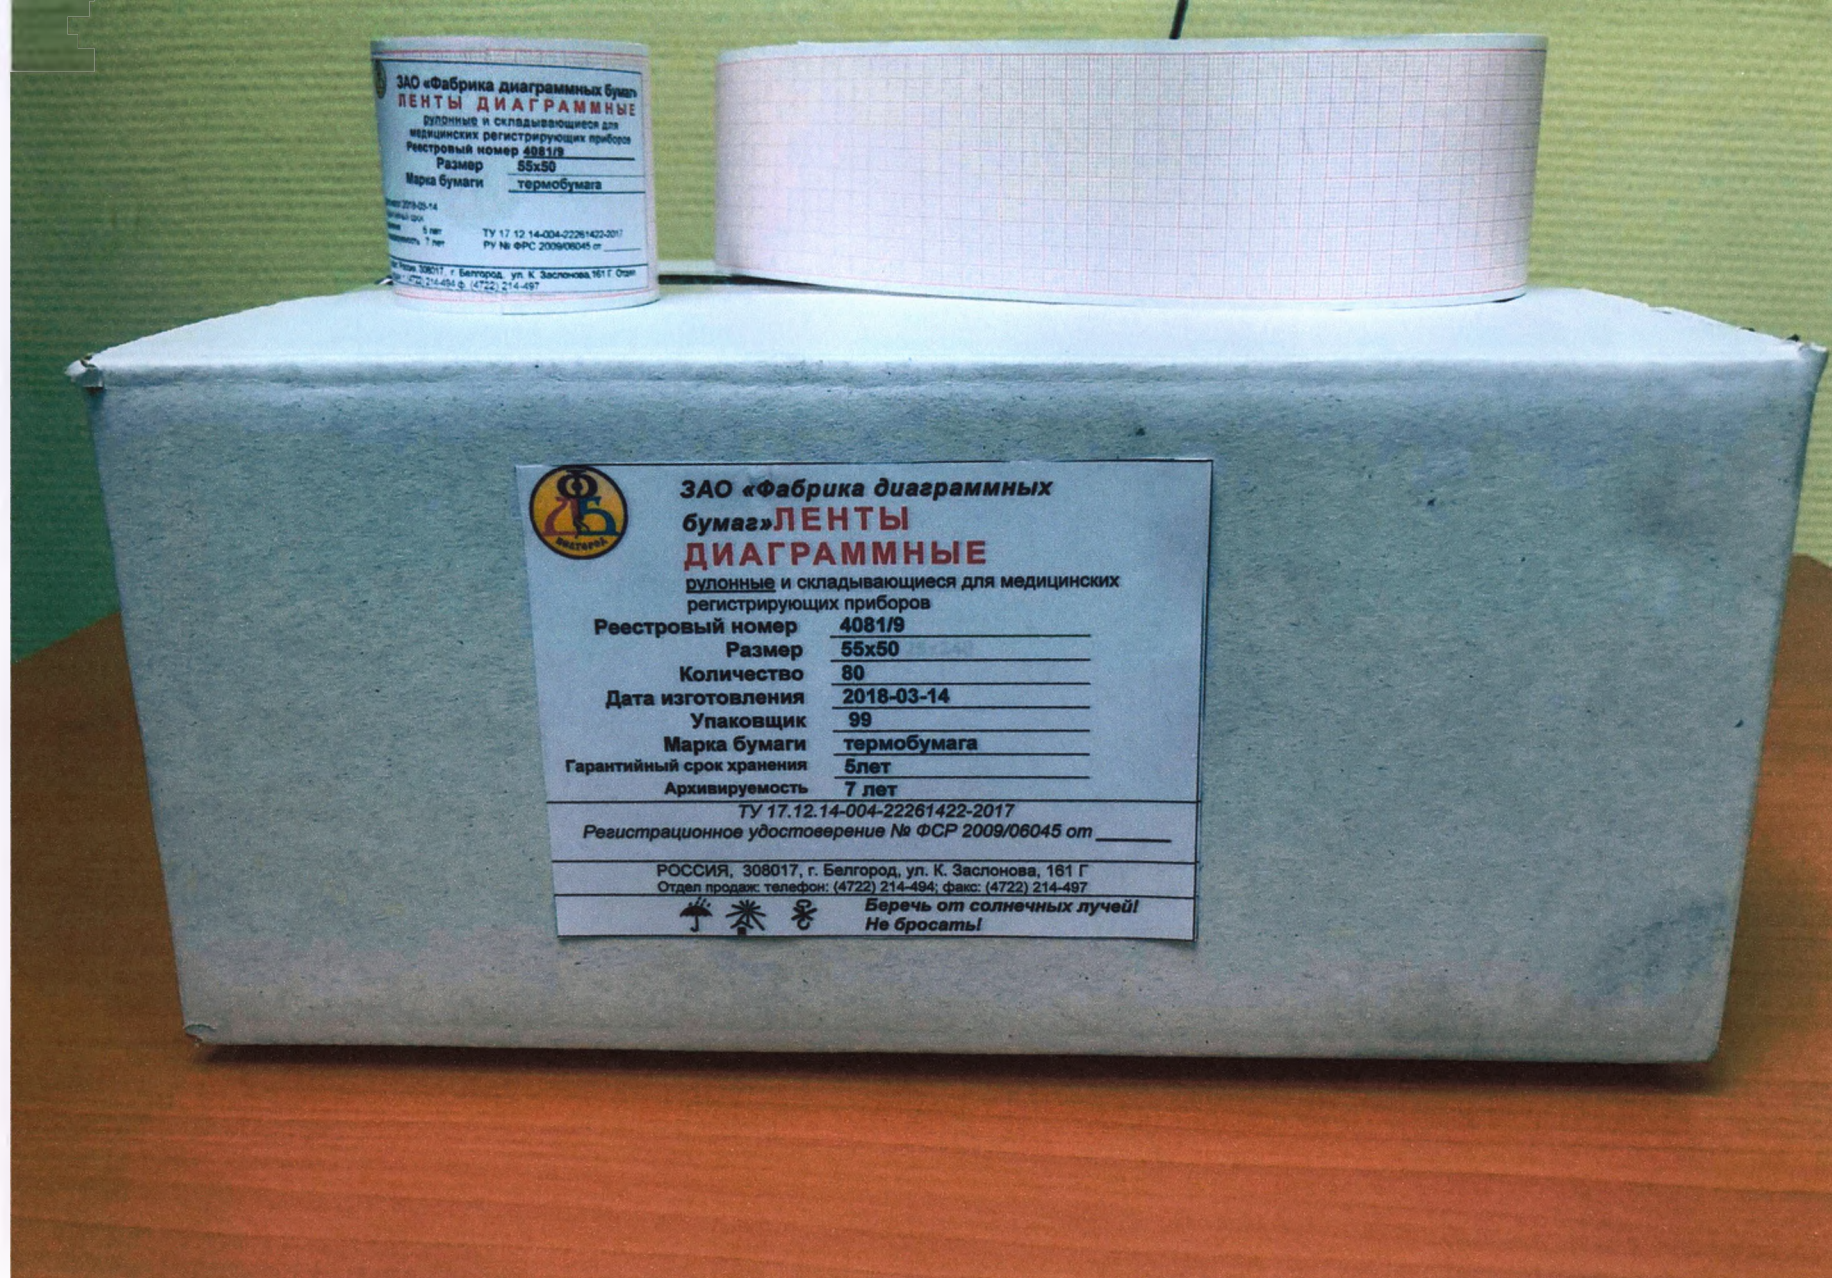

4. Ленты диаграммные в рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на катушку термослоем наружу рулона без фотометрической метки

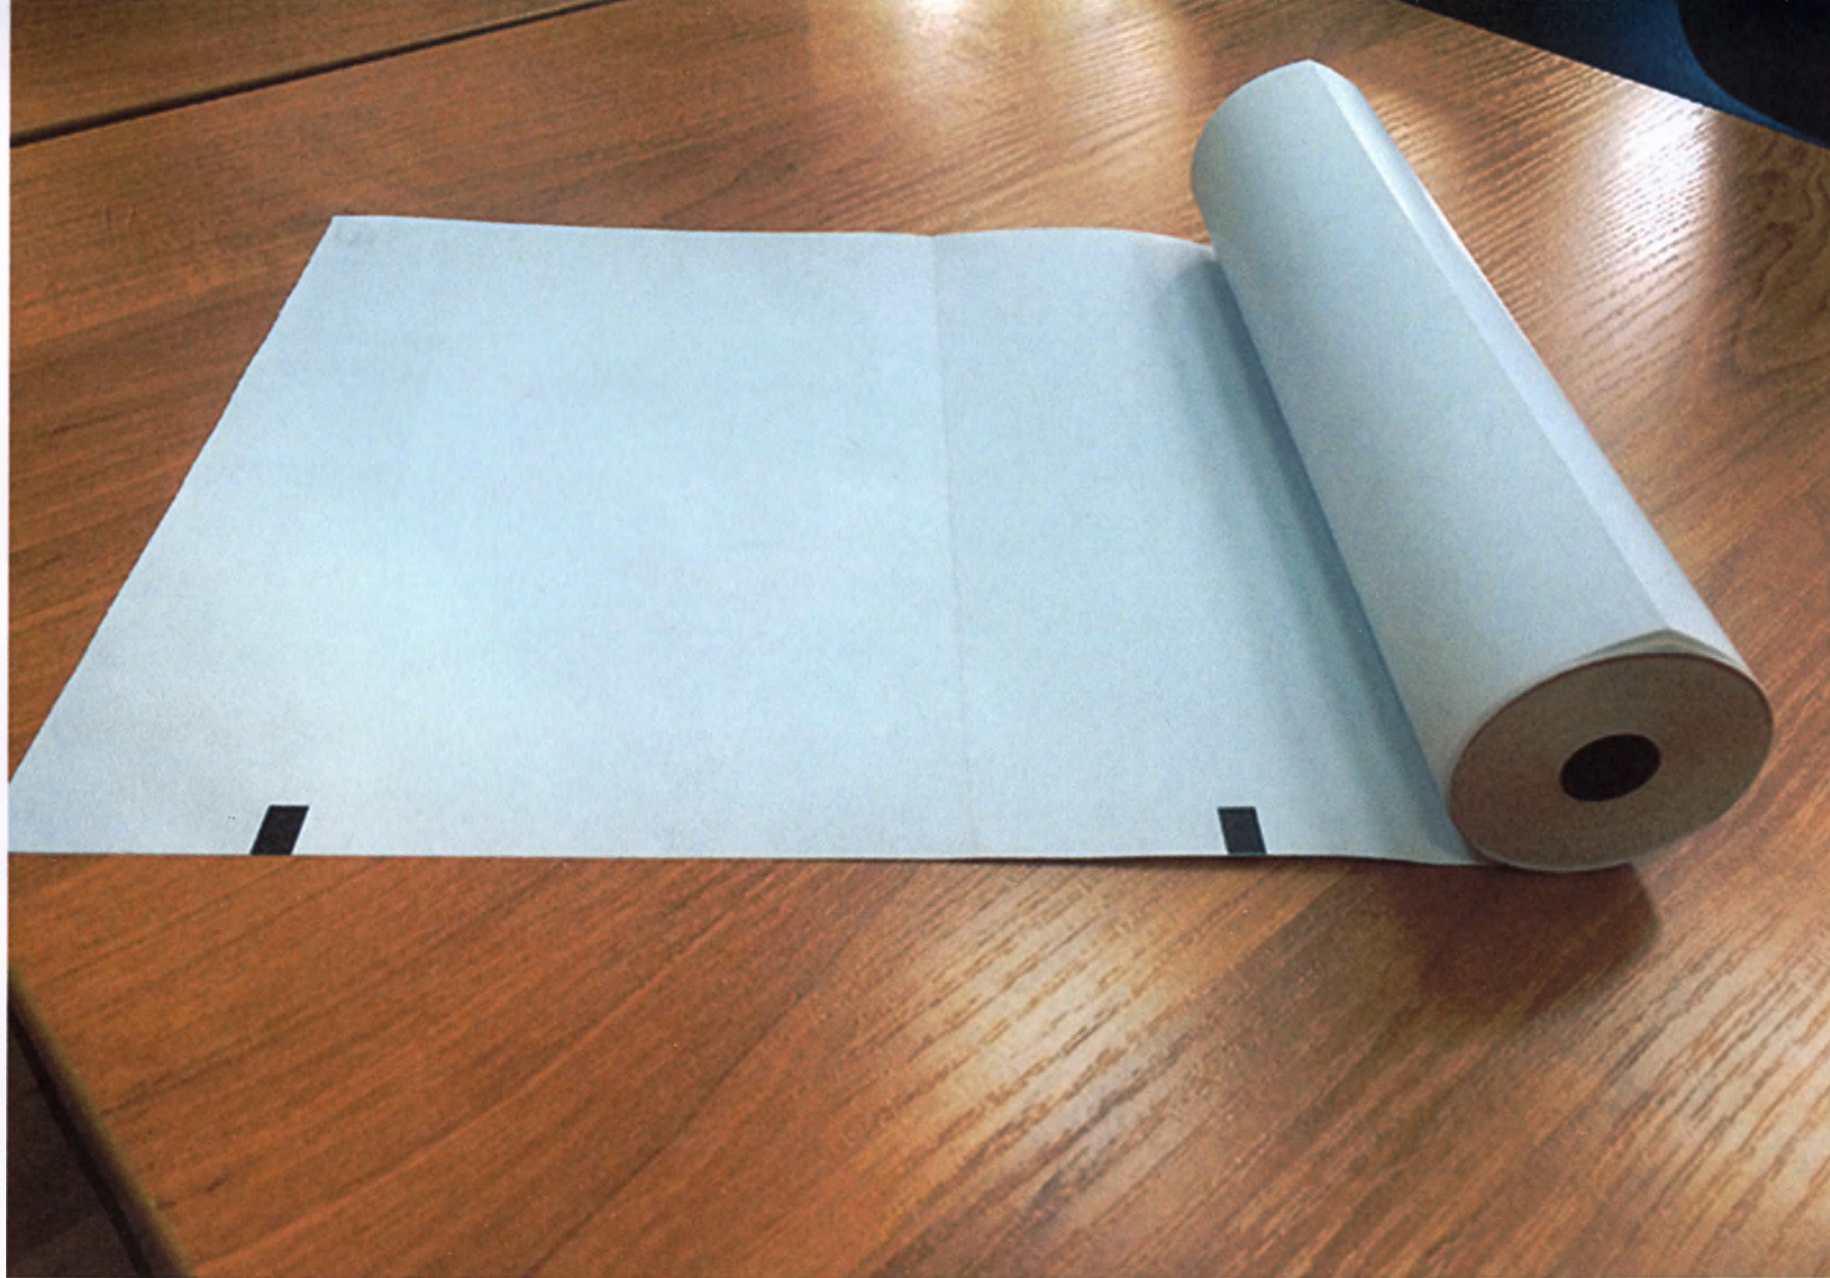


5. Ленты диаграммные в рулонах без диаграммной сетки,


измотка на втулку термослоем внутри рулона с фотометрической меткой




**6. Ленты диаграммные в рулонах без диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем внутри рулона без фотометрической метки**

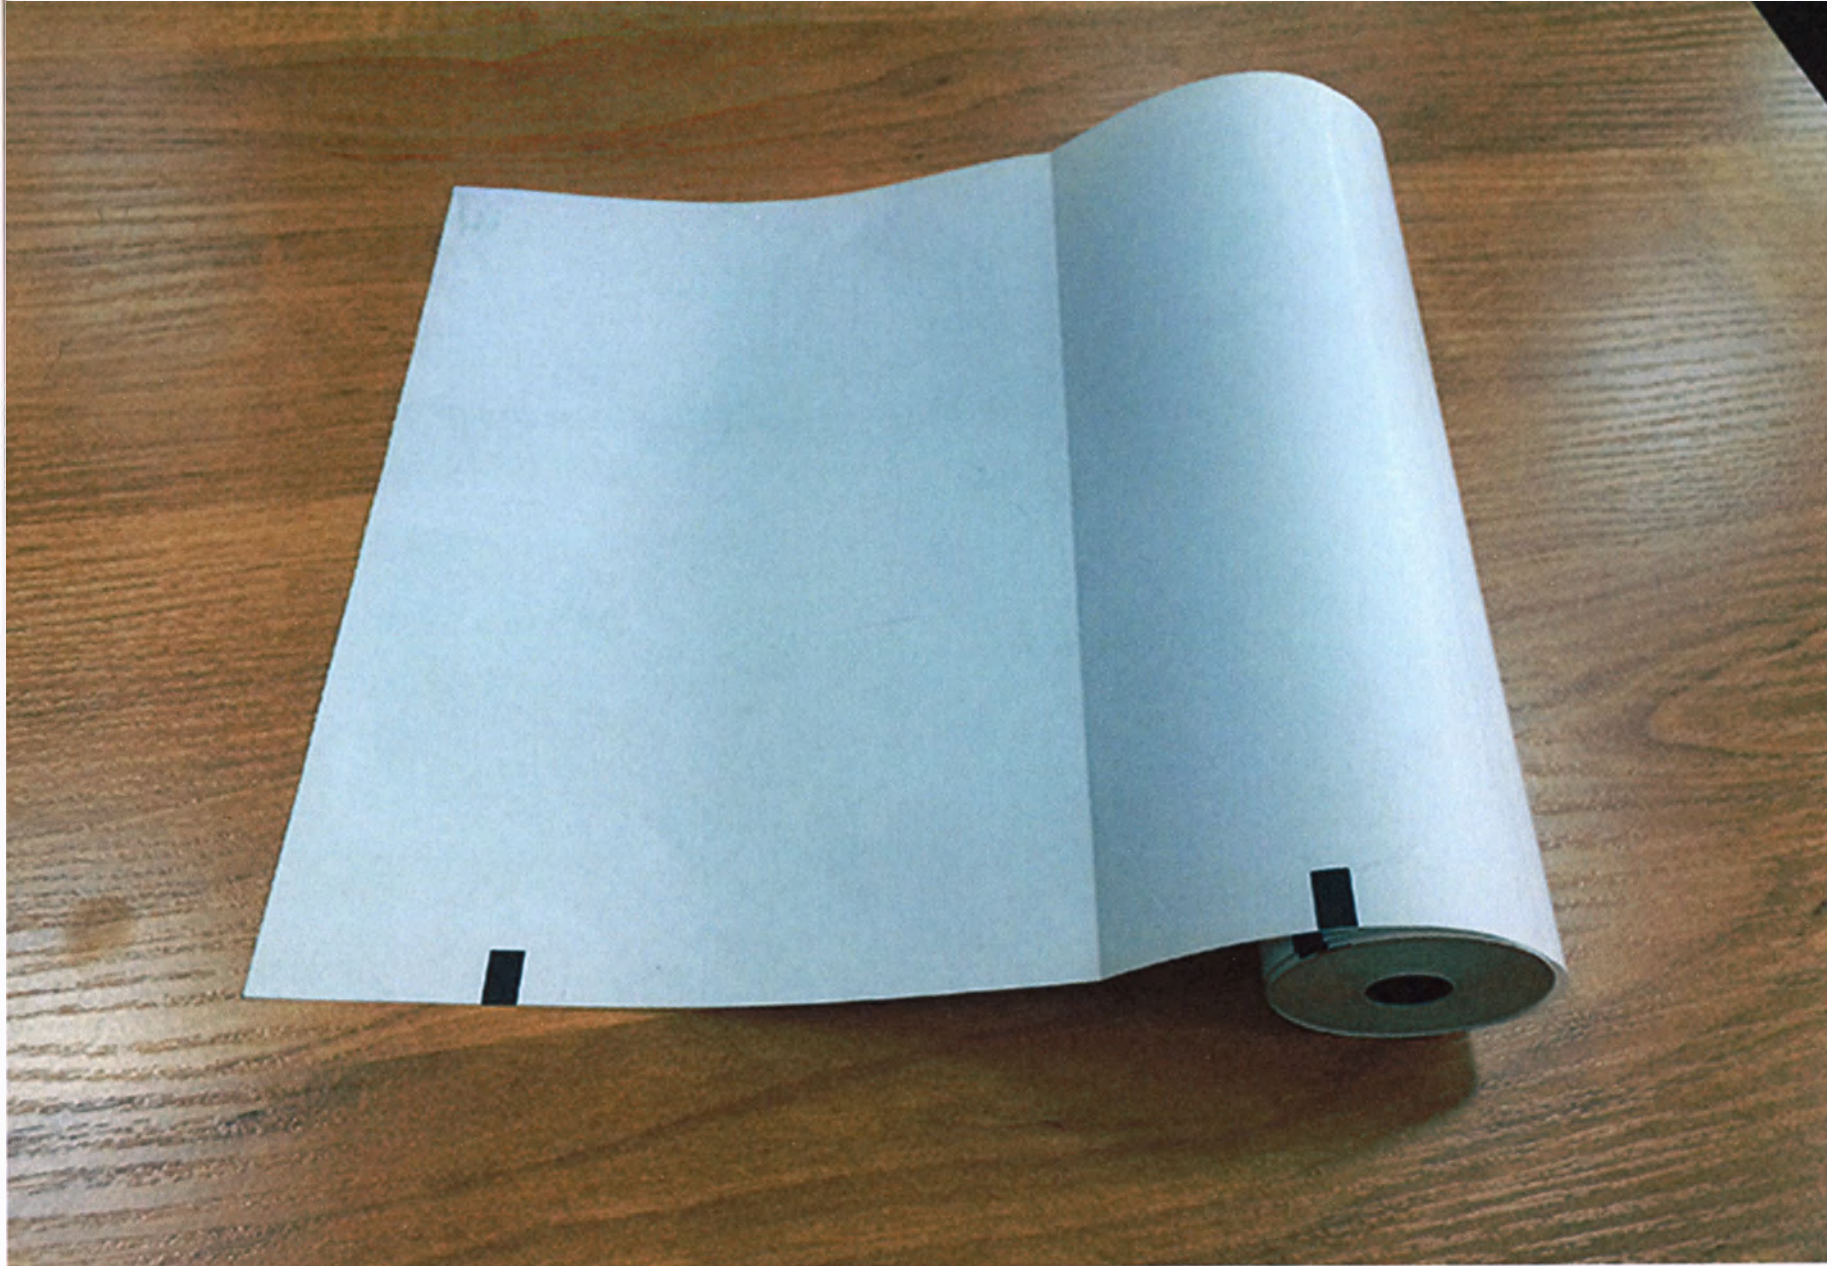


**7. Ленты диаграммные в рулонах без диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой**

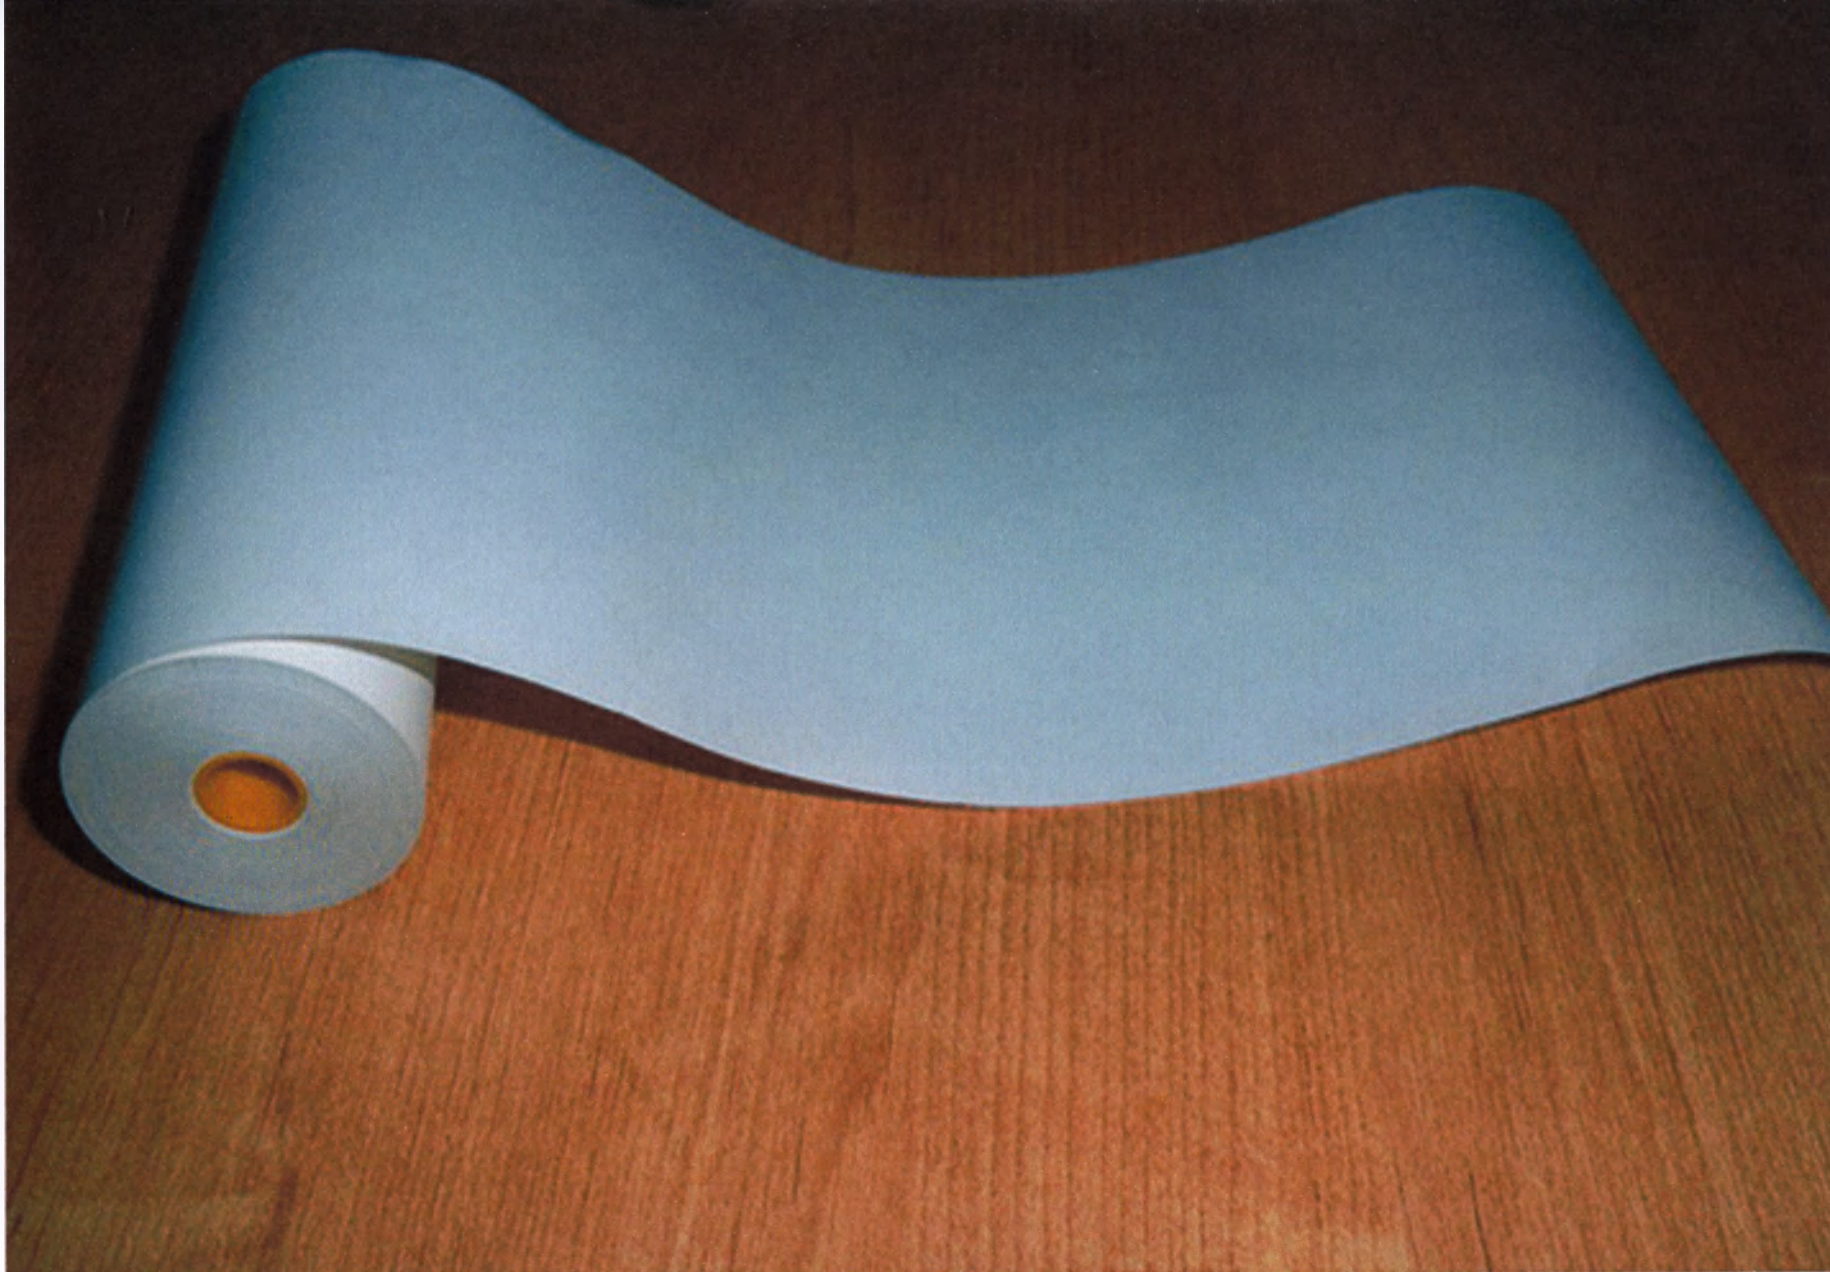


**8. Ленты диаграммные в рулонах без диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки**

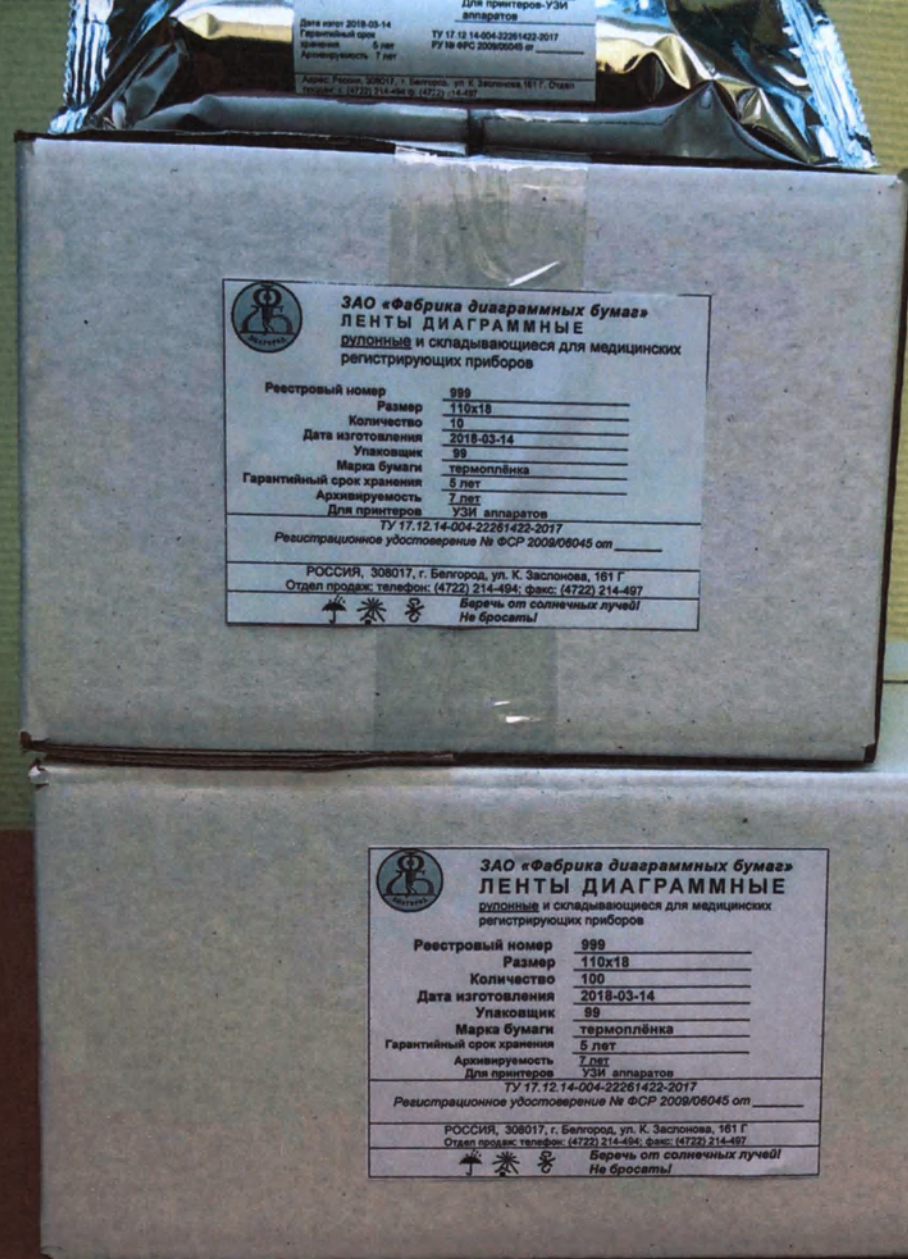


8. Ленты диаграммные в рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки

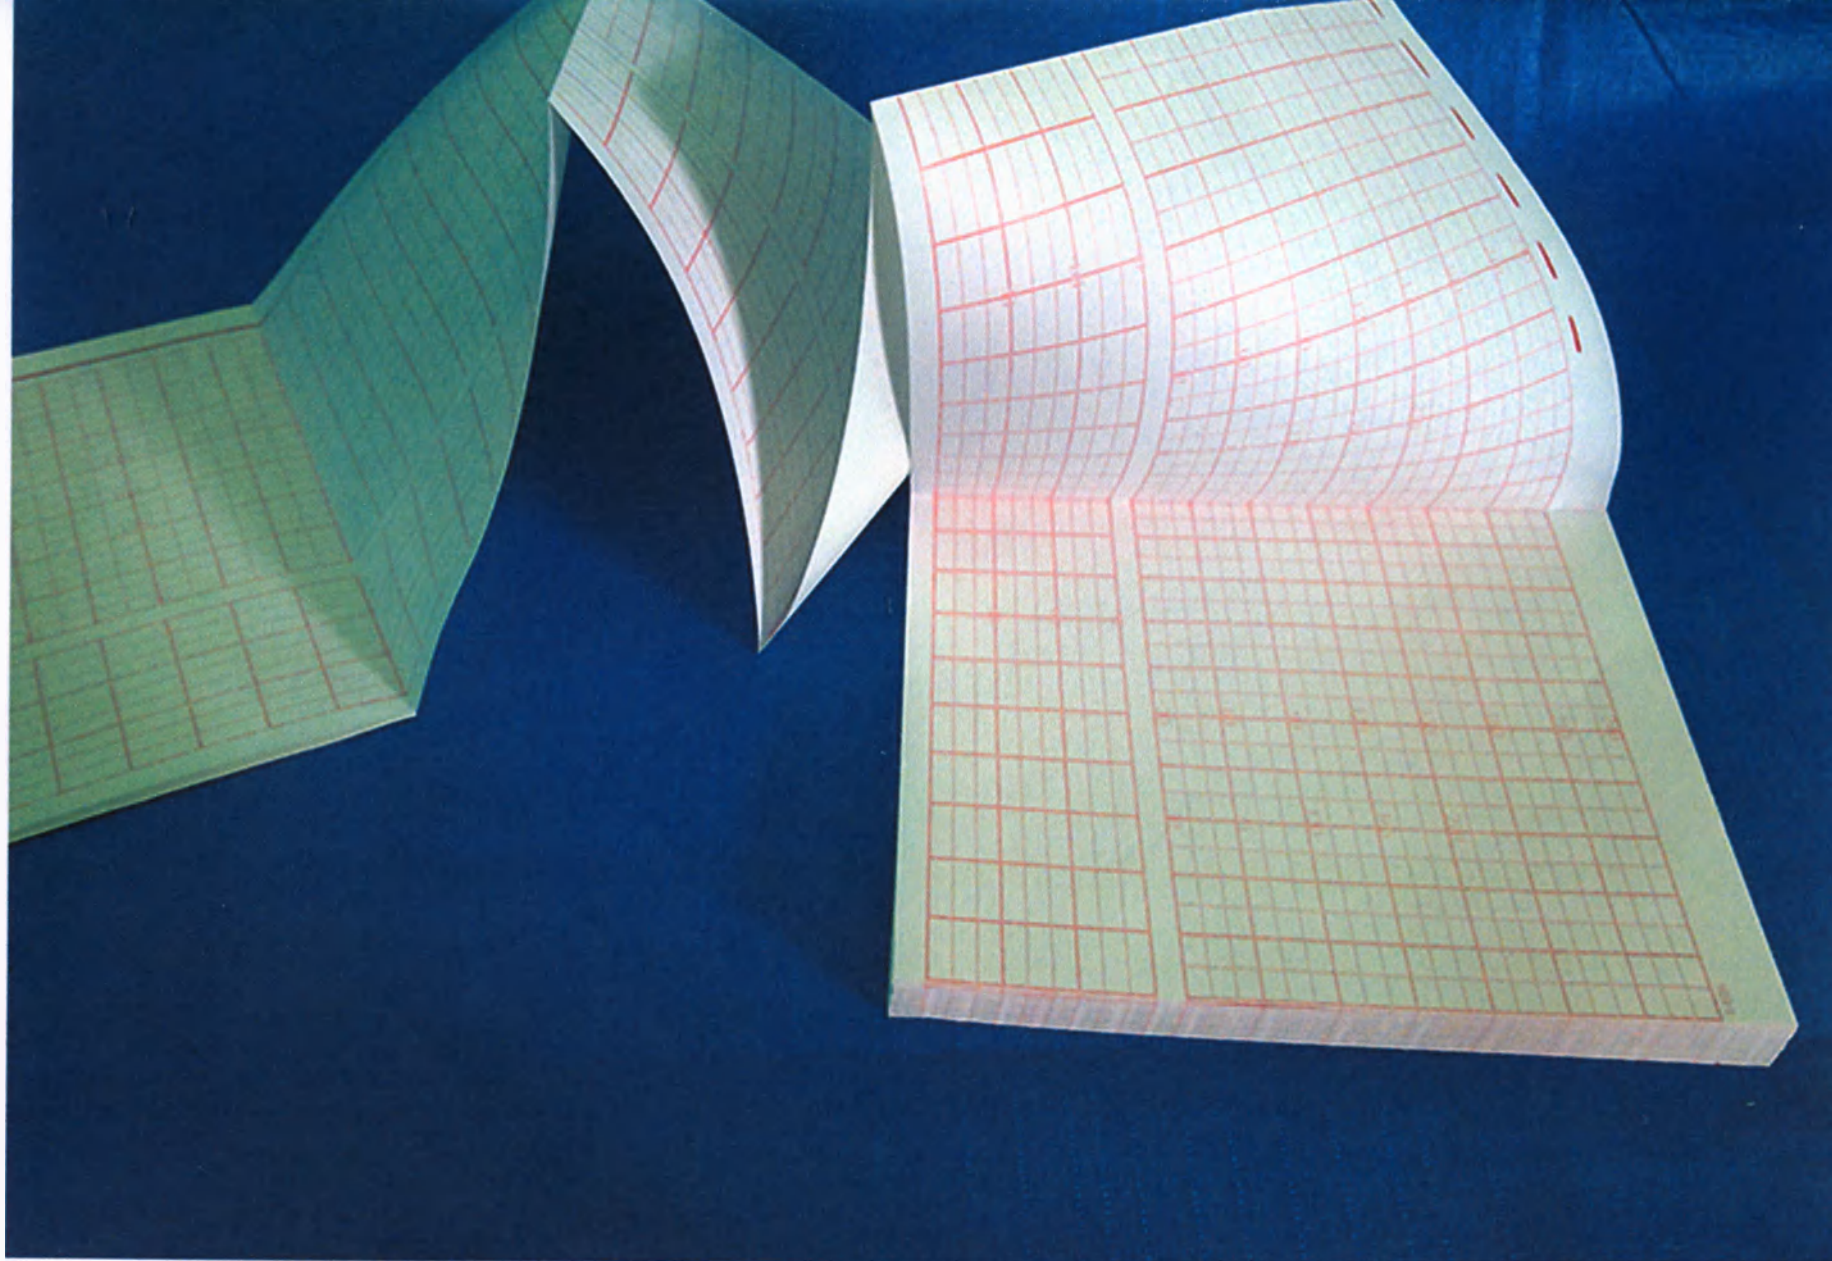


9. Ленты диаграммные складывающиеся с нанесением диаграммной сетки

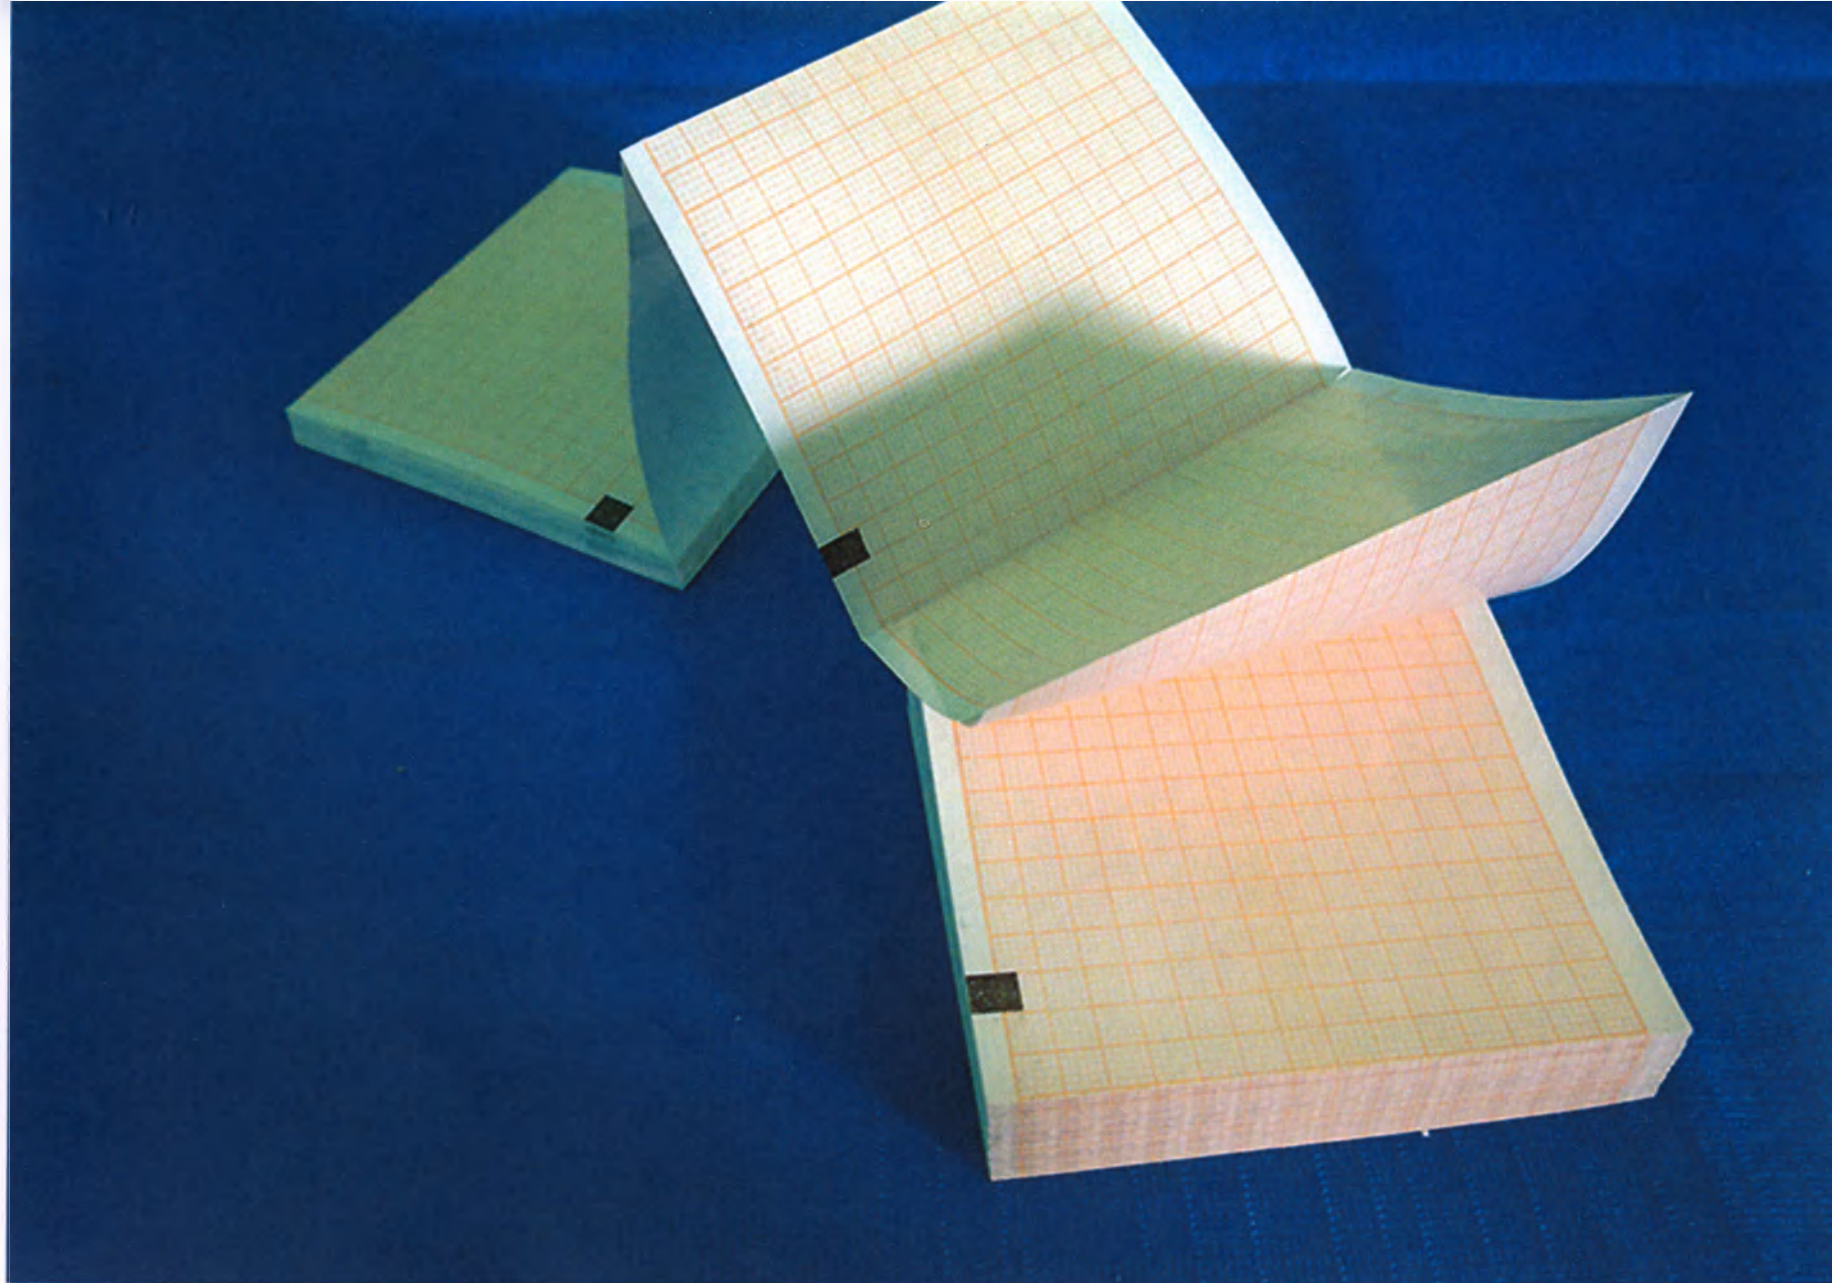


**10. Ленты диаграммные складывающиеся с нанесением
диаграммной сетки с фотометрической меткой**

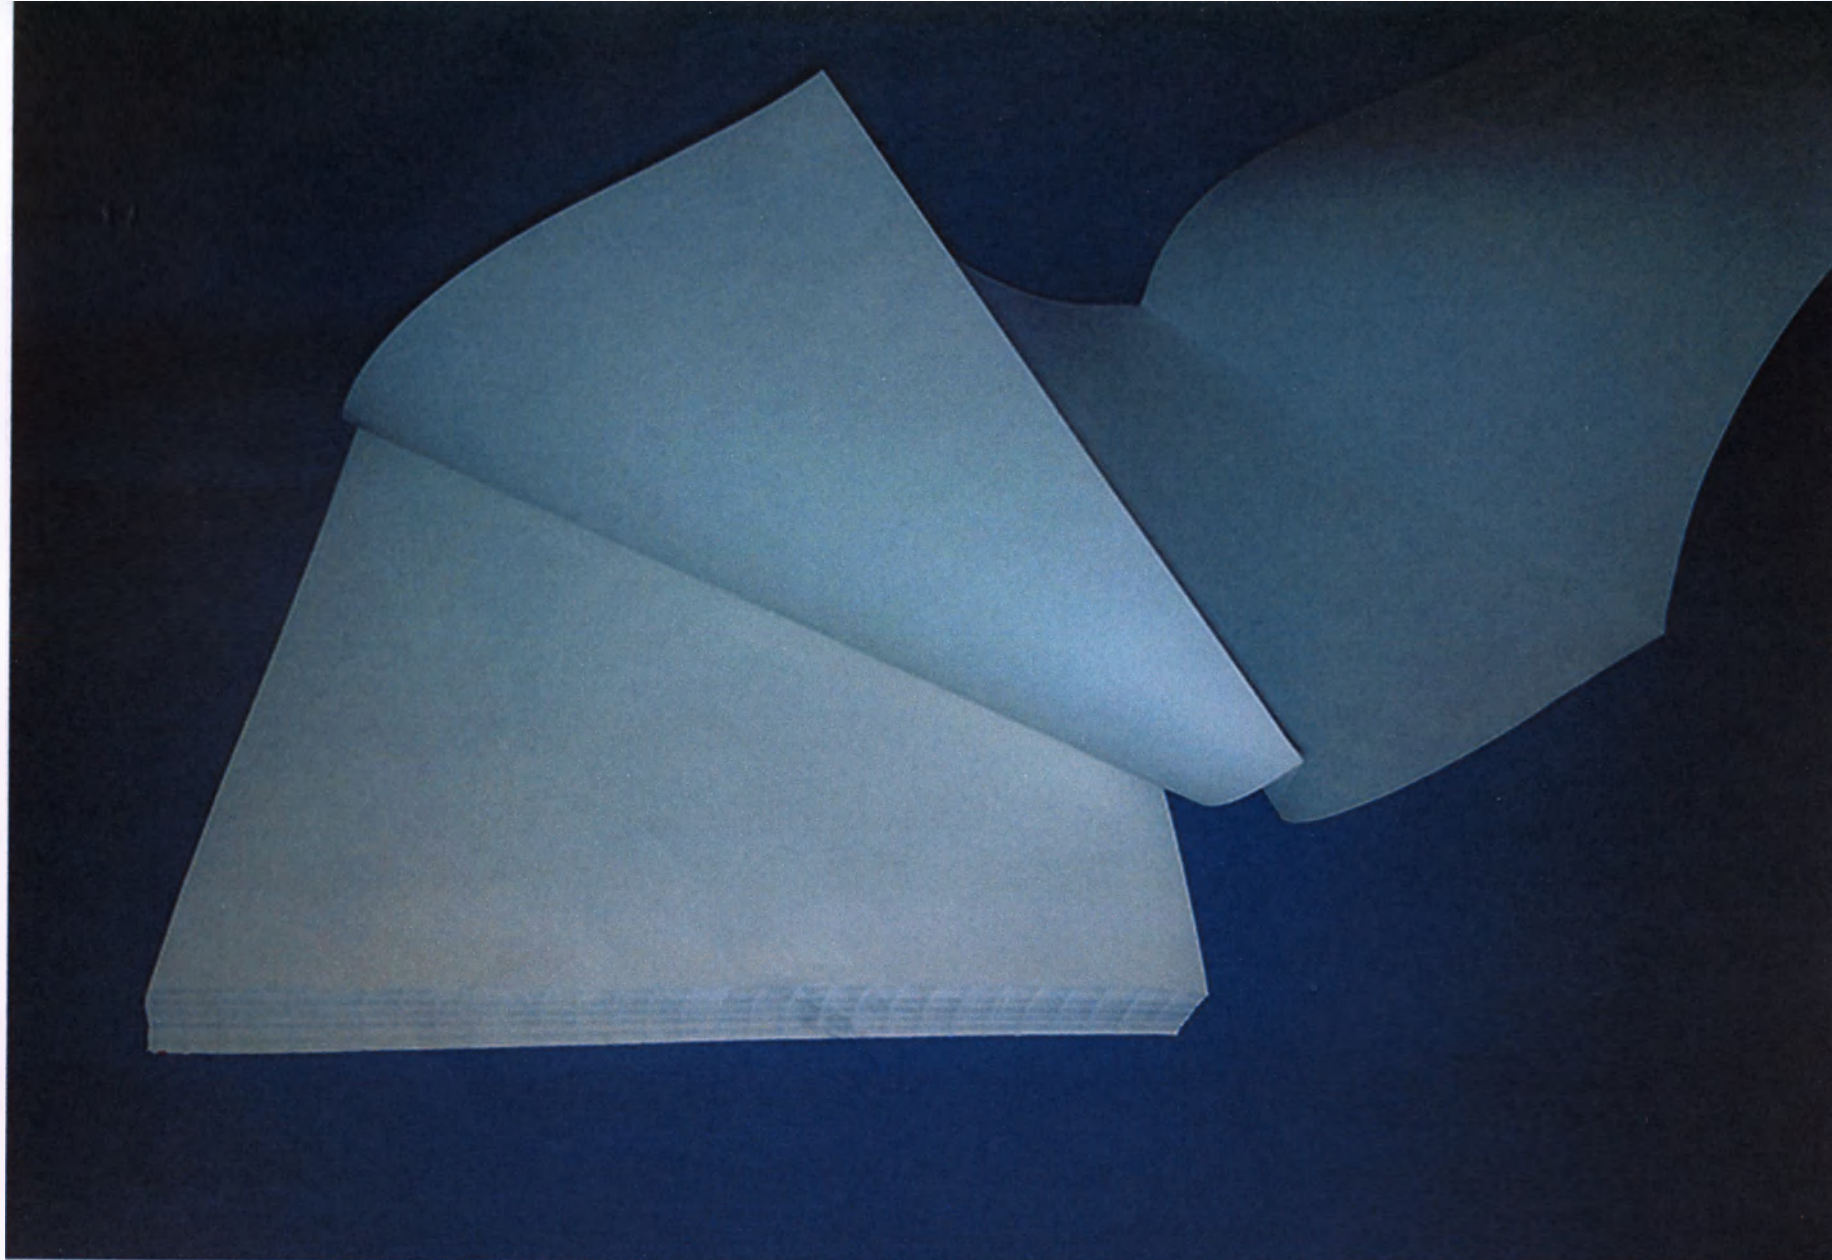

11. Ленты диаграммные складывающиеся без диаграммной сетки

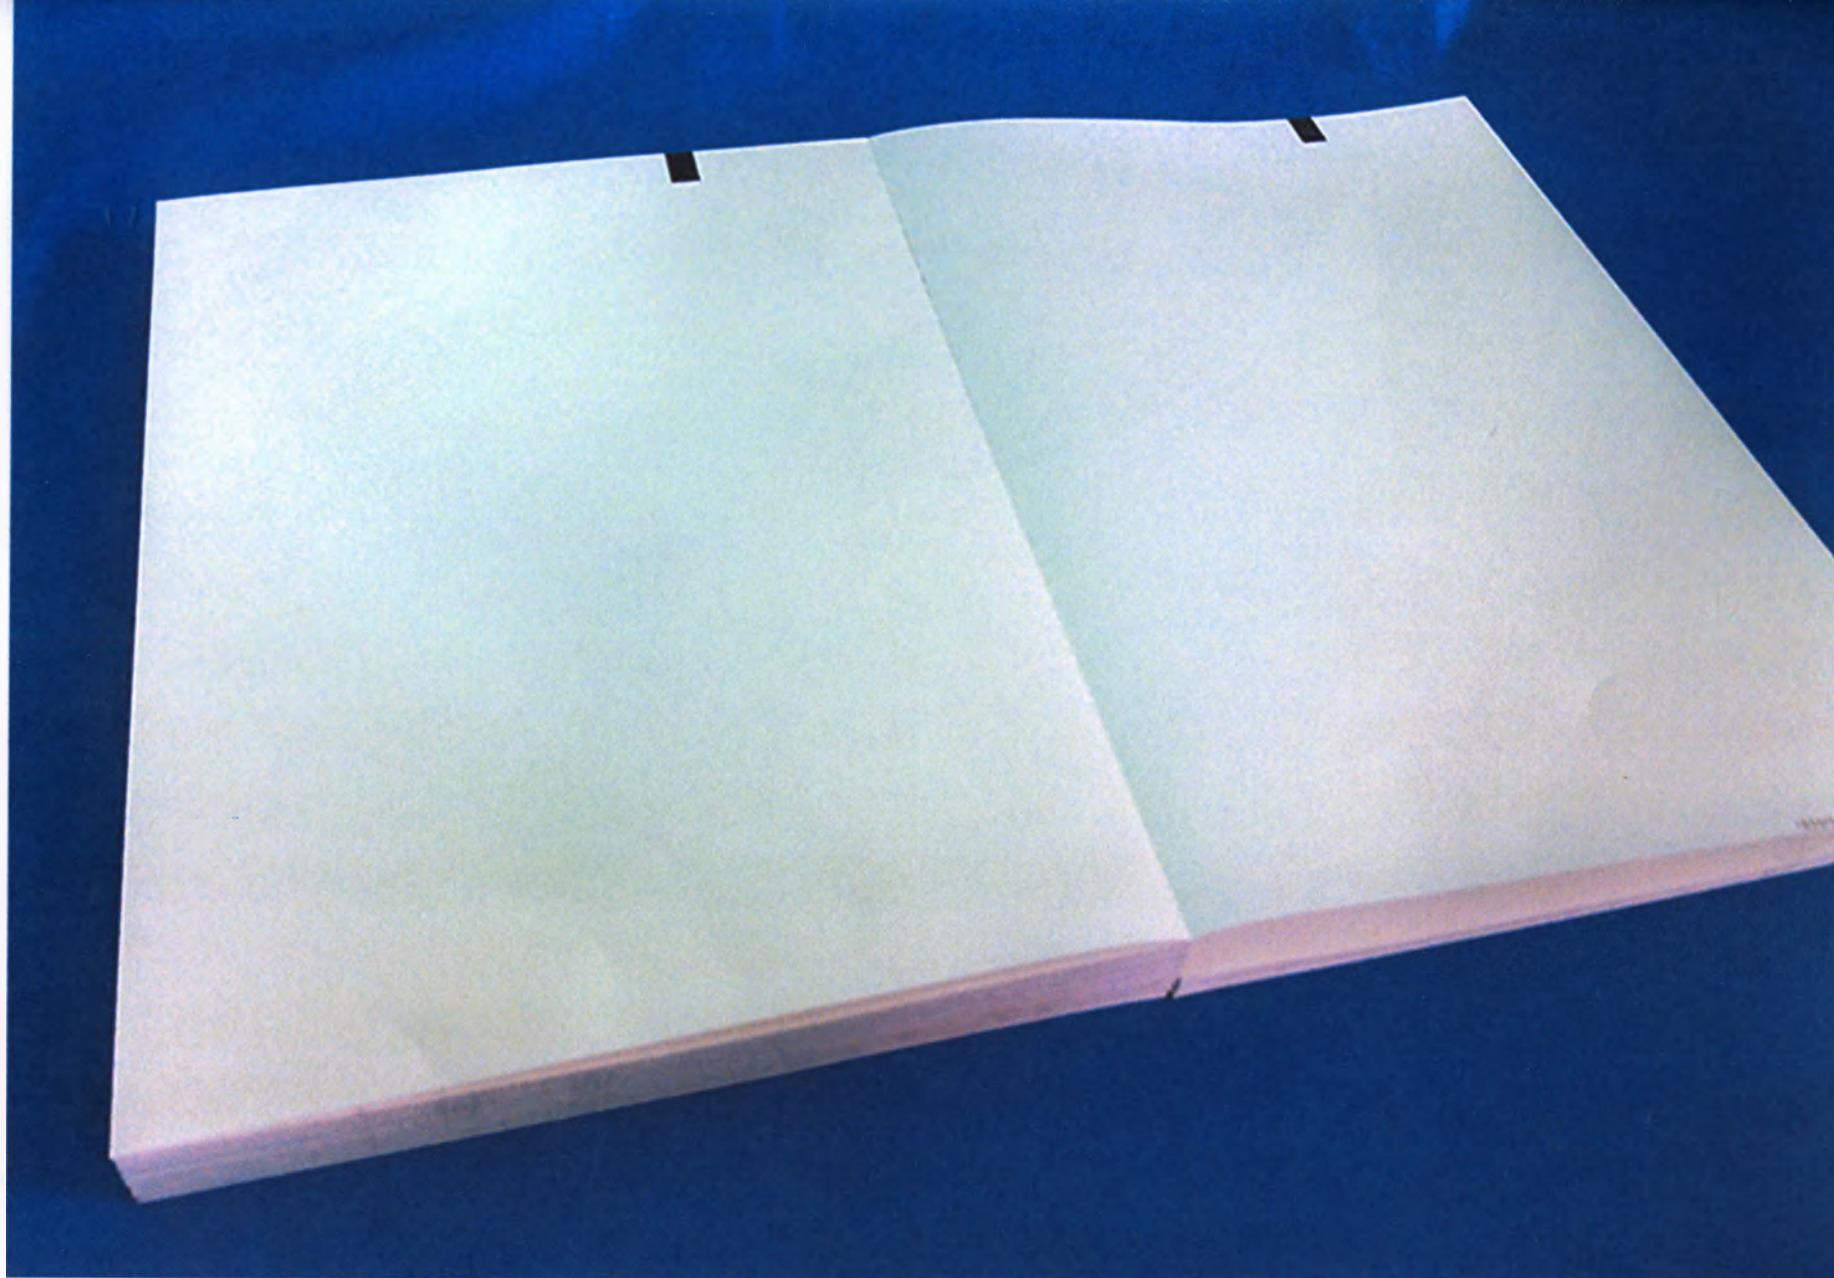

**12. Ленты диаграммные складывающиеся
без диаграммной сетки с фотометрической меткой**

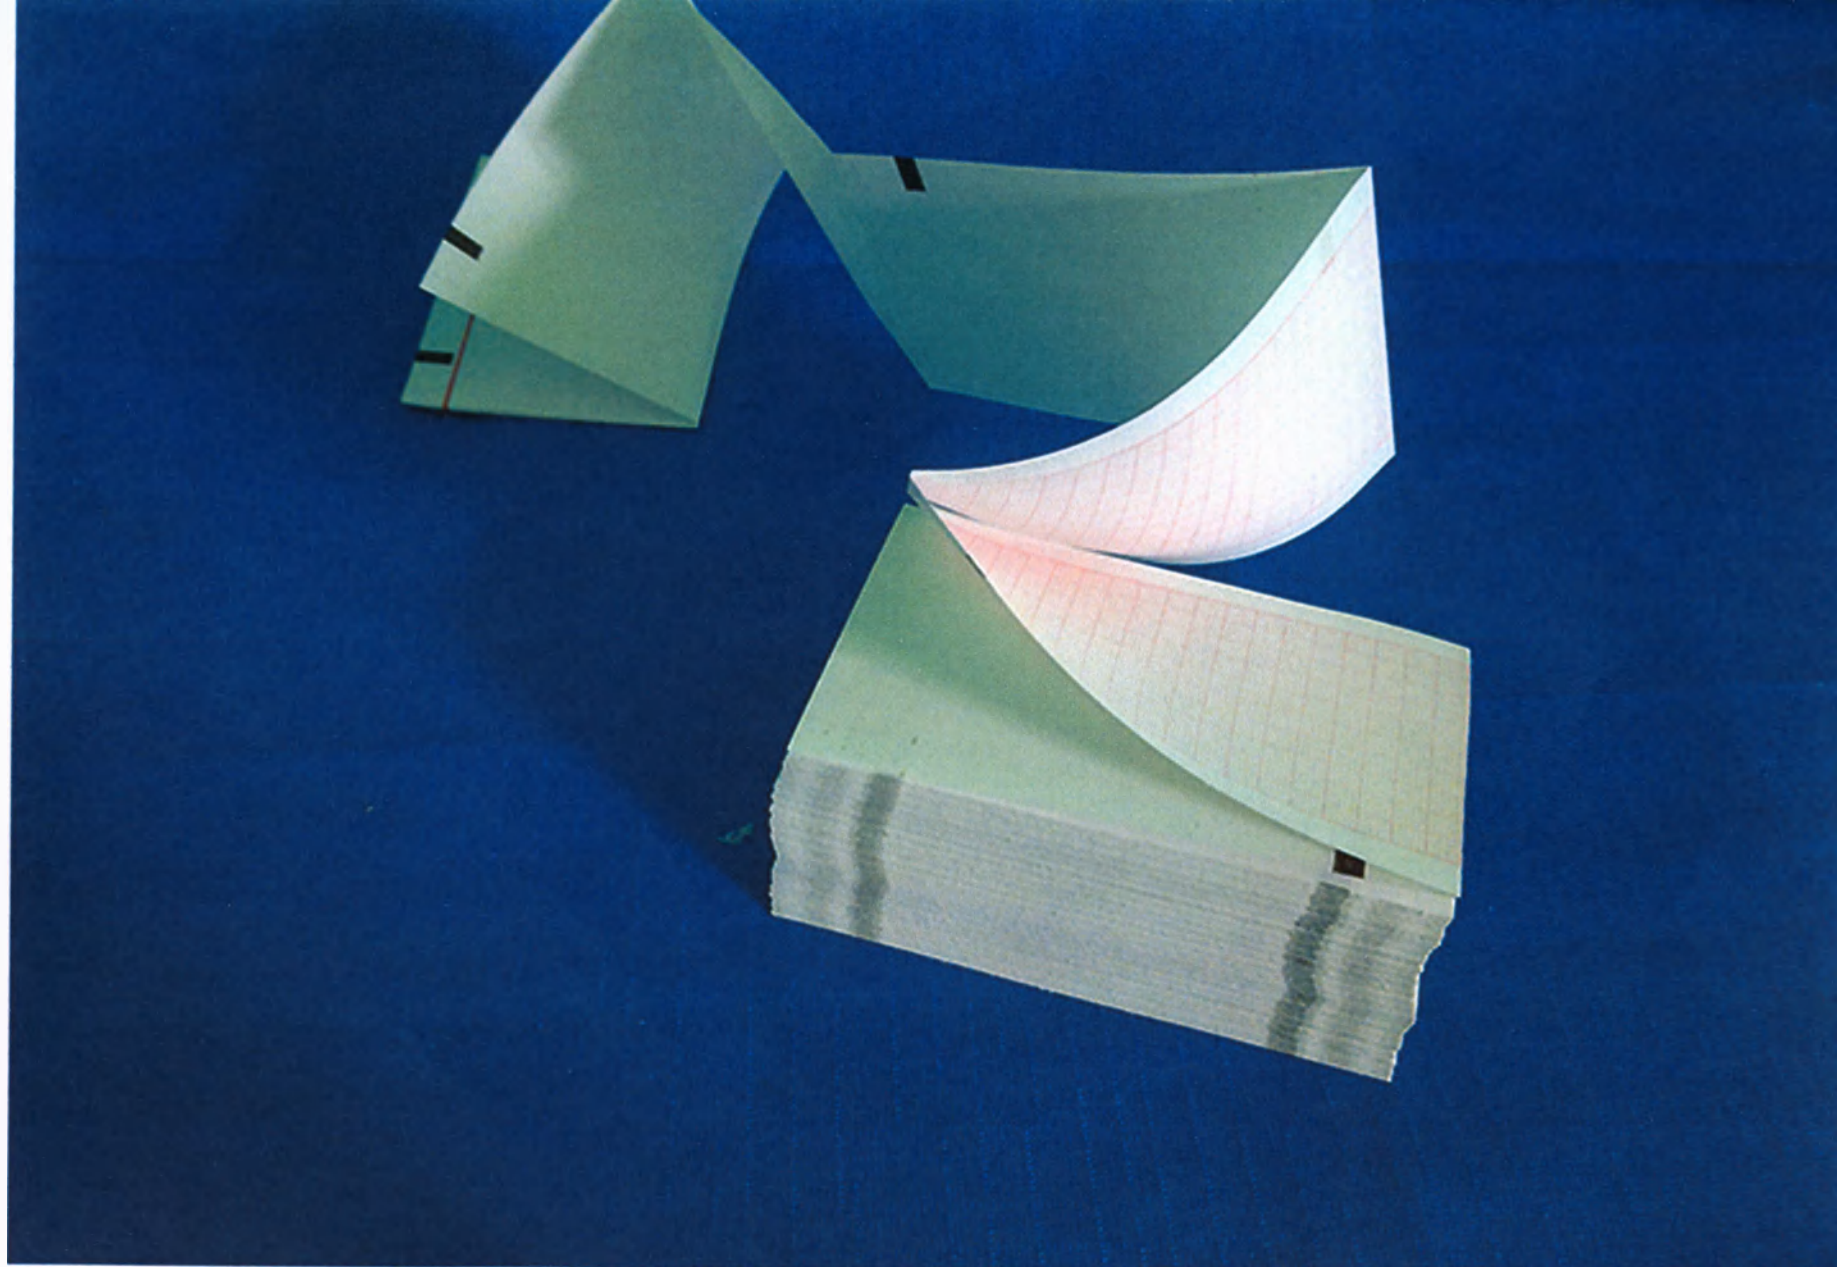


**13. Ленты диаграммные складывающиеся с диаграммной сеткой
с фотометрической меткой на стороне бумаги без термослоя**




 ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов	
Реестровый номер	4100
Размер	145x125x240
Количество	70
Дата изготовления	2018-03-16
Упаковщик	99
Марка бумаги	термобумага
Гарантийный срок хранения	5 лет
Архивируемость	7 лет
ТУ 17.12.14-004-22261422-2017	
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06045 от _____	
РОССИЯ, 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 161 Г Отдел продаж: телефон: (4722) 214-494; факс: (4722) 214-497	
 Беречь от солнечных лучей! Не бросать!	

13. Ленты диаграммные складывающаяся с диаграммной сеткой с фотометрической меткой на стороне бумаги без термослоя

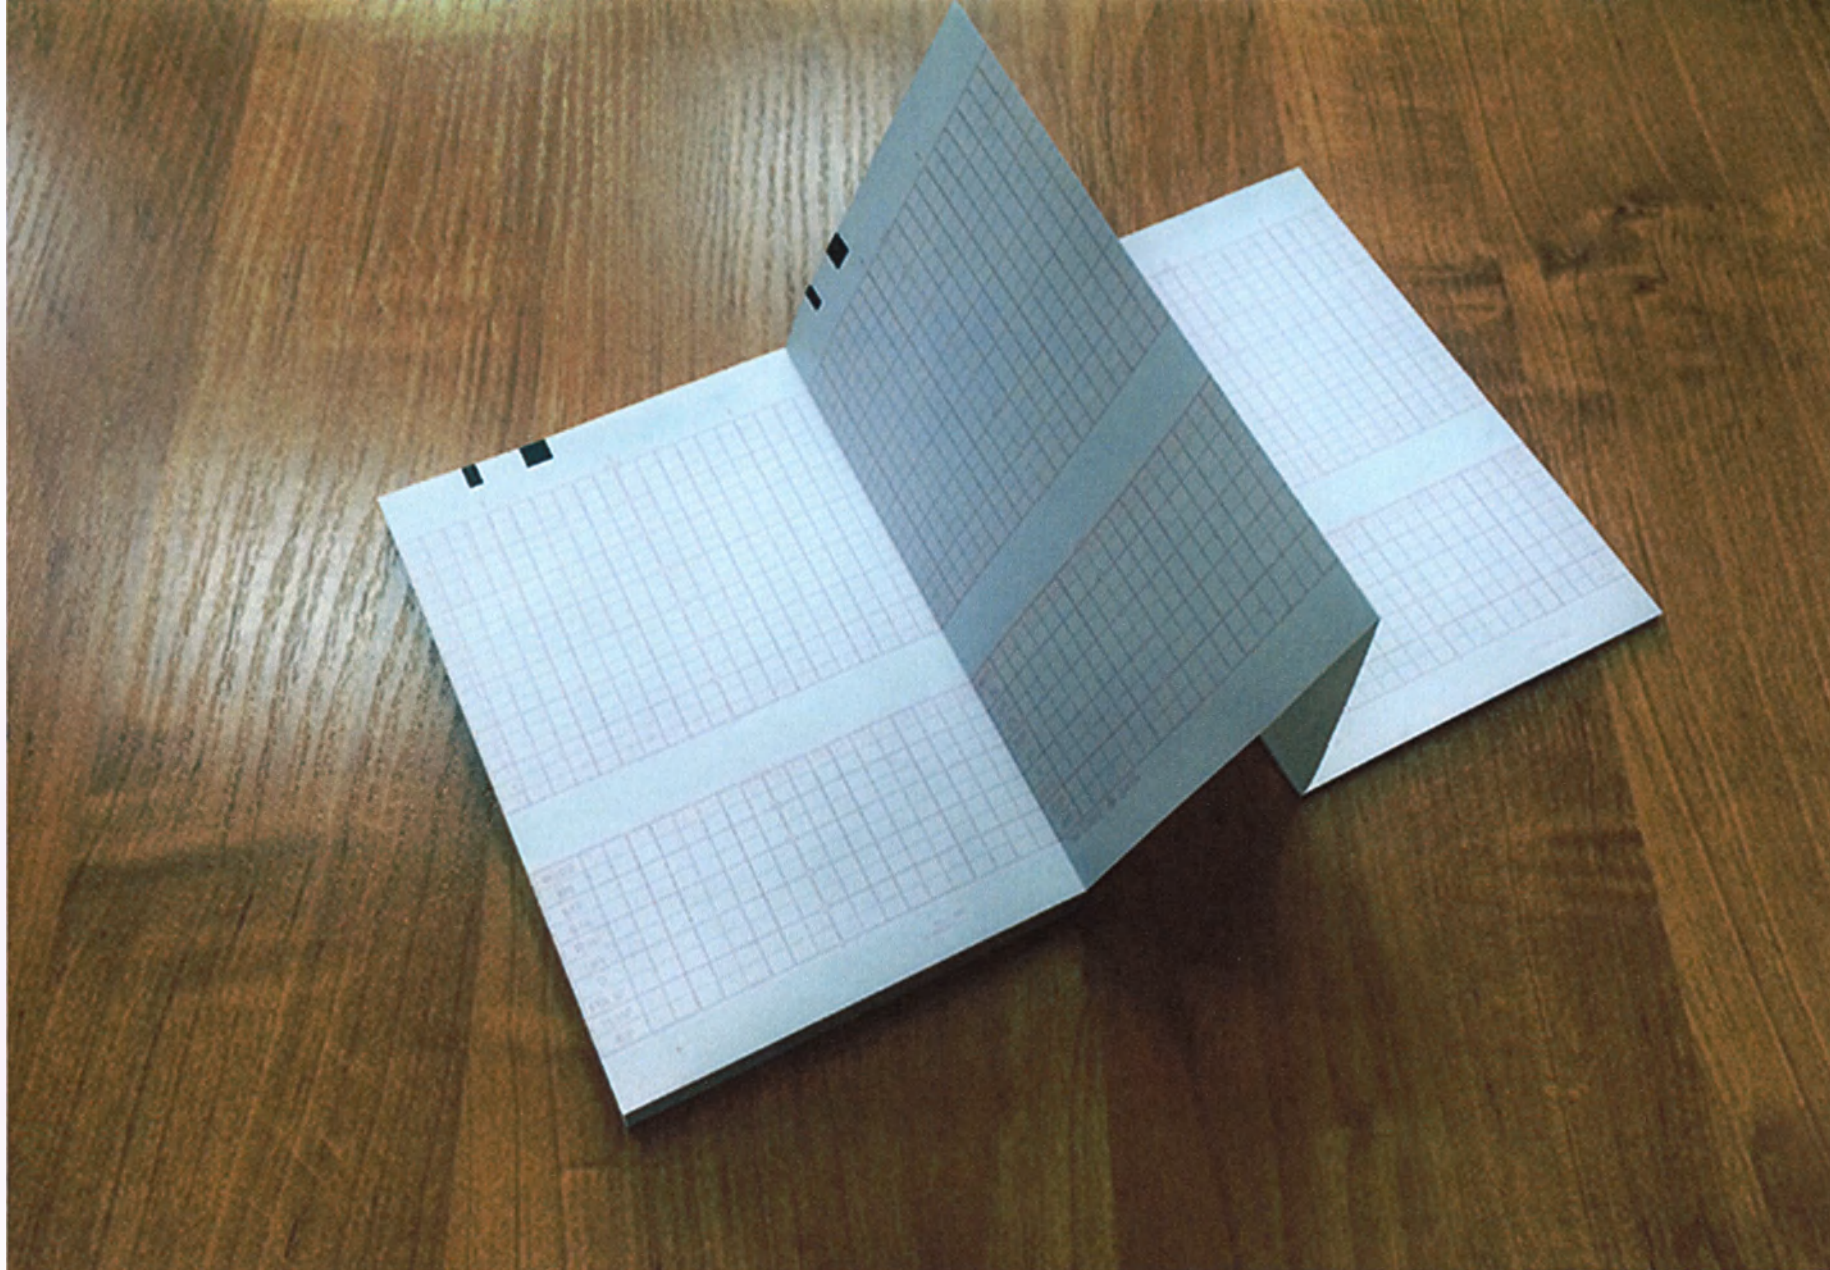


14. Ленты диаграммные складывающиеся

с диаграммной сеткой с двумя фотометрическими метками на сетке

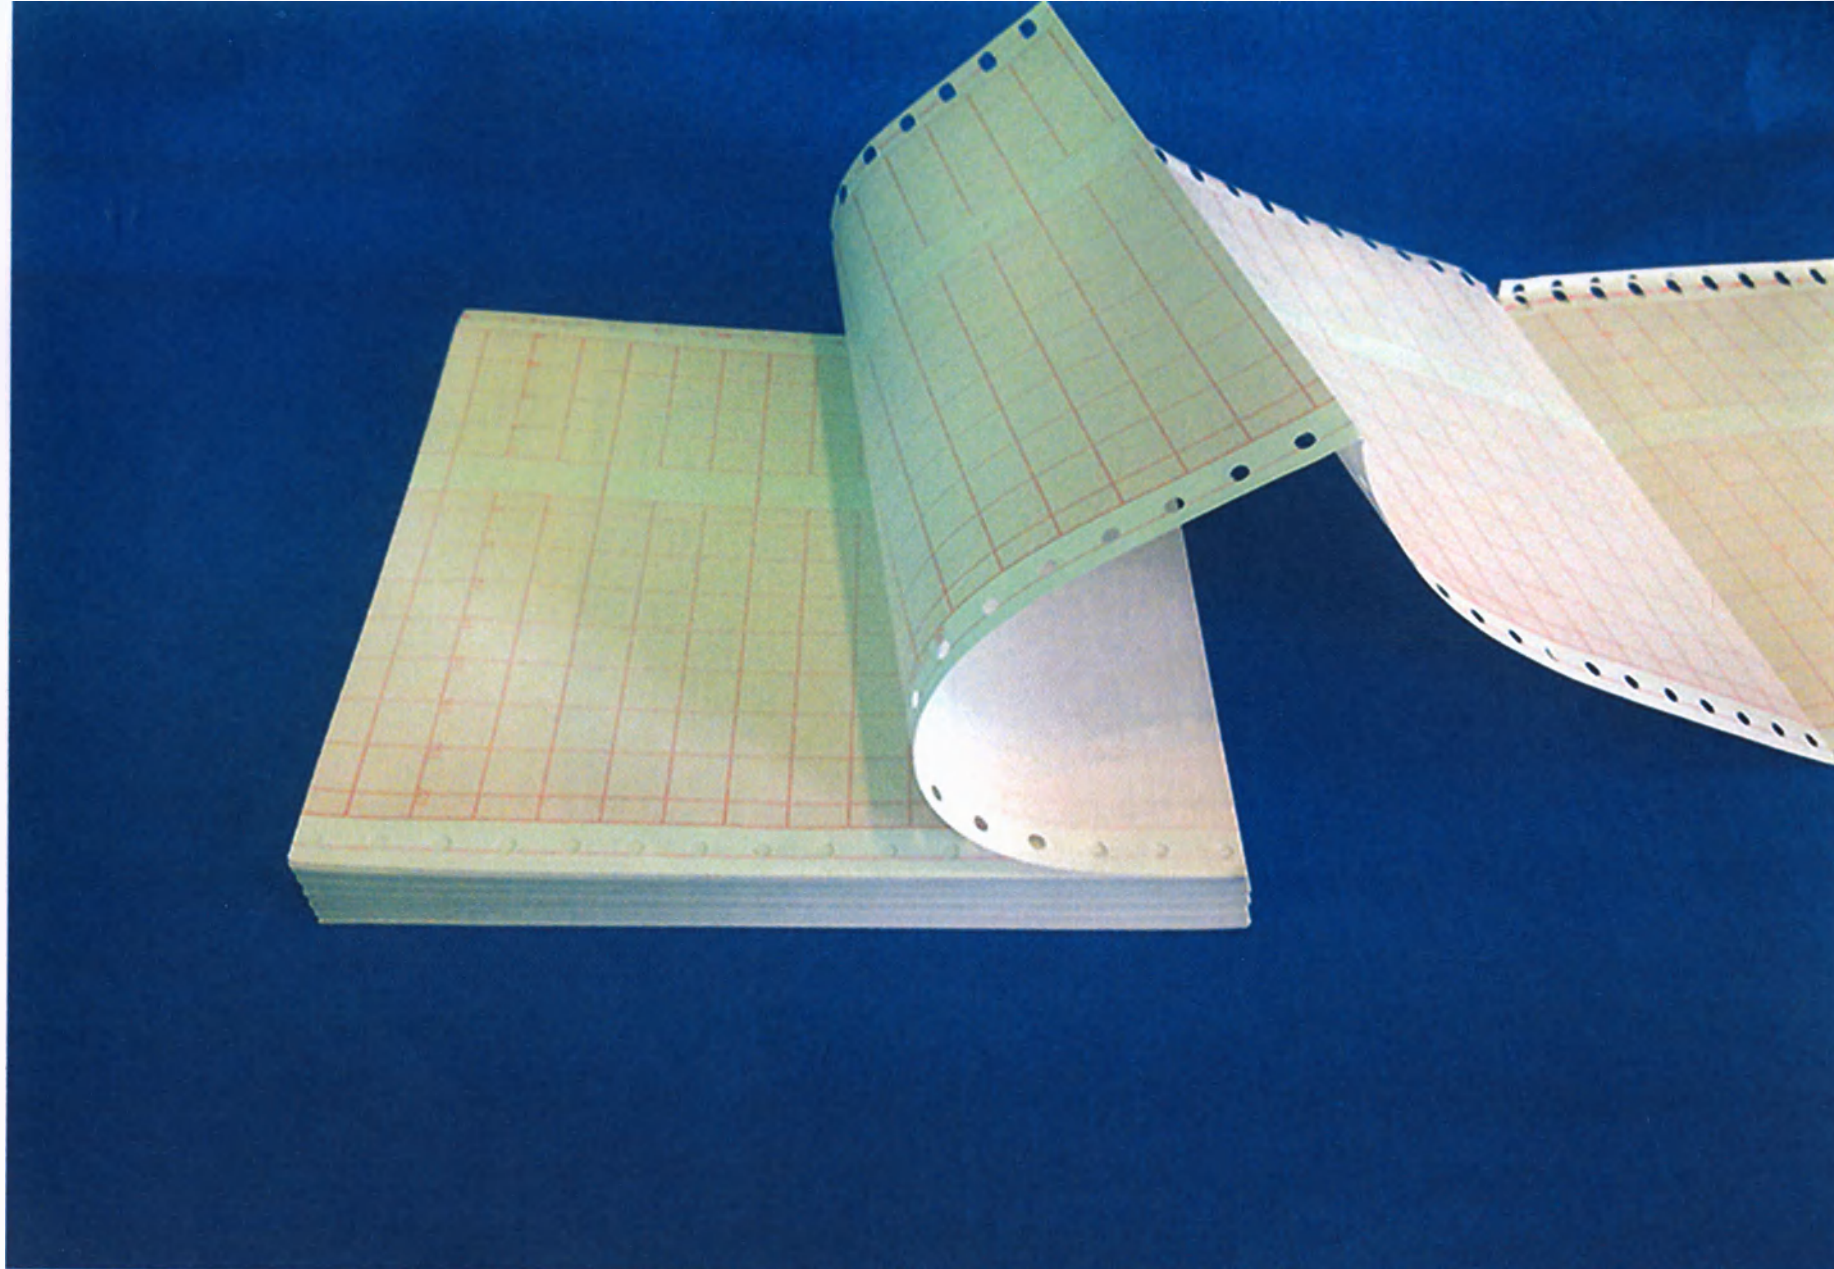

**15. Ленты диаграммные складывающиеся
с диаграммной сеткой с перфорацией с двух сторон**

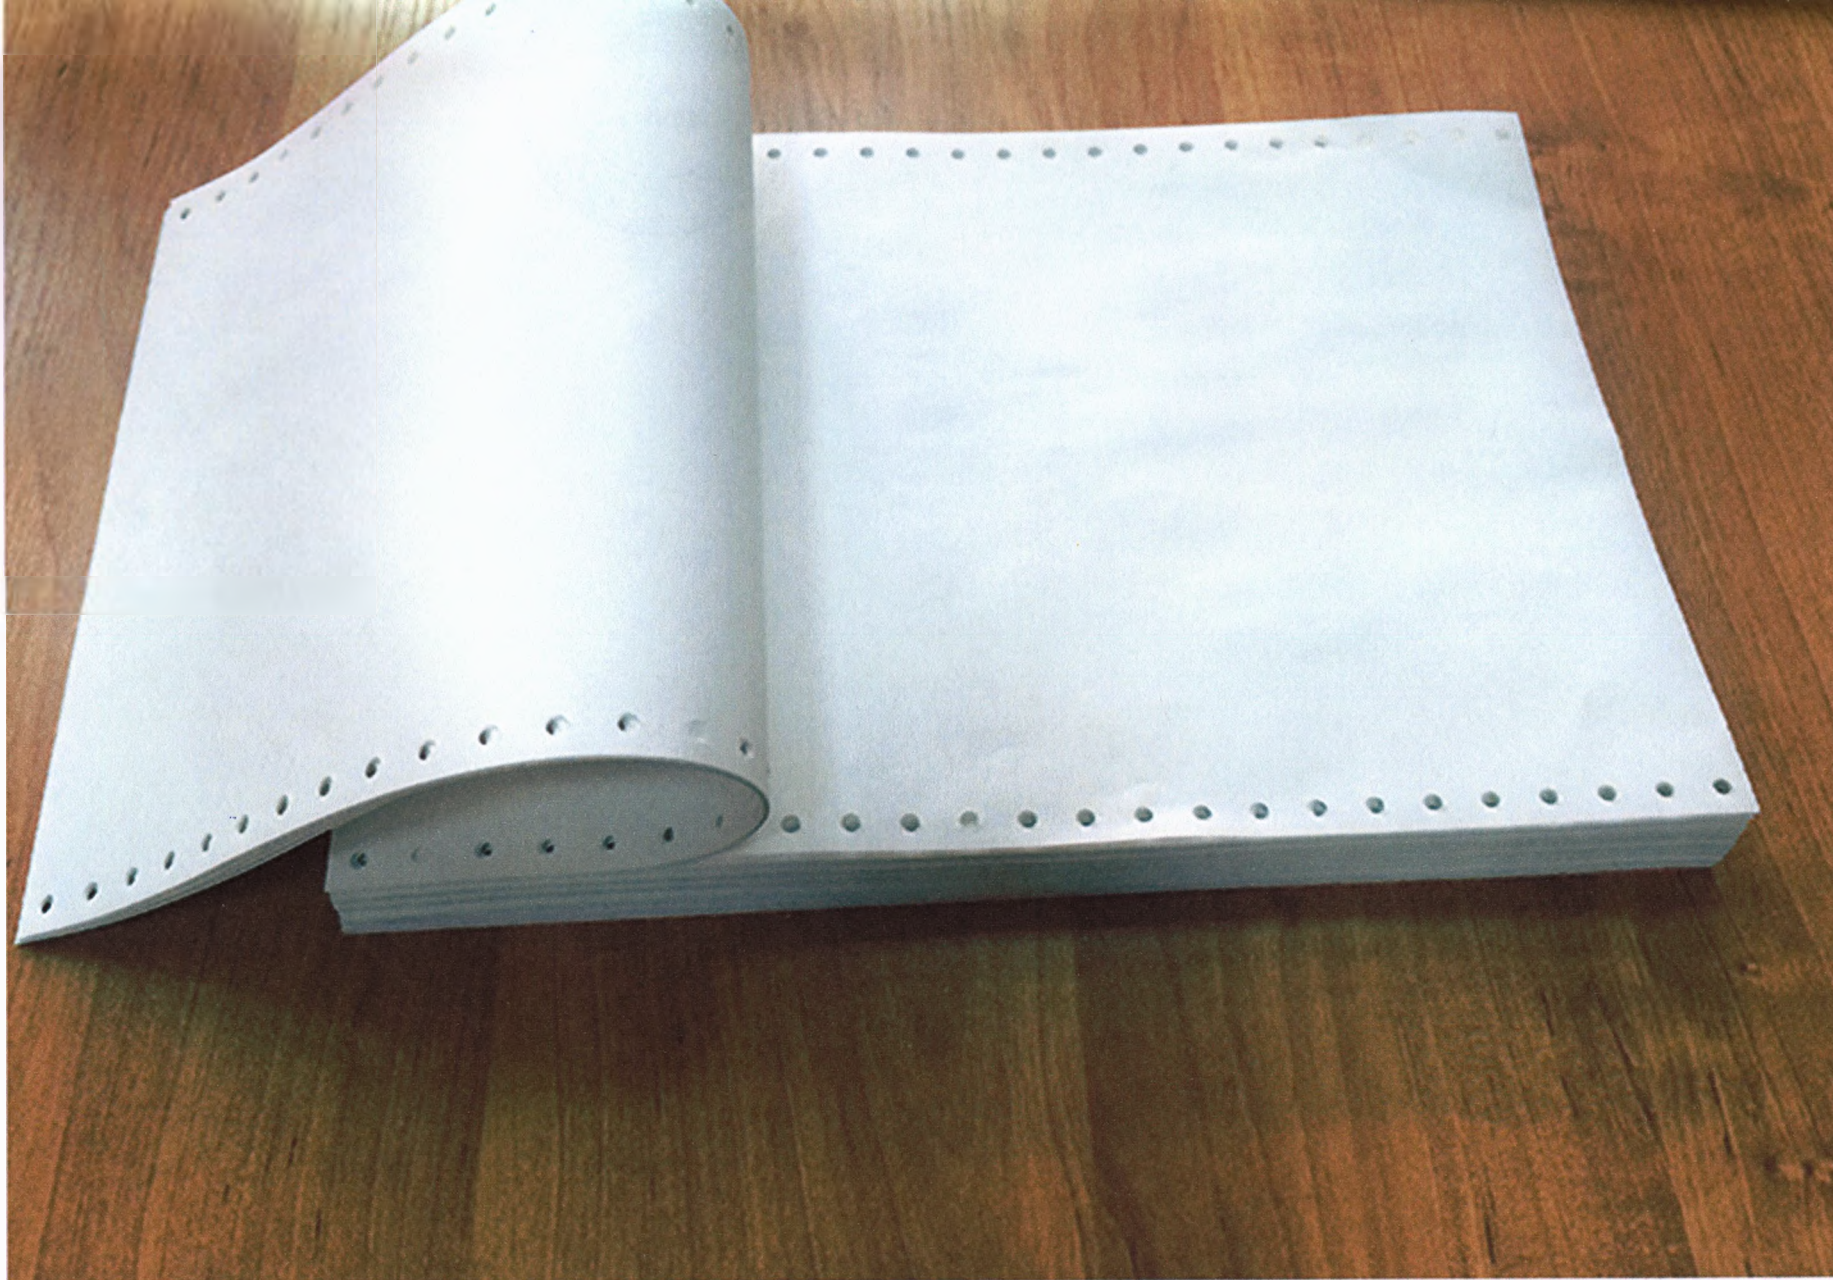

**16. Ленты диаграммные складывающиеся без
диаграммной сетки с перфорацией с двух сторон**

