




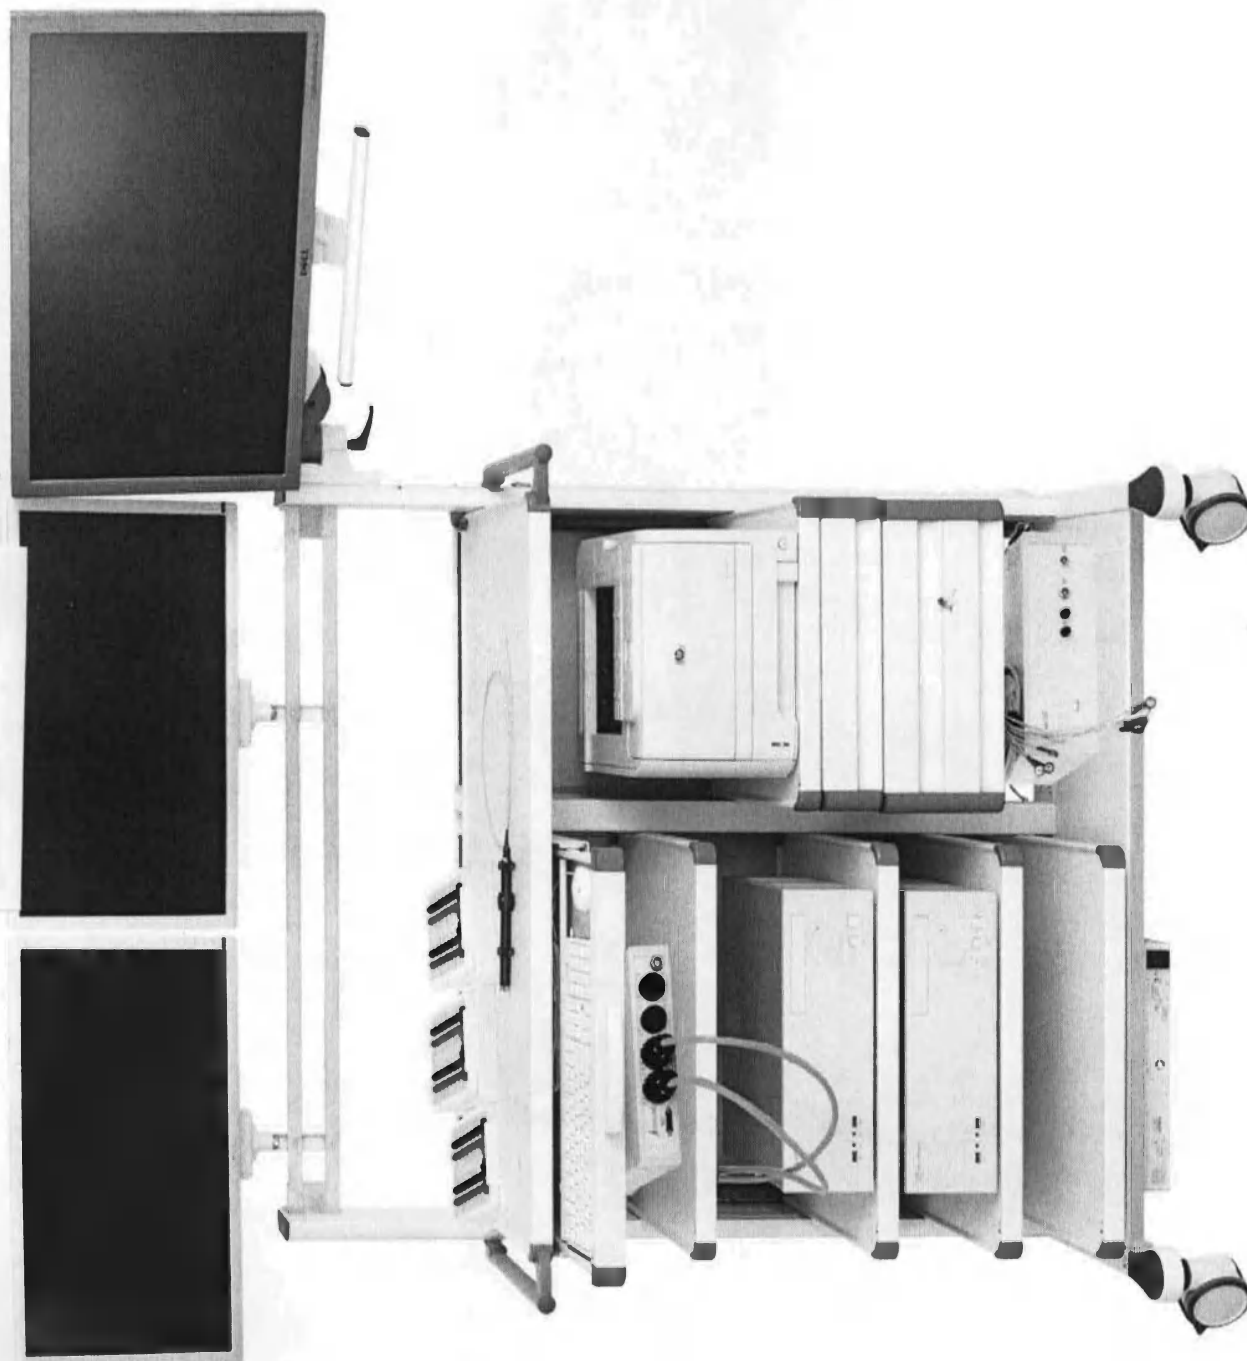


Комплекс нефлюороскопический для проведения внутрисердечных электрофизиологических исследований сердца «Астрокард -КАРДИО ЭФИ 2»

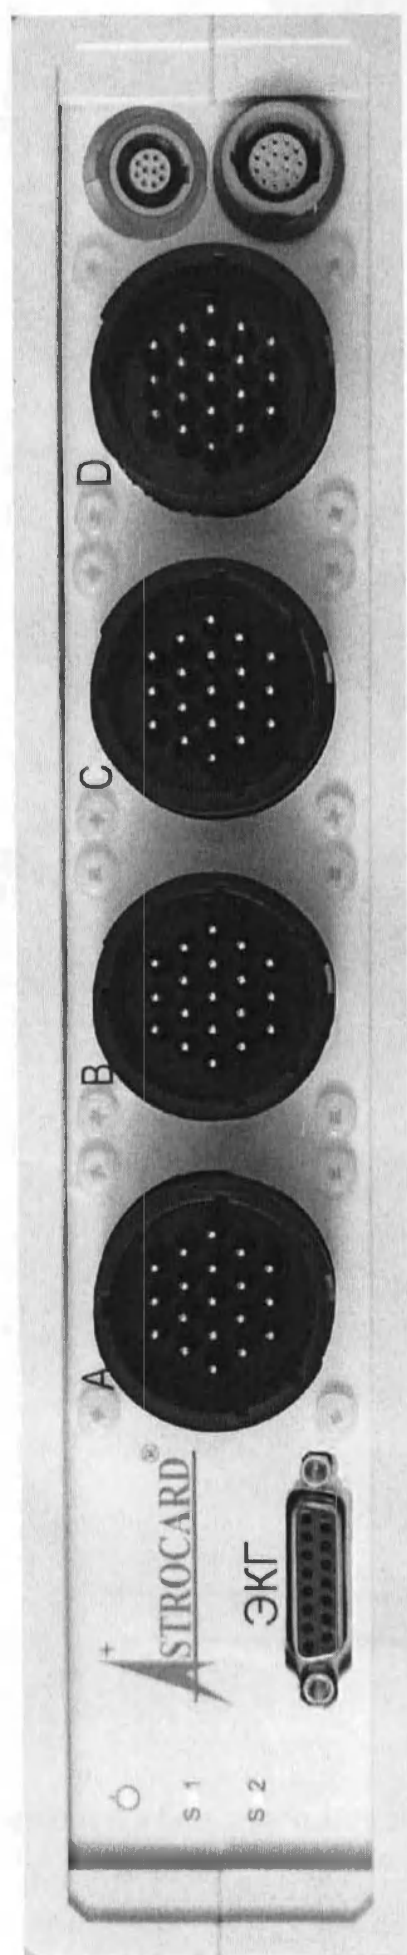


Блок усилителей биопотенциалов со встроенным кардиостимулятором

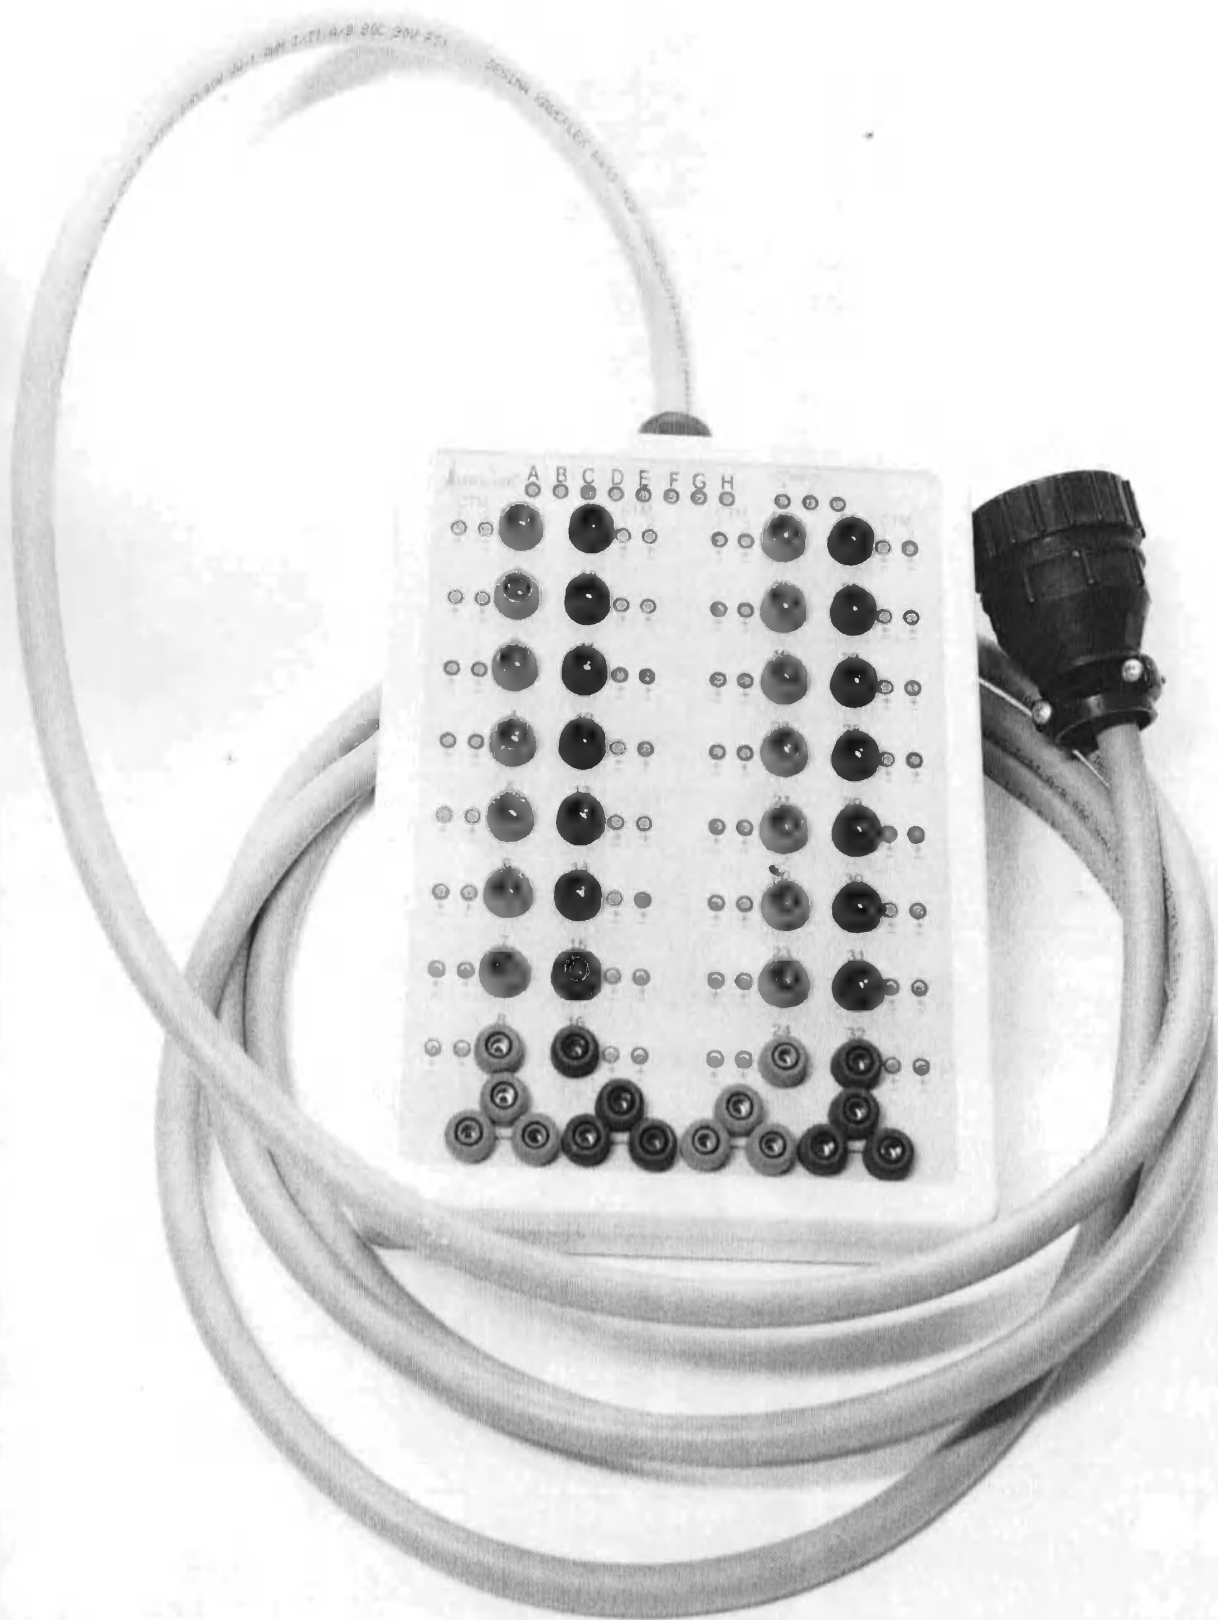

Блок усилителей биопотенциалов дополнительный

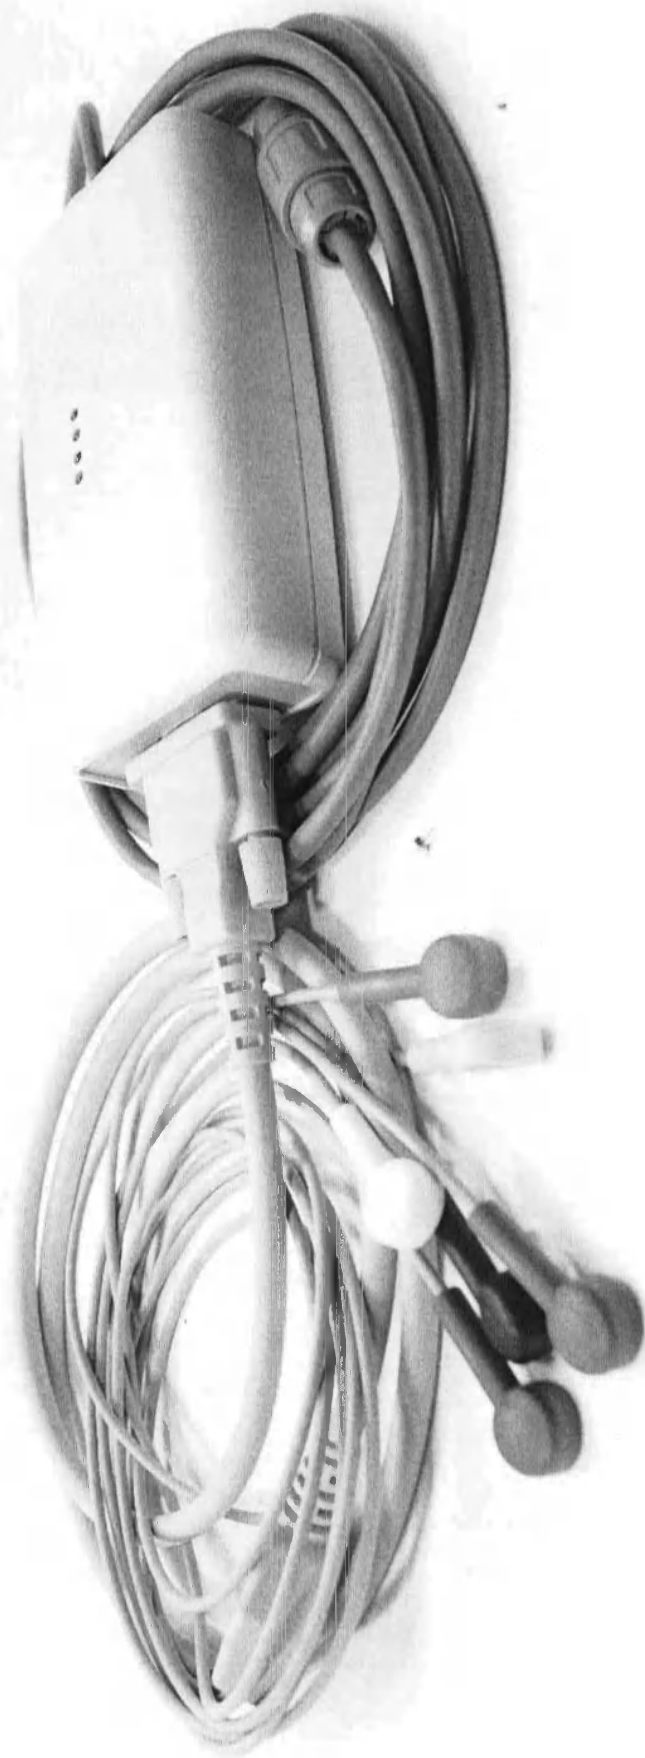



Блок навигации в комплекте с кабелем

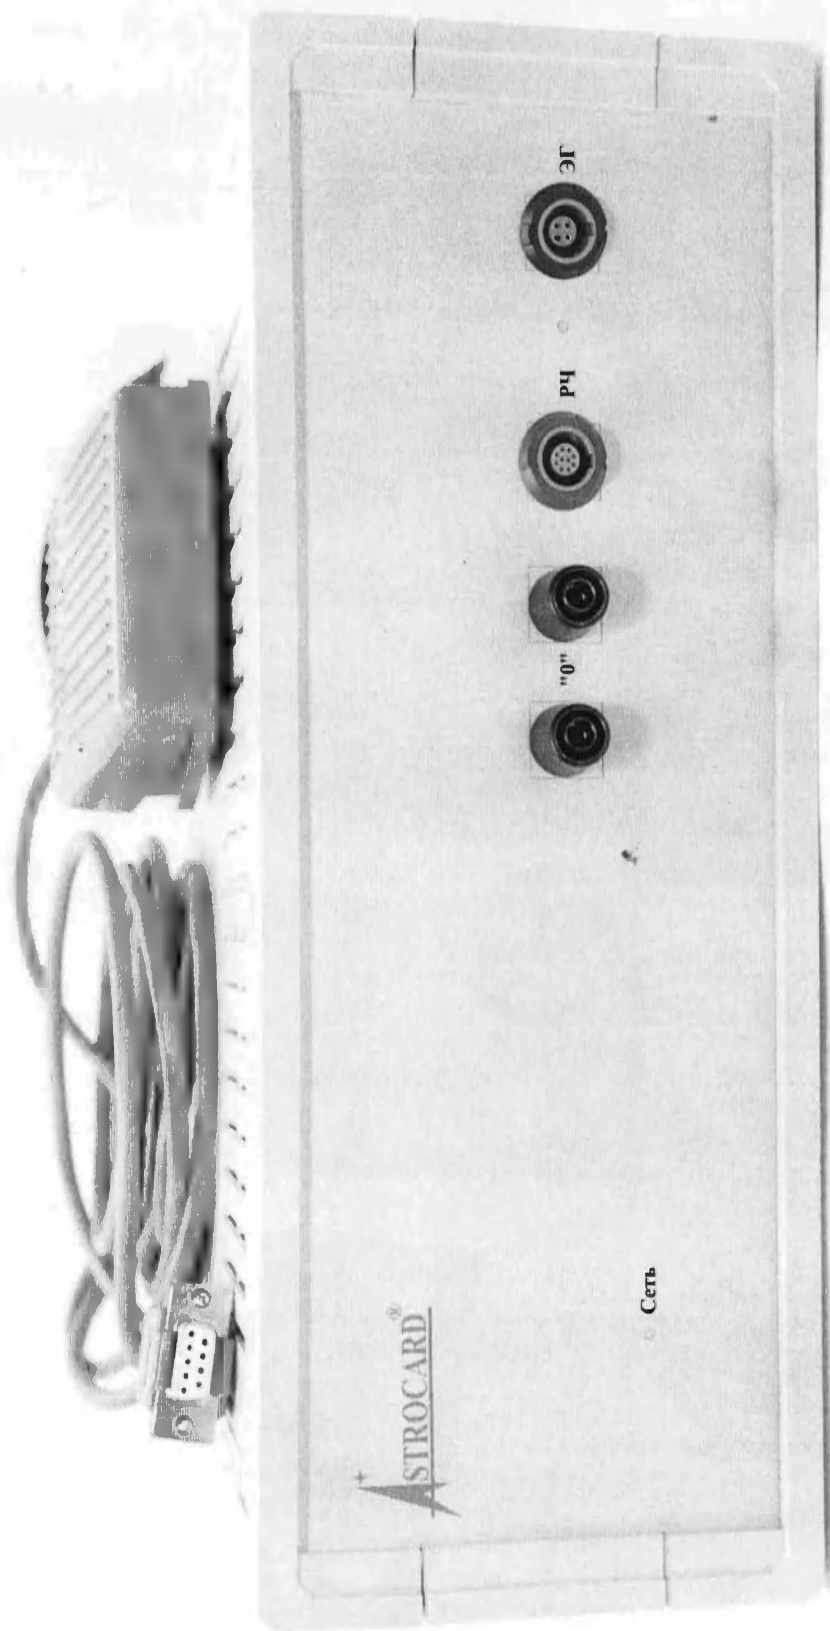

Блок радиочастотного деструктора с комплектом соединительных кабелей и управляющей pedalью

Переходник-калибратор для абляционного катетера

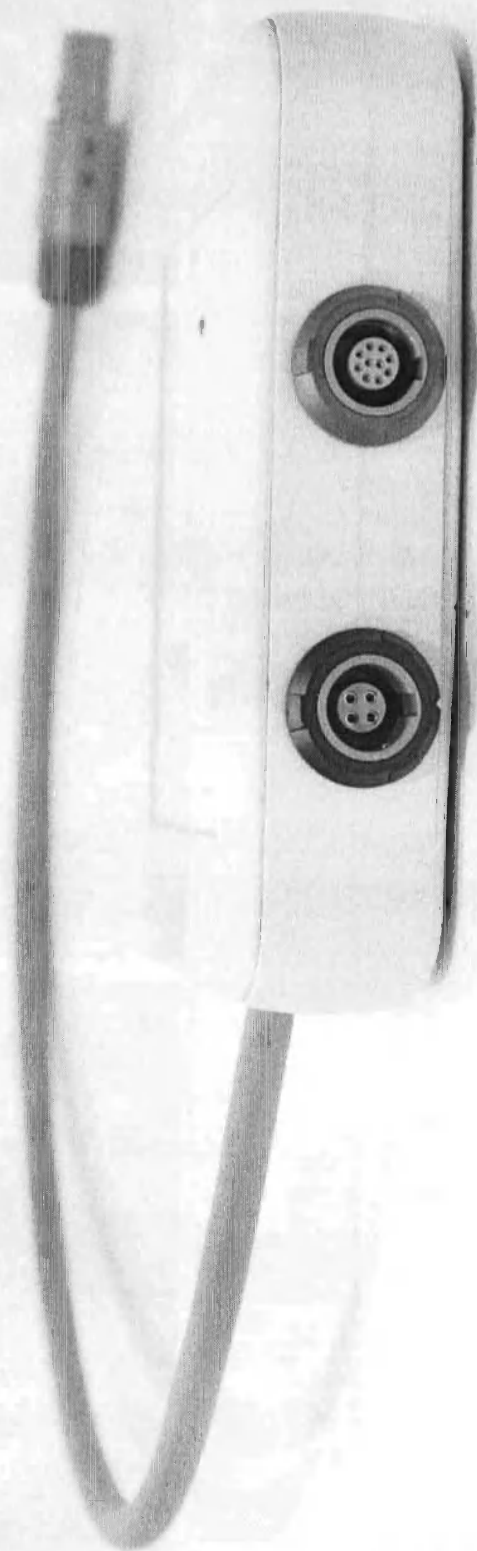

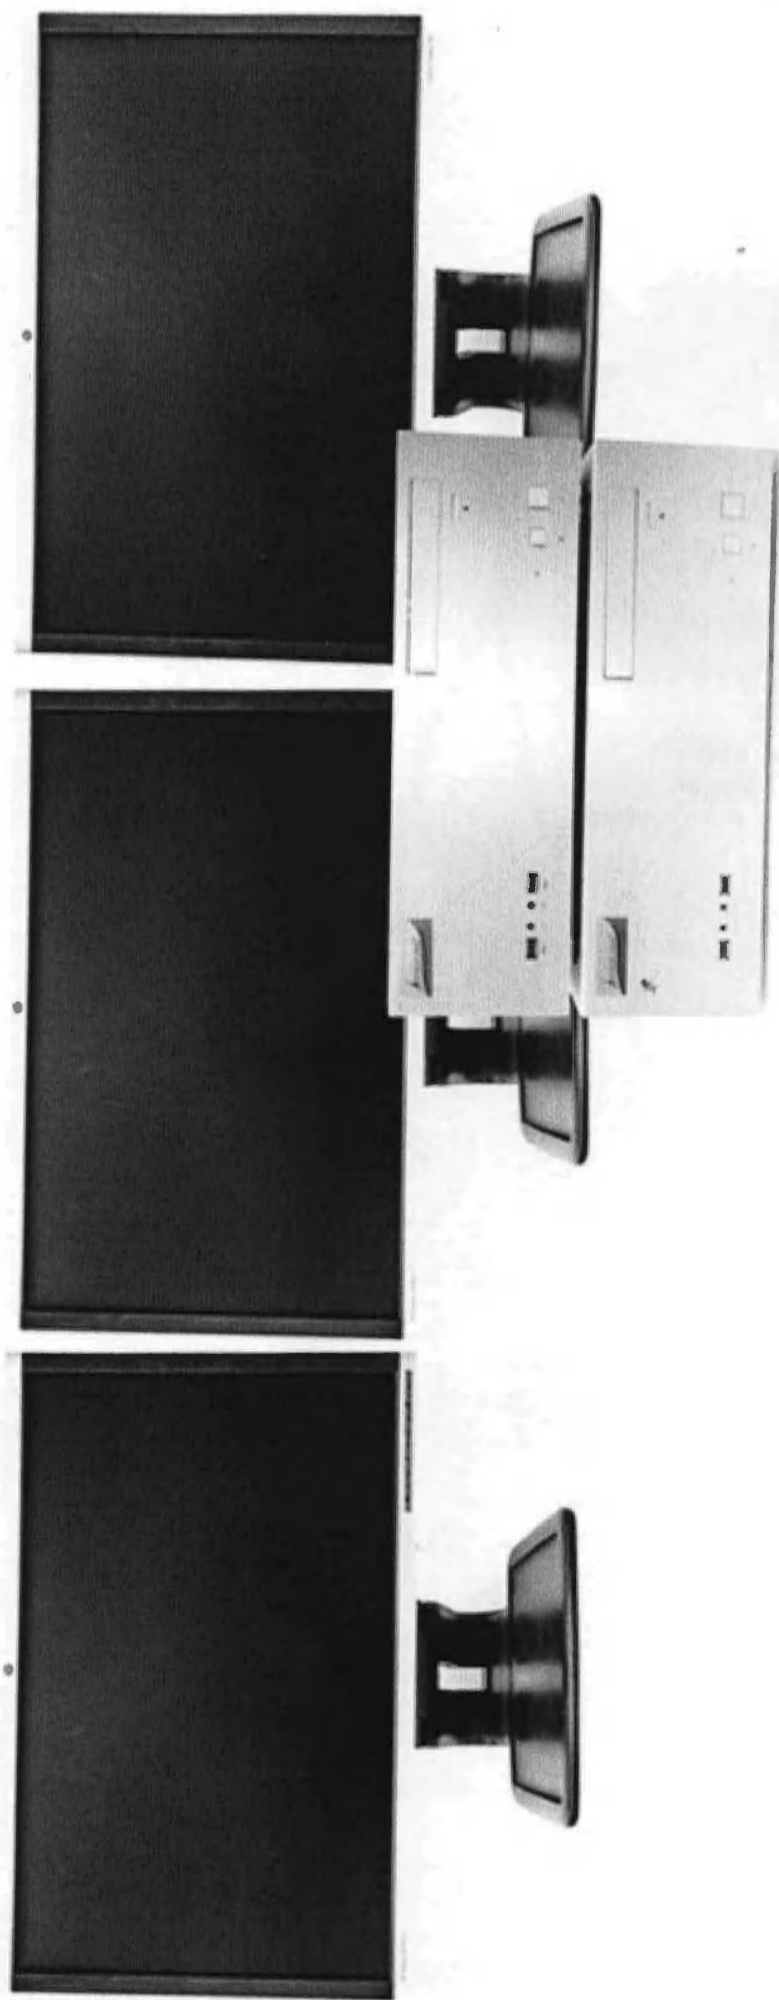


Блок управления с устройствами визуализации (три ЖК дисплея)


Адаптер для соединения блока управления и блока усилителя биопотенциалов



Ирригационный насос Cool Point

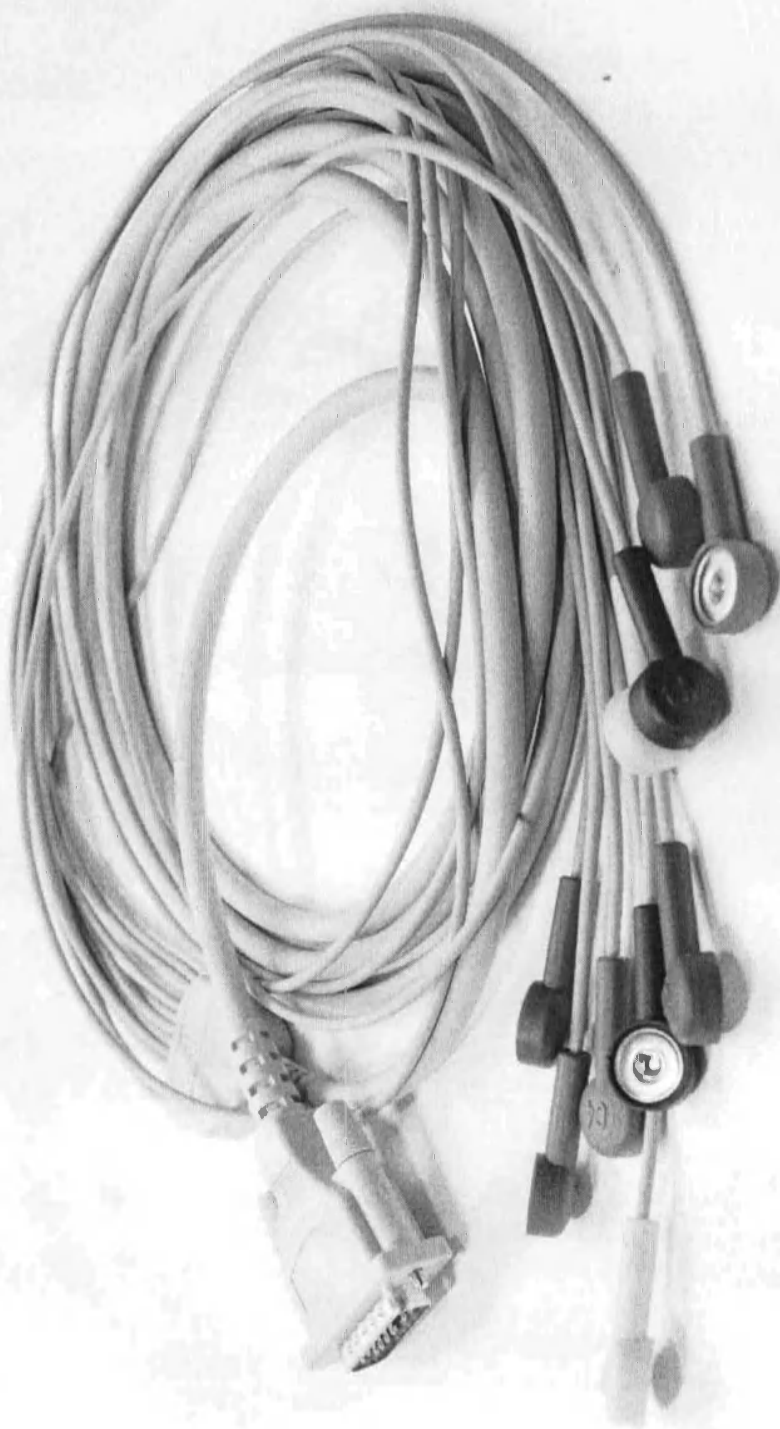


Кабель отведений (для ЭКГ каналов)

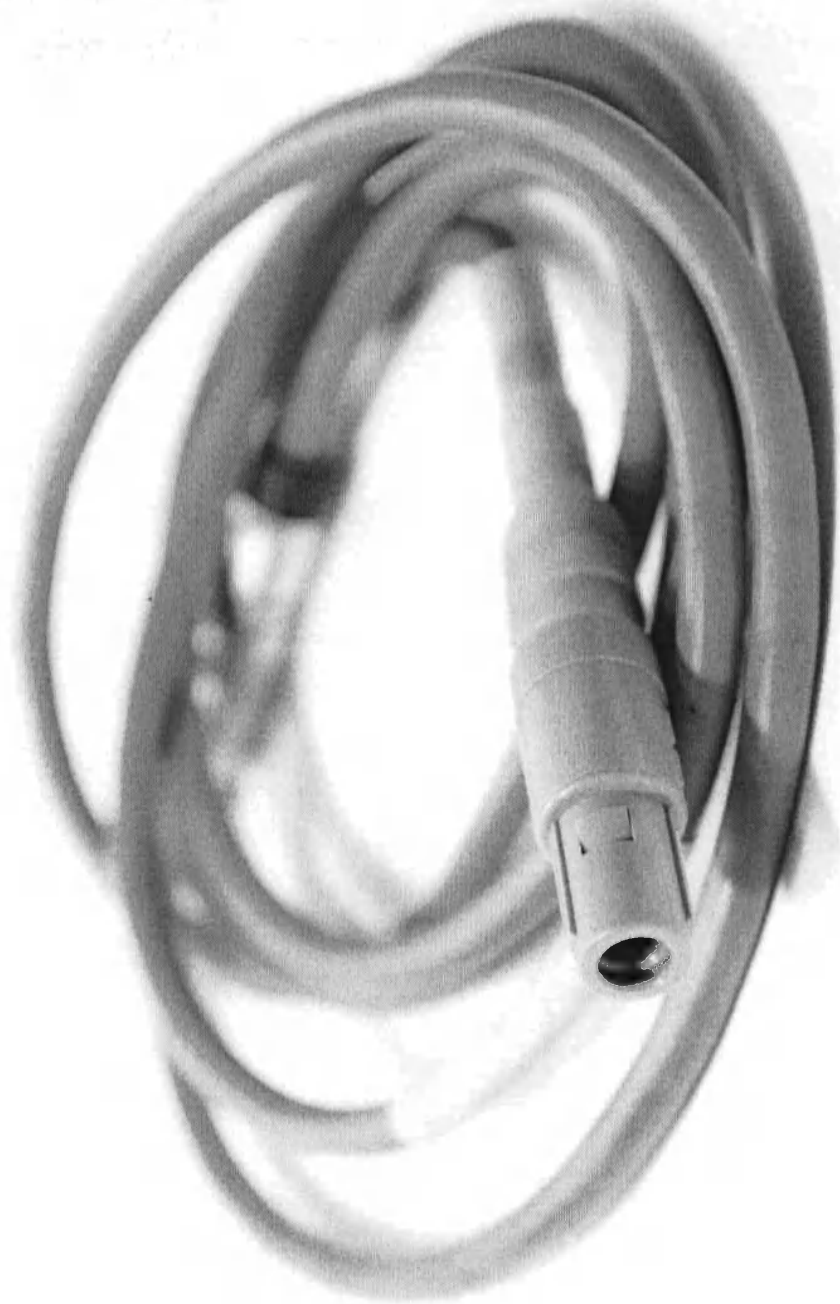

Кабель отведений (для инвазивных каналов)




Электроды одноразовые F9070

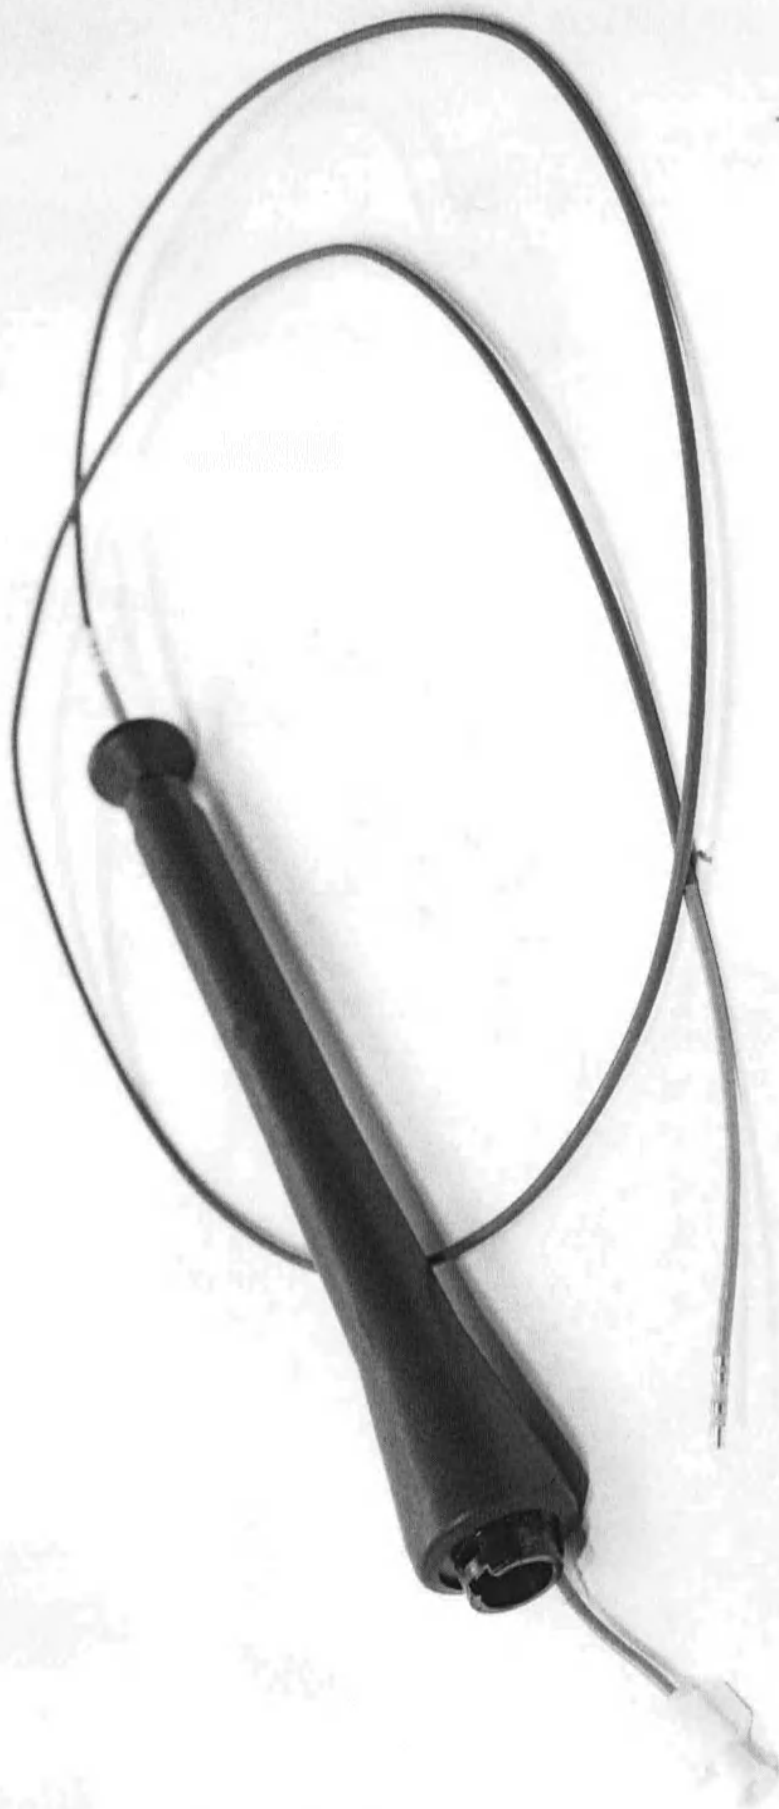

Катетер для радиочастотной деструкции (Абляционный орошаемый катетер Therapy CoolPath Ablation Catheter 83502-83506)



Электрод F7915

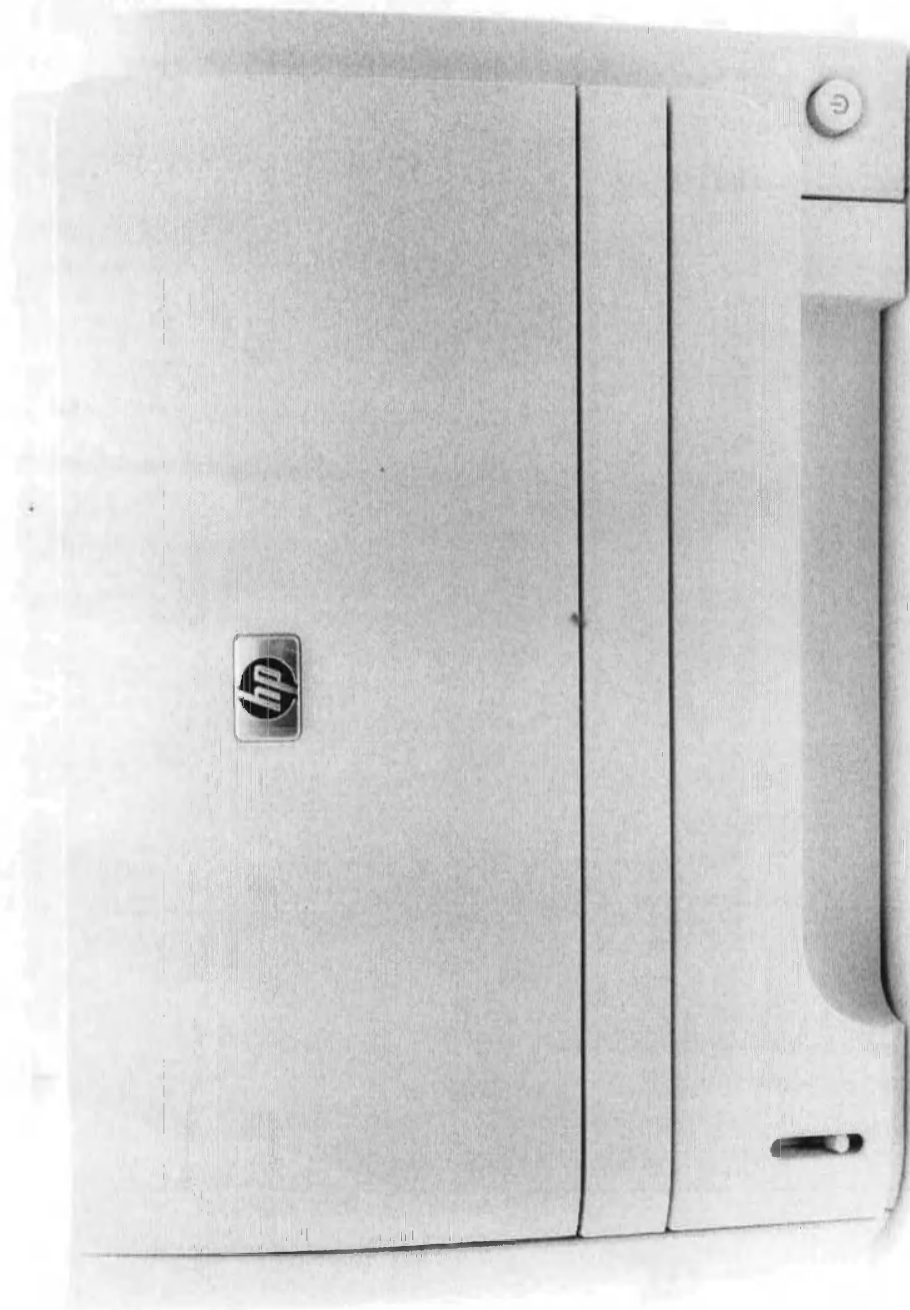

Принтер



Тележка

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 лист(ов)

Руководитель организации



[Handwritten signature]