

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Физиотехника»



Лапаев А.Е.

«22» .08. 2018 г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»

по ТУ 26.60.13-021-76228444-2017

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника", г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, литер А, помещение 2-Н

Адрес места производства: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», дер. Малое Карлино

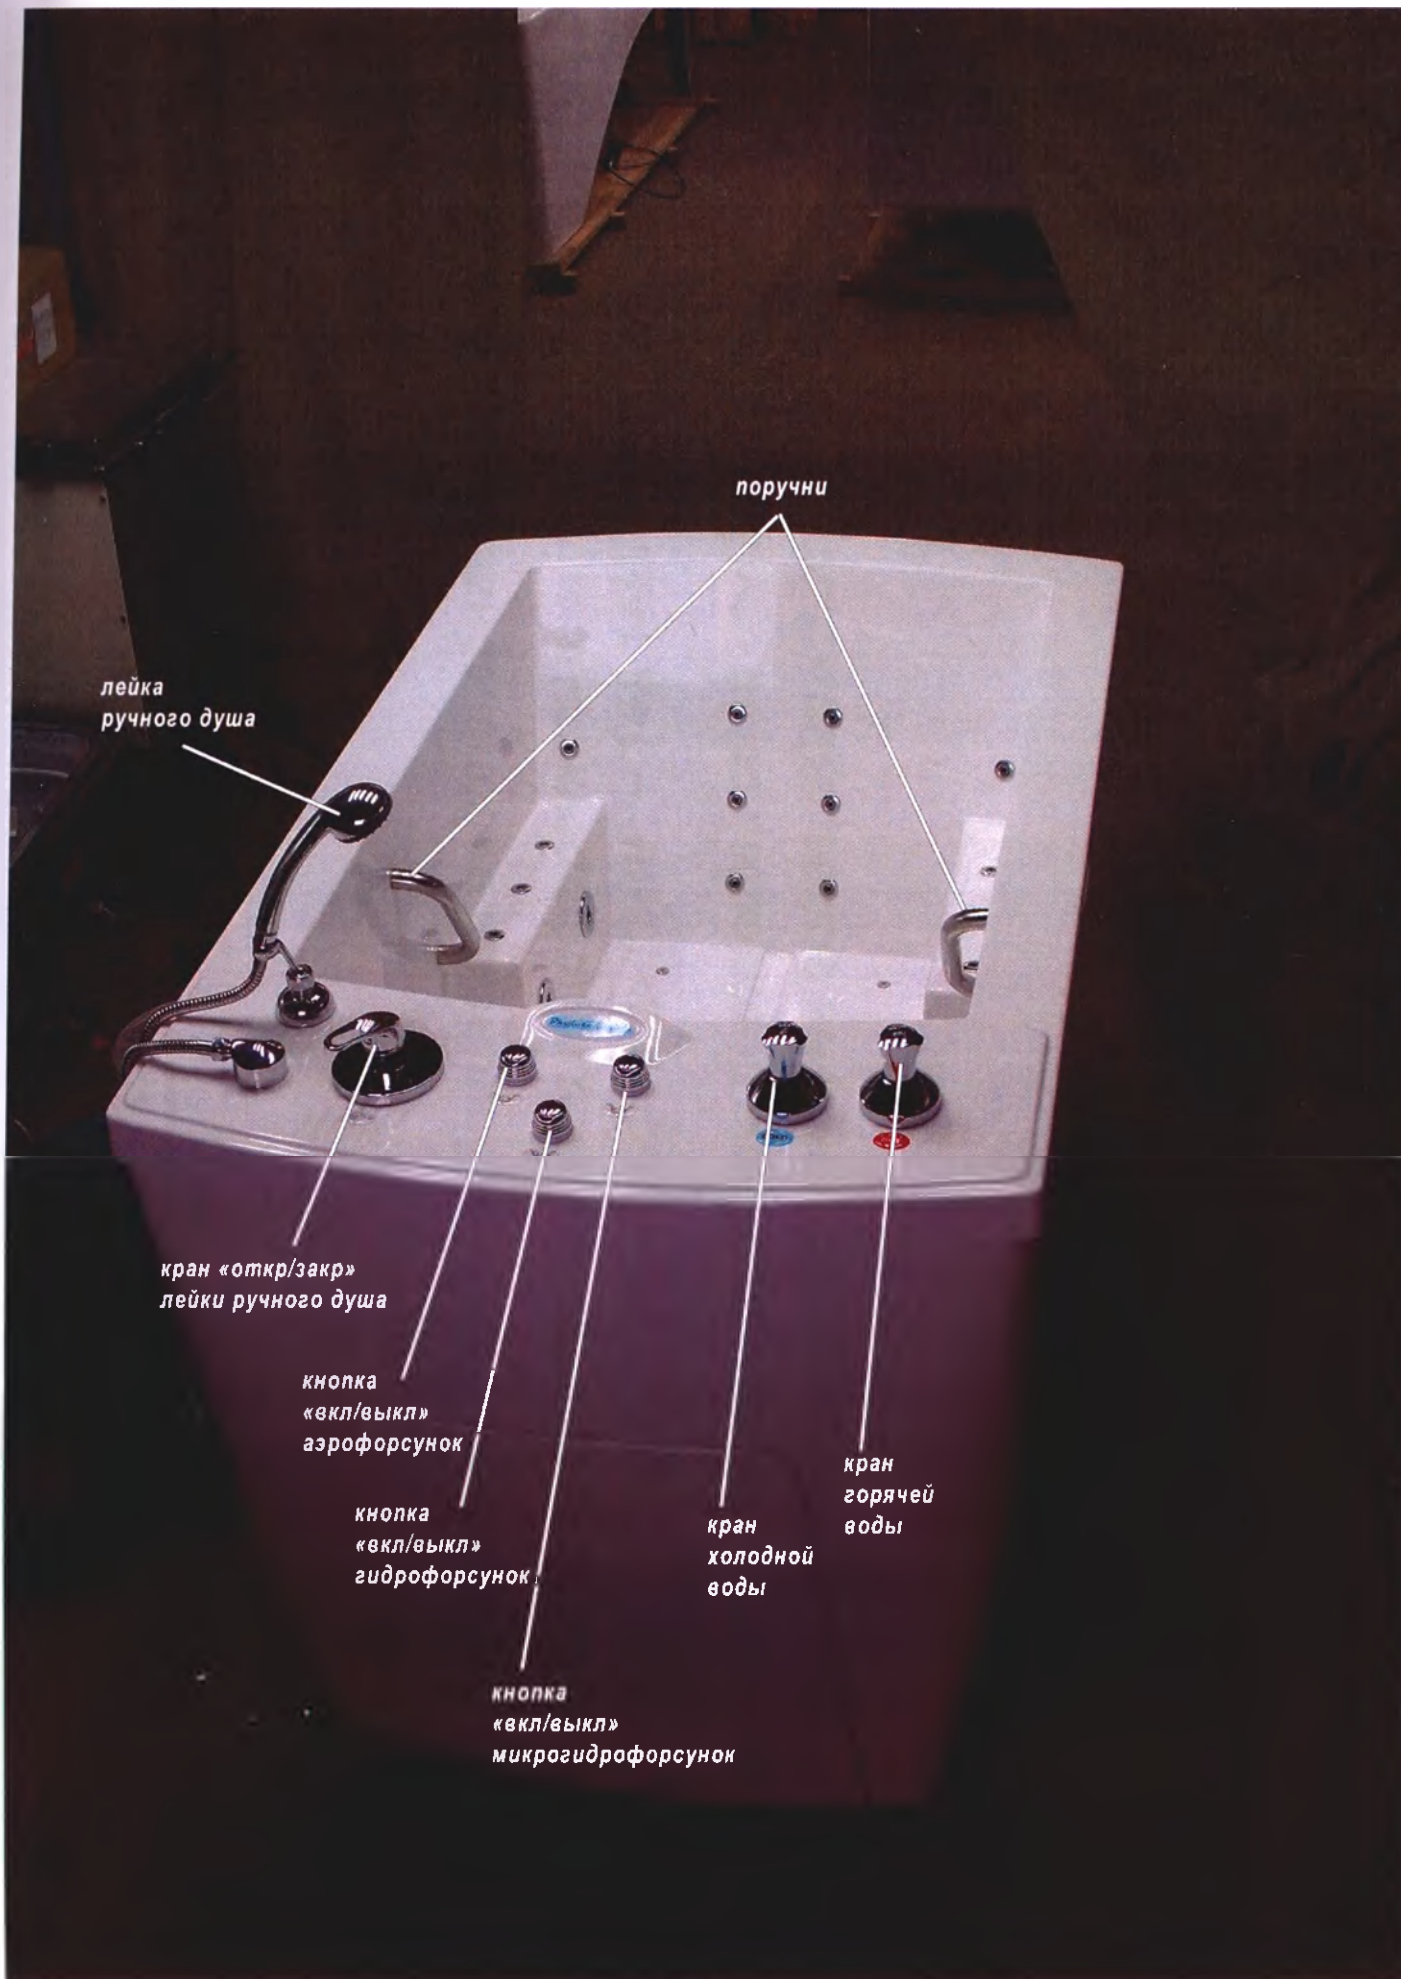


Фото 1 – Общий вид.

модификация – аэрогидромассажная с аэрофорсунками, с микрогидрофорсунками и с гидрофорсунками - 14А 14МГ 10Г

Рхуsіотесhнiса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - аэрогидромассажная с аэрофорсунками,
с микрогидрофорсунками и с гидрофорсунками – 14А 14МГ 10Г

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 3,38



- 001



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



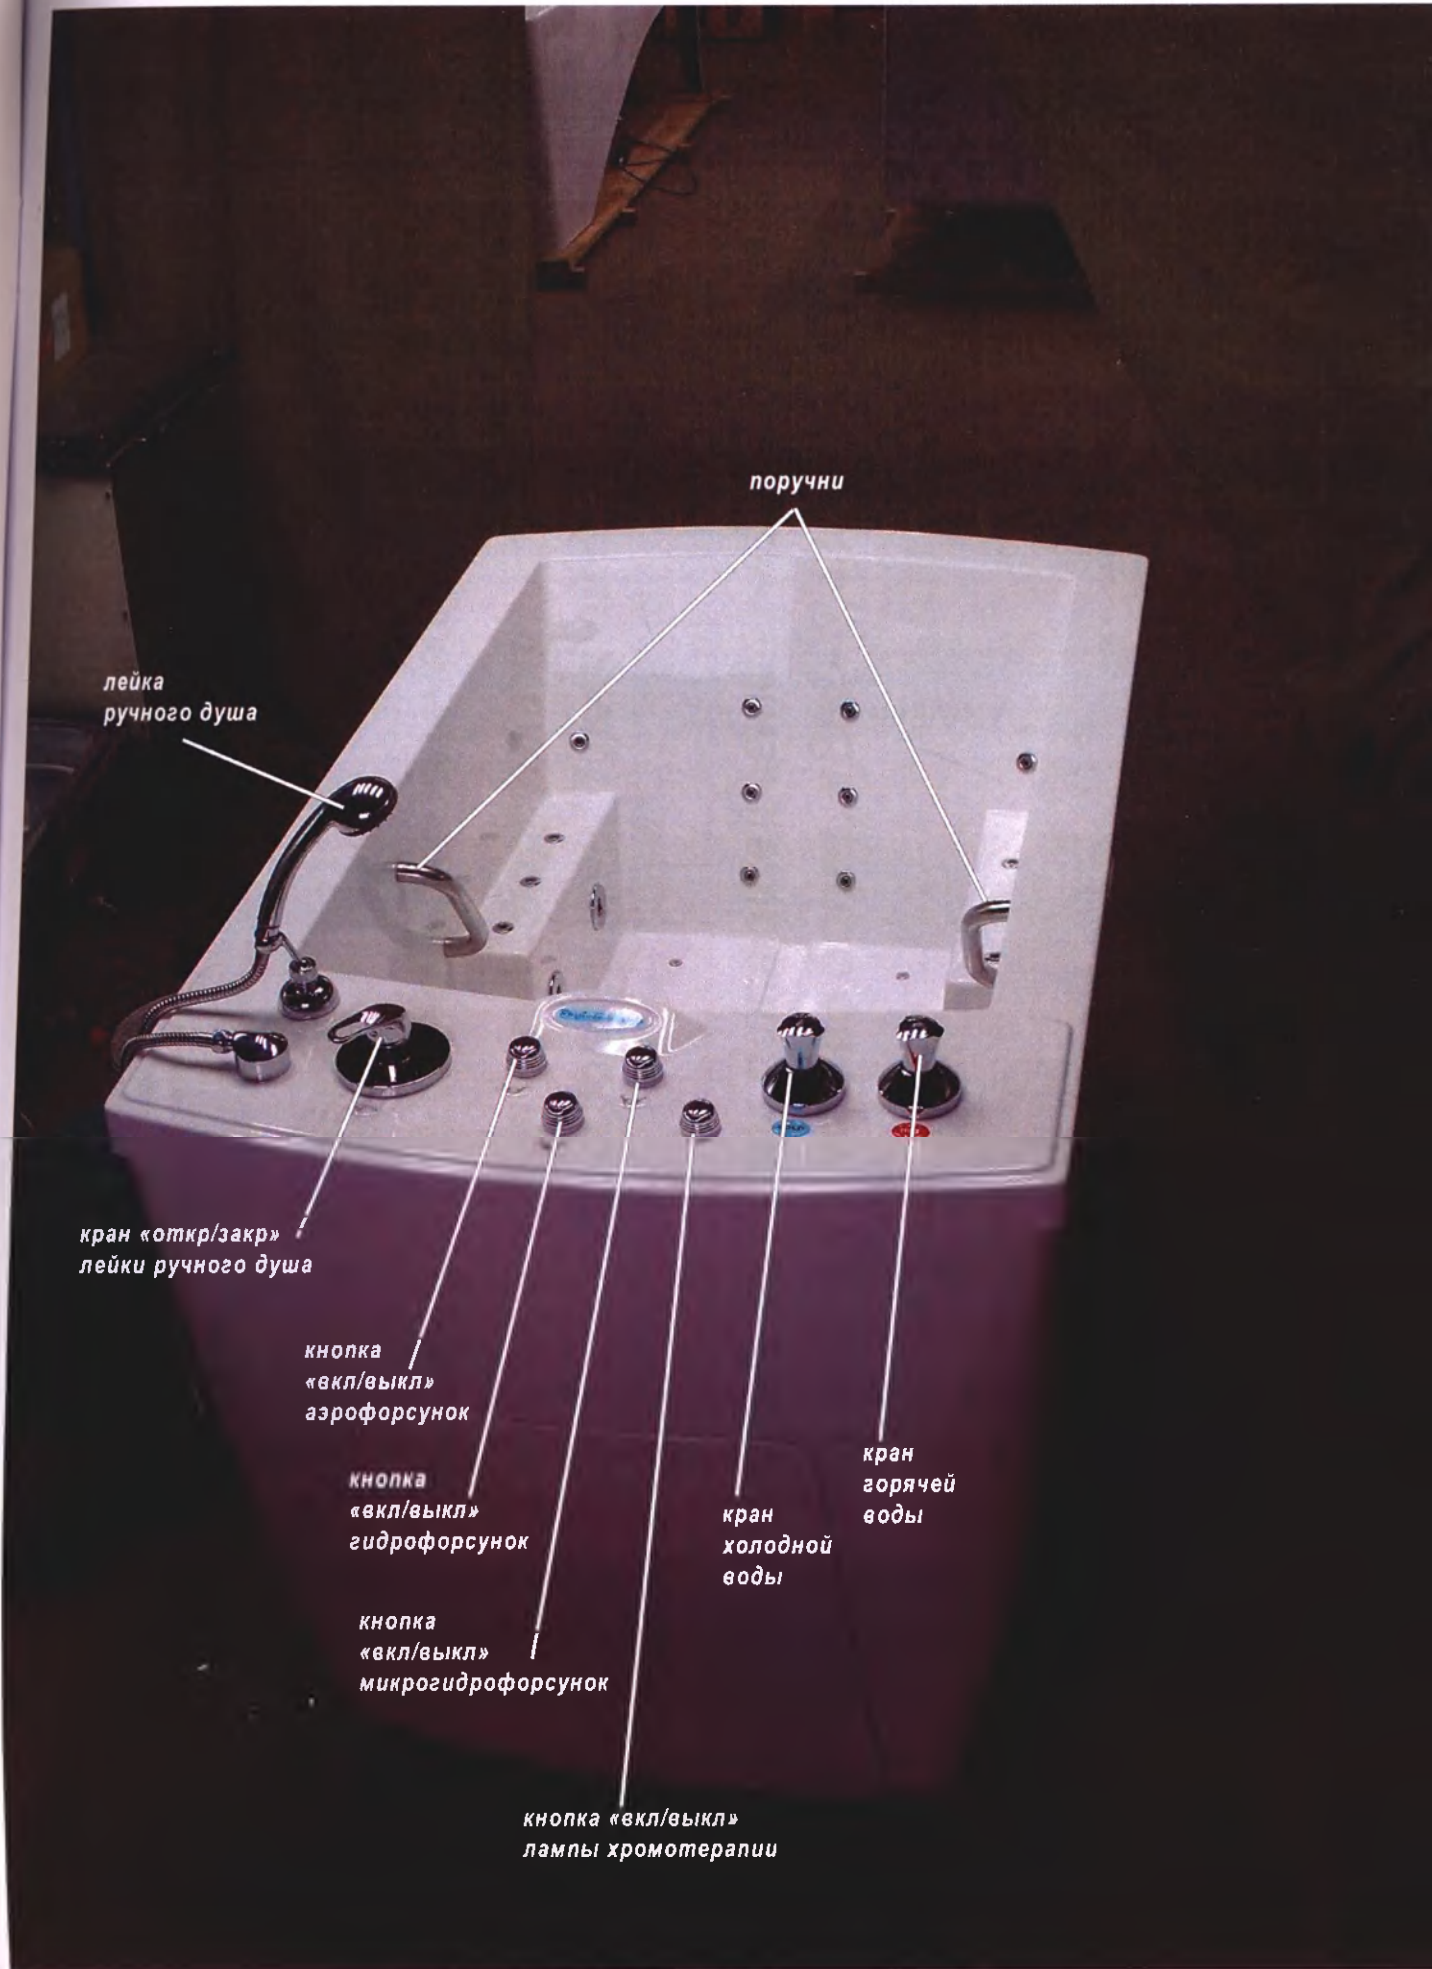


Фото 3 – Общий вид. Исполнение №2.

модификация –аэрогидромассажная с аэрофорсунками, с микрогидрофорсунками, с гидрофор-сункаками и с лампой для хромотерапии - 14А 14МГ 10Г Х

Ркусіотесійіса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - аэрогидромассажная с аэрофорсунками,
с микрогидрофорсунками и с гидрофорсунками, с лампой для хромотерапии
– 14А 14МГ 10Г Х

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 3,43



- 002



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



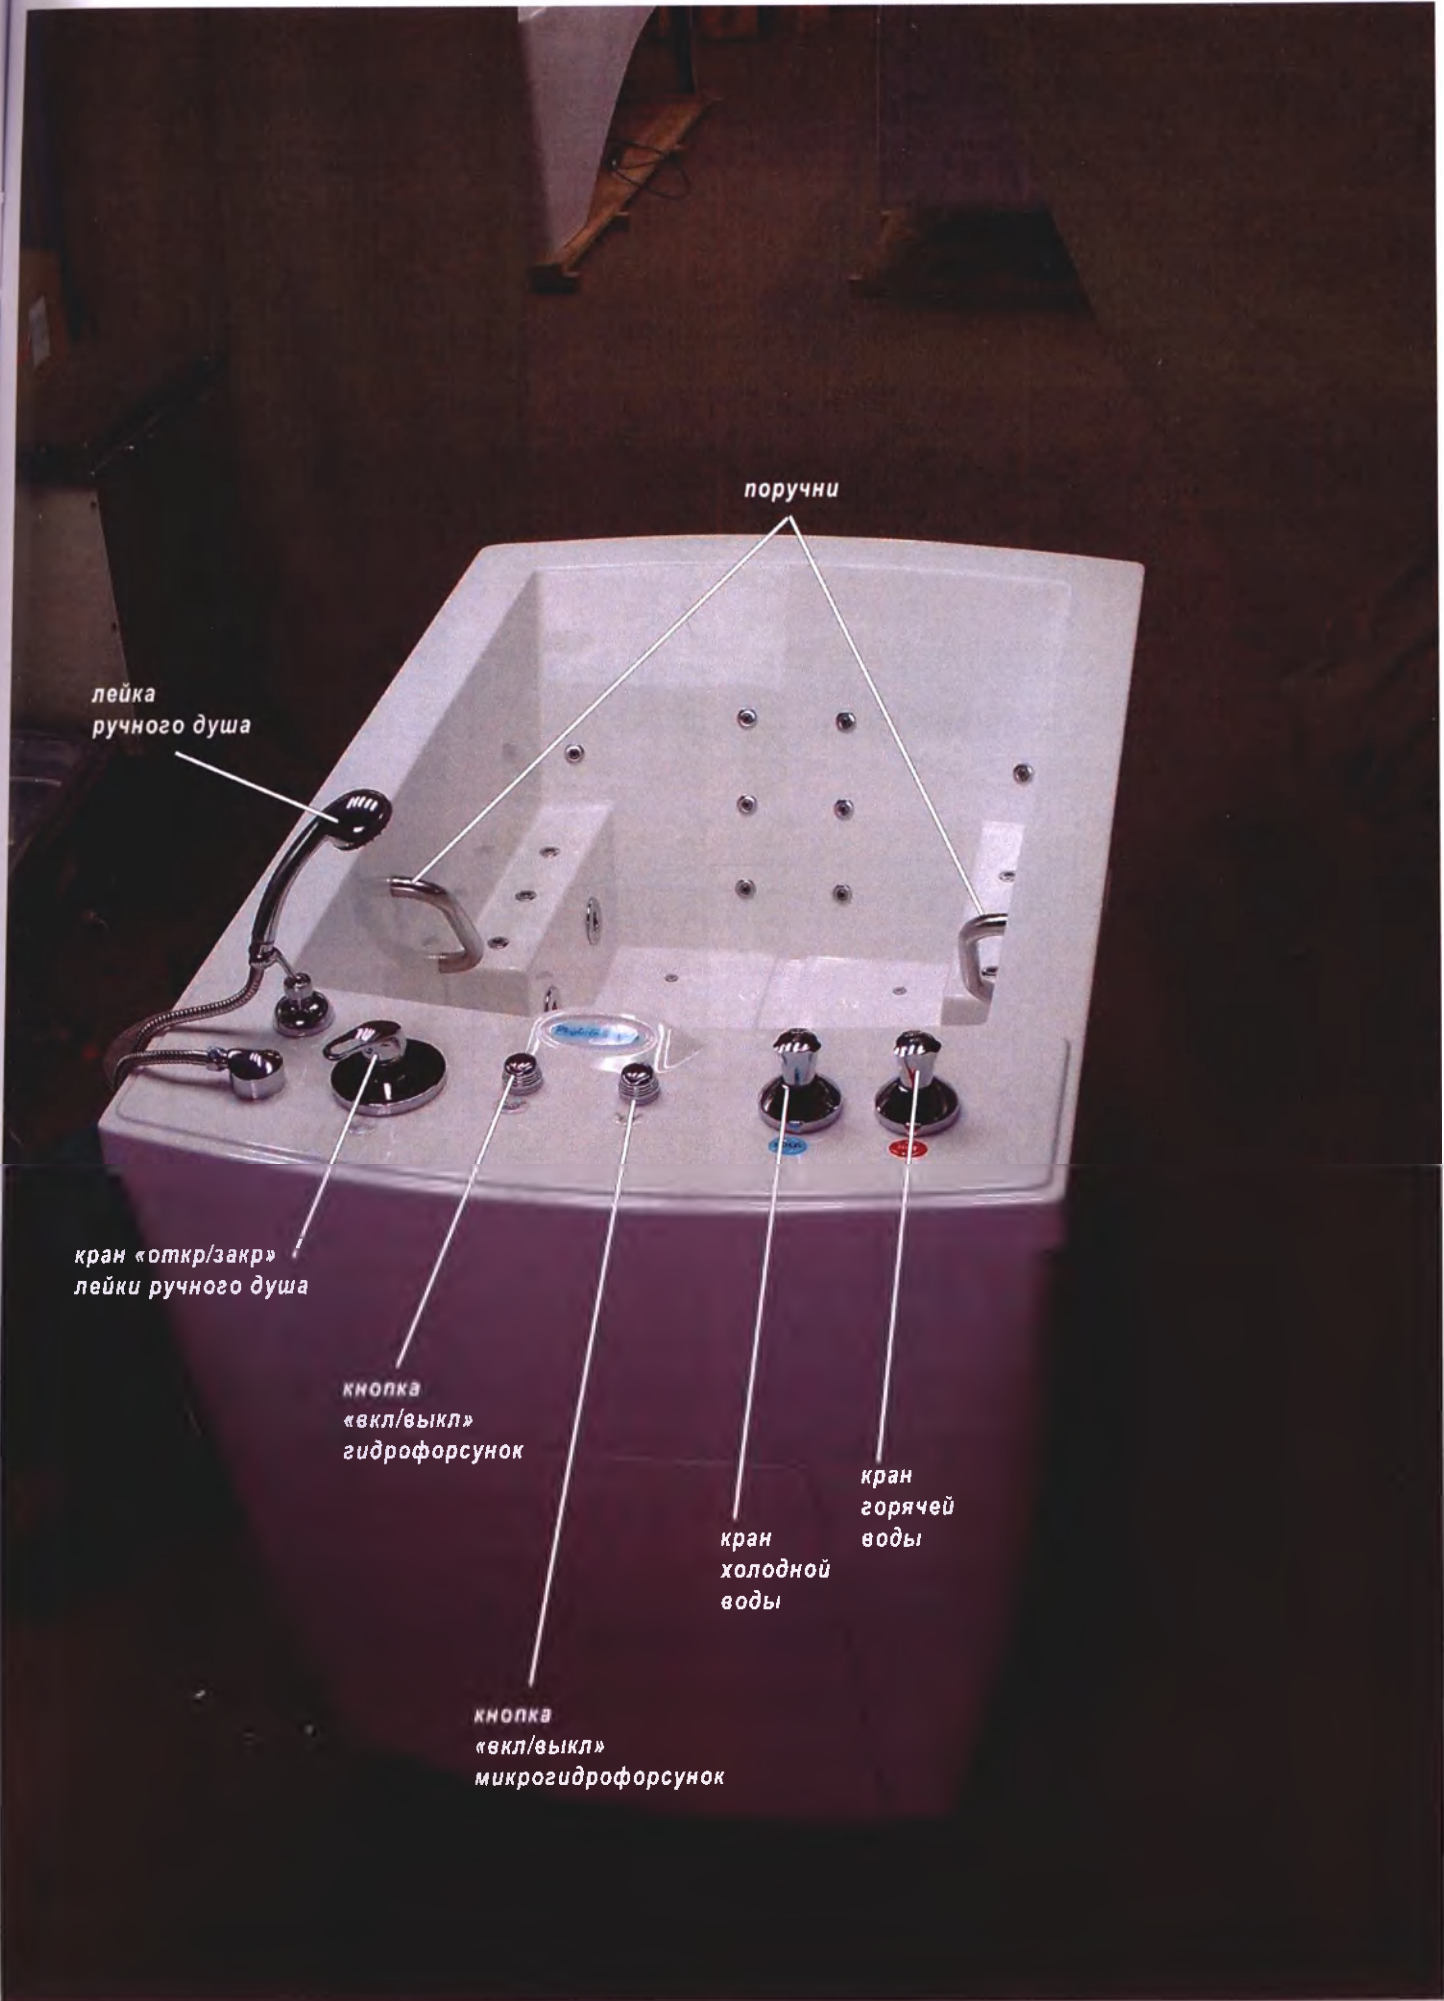


Фото 5 – Общий вид. Исполнение №3.

Physiotecnica




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - гидромассажная с микрогидрофорсунками
и с гидрофорсунками – 14МГ 10Г

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 3,0



- 003



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



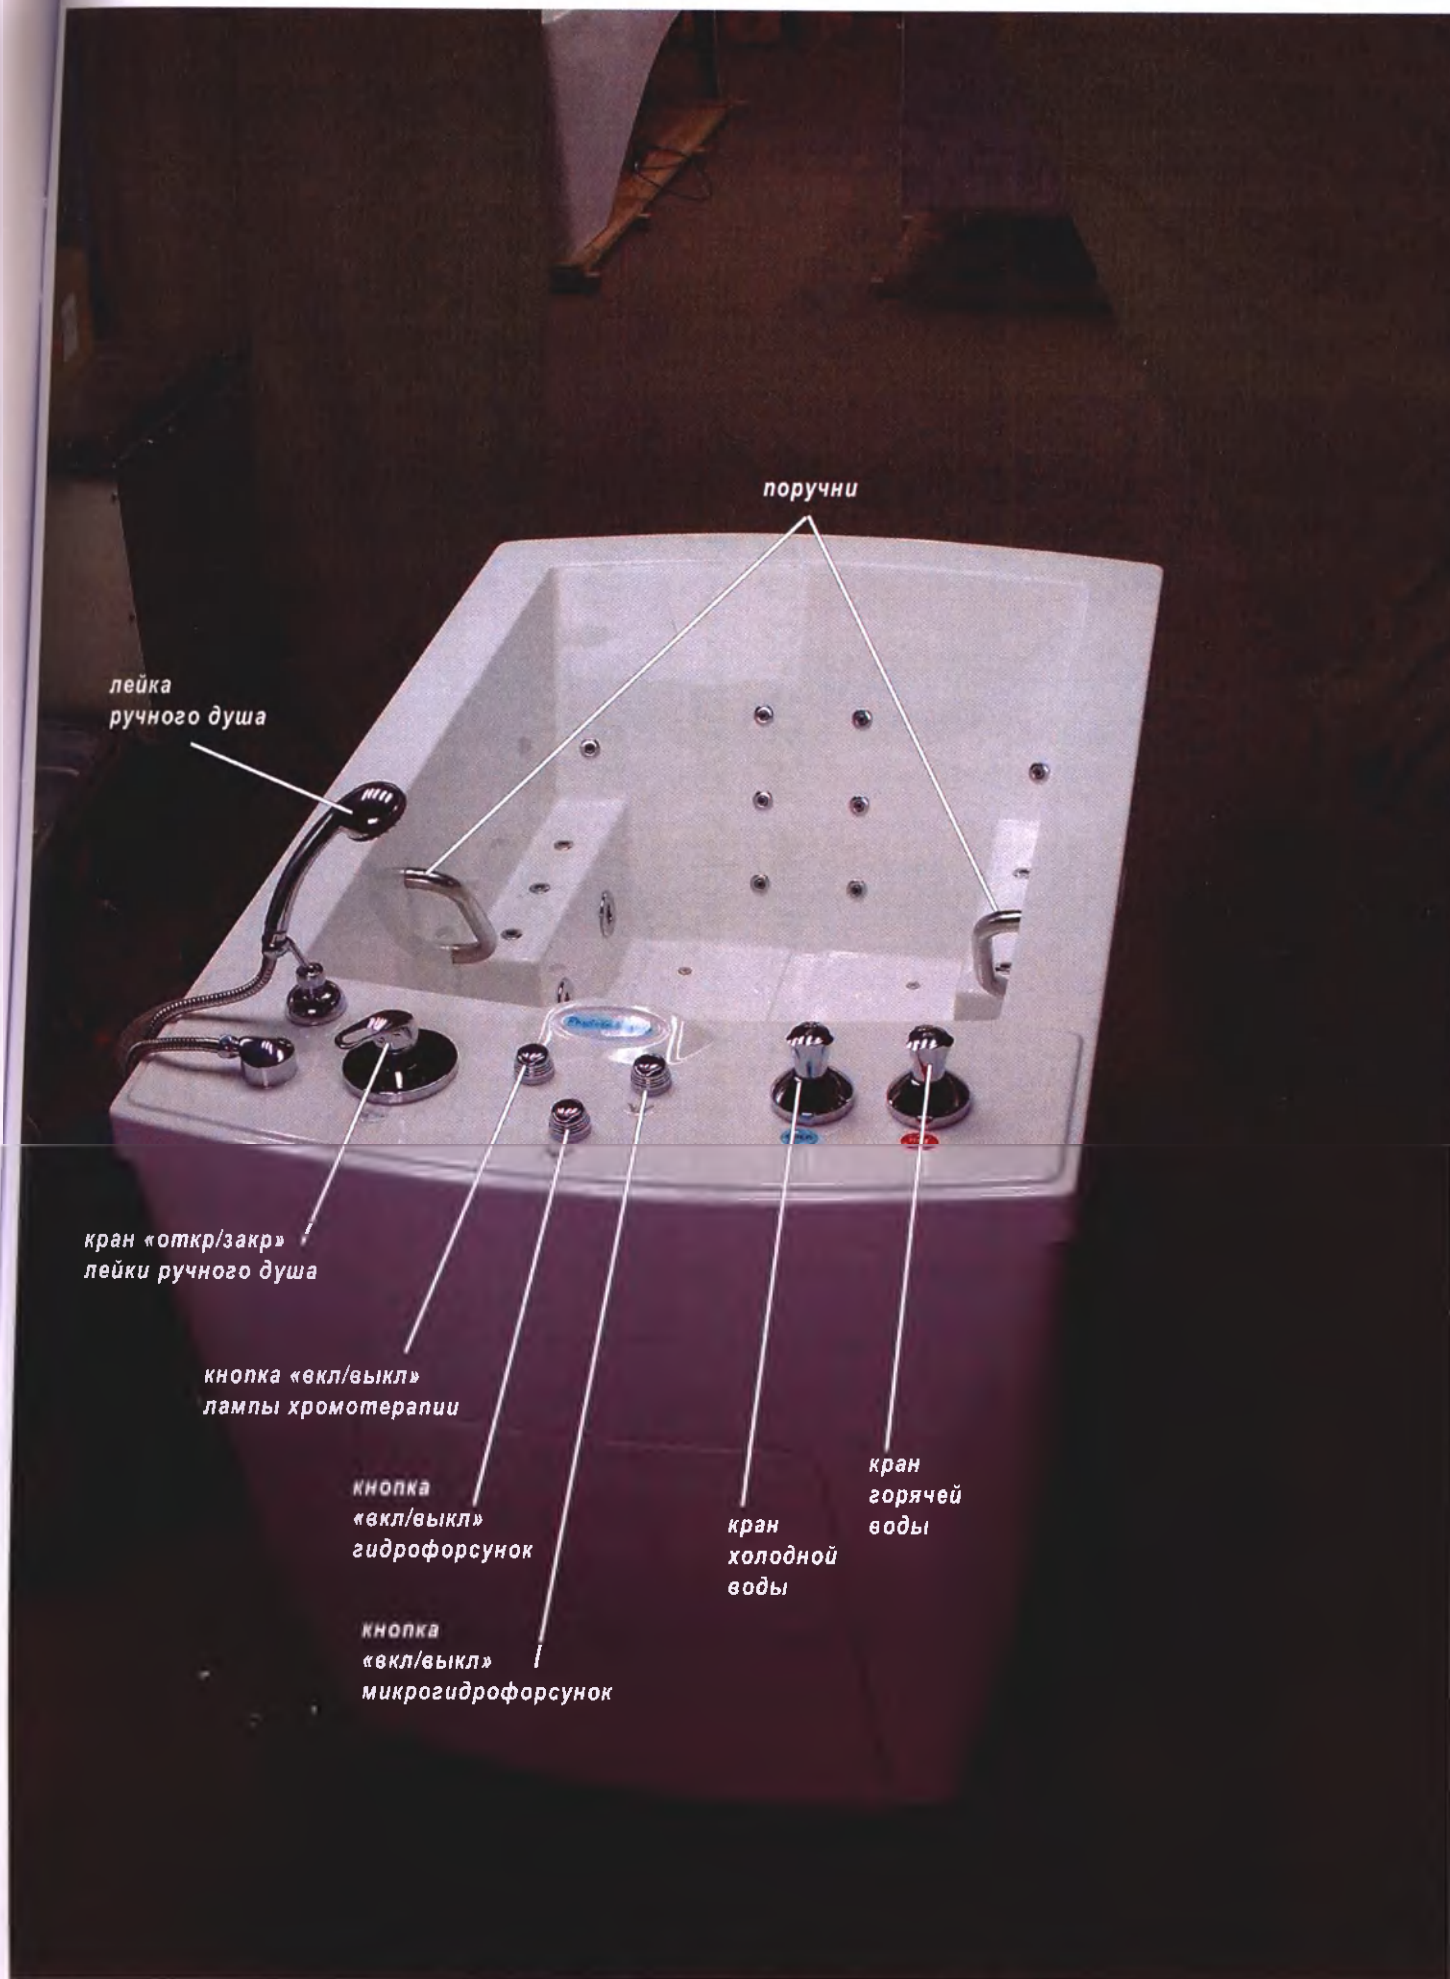


Фото 7 – Общий вид. Исполнение №4.

модификация – гидромассажная с микрогидрофорсунками, с гидрофорсунками и с лампой для хромотерапии - 14МГ 10Г X

Рхуsіотесһнїса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - гидромассажная с микрогидрофорсунками
и с гидрофорсунками и с лампой для хромотерапии – 14МГ 10Г Х

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm22)$ В, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 3,05



- 004



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



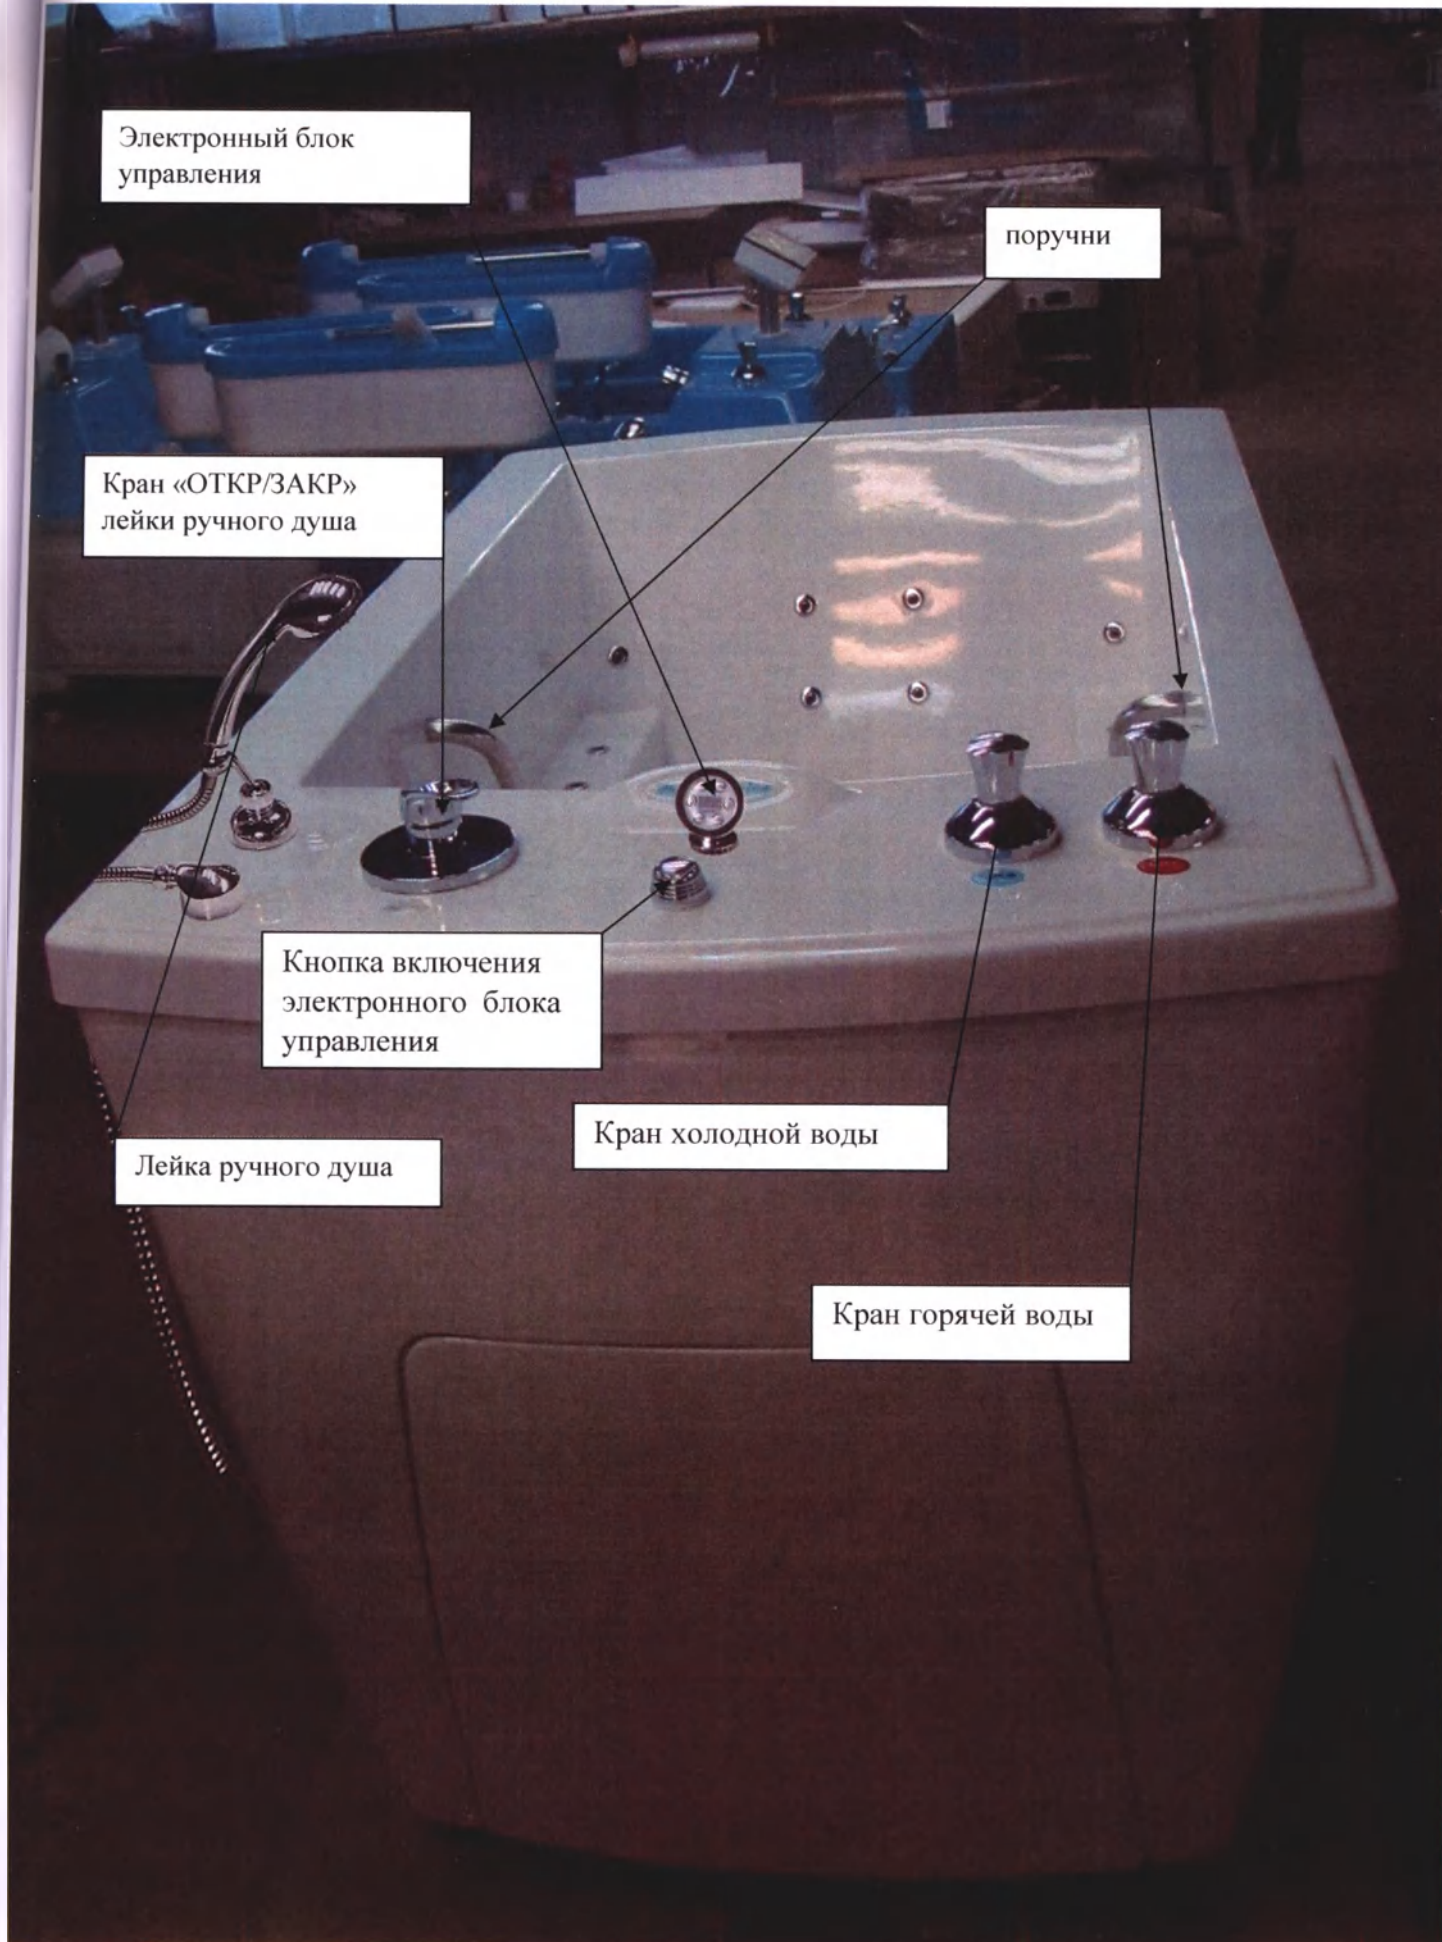


Фото 9 – Общий вид. Исполнение №5

модификация – аэрогидромассажная с аэрофорсунками, с микрогидрофорсунками, с гидрофорсунками, с лампой для хромотерапии и с электронным блоком для управления процедурами (SPA) –14А 14МГ 10Г Х Э

Ркусіотесніса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - аэрогидромассажная с аэрофорсунками,
с микрогидрофорсунками и с гидрофорсунками, с лампой для хромотерапии
и с электронным блоком управления процедурами (SPA) – 14А 14МГ 10Г Х Э

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm22)$ В, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 3,44



- 008



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



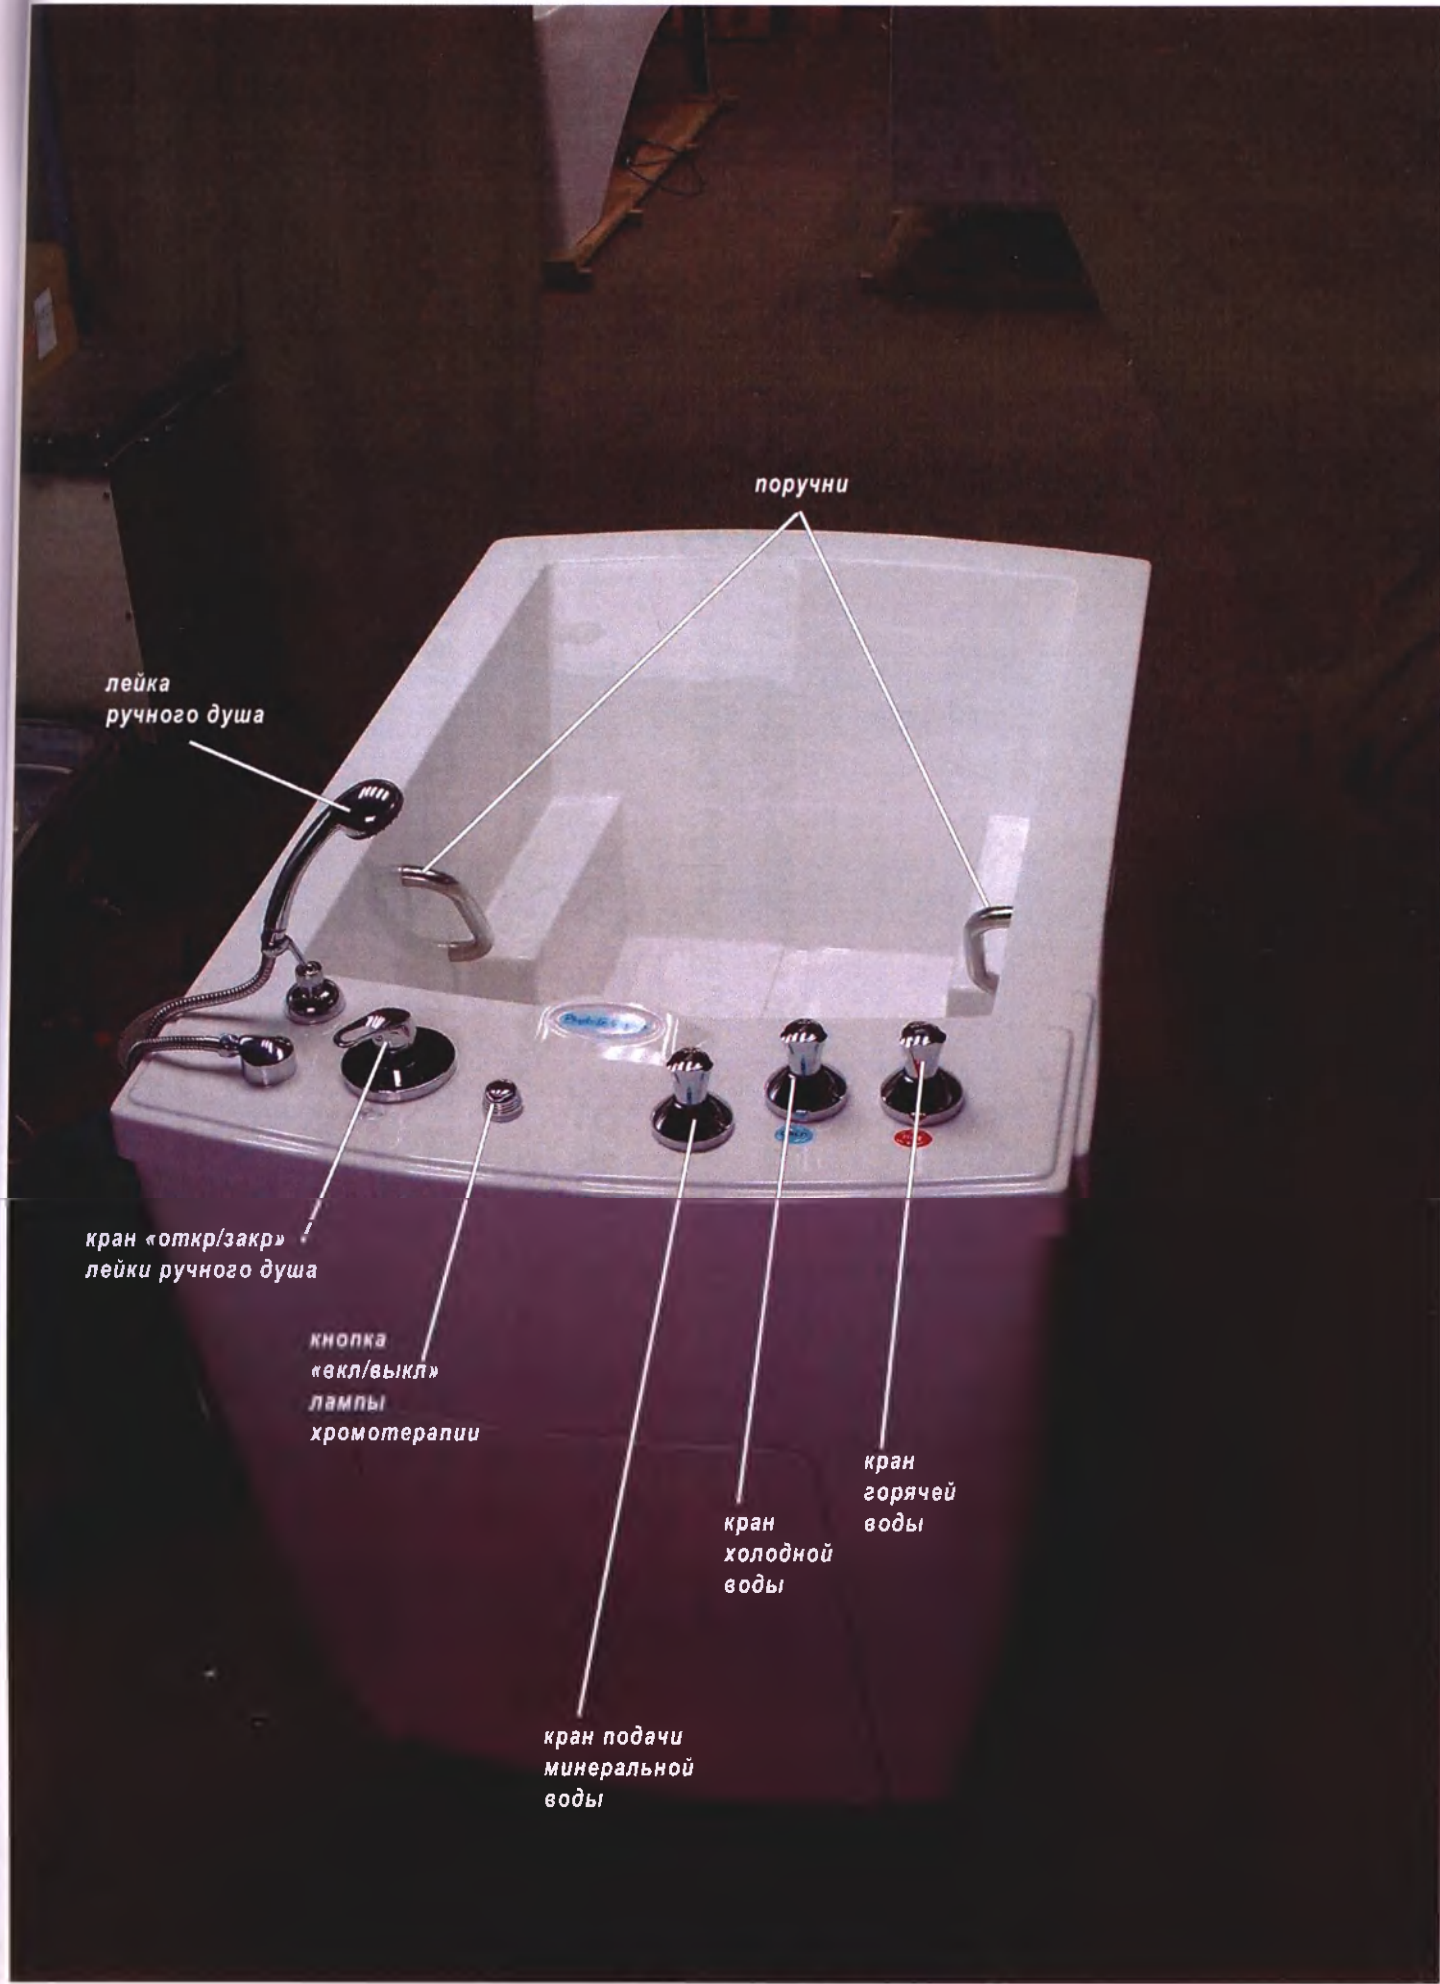


Фото 11 – Общий вид. Исполнение №6.

модификация – бальнеологическая с лампой для хромотерапии и с краном подачи минеральной воды - Б X KMB

Рхусіотесійніса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - бальнеологическая с лампой для хромотерапии и с краном подачи минеральной воды – Б Х КМВ

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm22)\text{В}$, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 0,05



- 005



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



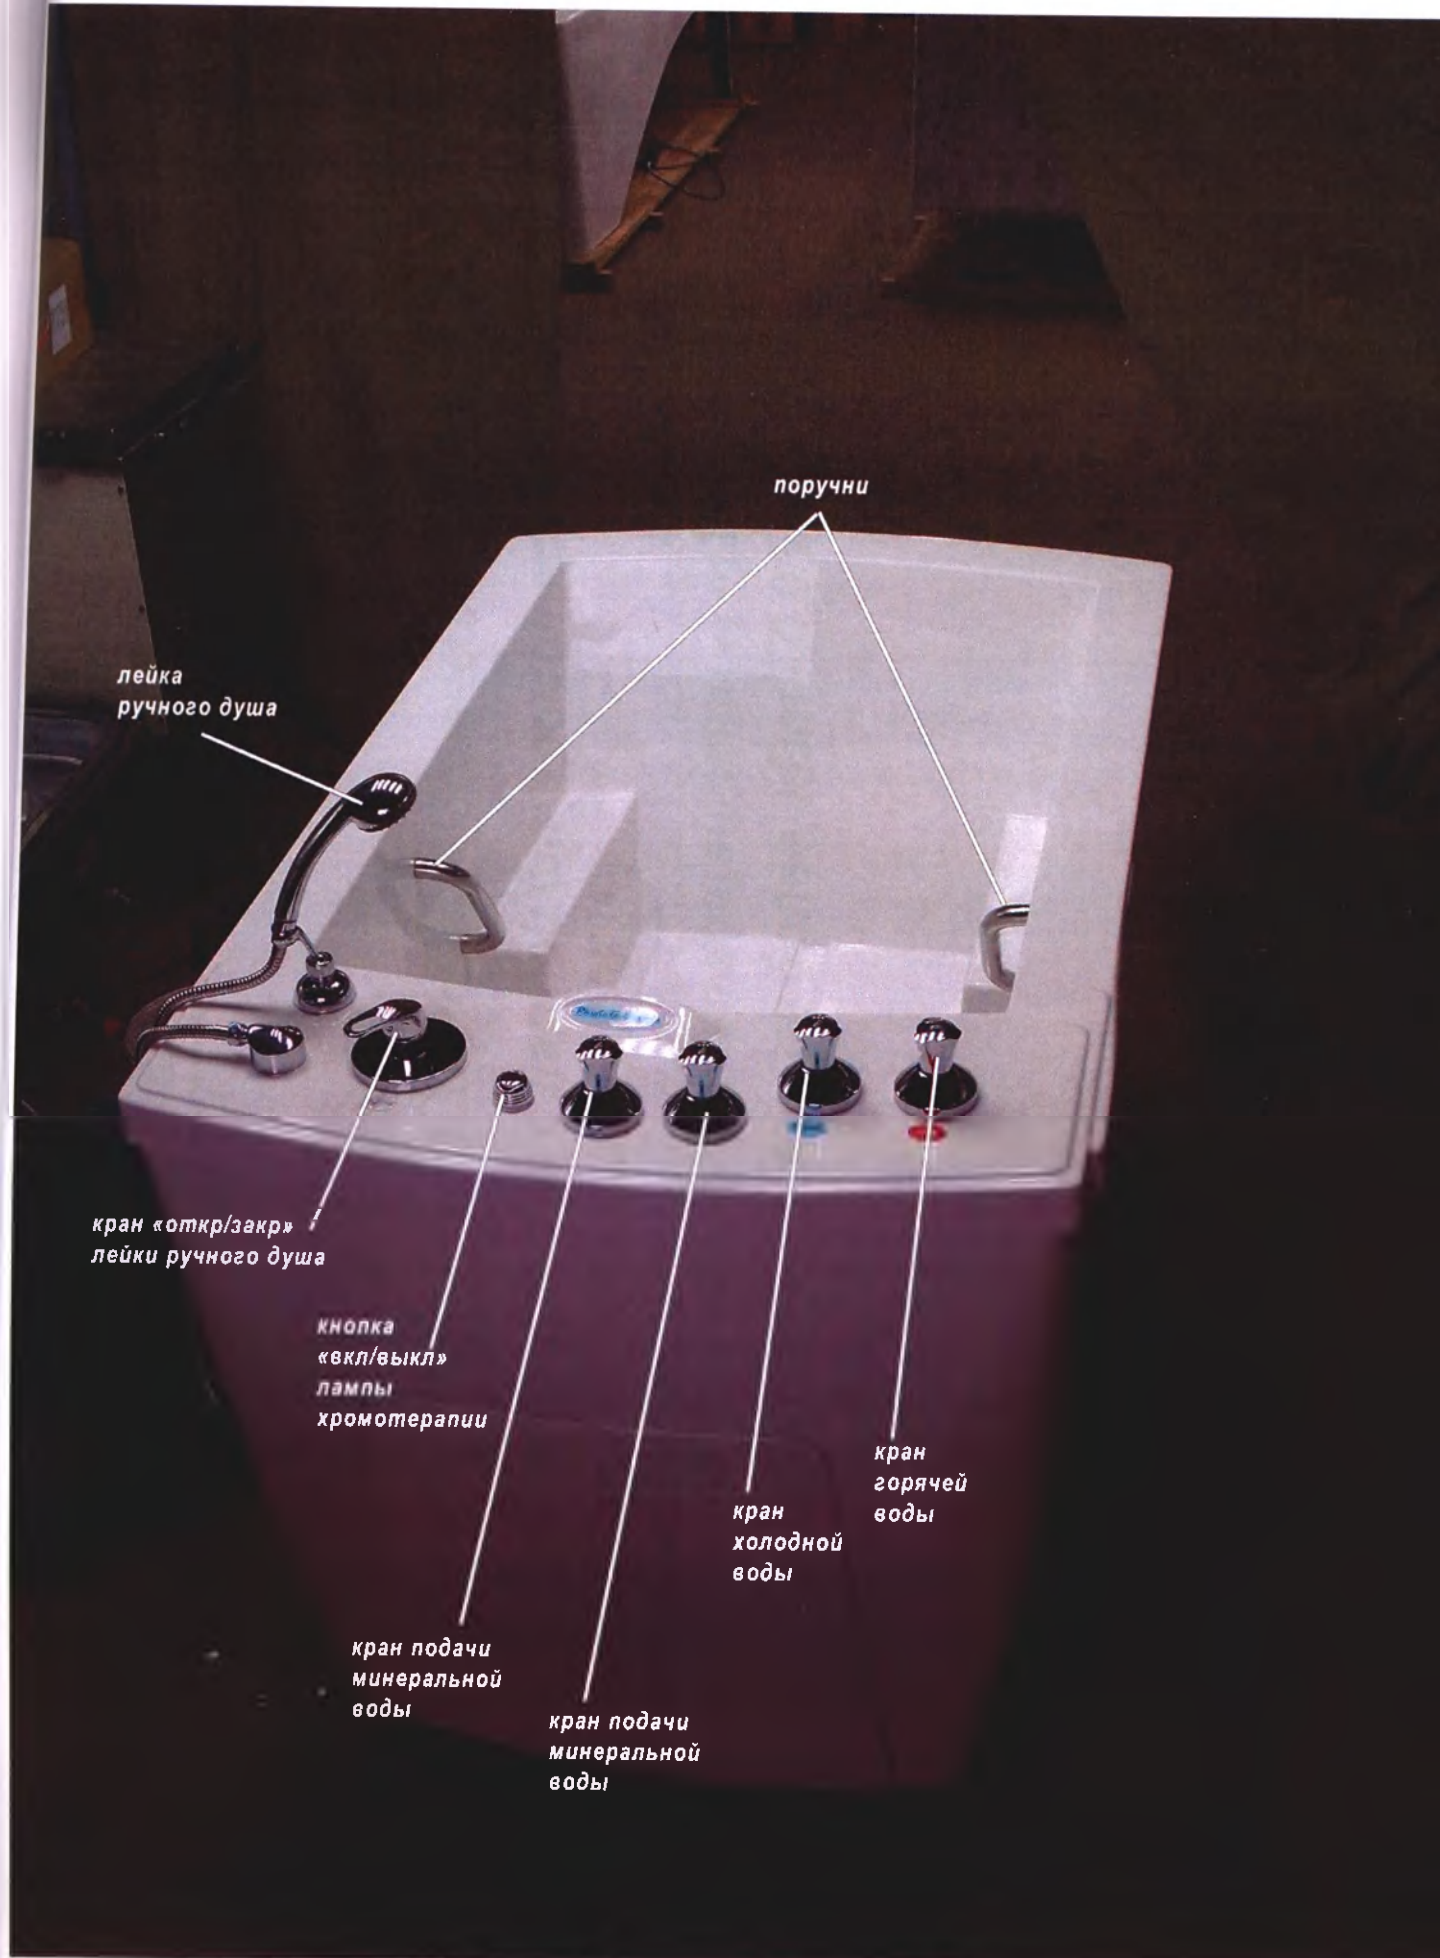


Фото 13 – Общий вид. Исполнение №7.

модификация - бальнеологическая с лампой для хромотерапии и с кранами подачи минеральной воды - Б X 2КМВ

Рyсiотесhнiсa




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»


Модификация - бальнеологическая с лампой для хромотерапии и с кранами подачи минеральной воды – Б X 2КМВ

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц

Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 0,05



- 006



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5



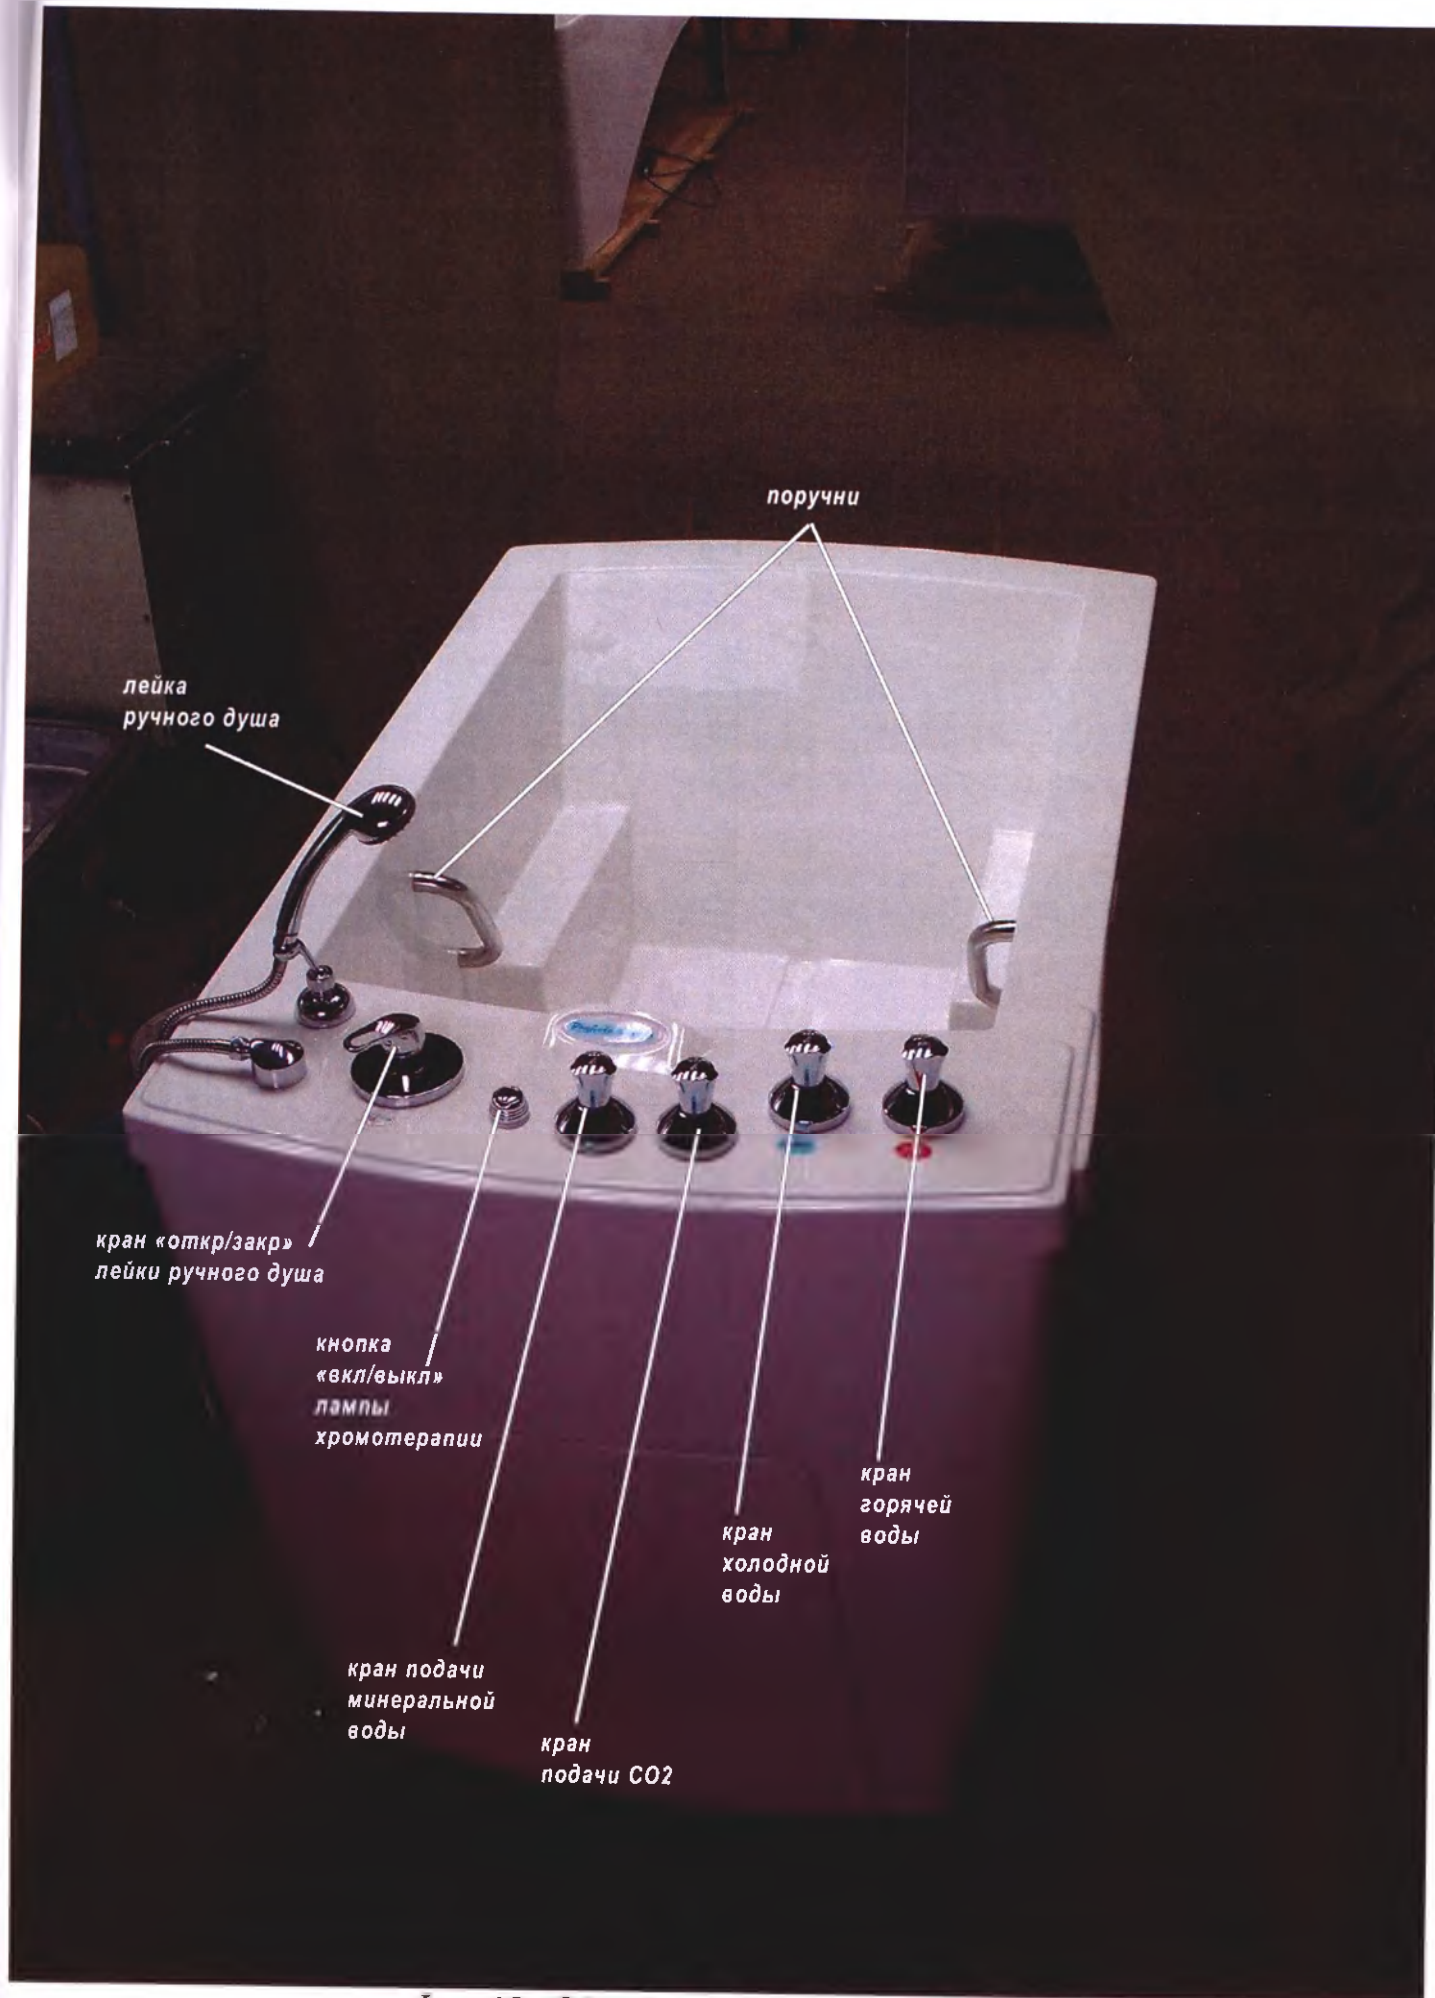


Фото 15 – Общий вид. Исполнение №8.

модификация – бальнеологическая с лампой для хромотерапии, с краном подачи минеральной воды и с краном подачи CO₂ - Б X KMB KCO₂


Ркусіотесніса




- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: «Ванна медицинская водолечебная сидячая «ОНЕГА»
Модификация - бальнеологическая с лампой для хромотерапии, с краном подачи минеральной воды и с краном подачи CO₂ – Б X КМВ КСО₂

Номинальное напряжение и частота питающей сети - $\sim(220\pm 22)$ В, 50 Гц
Потребляемая от сети мощность, не более, кВт - 0,05



- 007



- 2018г (II квартал)

ТУ 26.60.13-021-76228444-2017



IPX5





Прошито и пронумеровано

Кол-во: 18 листов

Подпись (восстановитель)

Ген. дир. Лапаев А.Е.

