






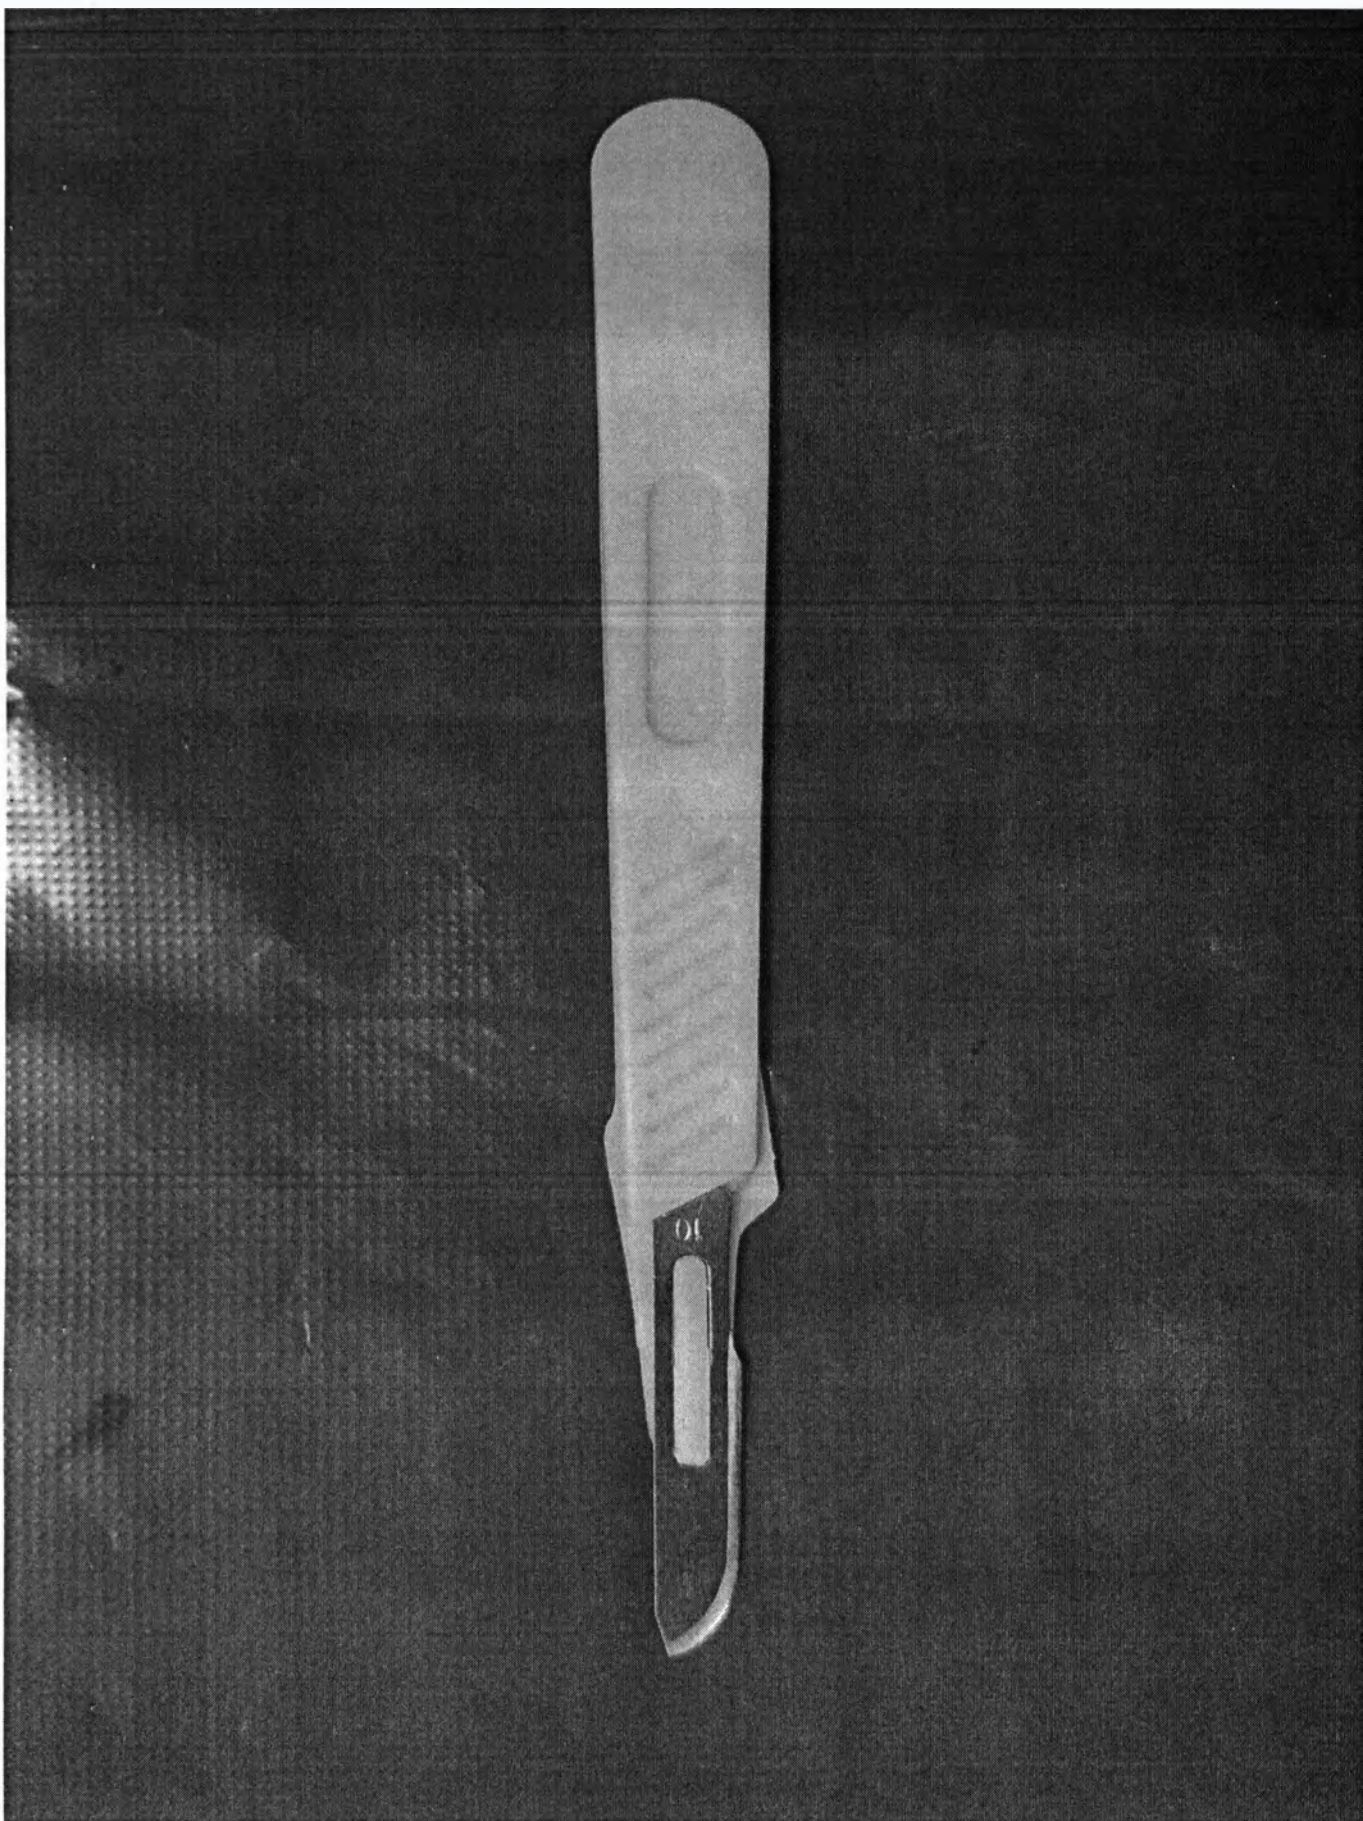


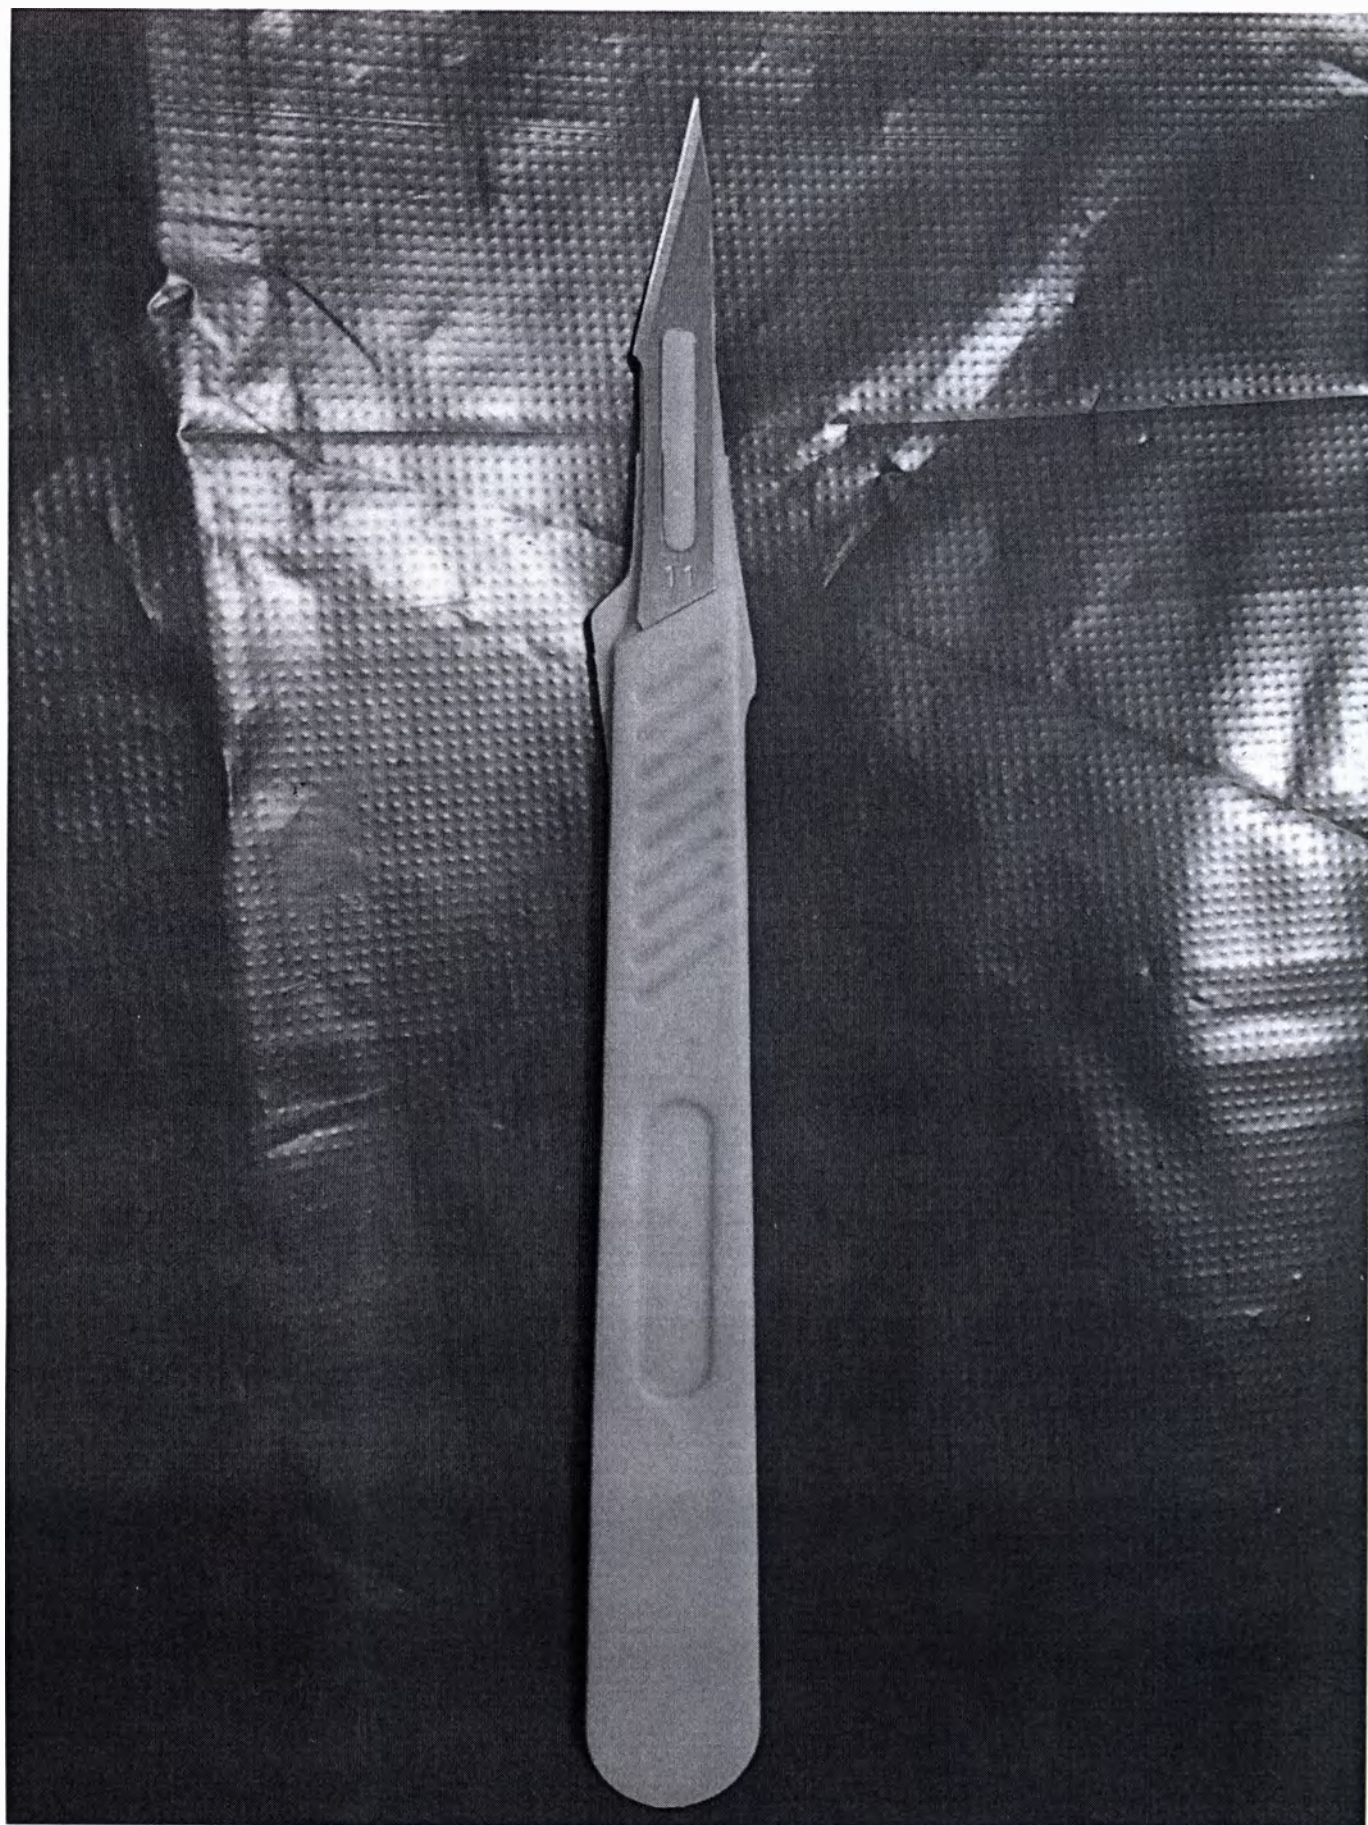


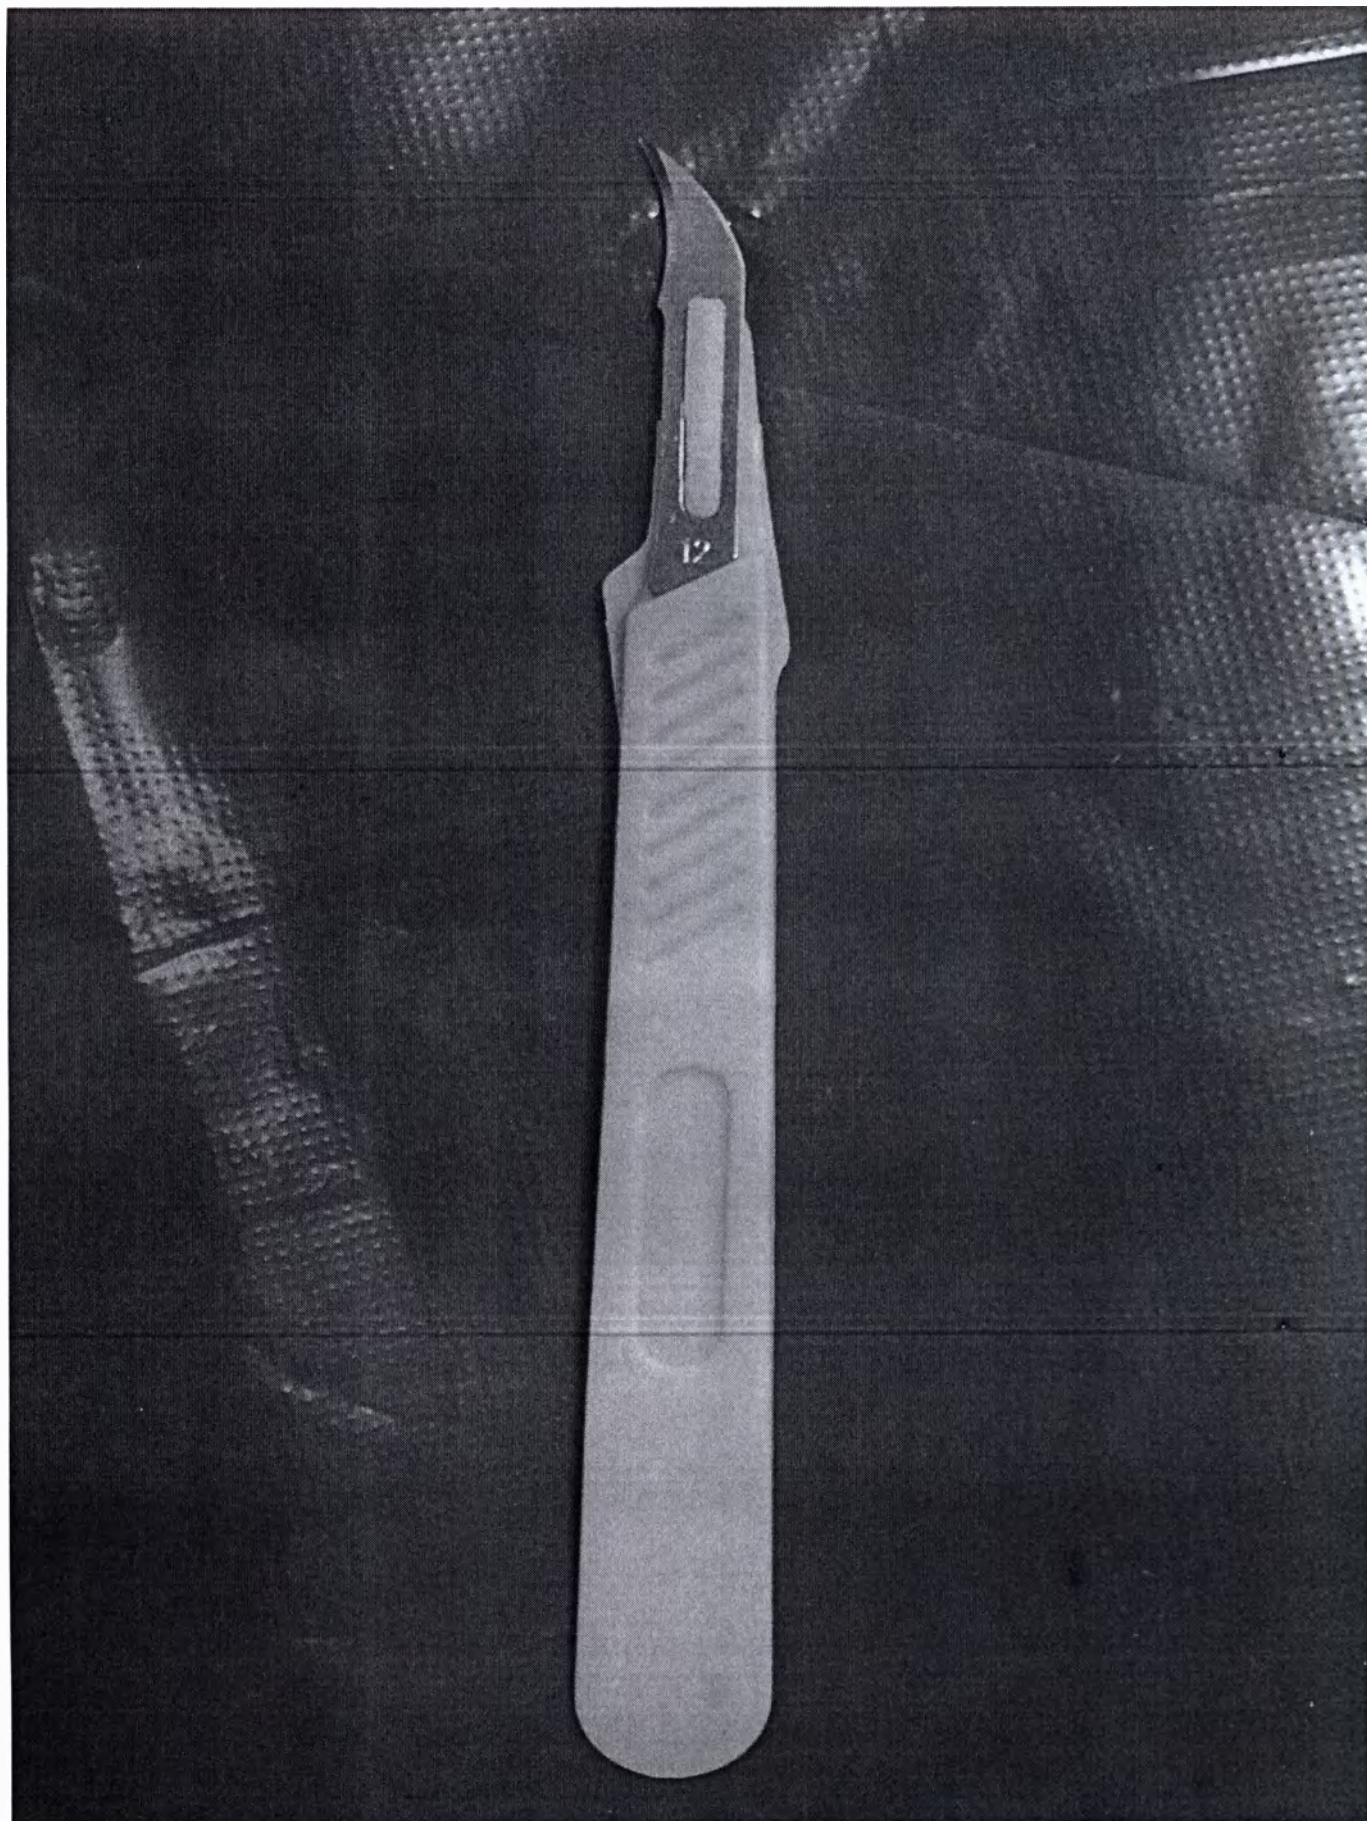


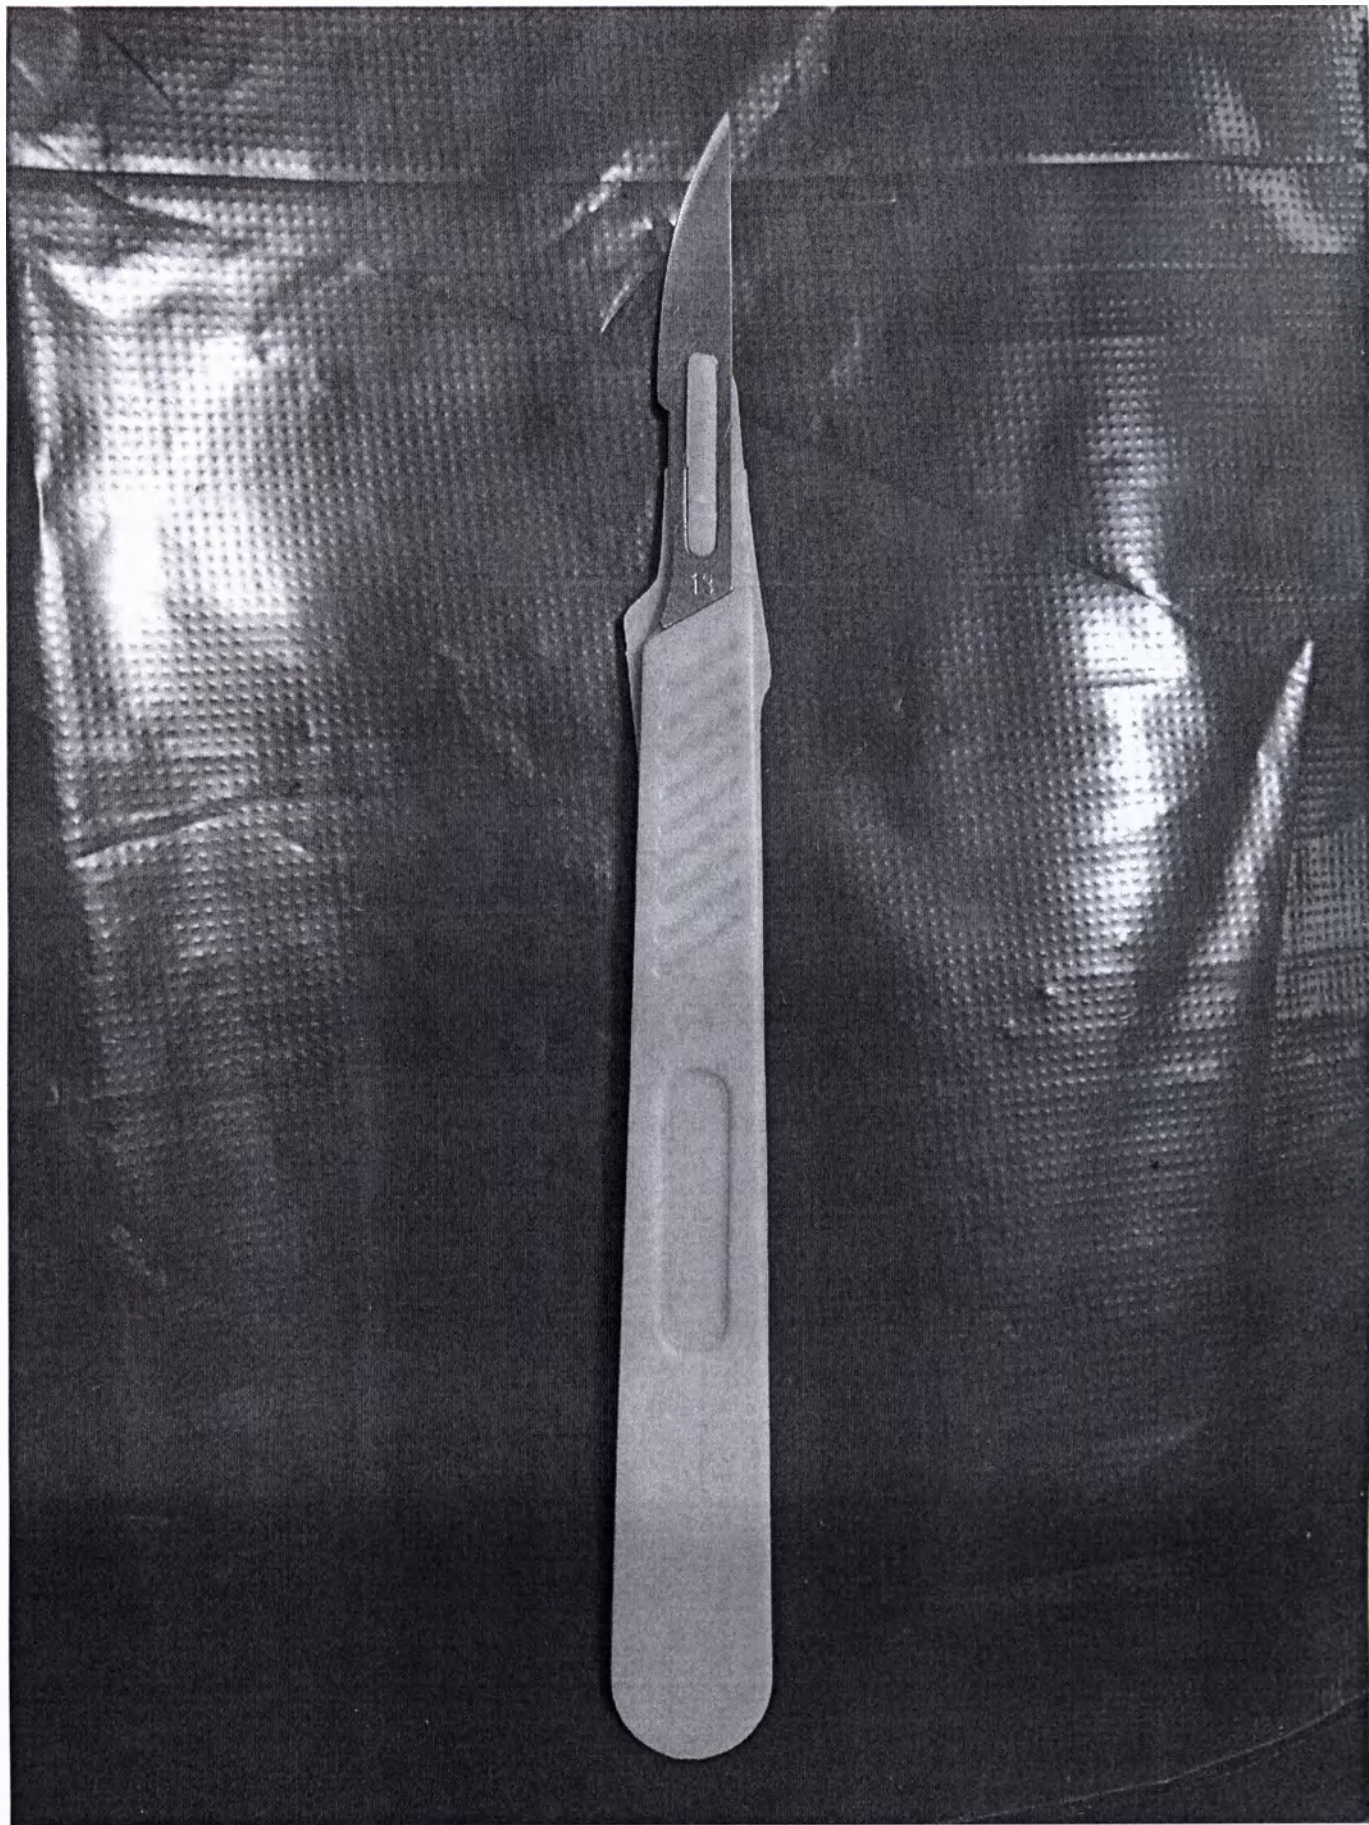


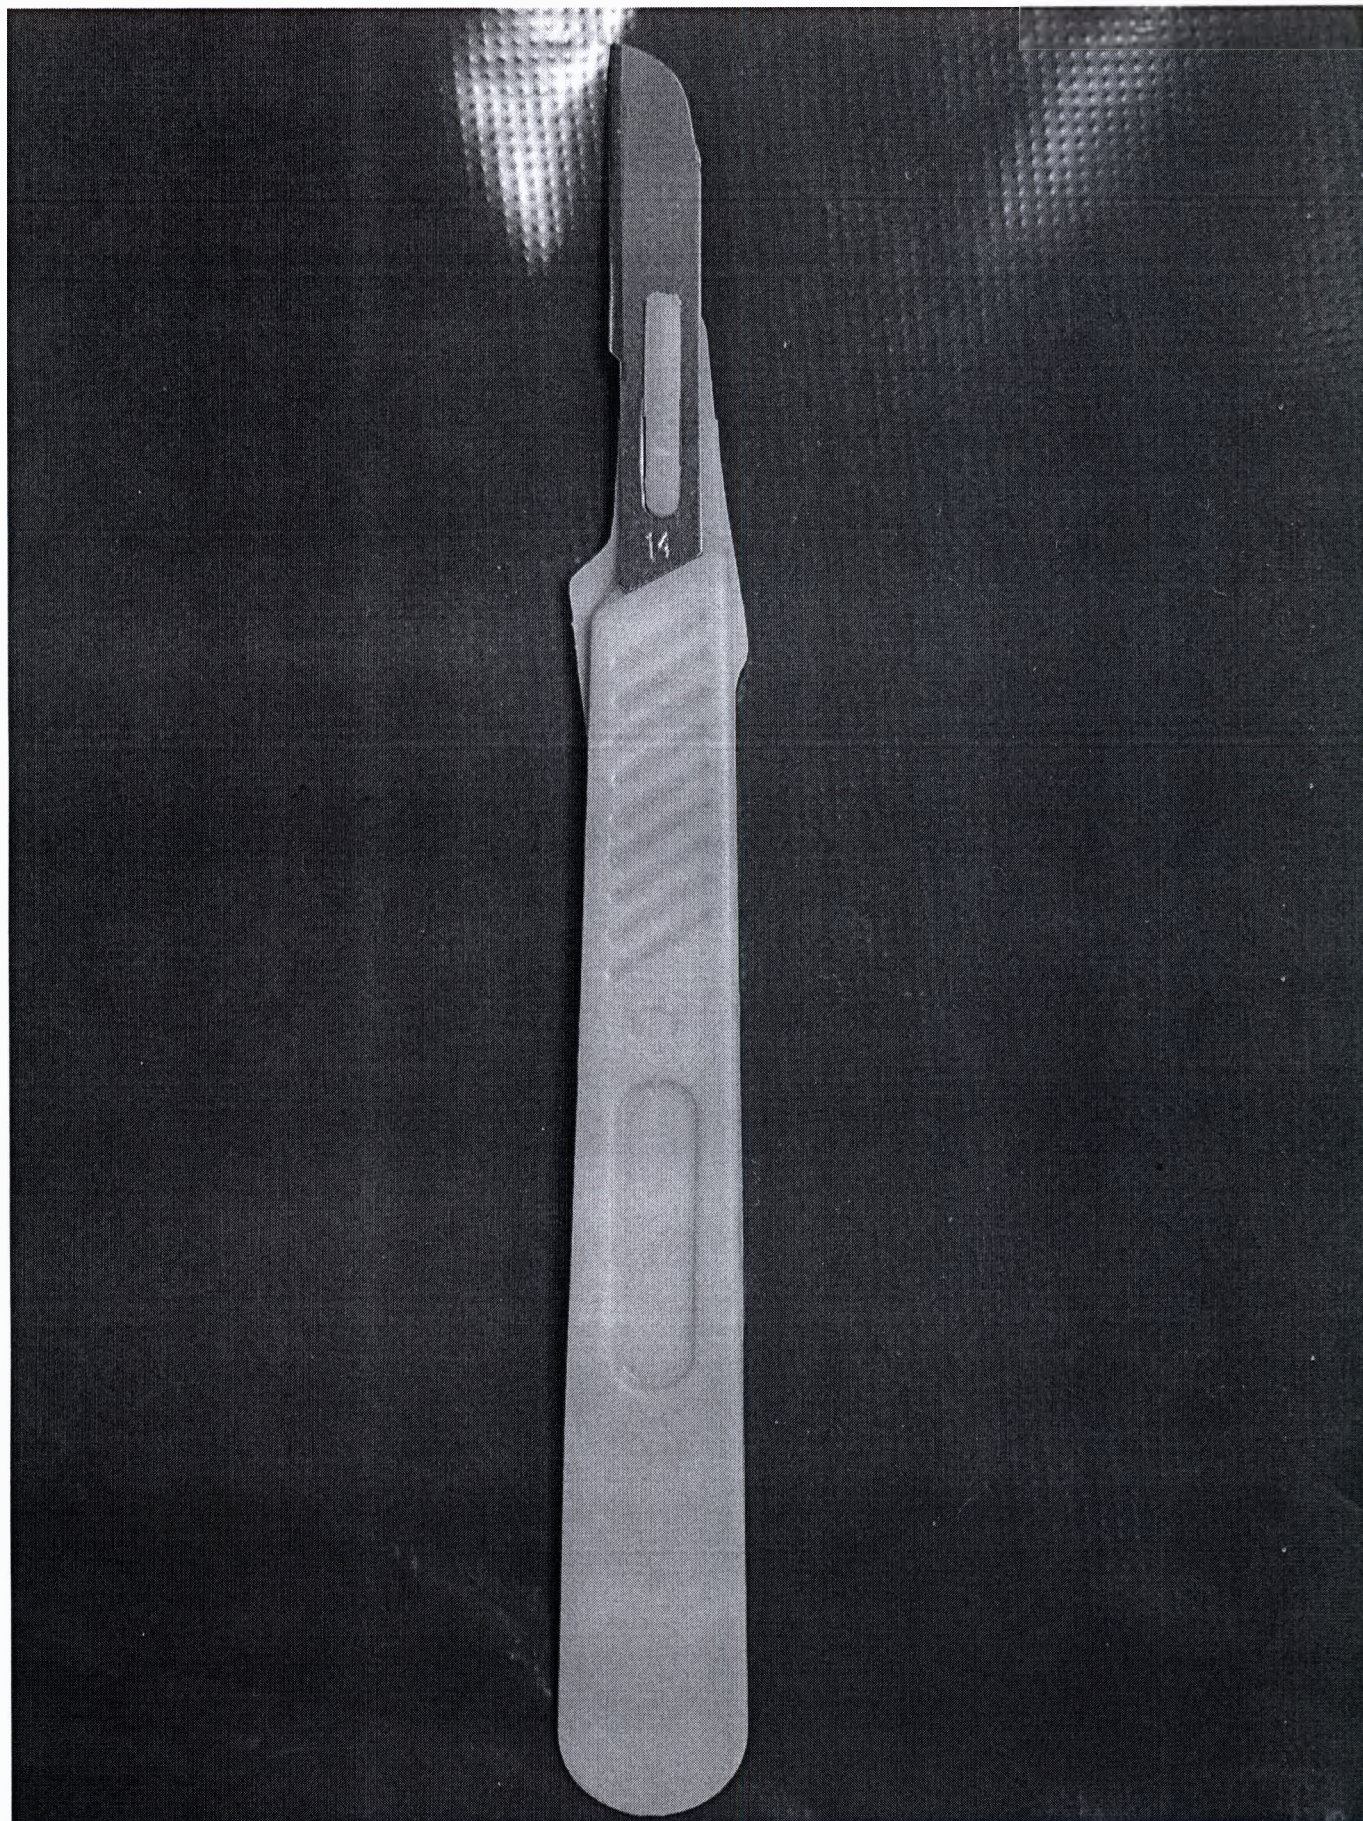


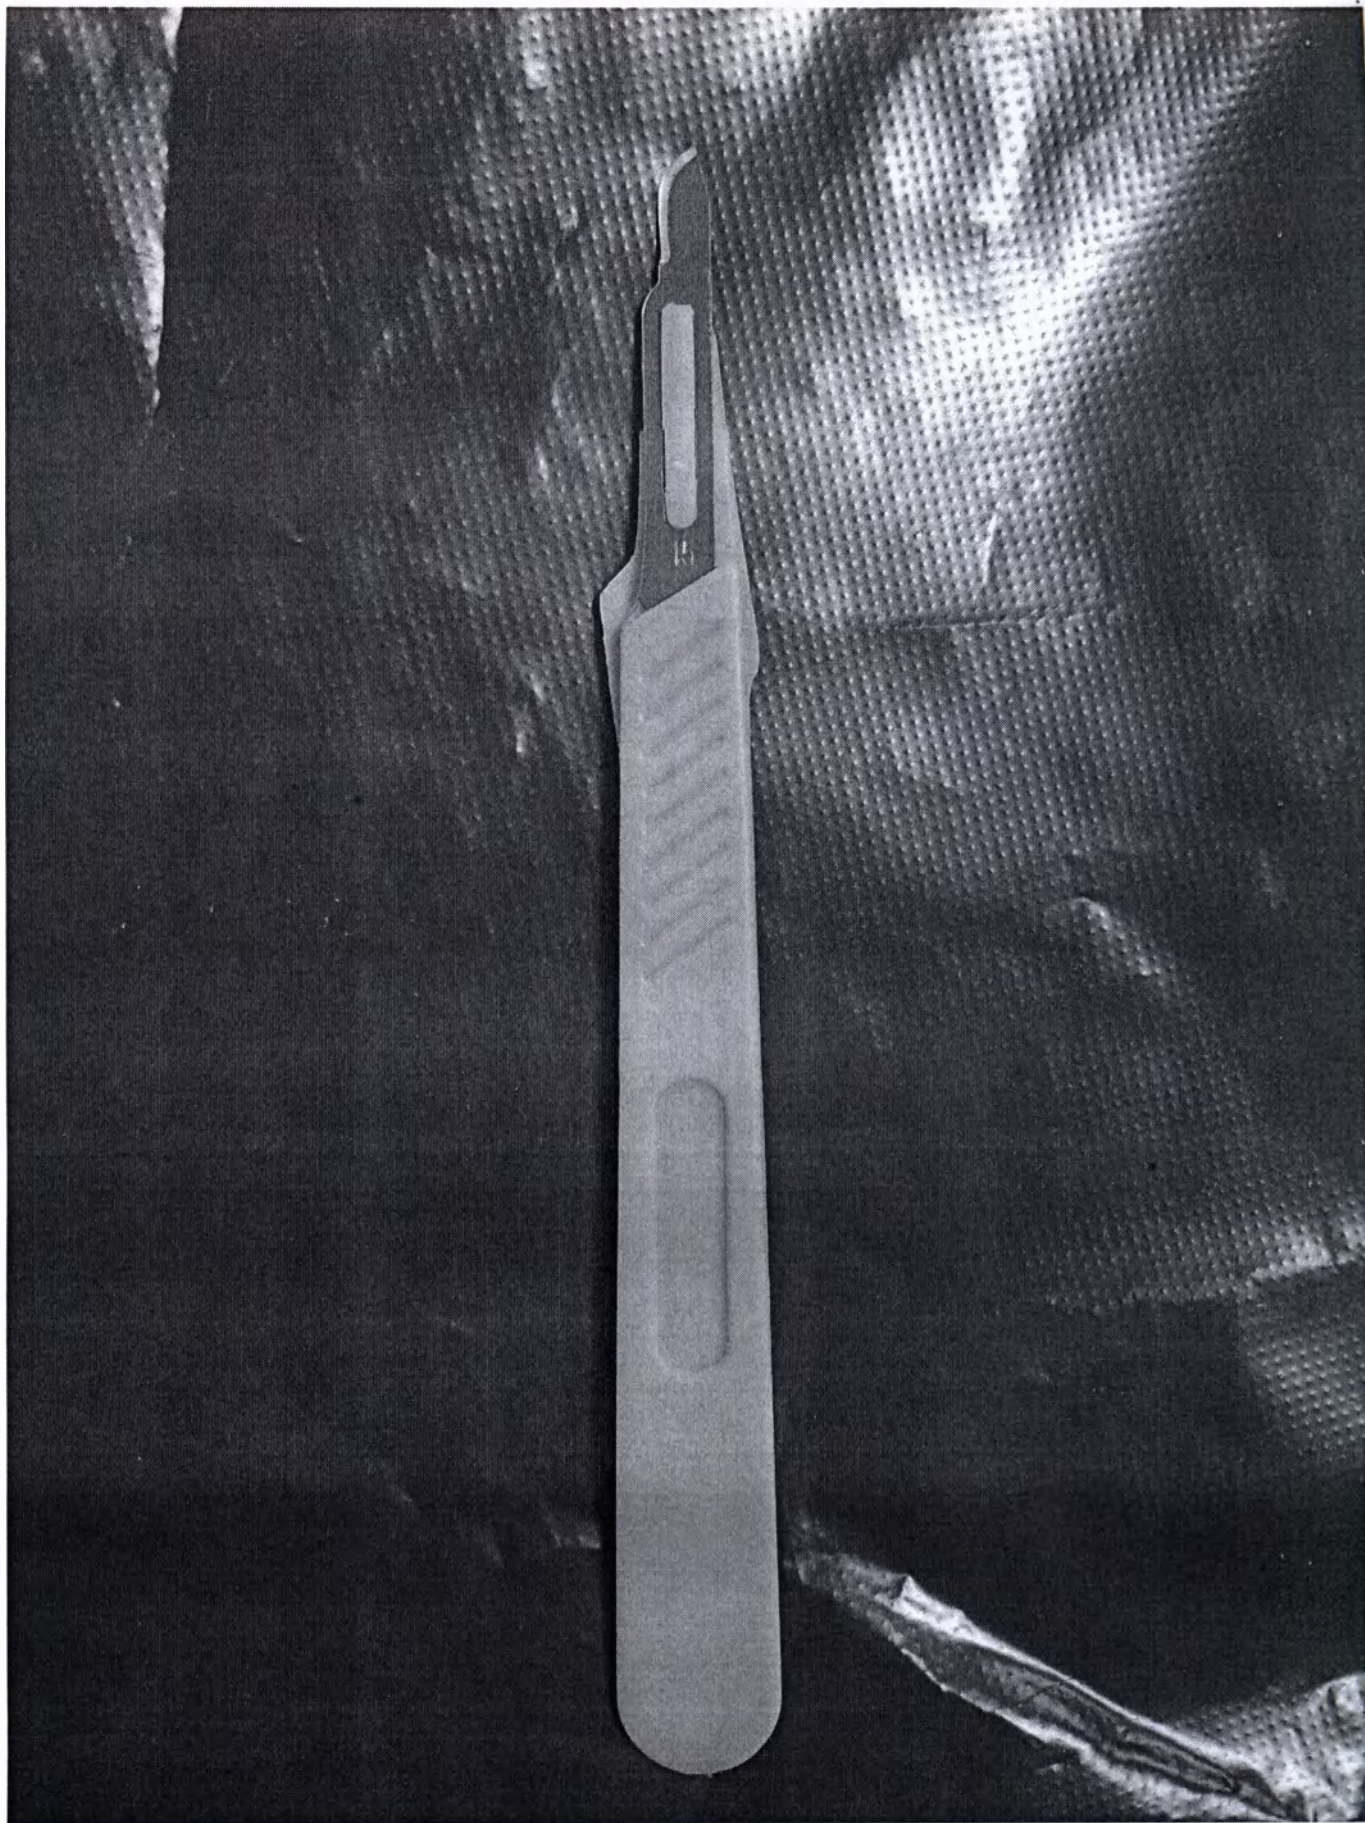


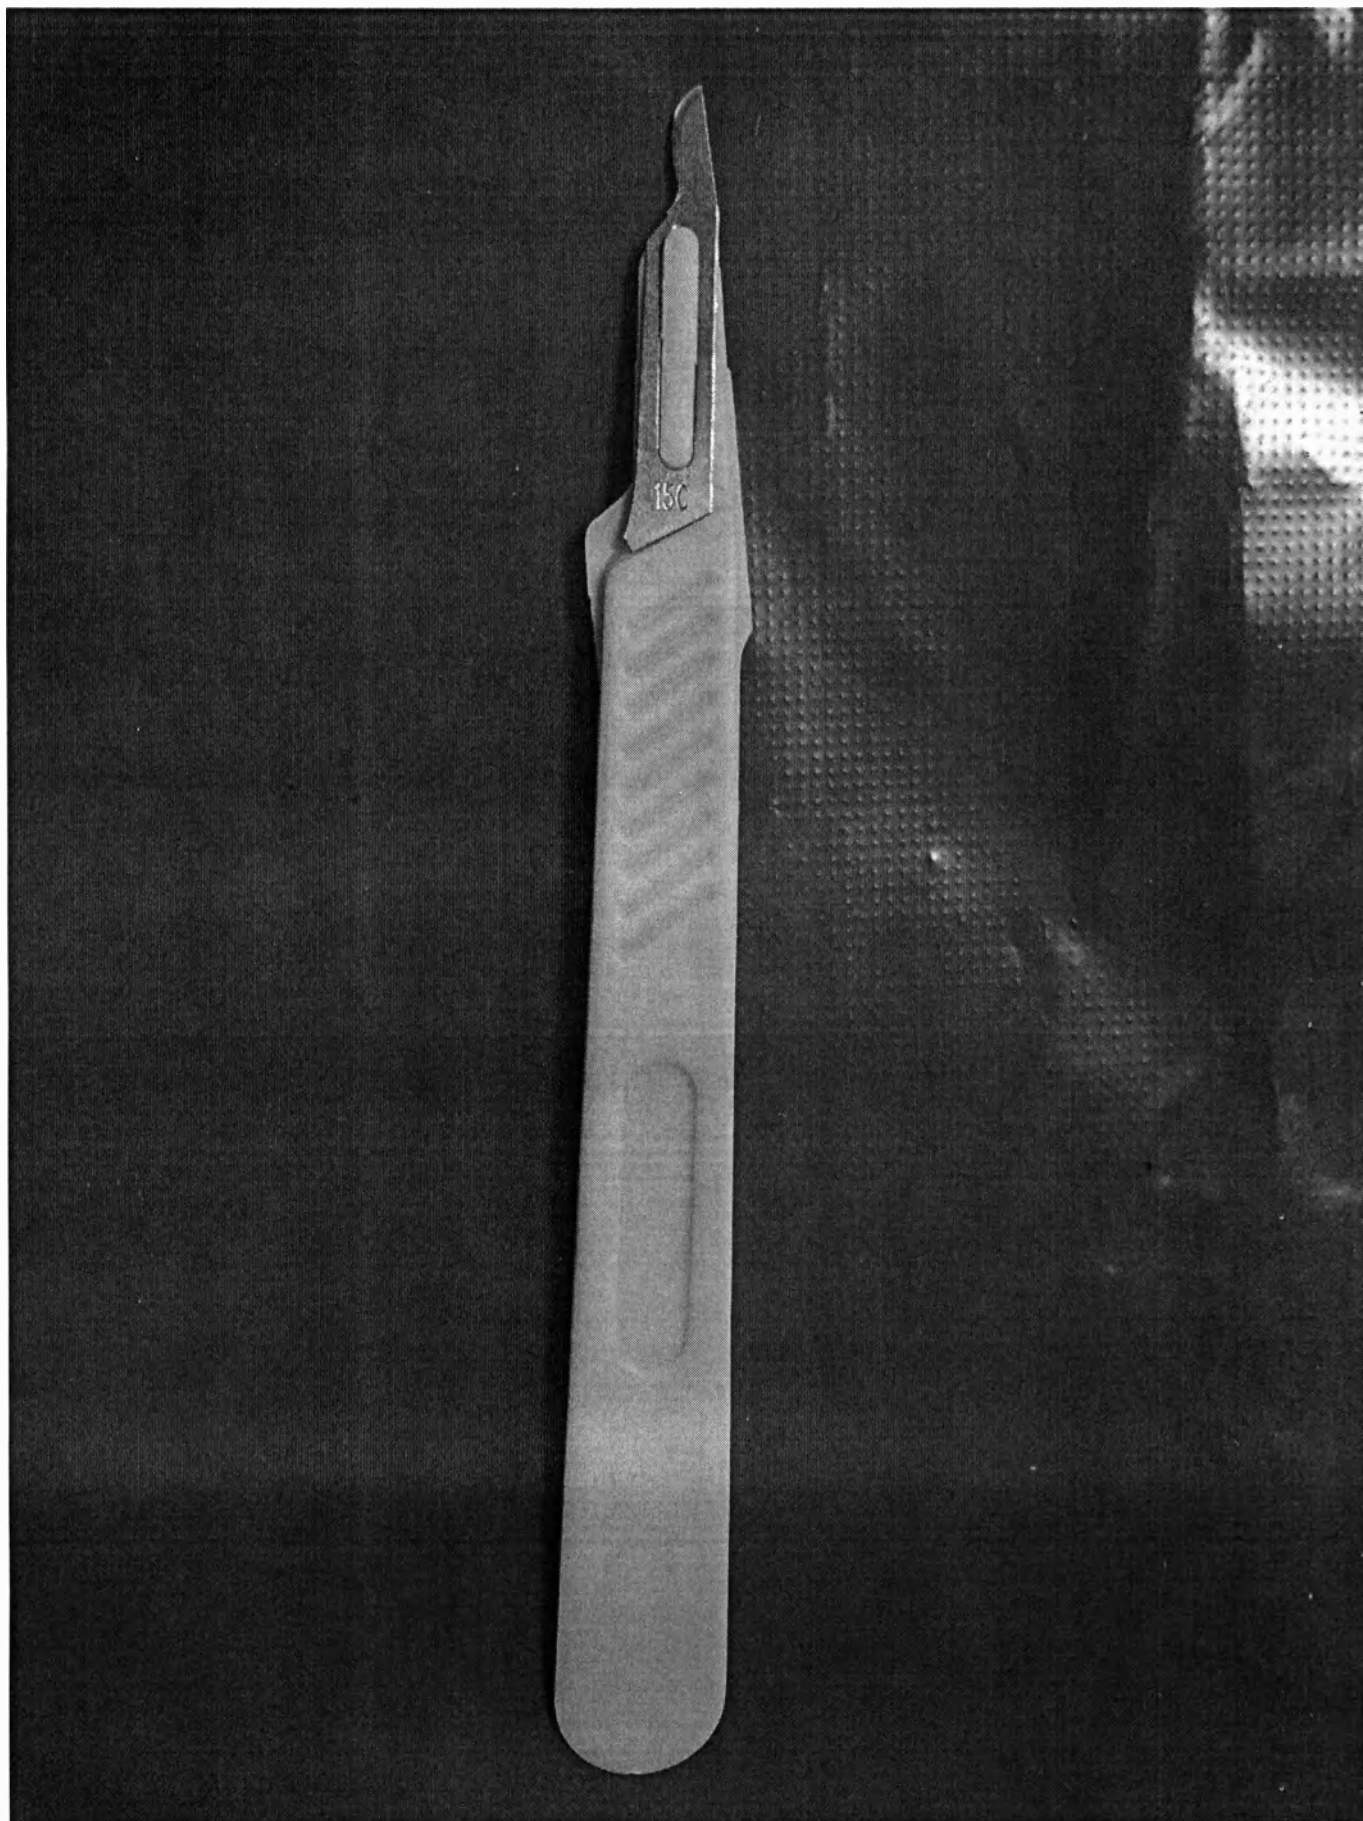


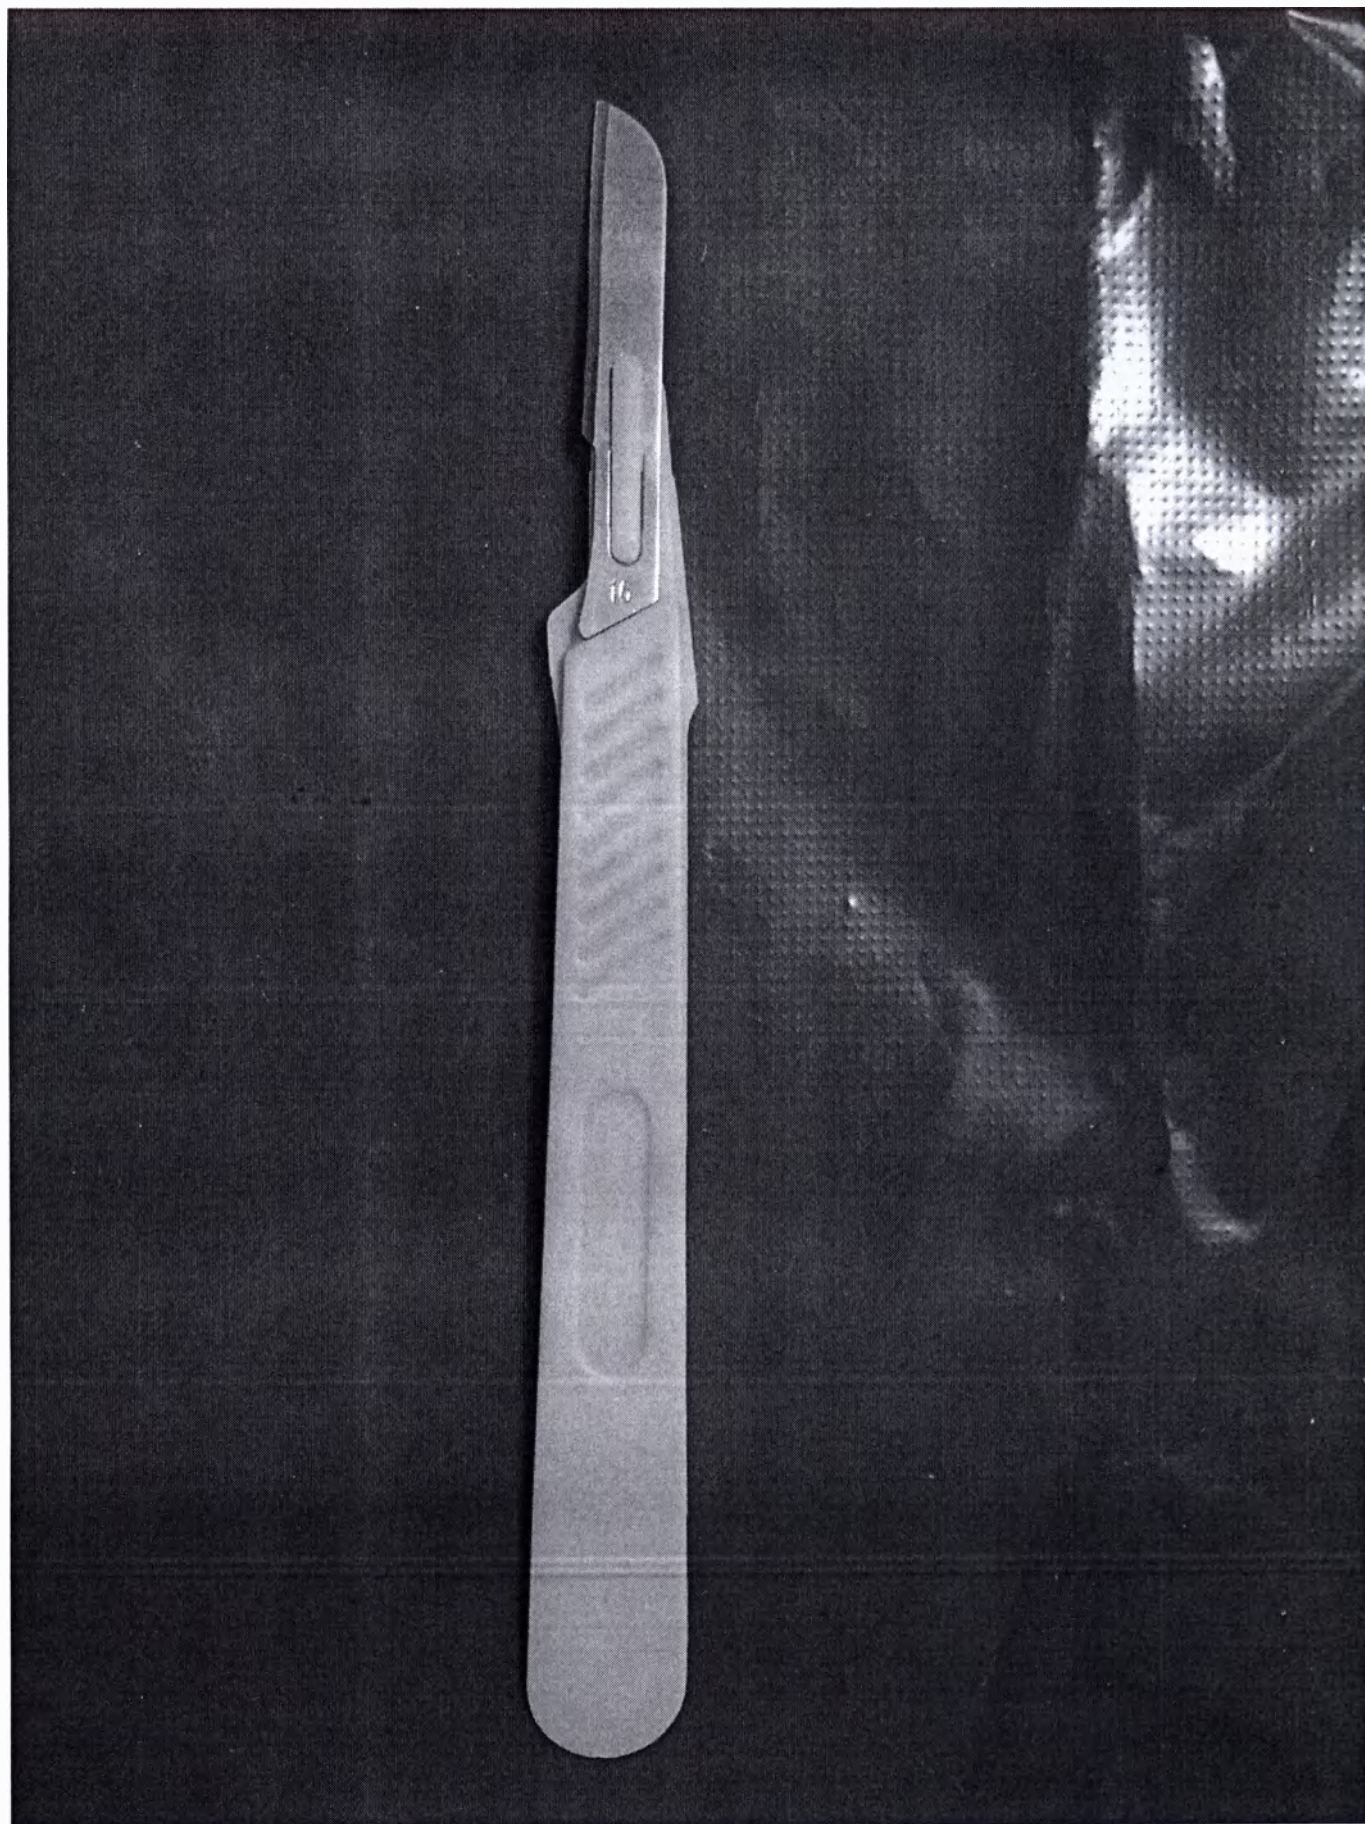


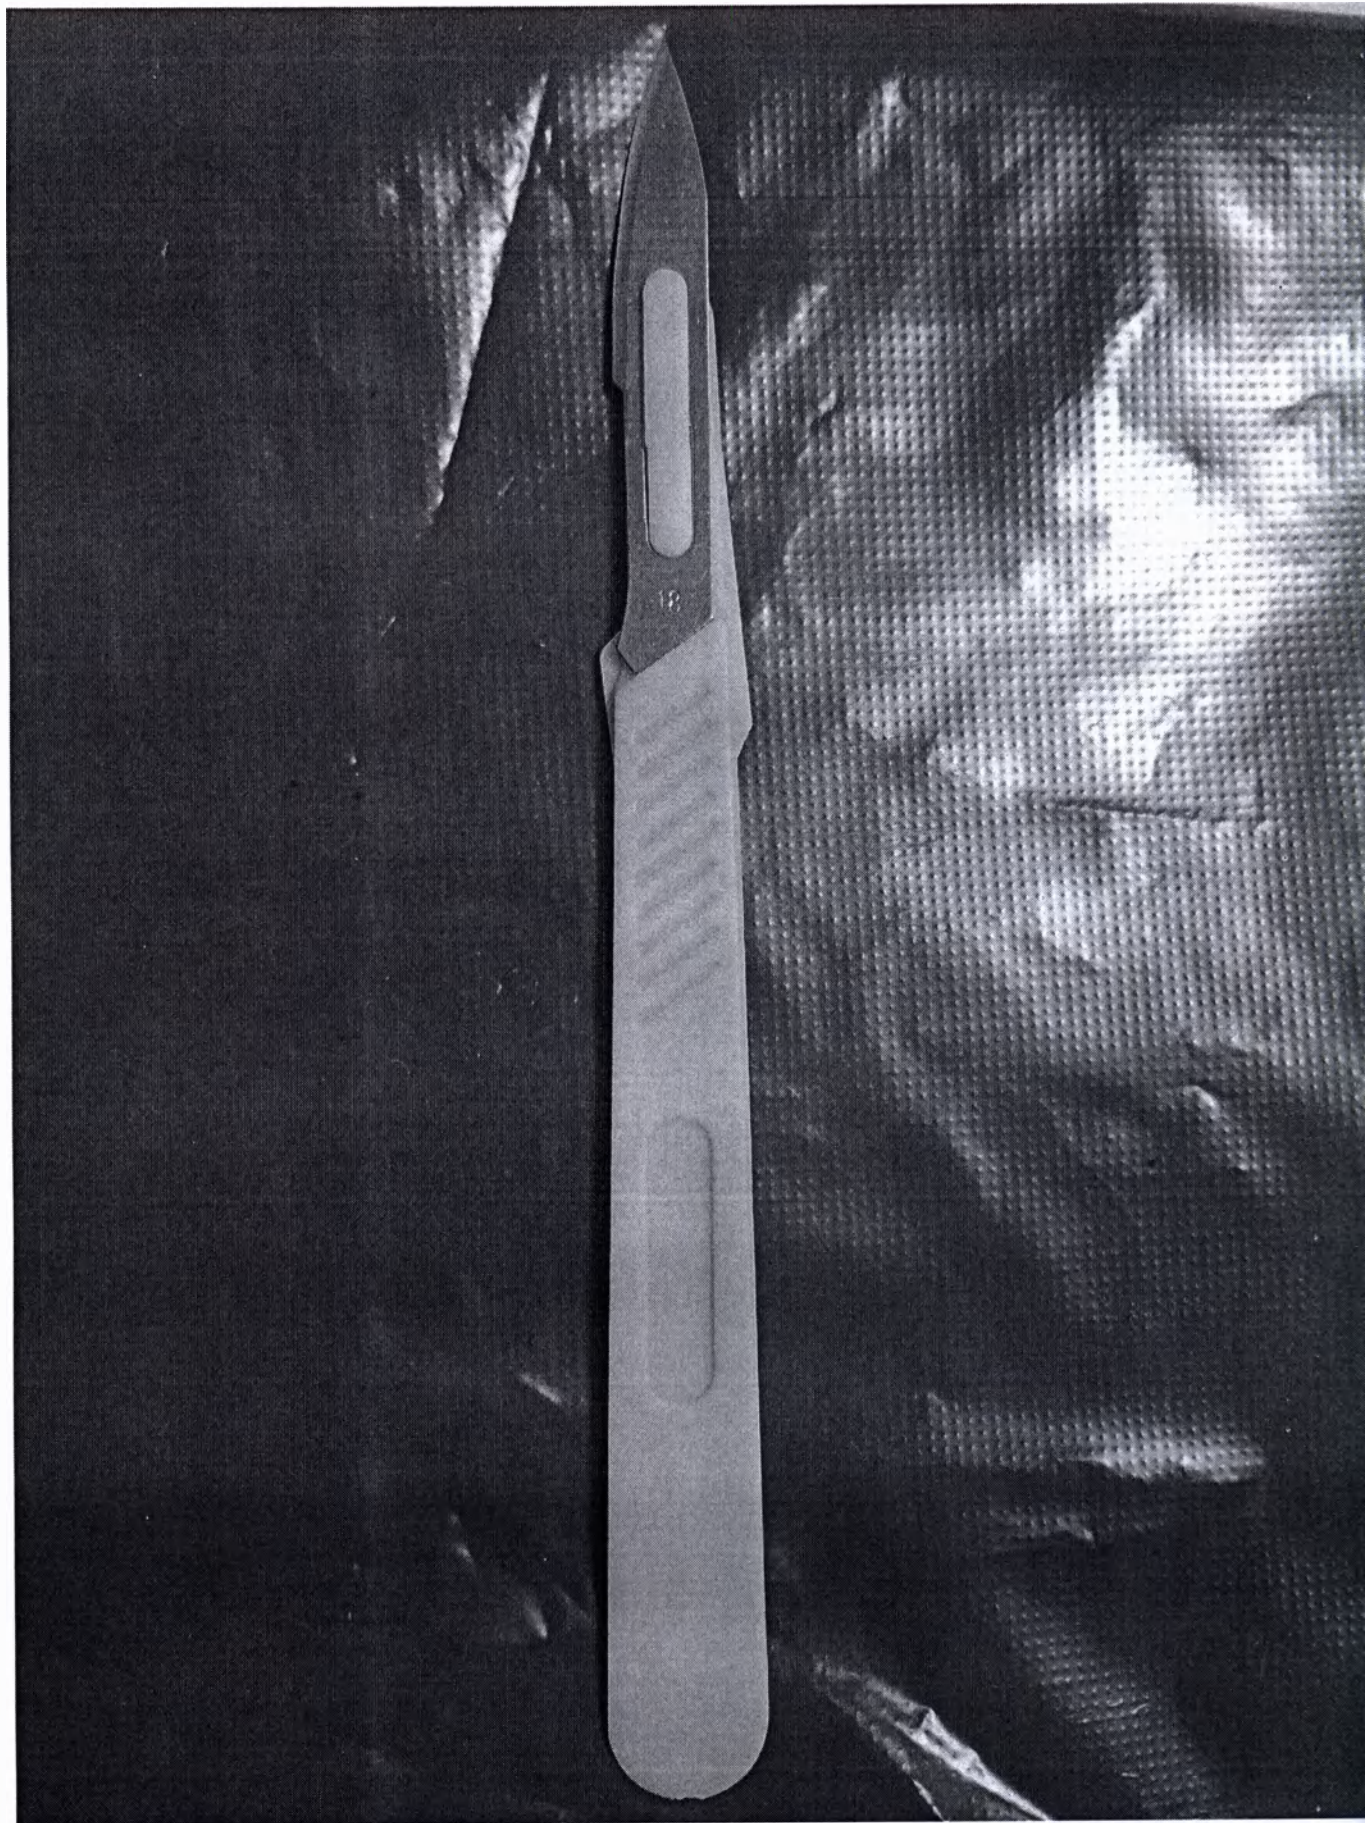

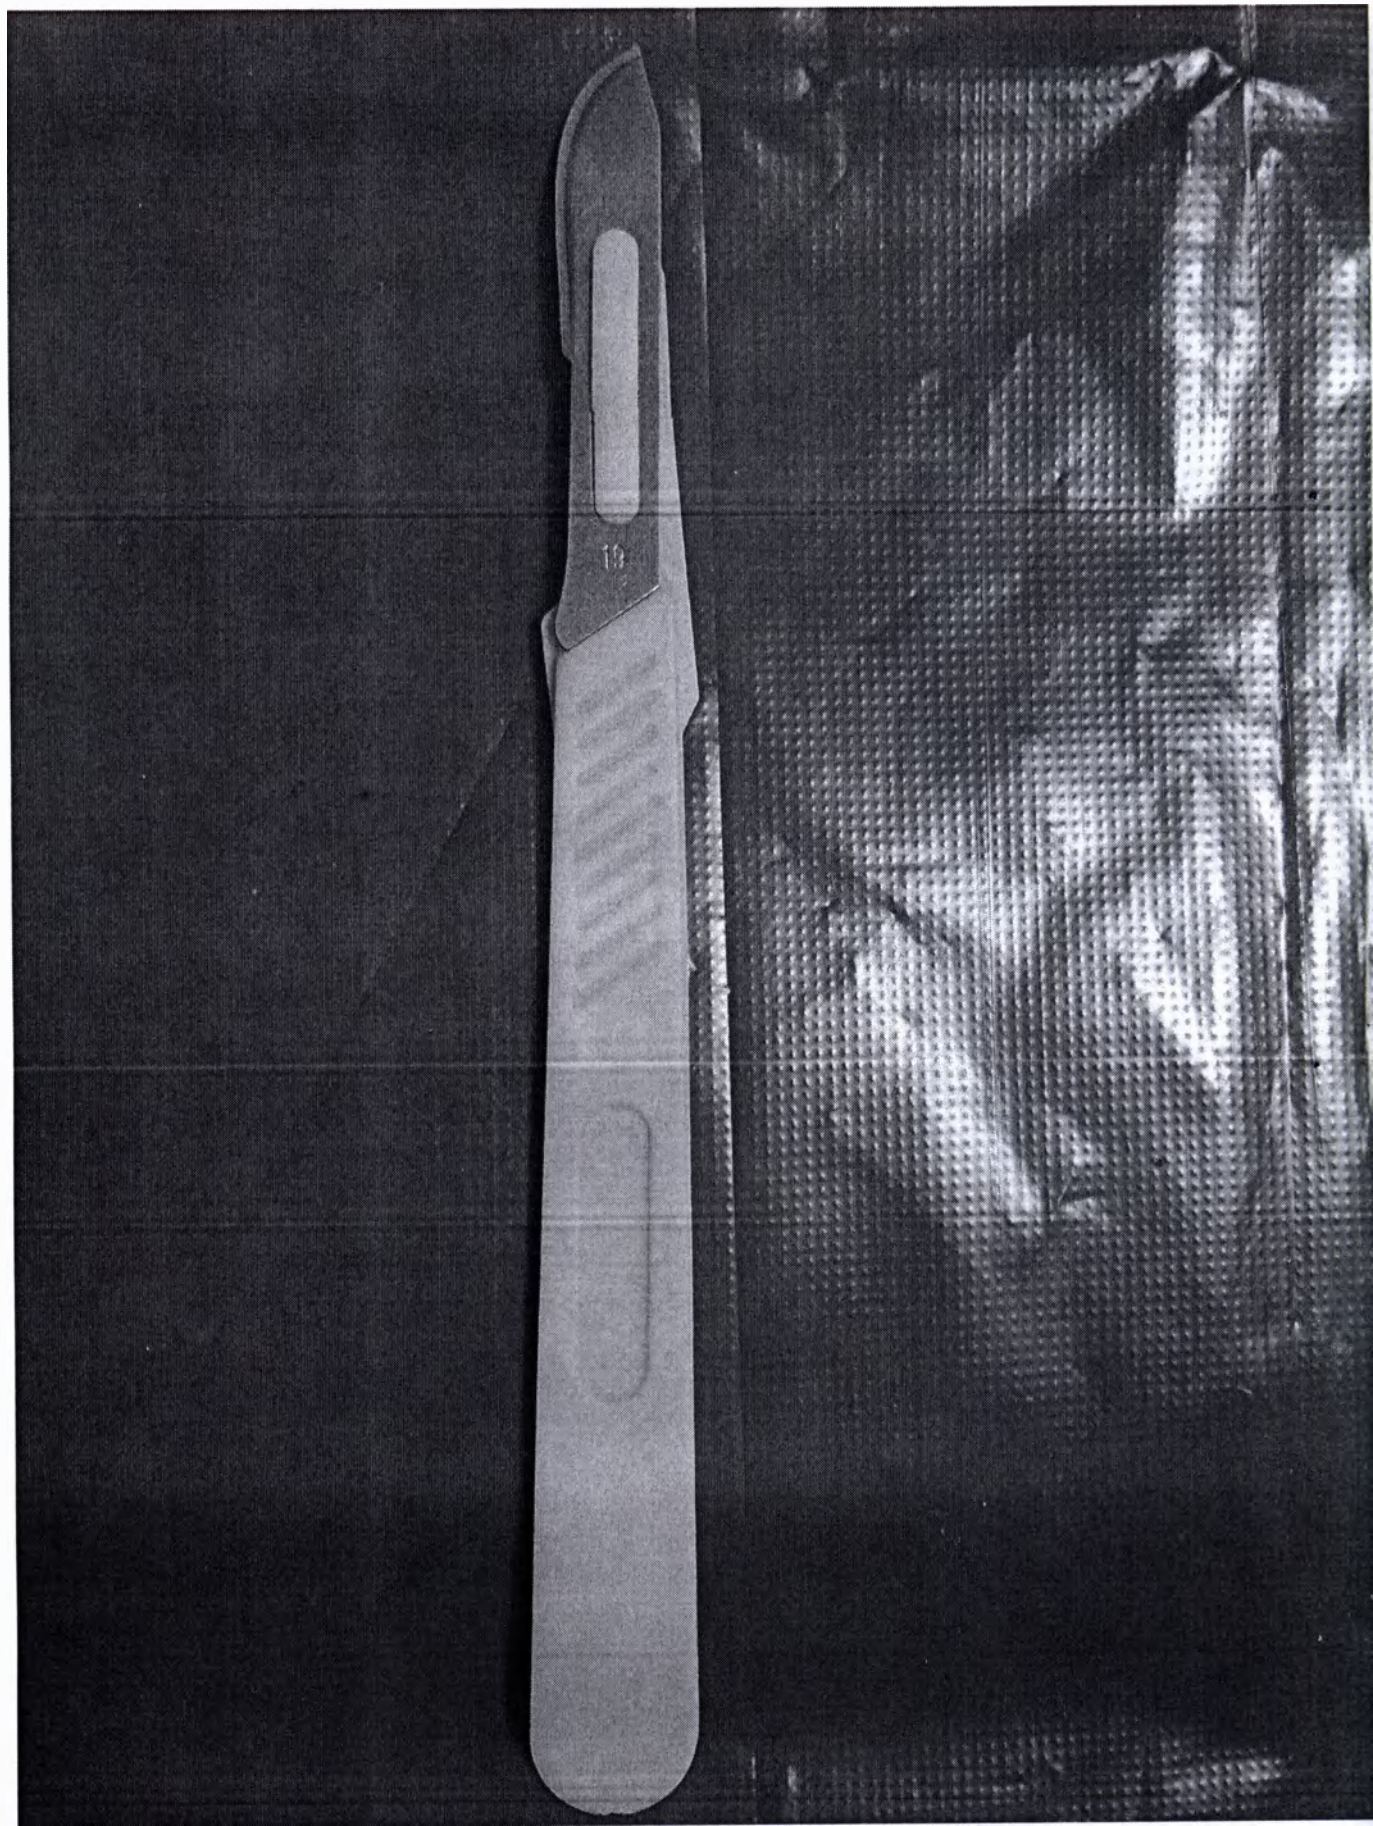


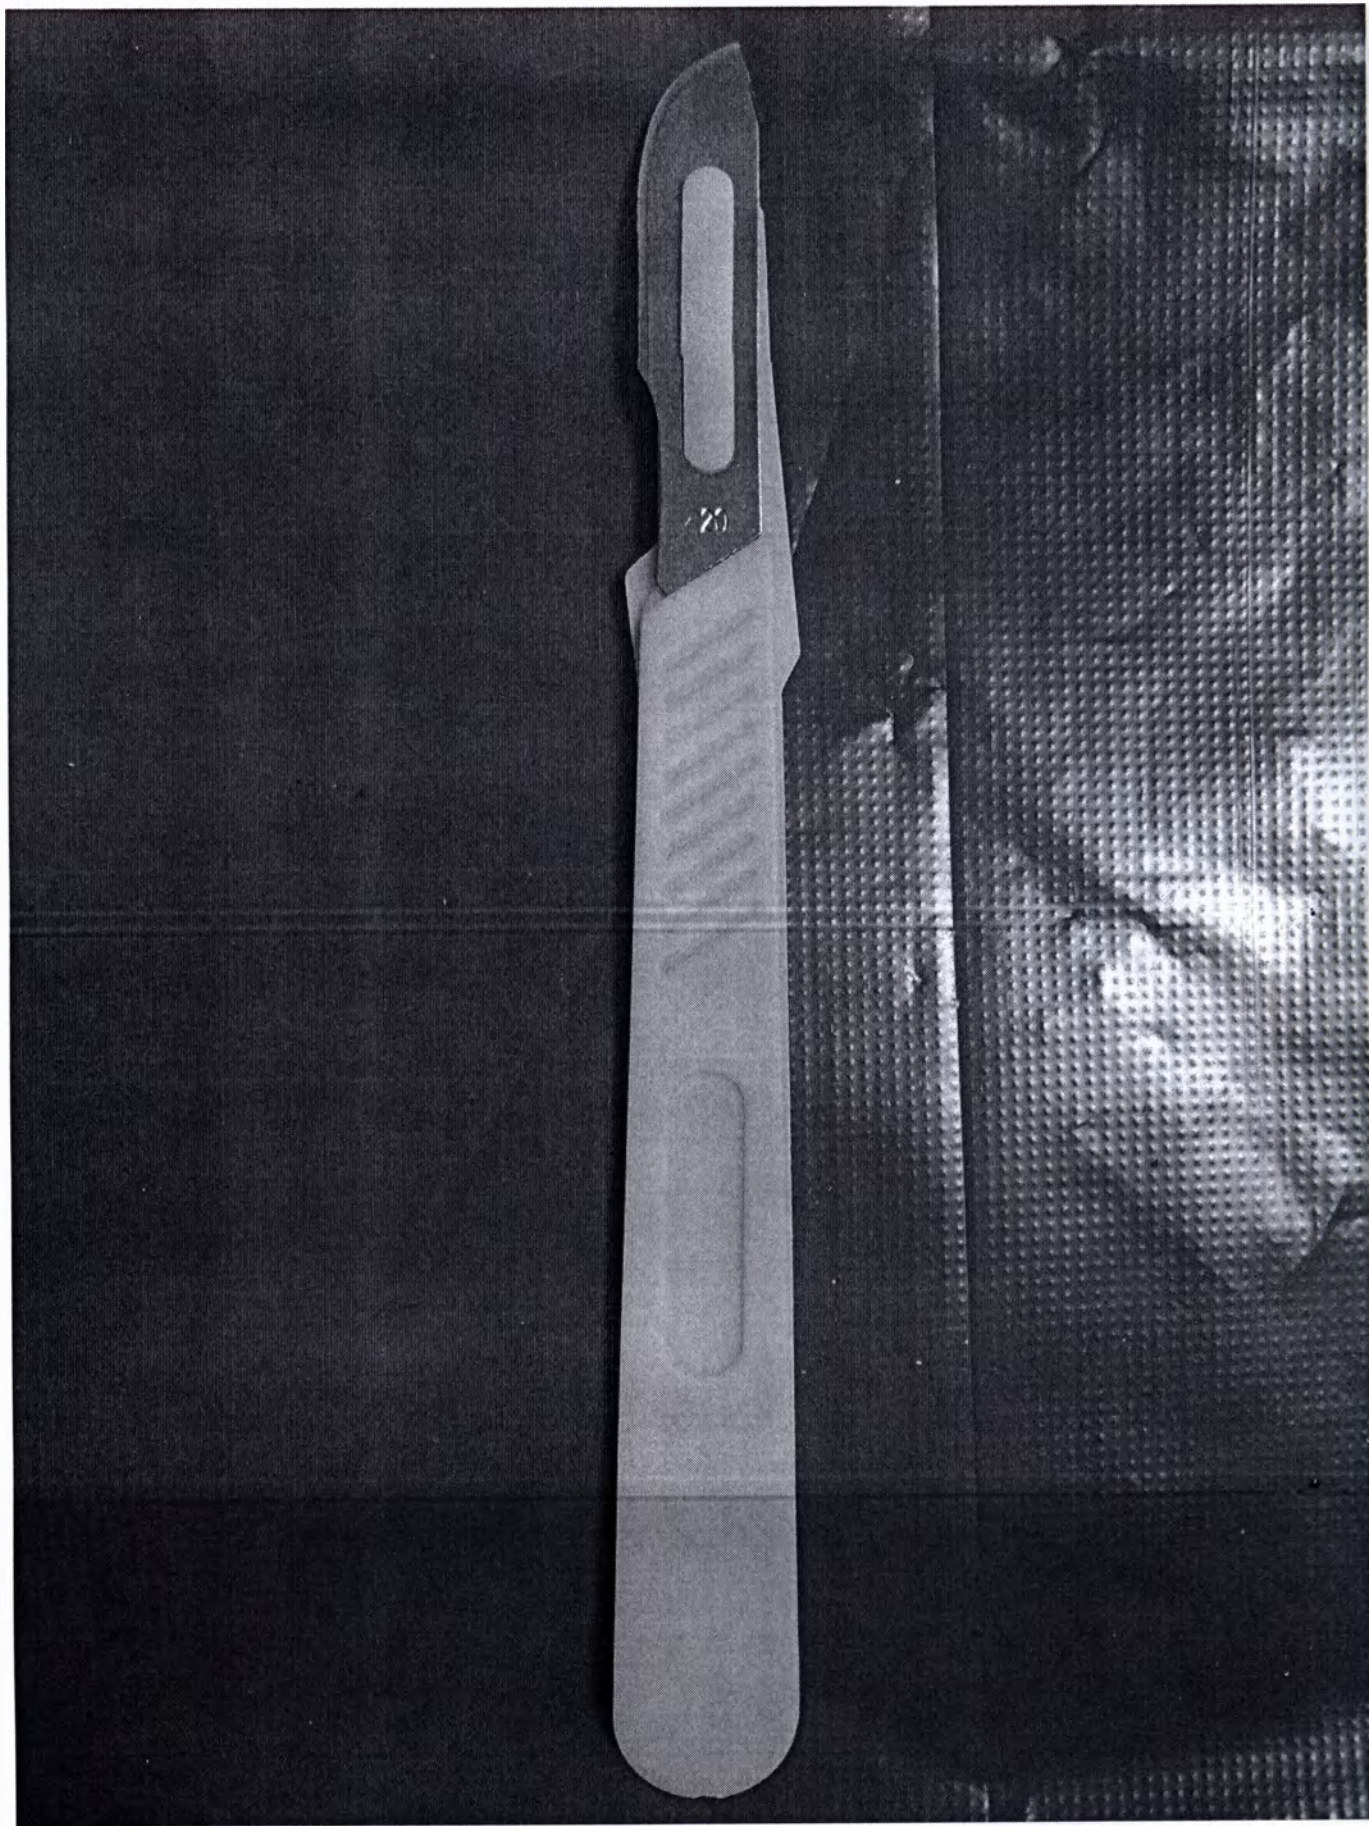

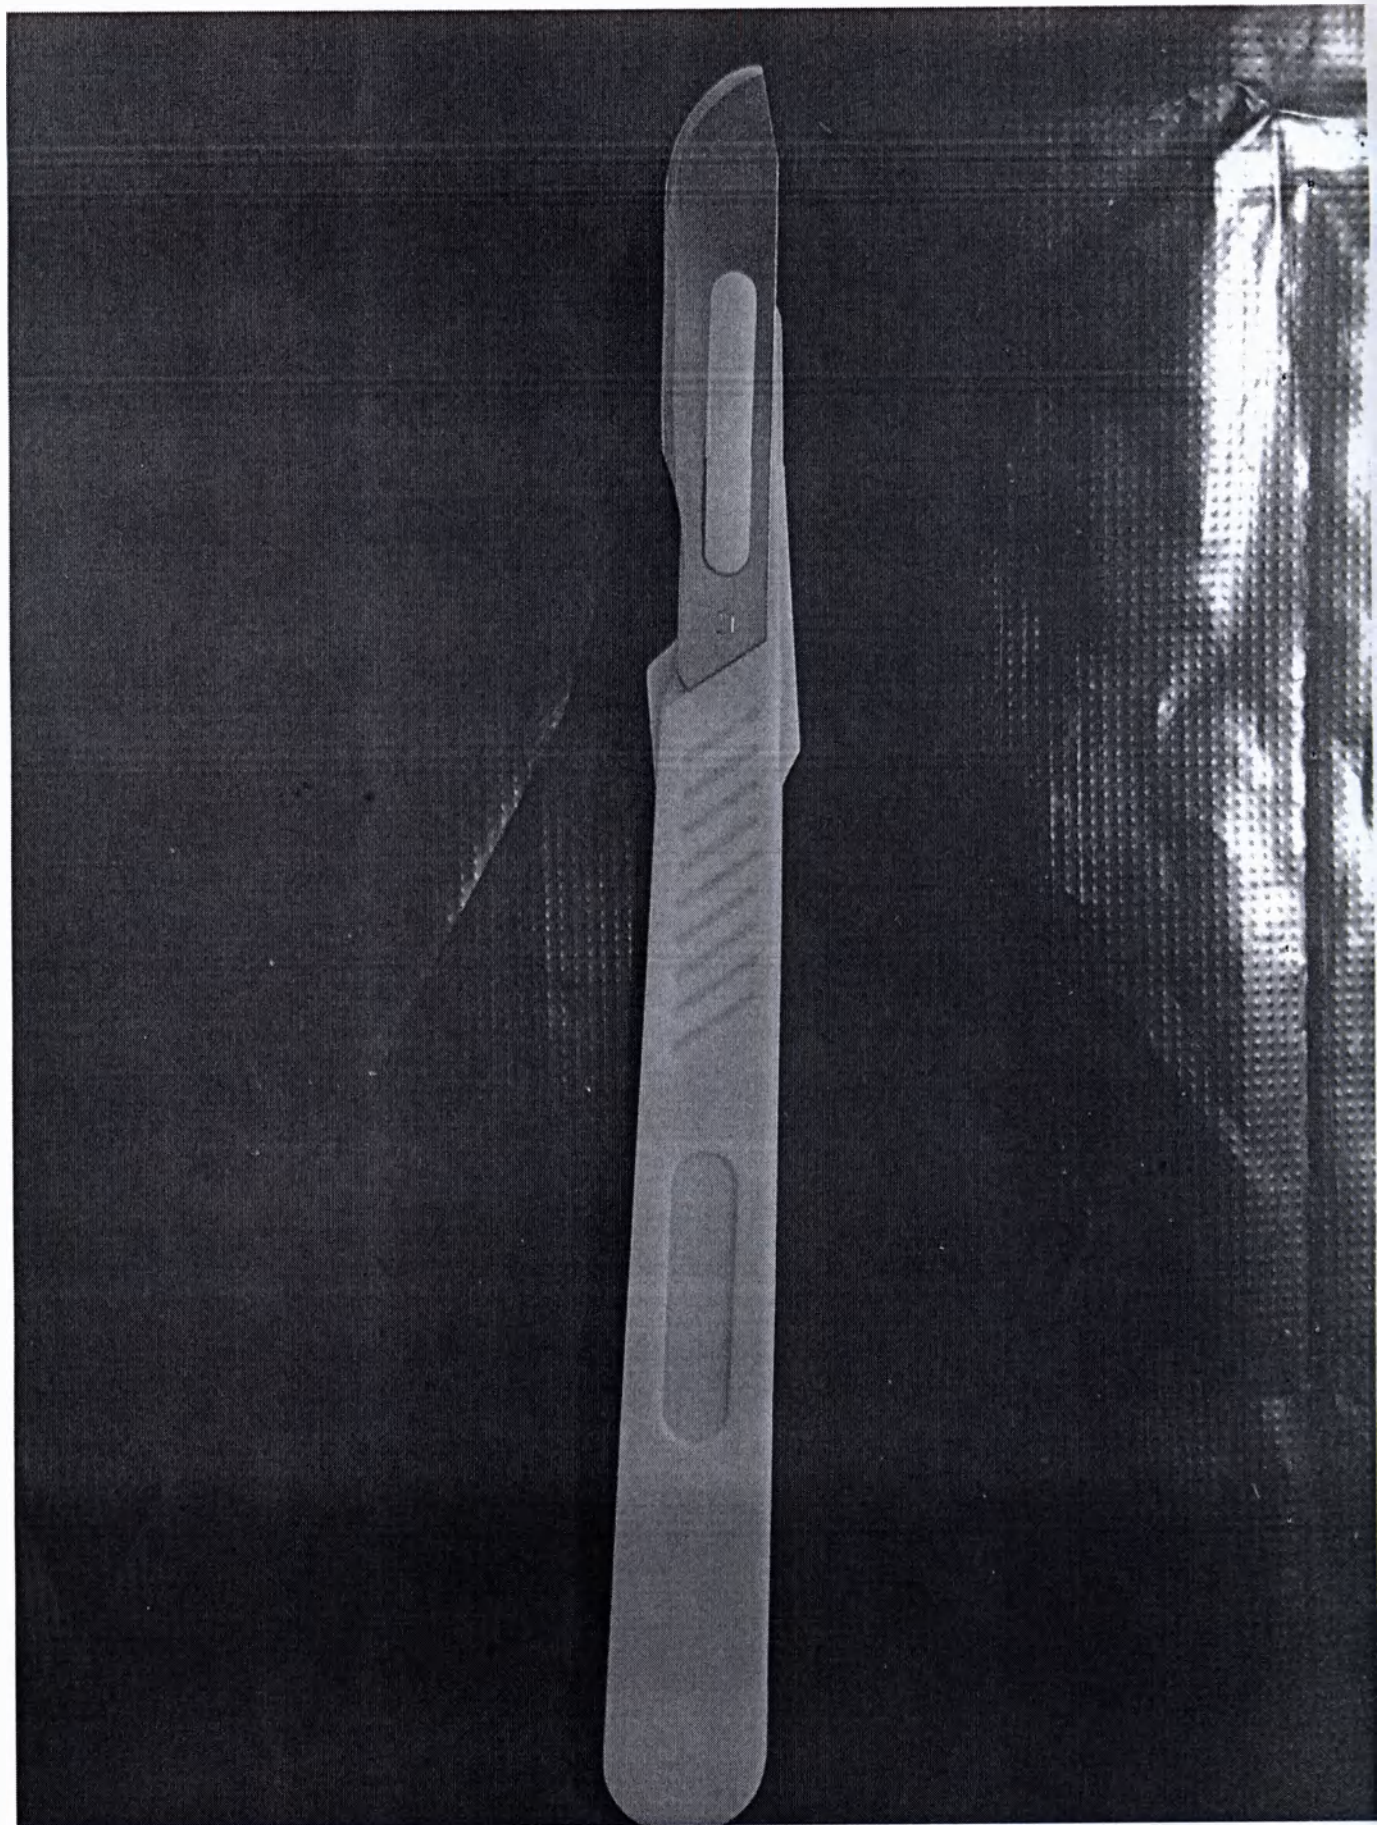


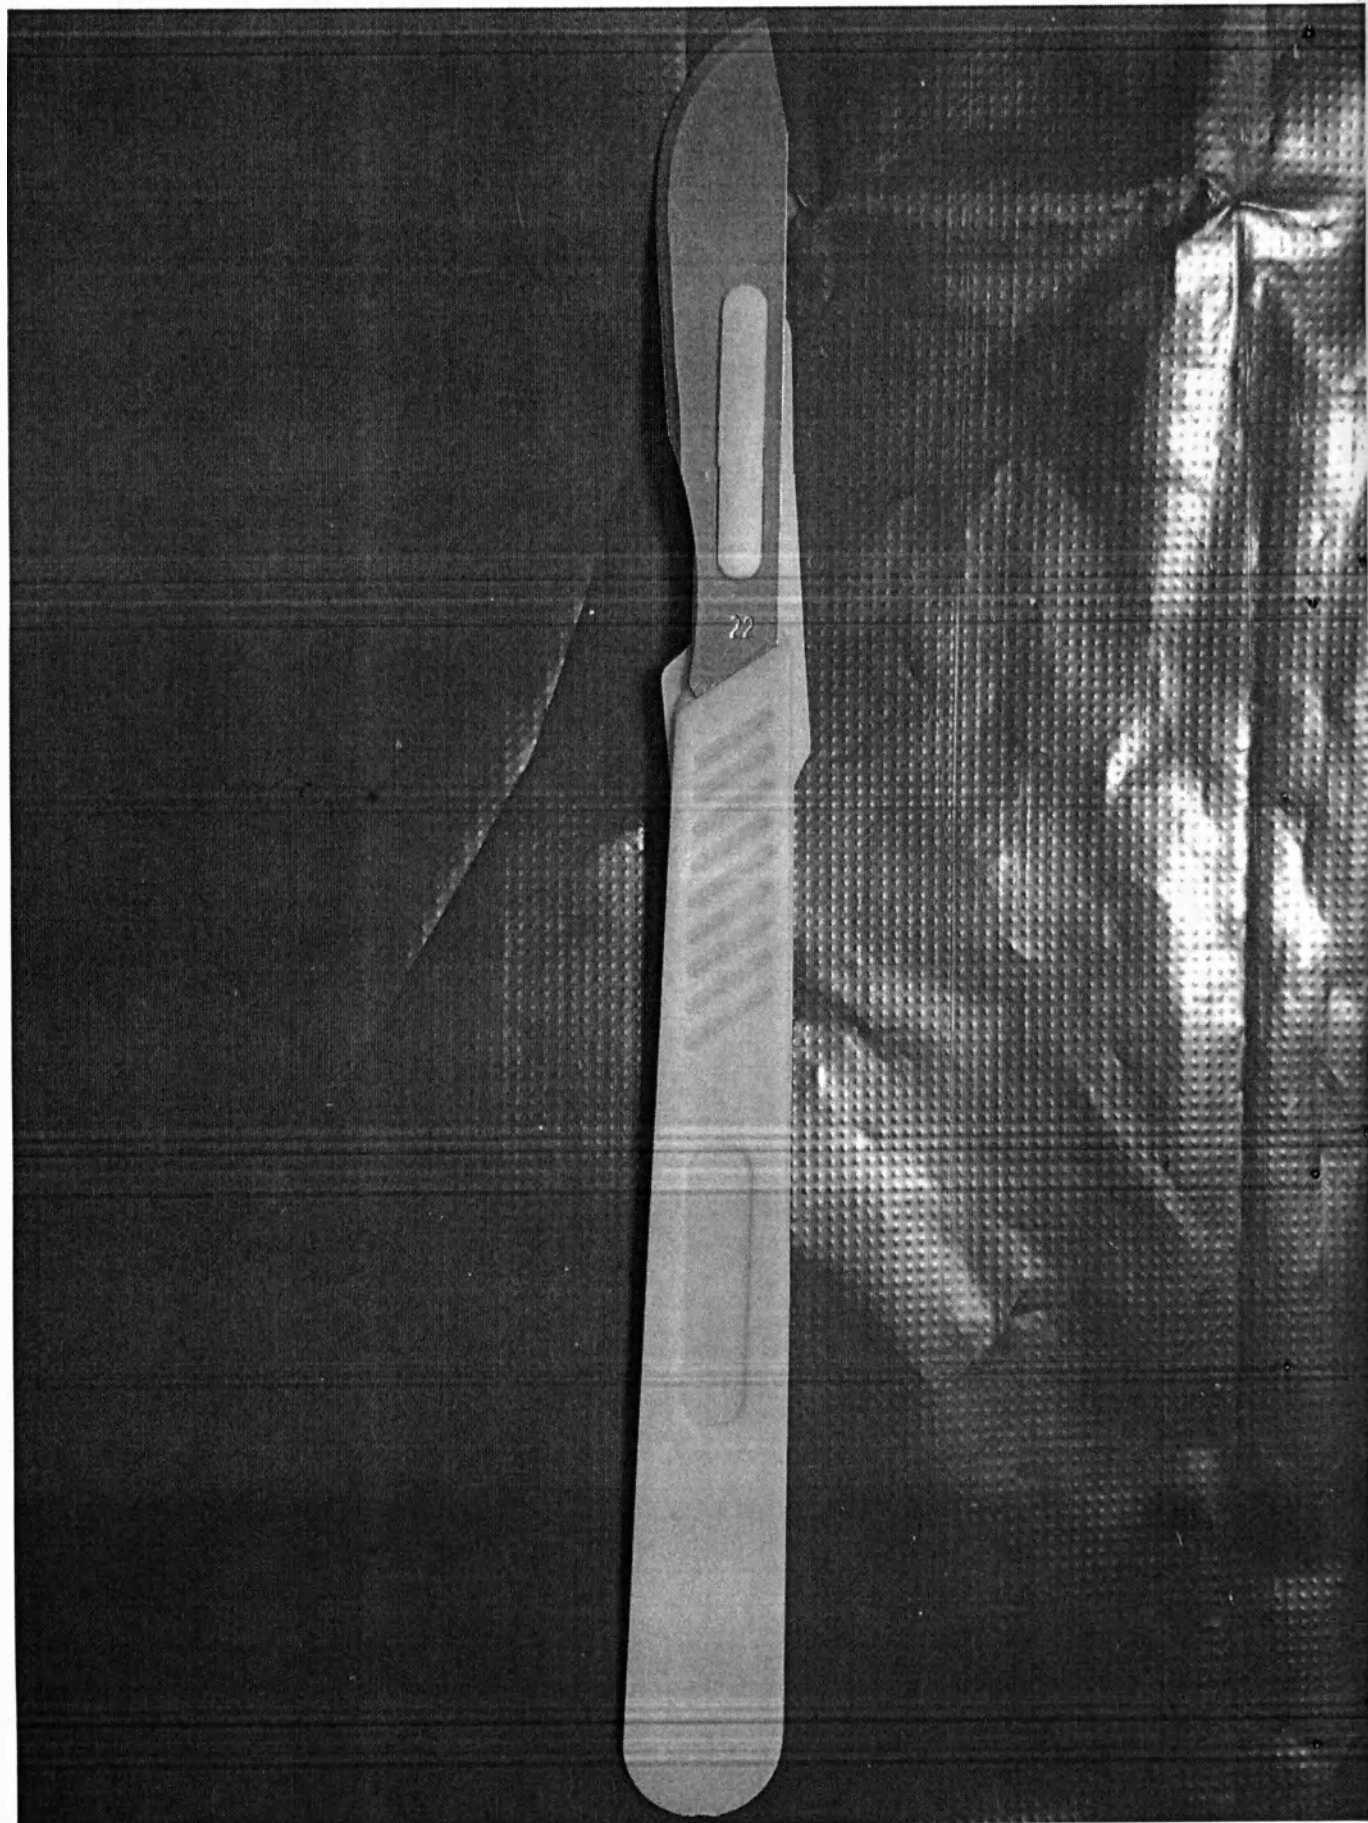



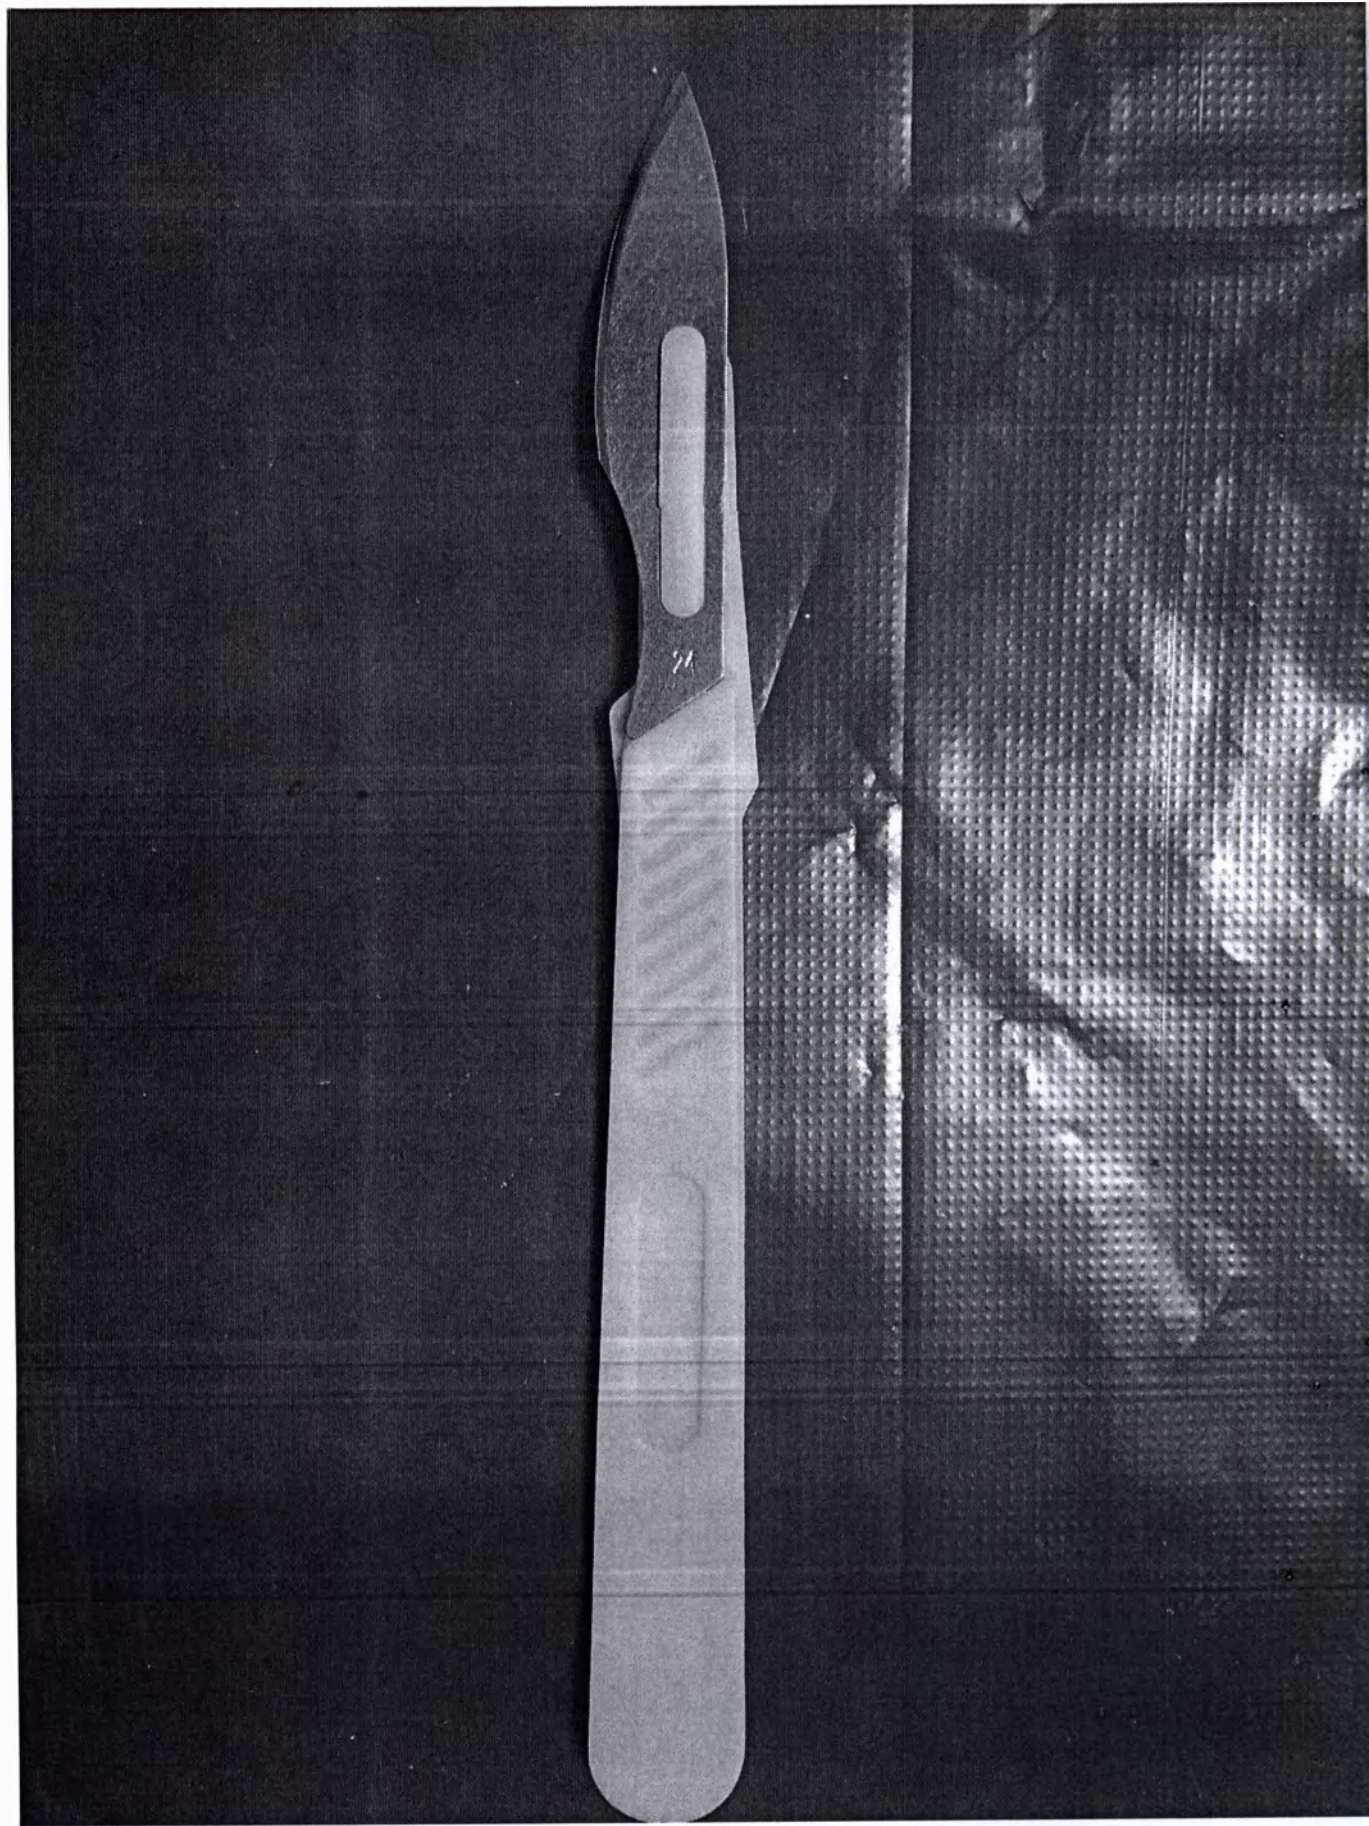





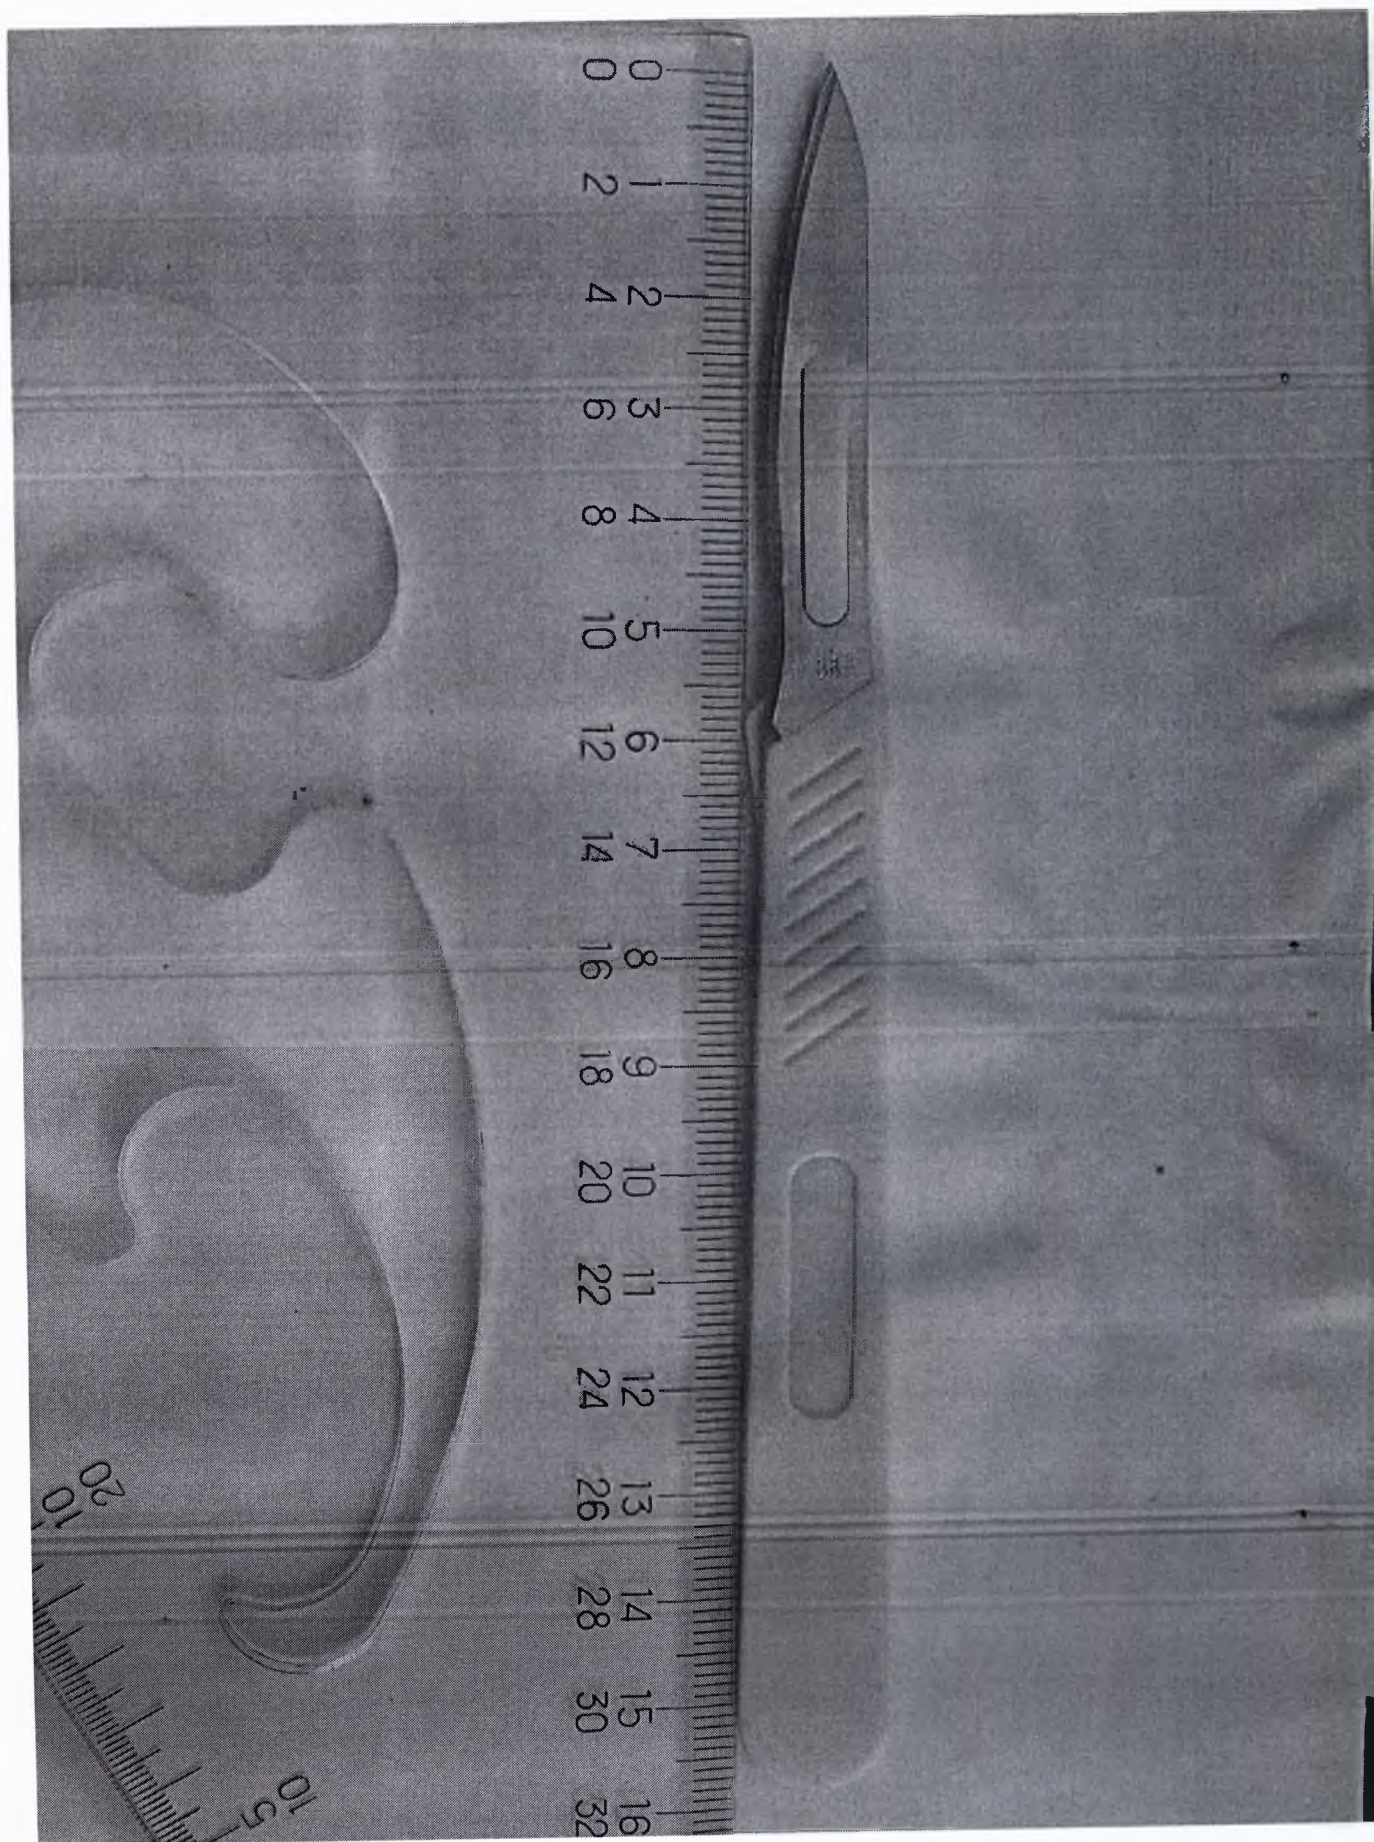


Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью	
17 (вештаков)	17 (вештаков)
Руководитель	Мухомов В. В.
Подпись	
Дата	02.08.2025.


ИНН 1654036310
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

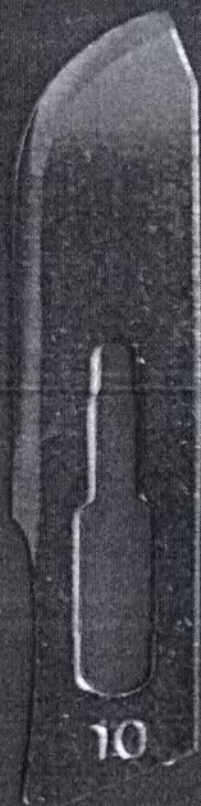


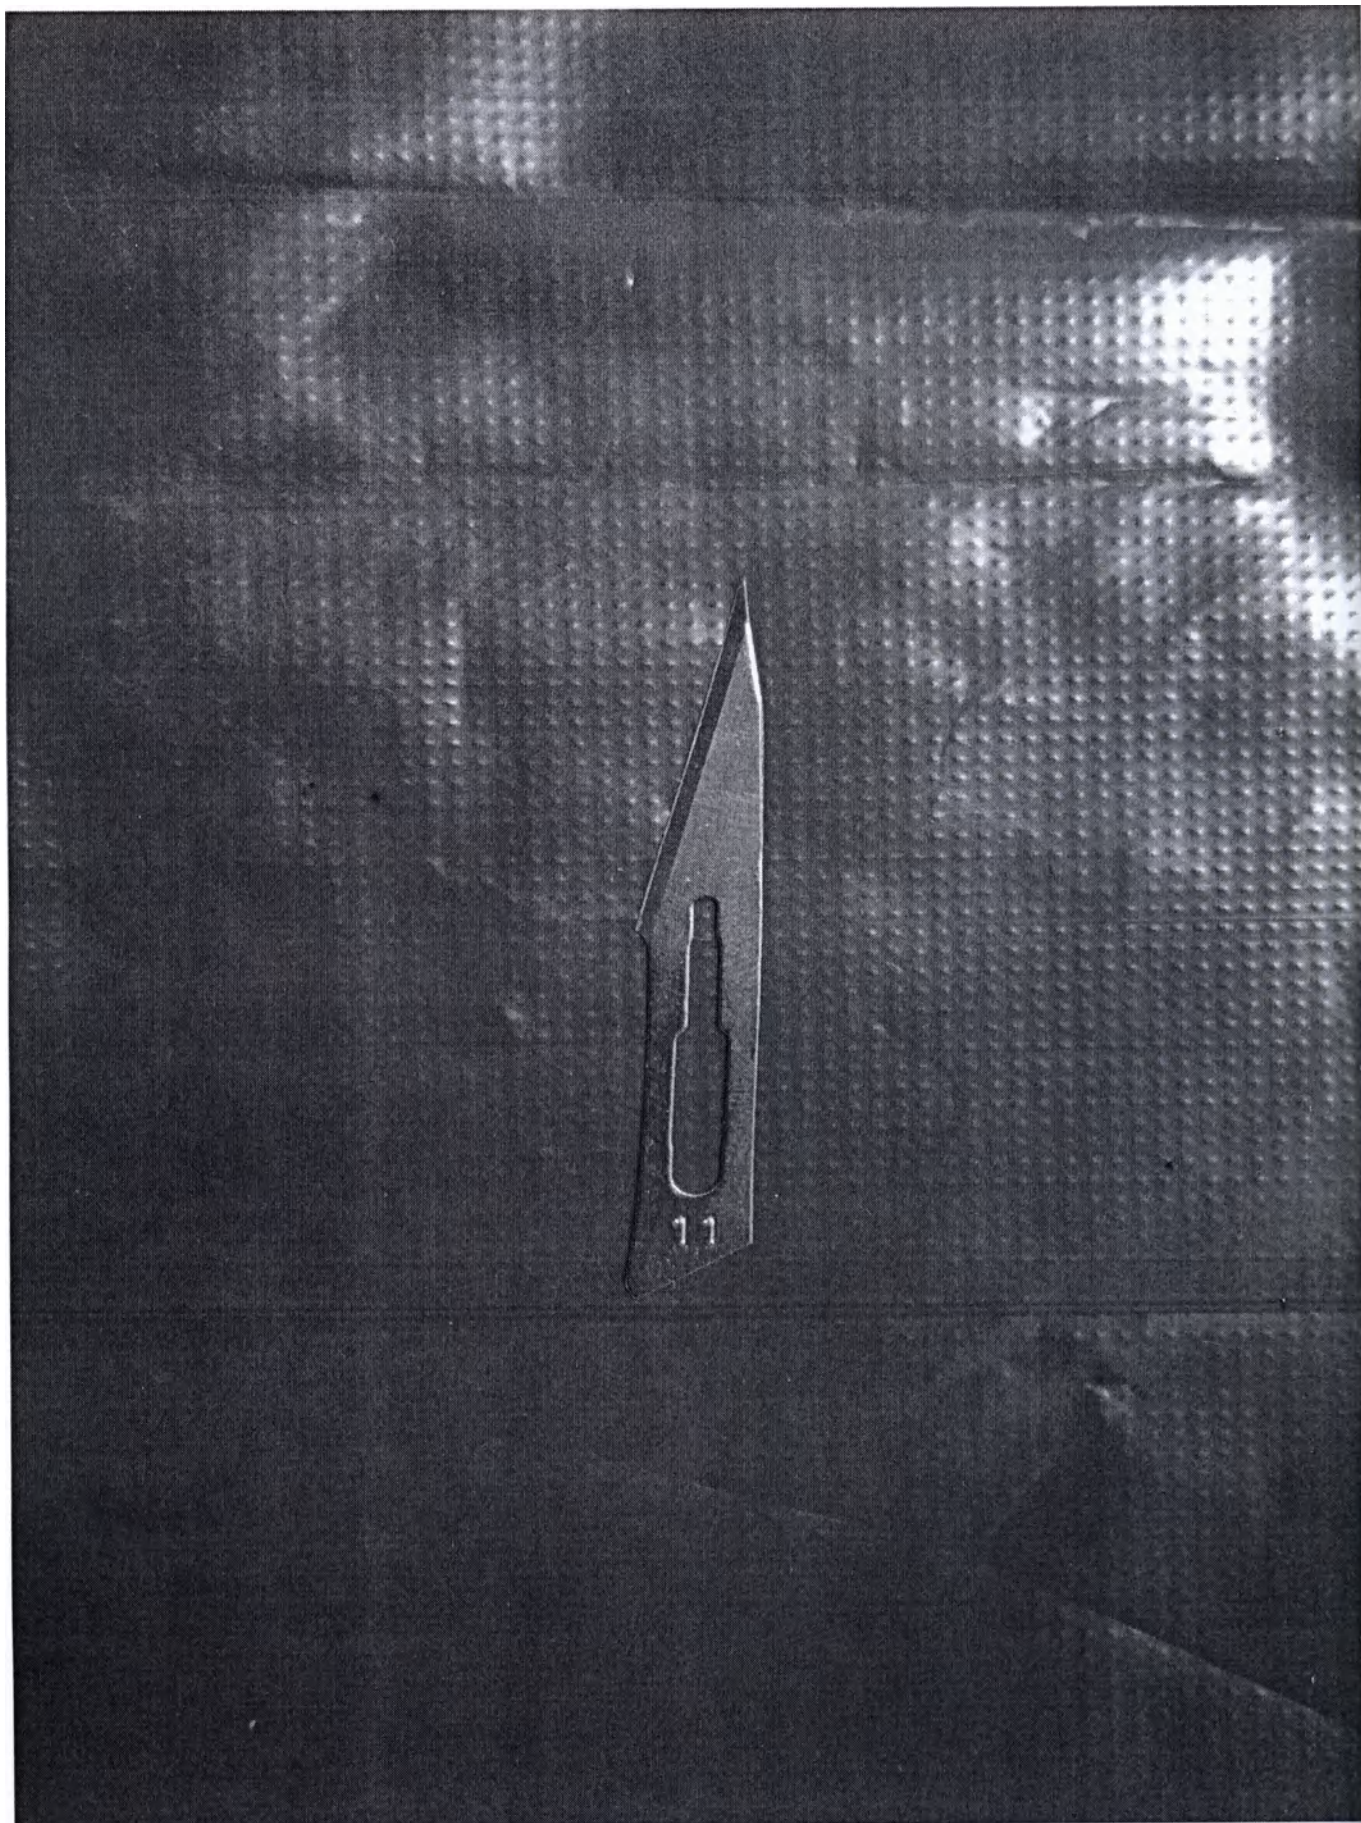


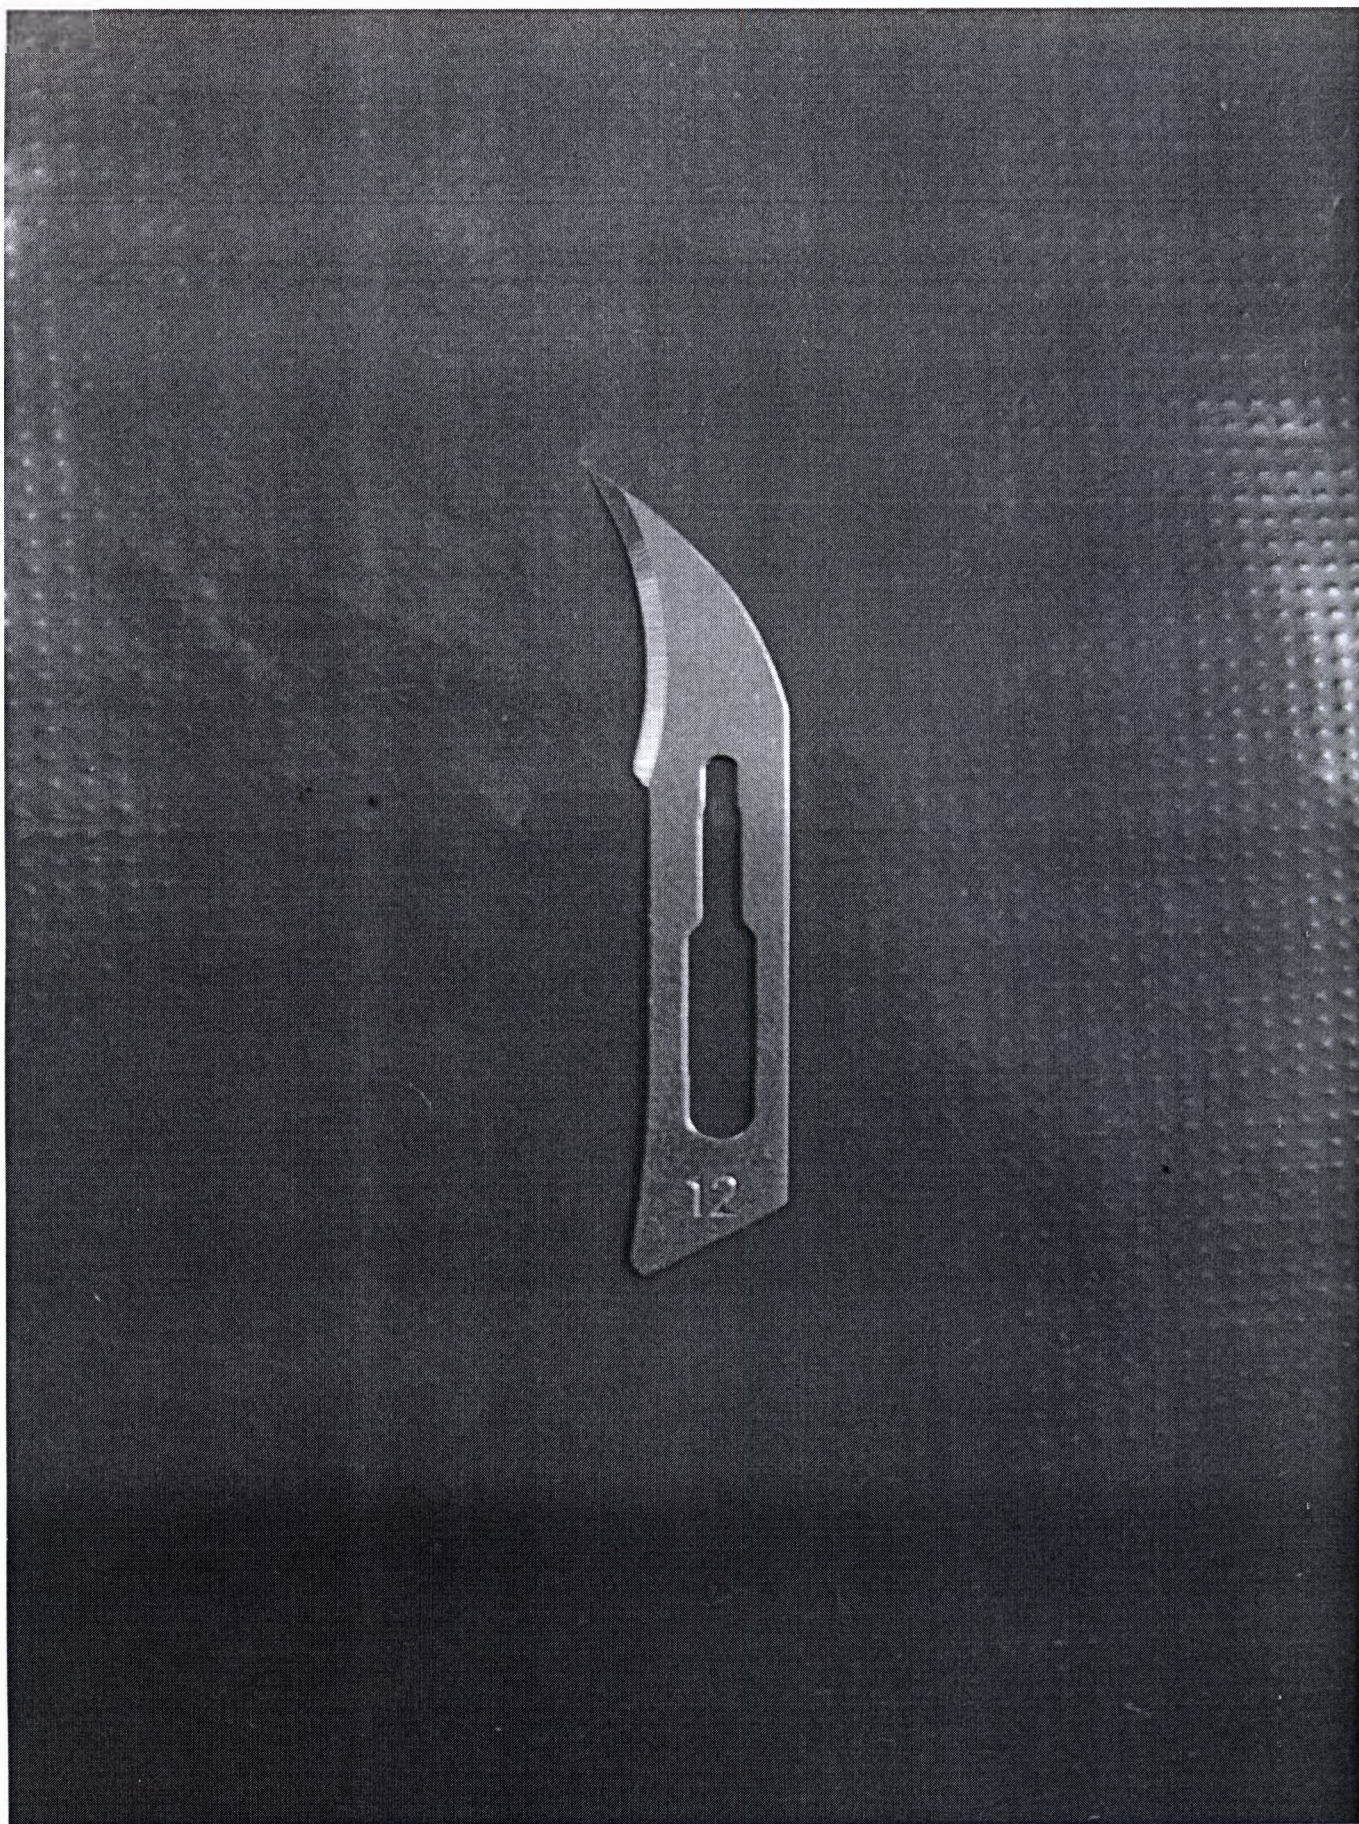





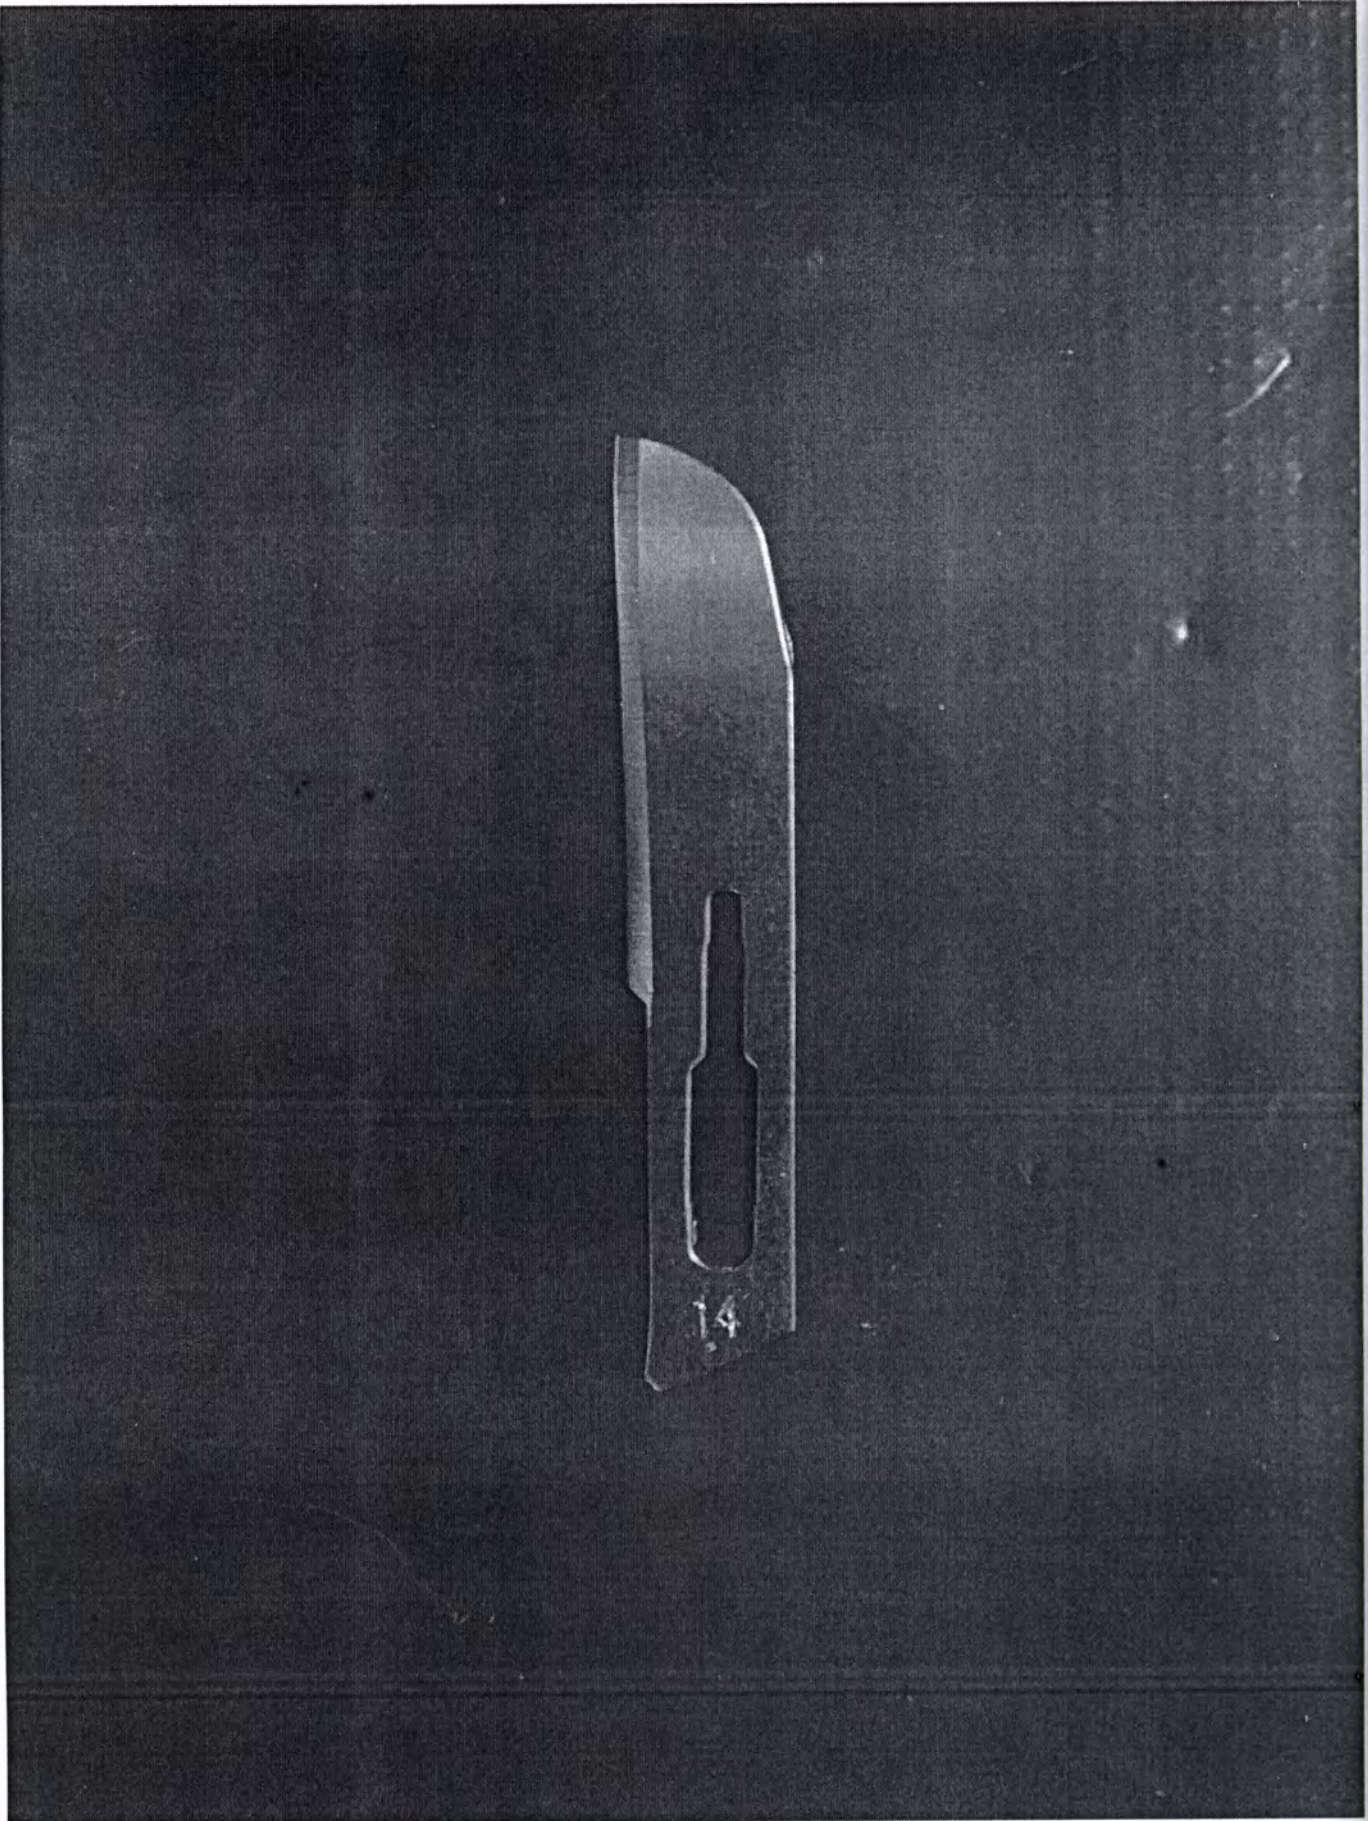


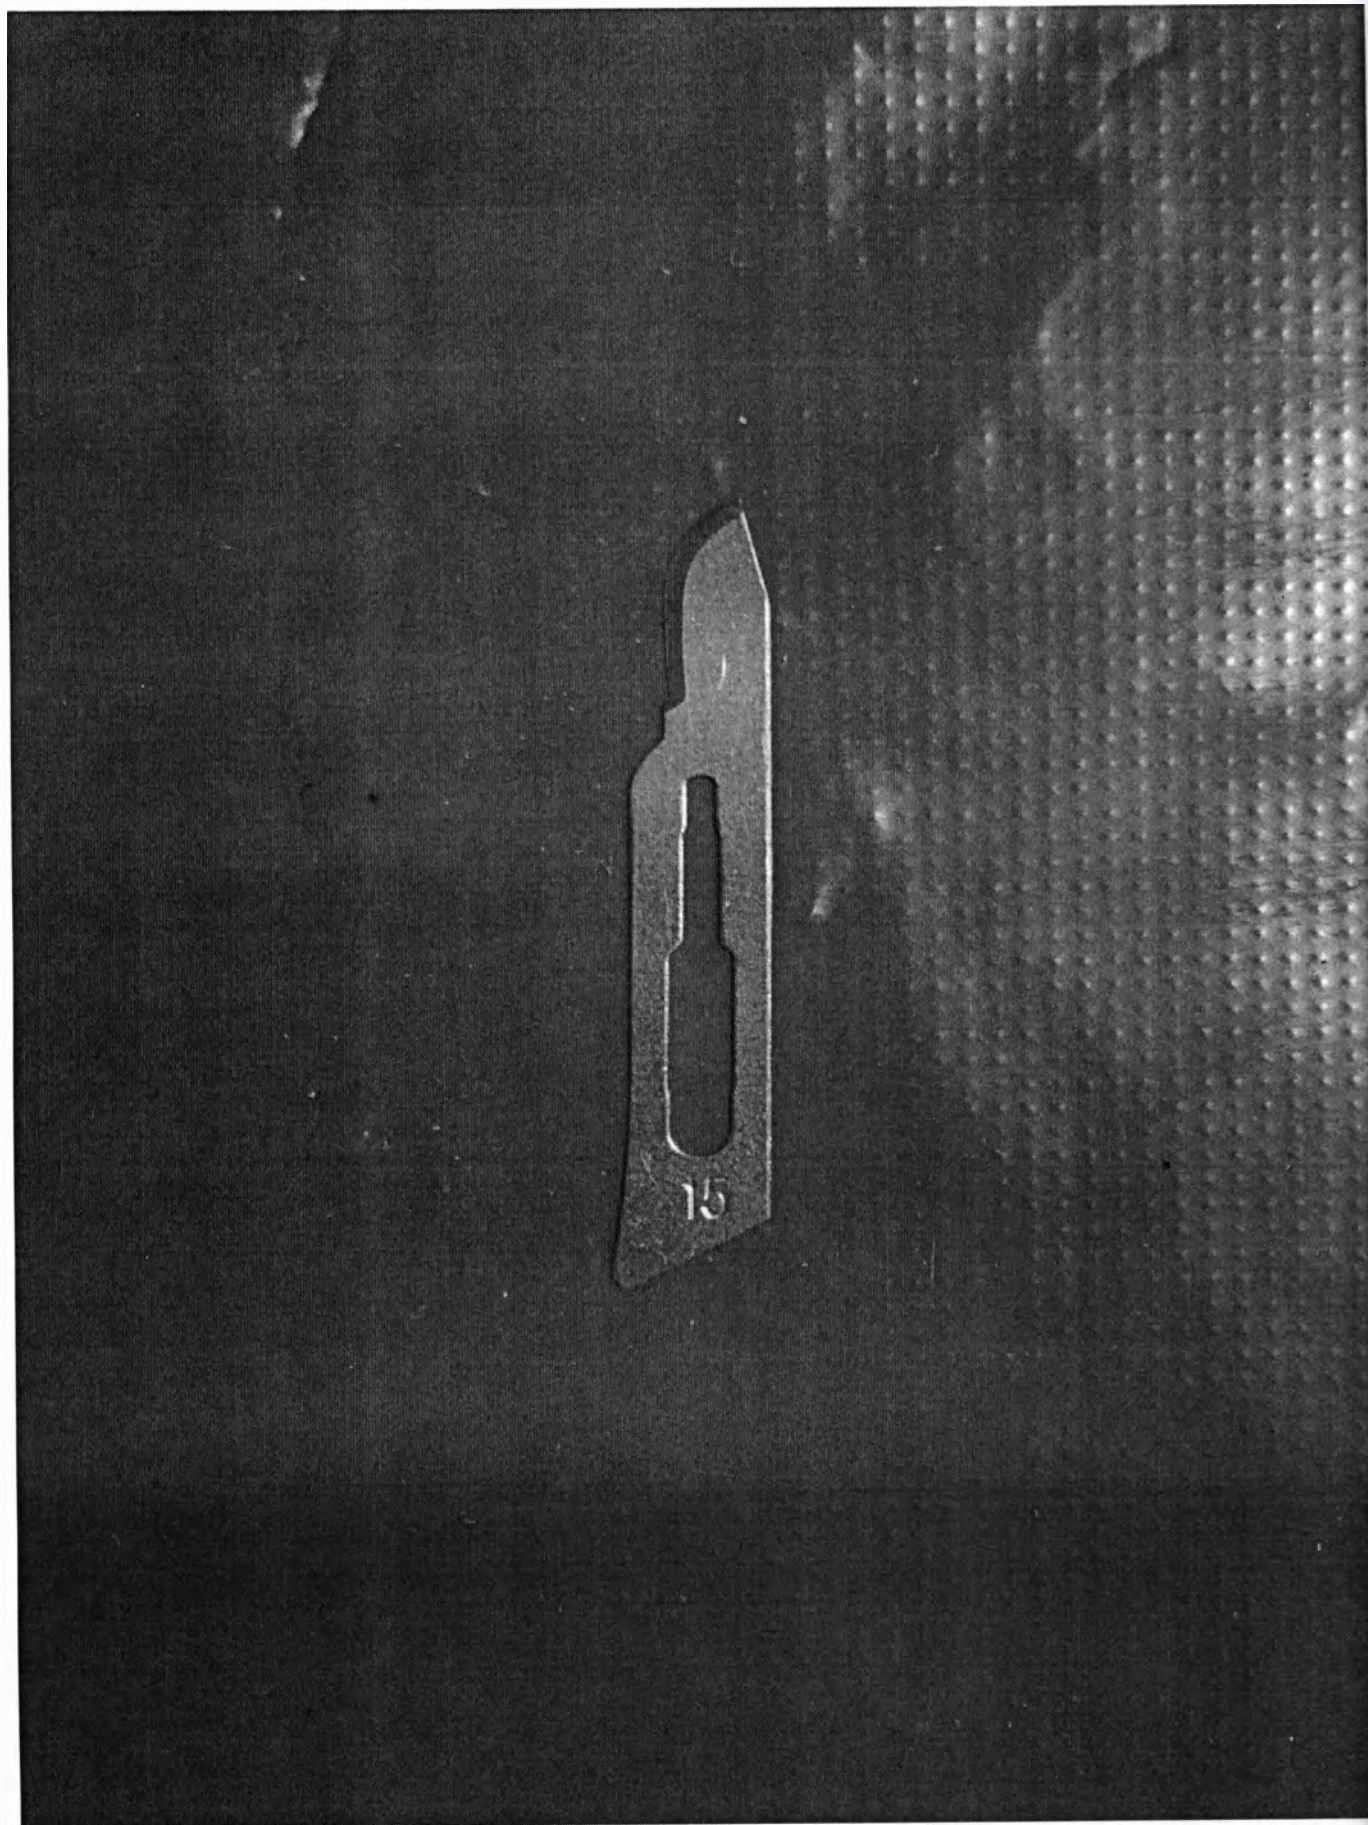


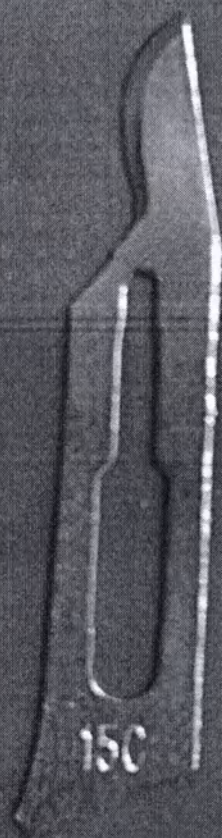


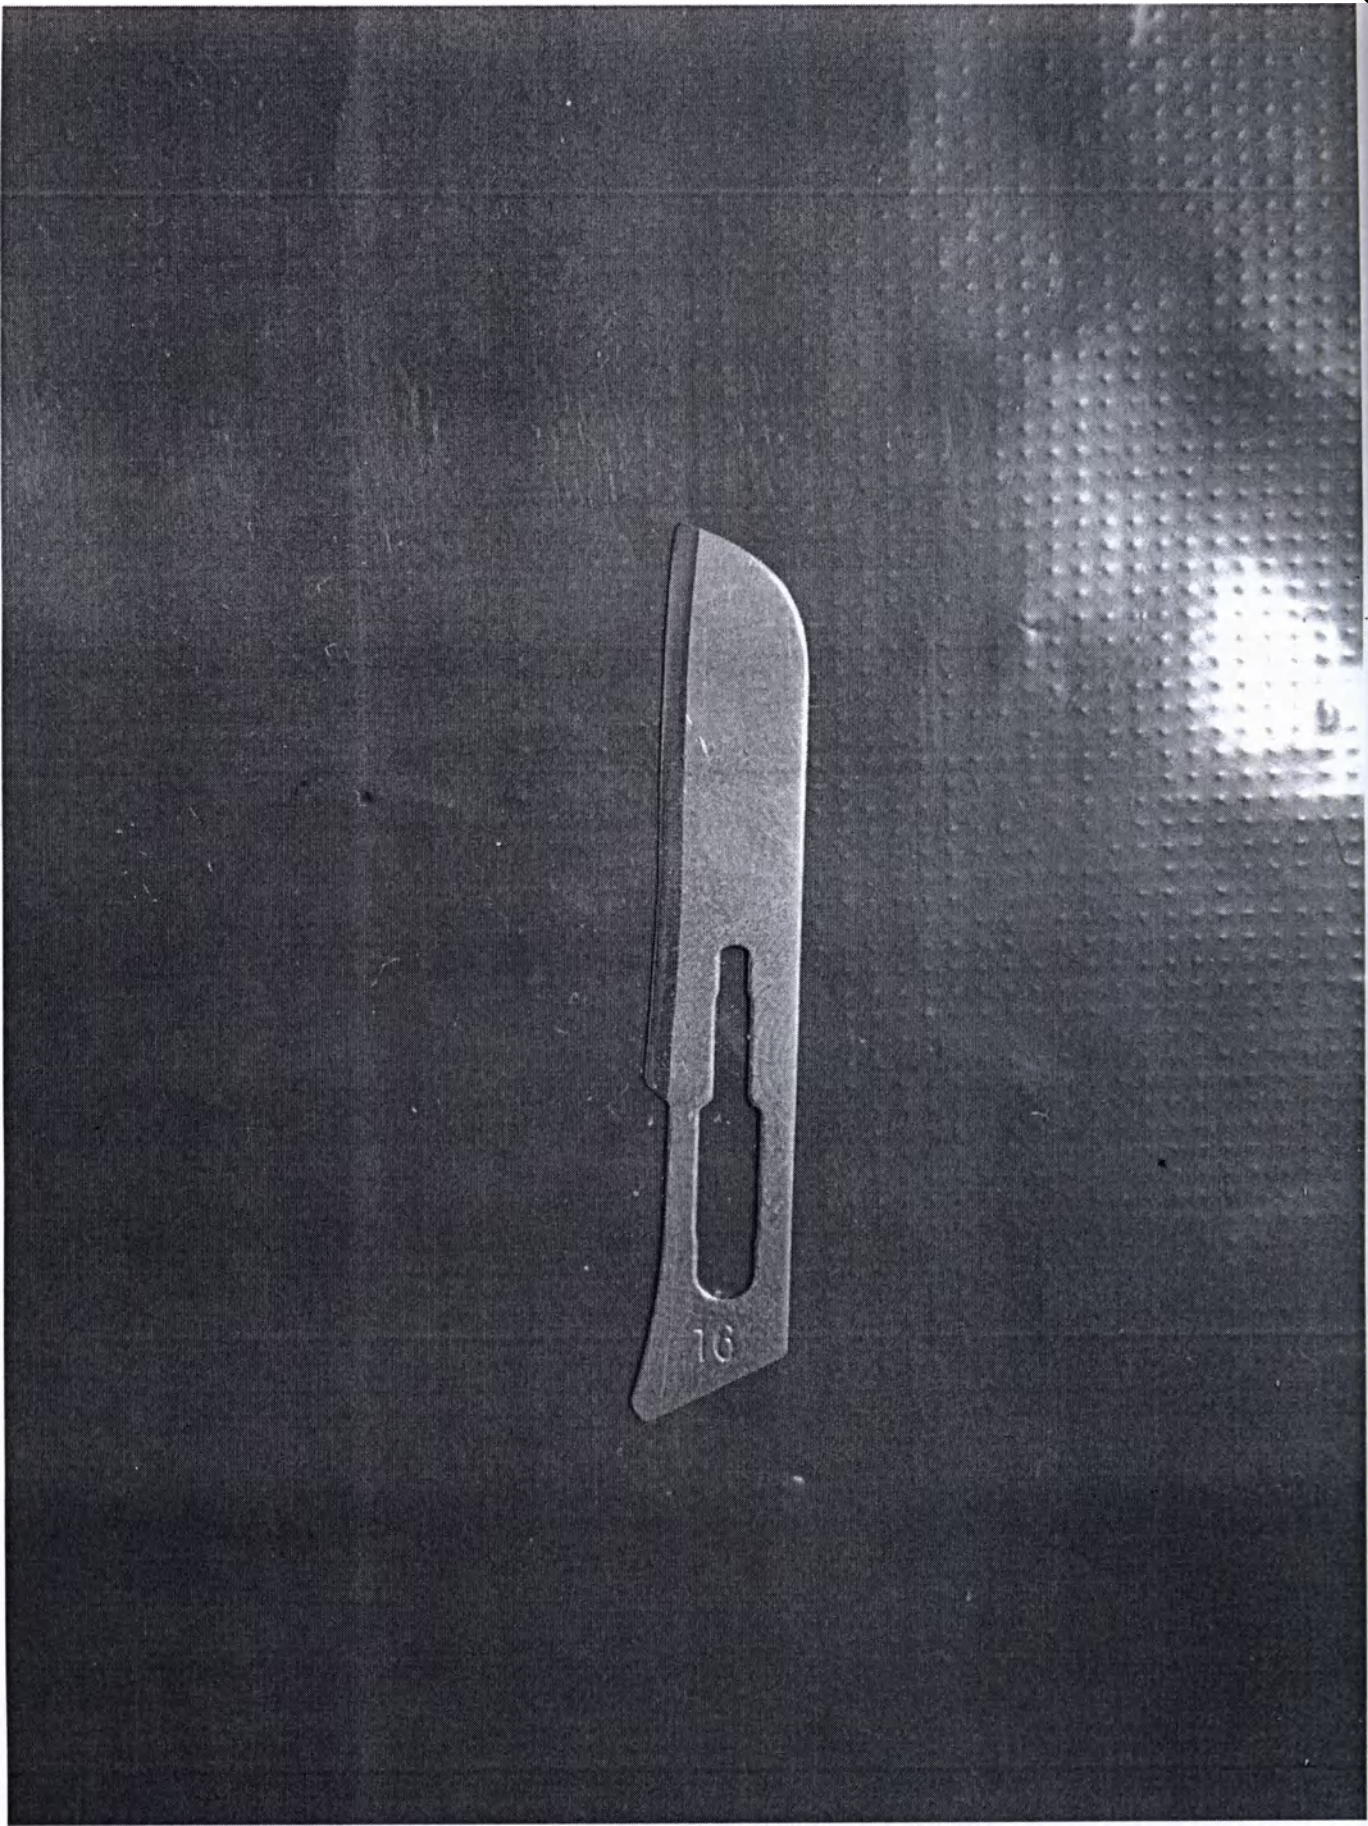


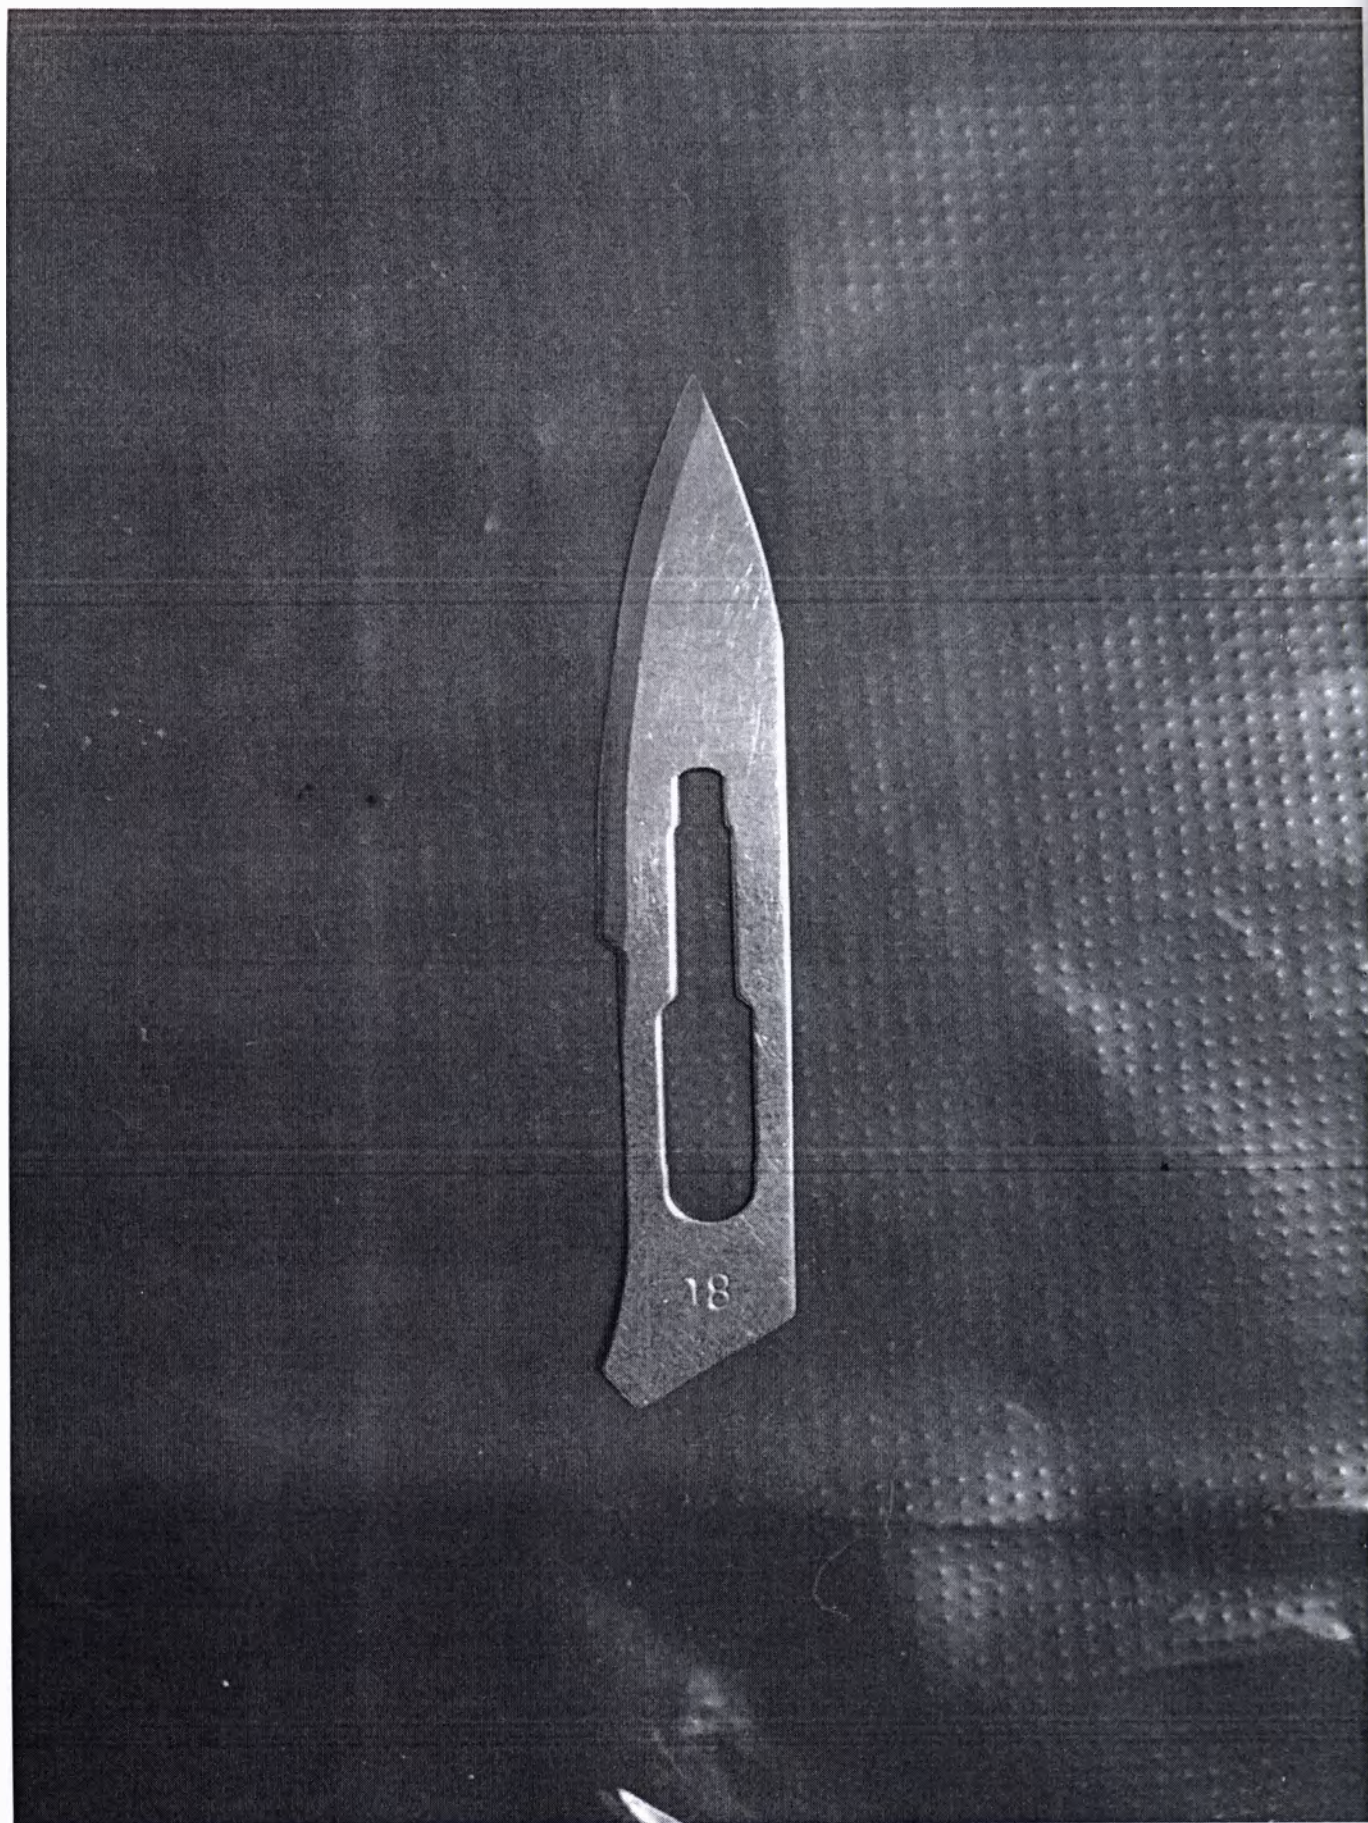


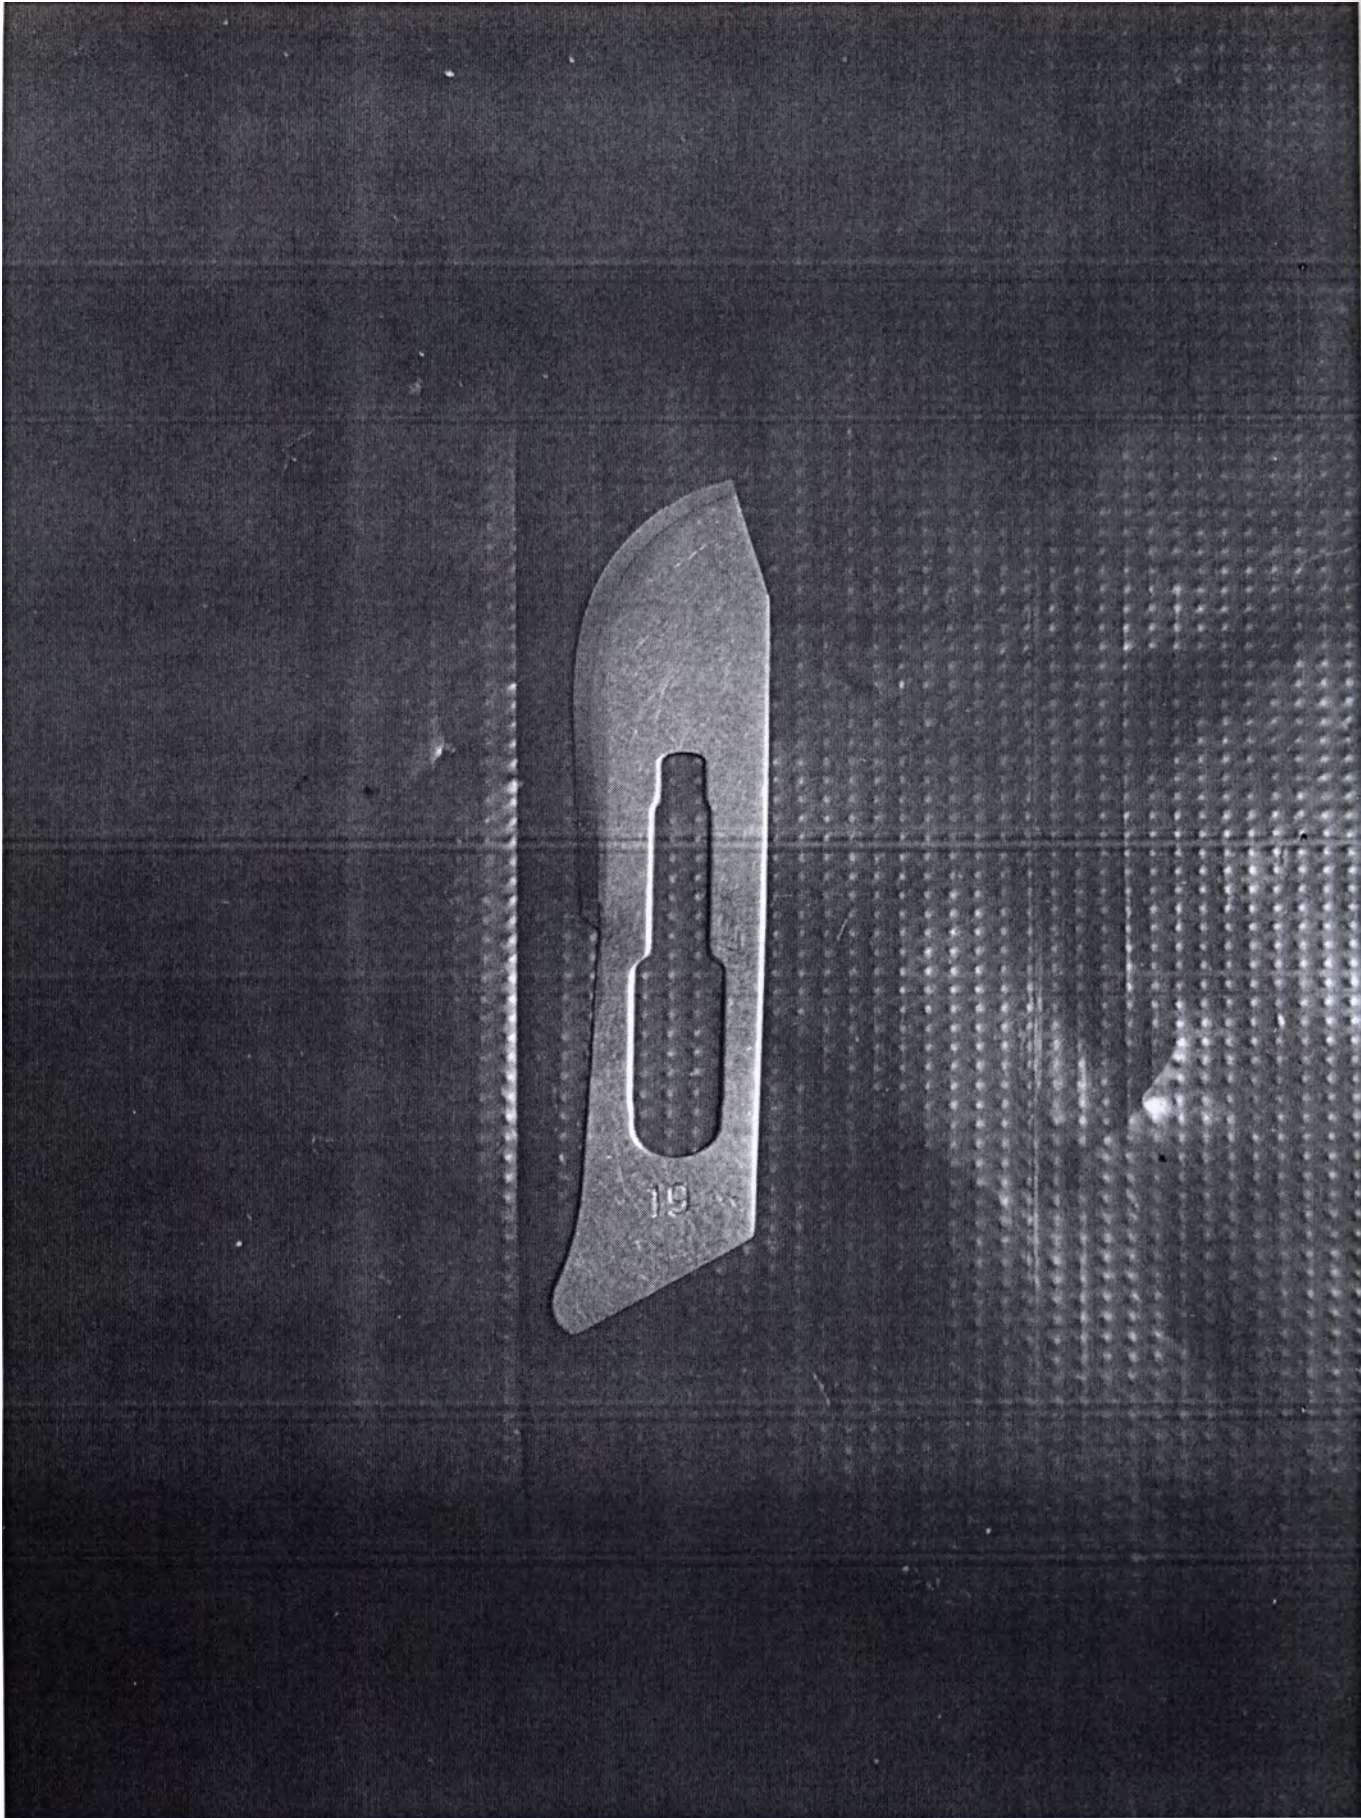


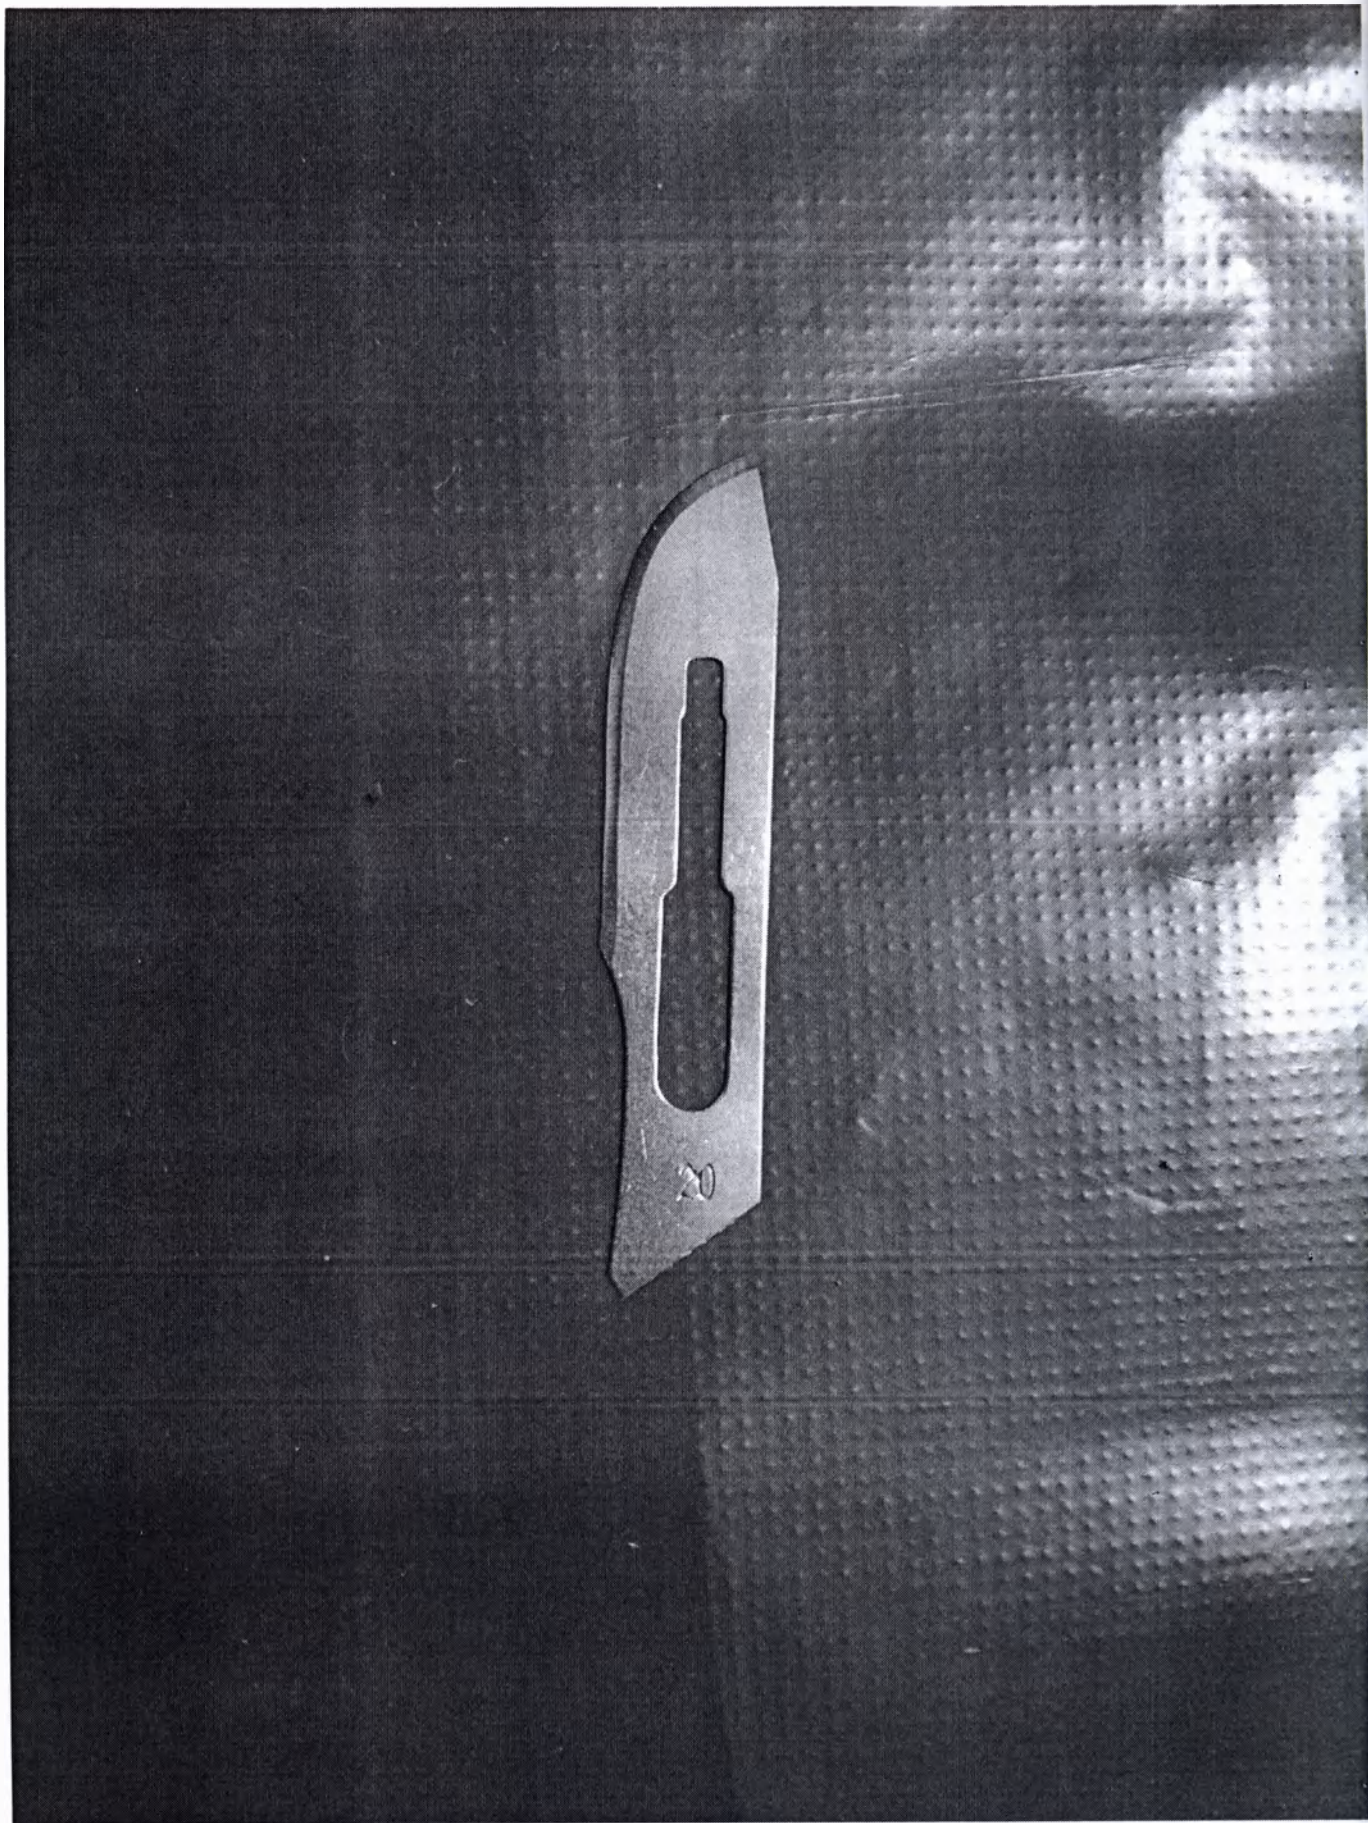


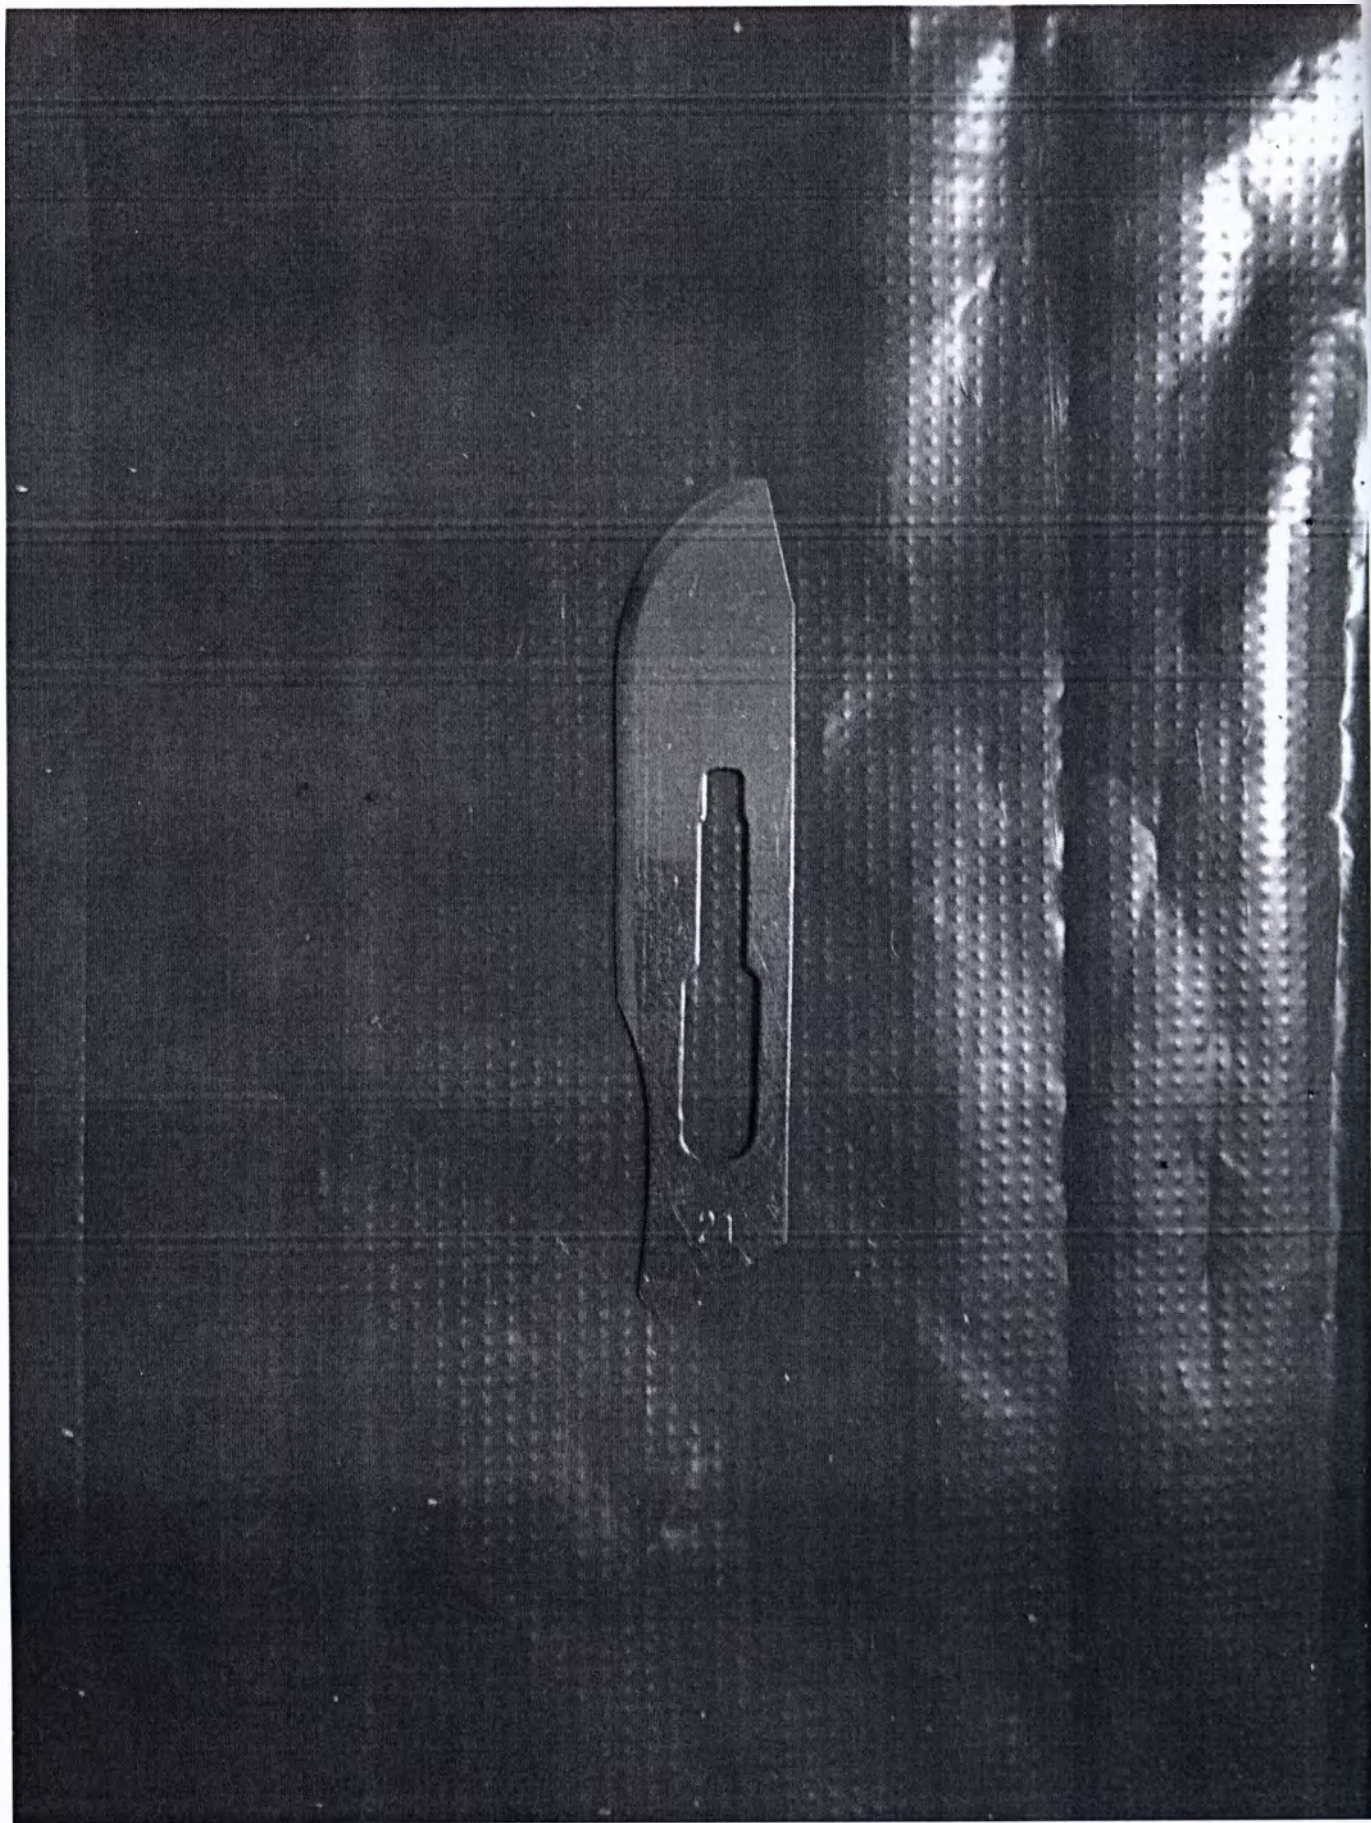


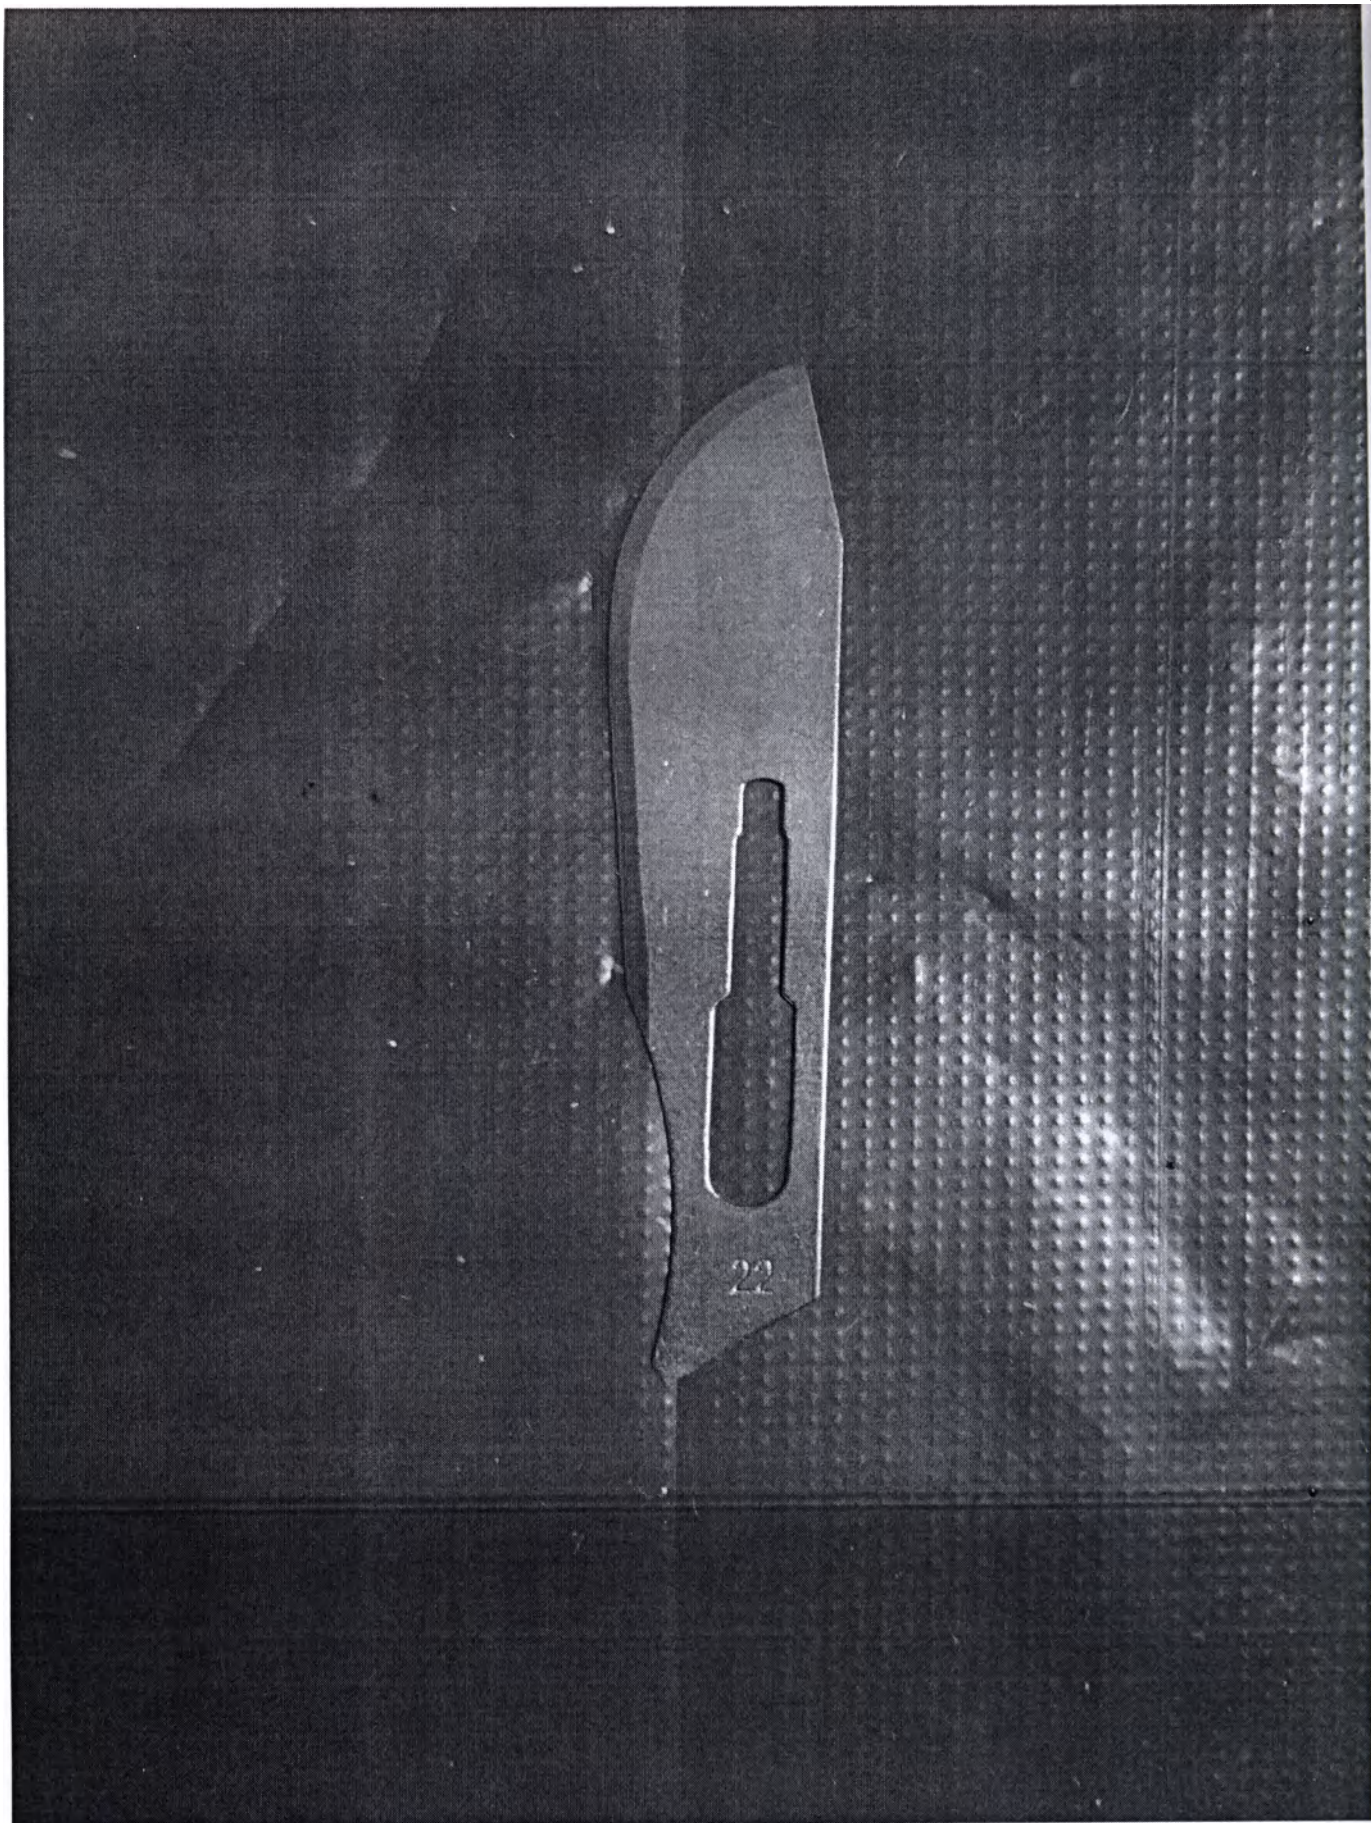

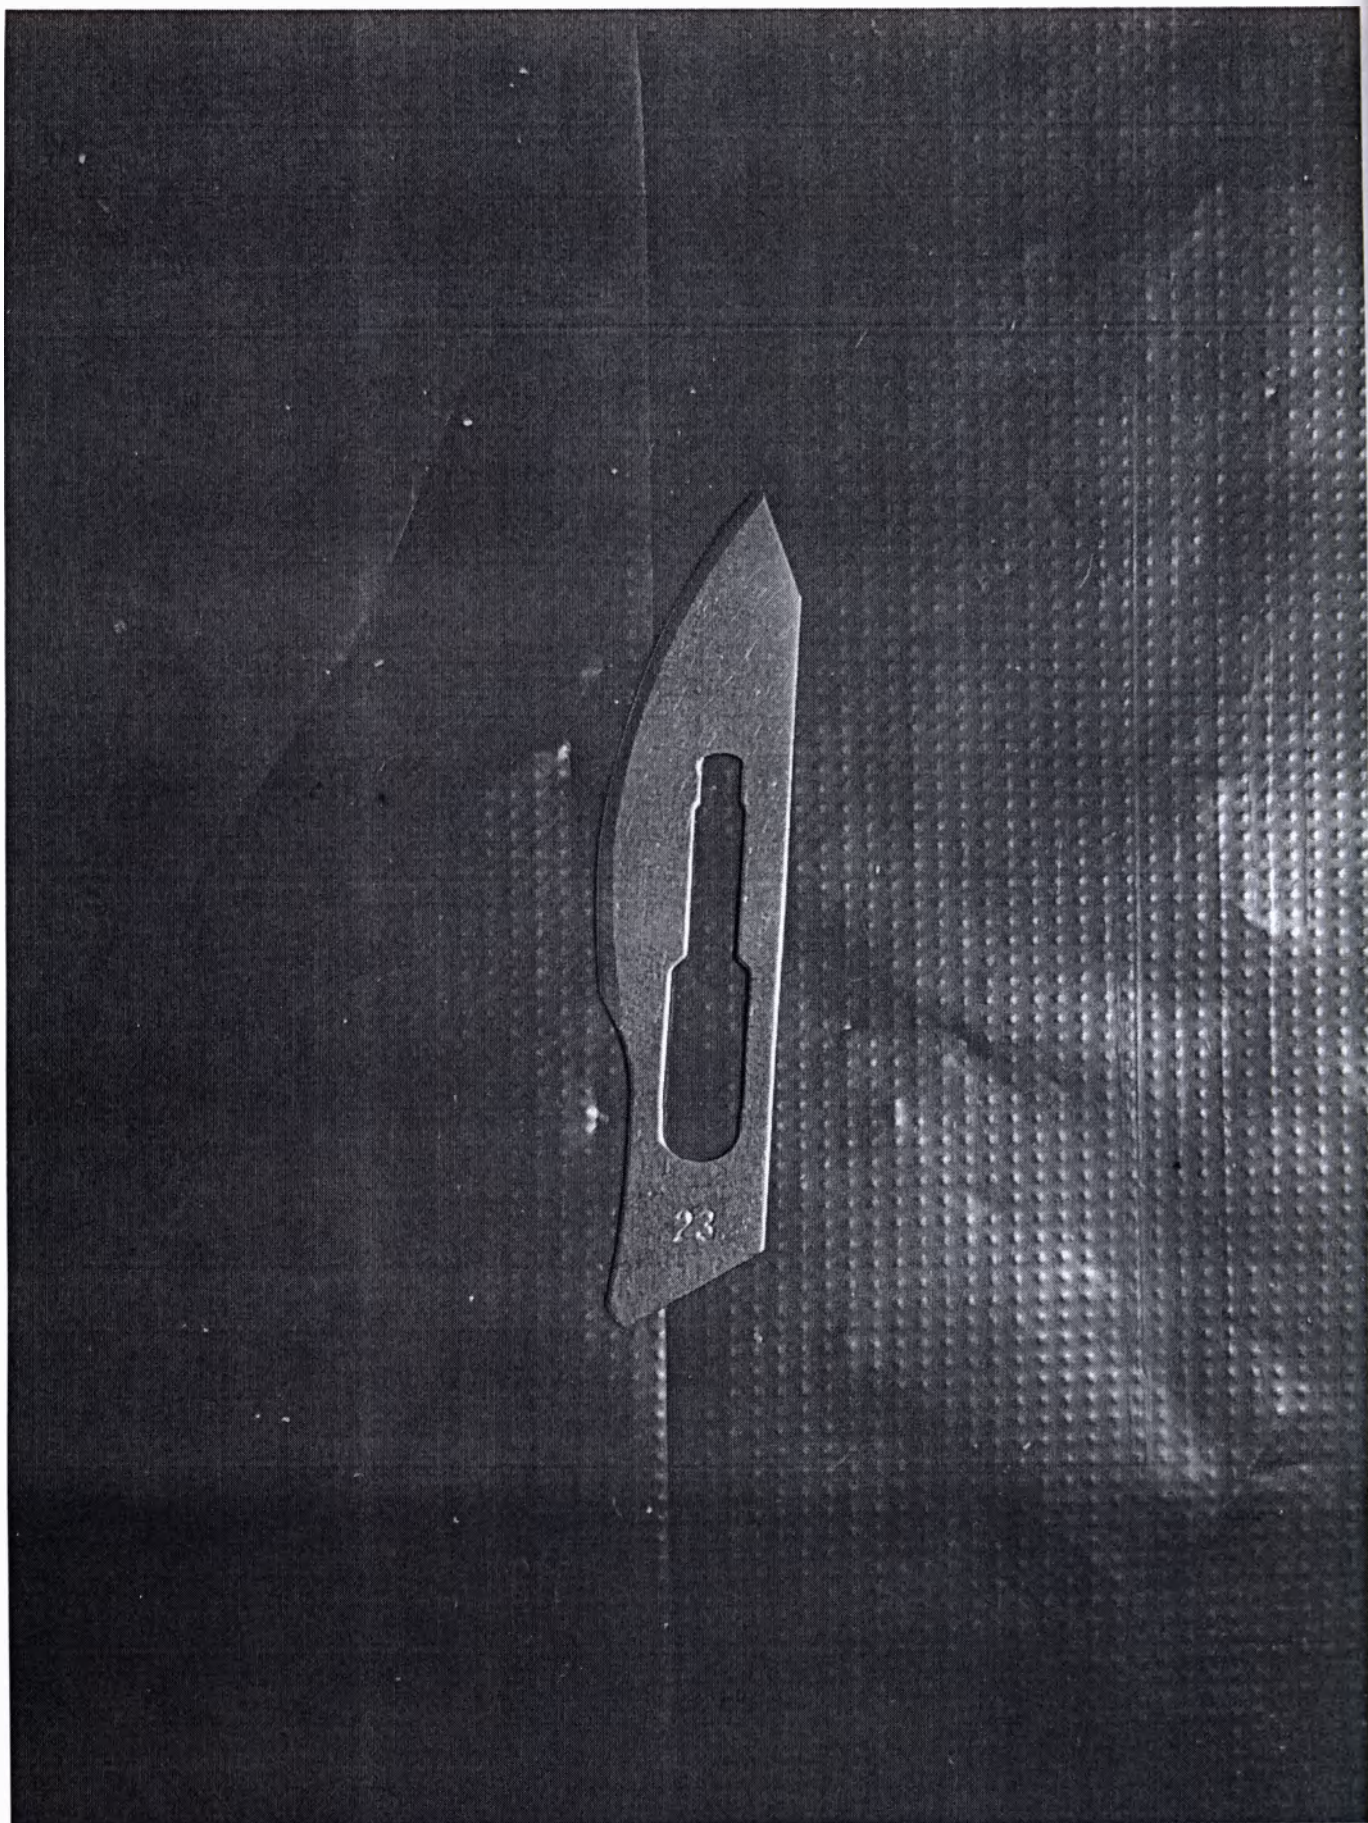

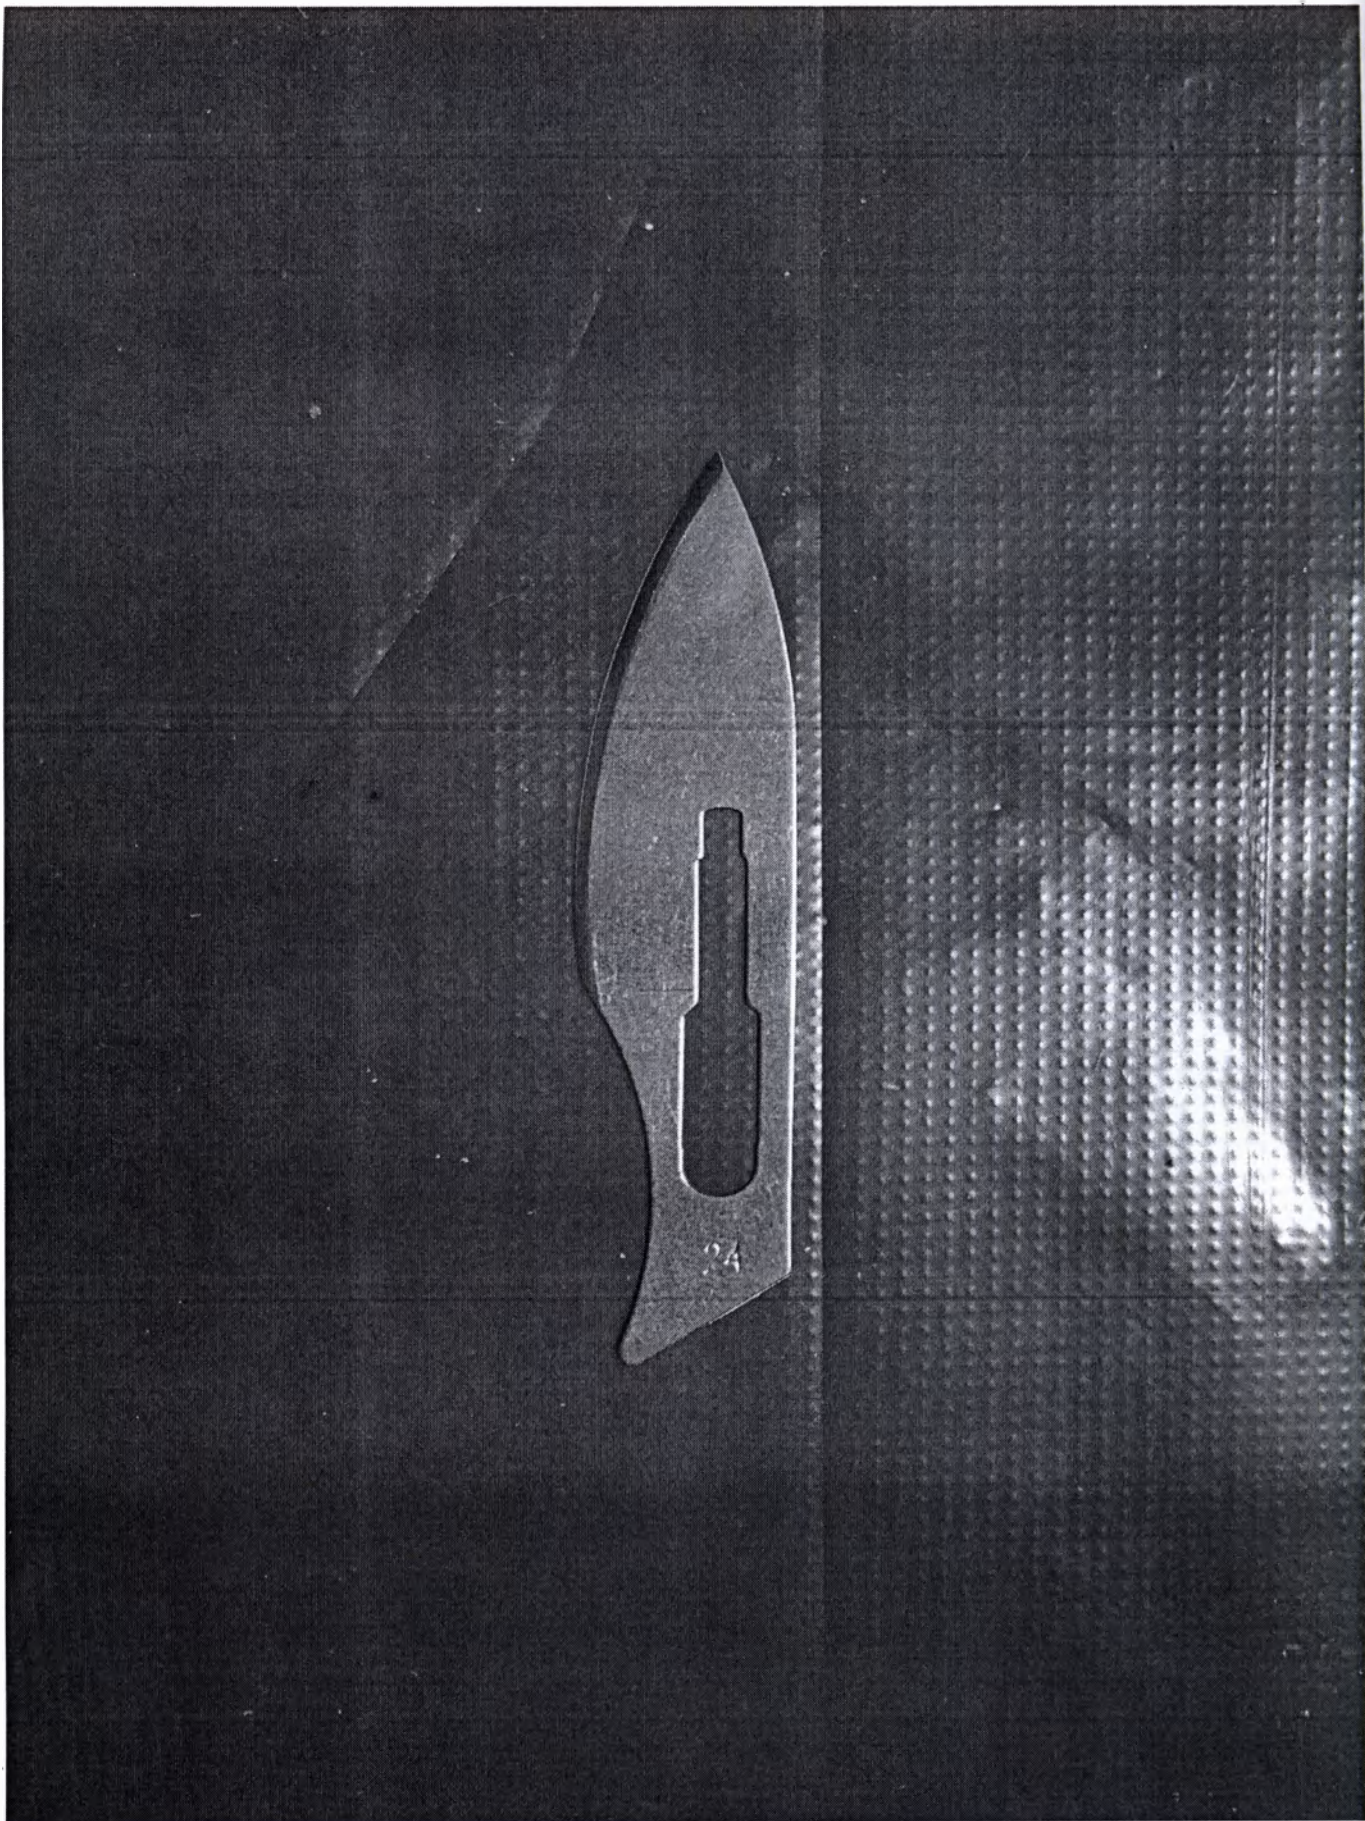

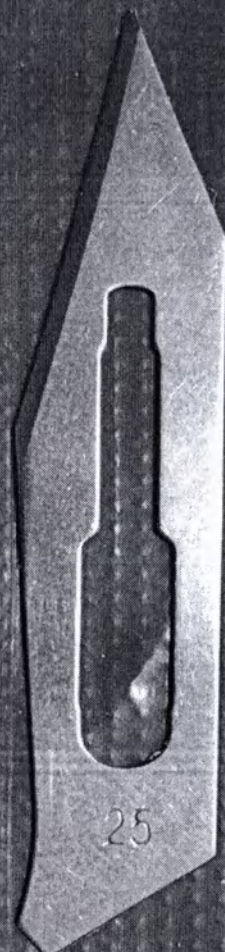

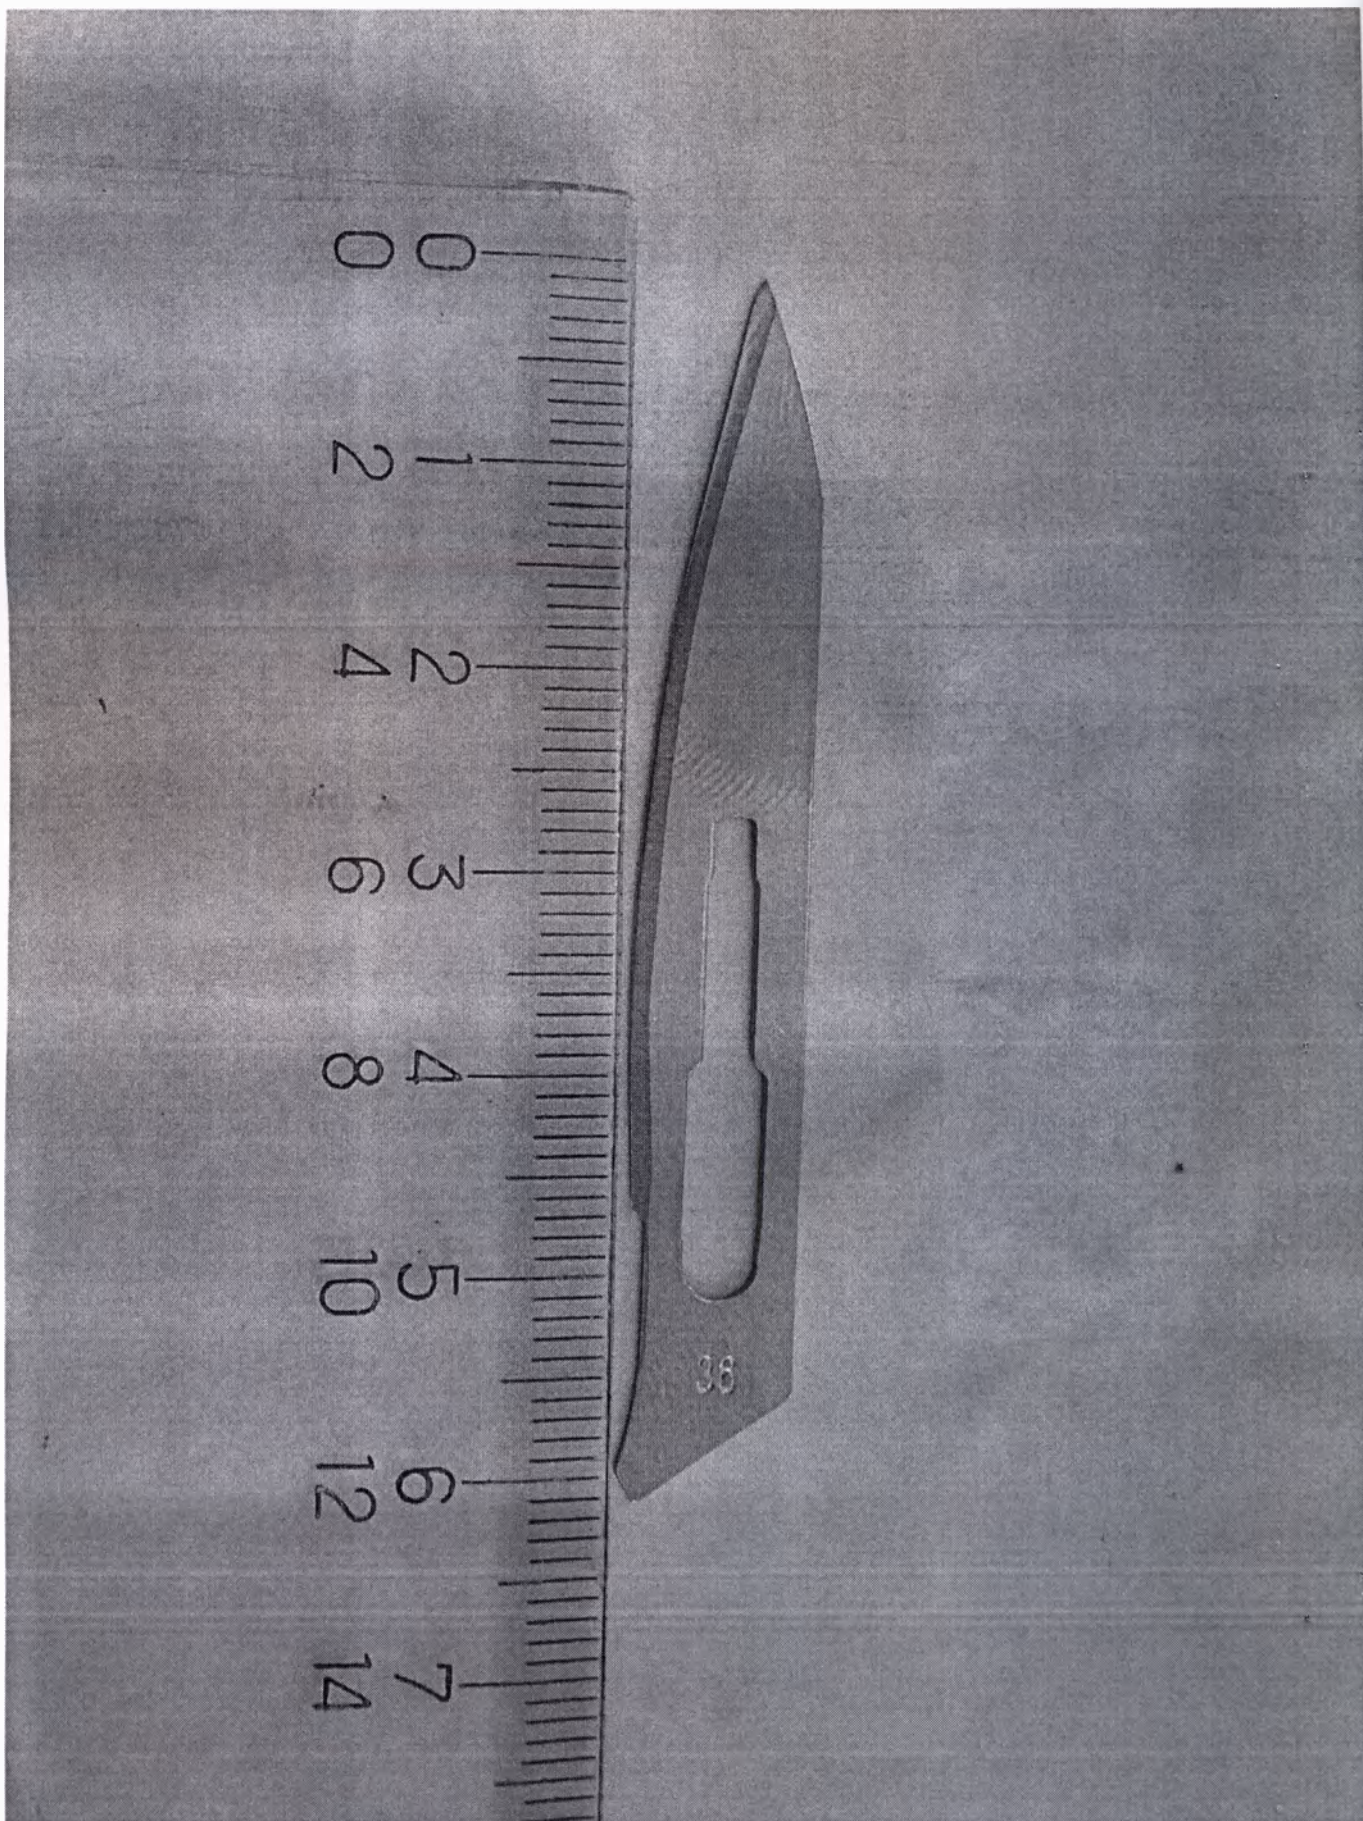



Протнуровано, пронумеровано и скреплено печатью	
17 (визуально)	
Руководитель	Дукашечкин А. П.
Подпись	Дукашечкин А. П.
Дата	08.08.2018 г.



Макеты упаковки МИ "Скальпели и лезвия хирургические стерильные однократного применения ENSENT"

**Лезвие хирургическое стерильное
однократного применения ENSENT,[®]
нержавеющая сталь**



- Стерильно
- Апиrogenно
- Нетоксично

STERILE R

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Рег. удостоверение

Хранить при температуре от -5 до +35°C.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления.

Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай

Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1. info@rafel.ru



YYMM : YYYYMM

YYMM : YYYYMM

LOT : YYMMXX

Размер: 10

**Лезвие хирургическое стерильное
однократного применения ENSENT,[®]
углеродистая сталь**



- Стерильно
- Апиrogenно
- Нетоксично

STERILE R

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Рег. удостоверение

Хранить при температуре от -5 до +35°C.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления.

Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай

Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1. info@rafel.ru





YYMM : YYYYMM

YYMM : YYYYMM

LOT : YYMMXX


Размер: 10

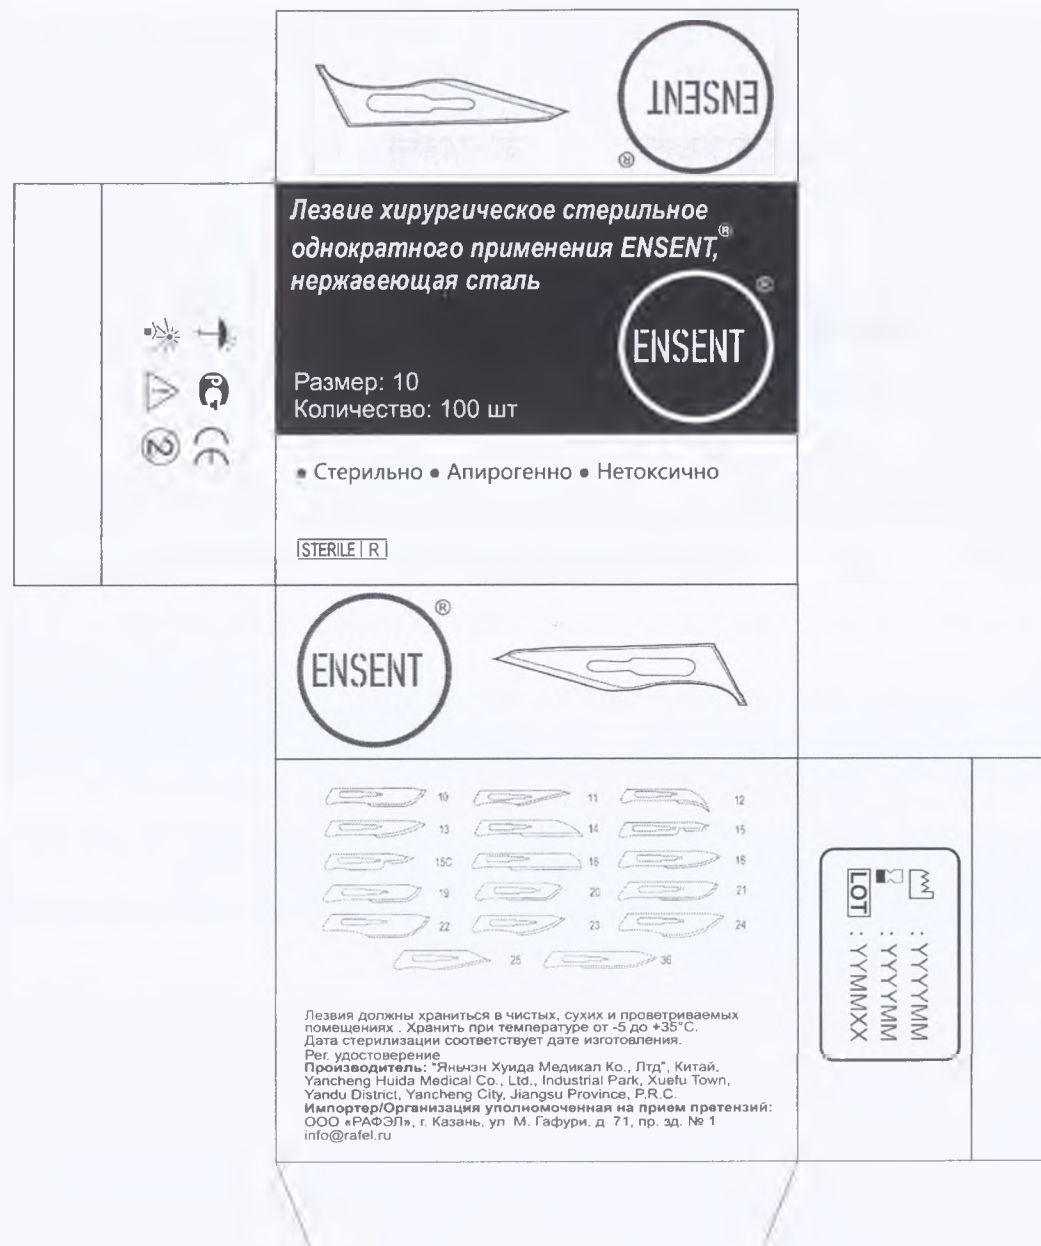

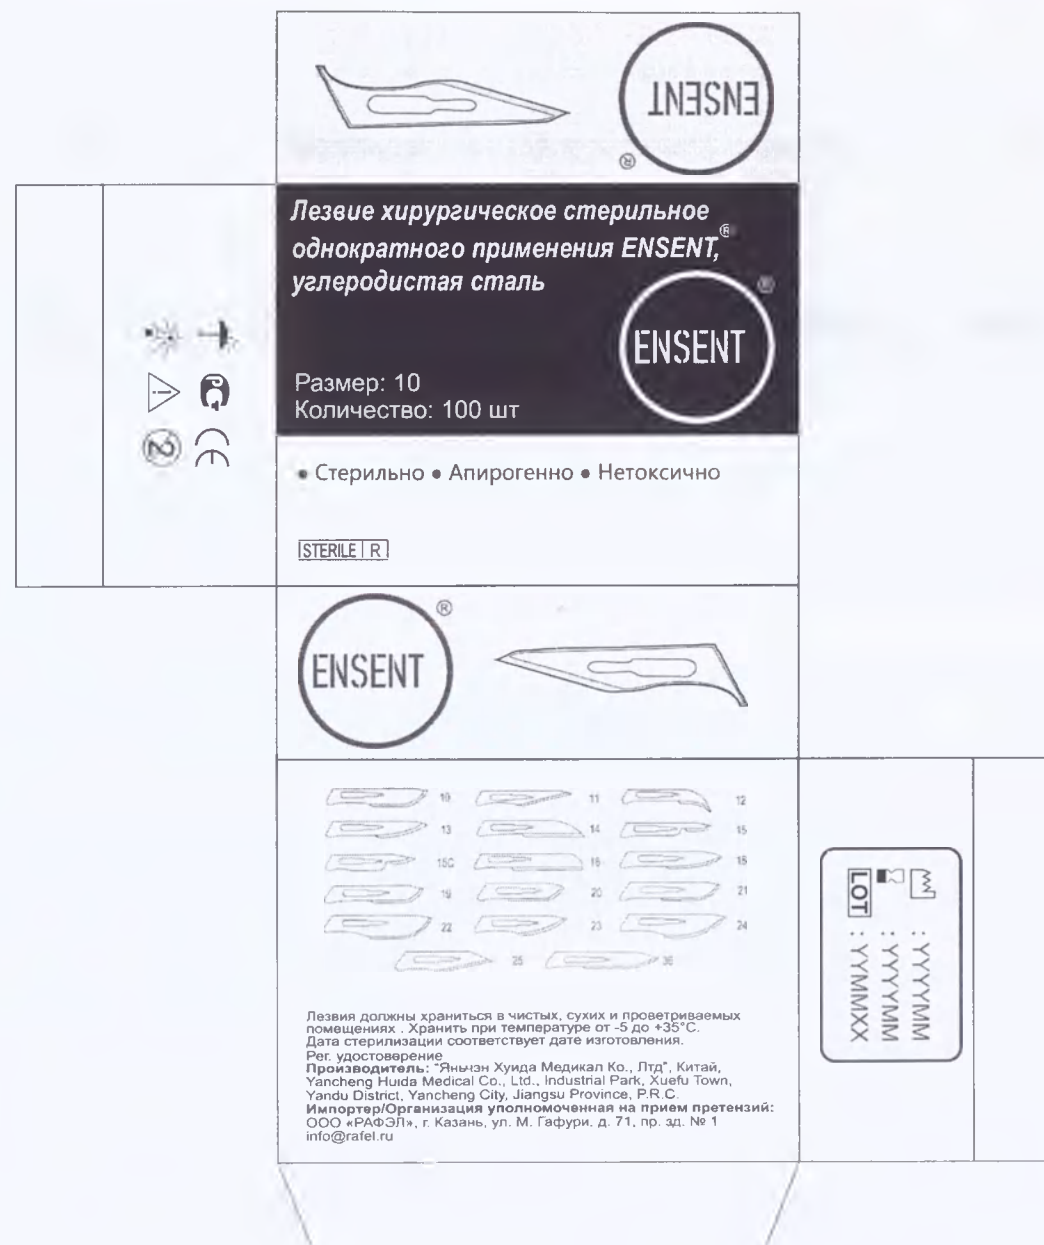

Лезвие хирургическое стерильное однократного применения **ENSENT**, нержавеющая сталь

Размер:	XX
Количество:	XXXXX шт
Вес Брутто:	XXXXX кг
Вес Нетто:	XXXXX кг
Размер кор.:	XXX x XXX x XXX см
	: YYYMM
	: YYYMM
LOT	: YYMMXX

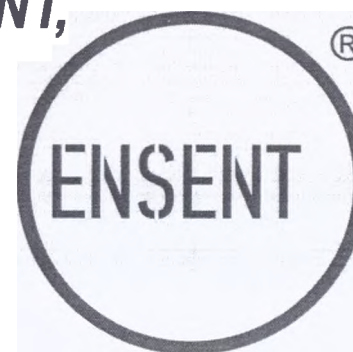

- Стерильно
- Апирогенно
- Нетоксично




Лезвия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течение всего срока годности. Хранить при температуре от -5 до +35°C. Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Рег. удостоверение

Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай, Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

Лезвие хирургическое стерильное однократного применения **ENSENT**, углеродистая сталь

Размер:	XX
Количество:	XXXXX шт
Вес Брутто:	XXXXX кг
Вес Нетто:	XXXXX кг
Размер кор.:	XXX x XXX x XXX см
 :	YYYYMM
 :	YYYYMM
LOT :	YYMMXX

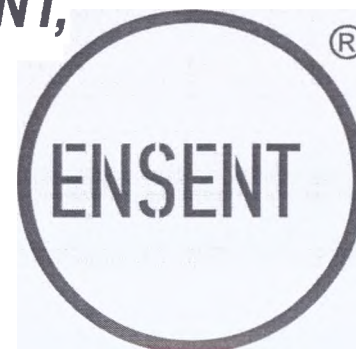

- Стерильно
- Апирогенно
- Нетоксично



STERILE R



Лезвия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течение всего срока годности. Хранить при температуре от -5 до +35°C. Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Рег. удостоверение

Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай, Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

Макеты упаковки МИ “Скальпели и лезвия хирургические стерильные однократного применения **ENSENT**”

**Скальпель хирургический стерильный
однократного применения **ENSENT**,
нержавеющая сталь**

• Стерильно • Апиrogenно • Нетоксично

ENSENT

STERILE R

Рег. удостоверение
Хранить при температуре от -5 до +35°C.
Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Производитель: “Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд”, Китай
Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

PG CE 2 ! ⚡ ☂

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

☞ : YYYYMM
☞ : YYYYMM
☞ : YYMMXX

Размер: 10

**Скальпель хирургический стерильный
однократного применения **ENSENT**,
углеродистая сталь**

• Стерильно • Апиrogenно • Нетоксично

ENSENT

STERILE R

Рег. удостоверение
Хранить при температуре от -5 до +35°C.
Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Производитель: “Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд”, Китай
Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

PG CE 2 ! ⚡ ☂

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

☞ : YYYYMM
☞ : YYYYMM
☞ : YYMMXX

Размер: 10



**Скальпель хирургический стерильный
однократного применения ENSENT,[®]
нержавеющая сталь**



• Стерильно • Апиrogenно • Нетоксично


Размер: 10
Количество: 10 шт


YYYYMM
YYYYMM
YYMMXX
LOT




Скальпели должны храниться в чистых, сухих и проветриваемых помещениях. Хранить при температуре от -5 до +35°C.
Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Рег. удостоверение
Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай,
Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu
District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.
Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

STERILE R

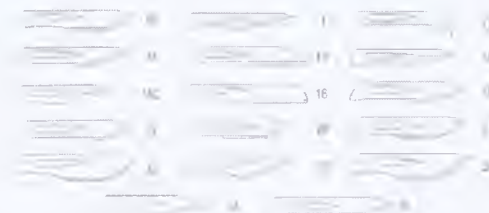



**Скальпель хирургический стерильный
однократного применения ENSENT,[®]
углеродистая сталь**




• Стерильно • Апиrogenно • Нетоксично

Размер: 10


Количество: 10 шт

YYYYMM
YYYYMM
LOT
YYYYMMXX




Скальпели должны храниться в чистых, сухих и проветриваемых помещениях. Хранить при температуре от -5 до +35°C.
Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Рег. удостоверение
Производитель: "Яньчэн Хuida Медикал Ко., Лтд", Китай,
Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu
District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.
Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

STERILE R

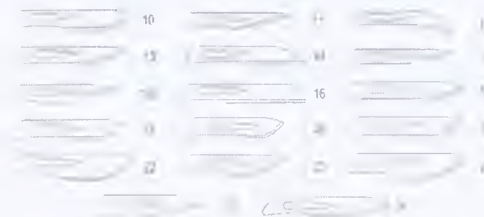


Скальпель хирургический стерильный однократного применения **ENSENT**, нержавеющая сталь

Размер:	XX
Количество:	XXXXX шт
Вес Брутто:	XXXXX кг
Вес Нетто:	XXXXX кг
Размер кор.:	XXX x XXX x XXX см
 :	YYYYMM
 :	YYYYMM
LOT :	YYMMXX

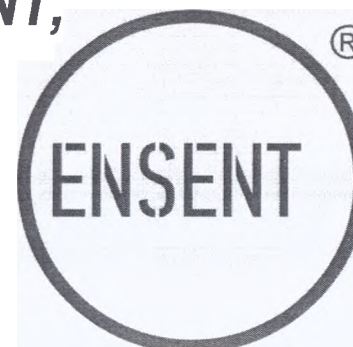

- Стерильно
- Апирогенно
- Нетоксично

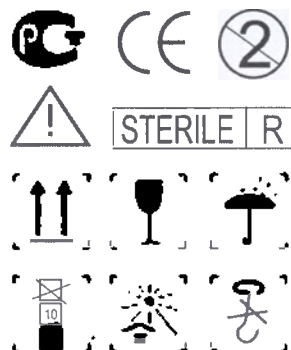


Скальпели должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течение всего срока годности. Хранить при температуре от -5 до +35°C. Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Рег. удостоверение

Производитель: "Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд", Китай, Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

Скальпель хирургический стерильный однократного применения **ENSENT[®]**, углеродистая сталь

Размер:	XX	
Количество:	XXXXX	шт
Вес Брутто:	XXXXX	кг
Вес Нетто:	XXXXX	кг
Размер кор.:	XXX x XXX x XXX	см
	: YYYYMM	
	: YYYYMM	
LOT	: YYMMXX	

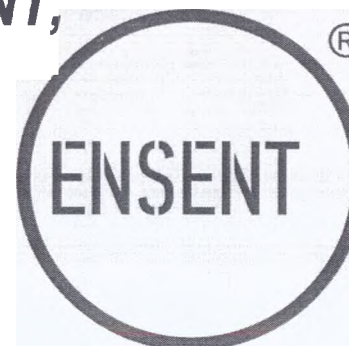

- Стерильно
- Апирогенно
- Нетоксично




Скальпели должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течение всего срока годности. Хранить при температуре от -5 до +35°C. Дата стерилизации соответствует дате изготовления.
Рег. удостоверение

Производитель: “Яньчэн Хуида Медикал Ко., Лтд”, Китай,
Yancheng Huida Medical Co., Ltd., Industrial Park, Xuefu Town, Yandu District, Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, пр. зд. № 1
info@rafel.ru

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
10 (десять) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

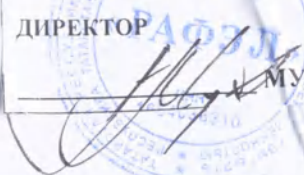
МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р.