

Общество с ограниченной ответственностью
«Страйкер»

ИНН 7731561935 ОГРН 1077746362770 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80 тел. (495) 785-07-18

Генеральный директор ООО "Страйкер"

Усачев Д.А.

(Подпись)

4 августа 2018 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Инструменты для установки имплантатов для остеосинтеза VariAx 2 с принадлежностями



1. Вставка для рукоятки канюлированная, соединение АО

2. Вставка для рукоятки с храповым механизмом, канюлированная, соединение АО



3. Втулка для сверла для направляющего блока ладонной пластины дистального отдела лучевой кости



4. Держатель универсальный




5. Джойстик направляющего блока для верхней латеральной пластины; 6. Джойстик направляющего блока для винтов T8; 7. Джойстик направляющего блока



9. Зажим для пластины; 10. Зажим репозиционный большой; 11. Зажим репозиционный прямой; 12. Зажим репозиционный прямой, широкий.



13. Зенковка для 2.7/3.5 винтов мм, АО.

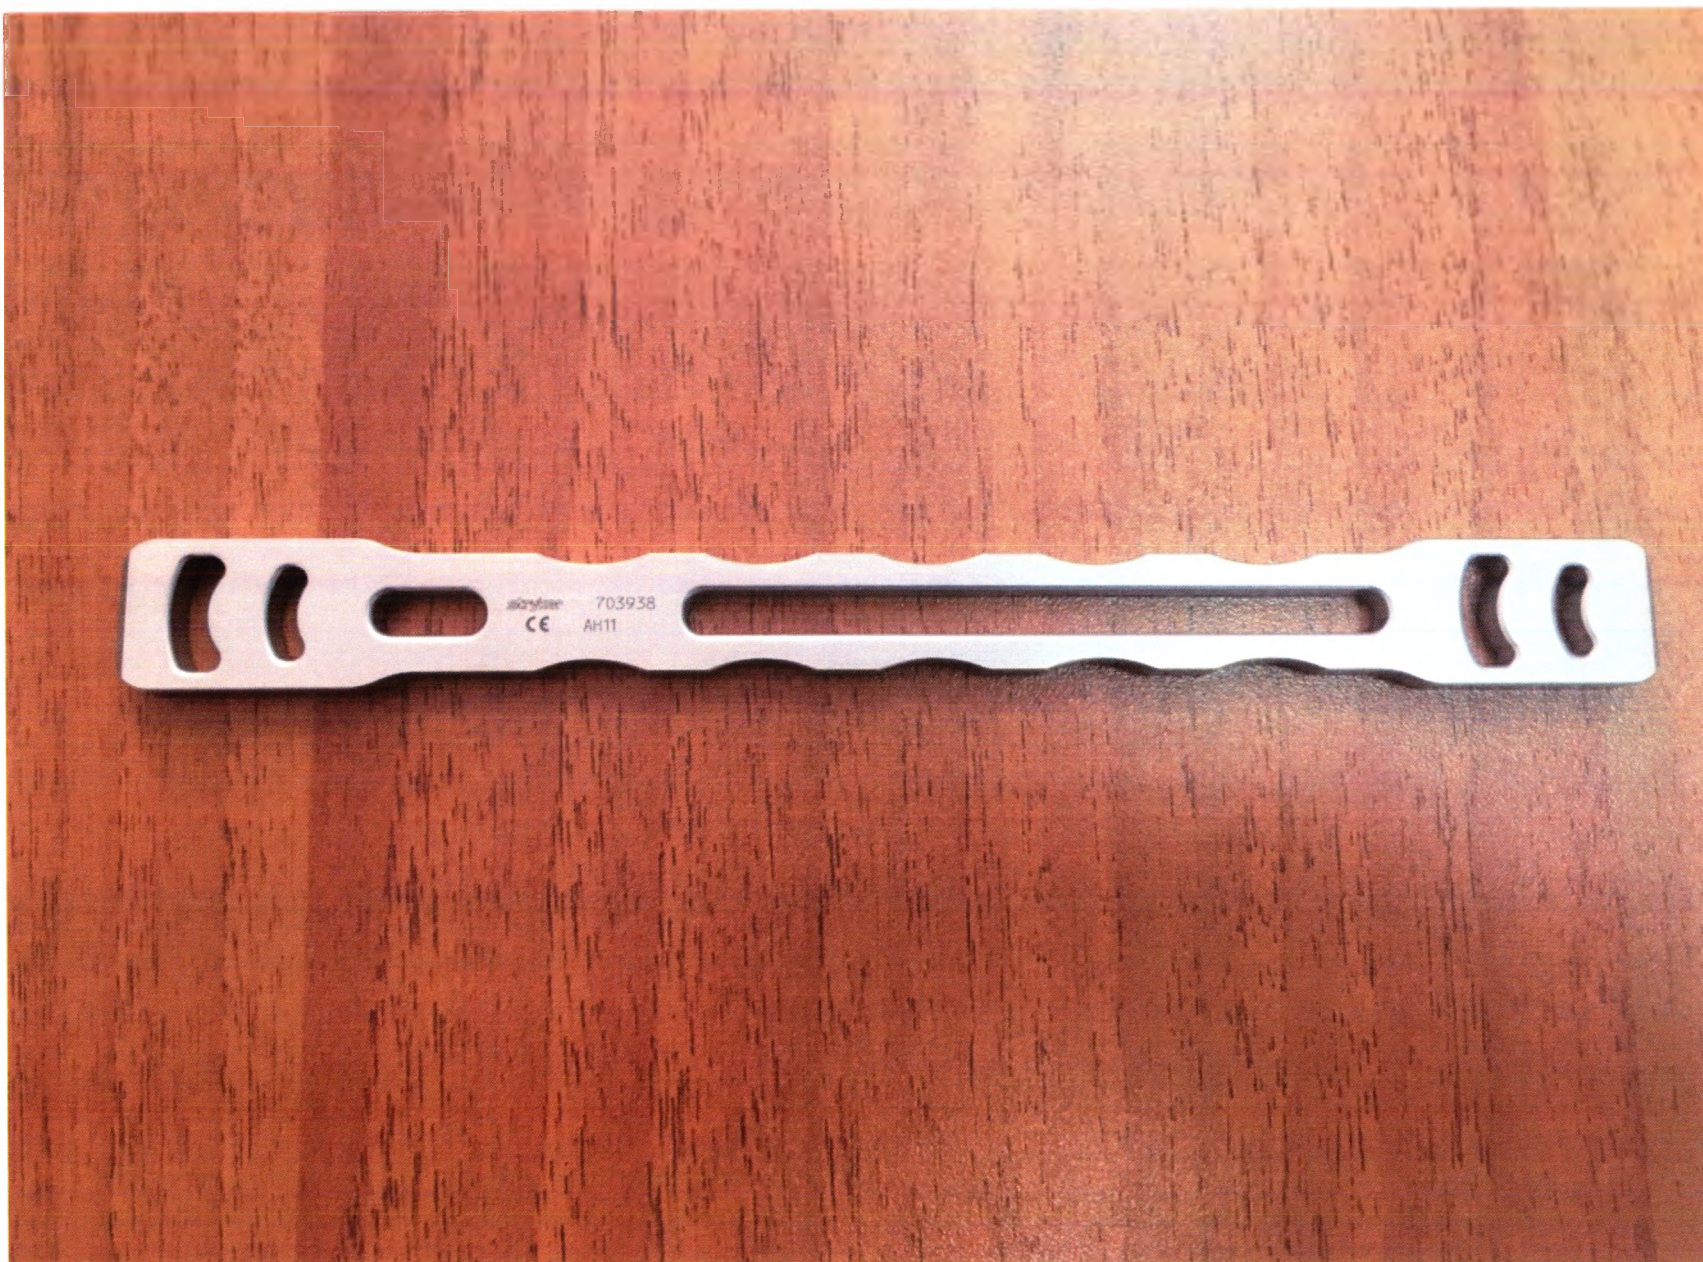

14. Изгибатель для пластин.



15. Измеритель длины для винтов 2.4 мм-3.5 мм; 16. Измеритель длины для винтов T8/T10; 17. Измеритель шаблона пластины с крючком



18. Крючок острый



19. Метчик для винтов 2,4 мм, АО; 20. Метчик для винтов 2,7 мм, АО; 21. Метчик для винтов 3,5 мм, АО.



22. Направитель для спицы Киршнера 1.1 мм / для сверла 2.0 мм, Т8, с фиксированным углом



23. Направитель сверла для компрессии/полиаксиальных винтов 2,0 мм (Т8)



24. Направитель сверла для компрессии/полиаксиальных винтов 2,0 мм (T10); 25. Направитель сверла для компрессии/полиаксиальных винтов 2,6 мм (T10); 26. Направитель сверла для стягивающего винта 2,4 мм (T8). 27. Направитель сверла для стягивающего винта 2,7 мм (T8). 28. Направитель сверла для стягивающего винта 2,7 мм (T10). 29. Направитель сверла для стягивающего винта 3,5 мм (T10). 30. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, промежуточной, левой. 31. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, промежуточной, правой. 32. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, стандартной, левой. 33. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, стандартной, правой. 34. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, узкой, левой. 35. Направляющий блок для ладонной пластины дистального отдела лучевой кости, узкой, правой. 36. Направляющий блок для латеральной верхней пластины, левой.



38. Пин фиксирующий. 39. Пин фиксирующий направляющего блока для дистального отдела лучевой кости



40. Развертка, 2.7 мм x 122 мм, T8, АО.



41. Развертка, соединение АО, 2.4 мм x 122 мм; 42. Развертка, соединение АО, 2.7 мм x 122 мм; 43. Развертка, соединение АО, 3.5 мм x 122 мм.




44. Ретрактор Нохманн; 45. Ретрактор Нохманн 6 мм; 46. Ретрактор Нохманн 8 мм. 47. Ретрактор Нохманн 15 мм.; 48. Ретрактор Нохманн 18 мм



49. Рукоятка средняя; 50. Рукоятка большая



51. Сверло быстрого соединения, для винтов 2.0 мм, соединение АО (L=30 мм); **52.** Сверло быстрого соединения, для винтов 2.0 мм, соединение АО (L=70 мм);

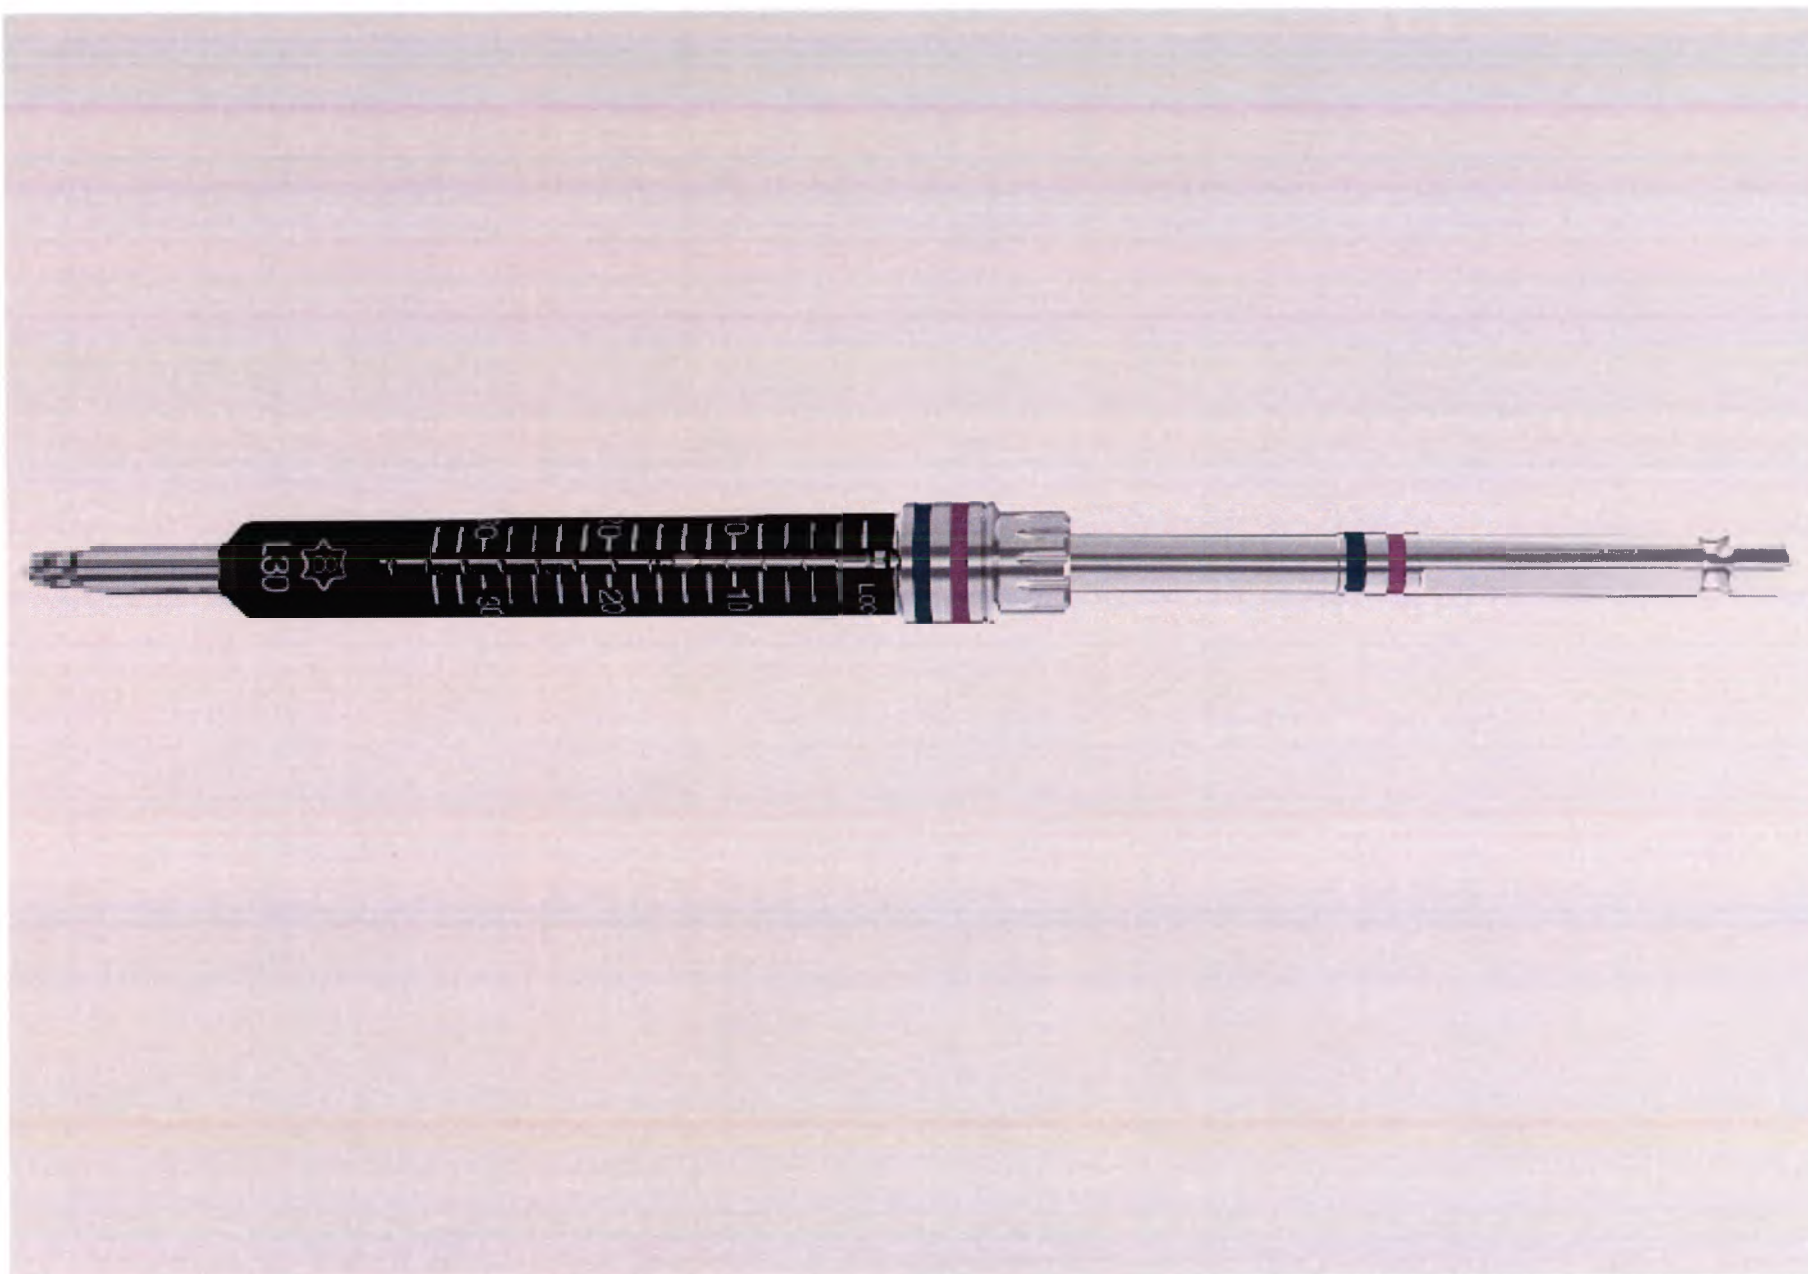

53. Сверло быстрого соединения, для винтов 2.4/2.7мм, T8 (L=30 мм).



54. Сверло быстрого соединения, для винтов 2.6 мм, соединение АО (L=30 мм); 55. Сверло быстрого соединения, для винтов 2.6 мм, соединение АО (L=70 мм).



56. Сверло быстрого соединения, для винтов 2.7 мм, T10 (L=70 мм); **57.** Сверло быстрого соединения, для винтов 2.7мм, T10 (L=30 мм); **58.** Сверло быстрого соединения, для винтов 3.5 мм, T10 (L=30 мм); **59.** Сверло быстрого соединения, для винтов 3.5 мм, T10 (L=70 мм).



60. Сверло, 2.0 мм x 135 мм, АО, с разметкой; 61. Сверло, 2.6 мм x 220 мм, АО.



62. Сверло, соединение АО, 2.0 мм x 135 мм, с разметкой; 63. Сверло, соединение АО, 2.6 мм x 135 мм, с разметкой;




64. Стержень отвертки, АО, Т10, 180 мм, самоудерживающий. 65. Стержень отвертки, АО, Т10, самоудерживающий..





67. Уплотнитель.

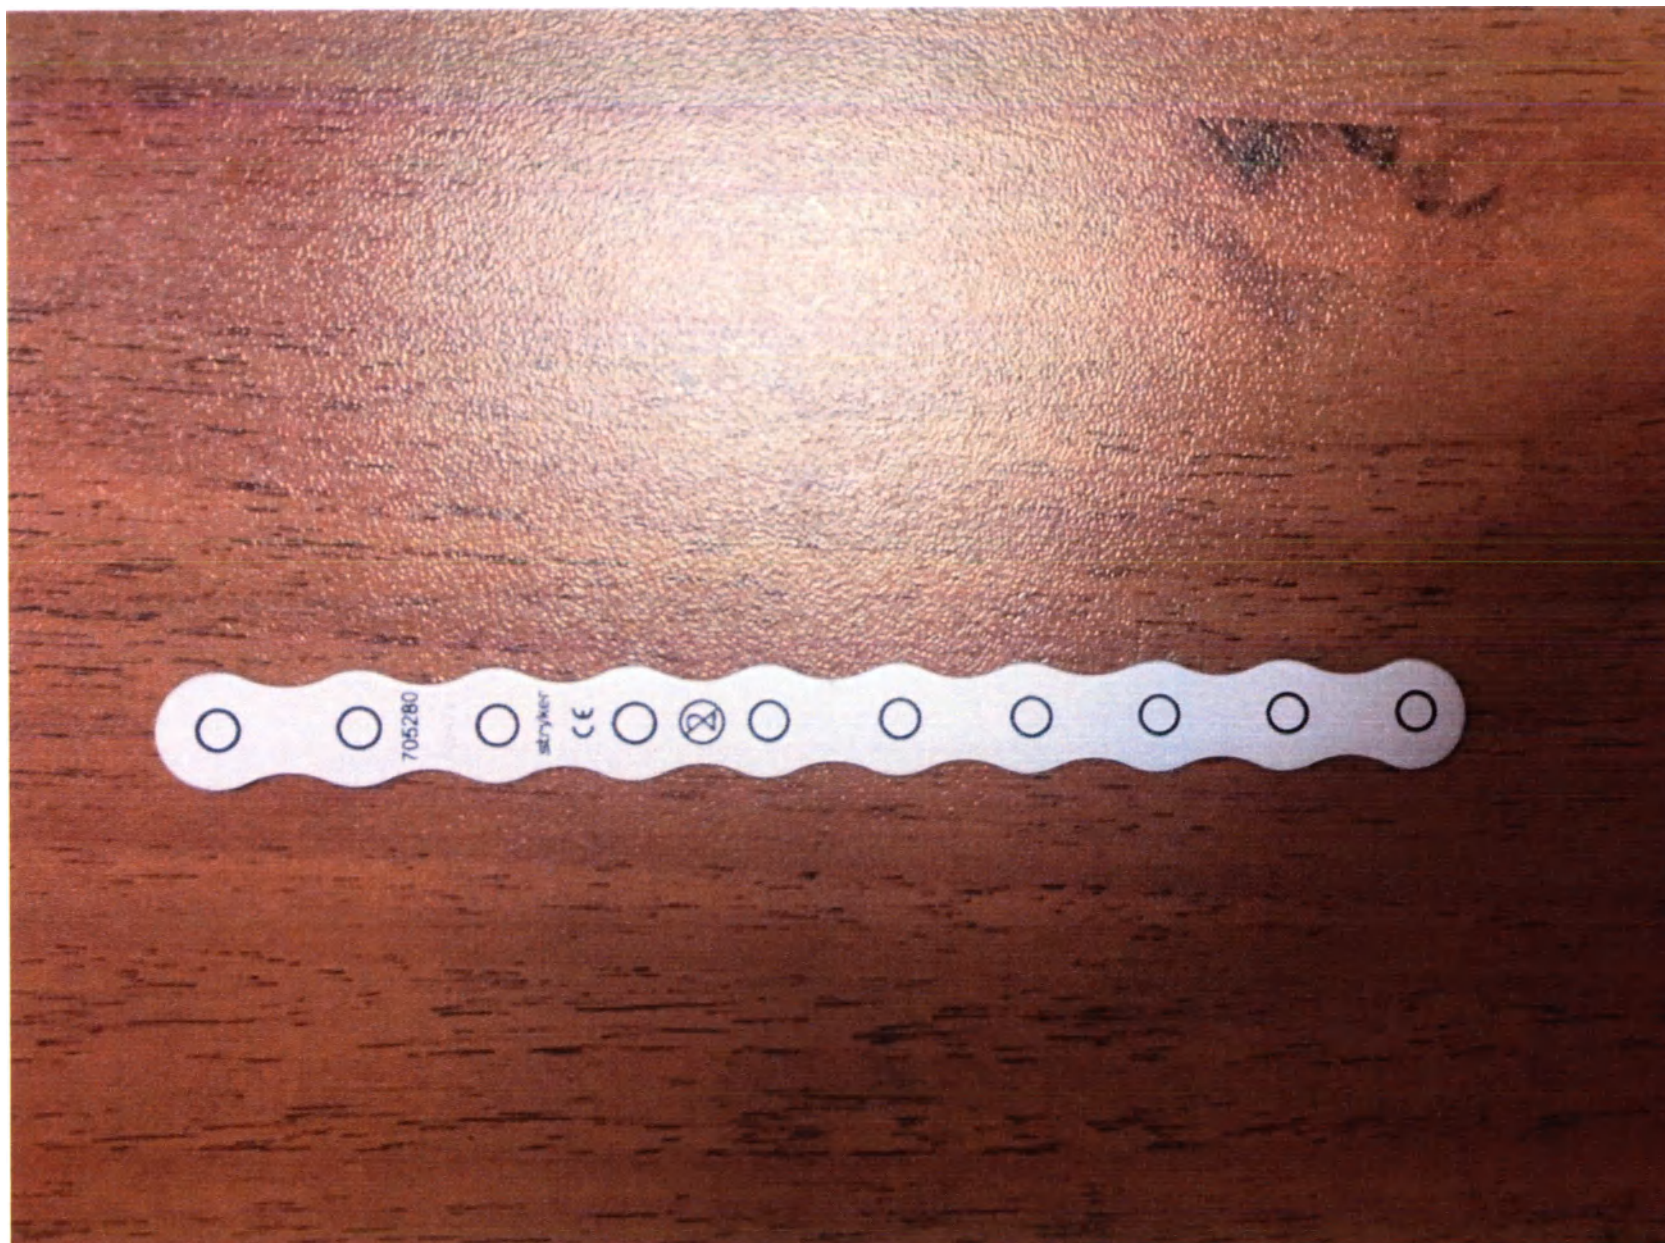

68. Шаблон 1/3 трубчатой пластины для изгибания, 5 отверстий; 69. Шаблон 1/3 трубчатой пластины для изгибания, 10 отверстий; 70. Шаблон 1/3 трубчатой пластины для изгибания, 16 отверстий; 71. Шаблон пластины с крючком глубиной 12 мм, левый; 72. Шаблон пластины с крючком глубиной 12 мм, правый; 73. Шаблон пластины с крючком глубиной 16 мм, левый; 74. Шаблон пластины с крючком глубиной 16 мм, правый; 75. Шаблон пластины с крючком глубиной 20 мм, левый; 76. Шаблон пластины с крючком глубиной 20 мм, правый.




77. Шило с шарообразным кончиком.




78. Щипцы distractionные. 79. Щипцы для изгибания пластин. 80. Щипцы для изгибания спиц Киршнера; 81. Щипцы для пластин и винтов.



82. Щипцы репозиционные/

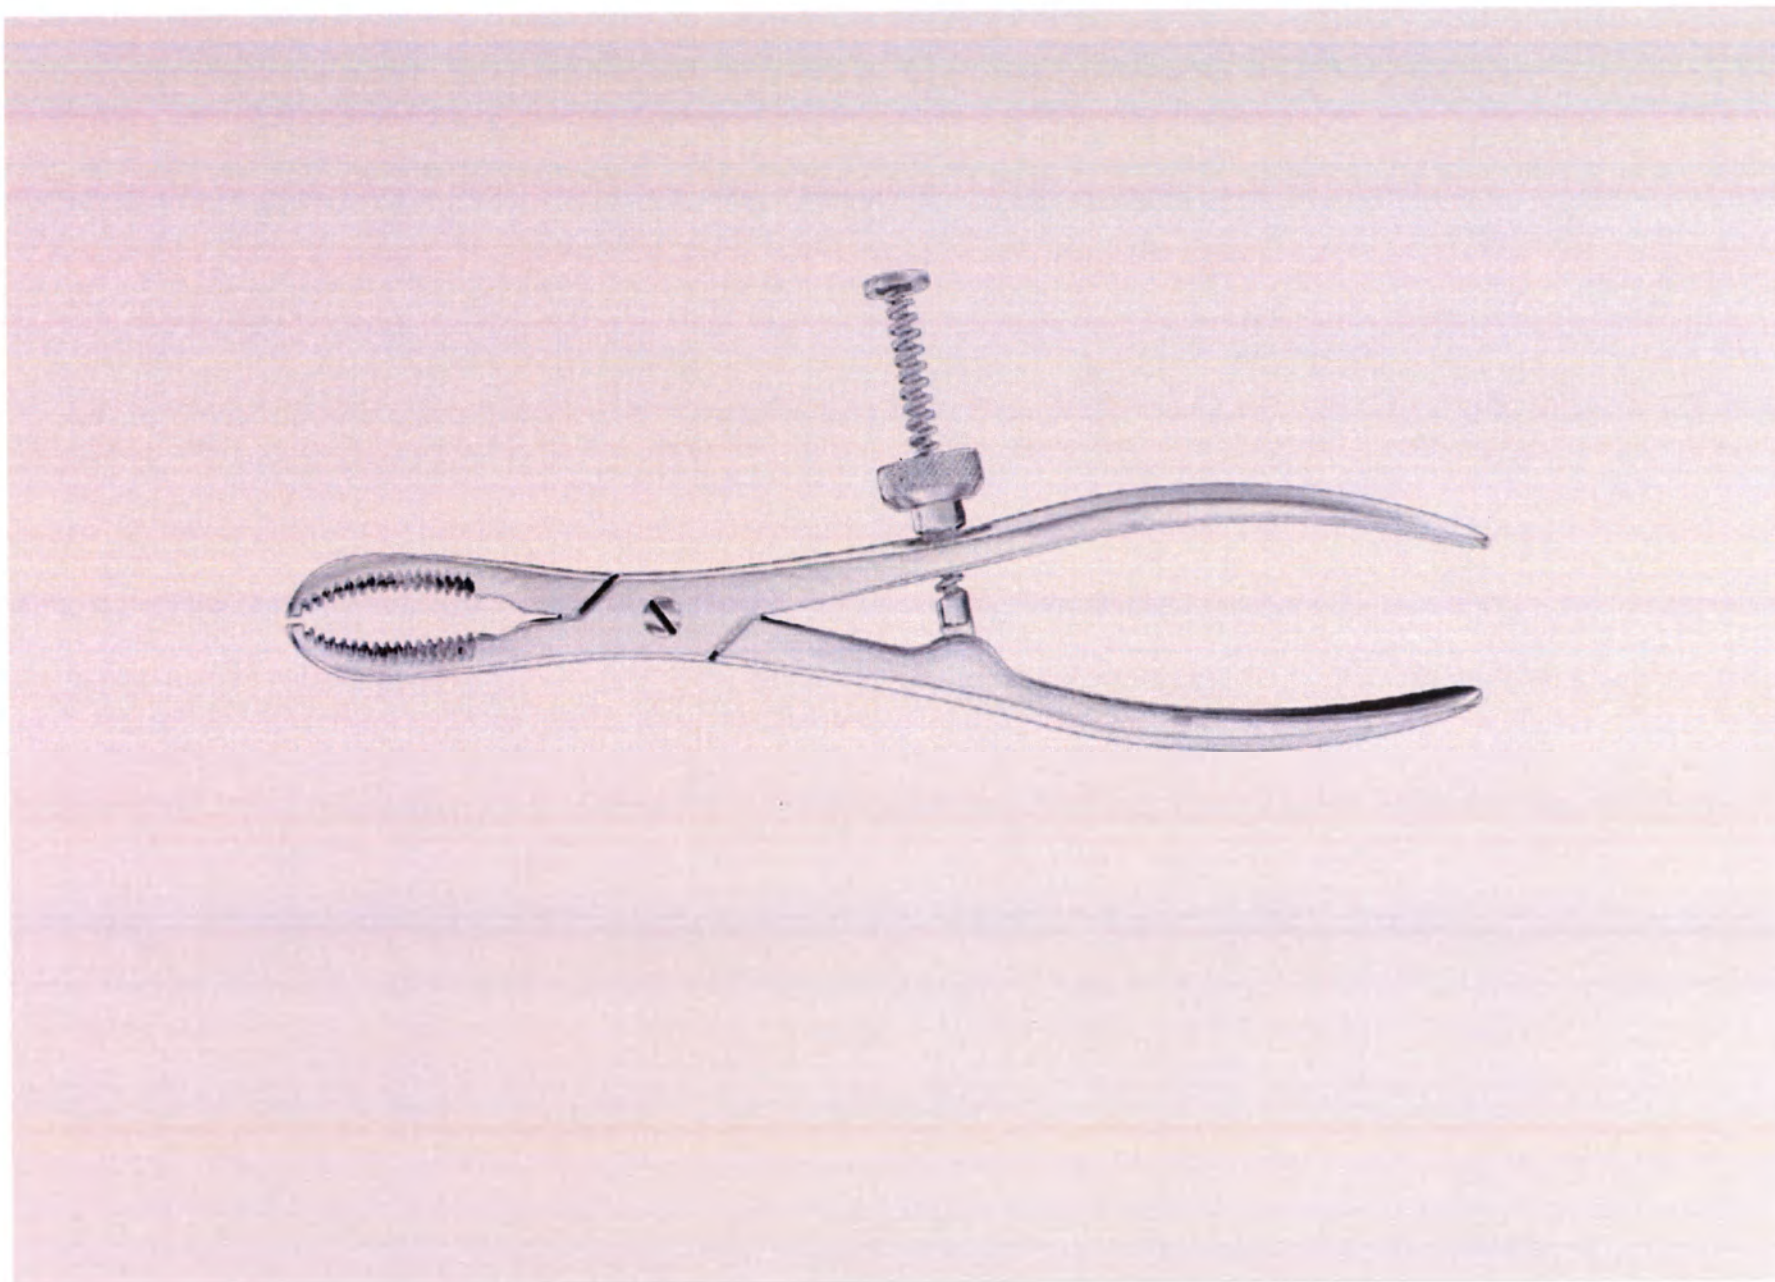


83. Щипцы репозиционные с зубчатыми браншами.

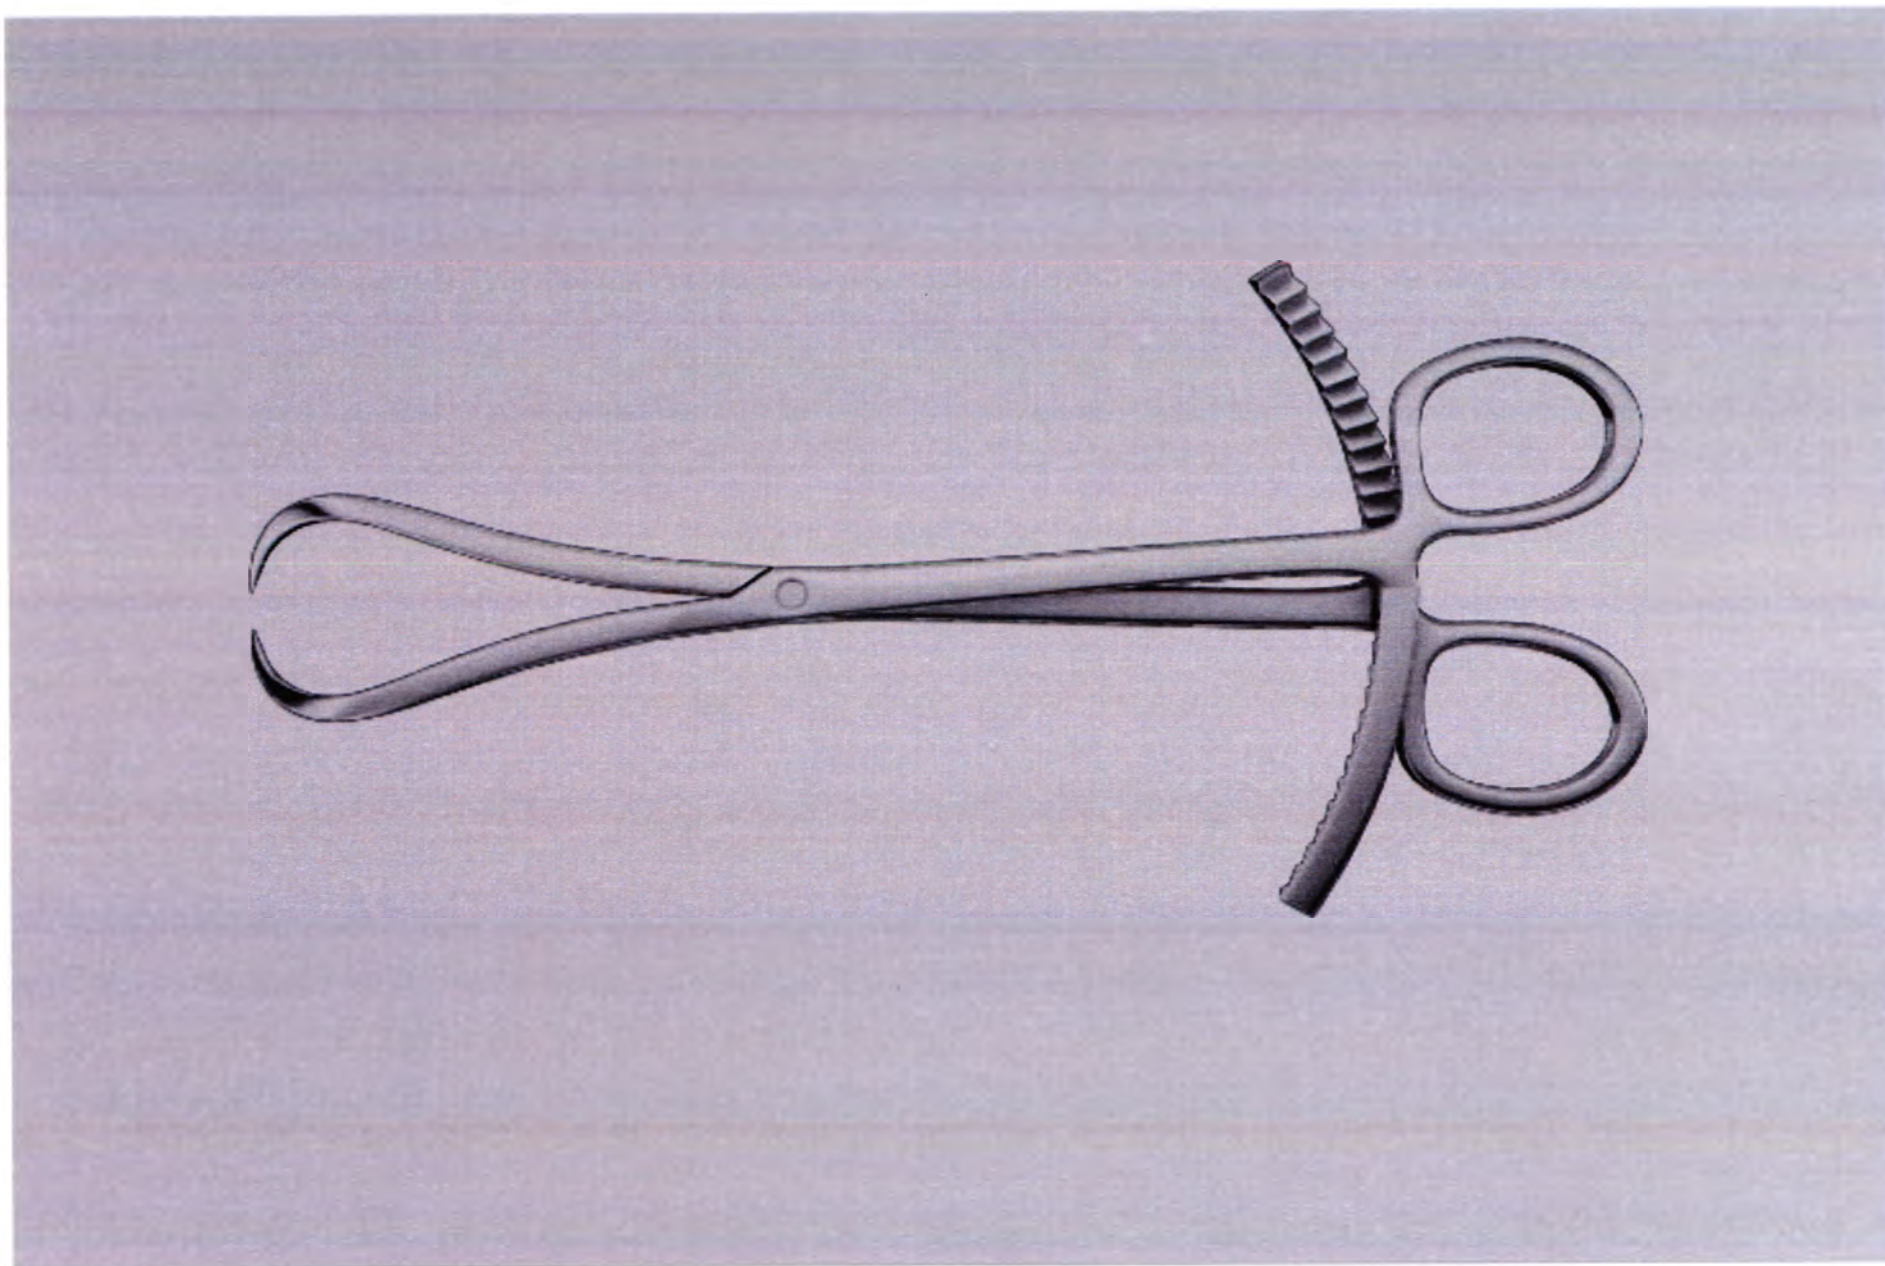

84. Щипцы репозиционные, длина 130 мм; 85. Щипцы репозиционные, шарообразные кончики




86. Элеватор периостальный; 87. Элеватор периостальный изогнутый. 88. Элеватор периостальный, круглый край 6 мм; 89. Элеватор периостальный, прямой край 6 мм; 90. Элеватор периостальный, изогнутое лезвие 13 мм; 91. Элеватор периостальный, плоское лезвие 13 мм.

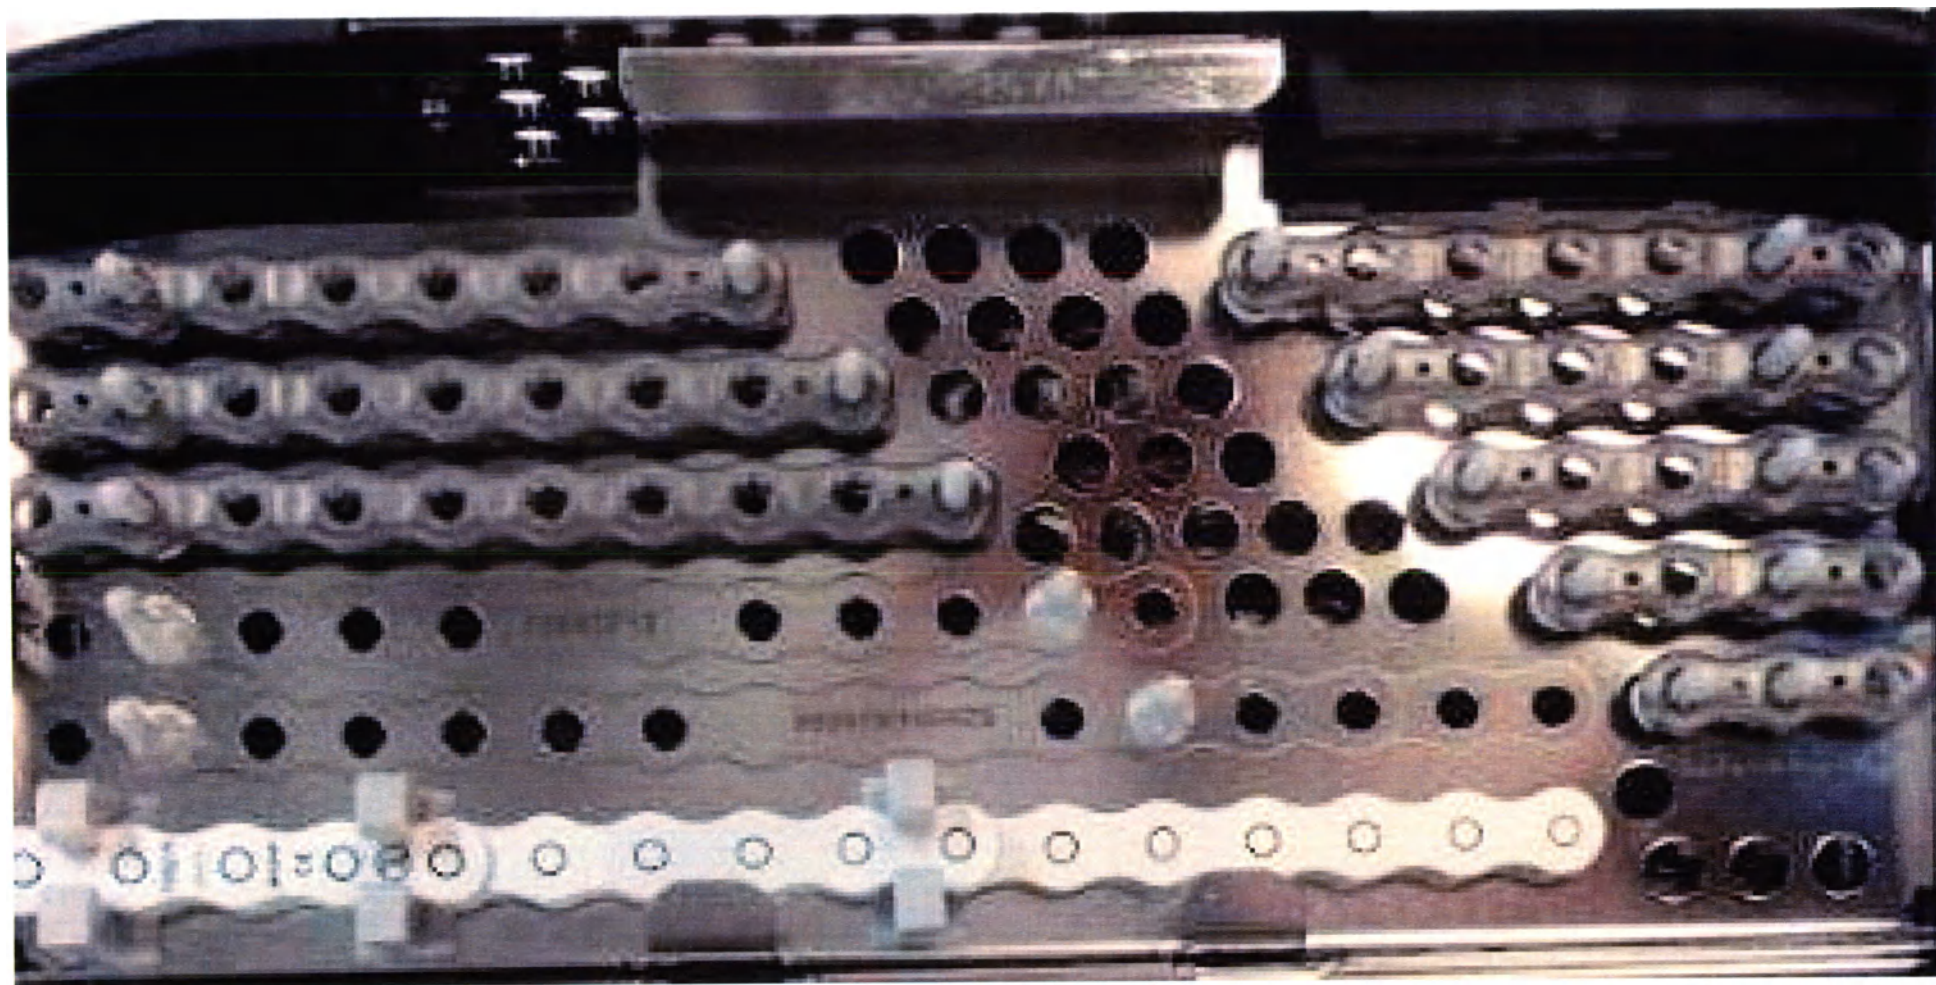


1. Вставка для ключичных верхних пластин с увеличенной кривизной. 2. Вставка для ключичных верхних пластин с уменьшенной кривизной, левых. 3. Вставка для ключичных верхних пластин с уменьшенной кривизной, правых. 4. Вставка для 1/3 трубчатых пластин. 5. Вставка для задних латеральных пластин для локтя, левых. 6. Вставка для задних латеральных пластин для локтя, правых. 7. Вставка для задних медиальных пластин для локтя. 8. Вставка для ключичных верхних латеральных пластин. 9. Вставка для ладонных пластин дистального отдела лучевой кости, правых. 10. Вставка для латеральных пластин для локтя, левых. 11. Вставка для латеральных пластин для локтя, правых. 12. Вставка для медиальных пластин для локтя. 13. Вставка для направляющих блоков дистального отдела лучевой кости. 14. Вставка для пластин дистальных латеральных для малоберцовой кости. 15. Вставка для пластин для локтевого отростка. 16. Вставка для специальных фрагментов пластин дистального отдела лучевой кости. 17. Вставка для тыльных пластин дистального отдела лучевой кости. 18. Вставка для узких компрессионных пластин. 19. Вставка для шаблонов ключичных пластин с крючком. 20. Вставка для широких компрессионных пластин. 21. Вставка под репозиционный инструмент 1. 22. Вставка под репозиционный инструмент 1 для хирургии стопы и голеностопного сустава. 23. Вставка под репозиционный инструмент 2. 24. Вставка под репозиционный инструмент 2 для хирургии стопы и голеностопного сустава. 25. Вставка под репозиционный инструмент 3. 26. Вставка, Т8, для дополнительных инструментов.



27. Клипса для верхнего лотка для ключичных пластин. 28. Клипса для дополнительного верхнего лотка под пластины для запястья. 29. Клипса для дополнительного верхнего лотка под пластины для локтя. 30. Клипса для дополнительного верхнего лотка под пластины для малых фрагментов. 31. Клипса для дополнительного лотка под латеральные пластины для локтя. 32. Клипса для дополнительного лотка под медиальные пластины для локтя. 33. Клипса для дополнительного лотка под пластины для запястья. 34. Клипса для дополнительного лотка под пластины для малых фрагментов. 35. Клипса для лотка верхнего для хирургии костей запястья. 36. Клипса для лотка для ключичных пластин. 37. Клипса для лотка для шаблонов ключичных пластин с крючком. 38. Клипса для лотка под пластины для запястья. 39. Клипса для лотка под репозиционный инструмент. 40. Клипса для лотка под стандартные инструменты. 41. Клипса для основного лотка. 42. Клипса для основного лотка под винты и инструменты T8. 43. Клипса для основного лотка под винты T10. 44. Клипса для основного лотка под репозиционный инструмент. 45. Клипса для ящика под инструменты для стопы.

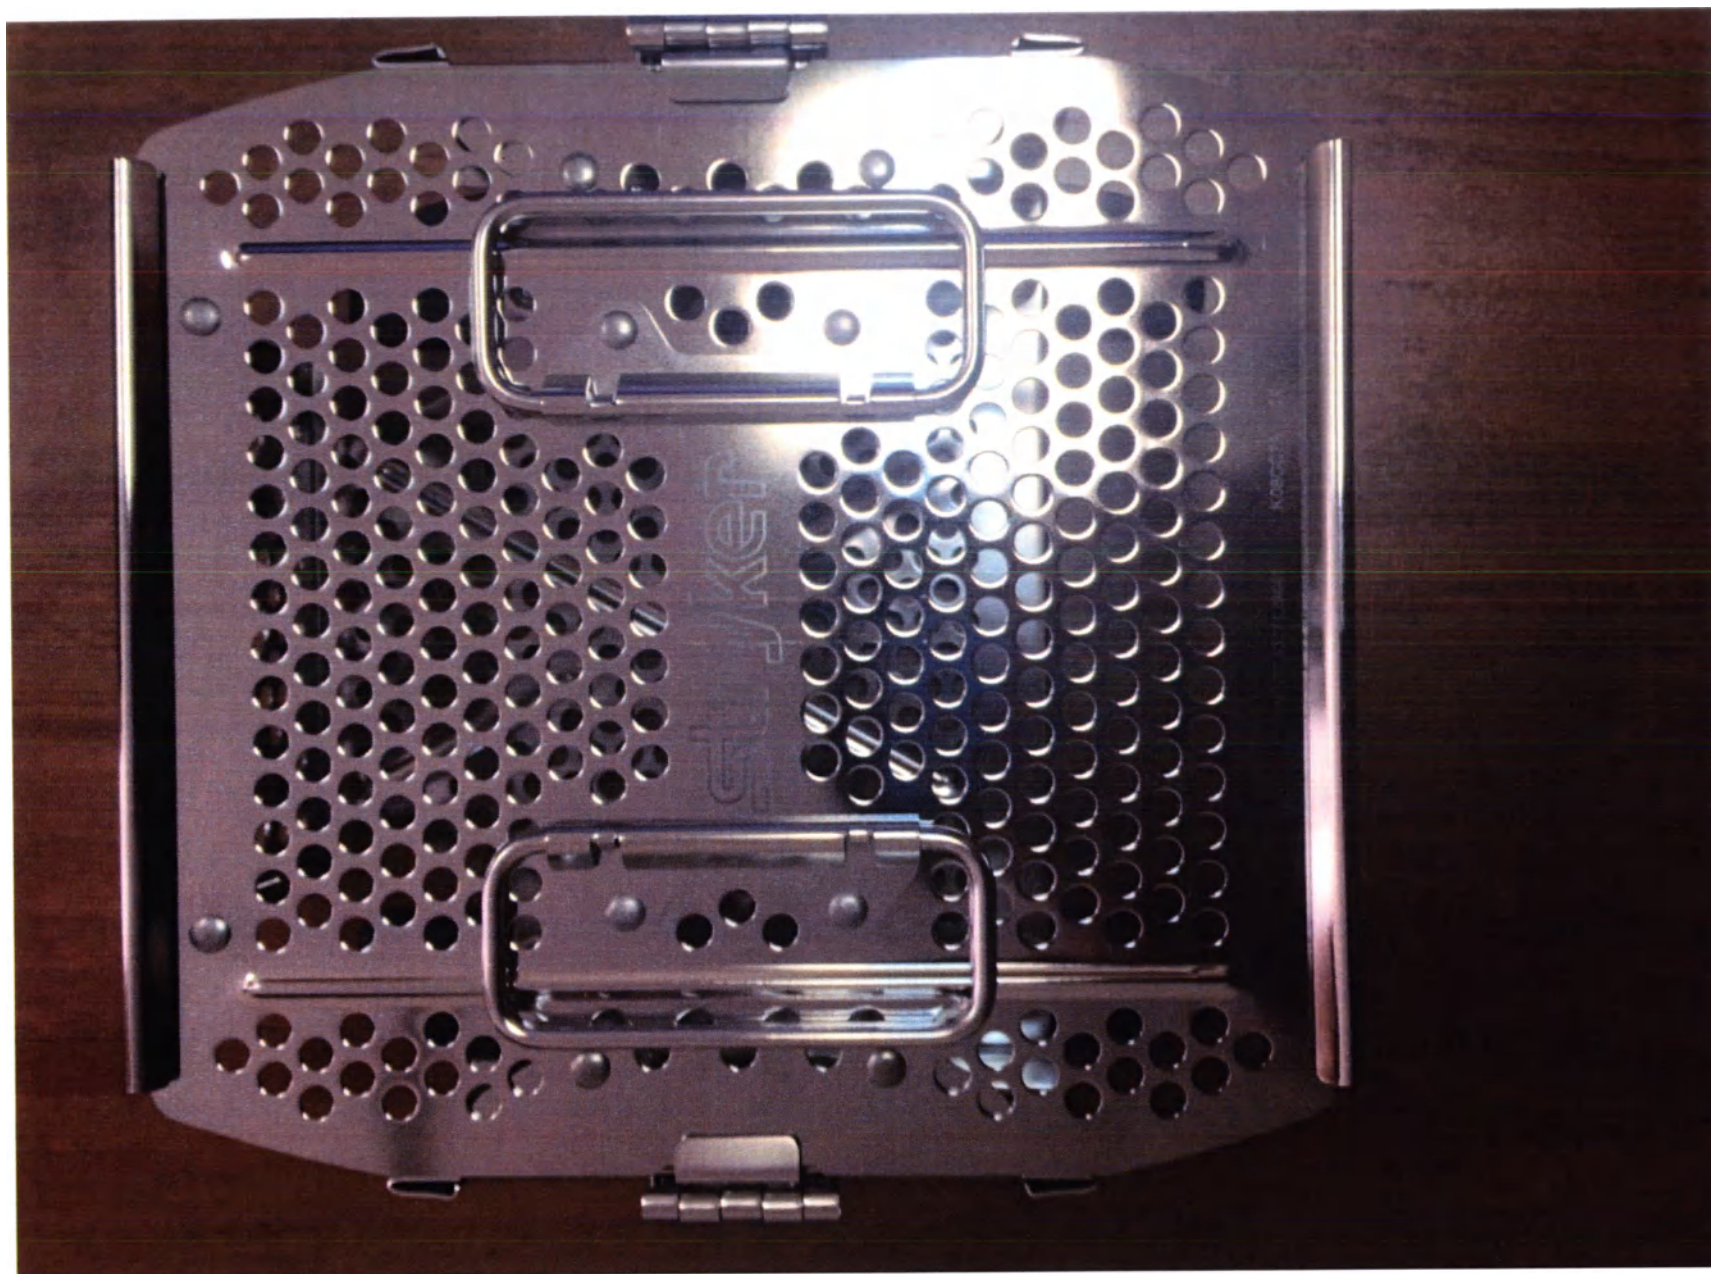


46. Лоток верхний для запястья. 47. Лоток дополнительный верхний для запястья. 48. Лоток дополнительный верхний для ключицы. 49. Лоток дополнительный верхний для локтя. 50. Лоток дополнительный верхний для малых фрагментов. 51. Лоток нижний 1 уровень. 52. Лоток нижний 2 уровня. 53. Лоток основной верхний.

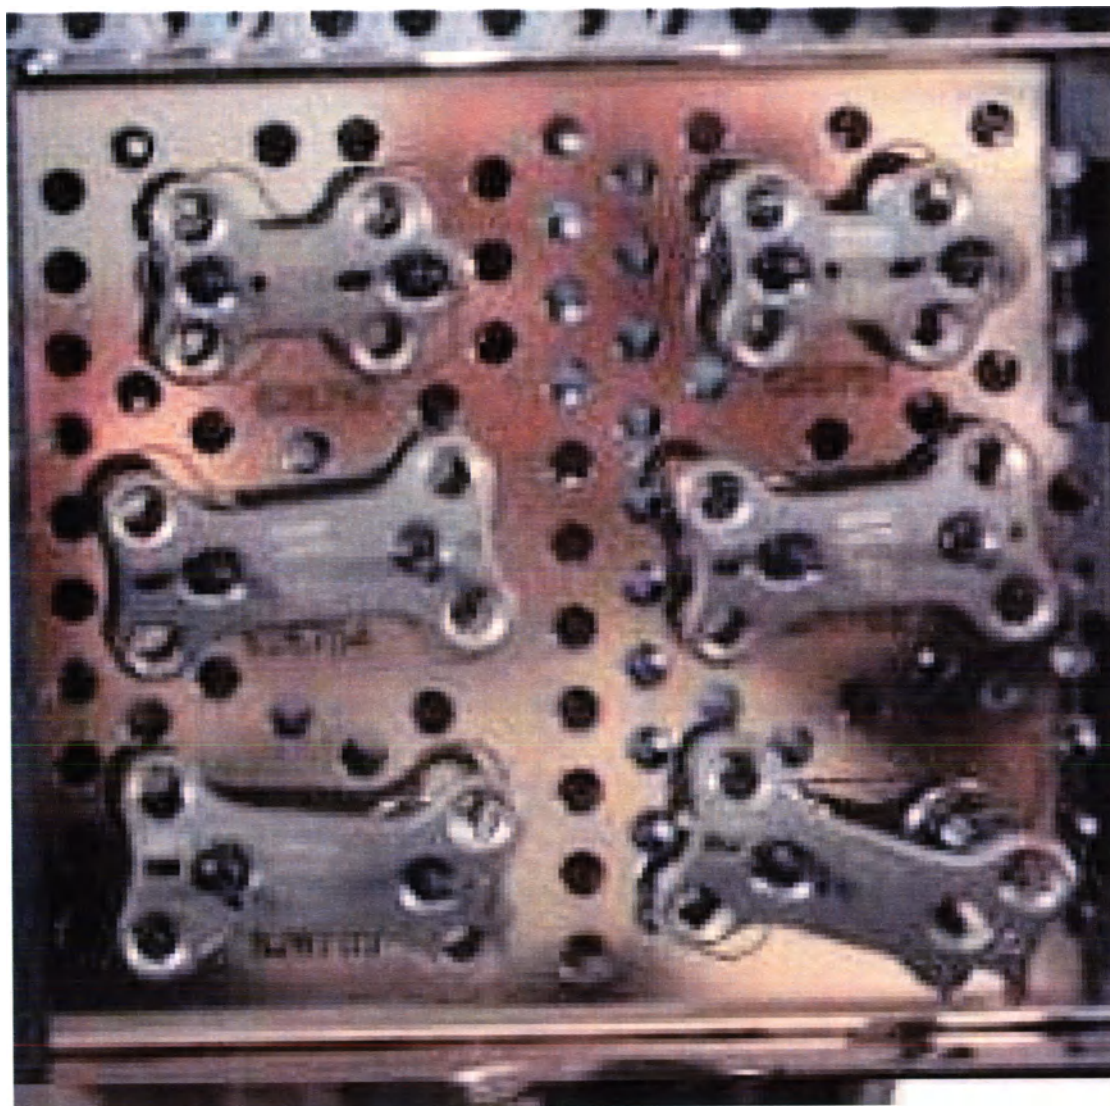

54. Модуль для изогнутых, прямых пластин. 55. Модуль для наклонных Т-образных, 3D, L-образных пластин. 56. Модуль для пластин для кубовидной, ладьевидной, таранной кости. 57. Модуль для пластин для латеральной колонны стопы. 58. Модуль для пластин для медиальной колонны стопы. 59. Модуль для пластин для таранно-ладьевидного сустава, ладьевидной и клиновидных костей. 60. Модуль для прямоугольных, Н-образных пластин. 61. Модуль для пяточных пластин.



62. Подставка под блокирующие винты 2.7 мм, T8. 63. Подставка под блокирующие винты 2.7 мм, T10. 64. Подставка под блокирующие винты 3.5 мм, T10. 65. Подставка под винты 2.4 мм, T8. 66. Подставка под винты 2.7 мм, T8. 67. Подставка под стандартные винты 2.4 мм, T8. 68. Подставка под стандартные винты 2.7 мм, T10. 69. Подставка под стандартные винты 3.5 мм, T10.

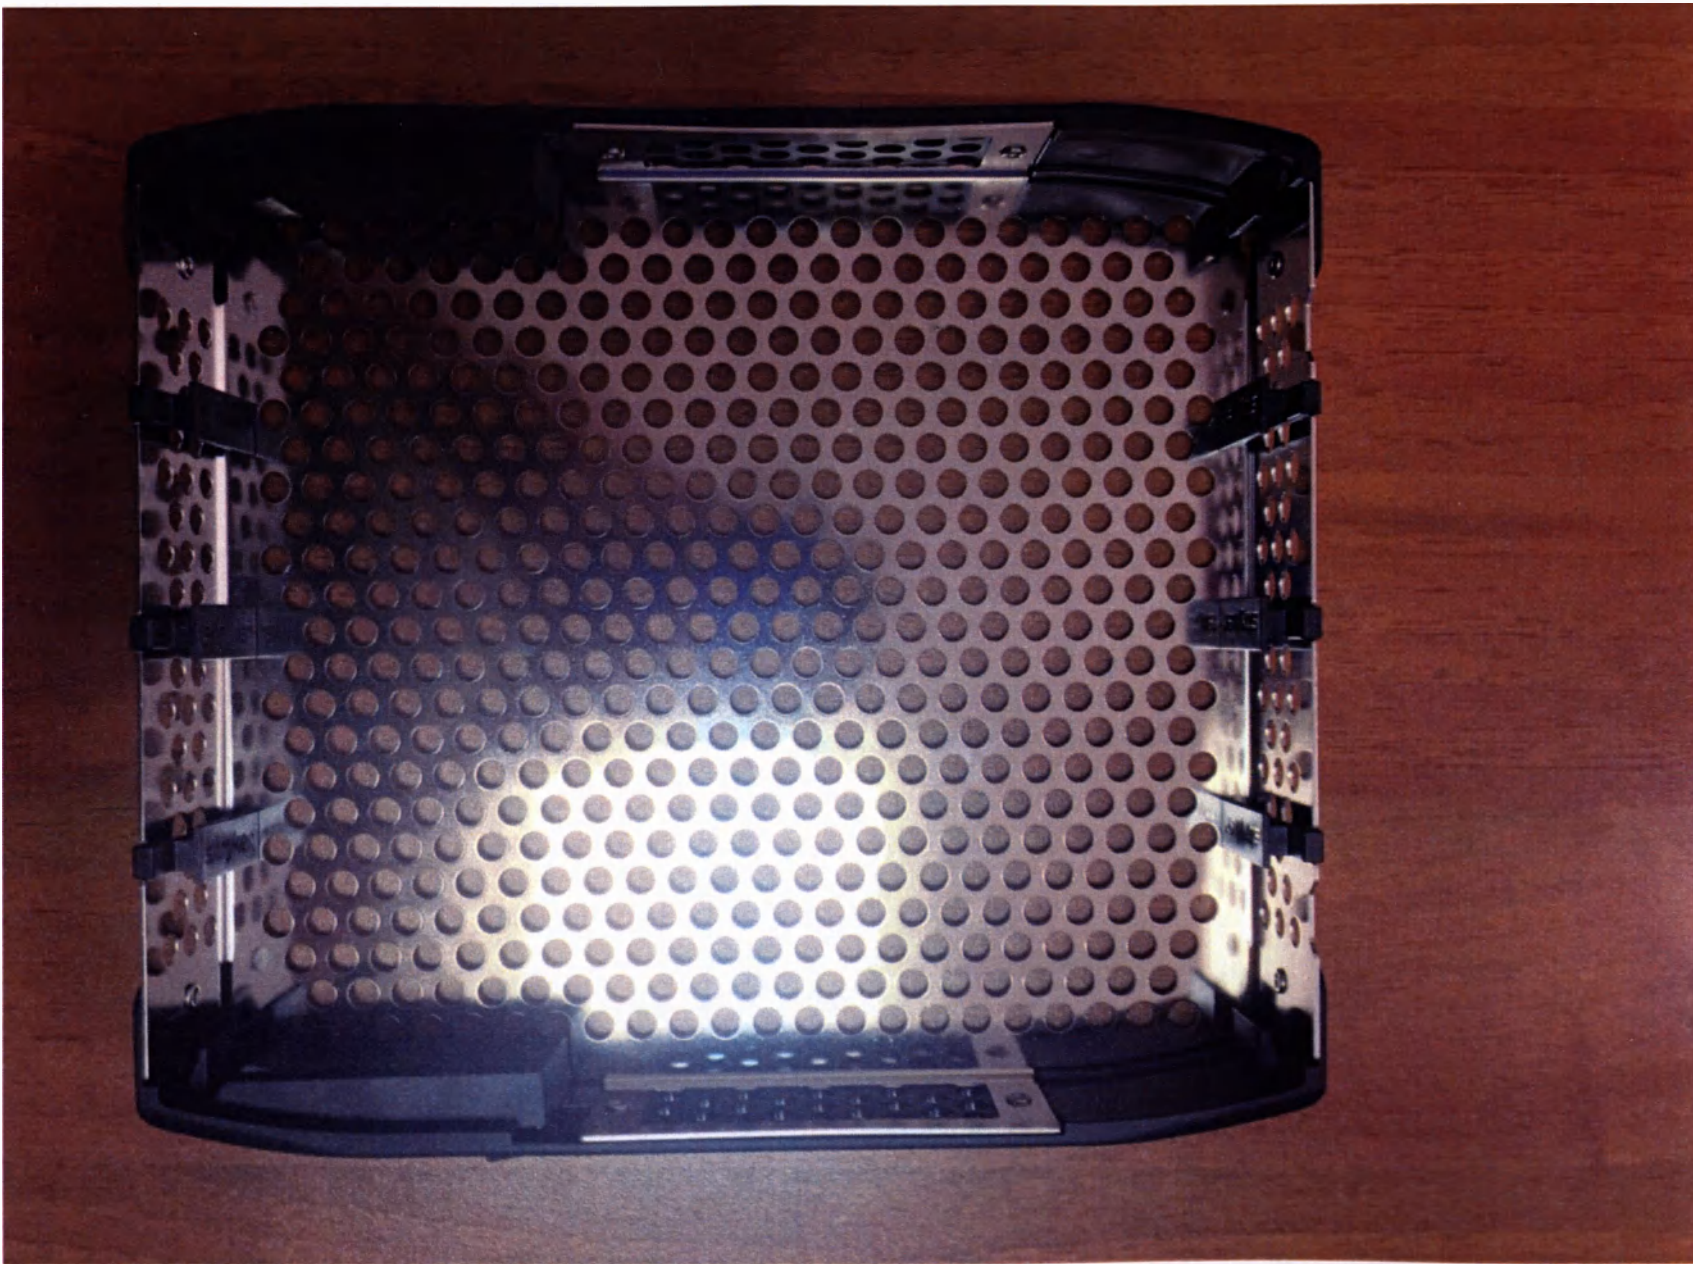

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

