

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Горшкова Н.А.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов:

Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol


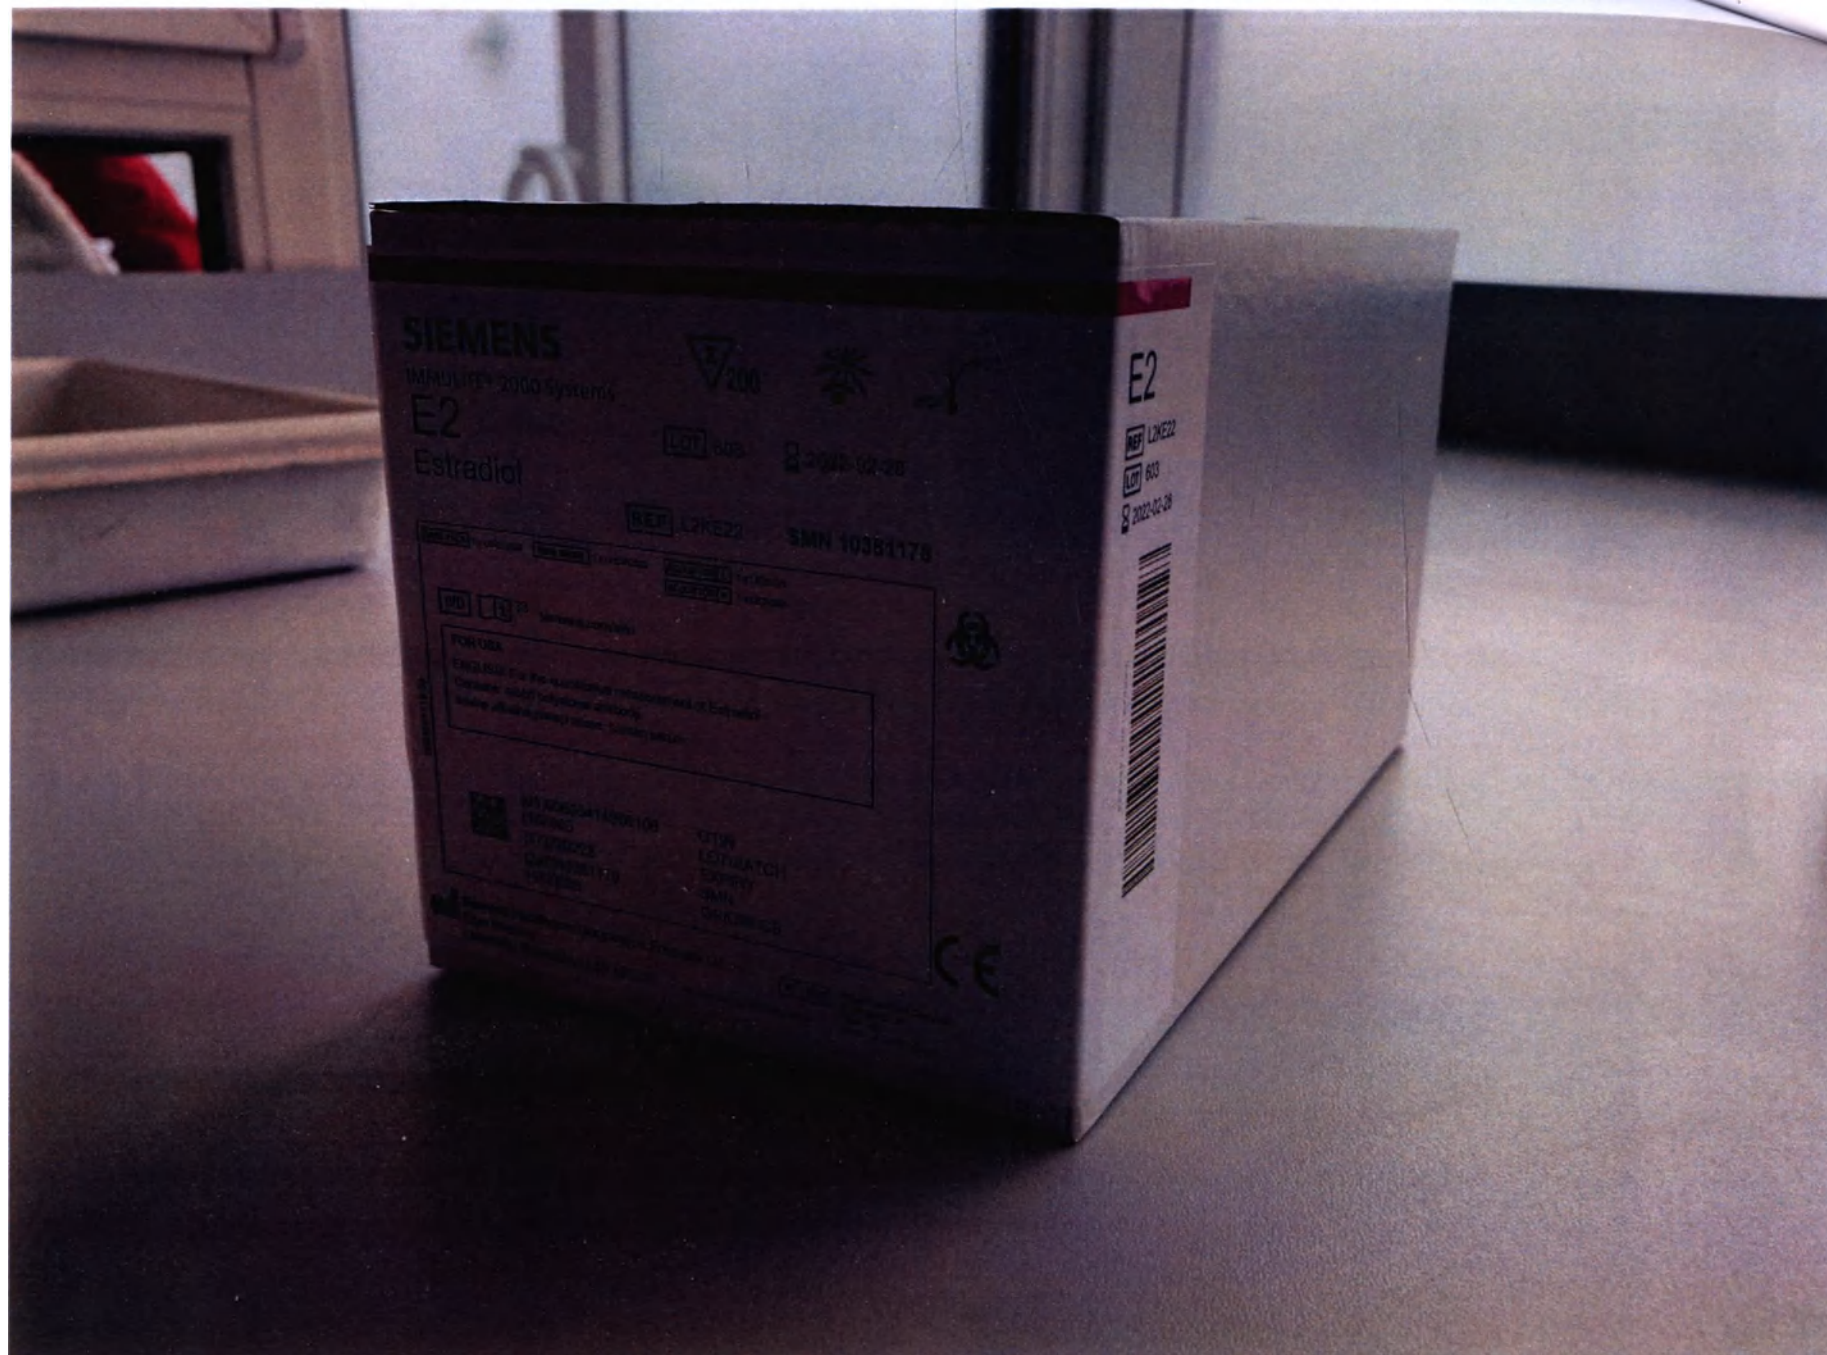


Рисунок 1. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol (картонная коробка)

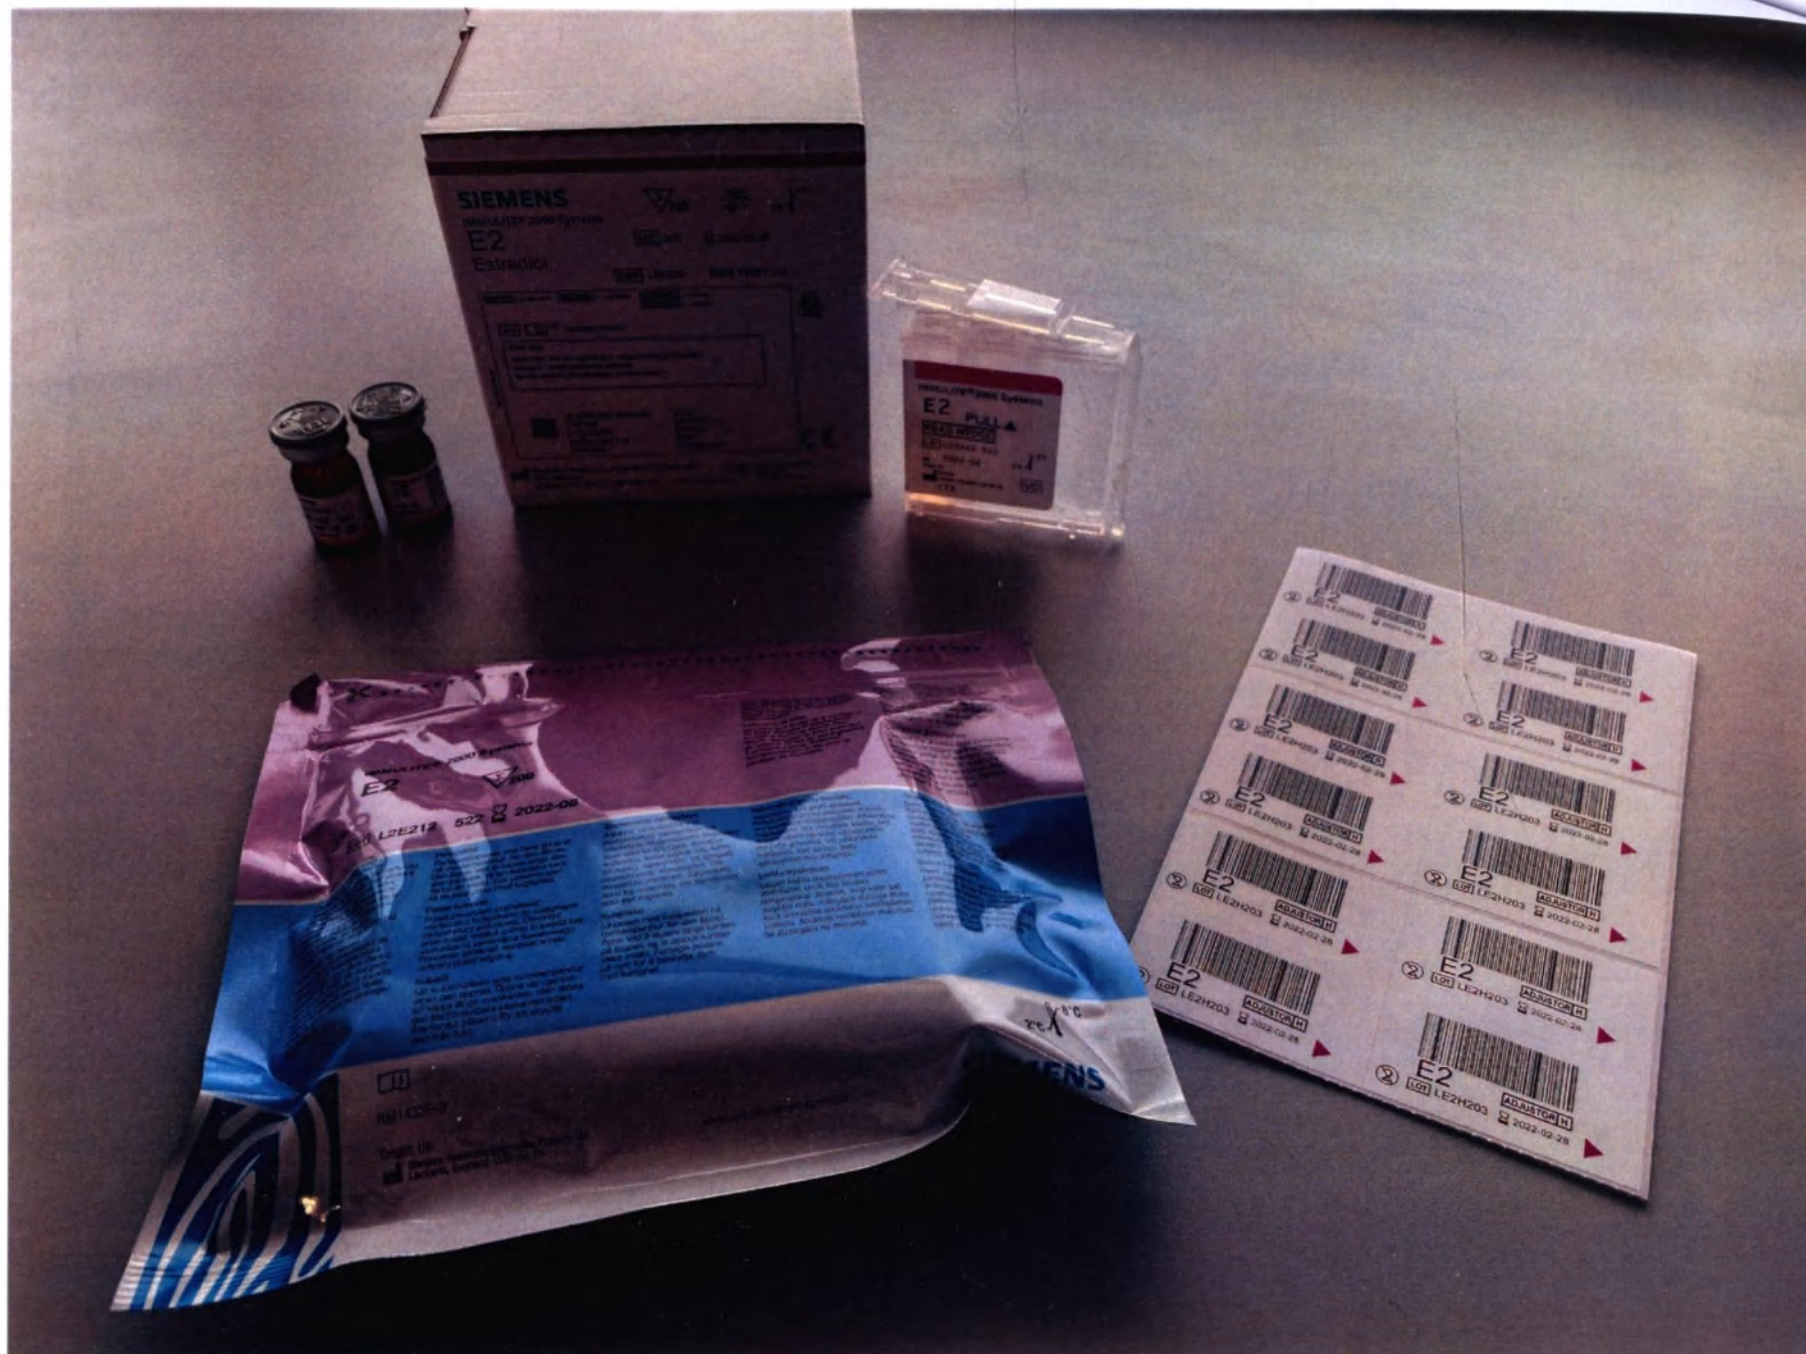

Изображение 2. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального гомеостаза и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol! (Содержимое коробки)



Рисунок 3. Наборы реагентов для иммунохемилуминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиона/Estradiol. (Estradiol Bead Pack (Упаковка шариков) (L2E212))

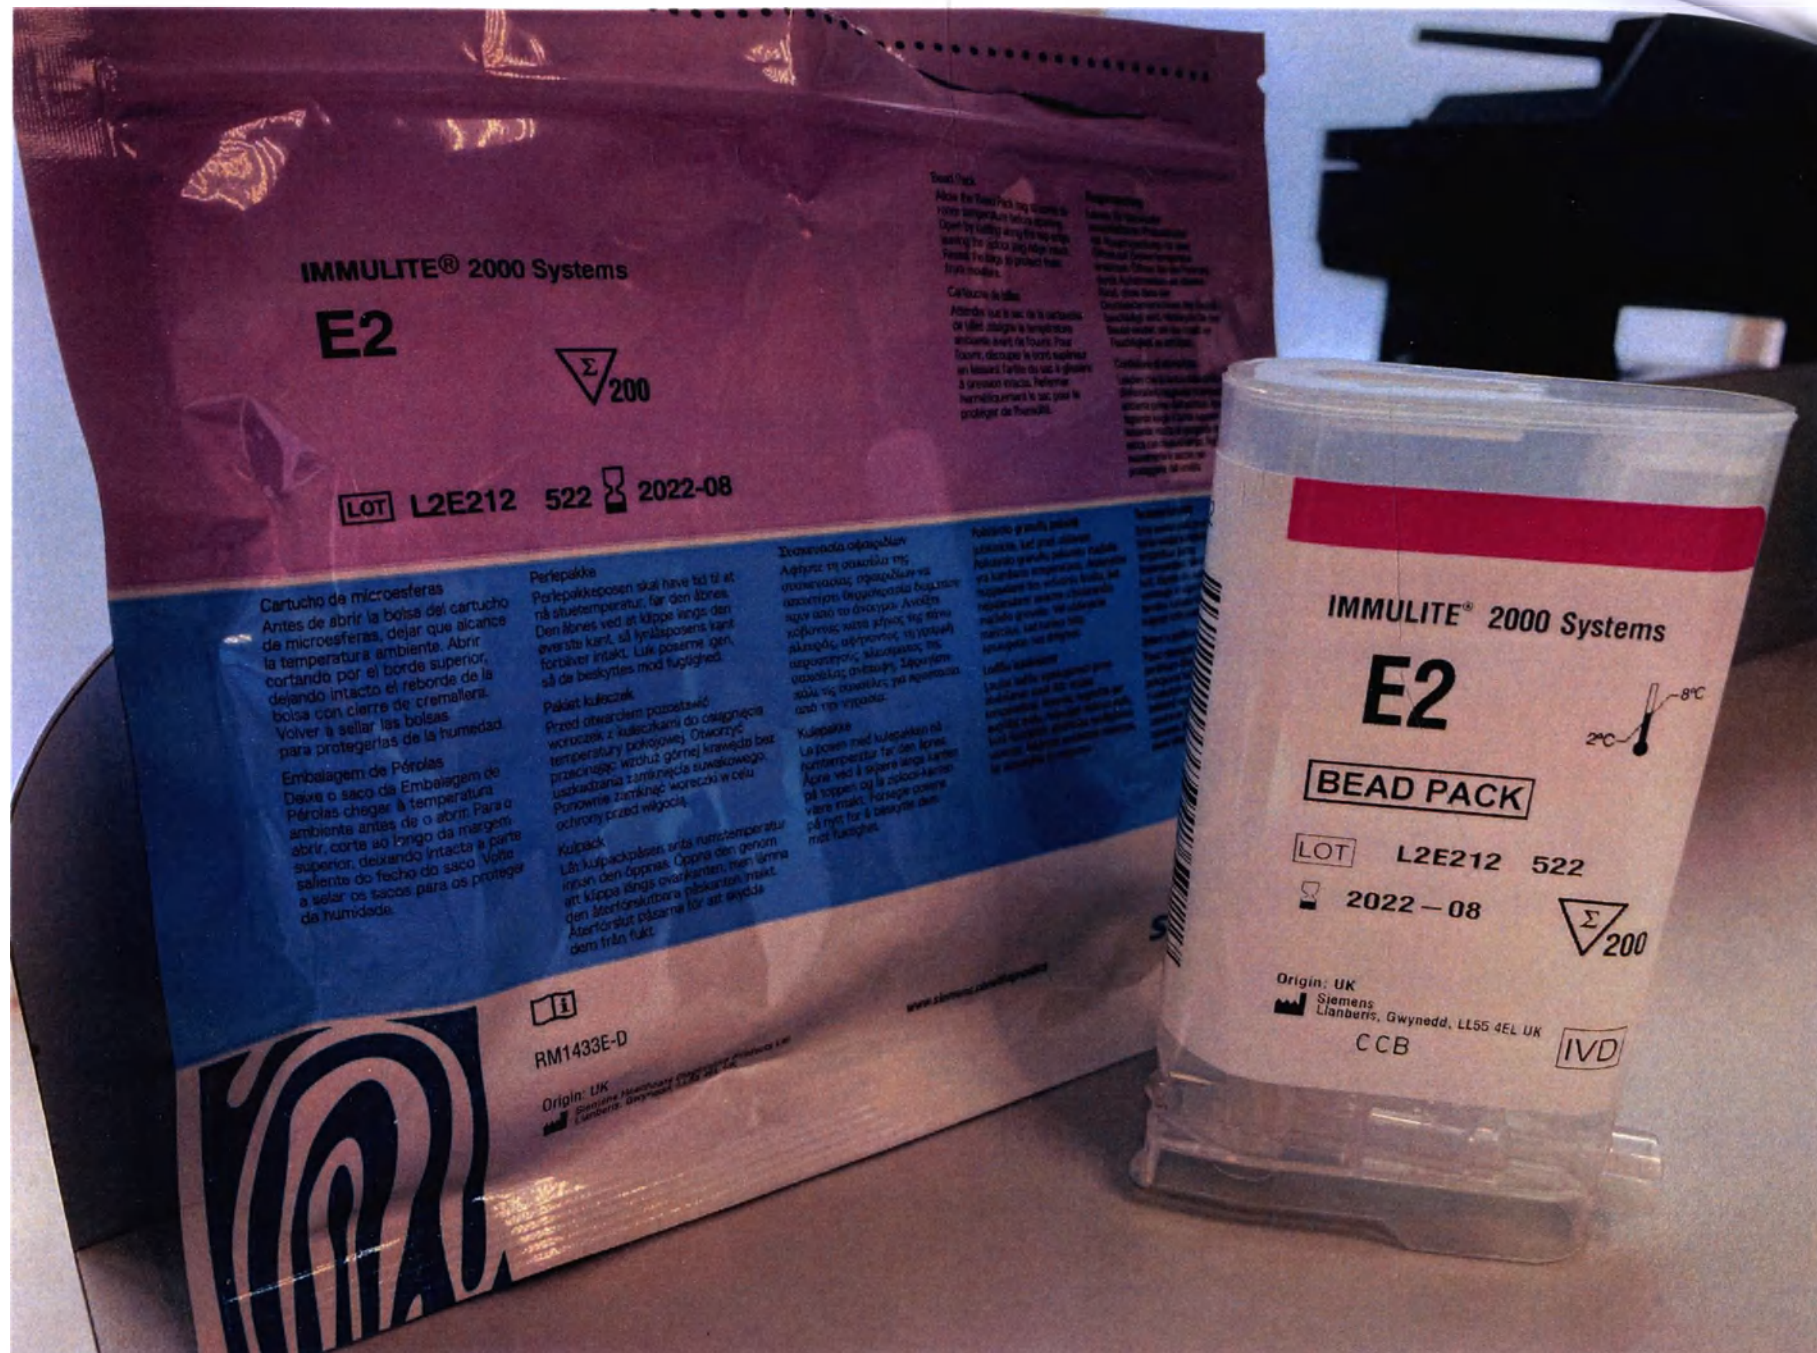


Рисунок 4. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol. (Содержимое Estradiol Bead Pack (Упаковка шариков) (L2E212))

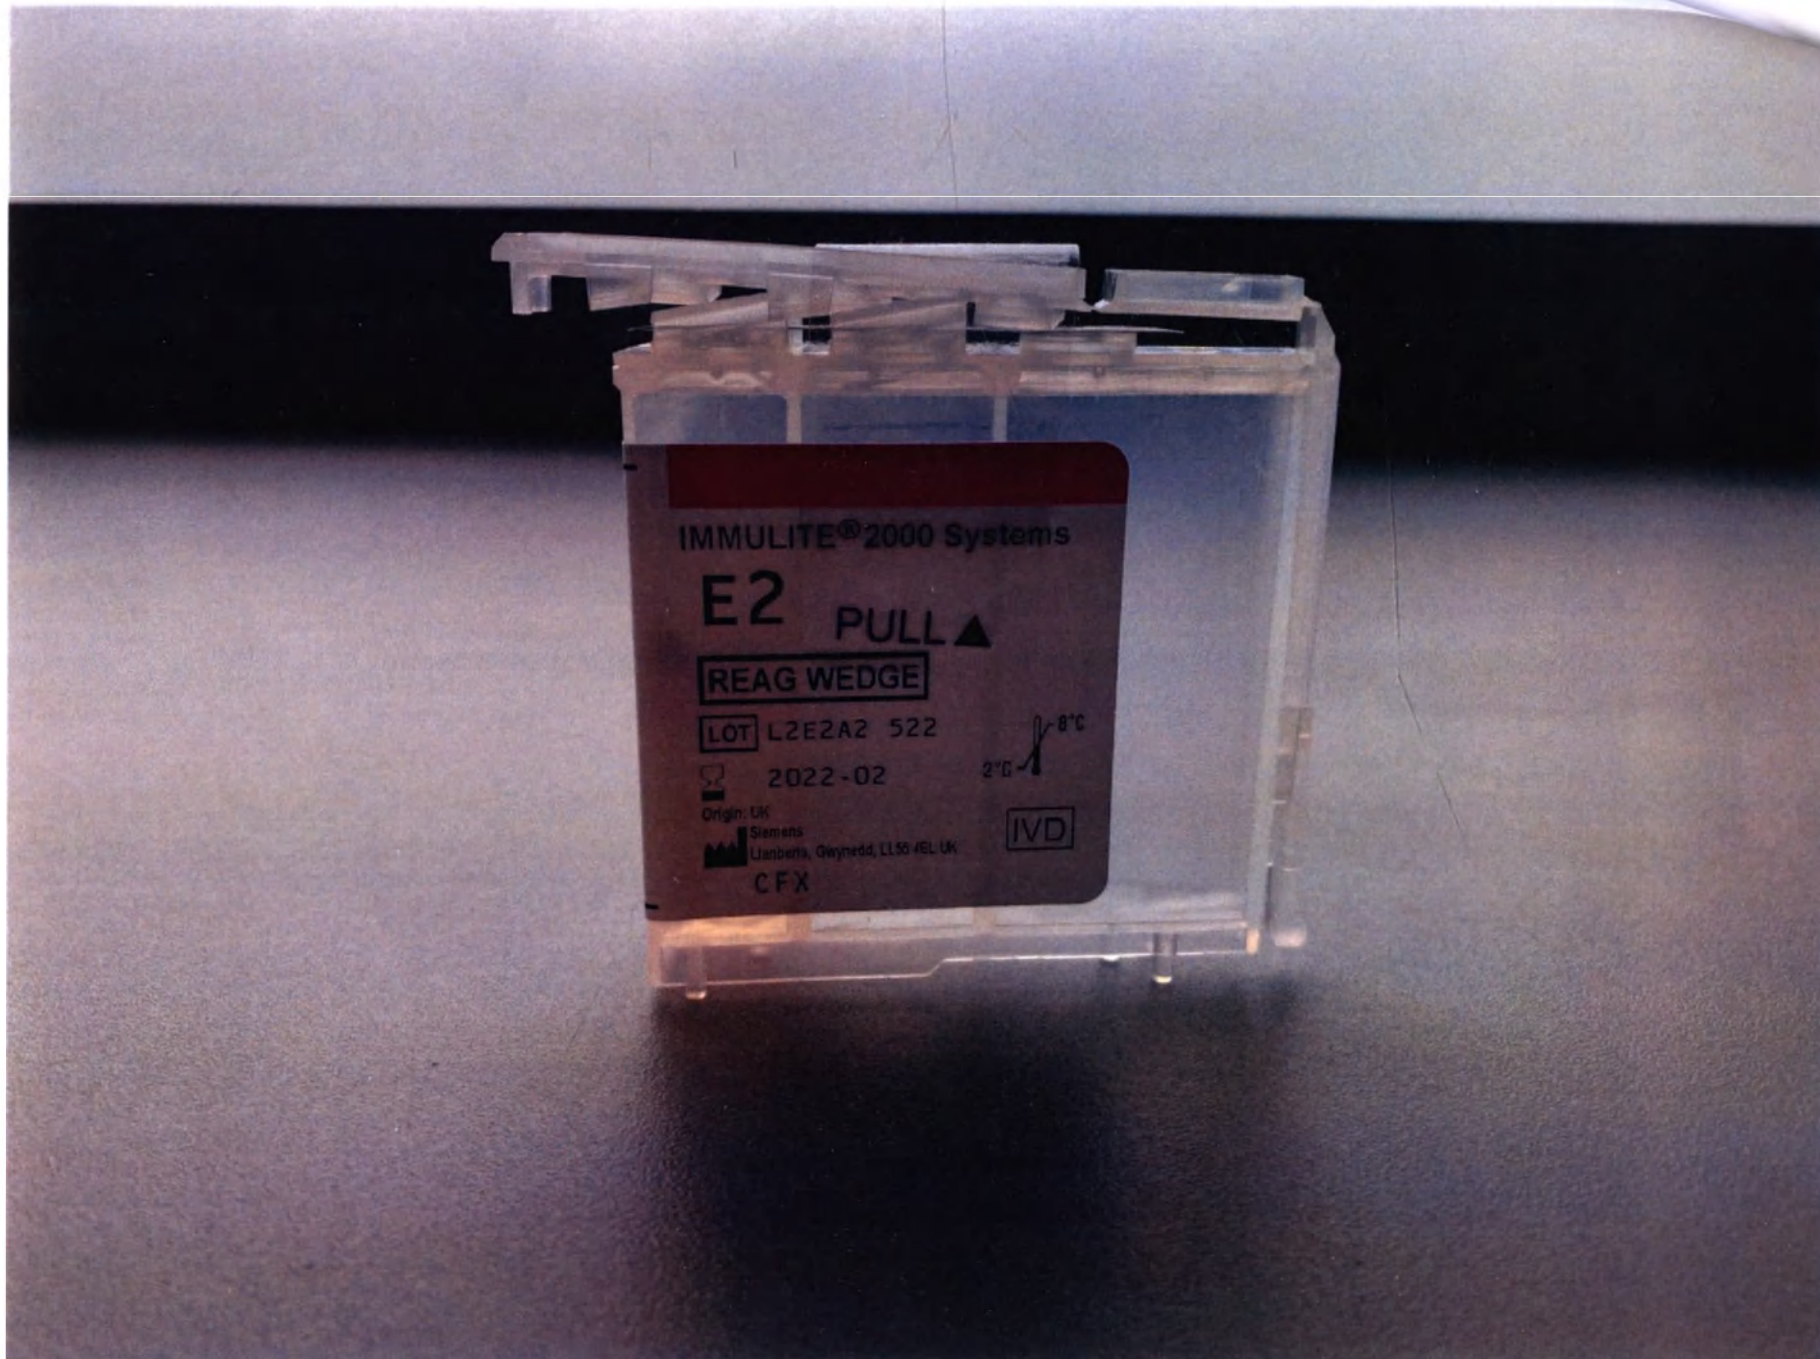


Рисунок 5. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol (Estradiol Reagent Wedge (Реагентный клин) (L2E2A2))



Рисунок 6. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol (Estradiol Adjustors (Калибраторы) (LE2L, LE2H))

0381177

Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2007/00596 от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

10381178

Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2007/00596 от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7. Наборы реагентов для иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000 для in-vitro диагностики: показателей нарушения гормонального статуса и аутоиммунных процессов: Набор реагентов для определения эстрадиола/Estradiol (Макеты русскоязычной маркировки)



Всего прошито и пронумеровано
_____ листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»