

1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центр Перинатальной
Медицины»
В.В. Морозов
«21» сентября 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения
(BALT EXTRUSION SAS (БАЛТ ЭКСТРУЖН САС), Франция)**

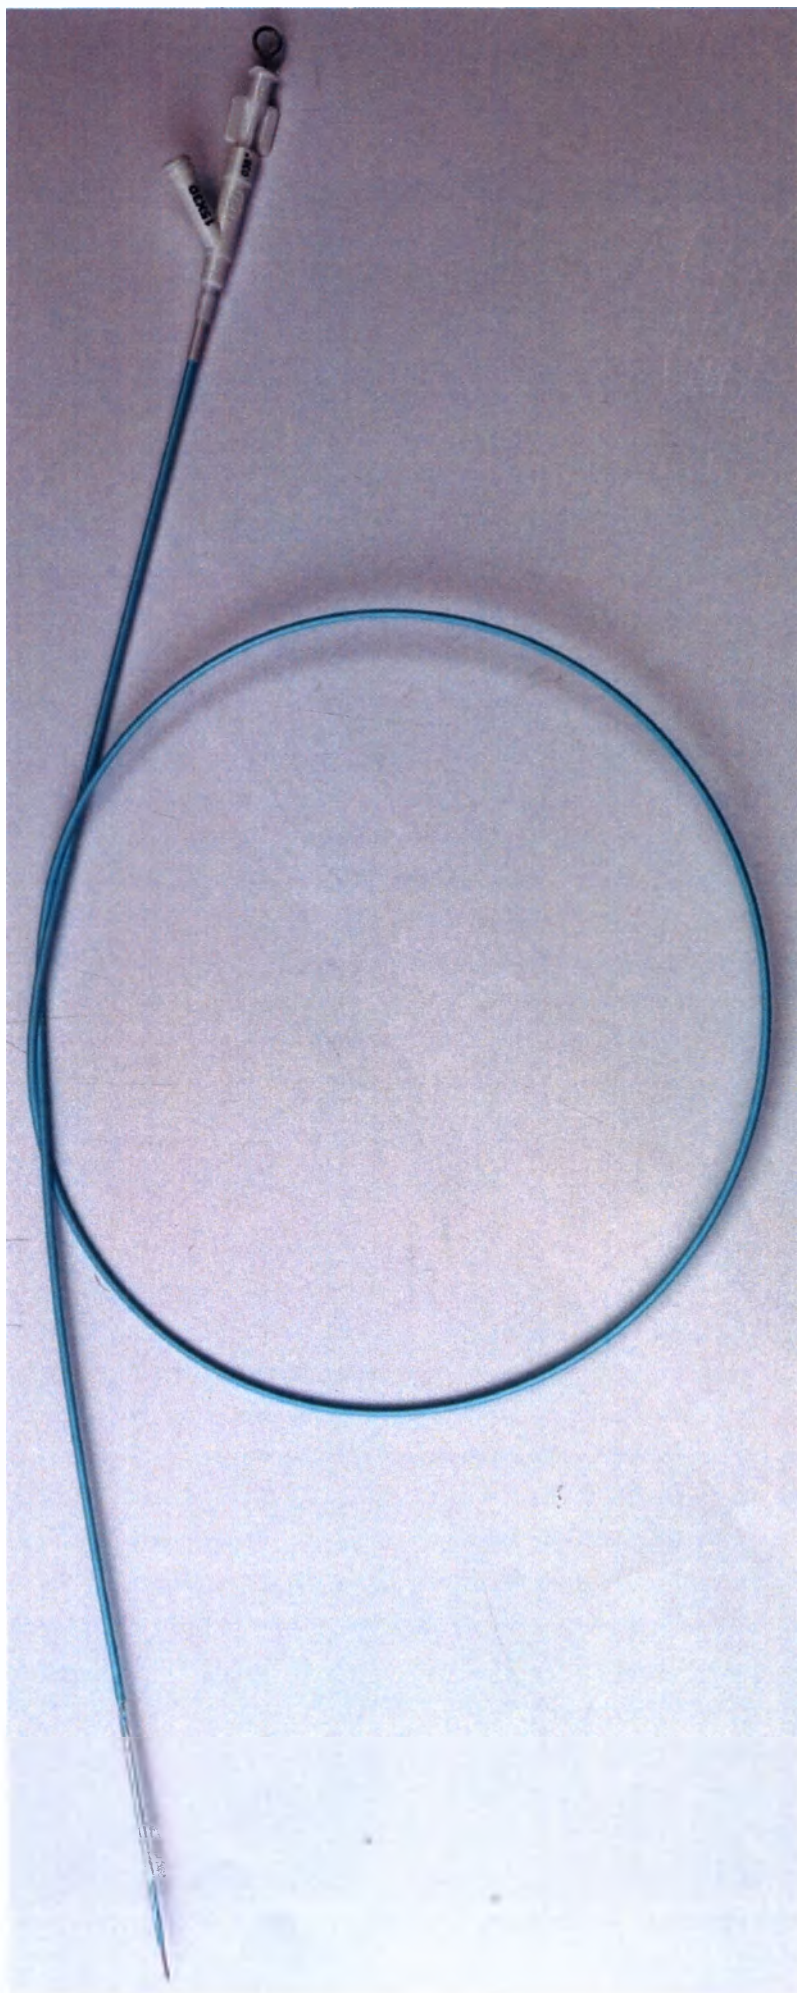


Рисунок 1. Внешний вид медицинского изделия без упаковки.

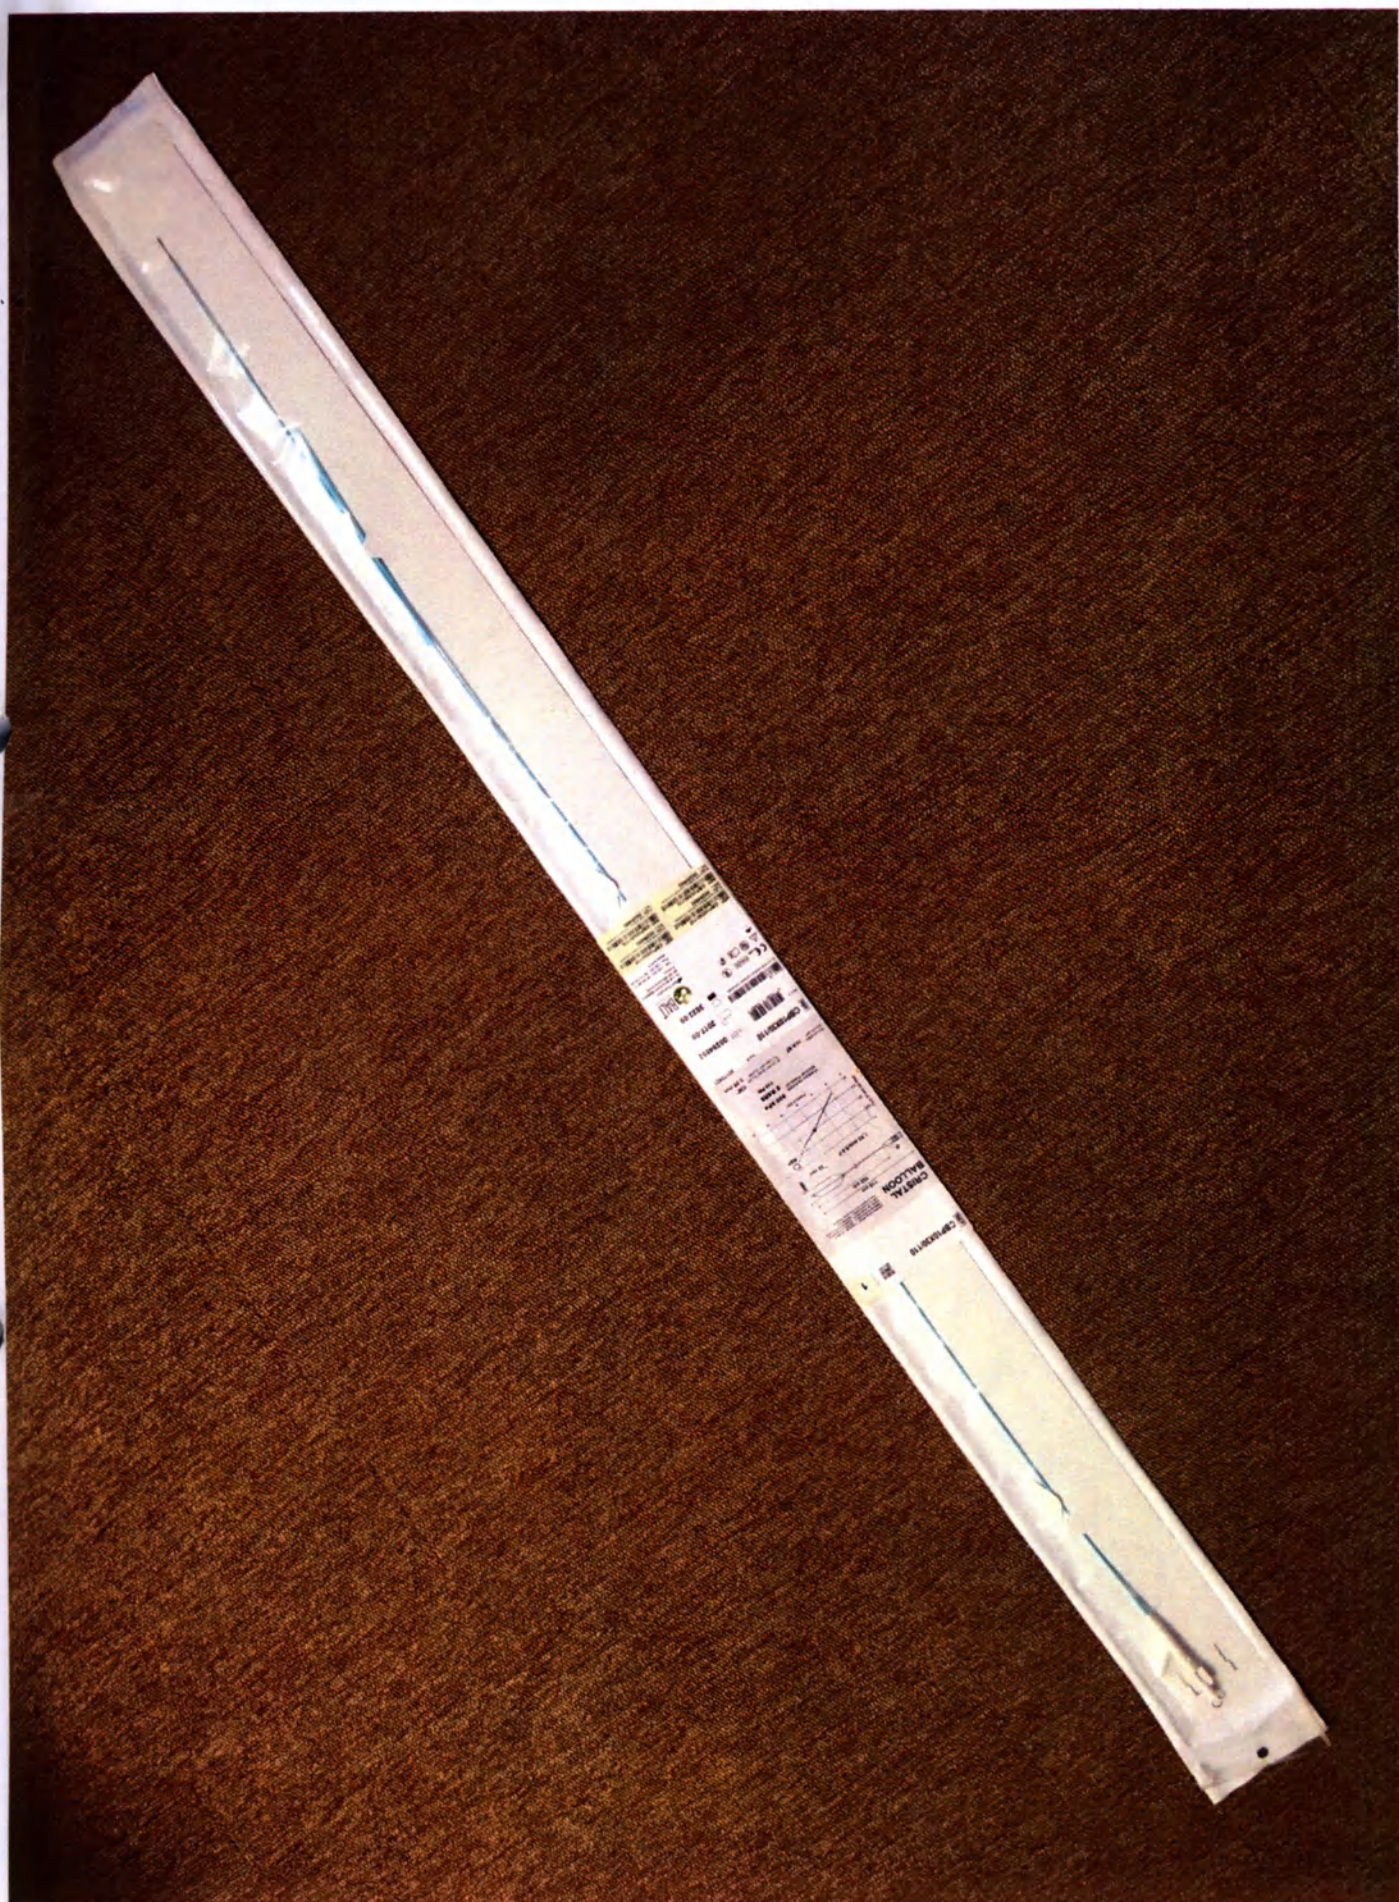


Рисунок 2. Внешний вид медицинского изделия в финишной упаковке для стерилизации.



Рисунок 3. Внешний вид картонной упаковки медицинского изделия.

REF CBVP8X20/70

2022-09
LOT: 00306169




CONTENTS

1

CRISTAL BALLOON

Contenido de suministro / Contenu de livraison /
Contenuto della fornitura / Contenu de livraison /
Contenido de suministro / Contenu de livraison /
Contenuto della fornitura / Contenu de livraison /
Contenuto della fornitura / Contenu de livraison /

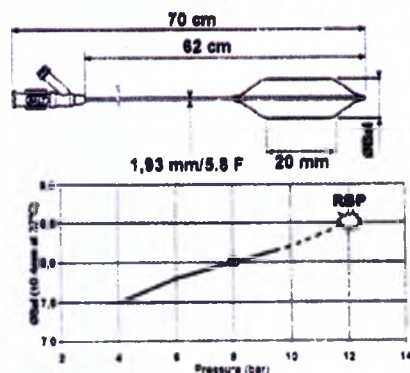

Pressure nominal
Nominal Pressure
800 kPa
8 BARS
116 PSI

Introducer/
Introducer
IVA 6F

Volume balloon (±10%)
Ballon volume (±10%)
2 ml
+
Space port (±10%)
Coed space (±10%)
1 ml

A Useful Guideline
To Use the Guide
.038"
0.98 mm

Ind.11 20180152

REF CBVP8X20/70



LOT 00306169



2017-08

2022-09



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Mignotte
90100 Montmorillon
France
Tel: +33 (0)1 30 00 40 41
Fax: +33 (0)1 34 17 01 40
www.balt.fr

REF CBVP8X20/70



LOT 00306169

REF CBVP8X20/70



LOT 00306169

REF CBVP8X20/70



LOT 00306169

REF CBVP8X20/70




LOT 00306169

Рисунок 4. Маркировка финишной упаковки для стерилизации.

CRISTAL BALLOON

Catheters de vinylplastice / Vinylplastice catheters /
Catheters para vinilplastico / Katheter für
vinylplastik / Catheter per vinilplastico /
Catheters de vinilplastico / Catheter de
vinilplastik / Katheter per vinilplastico /
Vinylplastik Catheter

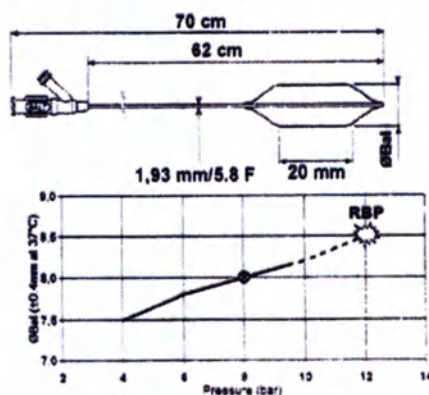

Pressure nominale
Nominal Pressure
800 kPa
8 BARS
116 PSI

introducere
introduce
IVA 6F

Volume ballon (±10%): **2 ml**
Balloon volume (±10%):
+
Espace mort (±10%): **1 ml**
Dead space (±10%):

Utiliser avec Guide **.036"**
To Use with Guide **0.89 mm**

Ind.11 **20180152**

CBVP8X20/70



LOT **00306169**



2017-08

2022-09



Balt Extrusion
10, rue de la Croix Vignerot
95160 Montmorency
France
Tel: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 5. Маркировка картонной упаковки медицинского изделия.

REF CBP8X3035/110


2022-07
LOT: 00292307

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateter per angioplastica / Cateteres de Angioplastia
Cewniki do angioplastyki / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

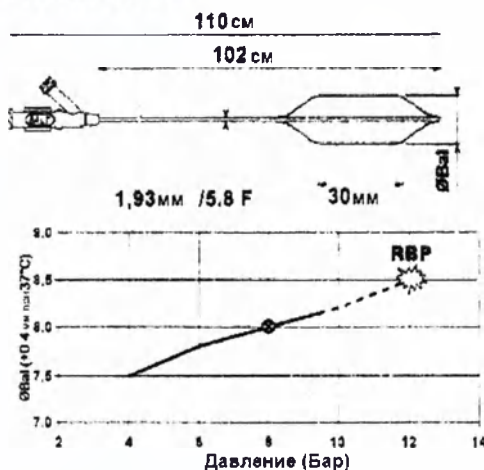

Pression nominale - 800 кПа
Nominal Pressure
8 Бар
116 PSI

Introduceur : IVA CF
Интродьюсер:

A Utiliser avec Guide : .036"
Для использования
с проводником : 0,89 mm

Ind 20170742

REF CBP8X3035/110



LOT 00292307



2017-07

2022-07



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerons
95160 Montmorency
France
Tél. +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBP8X3035/110
LOT 00292307

REF CBP8X3035/110
LOT 00292307

REF CBP8X3035/110
LOT 00292307

REF CBP8X3035/110
LOT 00292307

Рисунок 6. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBP8X3035/110.

REF CBP8X3035/110




2

2022-07
LOT: 00202307

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateteri per angioplastia / Cateteres de Angioplastia /
Cateteri de angioplastia / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

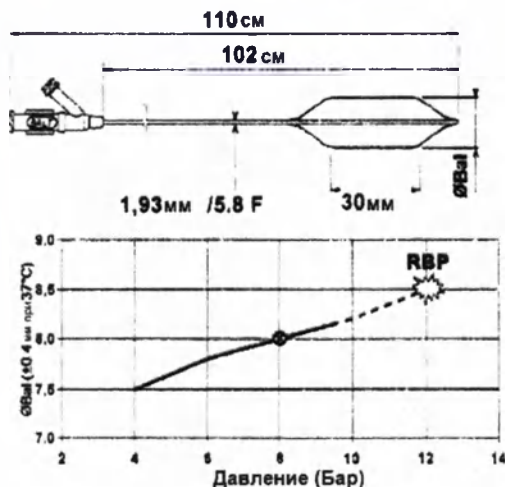

Pression nominale : **800 кПа**
Nominal Pressure :

8 Бар

116 PSI

Introduceur : **IVA 6F**
Интердюсер:

A Utiliser avec Guide : **.035"**
Для использования
с проводником : **0,89 mm**

Ind. # **20170742**

REF CBP8X3035/110



LOT 00292307



2017-07

2022-07



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95180 Montmorency
France
Тел. +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 7. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBP8X3035/110.

REF CBP10X30/110




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateteri per angioplastica / Cateteres de Angioplastia /
Cewniki do angioplastyki / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

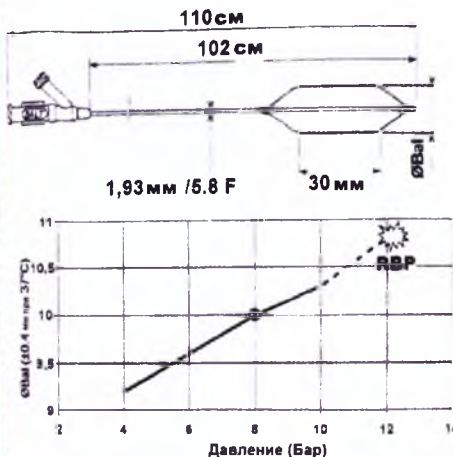

Pression nominale : 800 кПа
Номинальное
давление: 8 Бар
116 PSI

Introduit :
Интродьюсер: IVA 6F

A Utiliser avec Guide .035"
Для использования
с проводником : 0,89 мм

Ind. 8 20170921

REF CBP10X30/110



LOT 00294892



2017-09

2022-09



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 88 46 4
Факс: +33 (0)1 34 17 03 4
www.balt.fr

REF CBP10X30/110
LOT 00294892

REF CBP10X30/110
LOT 00294892

REF CBP10X30/110
LOT 00294892

REF CBP10X30/110
LOT 00294892

Рисунок 8. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBP10X30/110.

REF CVP10X30/110





Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateteri per angioplastica / Cateteres de Angioplastia /
Cewniki do angioplastyki / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

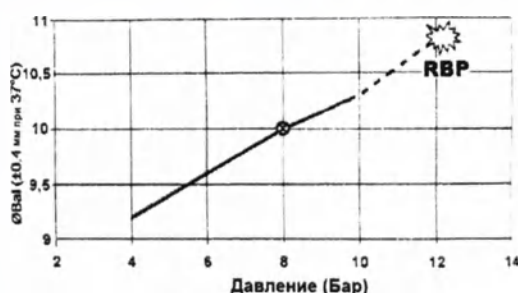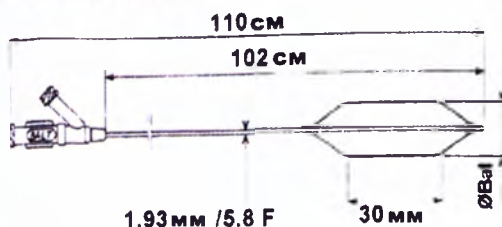

Pression nominale : 800 кПа

Номинальное

давление:

8 Бар

116 PSI

Introduceur :
Интродьюсер: IVA 6F

A Utiliser avec Guide : 035"
Для использования
с проводником : 0,89 мм

ind.8

20170921

REF CVP10X30/110



LOT 00294892



2017-09

2022-09



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 4
Факс: +33 (0)1 34 17 03 4
www.balt.fr

Рисунок 9. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения,
вариант исполнения CVP10X30/110.

REF CBP12X40/110




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateteri per angioplastica / Cateteres de Angioplastia /
Cewniki do angioplastyki / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

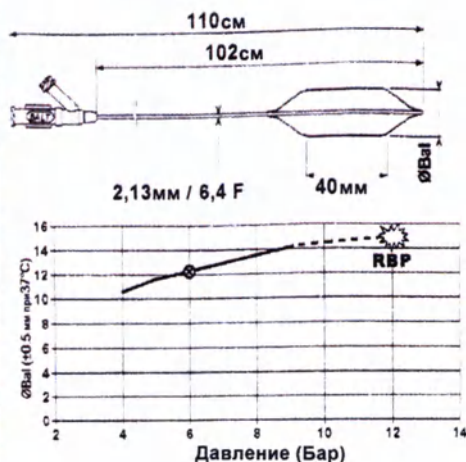

Pression nominale : **600 кПа**
Nominal Pressure : **6 Бар**
87 PSI

Introducteur
Интродьюсер: **IVA 7F**

A Utiliser avec Guide : **0,35"**
Для использования
с проводником : **0,89 mm**

ind. № 20170852

REF CBP12X40/110



LOT 00292692



2017-08



2022-08



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignero
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 4
Fax: +33 (0)1 34 17 03 4
www.balt.fr

REF CBP12X40/110



LOT 00292692

REF CBP12X40/110



LOT 00292692

REF CBP12X40/110



LOT 00292692

REF CBP12X40/110



LOT 00292692

Рисунок 10. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBP12X40/110.

REF CVP12X40/110




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters d'angioplastie / Angioplasty catheters /
Cateteres de angioplastia / Katheter für angioplastie /
Cateteri per angioplastica / Cateteres de Angioplastia /
Cewniki do angioplastyki / Баллонные катетеры для
периферической ангиопластики

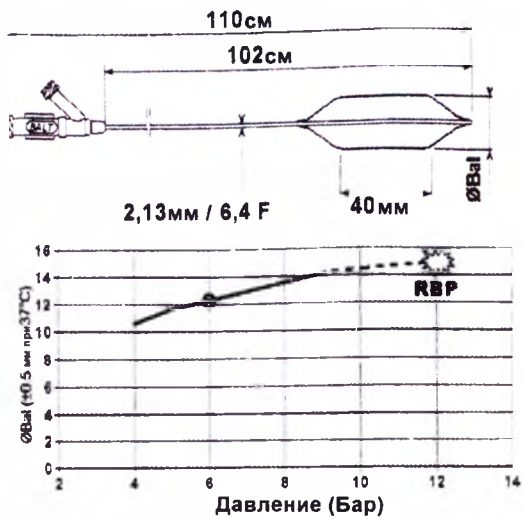

Pression nominale : **600 кПа**
Nominal Pressure : **6 Бар**
87 PSI

Introducteur : **IVA 7F**
Интрольюзер:

A Utiliser avec Guide : **.035"**
Для использования
с проводником : **0,89 mm**

ind.8 **20170852**

REF CVP12X40/110



LOT **00292692**



2017-08

2022-08



Не токсично



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignero
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 4
Факс: +33 (0)1 34 17 03 4
www.balt.fr

Рисунок 11. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CVP12X40/110.

REF CBV12X30/110

2023-01
LOT: 00305520




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplasties /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Walvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

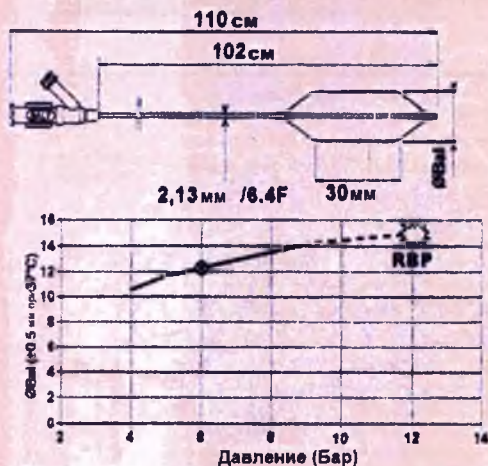

Pression nominale : 600 кПа
Номинальное
давление: 6 Бар
(87 PSI)

Introduceur : IVA 7F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): 6 мл
Максимальный
объем баллона

A Utiliser avec Guide : 0.38"
Для использования
с проводником : 0.97 mm

Espace mort (±10%): 1 мл
Мертвое
пространство

Ind.11 20180121

REF CBV12X30/110



LOT 00305520



2018-01

2023-01



STERILE 60



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV12X30/110
LOT 00305520

REF CBV12X30/110
LOT 00305520

REF CBV12X30/110
LOT 00305520

REF CBV12X30/110
LOT 00305520

Рисунок 12. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, однократного применения, вариант исполнения CBV12X30/110.

REF CBV12X30/110


2023-01
LOT: 00305520



Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

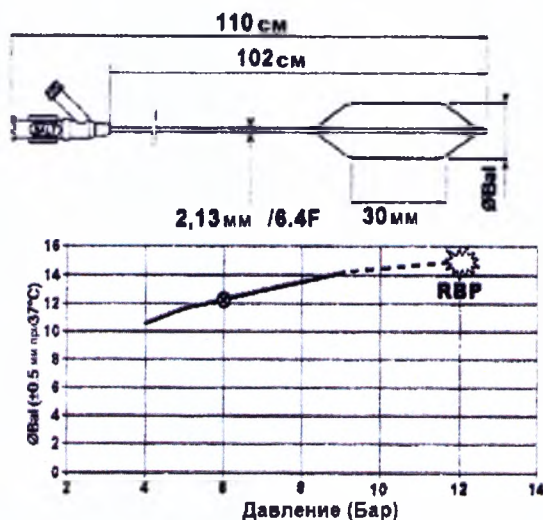

Pression nominale : 600 кПа
Номинальное
давление: 6 Бар
(87 PSI)

Introduceur : IVA 7F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): 6 мл
Максимальный
объем баллона

+

Espace mort (±10%): 1 мл
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 mm

Ind.11 20180121

REF CBV12X30/110



LOT 00305520



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 13. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV12X30/110.

REF CBV15X30/110

2022-12
LOT: 00301818


Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateters para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

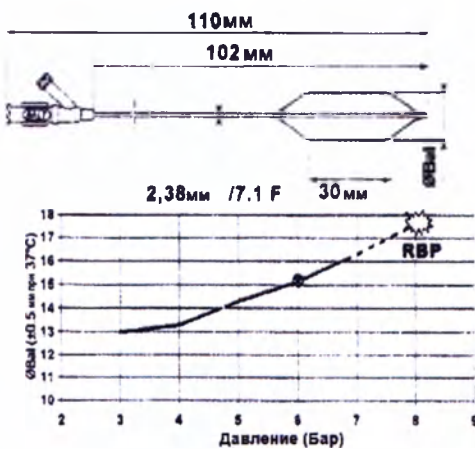

Pression nominale : 600 кПа
Номинальное
давление: 6 Бар
67 PSI

Introduceur : IVA 8F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): 9 мл
Маломальный
объем баллона

+

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 mm

Espace mort (±10%): 2 мл
Мертвое
пространство

ind.11 20171211

REF CBV15X30/110



LOT 00301818



2017-12

2022-12



STERILE EO



Не токсично

BALT Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV15X30/110
LOT 00301818

REF CBV15X30/110
LOT 00301818

REF CBV15X30/110
LOT 00301818

REF CBV15X30/110
LOT 00301818

Рисунок 14. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV15X30/110.


**CBV15X30/110**
2022-12
LOT : 00301818

**2**
Соержание

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter fur
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Walvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

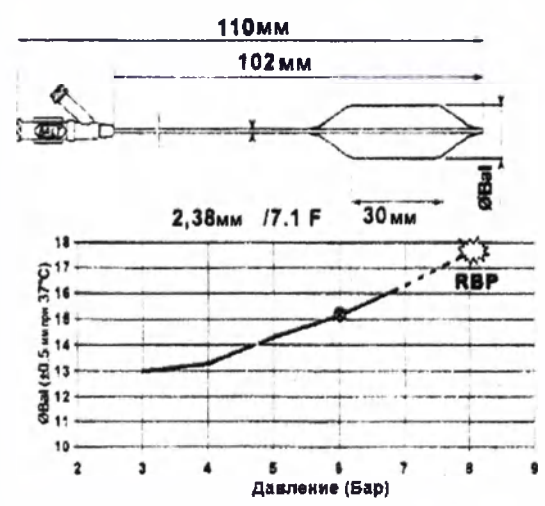

Pression nominale : **600 кПа**
Номинальное давление: **6 Бар**
67 PSI

Introduceur : **IVA 8F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : **9 мл**
Максимальный объем баллона

Espace mort (±10%) : **2 мл**
Мертвое пространство

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования с проводником : **0,97 mm**

Ind.11 **20171211**

 **CBV15X30/110**

EAN13  LOT **00301818**

CODE 128  **2017-12**

 **2022-12**



**Не токсично**

BALT Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 15. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV15X30/110.

REF CBV15X40/110

2023-01
LOT: 00304713




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateter per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteres de
Valvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

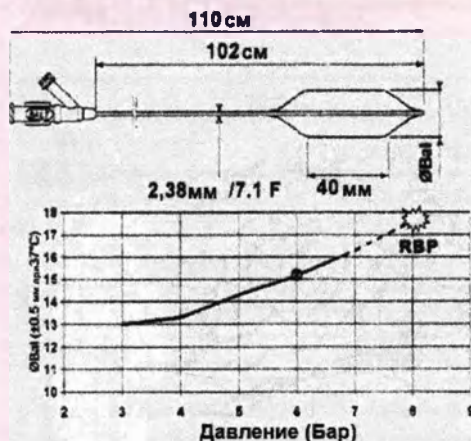

Pression nominale : **600 кПа**
Номинальное
давление: **6 Бар**
87 psi

Introduceur : **IVA 8F**
Интродьюсер:

Volume ballon $(\pm 10\%)$: **10 мл**
Максимальный
объем баллона $(\pm 10\%)$:

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником : **0,97 mm**

Espace mort $(\pm 10\%)$: **2 мл**
Мертвое
пространство $(\pm 10\%)$:

ind.13 20180132


REF CBV15X40/110

EAN13



LOT 00304713

CODE 128



2018-01



2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France



Не токсично

Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV15X40/110



LOT 00304713

REF CBV15X40/110



LOT 00304713

REF CBV15X40/110



LOT 00304713

REF CBV15X40/110



LOT 00304713

Рисунок 16. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV15X40/110.

REF CBV15X40/110


2023-01
LOT: 00304713

Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
BALLOON Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

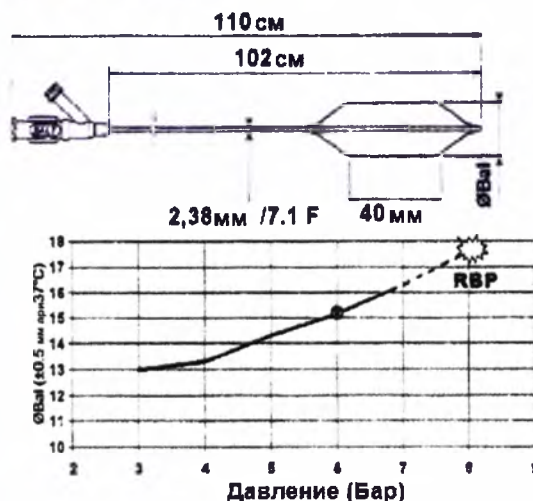

Pression nominale : **600 кПа**
Номинальное
давление: **6 Бар**
87 Psi

Introduceur : **IVA 8F**
Интродьюсер:

Volume ballon $(\pm 10\%)$ **10 мл**
Максимальный
объем баллона $(\pm 10\%)$

A Utiliser avec Guide : **0.038"**
Для использования
с проводником : **0.97 mm**

Espace mort $(\pm 10\%)$ **2 мл**
Мертвое
пространство $(\pm 10\%)$

ind.13 20180132

REF CBV15X40/110



LOT 00304713



2018-01



2023-01



STERILE EO



Не ТОКСИЧНО

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 17. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV15X40/110.

REF CBV16X40/110

g 2022-10
LOT: 00297100




Сокращение

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Cateteres für
Valvuloplastie / Cateteres per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteres de
Valvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

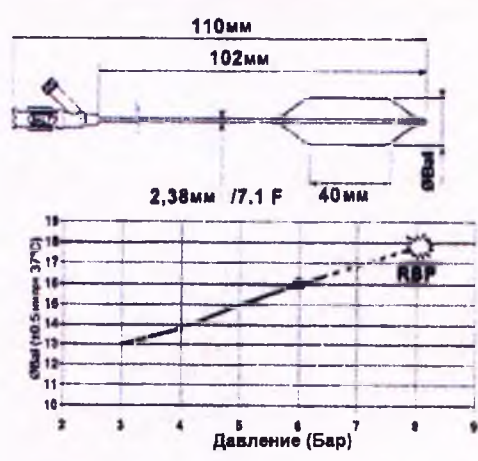

Pression nominale : **600 кПа**
Номинальное давление: **6 Бар**
87 psi

Introduceur : **IVA 8^e**
Интродьюсер: **IVA 8^e**

Volume ballon (±10%): **12 мл**
Максимальный объем баллона (±10%): **+**

Емкость лот. (±10%): **2 мл**
Емкость лот. (±10%): **2 мл**

A l'usage avec Guide : **0.038"**
Для использования с проводником : **0.97 mm**

Ind.11 20171021

REF CBV16X40/110



LOT **00297100**



2017-10
2022-10

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Факс: +33 (0)1 38 89 46 41
Тел.: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV16X40/110
010370048131005172210291000297100
LOT 00297100

REF CBV16X40/110
010370048131005172210291000297100
LOT 00297100

REF CBV16X40/110
010370048131005172210291000297100
LOT 00297100

REF CBV16X40/110
010370048131005172210291000297100
LOT 00297100


Рисунок 18 Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, однократного применения, вариант исполнения CBV16X40/110.

REF CBV16X40/110
2022-10
LOT: 00297100



Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**
Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

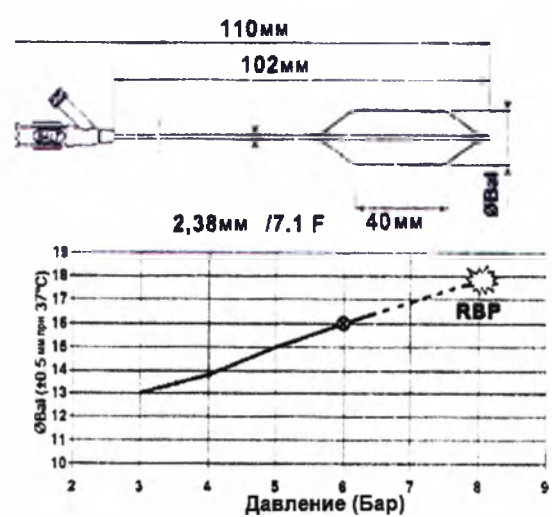

Pression nominale : **600 кПа**
Номинальное
давление: **6 Бар**
87 PSI

Introduceur : **IVA 8F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : **12 мл**
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%) : **2 мл**
Мертвое
пространство (±10%)

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником : **0,97 mm**

Ind.11 **20171021**

REF CBV16X40/110



LOT **00297100**



2017-10
 2022-10

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Факс: +33 (0)1 39 89 46 41
Тел.: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Не токсично

Рисунок 19. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV16X40/110.


CBV18X30/110
 2023-01
 LOT: 00306683



Баллонные катетеры CRISTAL
 для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
 стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
 BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
 Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
 Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
 Cateteres de valvuloplastia / Cateteri de
 Valvuloplastia / Баллонные катетеры для
 вальвулопластики

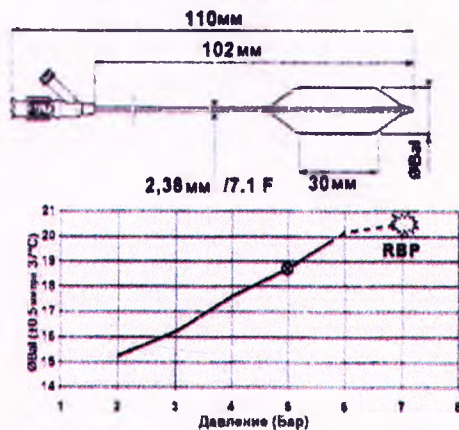

Pression nominale : **800 кПа**
 Номинальное
 давление: **8 Бар**
72 PSI

Introduceur : **9F**
 Интродьюсер:

Volume ballon $\pm 10\%$: **12 мл**
 Максимальный
 объем баллона
 +
 Espace mort $\pm 10\%$: **2 мл**
 Мертвое
 пространство $\pm 10\%$

A Utiliser avec Guide : **.038"**
 Для использования
 с проводником: **0,97 мм**

Ind.11 20180141

CBV18X30/110



LOT **00306683**



2018-01

2023-01



Balt Extrusion
 10, rue de la Croix-Vignerot
 95100 Montmorency
 France

Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
 Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
 www.balt.fr

Не токсично







Рисунок 20. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV18X30/110.

REF CBV18X30/110
2023-01
LOT: 00306683



Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**
Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

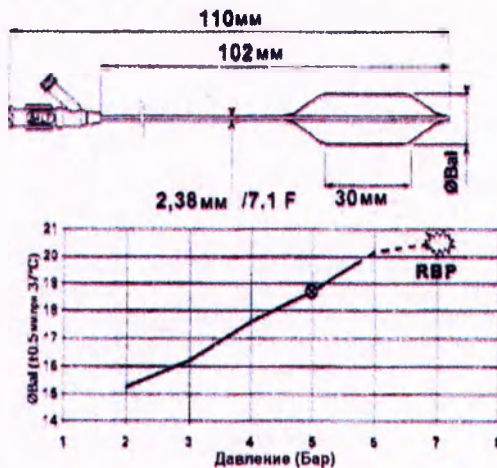

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное давление: 5 Бар
72 PSI
Introduceur : 9F
Интродьюсер:
Volume ballon (+10%): 12 мл
Максимальный объем Баллона +
Espace mort (+10%): 2 мл
Мертвое пространство (+10%):
A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования с проводником : 0,97 мм
ind.11 20180141

REF CBV18X30/110



LOT 00306683



2018-01

2023-01



Рисунок 21. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV18X30/110.

REF CBV18X40/110




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, однократного применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

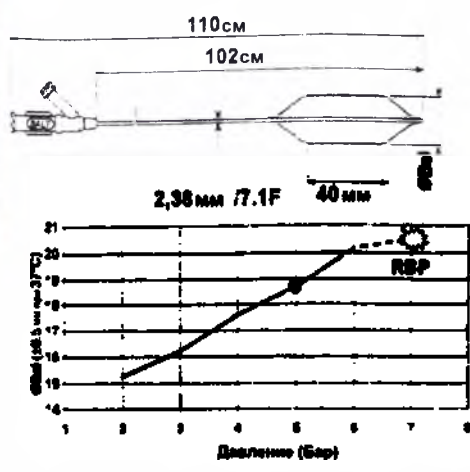

Pression nominale : **500 кПа**
Номинальное давление: **5 Бар**
72 PSI

Introduceur : **9F**
Интродьюсер: **9F**


Volume ballon (±10%) : **14 ml**
Максимальный объем баллона (±10%) : **14 ml**

Баллон (±10%) : **14 ml**
Мертвое пространство (±10%) : **2 ml**

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования с проводником : **0,97 мм**

ind.13 20180111


REF CBV18X40/110



LOT 00304712

2018-01

2023-01



BALT
EXTRUSION

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV18X40/110
LOT 00304712

REF CBV18X40/110
LOT 00304712

REF CBV18X40/110
LOT 00304712

REF CBV18X40/110
LOT 00304712

Рисунок 22. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, однократного применения, вариант исполнения CBV18X40/110.

REF CBV18X40/110




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

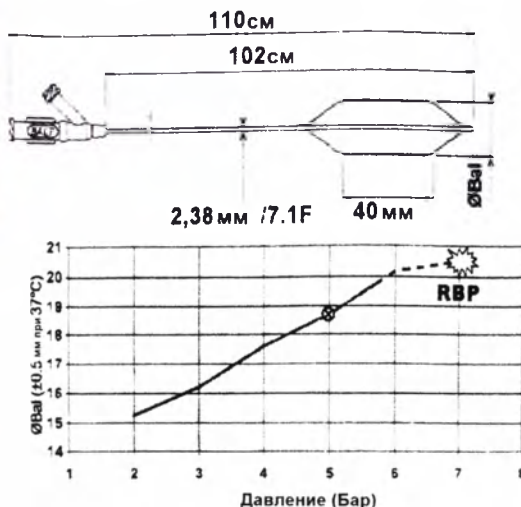

Pression nominale : **500 кПа**
Номинальное давление: **5 Бар**
72 Psi

Introduceur : **9F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): **14 ml**
Максимальный объем баллона (±10%): **14 ml**
+
Espace mort (±10%): **2 ml**
Мертвое пространство (±10%): **2 ml**

A Utiliser avec Guide : **038"**
Для использования с проводником : **0,97 мм**

ind.13 20180111

REF CBV18X40/110



LOT 00304712



2018-01

2023-01



Не токсично



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 23. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV18X40/110.

REF CBV18X45/110




Содержание 1

2022-12
LOT: 00304429

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter fur
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

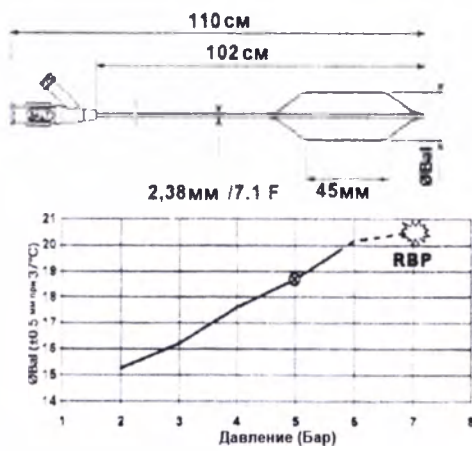

Прессия номинальная: **500 кПа**
Номинальное давление: **5 Бар**
72 PSI

Introducteur: **9F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): **15 мл**
Максимальный объем баллона
Espace mort (±10%): **2 мл**
Мертвое пространство

A Utiliser avec Guide: **.038"**
Для использования с проводником: **0.97 MM**

ind.11 20171232

REF CBV18X45/110



LOT 00304429



2017-12

2022-12



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV18X45/110
LOT 00304429

REF CBV18X45/110
LOT 00304429

REF CBV18X45/110
LOT 00304429

REF CBV18X45/110
LOT 00304429

Рисунок 24. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV18X45/110.

REF CBV18X45/110



Содержание


2

2022-12
LOT : 00304429

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Catheter for
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Wahuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

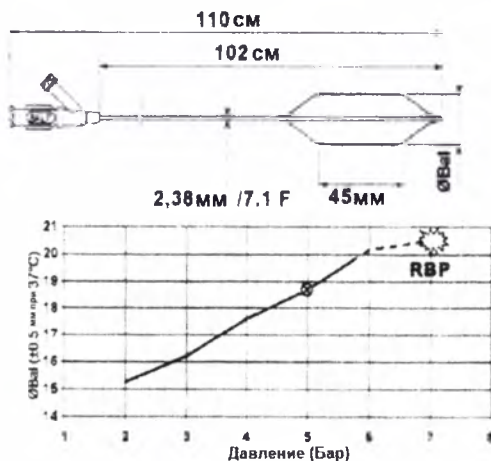

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное
давление: 5 Бар
72 PSI

Introduceur : 9F
Интродьюсер:

Volume ballon
Максимальный
объем баллона

15 мл

+

Espace mort
Мертвое
пространство

2 мл

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0.97 мм

ind.11 20171232

REF CBV18X45/110



LOT 00304429



2017-12



2022-12



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 25. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV18X45/110.

REF CBV20X30/110

2023-01
LOT: 00304711




Сторона 1

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewunki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

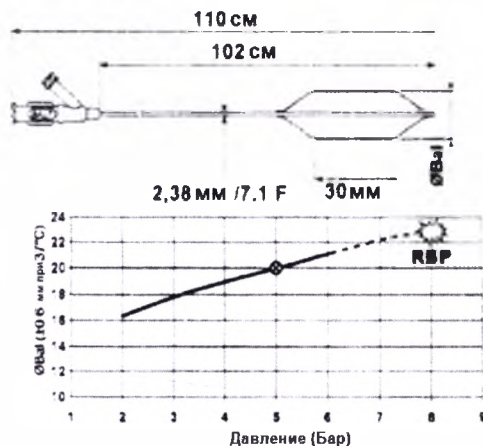

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное
давление: 5 Бар
72 PSI

Introduceur : 9F
Интродьюсер: 9F

Volume ballon : 14 мл
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort : 2 мл
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 мм

ind.11 20180111

REF CBV20X30/110



LOT 00304711



2018-01

2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV20X30/110
LOT 00304711

REF CBV20X30/110
LOT 00304711

REF CBV20X30/110
LOT 00304711

REF CBV20X30/110
LOT 00304711

Рисунок 26. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X30/110.

REF CBV20X30/110

2023-01
LOT: 00304711




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Walvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

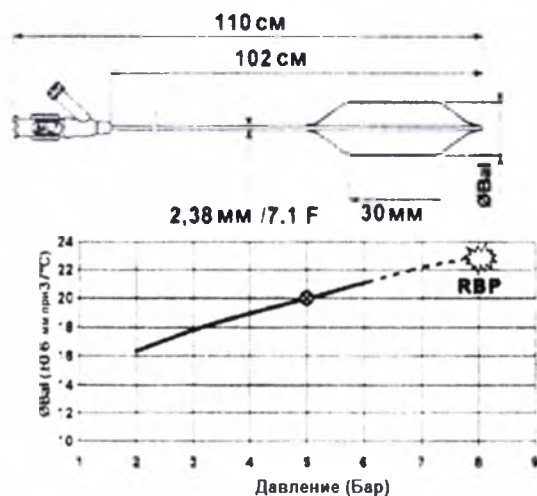

Pression nominale : **500 кПа**
Номинальное
давление: **5 Бар**
72 PSI

Introduceur : **9F**
Интродьюсер:

Volume ballon **14 мл**
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort **2 мл**
Мертвое
пространство


A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником: **0,97 мм**

ind.11 20180111

REF CBV20X30/110



LOT 00304711



2018-01



2023-01



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 27. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X30/110.

REF CBV20X40/110



Сопровож.


1

2023-01
LOT: 00306224

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Valvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

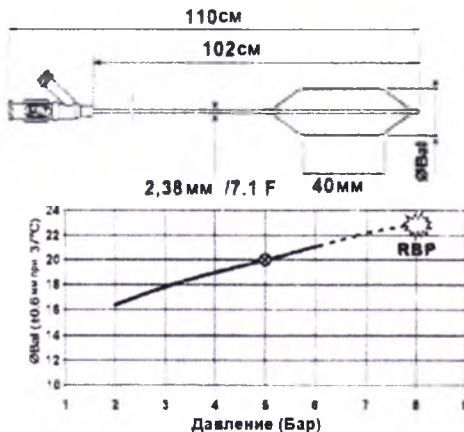

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное
давление: 5 Бар
72 PSI

Introduceur : 9F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) 17 мл
Максимальный
объем Баллона

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником: 0,97 мм

Espace mort (±10%) 2 мл
Мертвое
пространство

ind.11 20180141

REF CBV20X40/110



LOT 00306224



2018-01

2023-01



STERILE EO



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95100 Montmorency
France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Не токсично

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

Рисунок 28. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X40/110.

REF CBV20X40/110

2023-01
LOT: 00306224




Степень

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri de
Valvuloplastiya / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

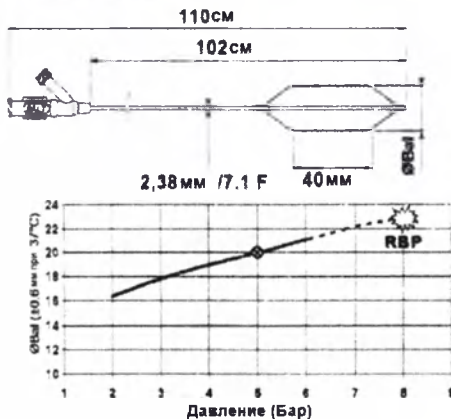

Pression nominale: **500 кПа**
Номинальное
давление: **5 Бар**
72 PSI

Introduceur: **ef**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): **17 мл**
Максимальный
объем баллона (±10%): **17 мл**

A Utiliser avec Guide: **.038"**
Для использования
с проводником: **0,97 мм**


Espace mort (±10%): **2 мл**
Мертвое
пространство (±10%): **2 мл**

ind.11 20180141

REF CBV20X40/110



LOT 00306224



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 00 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

REF CBV20X40/110
LOT 00306224

Рисунок 29. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X40/110.

REF CBV20X45/110

2023-01

LOT: 00306992




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, вариант исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateter per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri de
Valvuloplastyk / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

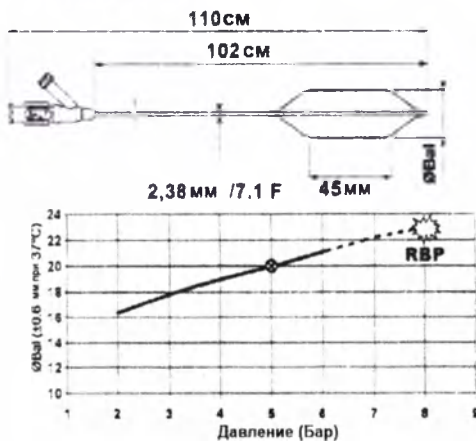

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное
давление: **5 Бар**
(72 PSI)

Introduceur : 9F
Интродьюсер:

Volume ballon
Максимальный
объем баллона: **19 мл**
+
Espace mort
Мертвое
пространство: **2 мл**

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : **0,97 мм**

ind.14 20180141

REF CBV20X45/110



LOT 00306992



2018-01



2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Не токсично

REF CBV20X45/110
LOT 00306992

REF CBV20X45/110
LOT 00306992

REF CBV20X45/110
LOT 00306992

REF CBV20X45/110
LOT 00306992

Рисунок 30. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X45/110.

REF CBV20X45/110

2023-01
LOT : 00306992




Соединение

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

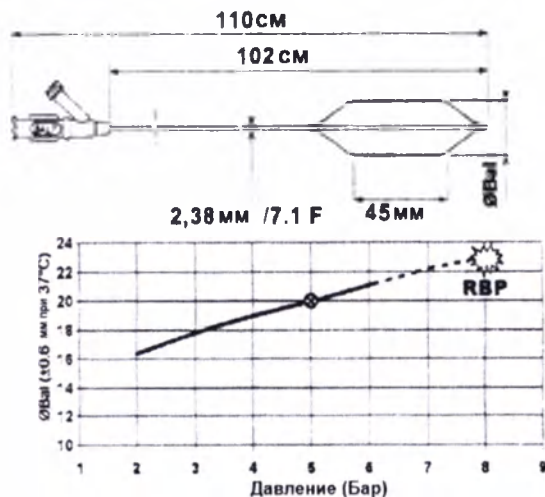

Pression nominale : 500 кПа
Номинальное
давление: 5 Бар
(72 PSI)

Introduceur : 3F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : 19 мл
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%) : 2 мл
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : 0.038"
Для использования
с проводником : 0.97 мм

ind.14 20180141

REF CBV20X45/110



LOT 00306992



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 31. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV20X45/110.

REF CBV23X45/110




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastie / Cateteri do
Valvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

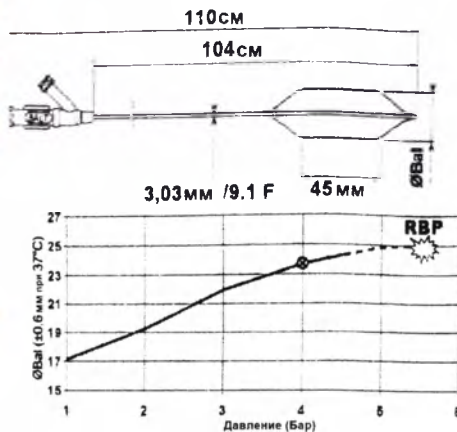

Pression nominale **400 кПа**
Номинальное **4 Бар**
давление **(58 PSI)**

Introduit par : **IVA 10F**
Интродюсер :

Volume ballon (±10%) **25 мл**
Максимальный **25 мл**
объем баллона
Емкость мертвого **3 мл**
пространства (±10%)

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования **0,97 mm**
с проводником

ind.12 **20180111**

REF CBV23X45/110



LOT 00305222



2018-01



2023-01



Не токсично



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr




LOT 00306222



LOT 00306222



LOT 00306222



LOT 00306222

Рисунок 32. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV23X45/110.

REF CBV23X45/110




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteres de valvuloplastia /
Walvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

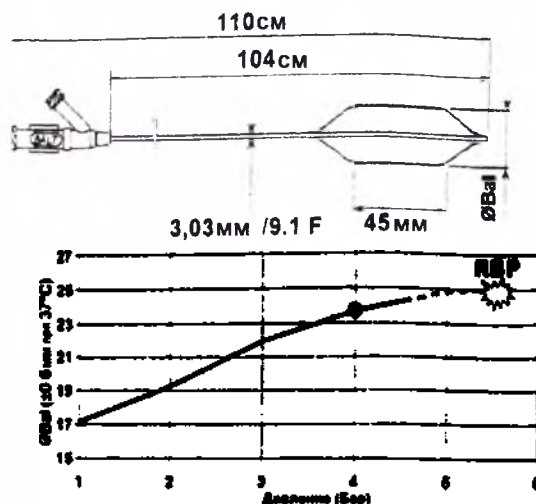

Press. on nominale
Номинальное
давление

400 кПа
4 Бар
(58 PSI)

Introduceur : IVA 10F
Интродьюсер :

Volume ballon (±10%) : **25 мл**
Максимальный
объем баллона
Espace mort (±10%) : **+**
Мертвое
пространство (±10%) : **3 мл**

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником : **0,97 mm**

ind.12 20180111

REF CBV23X45/110



LOT 00305222



2018-01

2023-01



Не токсично



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 33. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV23X45/110.

REF CBV25X40/110

2022-10
LOT: 00297760




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Wahvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

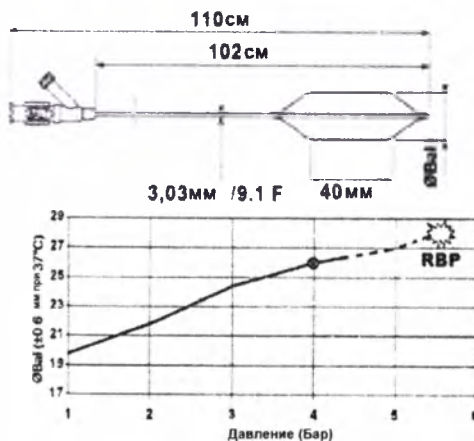

Pression nominale : 400 кПа
Номинальное
давление: 4 Бар
58 Psi

Introduceur :
Интродьюсер: IVA 10F

Volume ballon (±10%): 29 мл
Максимальный
объем баллона (±10%)

+ 3 мл

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 мм


Espace mort (±10%):
Мертвое
пространство (±10%)

ind 11 20171032

REF CBV25X40/110



LOT 00297750



2017-10



2022-10



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France

Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Не токсично

REF CBV25X40/110
LOT 00297760

REF CBV25X40/110
LOT 00297760

REF CBV25X40/110
LOT 00297760

REF CBV25X40/110
LOT 00297760

Рисунок 34. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV25X40/110.

REF CBV25X40/110

2022-10
LOT: 00297750




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

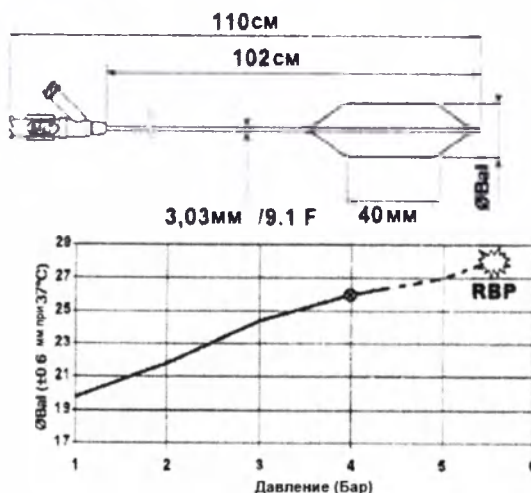

Pression nominale : **400 кПа**
Номинальное
давление: **4 Бар**
58 PSI

Introduceur : **IVA 10F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): **29 мл**
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%): **3 мл**
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником : **0,97 мм**

ind.11 20171032

REF CBV25X40/110



LOT 00297750



2017-10

2022-10



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 35. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV25X40/110.

REF CBV25X50/110

2023-01
LOT: 00306606


Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в варианте наполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateter per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

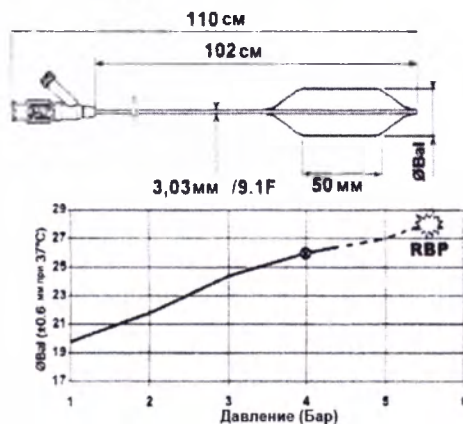

Pression nominale: **400 кПа**
Номинальное
давление: **4 Бар**
58 PSI

Introducteur: **IVA 10F**
Интродьюсер:

Volume ballon
Максимальный
объем баллона: **34 мл**
(±10%)

A Utiliser avec Guide: **038"**
Для использования
с проводником: **0,97 мм**

Espace mort
Мертвое
пространство: **3 мл**
(±10%)

ind.14 20180141

REF CBV25X50/110



LOT 00306606



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV25X50/110
LOT 00306606

REF CBV25X50/110
LOT 00306606

REF CBV25X50/110
LOT 00306606

REF CBV25X50/110
LOT 00306606

Рисунок 36. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV25X50/110.

REF CBV25X50/110

2023-01
LOT : 00306606




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

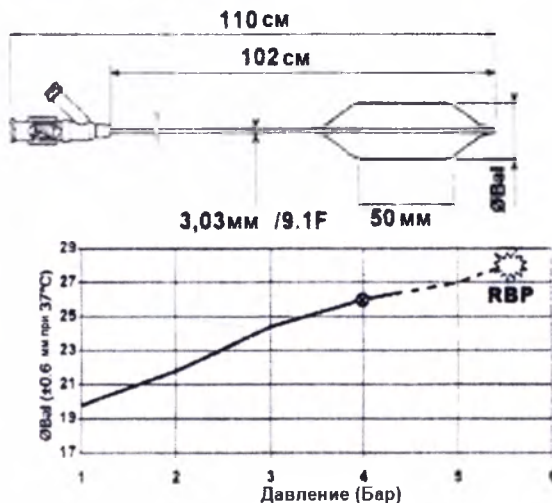

Pression nominale : **400 кПа**
Номинальное
давление: **4 Бар**
58 PSI

Introduceur : **IVA 10F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : **34 мл**
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%) : **3 мл**
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : **.038"**
Для использования
с проводником : **0,97 мм**

ind.14 20180141

REF CBV25X50/110



LOT 00306606



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 37. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV25X50/110.

REF CBV28X50/110

2023-01
LOT: 00305880


C00111111

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, однократного применения, вариант исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters.
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteres do
Walvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

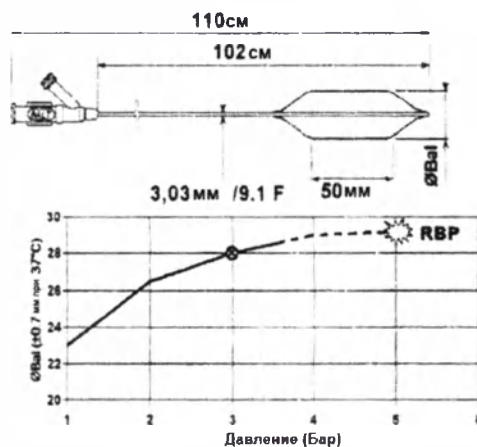

Pression nominale : **300 кПа**
Номинальное
давление: **3 Бар**
44 PSI

Introduceur : **IVA 12F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) **43 мл**
Максимальный
объем баллона (±10%)
+ **3 мл**
Средство для
контраста (±10%)

A Utiliser avec Guide
Для использования
с проводником **0.38"**
0.97 мл

ind.12 **20180131**

REF CBV28X50/110



LOT 00305880



2018-01



2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV28X50/110
LOT 00305880

REF CBV28X50/110
LOT 00305880

REF CBV28X50/110
LOT 00305880

REF CBV28X50/110
LOT 00305880

Рисунок 38. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, однократного применения, вариант исполнения CBV28X50/110.

REF

CBV28X50/110

2023-01

LOT : 00305880


Сиринг

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики.
стерильные, одноразового применения, в варианте исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

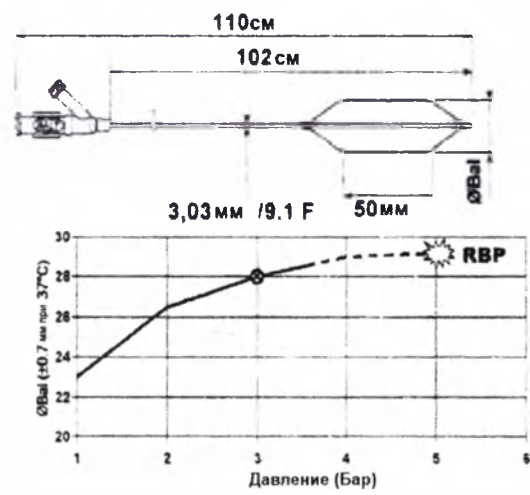

Pression nominale : 300 кПа
Номинальное давление: 3 Бар
44 PSI

Introduceur : IVA 12F
Интродьюсер:

Volume Balloon (±10%)
Максимальный объем баллона 43 мл
+
Espace mort (±10%)
Мертвое пространство 3 мл

A Utiliser avec Guide
Для использования с проводником .038"
0,97 мл

ind.12 20180131

REF

CBV28X50/110

LOT 00305880

2018-01

2023-01

0297

STERILE EO

Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerons
95160 Montmorency
France
Тел: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 39. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV28X50/110.


REF CBV30X60/110
2023-01
LOT: 00305883



Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateter per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteres de
Valvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

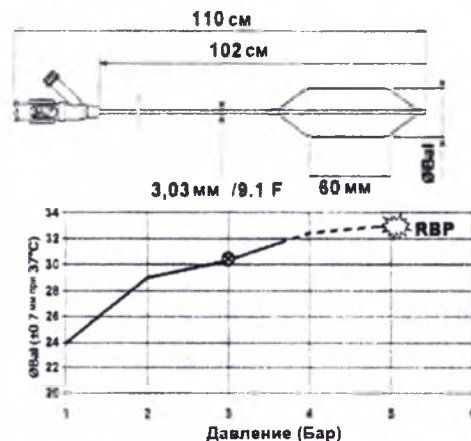

Pression nominale : 300 кПа
Номинальное
давление: 3 Бар
44 PSI

Introduceur : IVA 12F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): 56 MM
Максимальный (±10%)
объем баллона + A Utiliser avec Guide : 038"
Для использования
с проводником : 0,97 MM

Espace mort (±10%): 3 MM
Мертвое (±10%)
пространство

ind.11 20180131

REF CBV30X60/110



LOT 00305883



2018-01

2023-01



REF CBV30X60/110
LOT 00305883

REF CBV30X60/110
LOT 00305883

REF CBV30X60/110
LOT 00305883

REF CBV30X60/110
LOT 00305883

Рисунок 40. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV30X60/110.


REF CBV30X60/110
 2023-01
 LOT: 00305883



Баллонные катетеры CRISTAL
 для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
 стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
 BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
 Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
 Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
 Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
 Walsuloplastyki / Баллонные катетеры для
 вальвулопластики

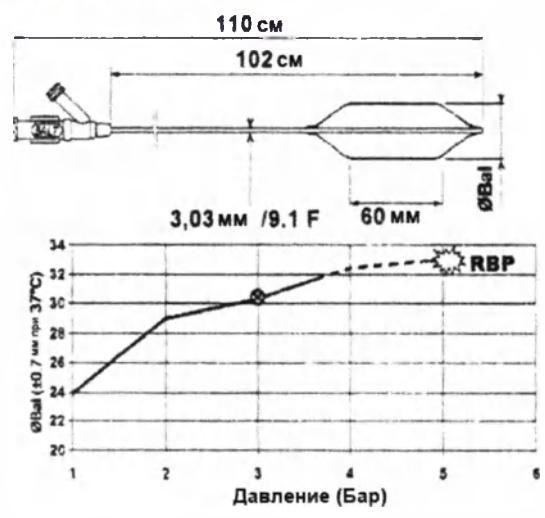

Pression nominale : **300 кПа**
 Номинальное давление: **3 Бар**
44 PSI

Introduceur : **IVA 12F**
 Интродьюсер:

Volume ballon (±10%): **56 мм**
 Максимальный объем баллона
 +
 Espace mort (±10%): **3 мм**
 Мертвое пространство

A Utiliser avec Guide : **.038"**
 Для использования с проводником : **0,97 мм**

ind.11 20180131

REF CBV30X60/110



LOT **00305883**



2018-01

2023-01



BALT
 BALT Extrusion
 10, rue de la Croix-Vigneron
 95180 Montmorency
 France
 Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
 Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
 www.balt.fr

Рисунок 41. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV30X60/110.

42

REF CBV35X60/110

2022-03
LOT : 00284486




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

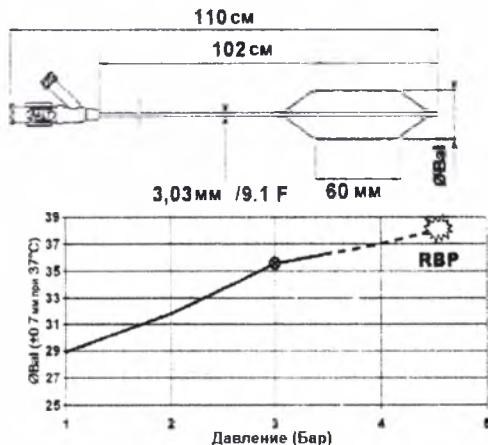

Pression nominale : 300 кПа
Номинальное
давление: 3 Бар
44 PSI

Introduceur : 15F
Интродьюсер:

Volume ballon
Максимальный
объем баллона

73 мл

+

Espace mort
Мертвое
пространство

3 мл

A Utiliser avec Guide : 038"
Для использования
с проводником : 0,97 мм

ind.11 20170321

REF CBV35X60/110



LOT 00284486



2017-03

2022-03



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerion
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV35X60/110
LOT 00284486

REF CBV35X60/110
LOT 00284486

REF CBV35X60/110
LOT 00284486

REF CBV35X60/110
LOT 00284486

Рисунок 42. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV35X60/110.



CBV35X60/110



Современные

2


2022-03

LOT: 00284486

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

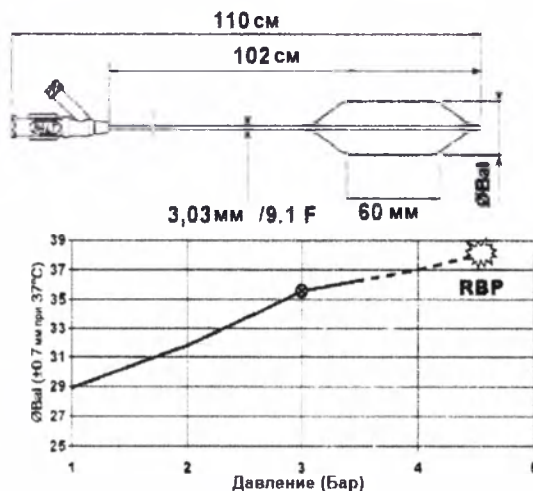

Pression nominale : **300 кПа**
Номинальное
давление: **3 Бар**
44 PSI

Introduceur : **15F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%)
Максимальный
объем баллона **73 мл**

+

Espace mort (±10%)
Мертвое
пространство **3 мл**

A Utiliser avec Guide **0.38"**
Для использования
с проводником : **0.97 мм**

ind.11 20170321



CBV35X60/110

EAN13



LOT 00284486

CODE 128



2017-03



2022-03



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 43. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV35X60/110.

REF CBV40X40/110

2022-12
LOT : 20171232




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Waleuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

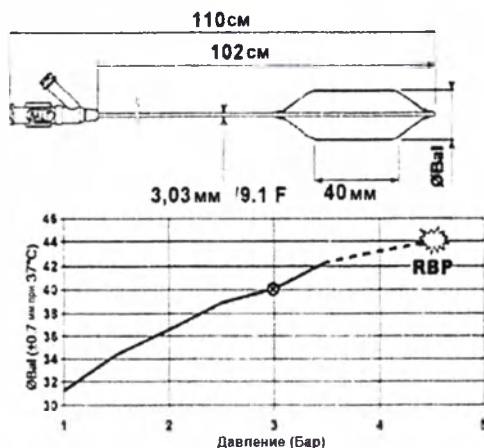

Pression nominale : 300 кПа
Номинальное
давление: 3 Бар
44 PSI

Introducteur : 16F
Интродьюсер:

Volume ballon
Максимальный
объем баллона 68 мл

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 мм

Espace mort
Мертвое
пространство 3 мл

ind.12 20171232

REF CBV40X40/110



LOT 20171232



2017-12

2022-12



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBV40X40/110
LOT 20171232

REF CBV40X40/110
LOT 20171232

REF CBV40X40/110
LOT 20171232

REF CBV40X40/110
LOT 20171232

Рисунок 44. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV40X40/110.

REF CBV40X40/110

2022-12
LOT : 20171232




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

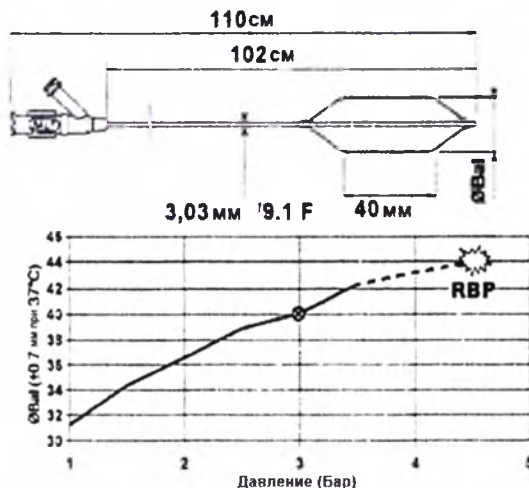

Pression nominale : 300 кПа
Номинальное
давление: 3 Бар
44 PSI

Introducteur : 16F
Интродьюсер: 16F

Volume ballon (+10%) 68 мл
Максимальный
объем баллона (+10%)

+

Espace mort (+10%) 3 мл
Мертвое
пространство (+10%)

A Utiliser avec Guide : .038"
Для использования
с проводником : 0,97 мм

ind.12 20171232

REF CBV40X40/110



LOT 20171232



2017-12



2022-12



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 45. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBV40X40/110.

REF CBVP12X20/70

2022-10

LOT: 00298752




Современные

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateten per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

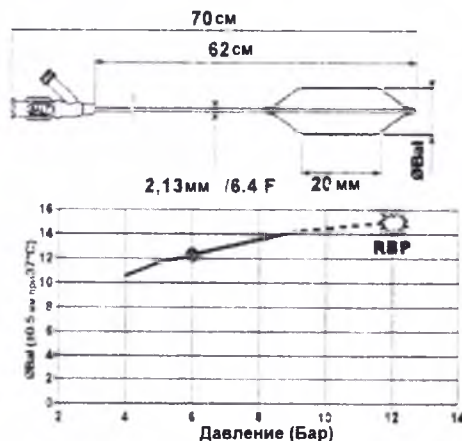

Pression nominale : 600 кПа

Номинимальное

давление: 6 Бар

87 PSI

Introduceur :

Интродьюсер: IVA 7F

Volume ballon (±10%) 4 мл

Максимальный

объем баллона (±10%)

A Utiliser avec Guide : .038"

Для использования

с проводником : 0,89 мм

Espace mort (±10%) 1 мл

Мертвое

пространство (±10%)

ind.11

20171042

CBVP12X20/70

EAN13



LOT

00298752

CODE 128



2017-10



2022-10



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41

Факс: +33 (0)1 34 17 03 46

www.balt.fr

REF CBVP12X20/70

01 337 048 13 2500 17 02 10 28 10 00 298752

LOT 00298752

REF CBVP12X20/70

01 337 048 13 2500 17 02 10 28 10 00 298752

LOT 00298752

REF CBVP12X20/70

01 337 048 13 2500 17 02 10 28 10 00 298752

LOT 00298752

REF CBVP12X20/70

01 337 048 13 2500 17 02 10 28 10 00 298752

LOT 00298752

Рисунок 46. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP12X20/70.

REF CBVP12X20/70

2022-10
LOT: 00298762




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Catetere para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Catetere de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

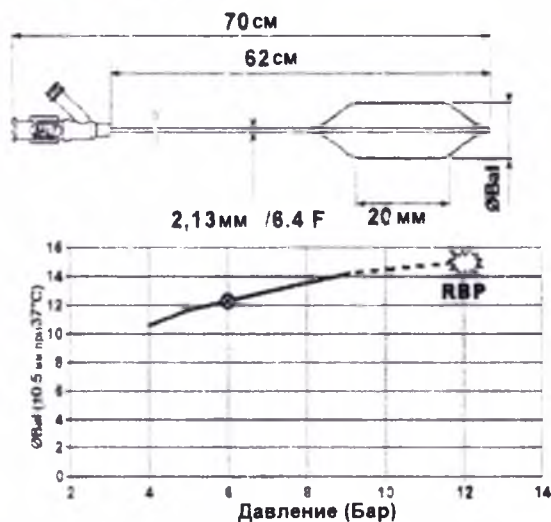

Pression nominale : 600 кПа

Номинальное
давление: 6 Бар

87 PSI

Introduceur : IVA 7F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) 4 мл
Максимальный
объем баллона (±10%)

+

Espace mort (±10%) 1 мл
Мертвое
пространство (±10%)

A Utiliser avec Guide : .035"
Для использования
с проводником : 0.89 мм

ind.11 20171042

REF CBVP12X20/70



LOT 00298752



2017-10

2022-10



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France

Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 47. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP12X20/70.

REF CBVP15X25/70

2023-01
LOT : 00305709




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

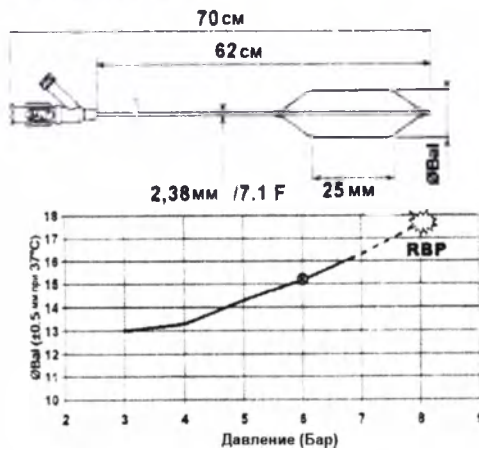

Pression nominale : 600 кПа
Номинальное
давление: 6 Бар
87 PSI

Introduceur : IVA 8F
Интродьюсер: IVA 8F

Volume ballon (±10%)
Максимальный
объем баллона: 8 мл

A Utiliser avec Guide : .036"
Для использования
с проводником: 0,89 мм

Espace mort (±10%)
Мертвое
пространство: 2 мл

ind.11 20180132

REF CBVP15X25/70



LOT 00305709



2018-01

2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tél.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBVP16X26/70
LOT 00306709

REF CBVP16X26/70
LOT 00306709

REF CBVP16X26/70
LOT 00306709

REF CBVP16X26/70
LOT 00306709

Рисунок 48. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP15X25/70.

REF CBVP15X25/70

2023-01
LOT : 00305709




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

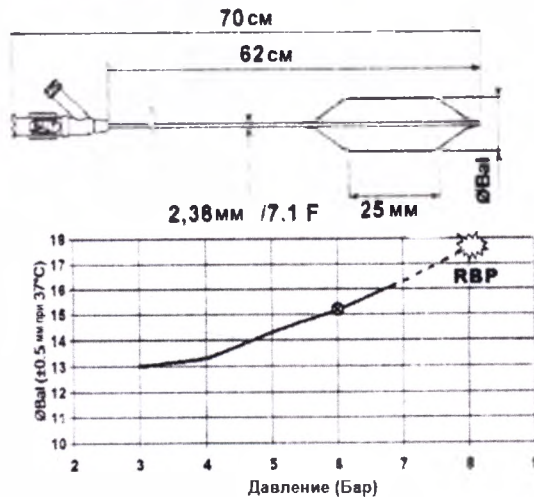

Pression nominale : 600 кПа
Номинальное
давление: 6 Бар
87 PSI

introducateur : IVA 8F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : 8 мл
Максимальный
объем баллона (±10%)
Espace mort (±10%) : 2 мл
Мертвое
пространство (±10%)

A Utiliser avec Guide : .035"
Для использования
с проводником : 0,89 мм

ind.11 20180132

REF CBVP15X25/70

EA N°13



LOT 00305709

CODE 128



2018-01



2023-01



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerion
95180 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 49. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP15X25/70.

REF CBVP8X20/70

2023-01
LOT: 00307066


Сомержение

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

**CRISTAL
BALLOON**

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Catheters for
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cateteri do
Valvuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

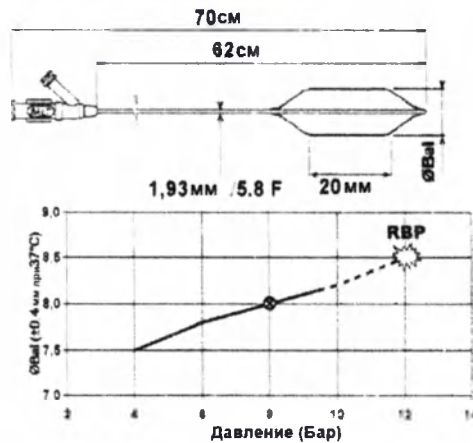

Pression nominale : **800 кПа**
Номинальное
давление: **8 Бар**
116 PSI

Introduceur : **IVA 6F**
Интродьюсер:

Volume ballon $\pm 10\%$ **2 мл**
Максимальный
объем баллона $\pm 10\%$

+

Espace mort $\pm 10\%$ **1 мл**
Мертвое
пространство $\pm 10\%$

A Utiliser avec Guide : **.035"**
Для использования
с проводником: **0,89 мм**

Ind. 11 **20180152**

REF CBVP8X20/70

EAN13



LOT 00307066

CODE 128



(01)03700481312840(17)0301281100307066



2018-01



2023-01



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tel: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBVP8X20/70
LOT 00307066

REF CBVP8X20/70
LOT 00307066

REF CBVP8X20/70
LOT 00307066

REF CBVP8X20/70
LOT 00307066

Рисунок 50. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP8X20/70.

52

REF CBVP8X20/70

2023-01
LOT : 00307066




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateter per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cateter do
Valvuloplasty / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

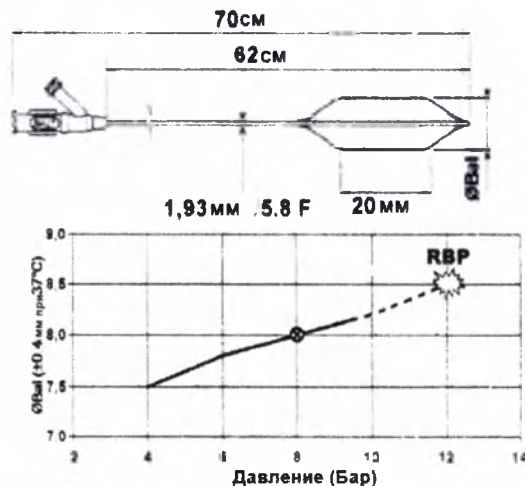

Pression nominale : 800 кПа
Номинальное
давление: 8 Бар
116 PSI

Introduceur : IVA 6F
Интродьюсер: IVA 6F

Volume ballon (±10%) 2 мл
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%) 1 мл
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide .035"
Для использования
с проводником: 0,89 мм

Ind.11 20180152

REF CBVP8X20/70



LOT 00307066



2018-01



2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vigneron
95160 Montmorency
France
Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 51. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP8X20/70.

REF CBVP10X20/70

2023-01
LOT: 00306696




Содержание

1

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateters para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastia /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

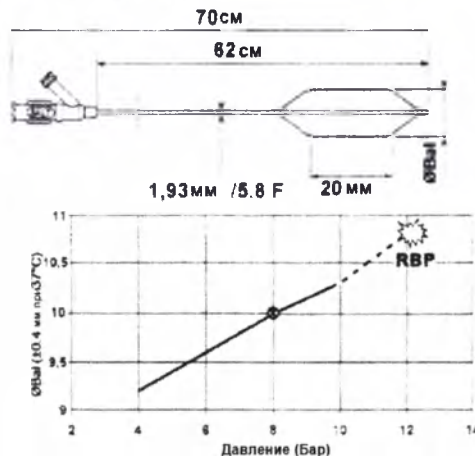

Pression nominale : 800 кПа
Номинальное
давление: 8 Бар
(116 PSI)

Introducteur : JVA 6F
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) 3 мл
Максимальный
объем баллона (±10%)

A utiliser avec Guide : .035"
Для использования
с проводником 0,89 мм

Espace mort (±10%) 1 мл
Мертвое
пространство (±10%)

ind.11 20180141

REF CBVP10X20/70



LOT 00306696



2018-01



2023-01



Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerot
95160 Montmorency
France

Tel.: +33 (0)1 39 89 46 41
Fax: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

REF CBVP10X20/70
LOT 00306696

REF CBVP10X20/70
LOT 00306696

REF CBVP10X20/70
LOT 00306696

REF CBVP10X20/70
LOT 00306696

Рисунок 52. Макет Российской маркировки финишной упаковки для стерилизации МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP10X20/70.

REF CBVP10X20/70

2023-01
LOT : 00306696




Содержание

2

Баллонные катетеры CRISTAL
для периферической ангиопластики и вальвулопластики,
стерильные, одноразового применения, в вариантах исполнения

CRISTAL
BALLOON

Catheters de valvuloplastie / Valvuloplasty catheters /
Cateteres para valvuloplastia / Katheter für
Valvuloplastie / Cateteri per valvuloplastica /
Cateteres de valvuloplastia / Cewniki do
Walwuloplastyki / Баллонные катетеры для
вальвулопластики

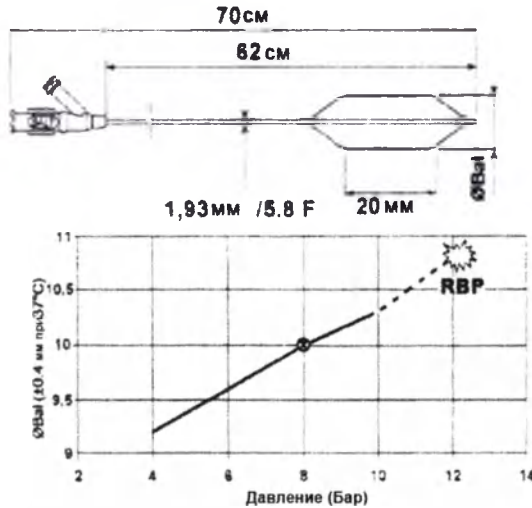

Pression nominale : **800 кПа**
Номинальное
давление: **8 Бар**
(116 PSI)

Introduceur : **JVA 6F**
Интродьюсер:

Volume ballon (±10%) : **5 мл**
Максимальный
объем баллона
+
Espace mort (±10%) : **1 мл**
Мертвое
пространство

A Utiliser avec Guide : **.036"**
Для использования
с проводником : **0,89 мм**

ind.11 20180141

REF CBVP10X20/70



LOT 00306696



2018-01

2023-01



STERILE EO



Не токсично

Balt Extrusion
10, rue de la Croix-Vignerons
95160 Montmorency
France
Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41
Факс: +33 (0)1 34 17 03 46
www.balt.fr

Рисунок 53. Макет Российской маркировки Картонной упаковки МИ: Баллонные катетеры CRISTAL для периферической ангиопластики и вальвулопластики, стерильные, одноразового применения, вариант исполнения CBVP10X20/70.

Сшито и заверено печатью 54

(Подпись) лист а
Сыре

Генеральный директор
Морозов В.В.

[Handwritten signature]

