

Фотографические изображения  
медицинского изделия

***Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический SonoSite EDGE II с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС»,

Кеничи Танака





**Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический**

**SonoSite EDGE II с принадлежностями**

Номер по каталогу : P01234-56\*



Серийный номер : MW98WM\*



Использовать только с блоком питания

Номер по каталогу : P09823\*



(дата производства)

Производитель :

FUJIFILM SonoSite, Inc. (ФУДЖИФИЛЬМ СоноСайт, Инк.)

21919 30th Drive SE, Bothell, Washington, 98021, США

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС»,  
РФ, 123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом 5А, этаж 4,

Тел. 8 (495) 797-35-12, Факс: 8 (495) 797-35-13,

e-mail: [ffru\\_info@fujifilm.com](mailto:ffru_info@fujifilm.com)

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_




\*номера изделия могут быть изменены по усмотрению производителя.





1. Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический SonoSite EDGE II, в составе: Аппарат ультразвуковой. Датчик ультразвуковой линейный, исполнения HFL38xi.



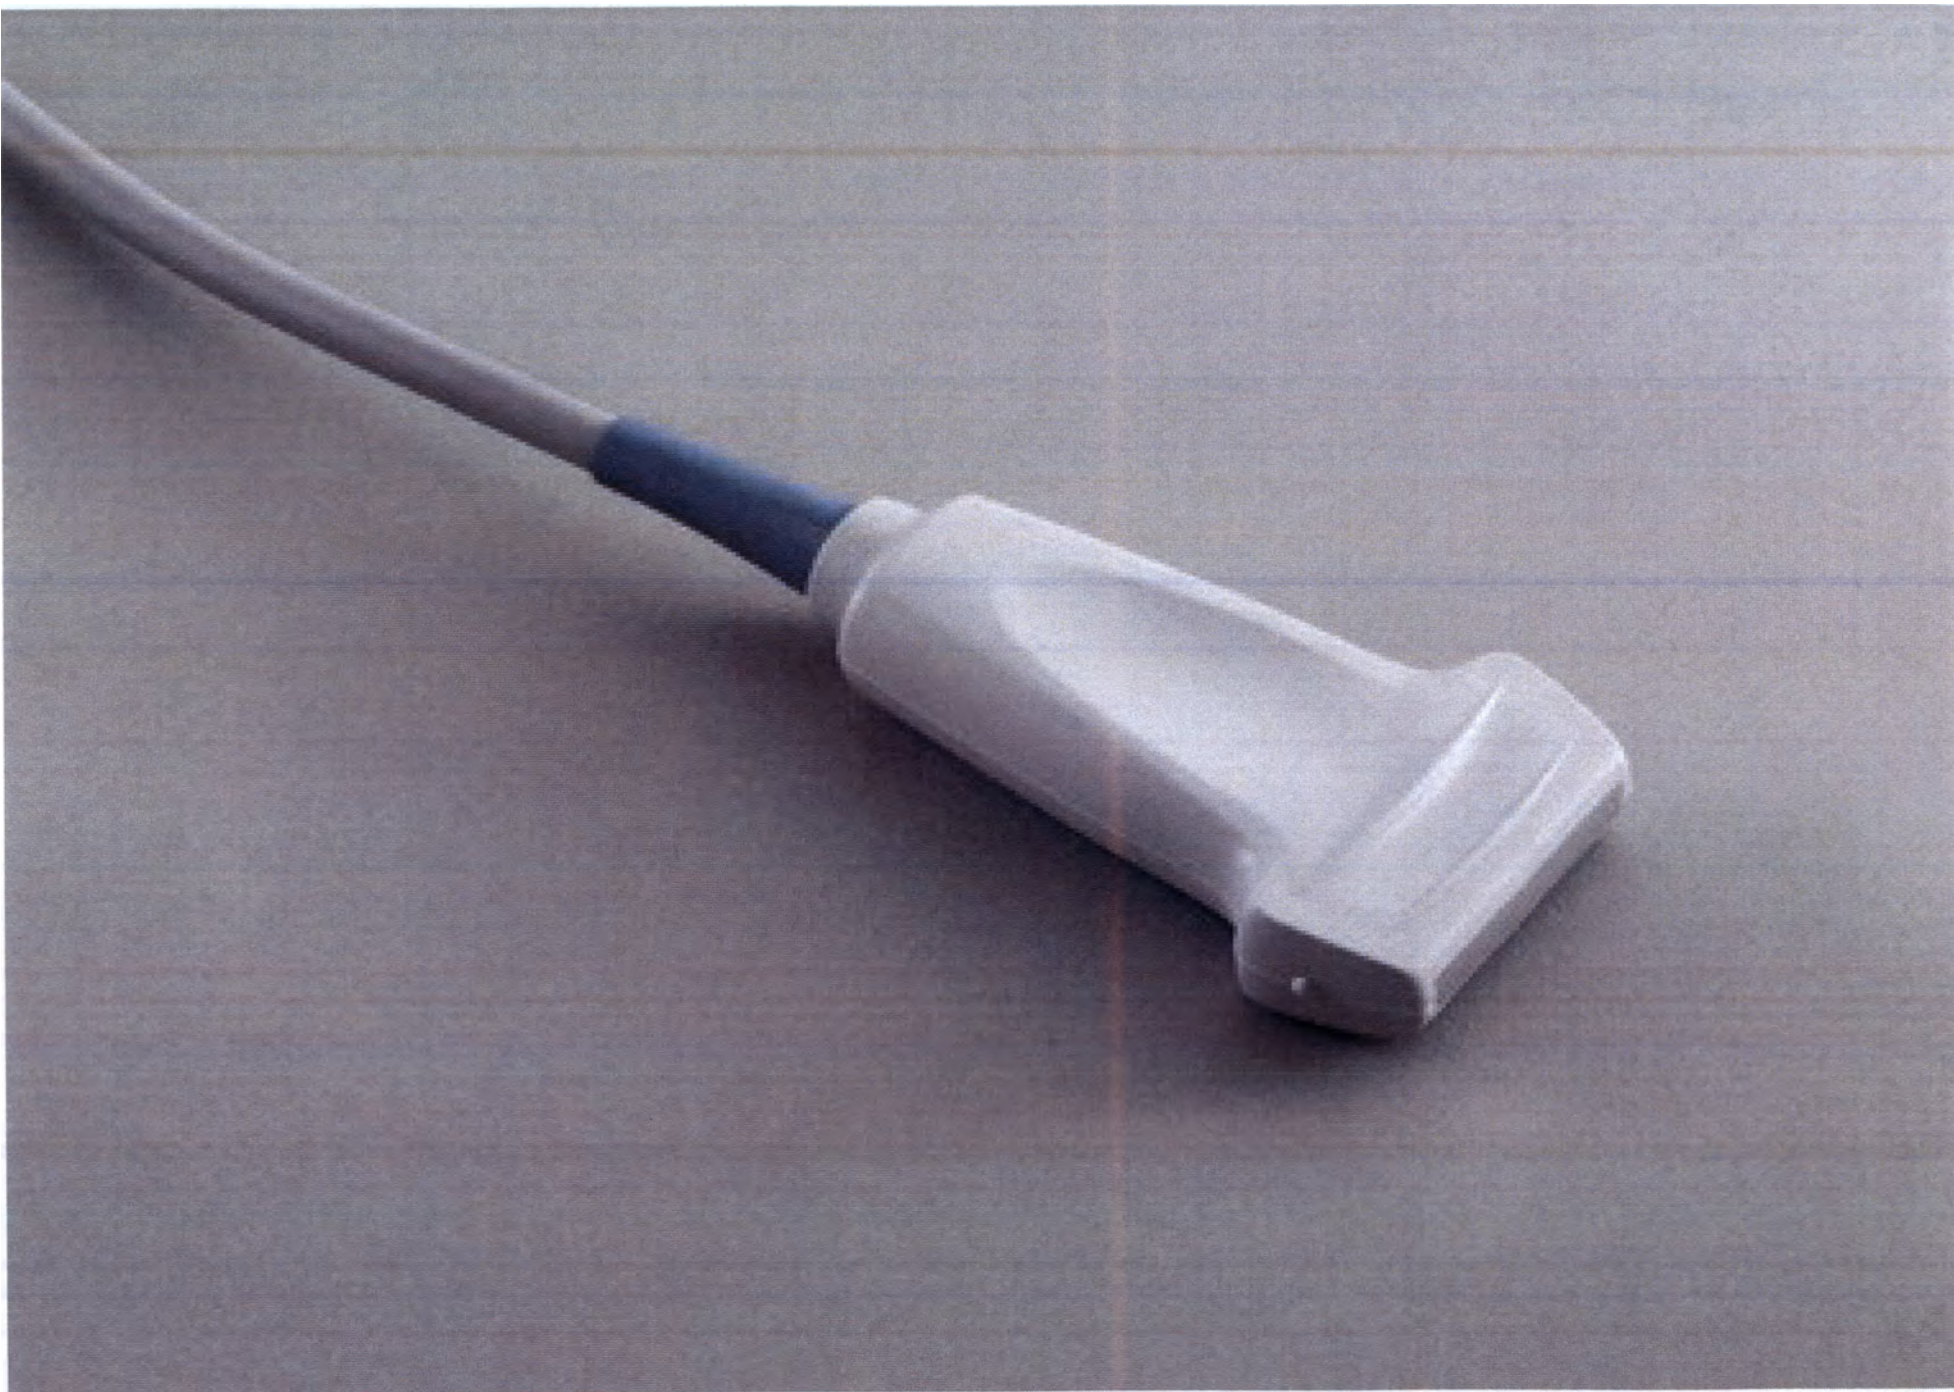

I. Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический SonoSite EDGE II, в составе: Аппарат ультразвуковой. Датчик ультразвуковой линейный, исполнения HFL38x.





I. Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический SonoSite EDGE II, в составе: Кабель питания.









I. Аппарат медицинский ультразвуковой диагностический SonoSite EDGE II, в составе: Блок питания.



**FUJIFILM**  
Values from Innovation


# SonoSite EDGE II

Аппарат медицинский ультразвуковой  
диагностический




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



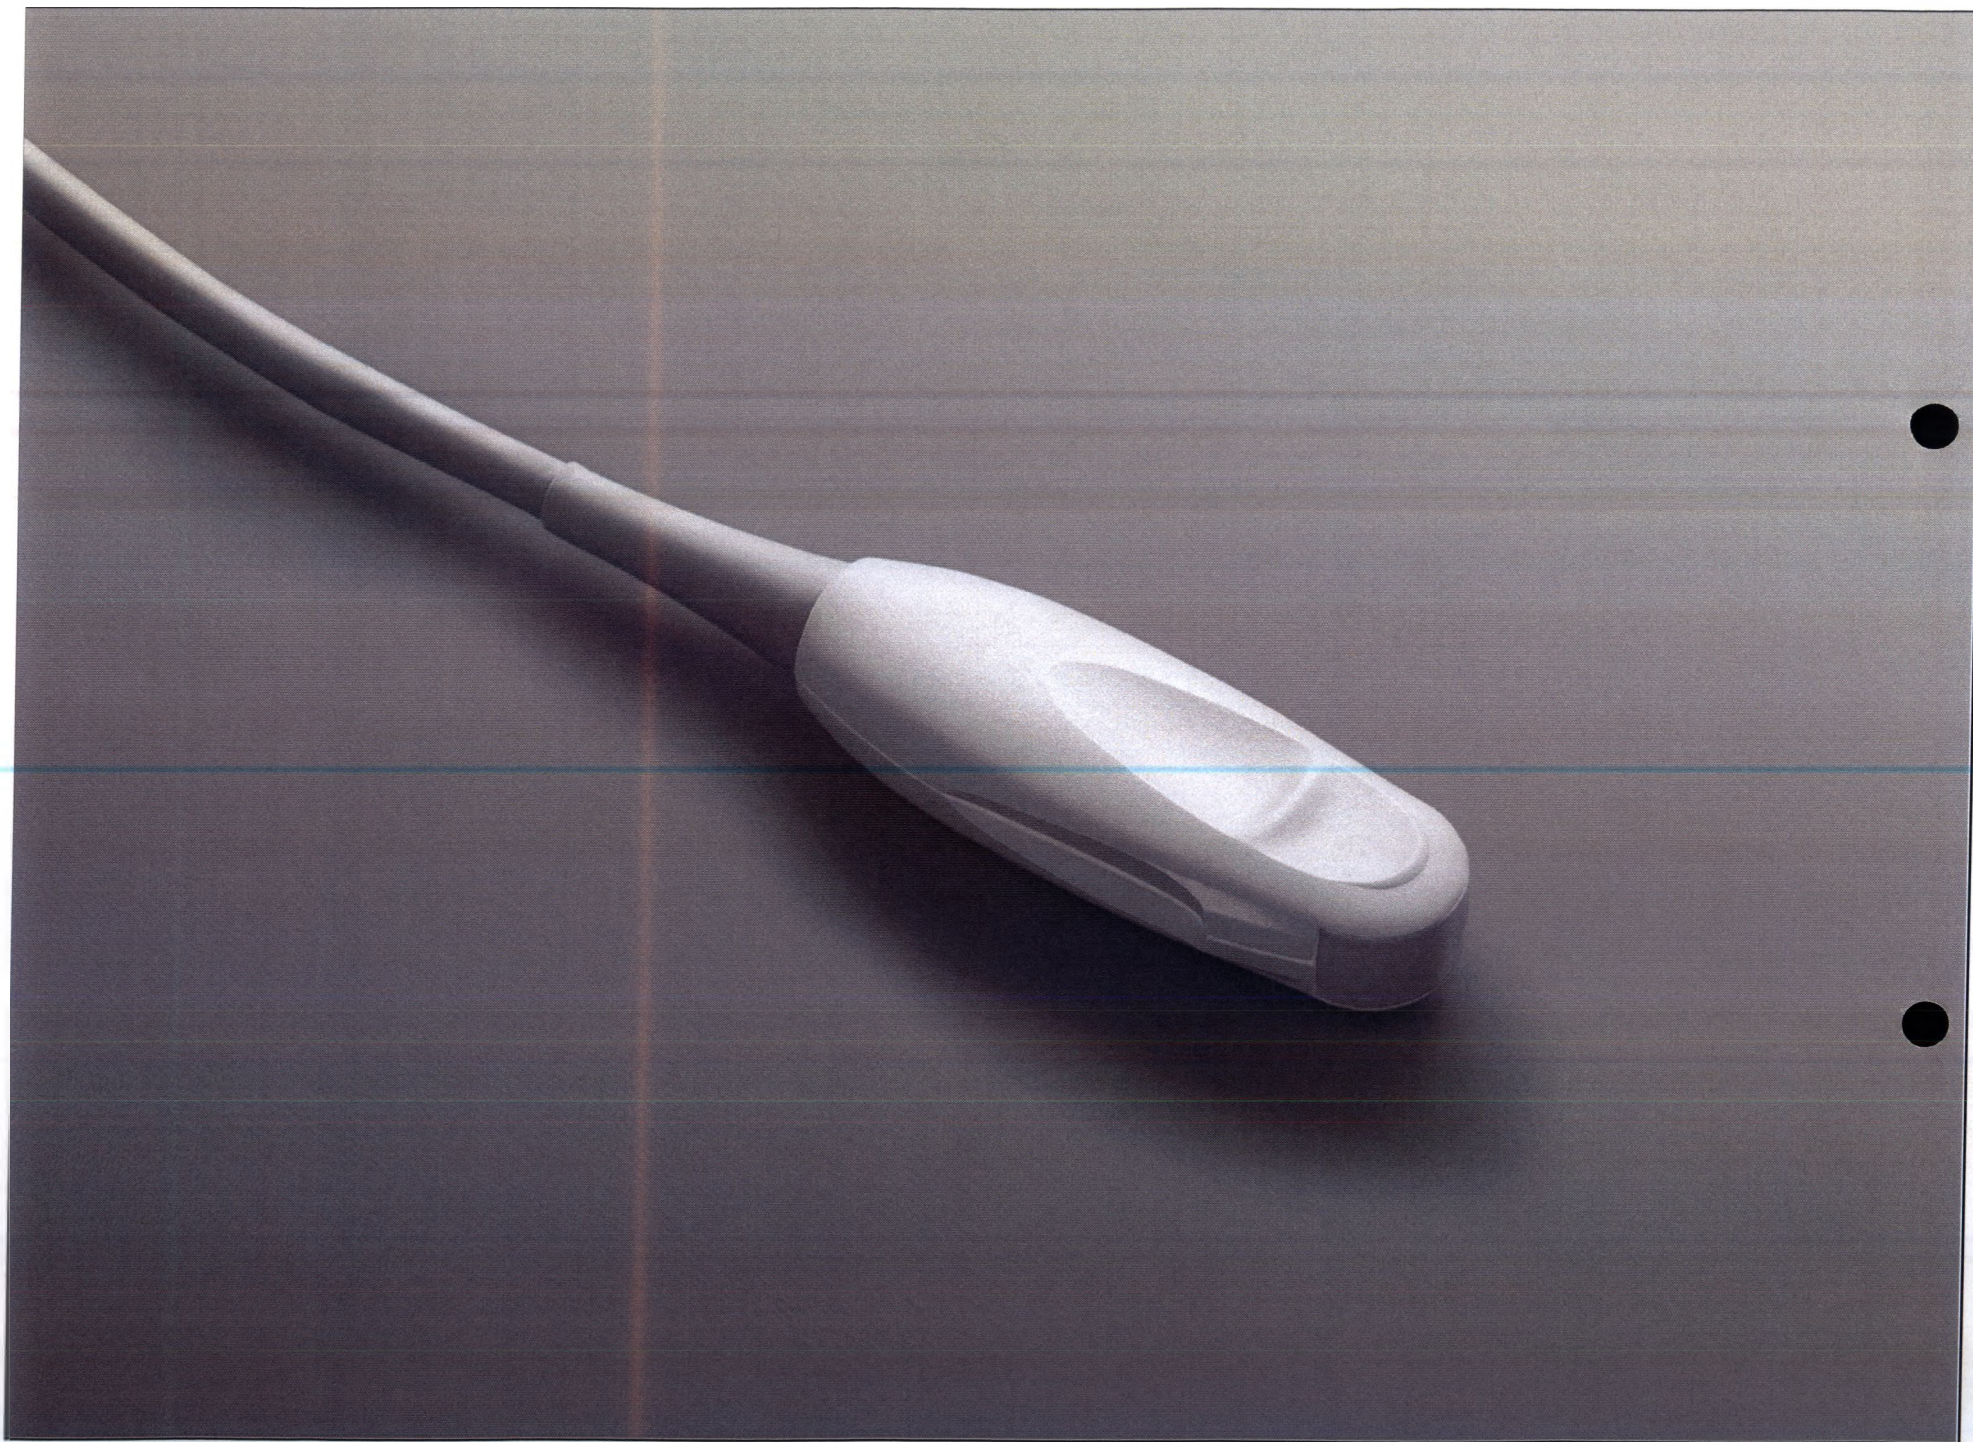


II. Принадлежности: 1. Датчик ультразвуковой микроконвексный С11х.



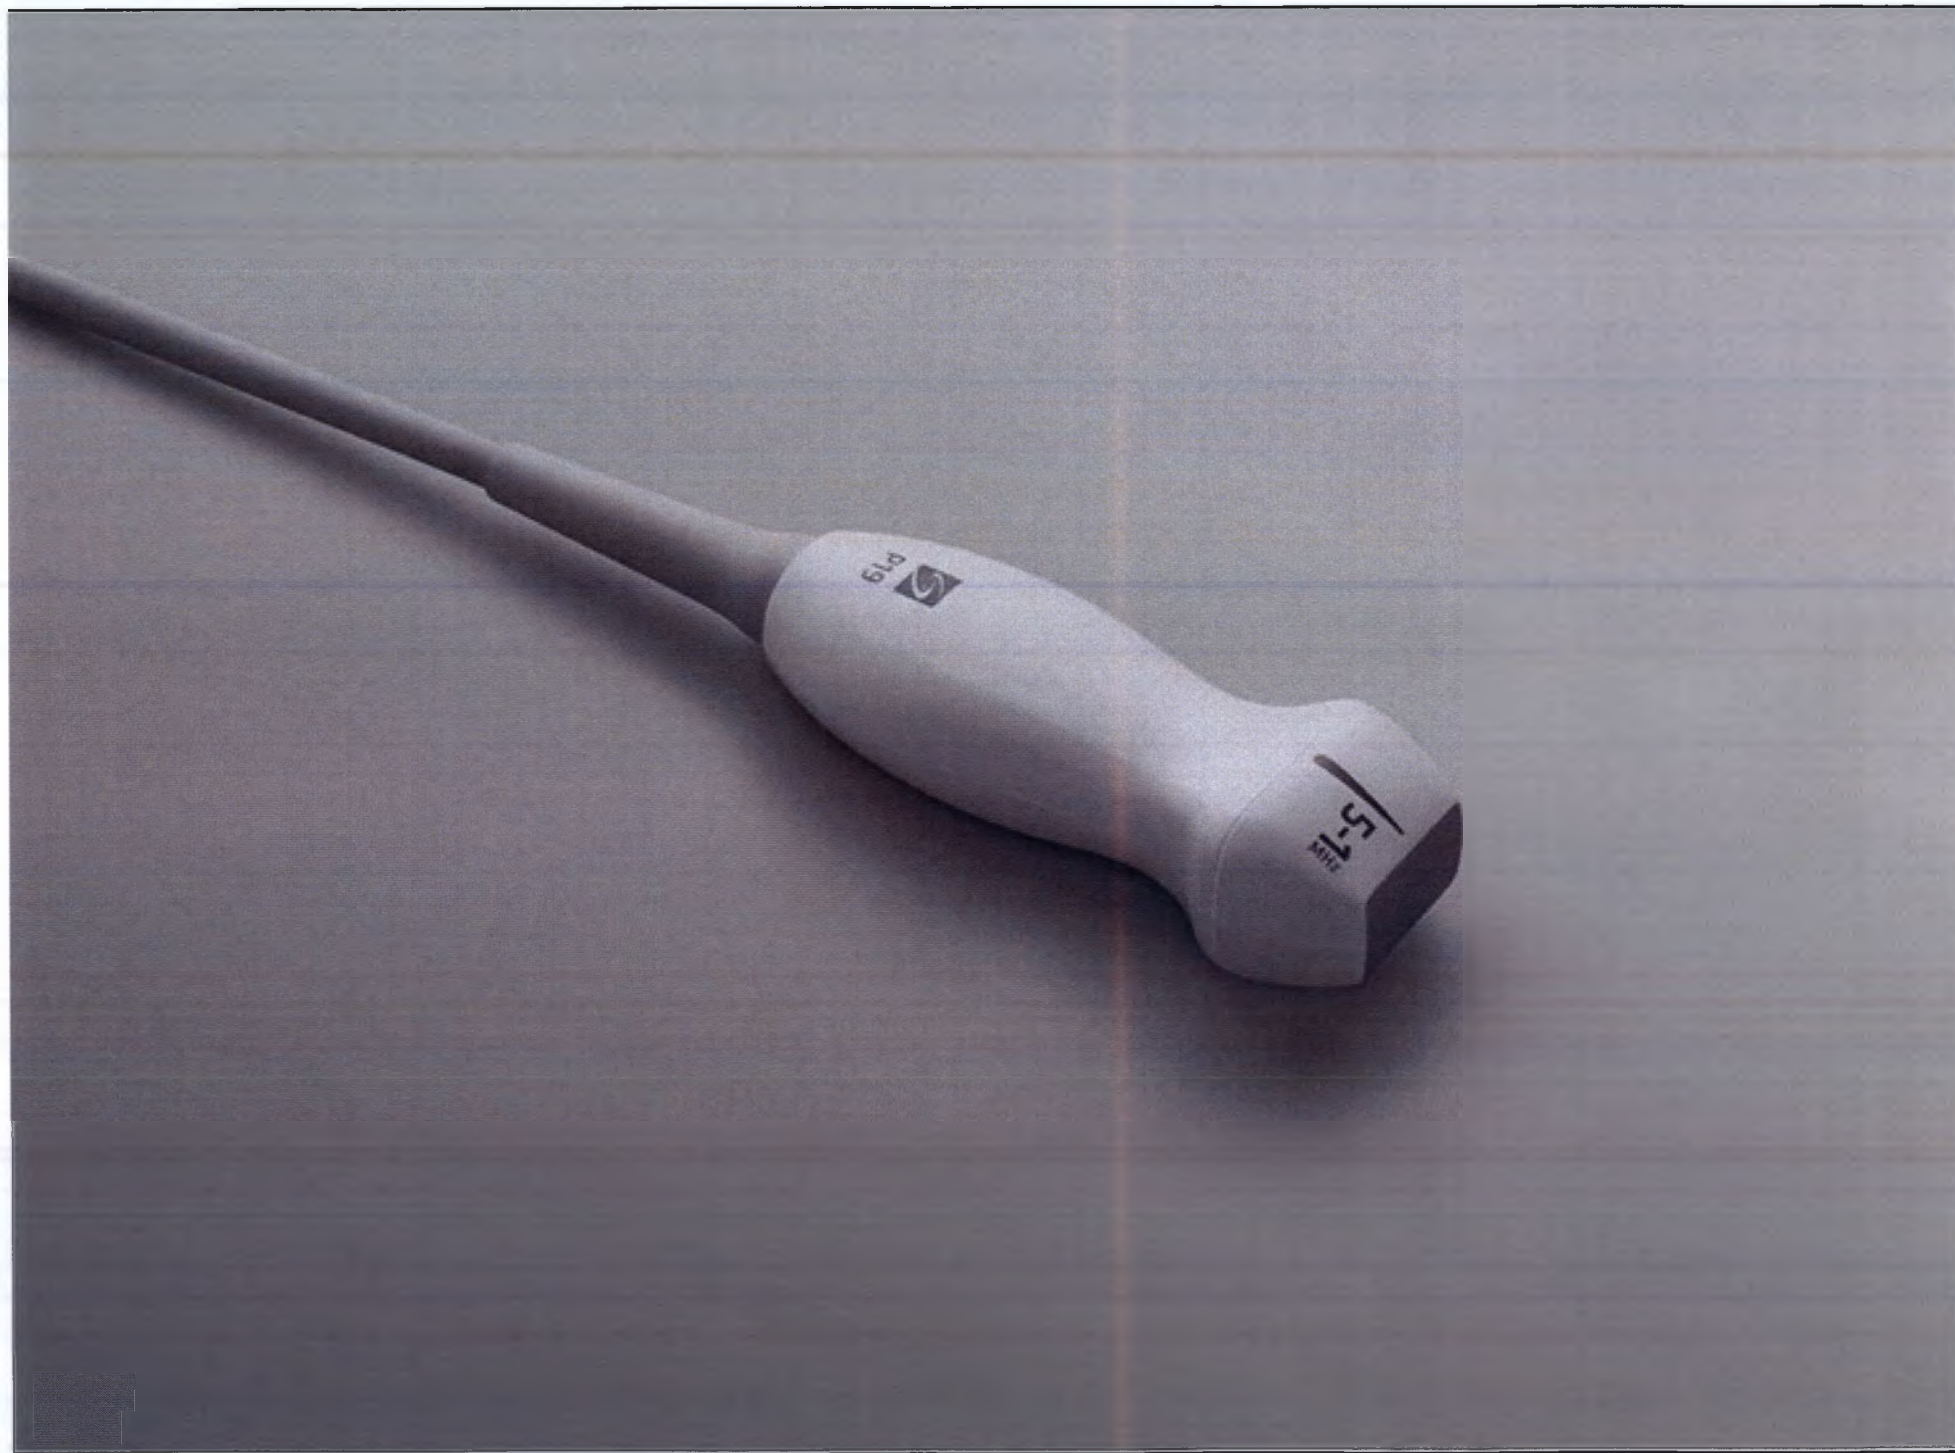




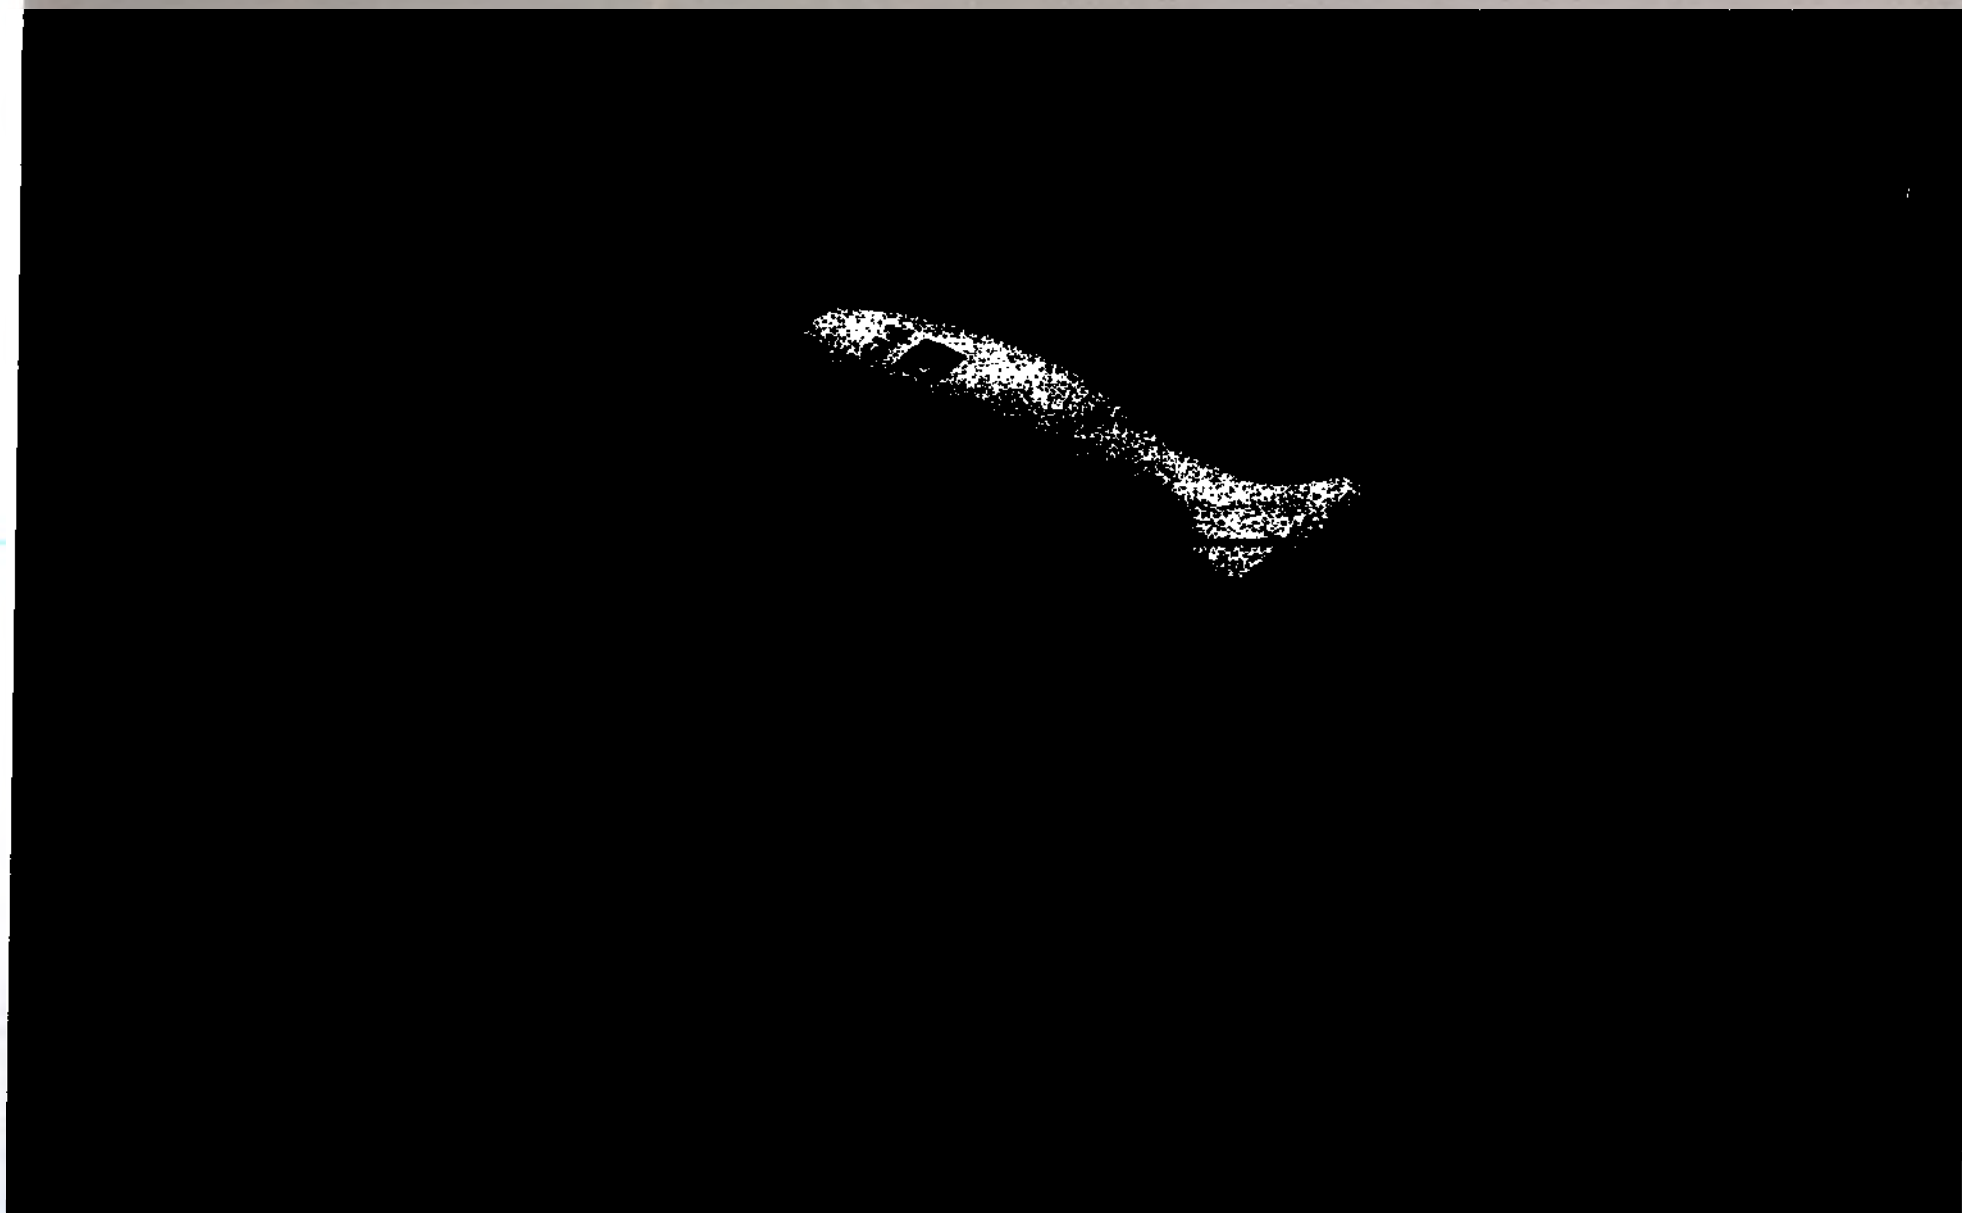

3. Датчик ультразвуковой фазированный гР19х с защищенным кабелем.



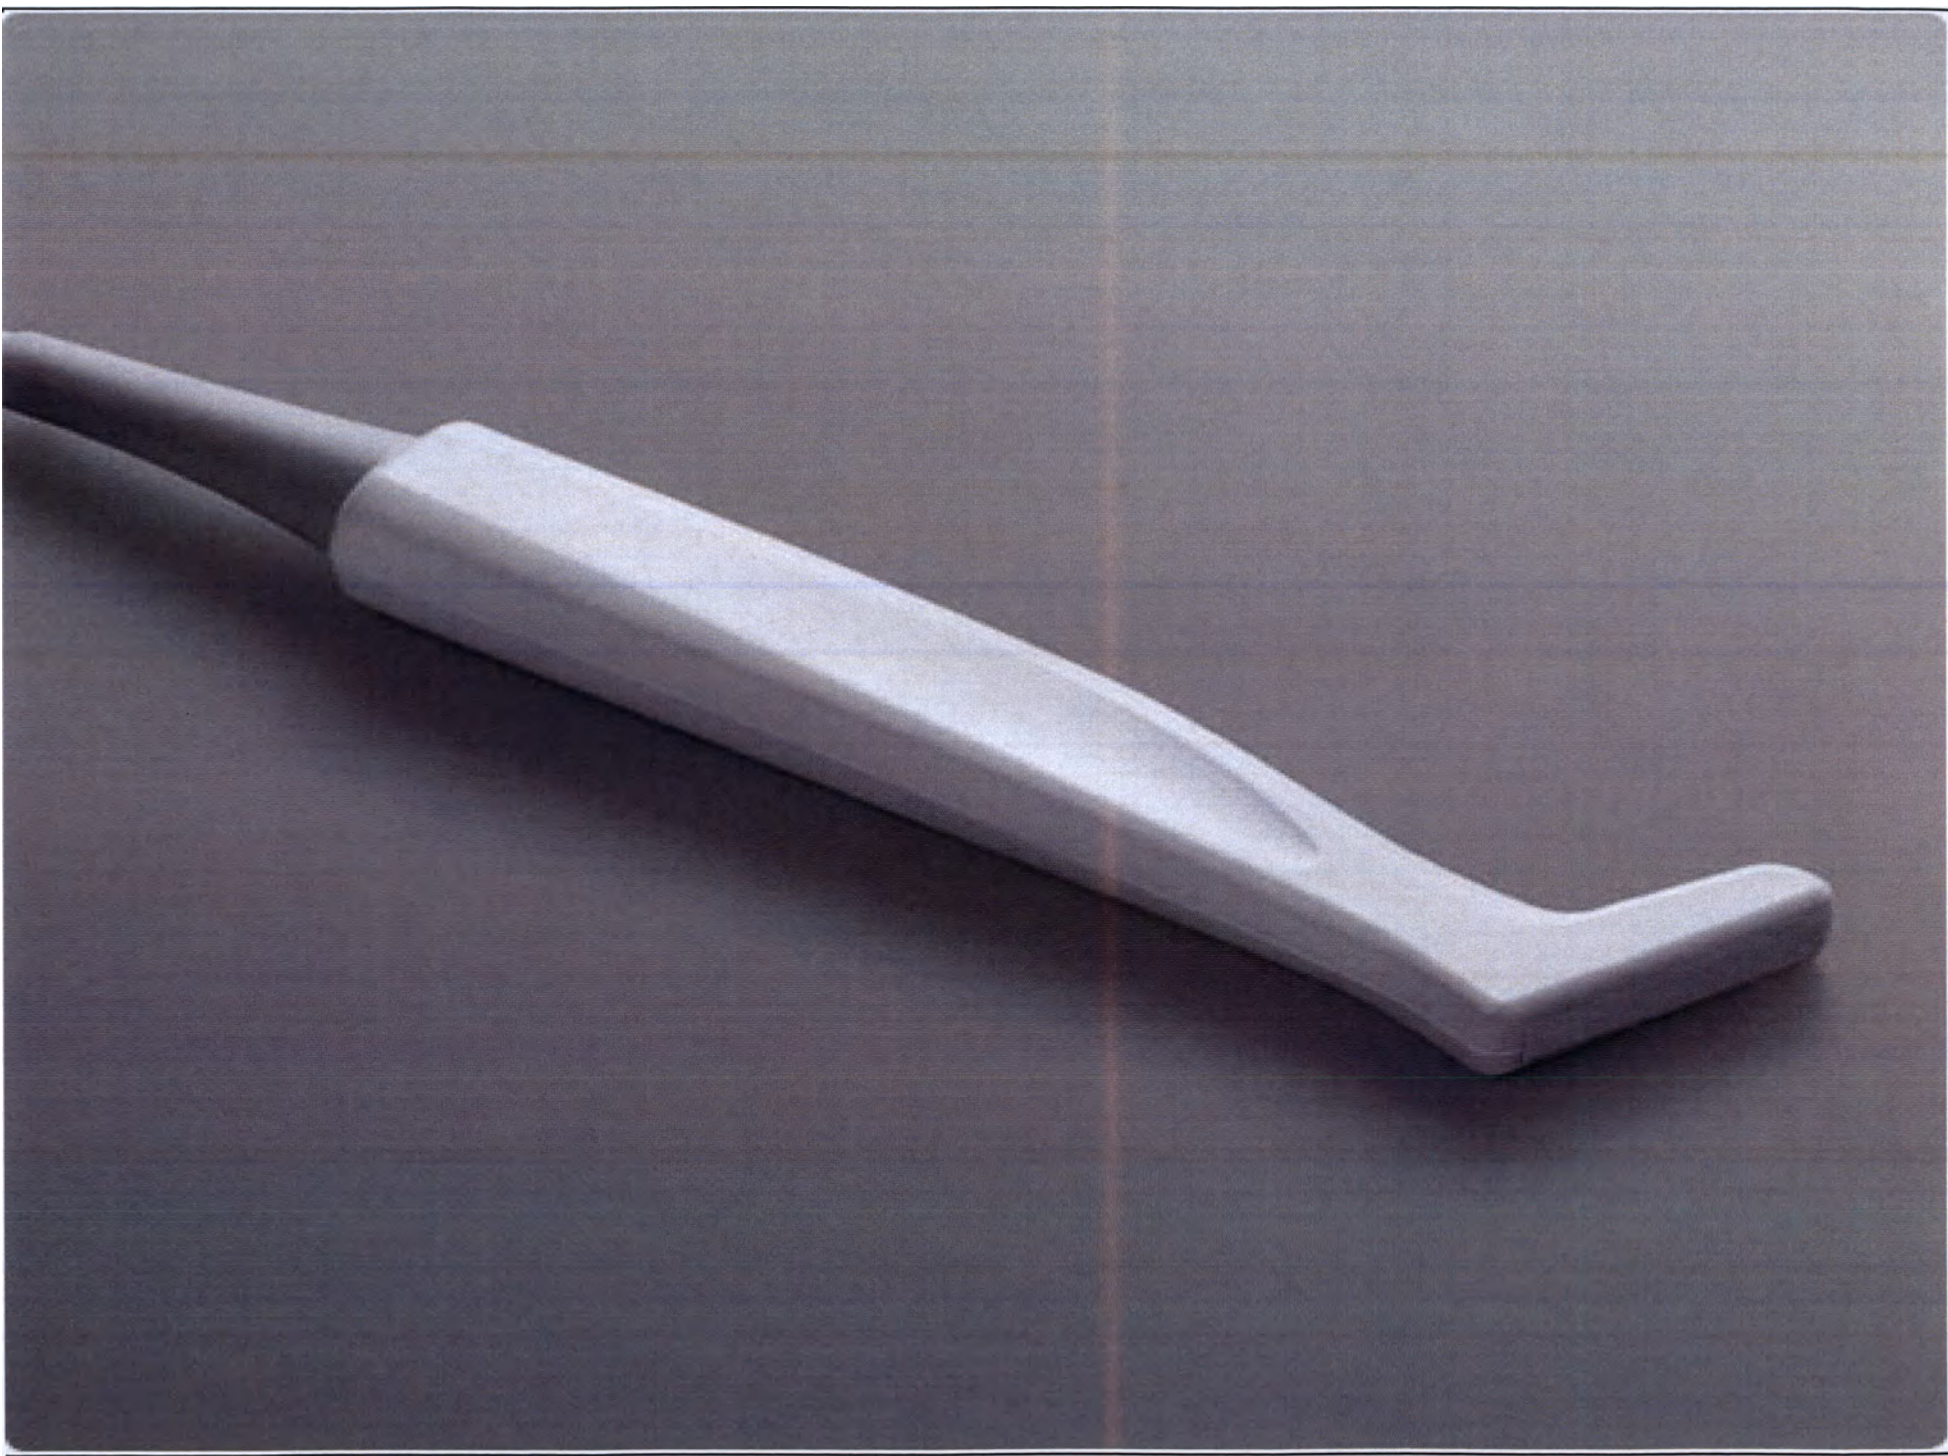






5. Датчик ультразвуковой линейный L52х.







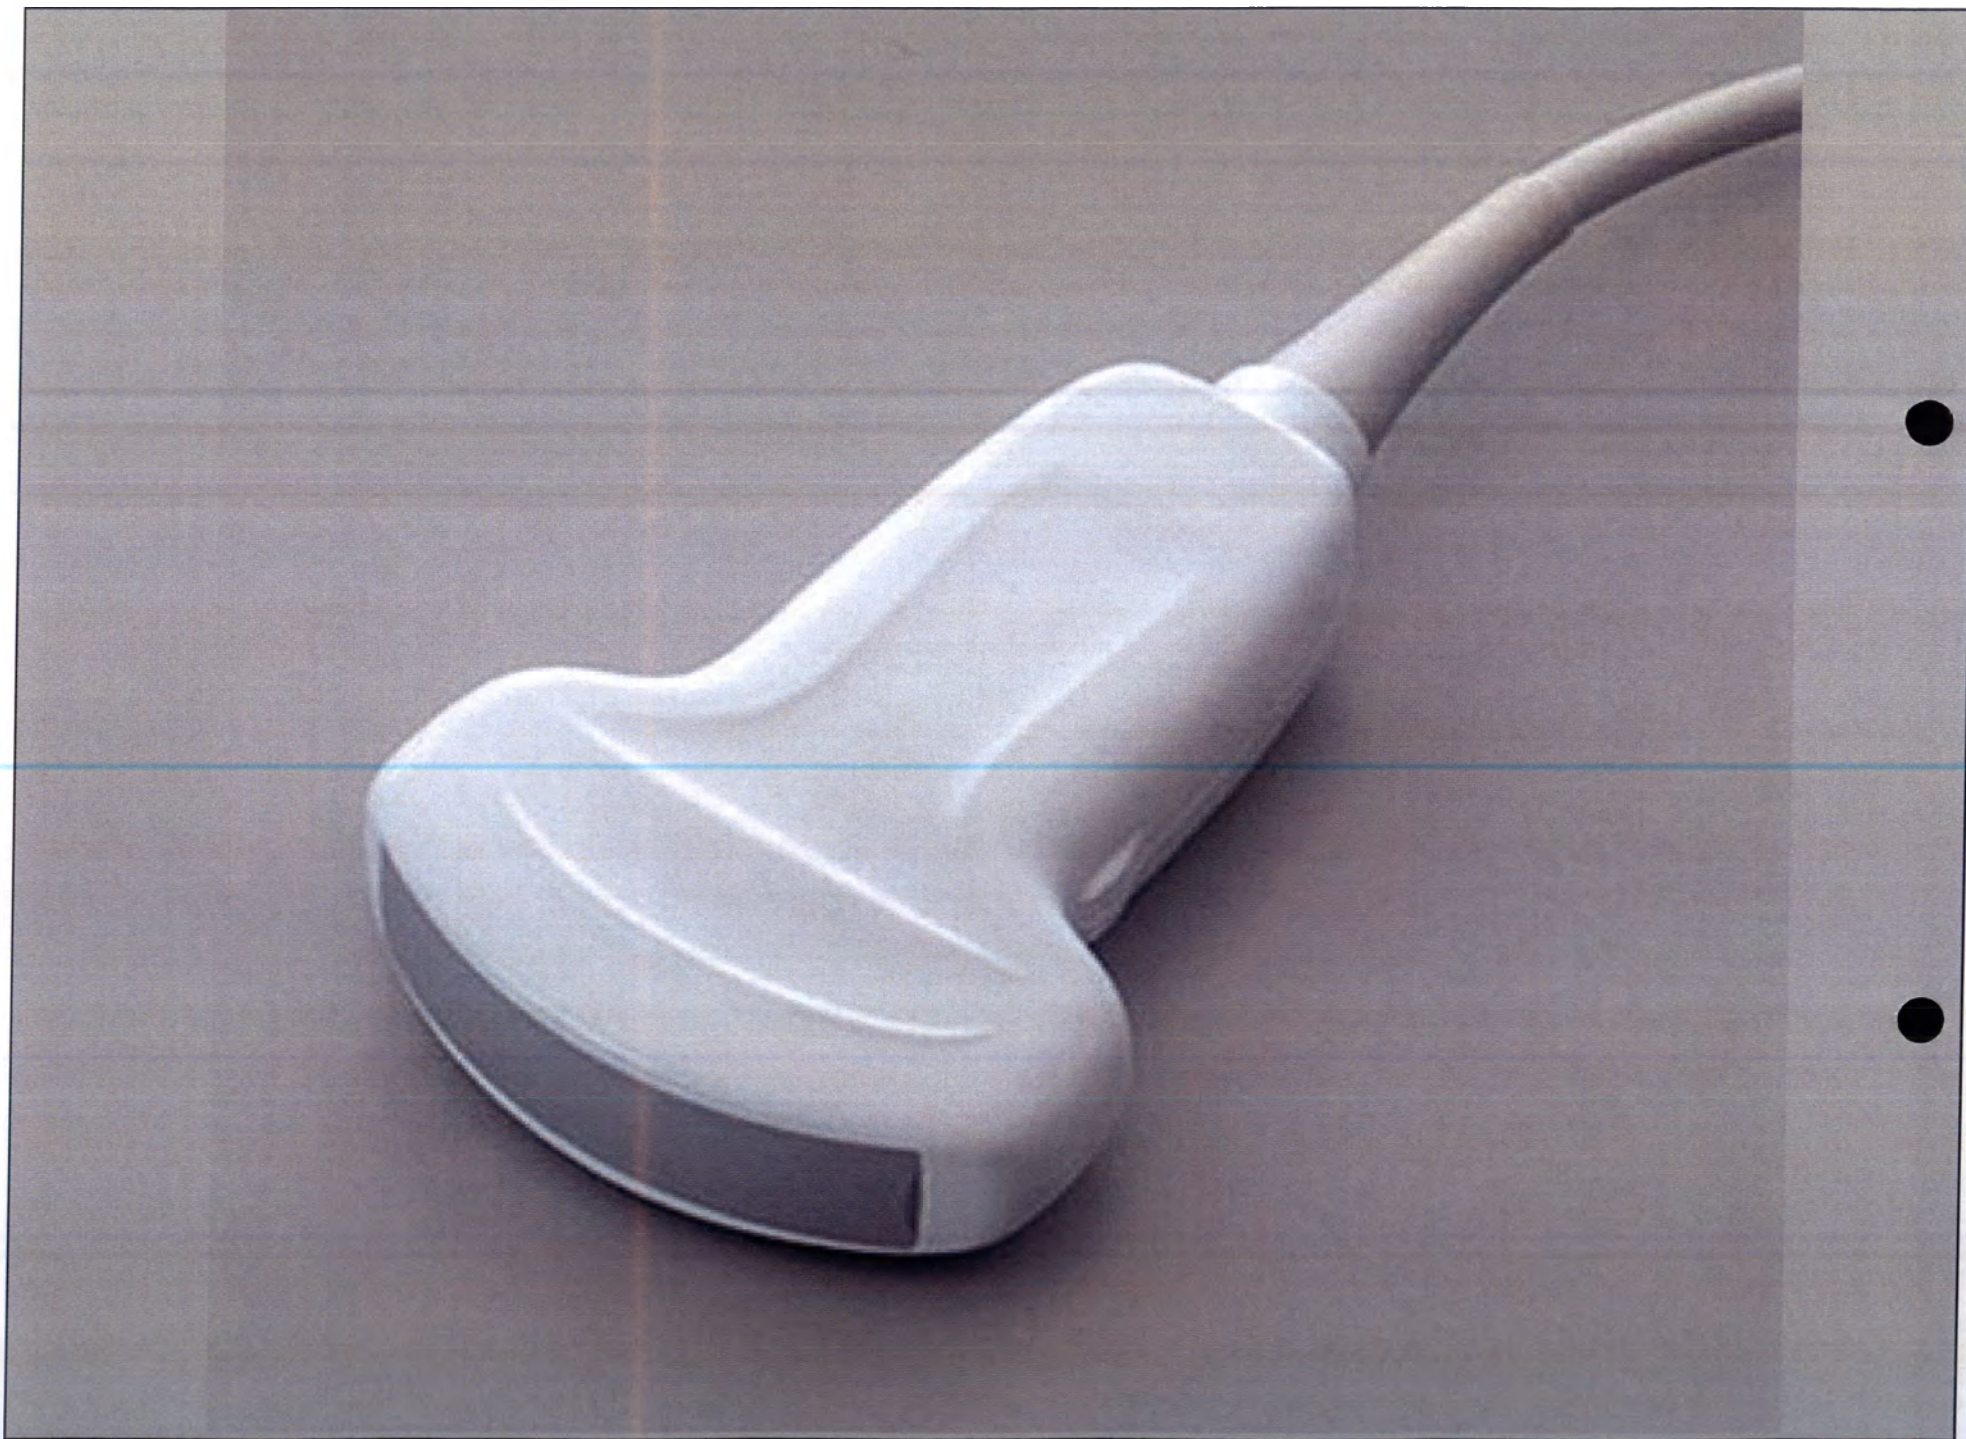


7. Датчик ультразвуковой конвексный С60х.








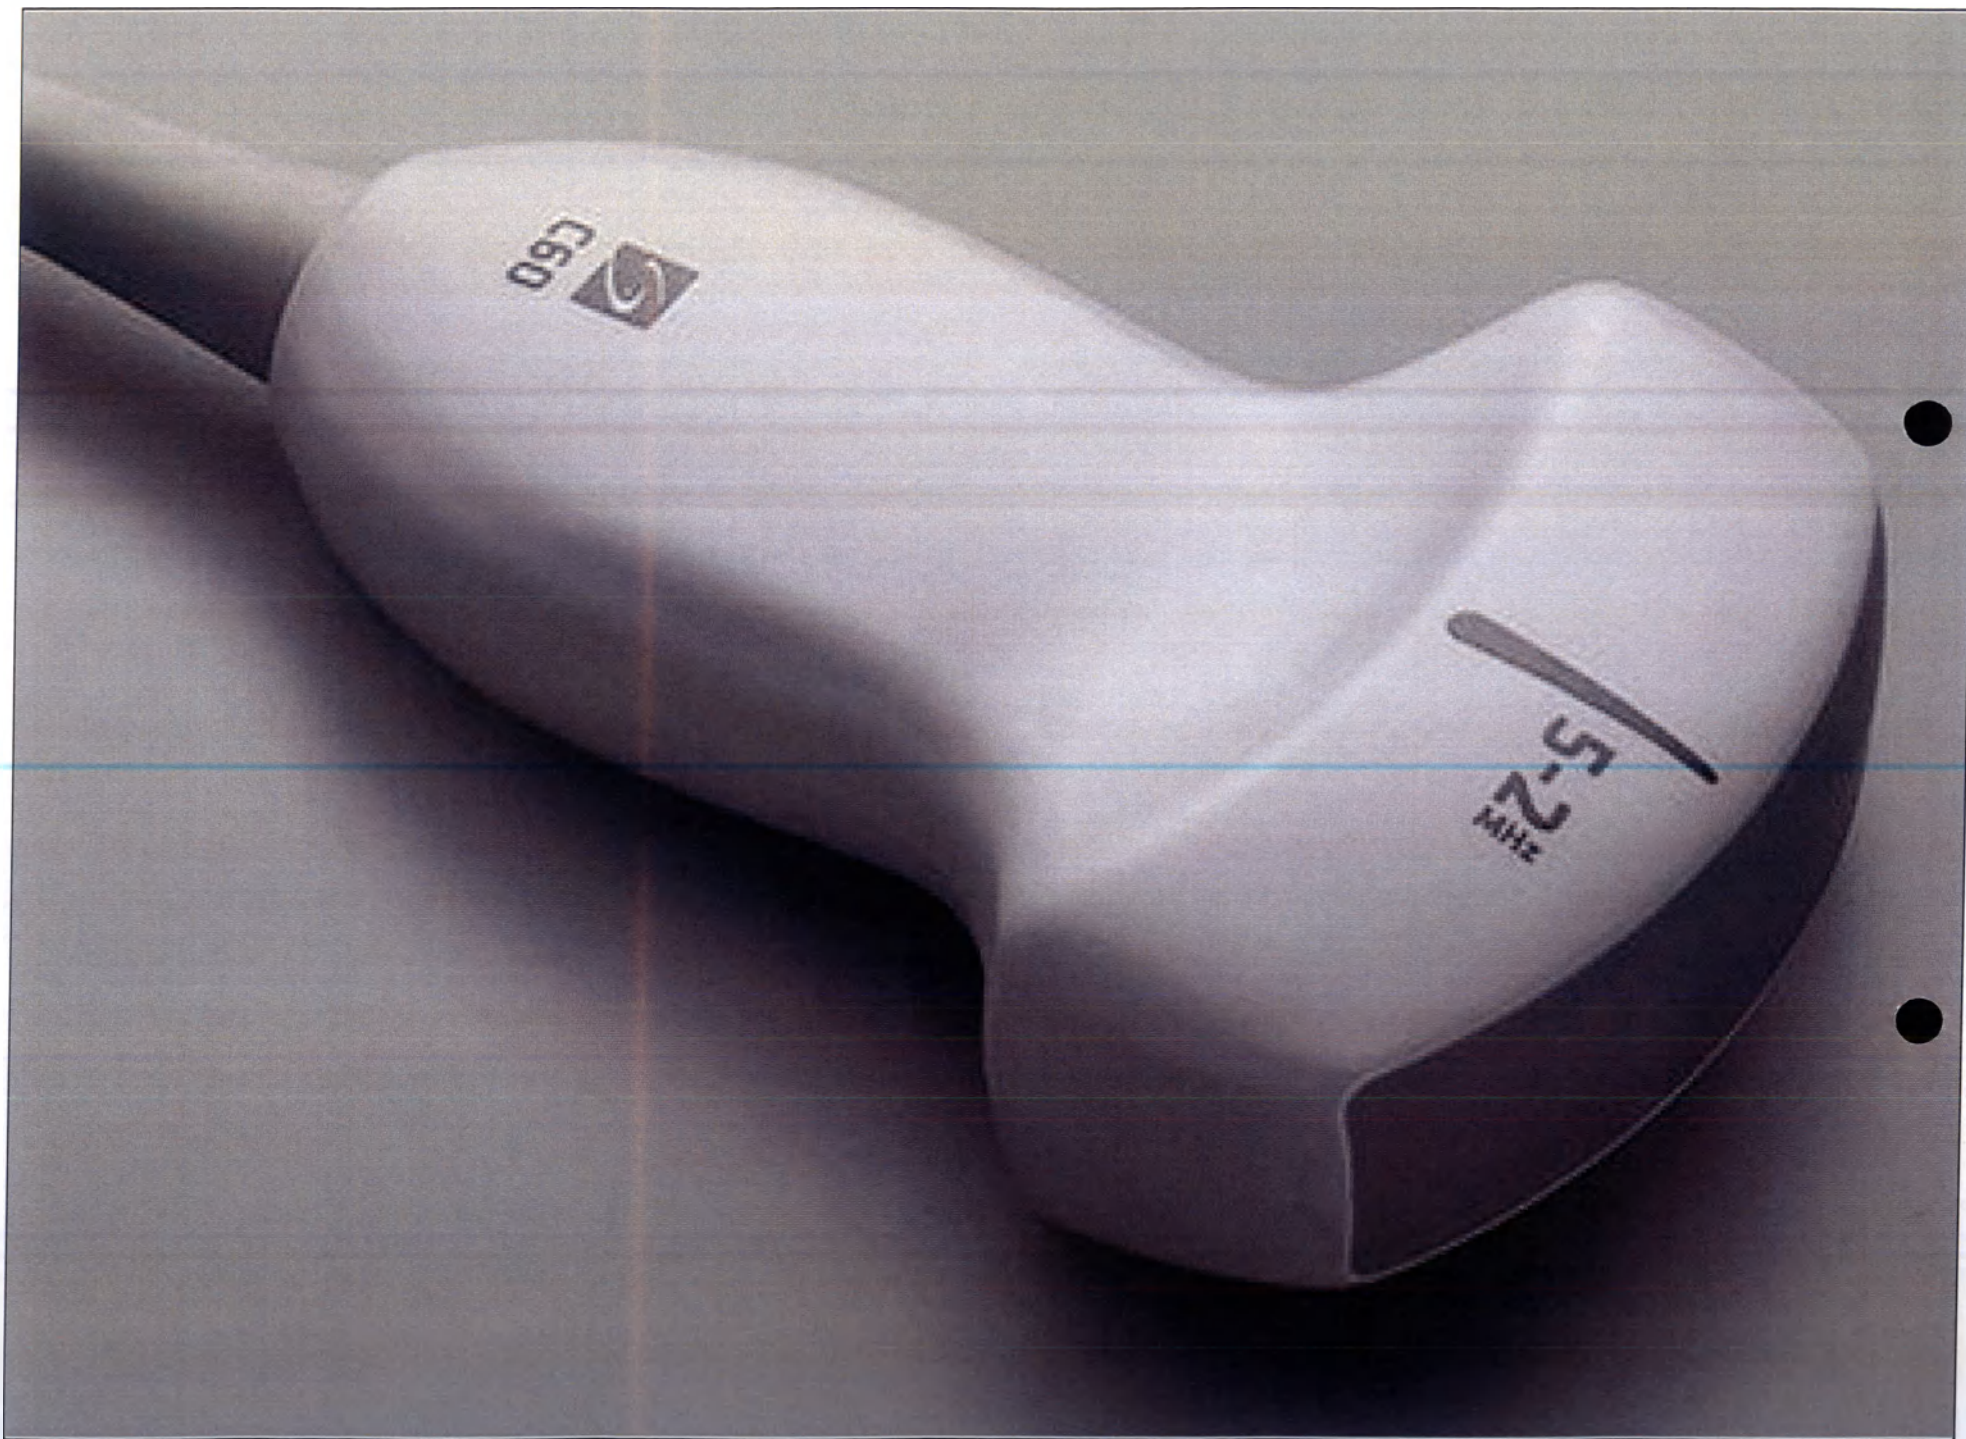


9. Датчик ультразвуковой конвексный rC60xi с защищенным кабелем.



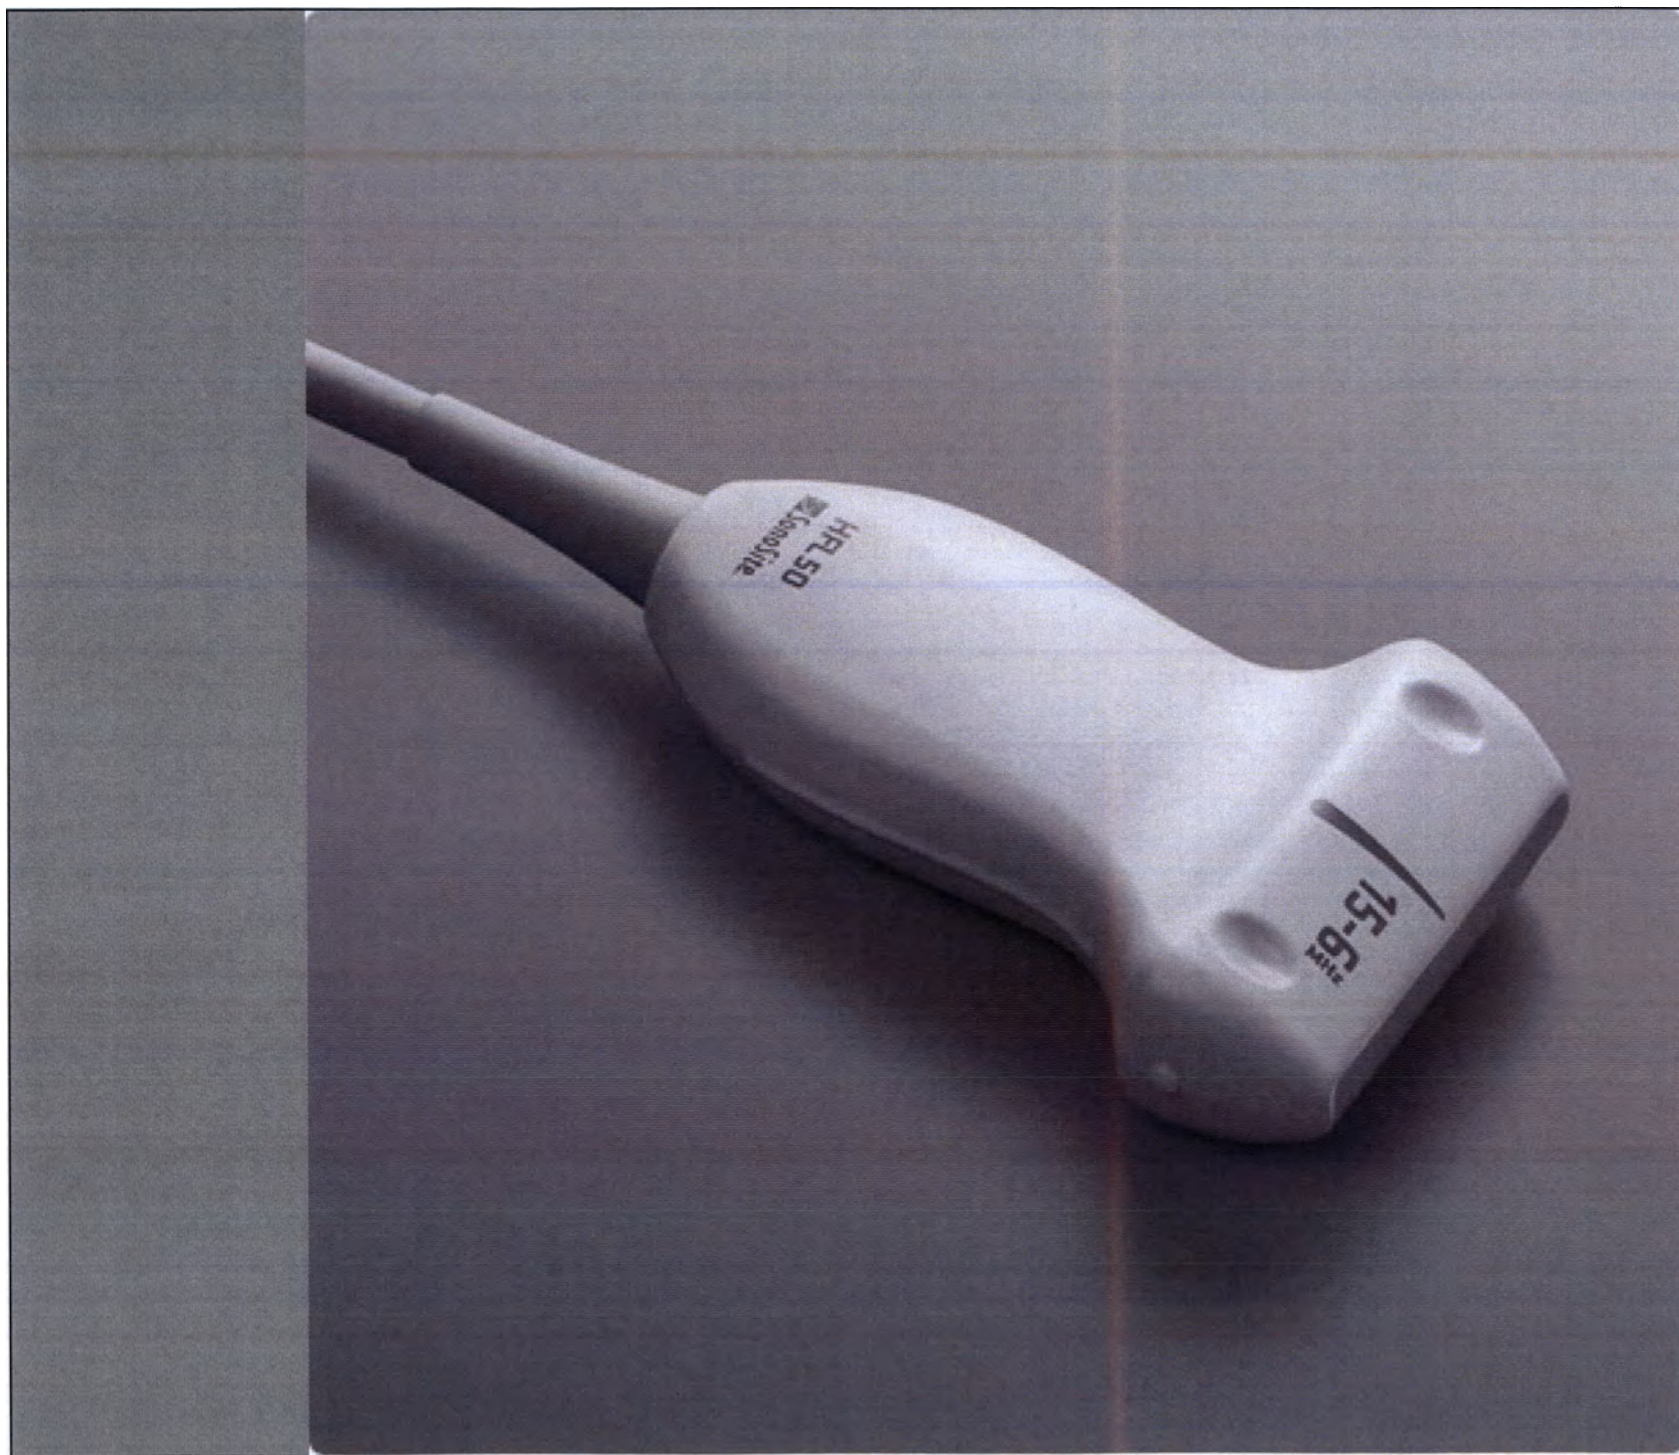




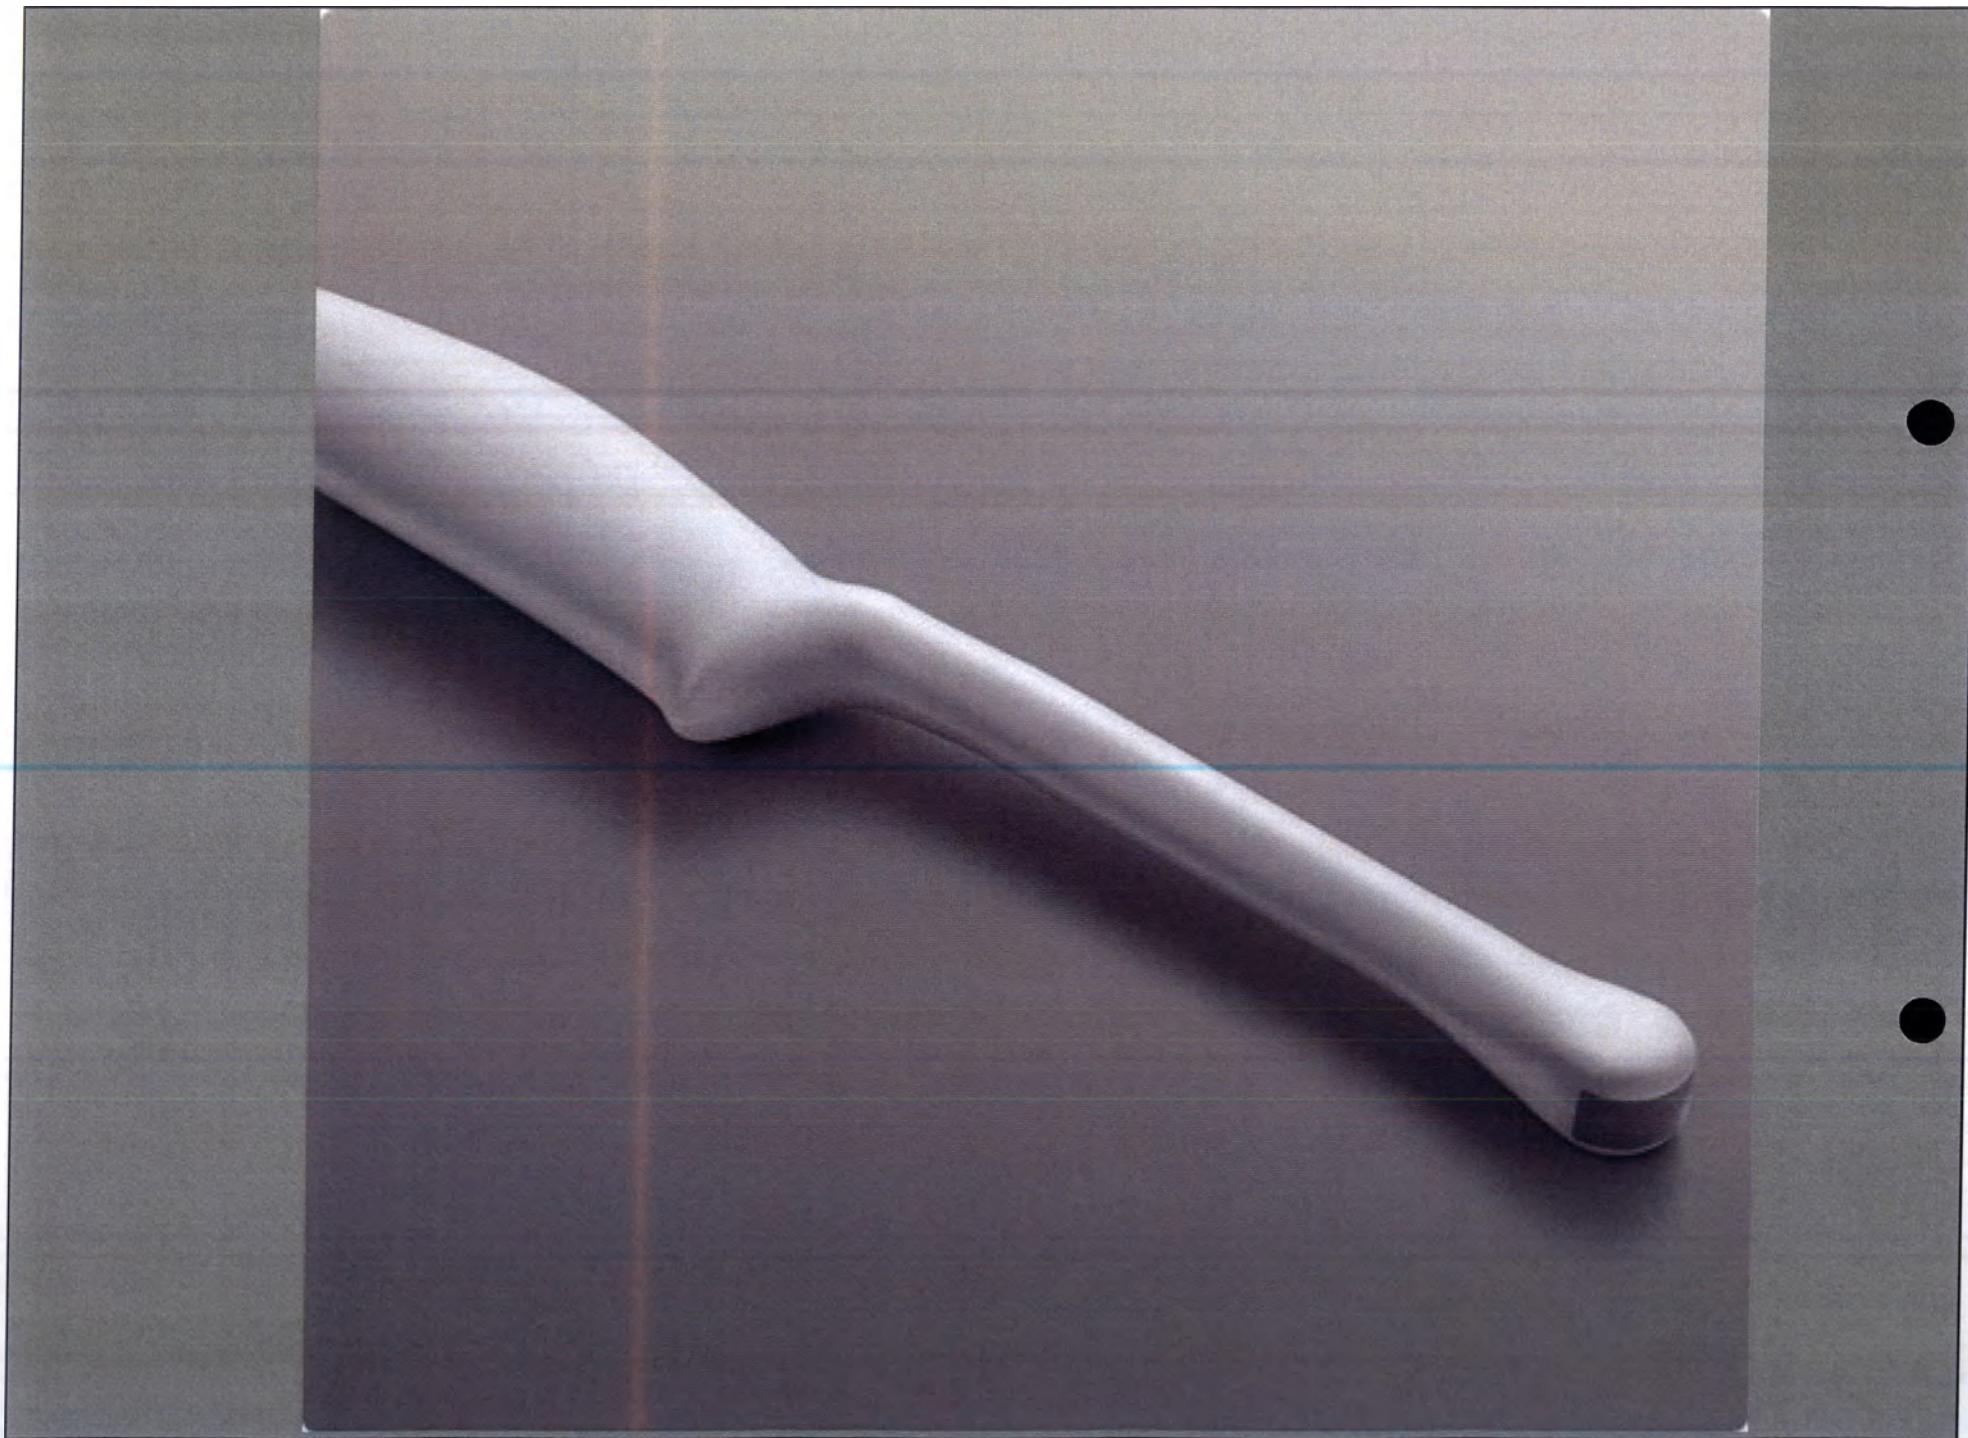


11. Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриволокнистый ИСТх.



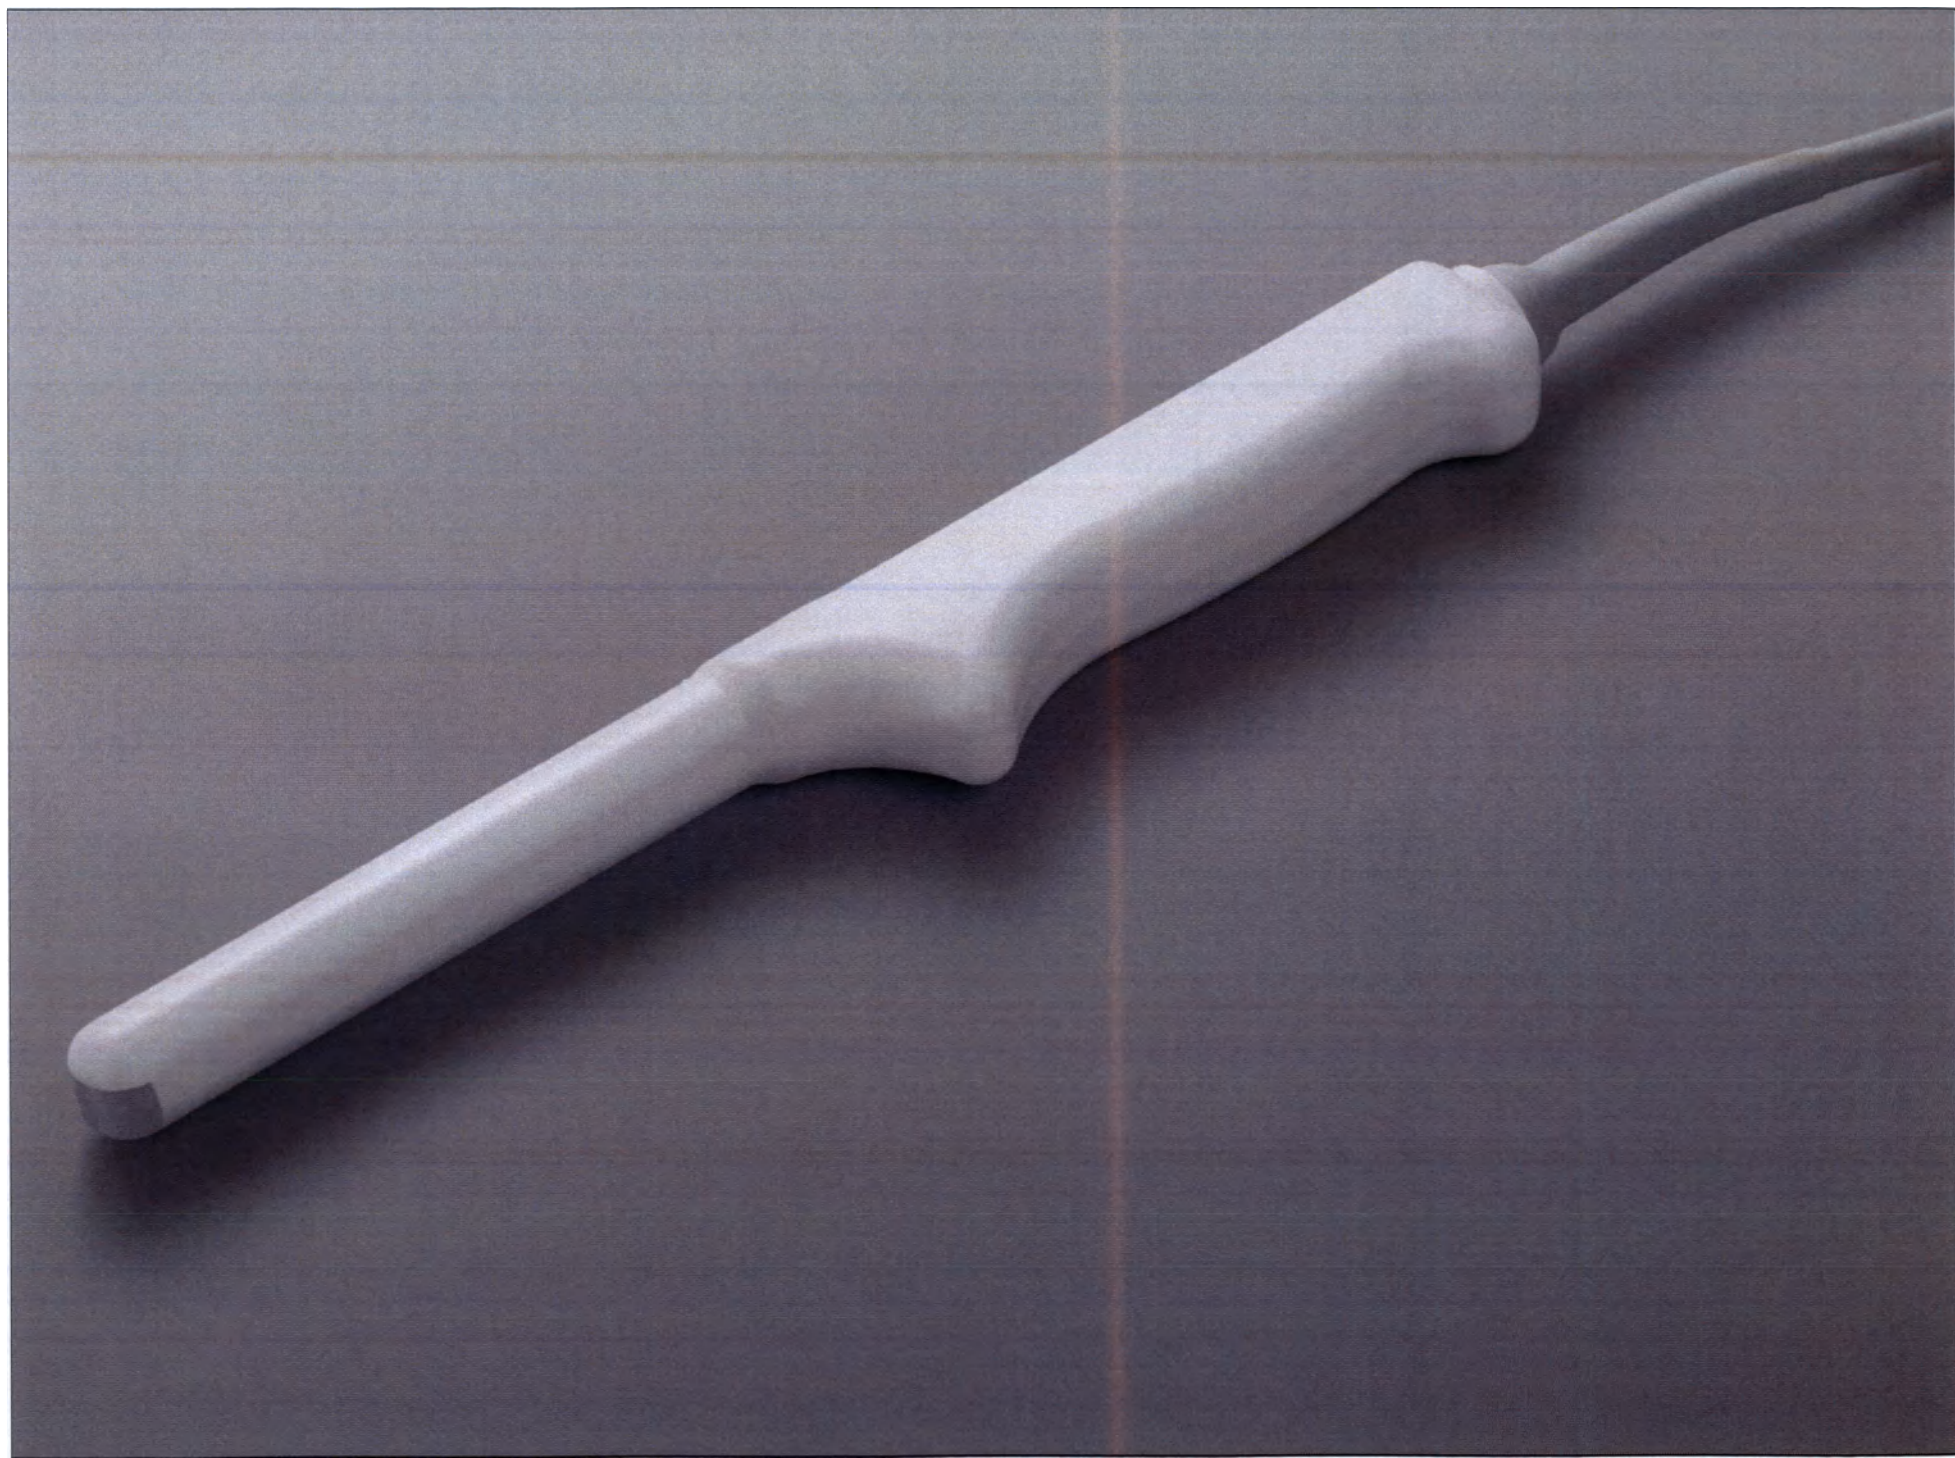




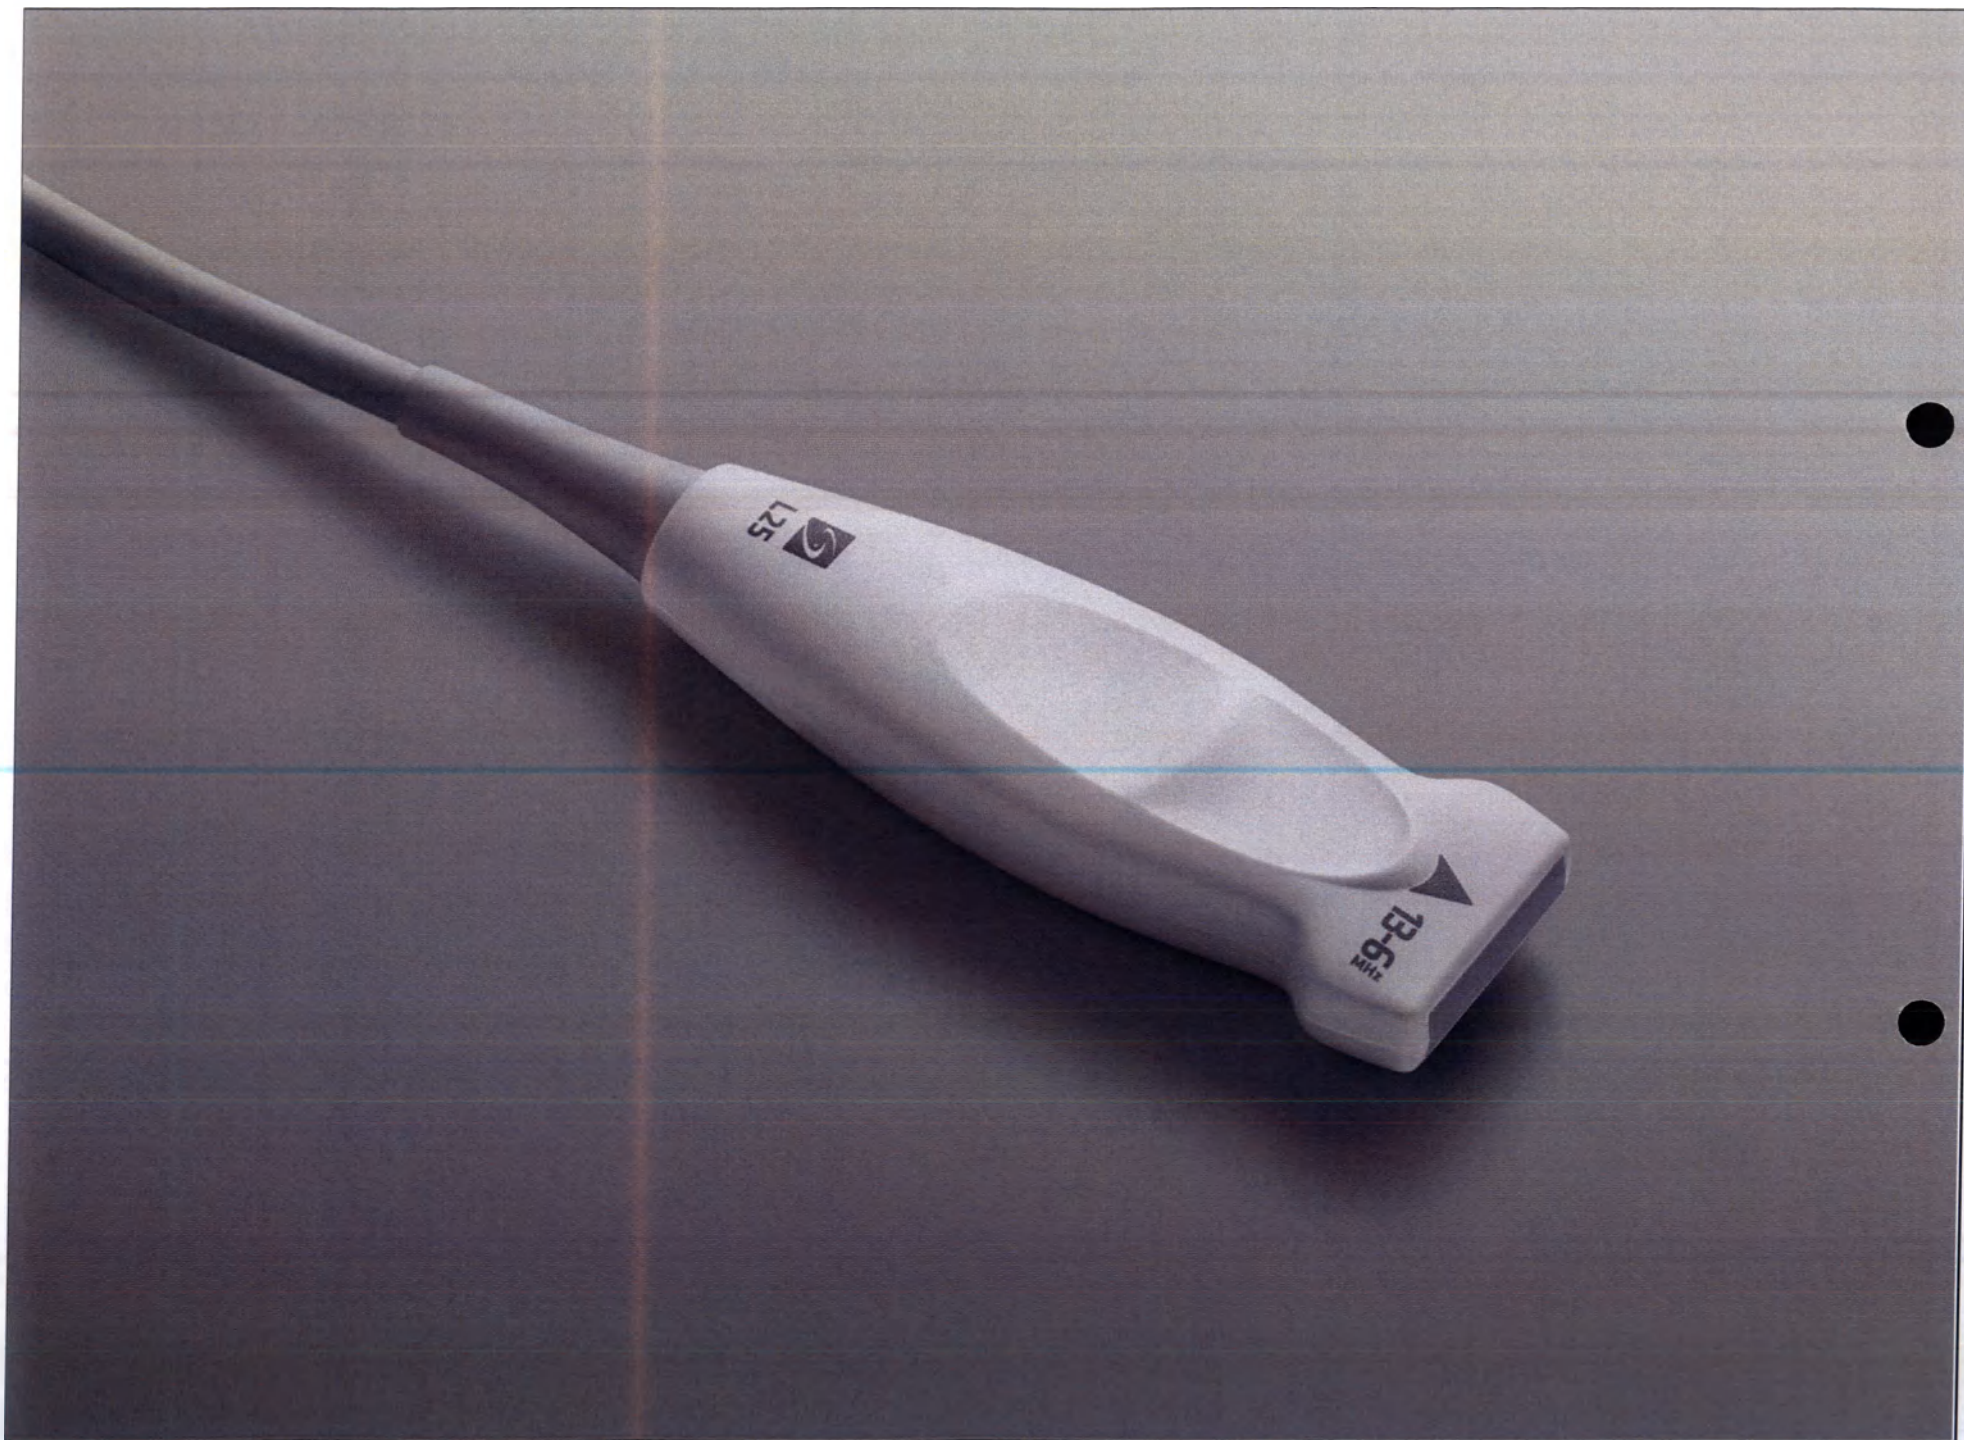

13. Датчик ультразвуковой линейный L25х.



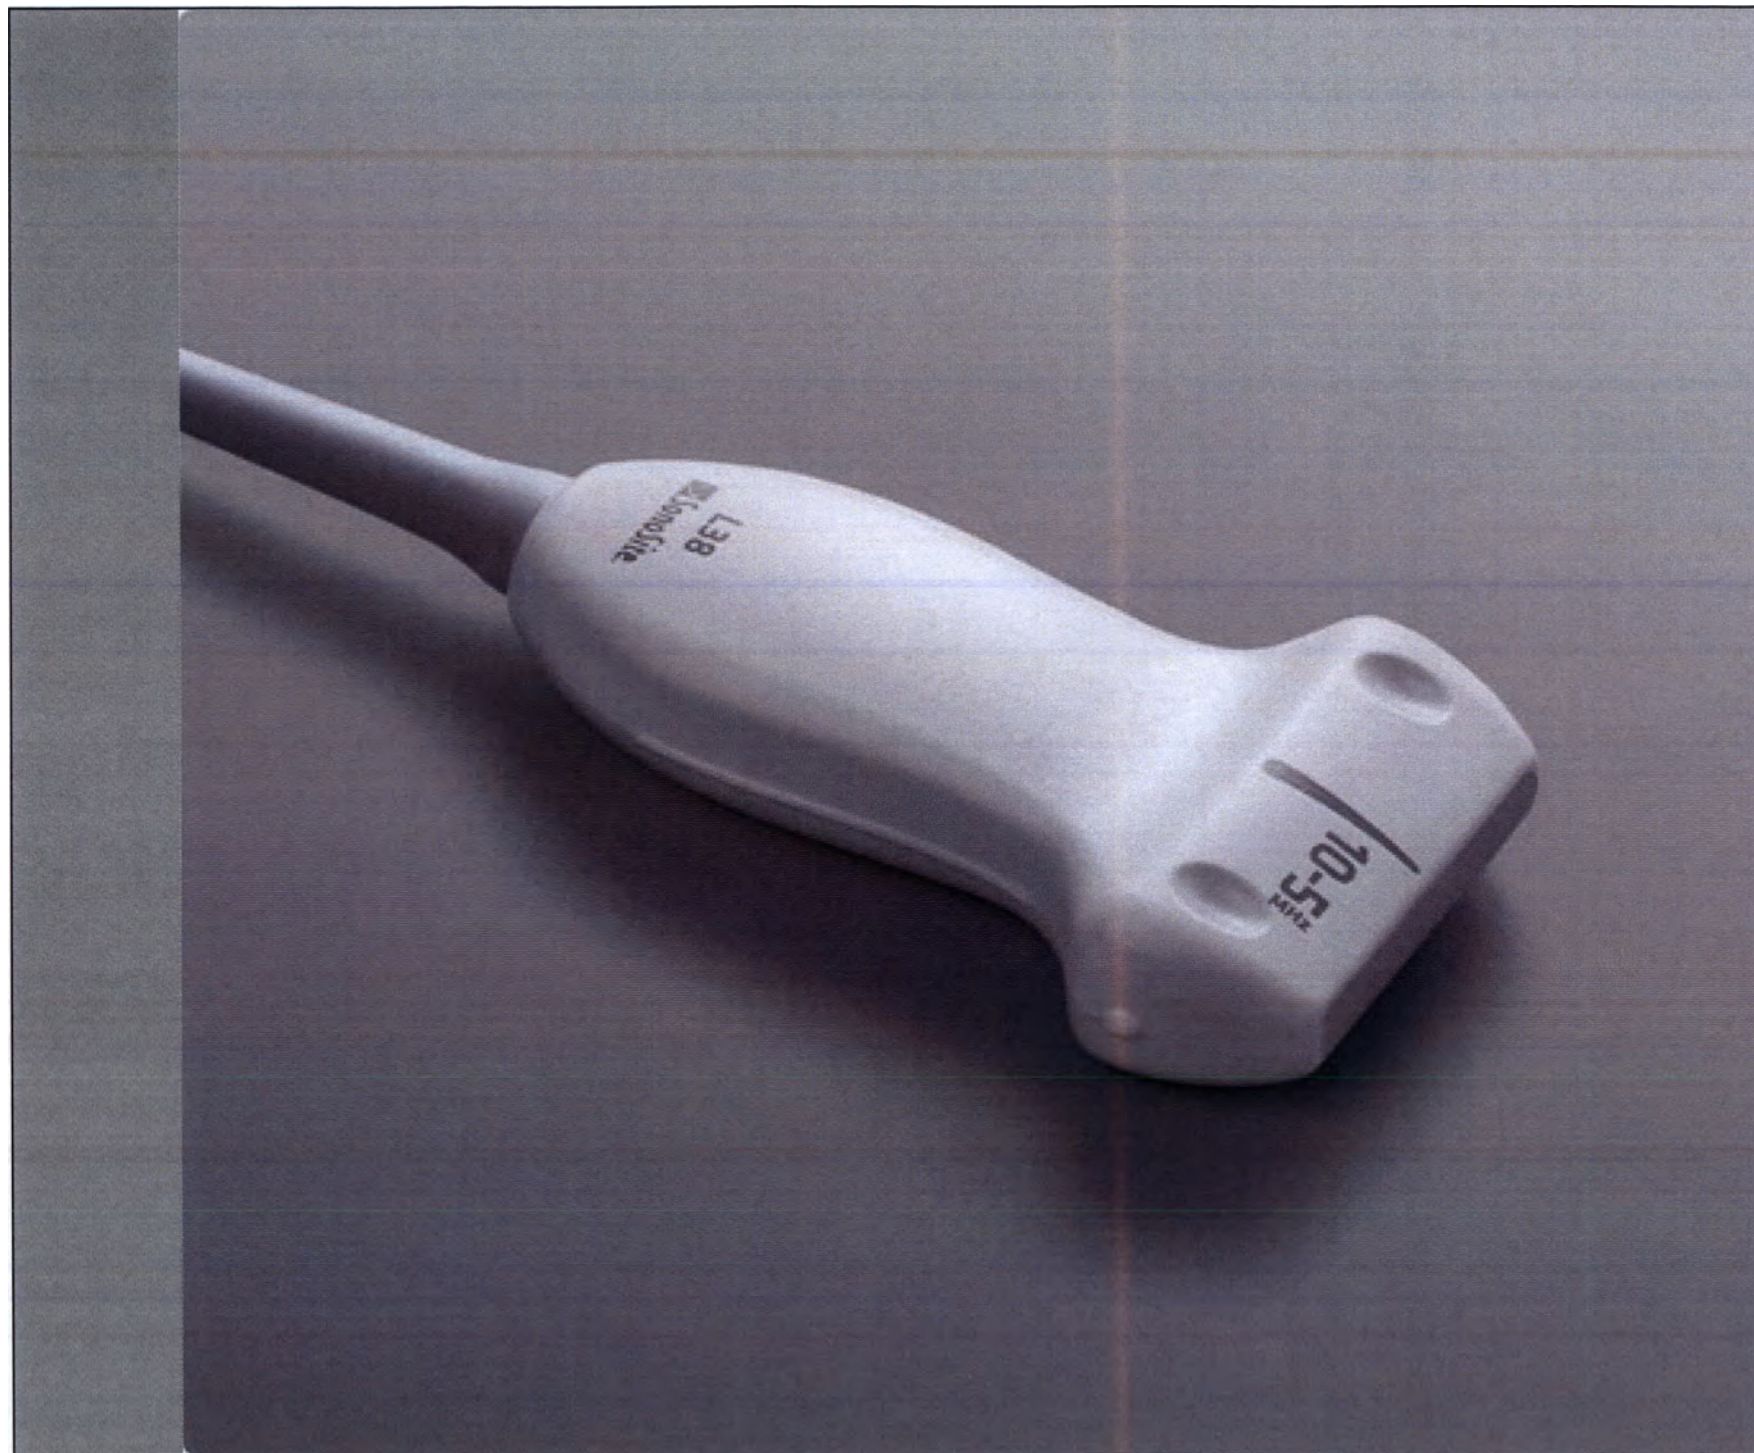







15. Датчик ультразвуковой линейный L38xi с защищенным кабелем.



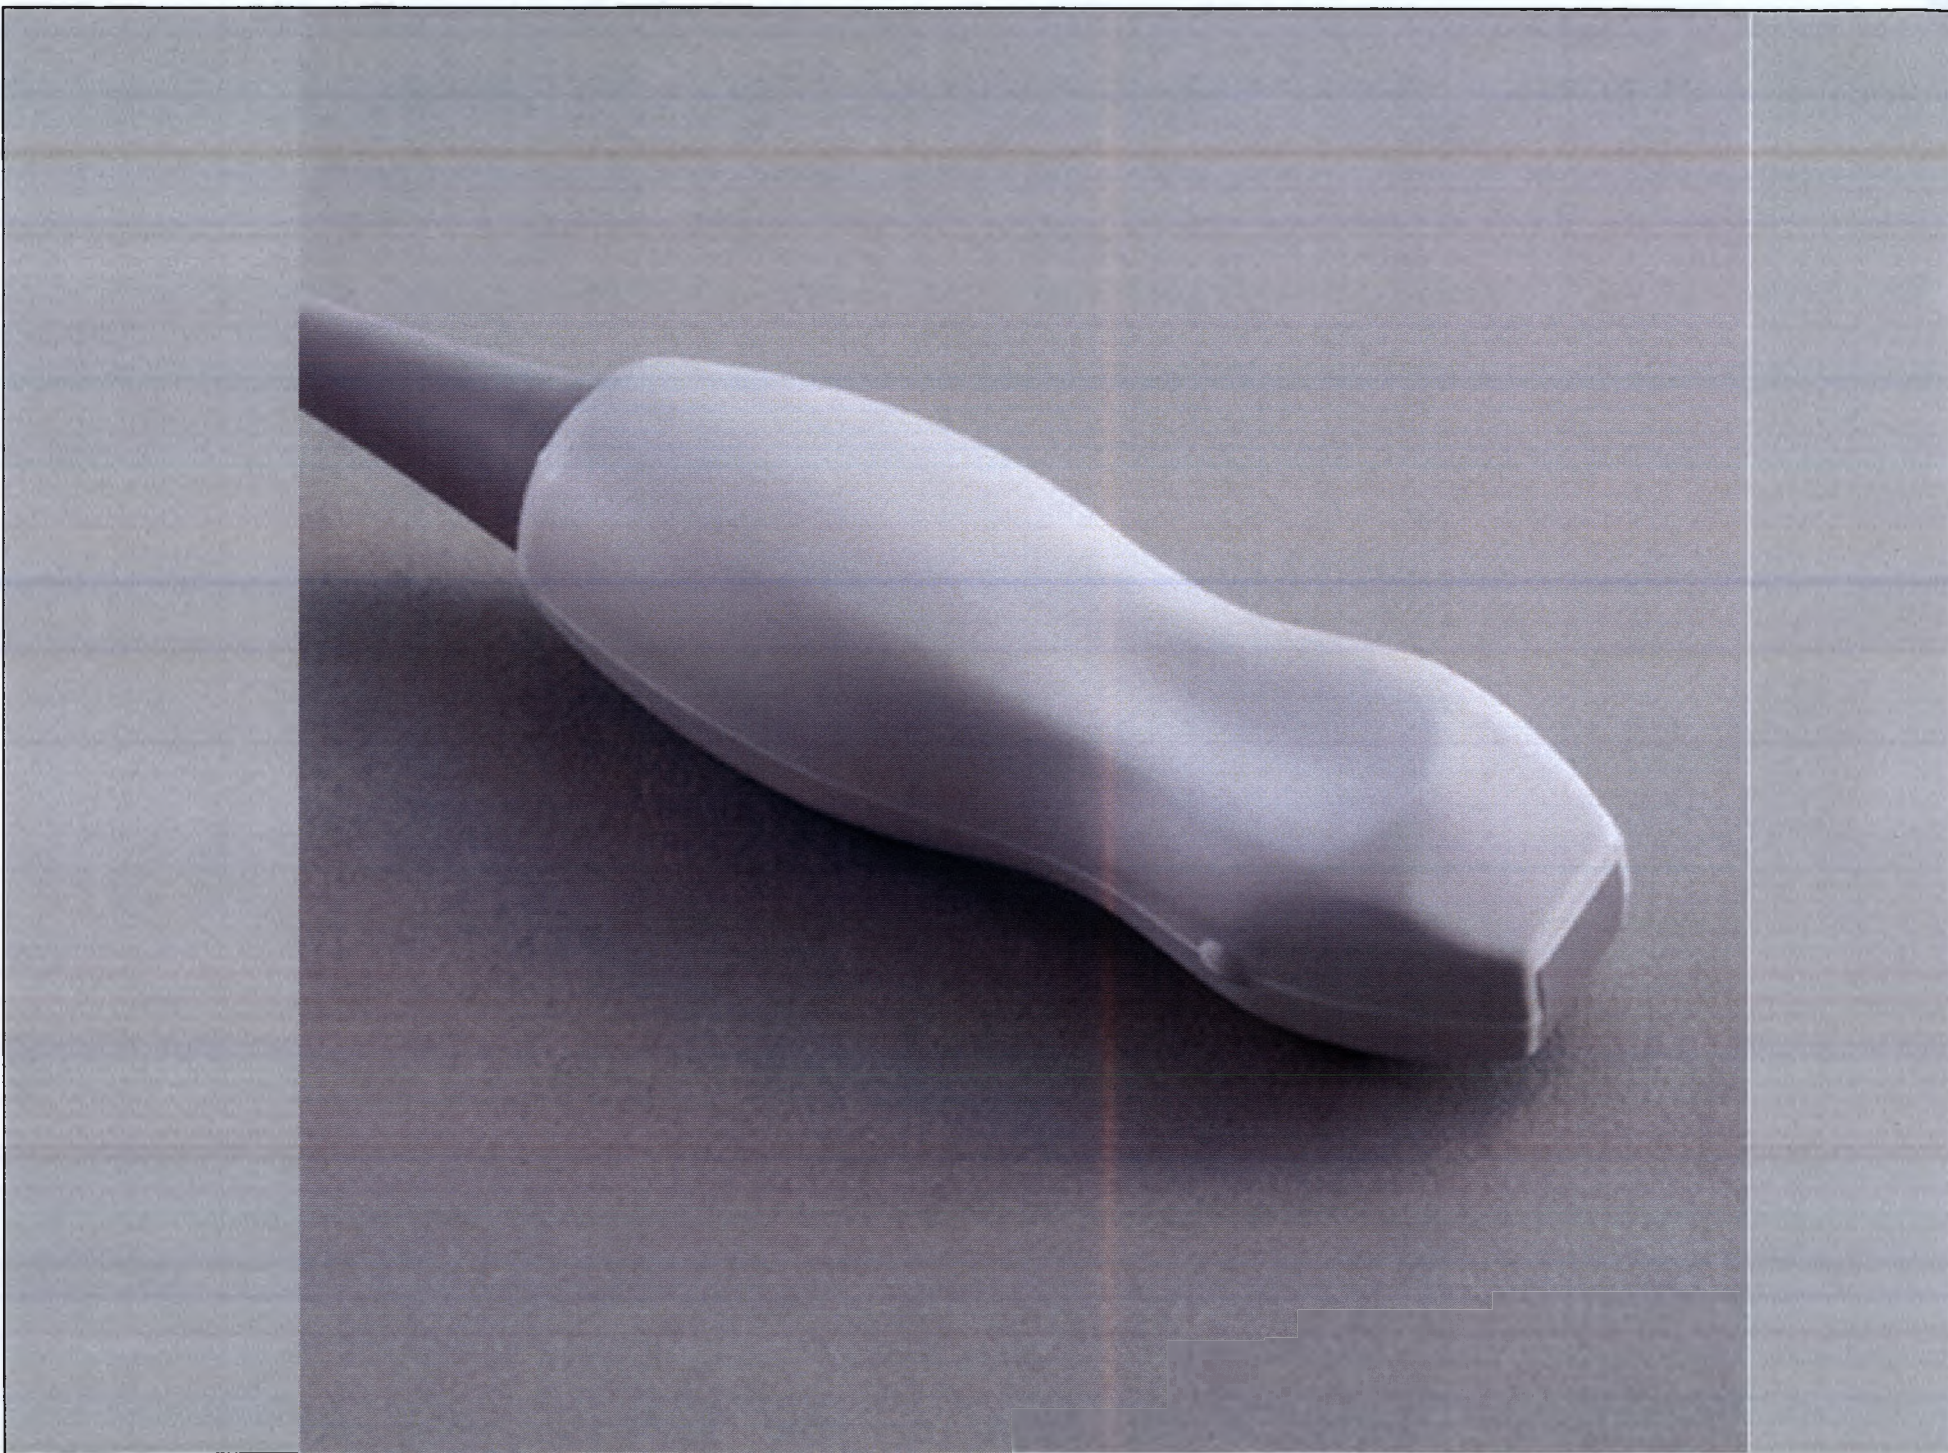




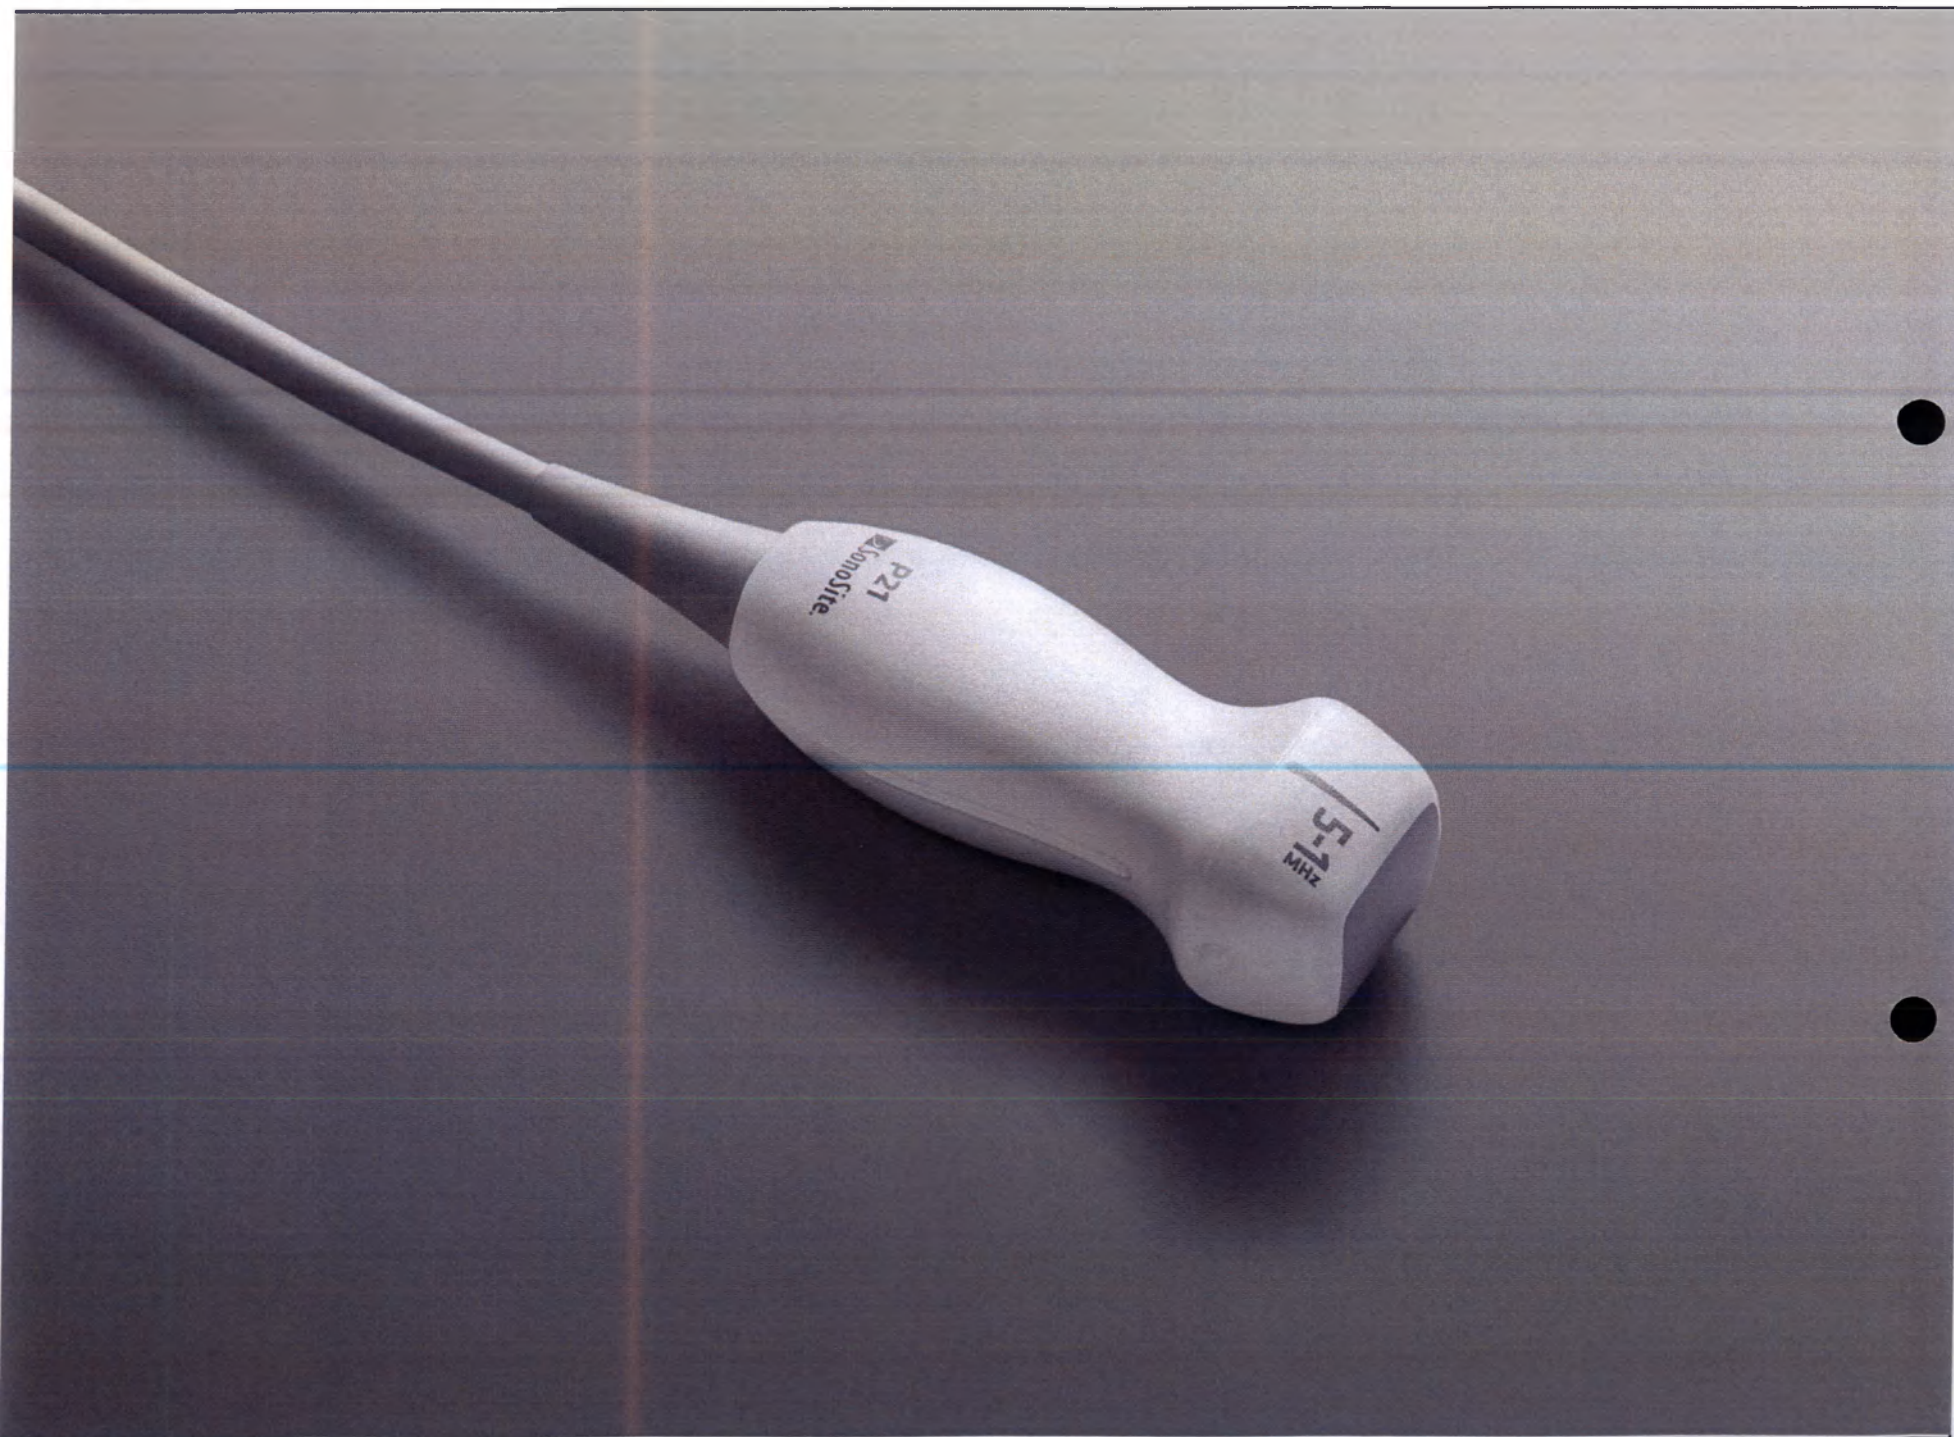


17. Датчик ультразвуковой фазированный Р21х.



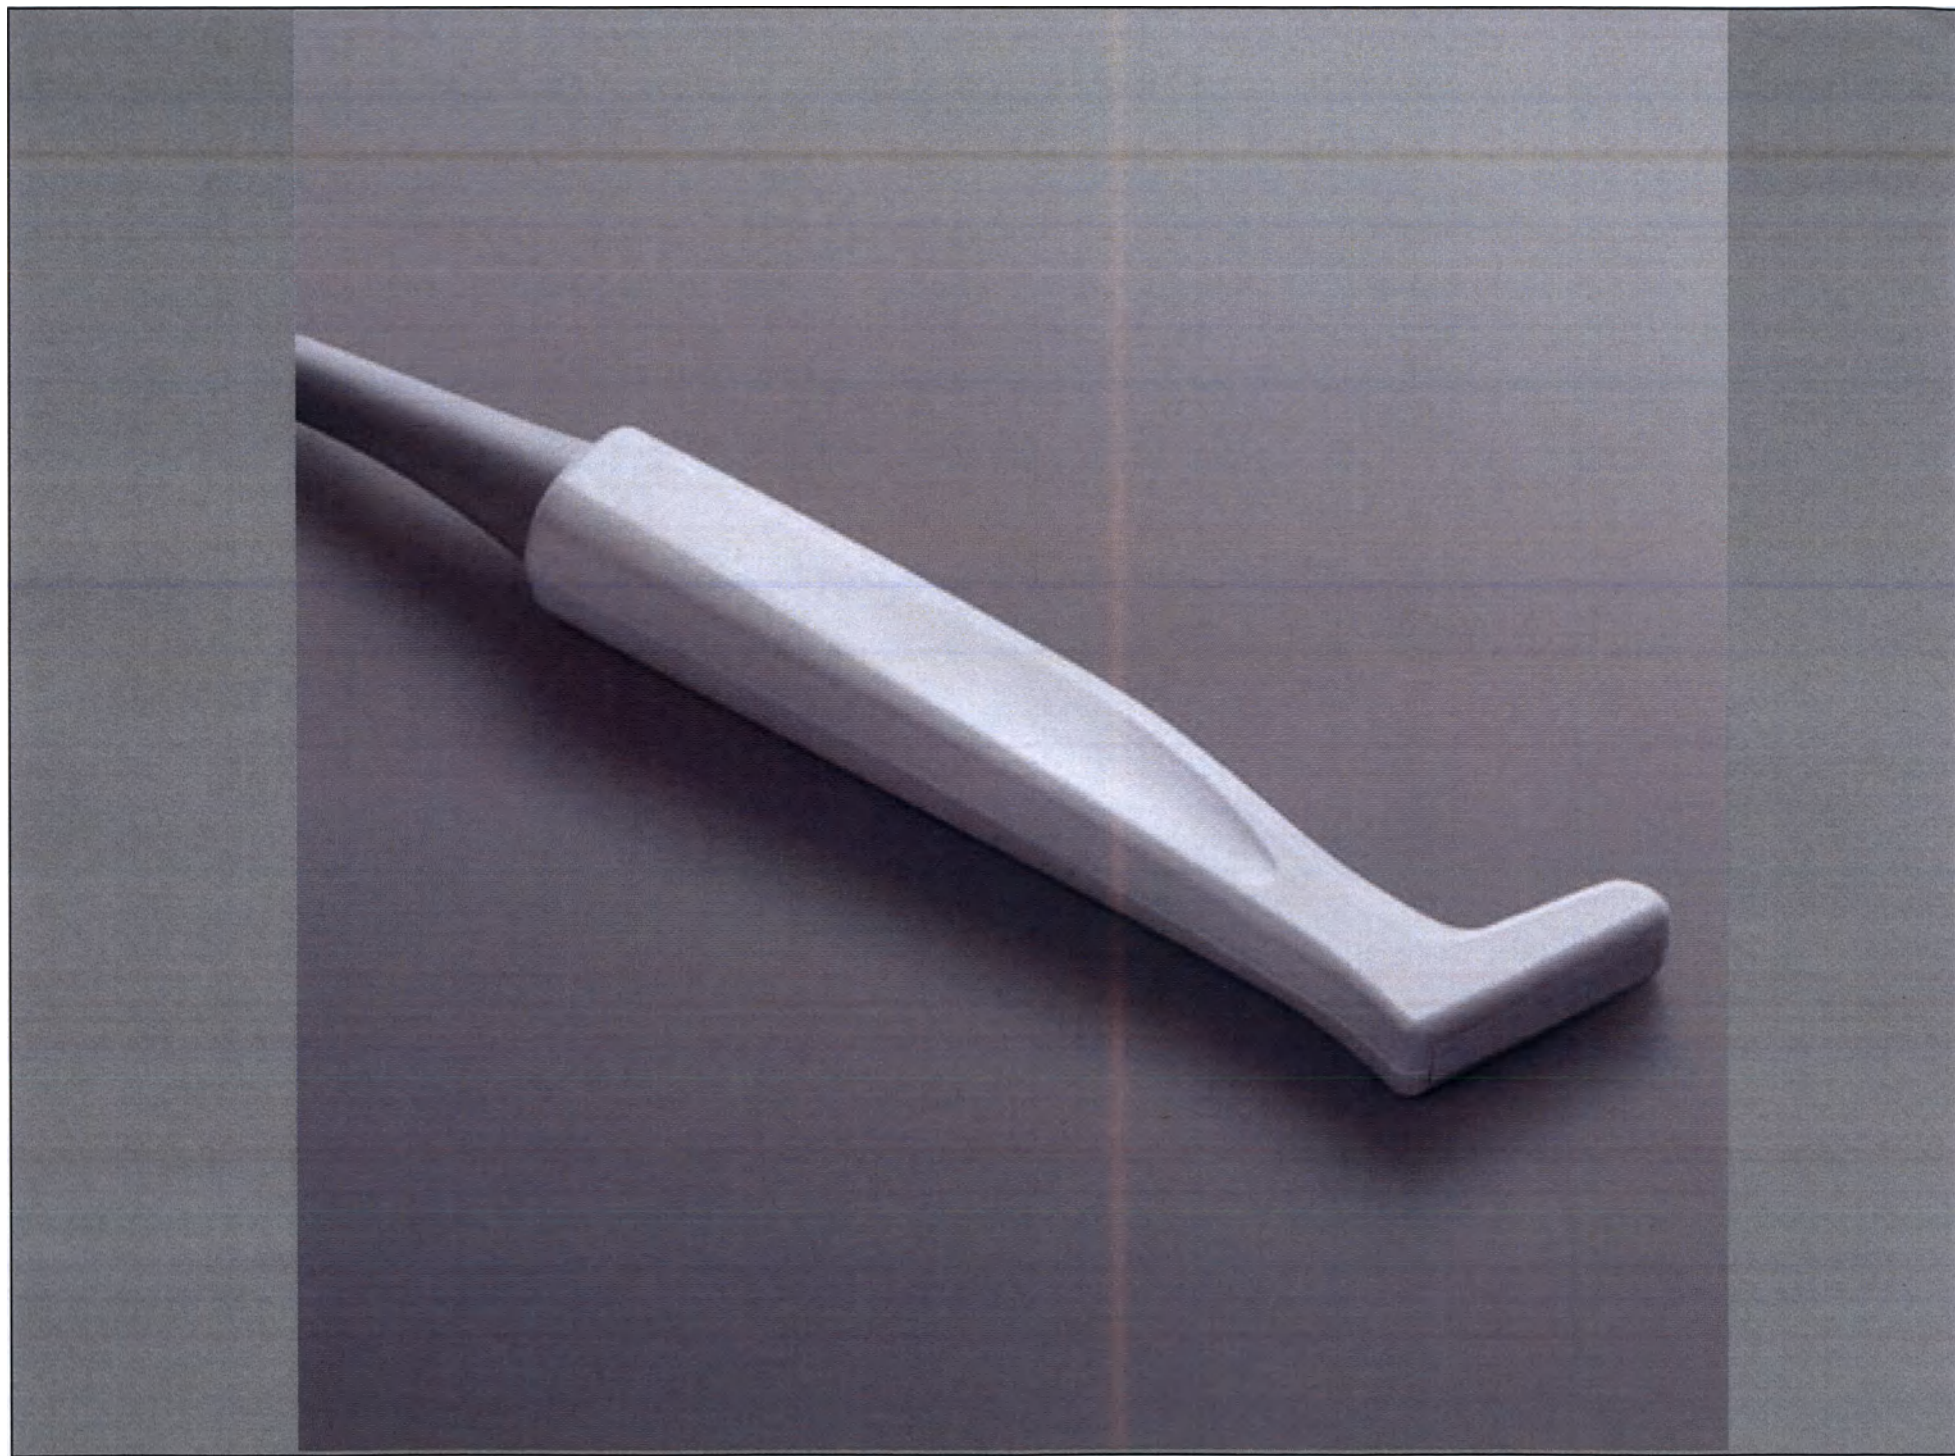




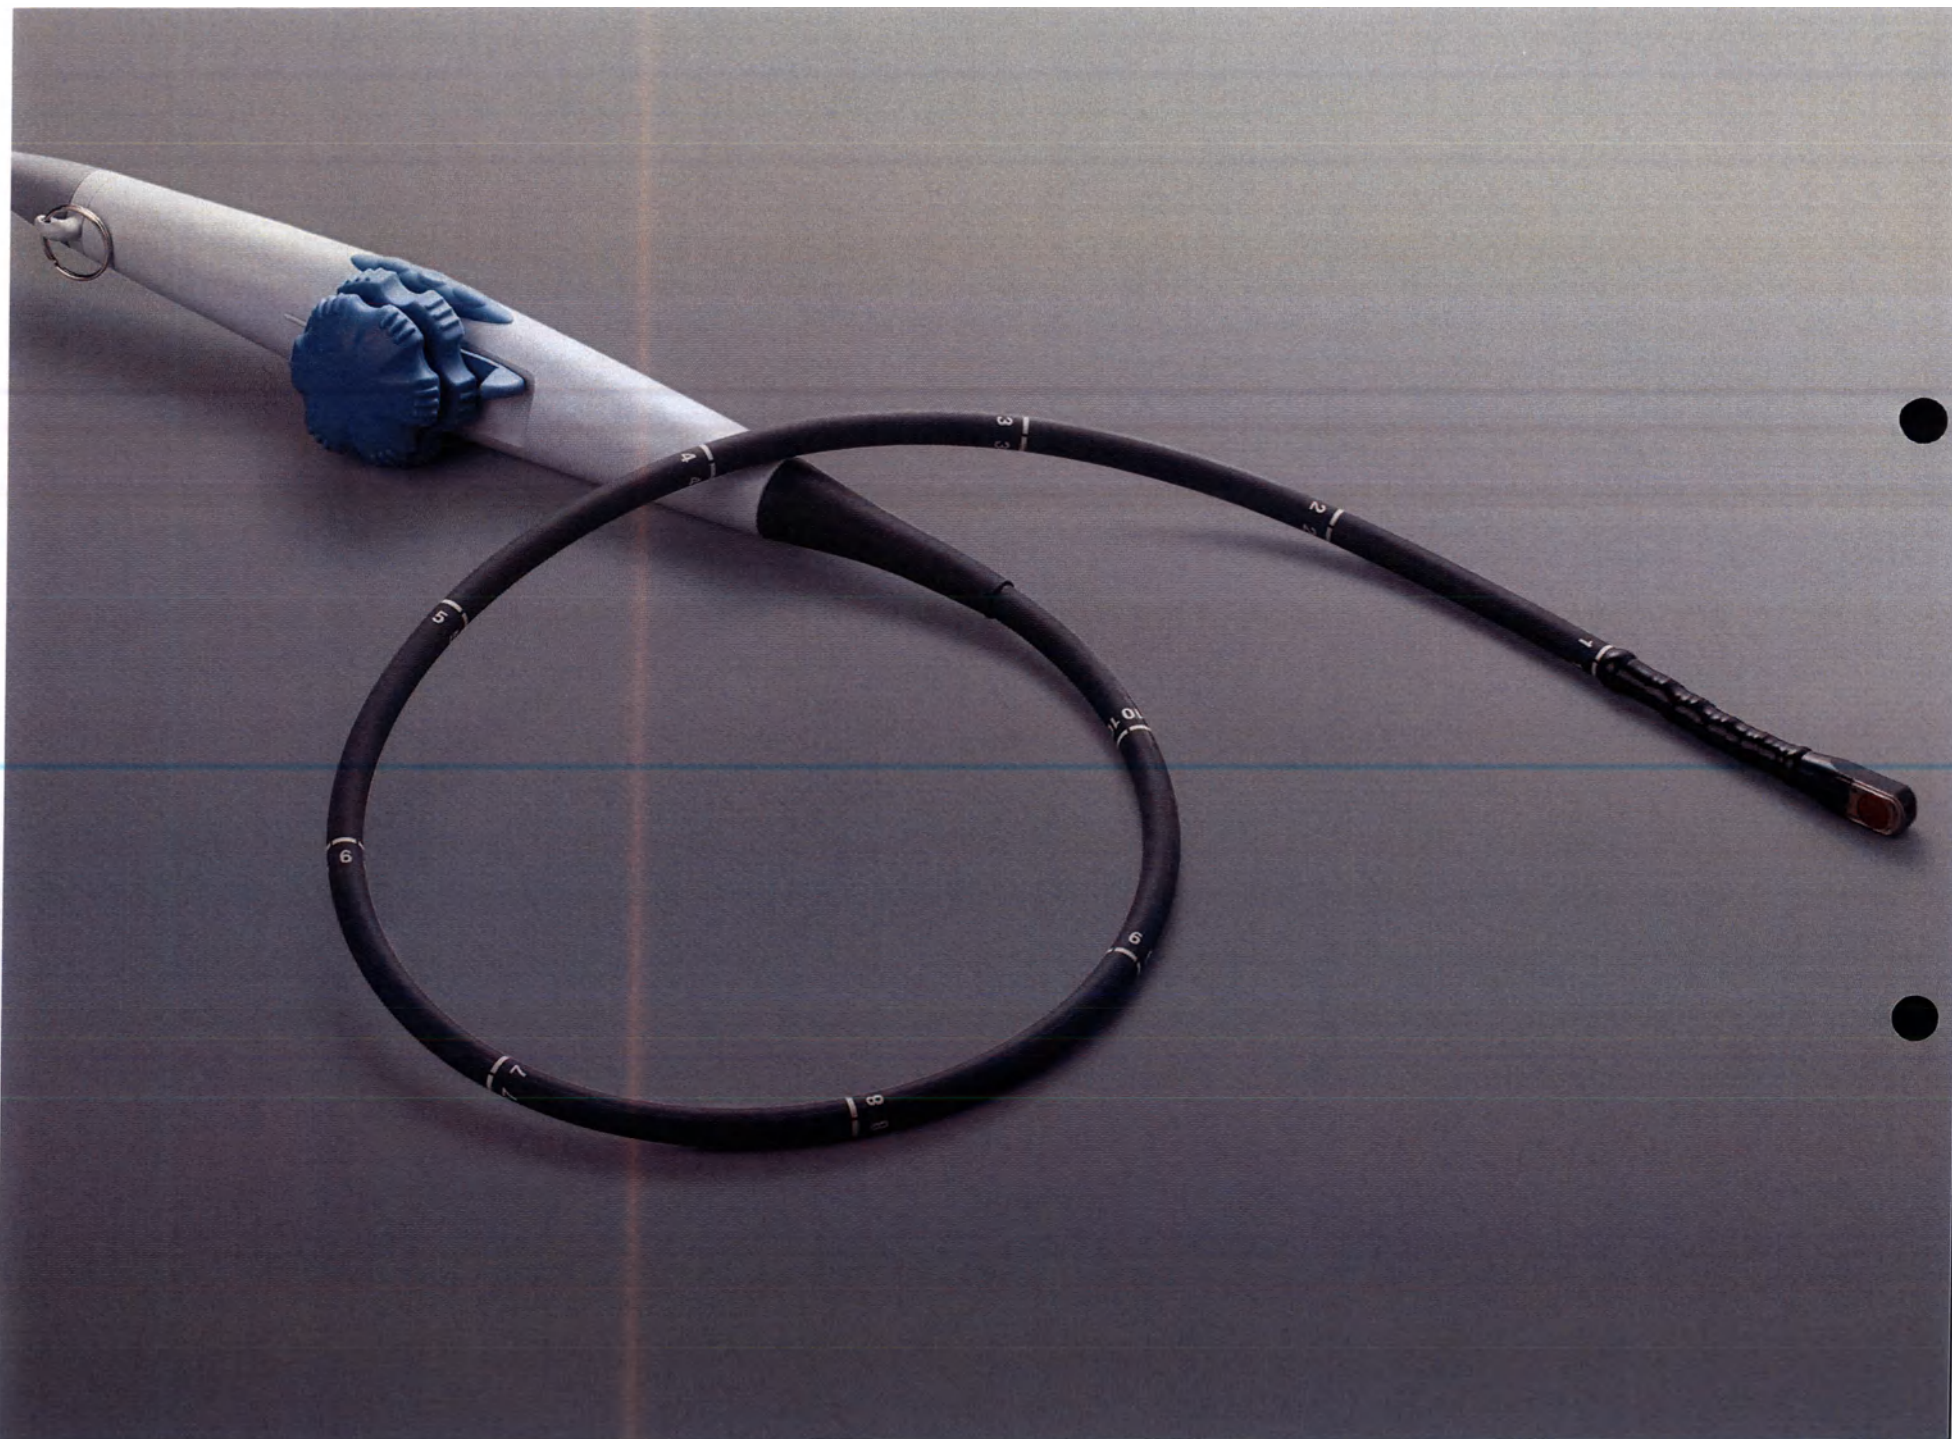

19. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный ТЕЕх.



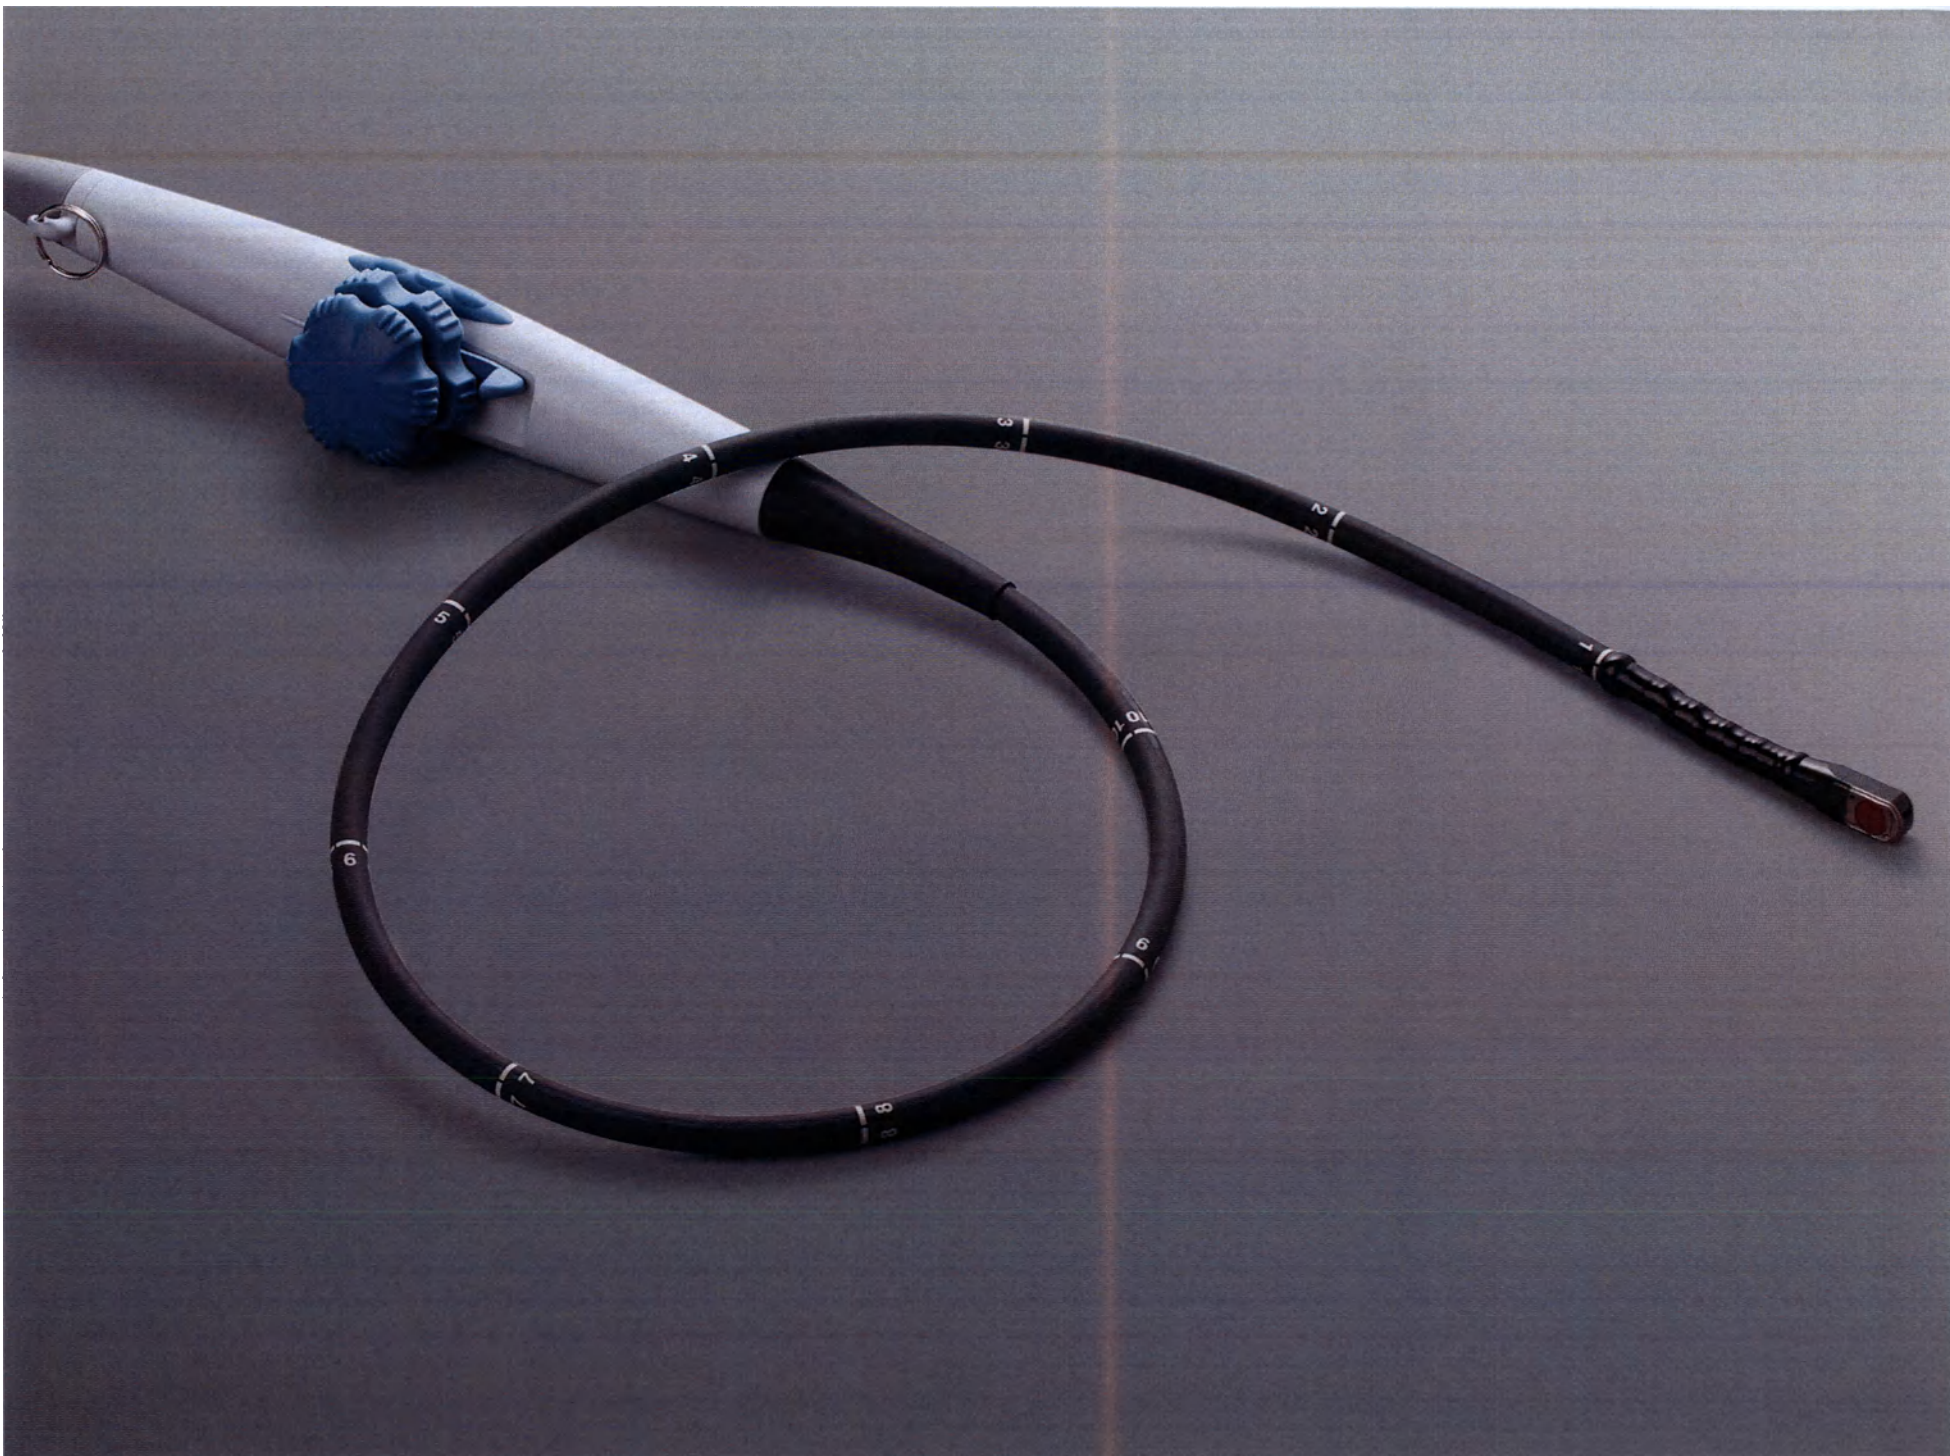






**ULT800**

IEEE Transducer Leakage Current Tester



SAFETY BY 2011



3420031

FLUKE BIOMEDICAL  
6020 SEAWAY BLVD. EVERETT, WA 98200  
800-900-5953

**FLUKE Biomedical**  
**CALIBRATED**

DATE 9-2-16  
DUE 9/17 BY 8000

DO NOT FILL ABOVE LINE.  
EMPTY PRIOR TO TRANSPORT.  
H LID ON. ONLY USE CIDEX® SOLUTION.  
MARK OF JOHNSON & JOHNSON.

21. Набор для определения тока утечки датчиков TEEх, TEEхi: Мультиметр;










21. Набор для определения тока утечки датчиков TEEх, TEEхi: Адаптер датчика SonoSite;







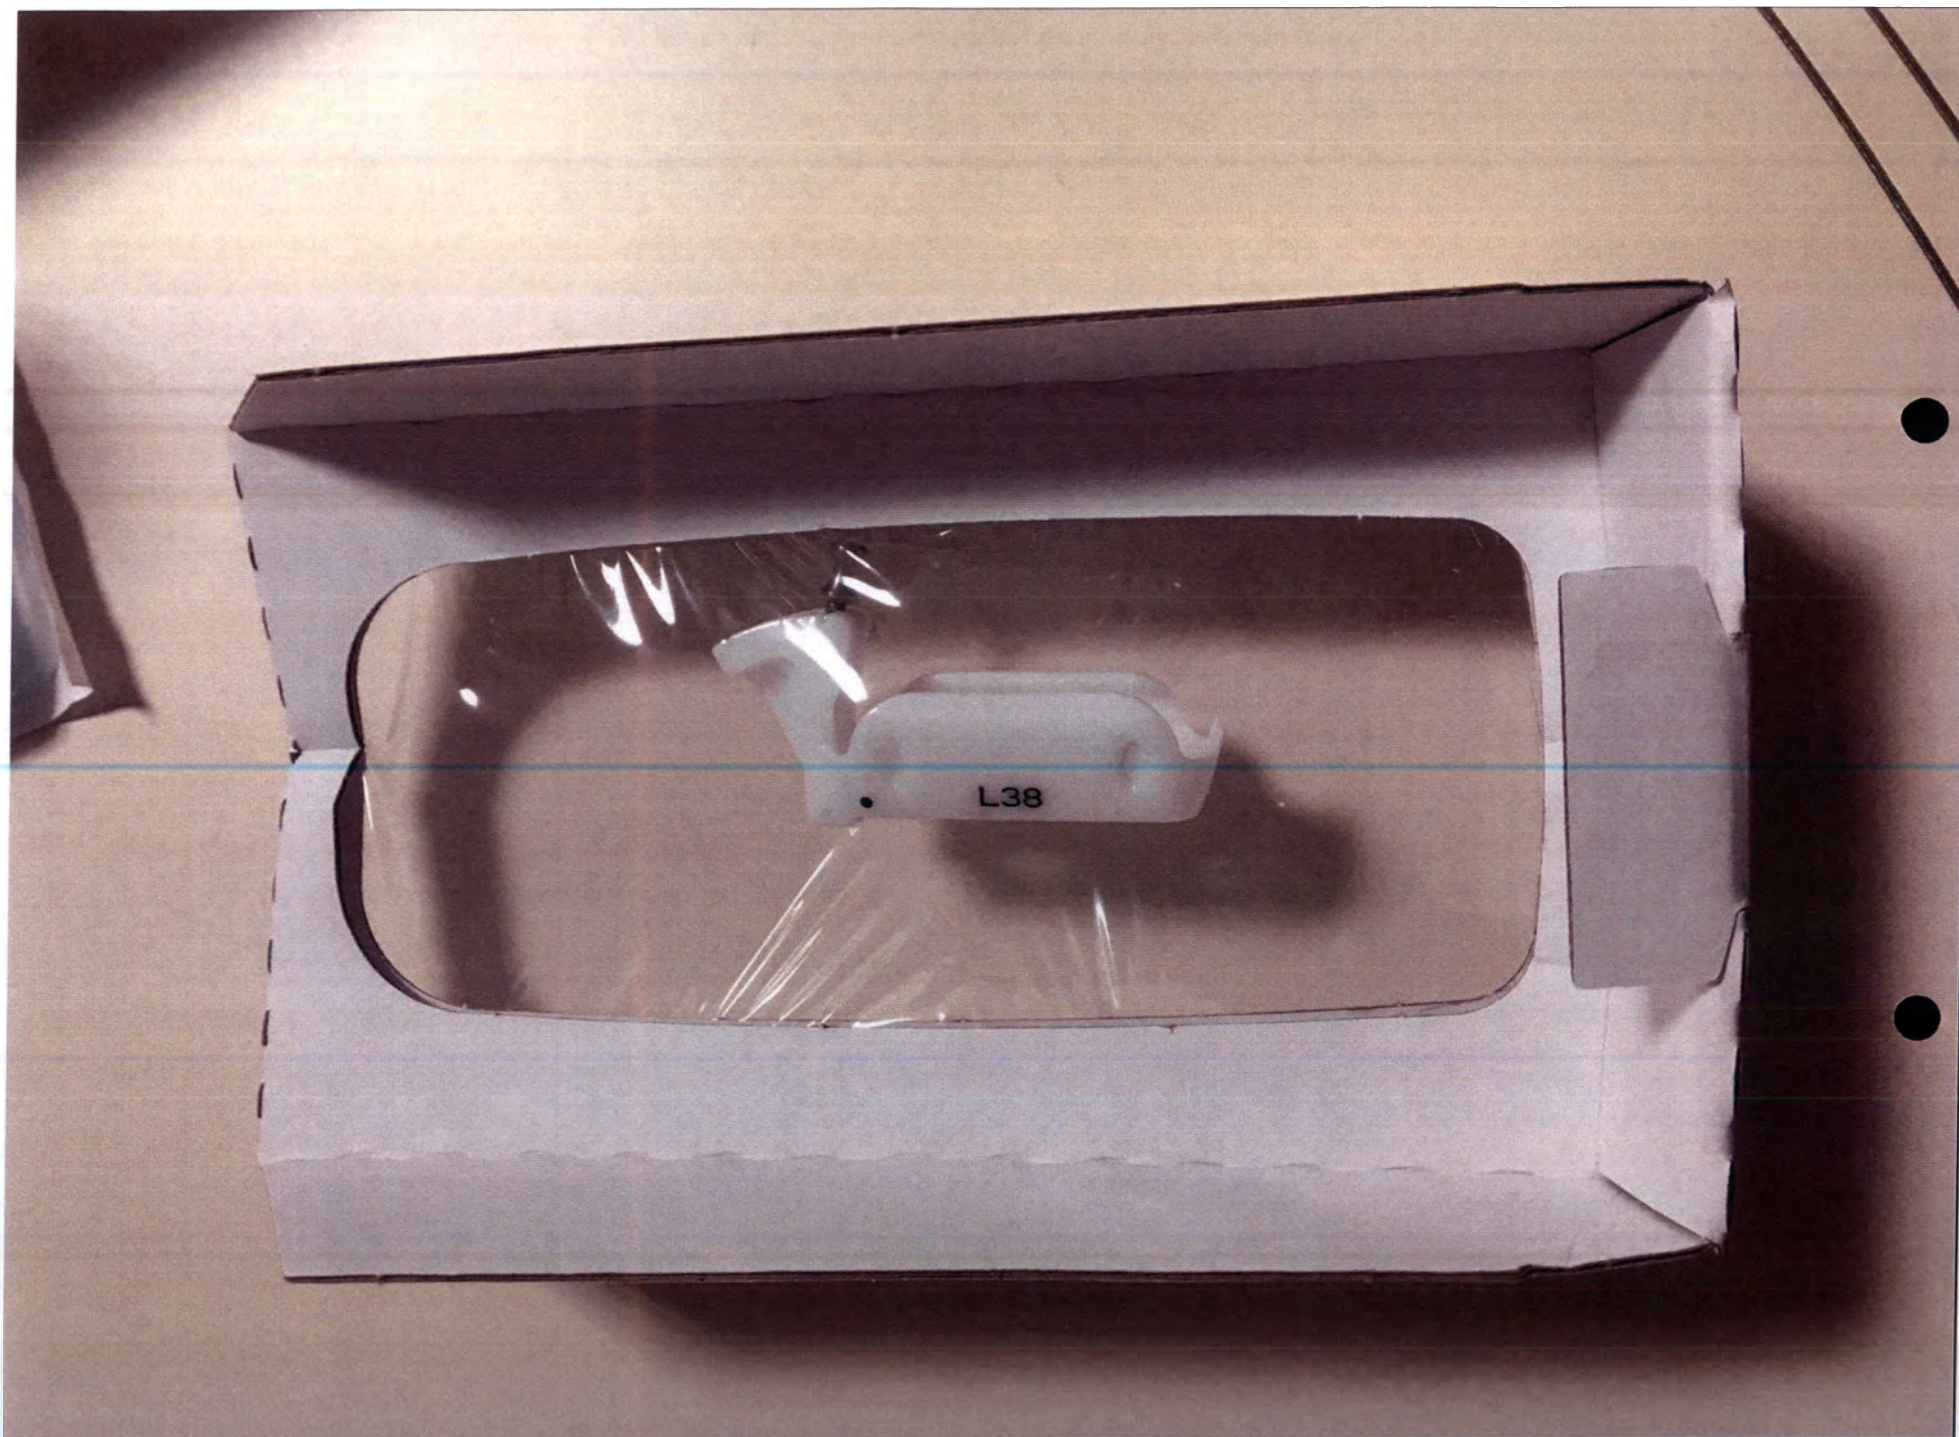

22. Набор биопсийный для датчиков L38xi, HFL38xi (не более 2 шт.): Насадка биопсийная;










22. Набор биопсийный для датчиков L38xi, HFL38xi (не более 2 шт.): Чехлы латексные одноразовые (5 шт.).







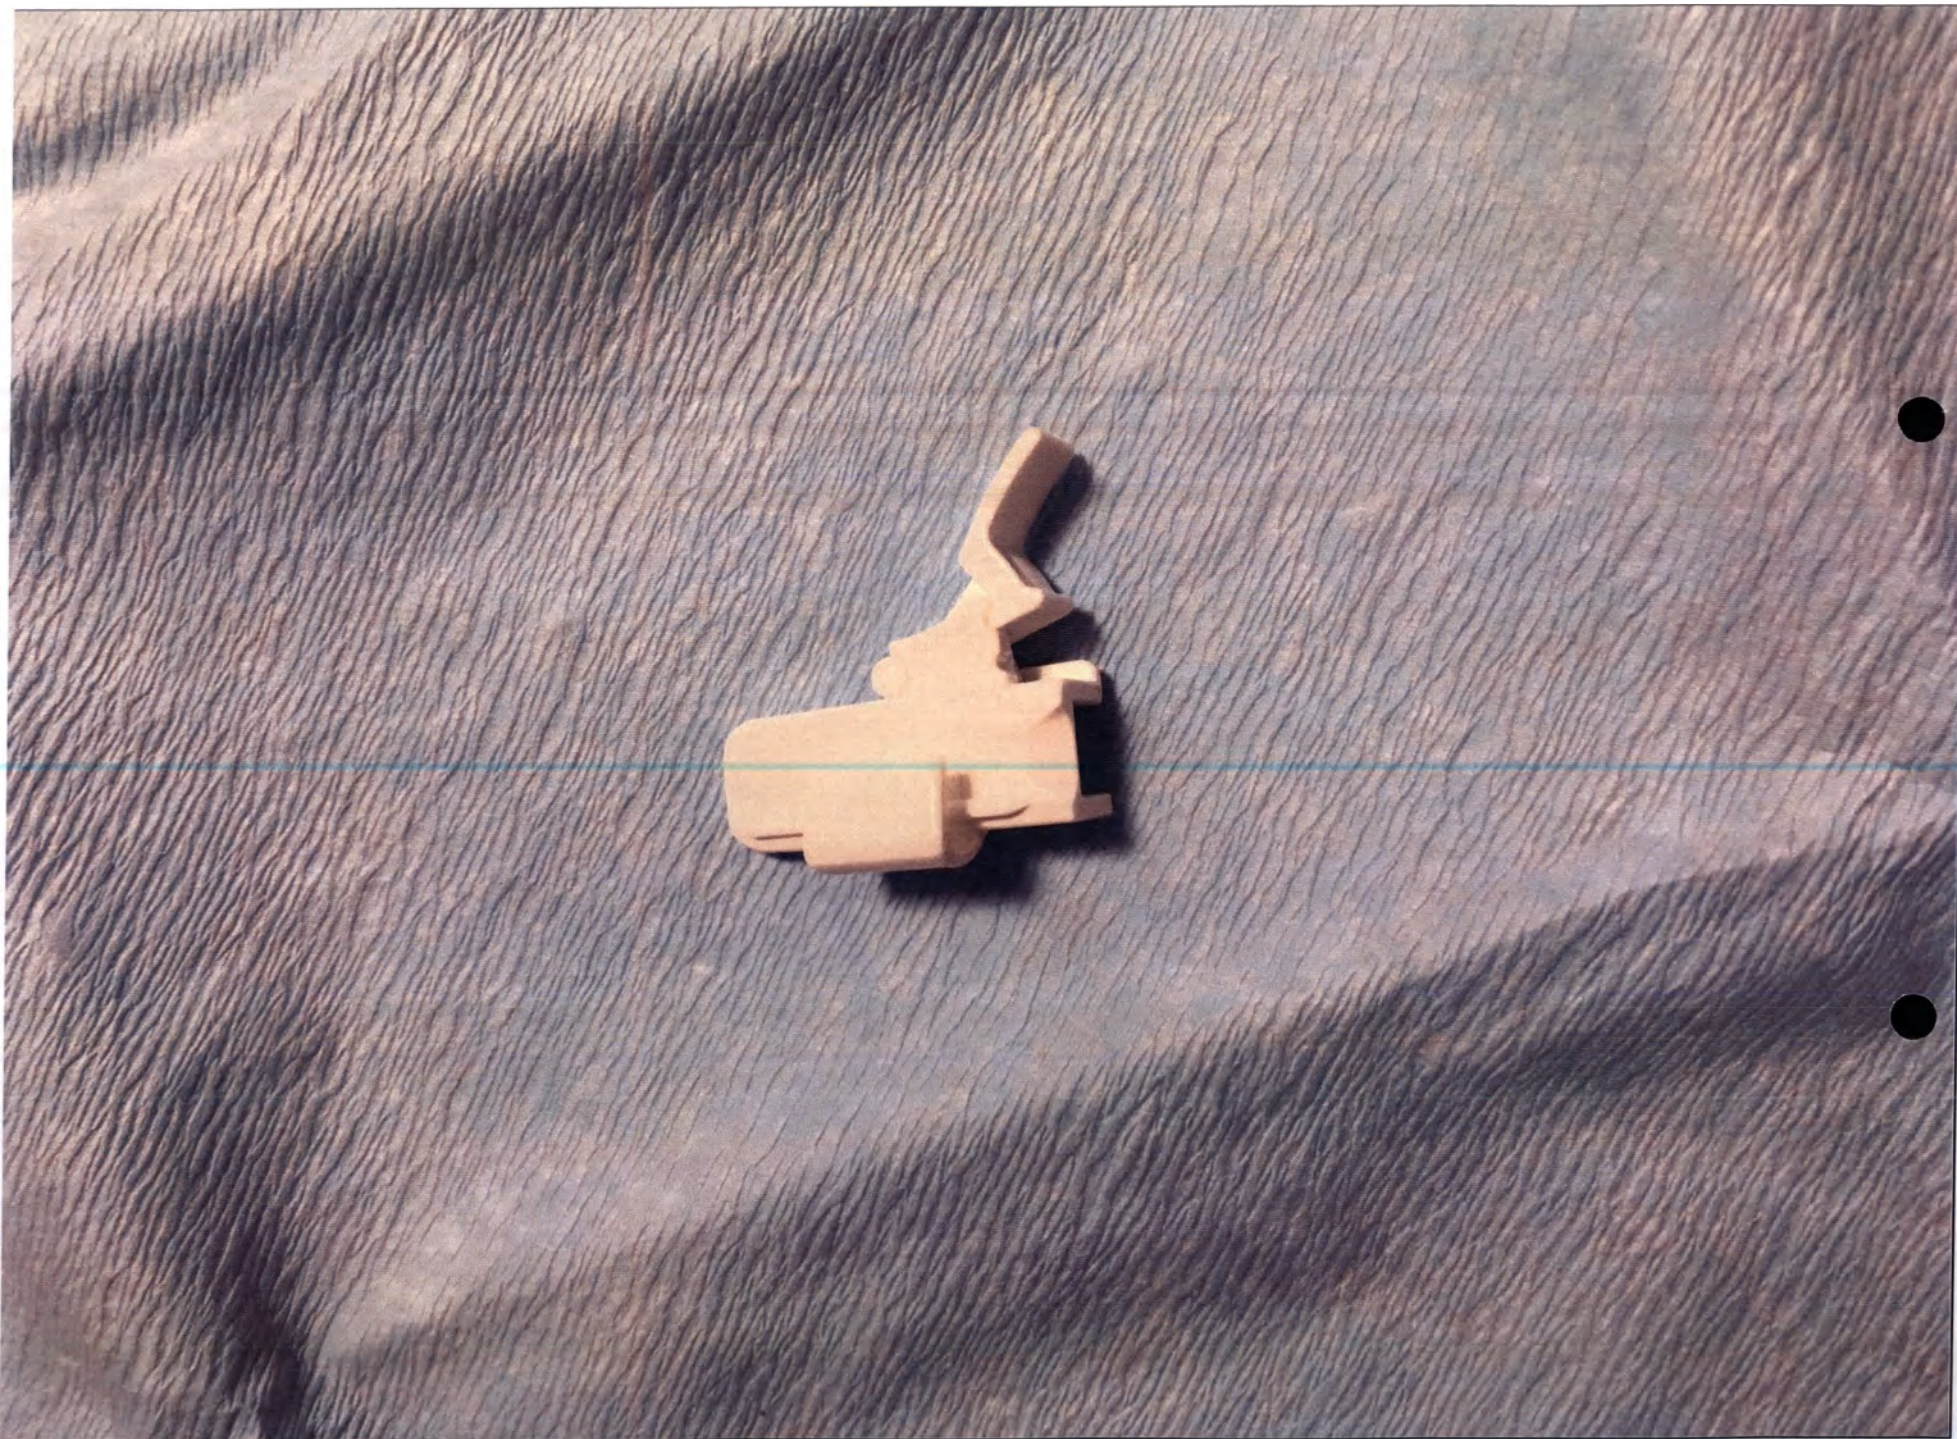

23. Набор стартовый для взятия биопсии для датчика HFL38 (не более 2 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);









74. Набор биопсийный для датчика HFL50 (не более 2 шт.): Насадка биопсийная;











24. Набор биопсийный для датчика HFL50 (не более 2 шт.): Чехлы латексные одноразовые (5 шт.).



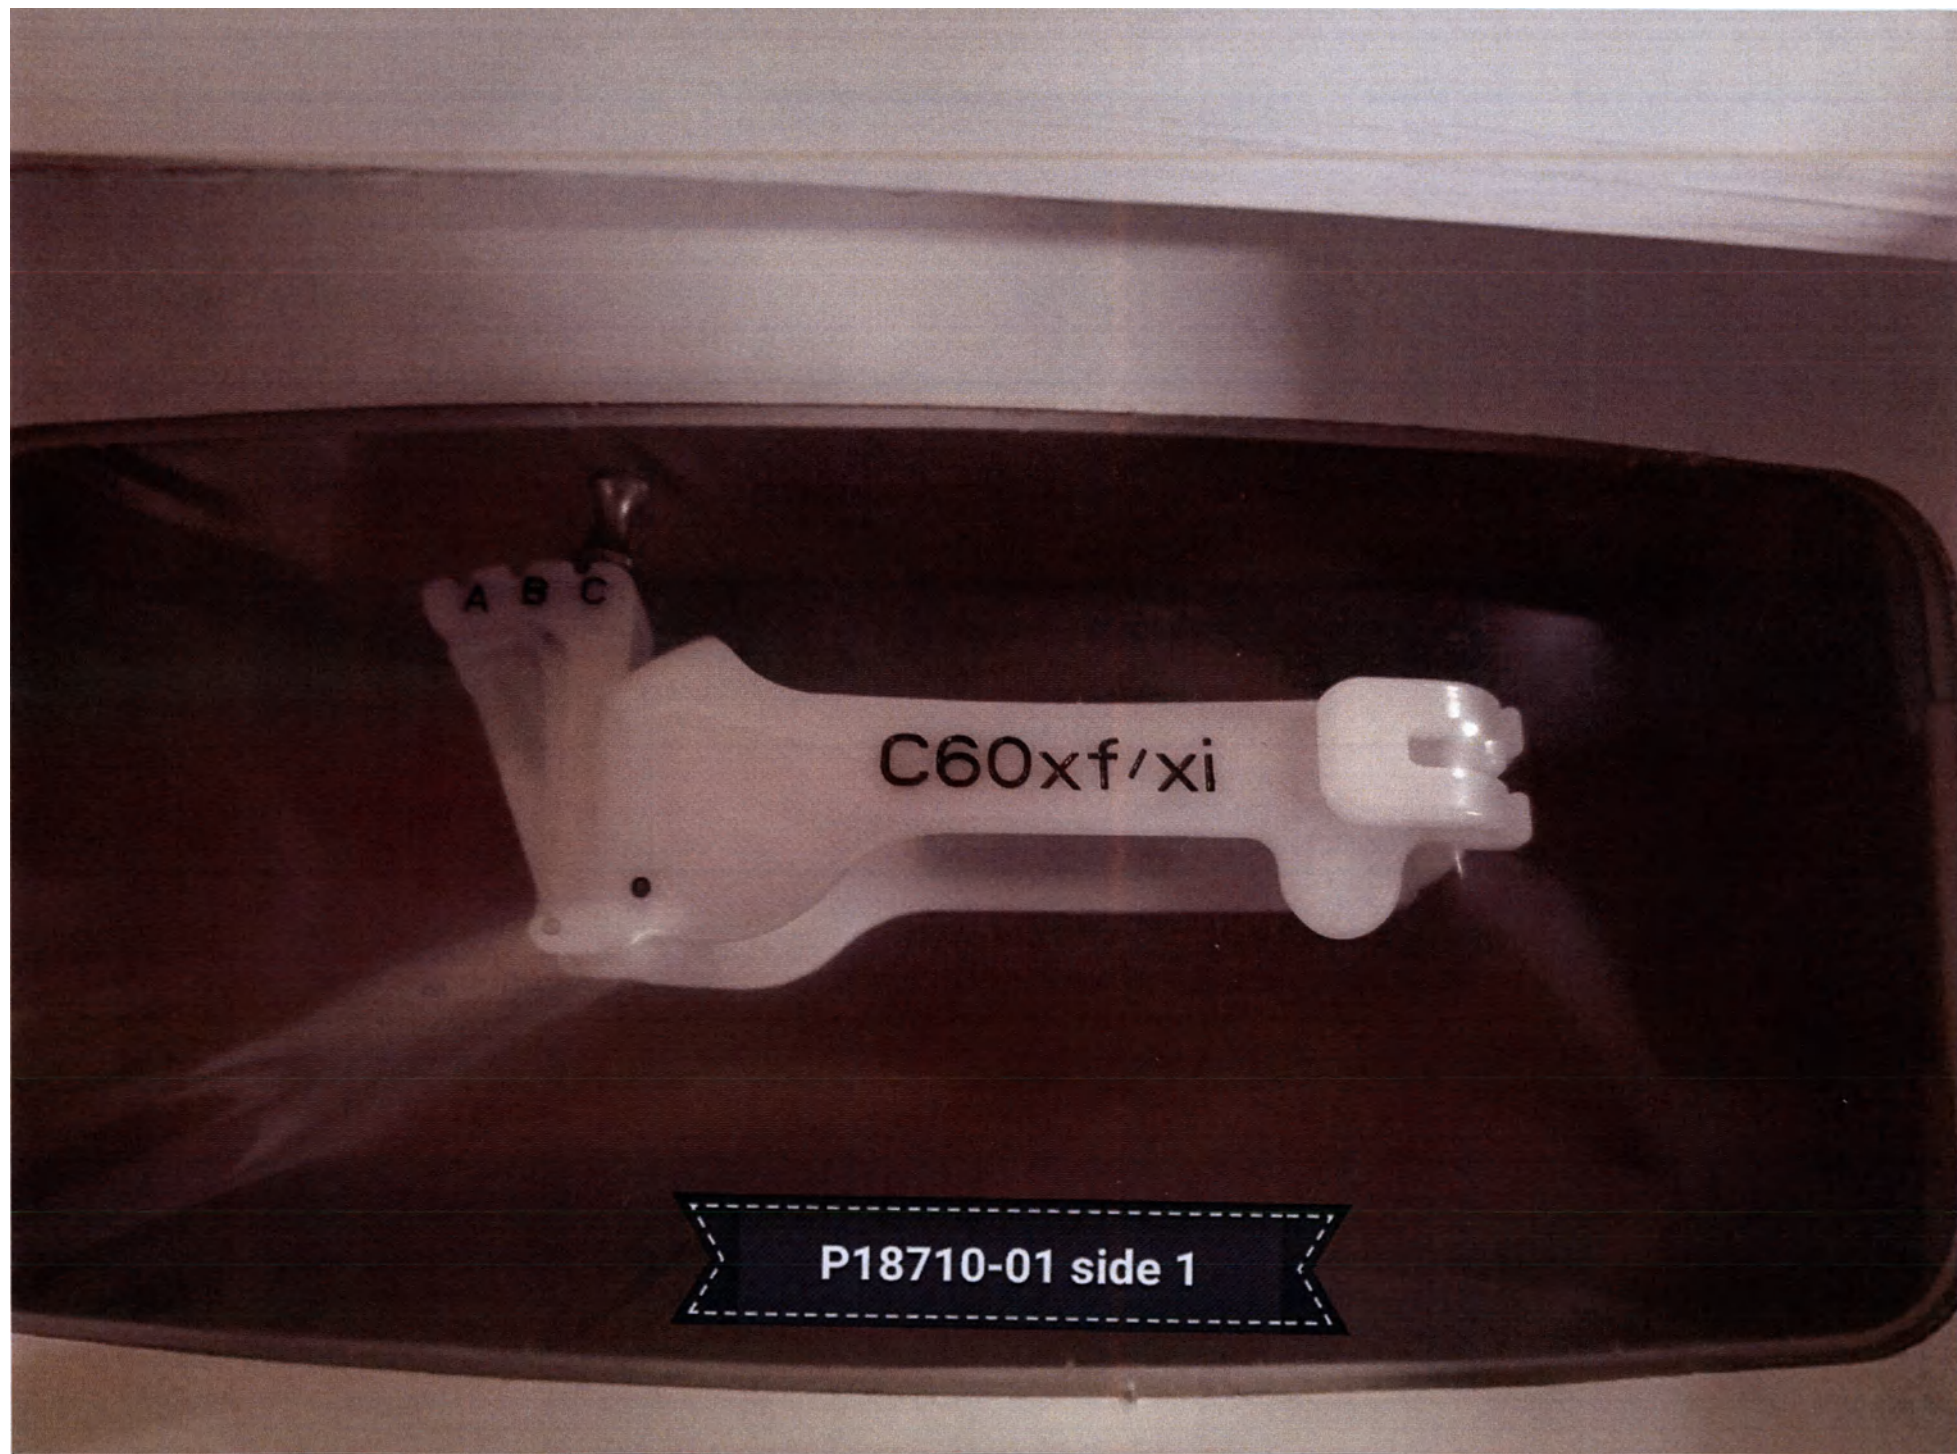



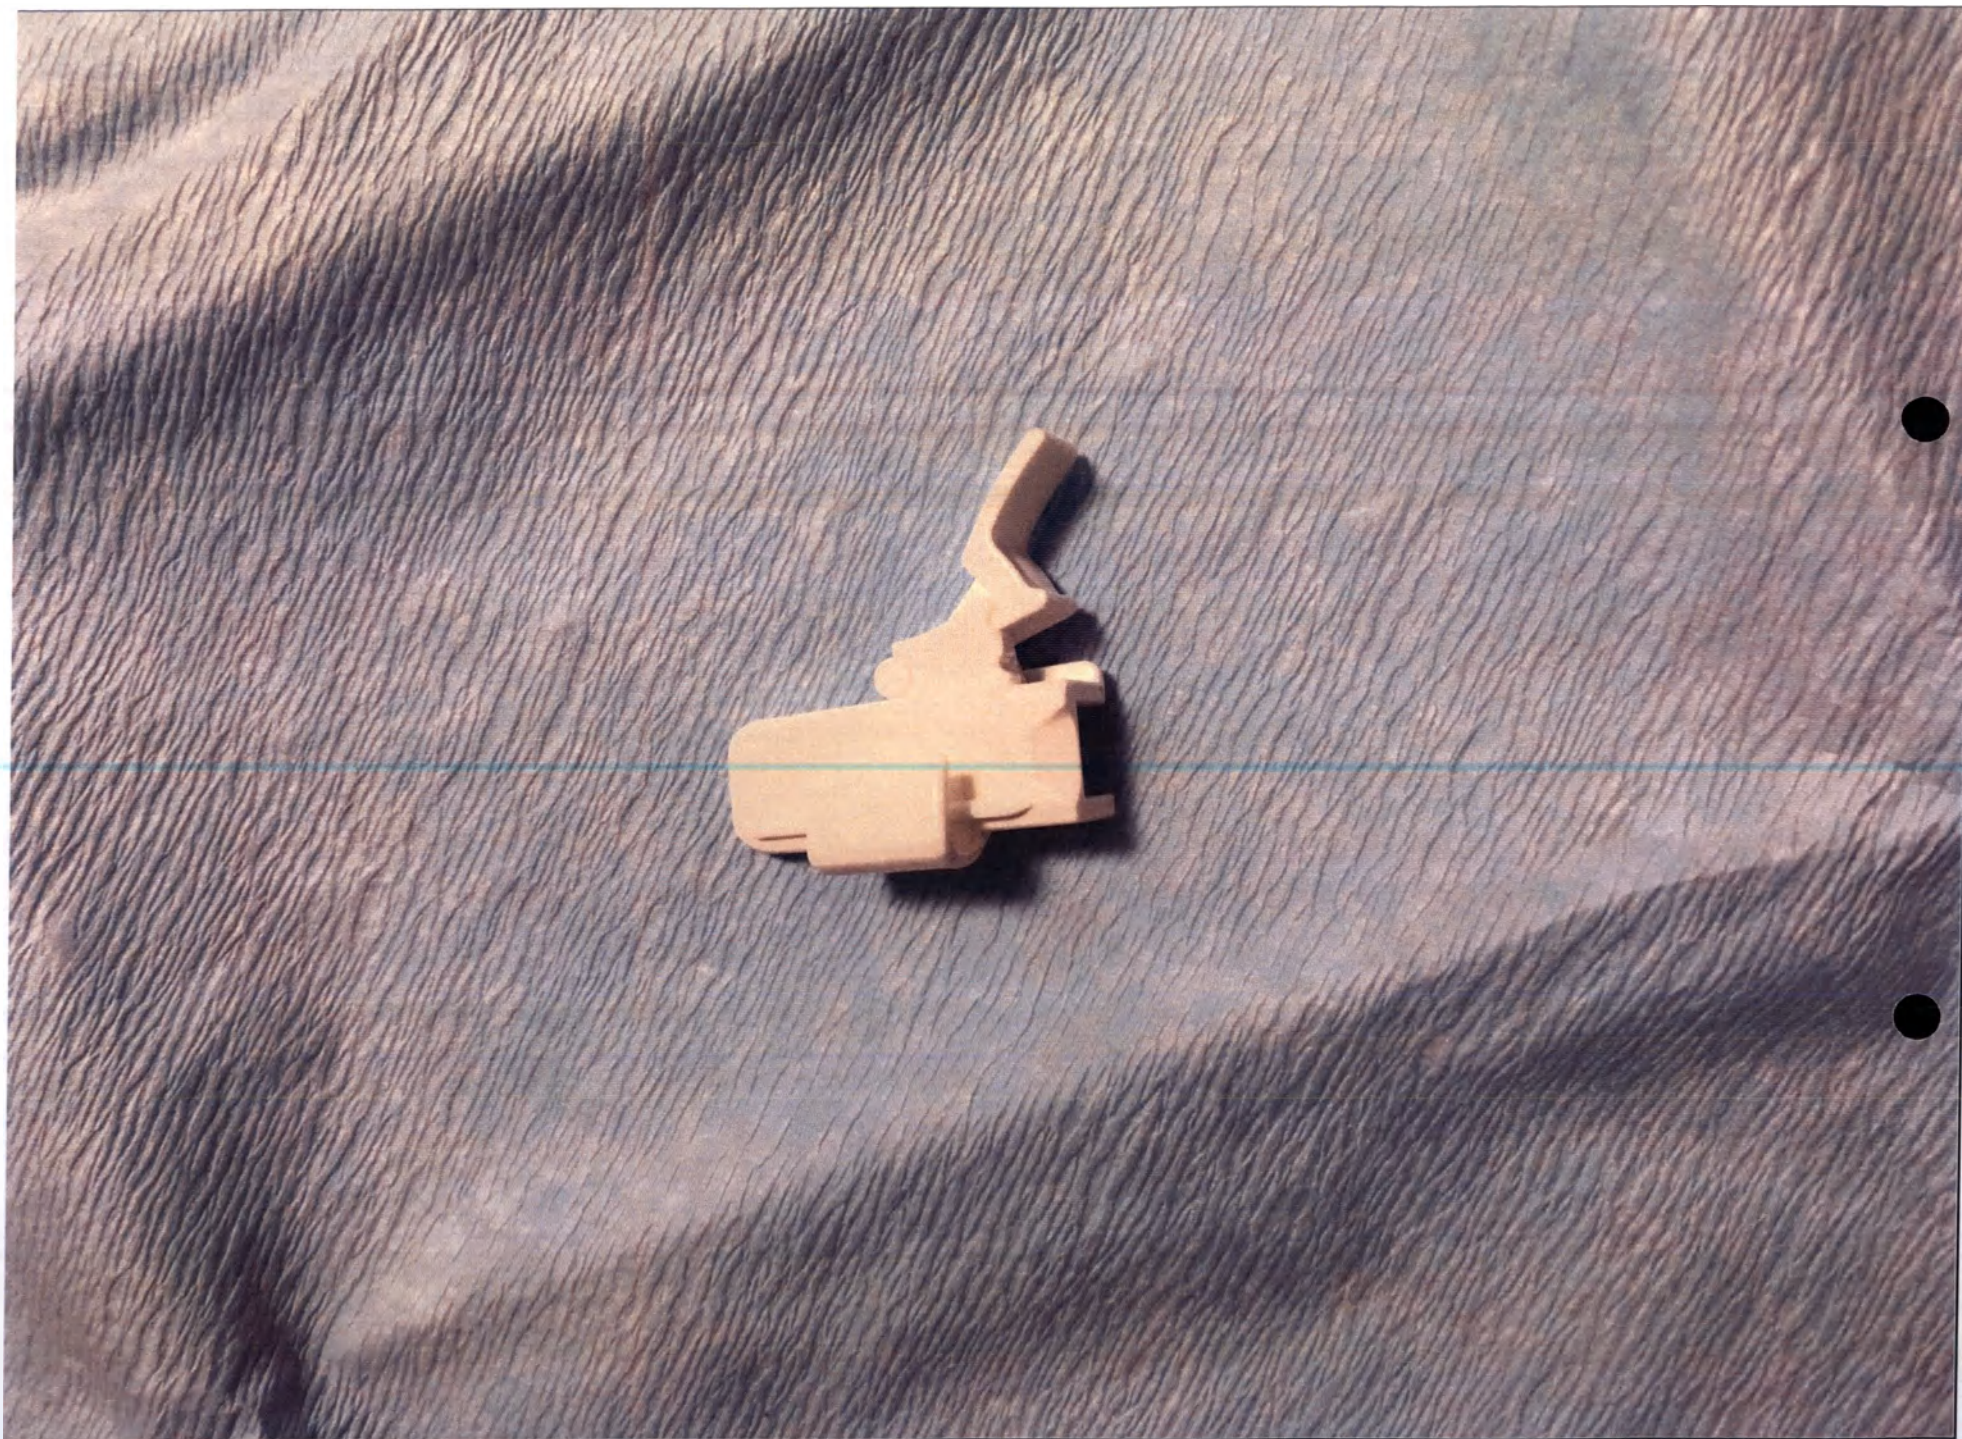


25. Набор биопсийный для датчиков rC60xi, C60x (не более 2 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);







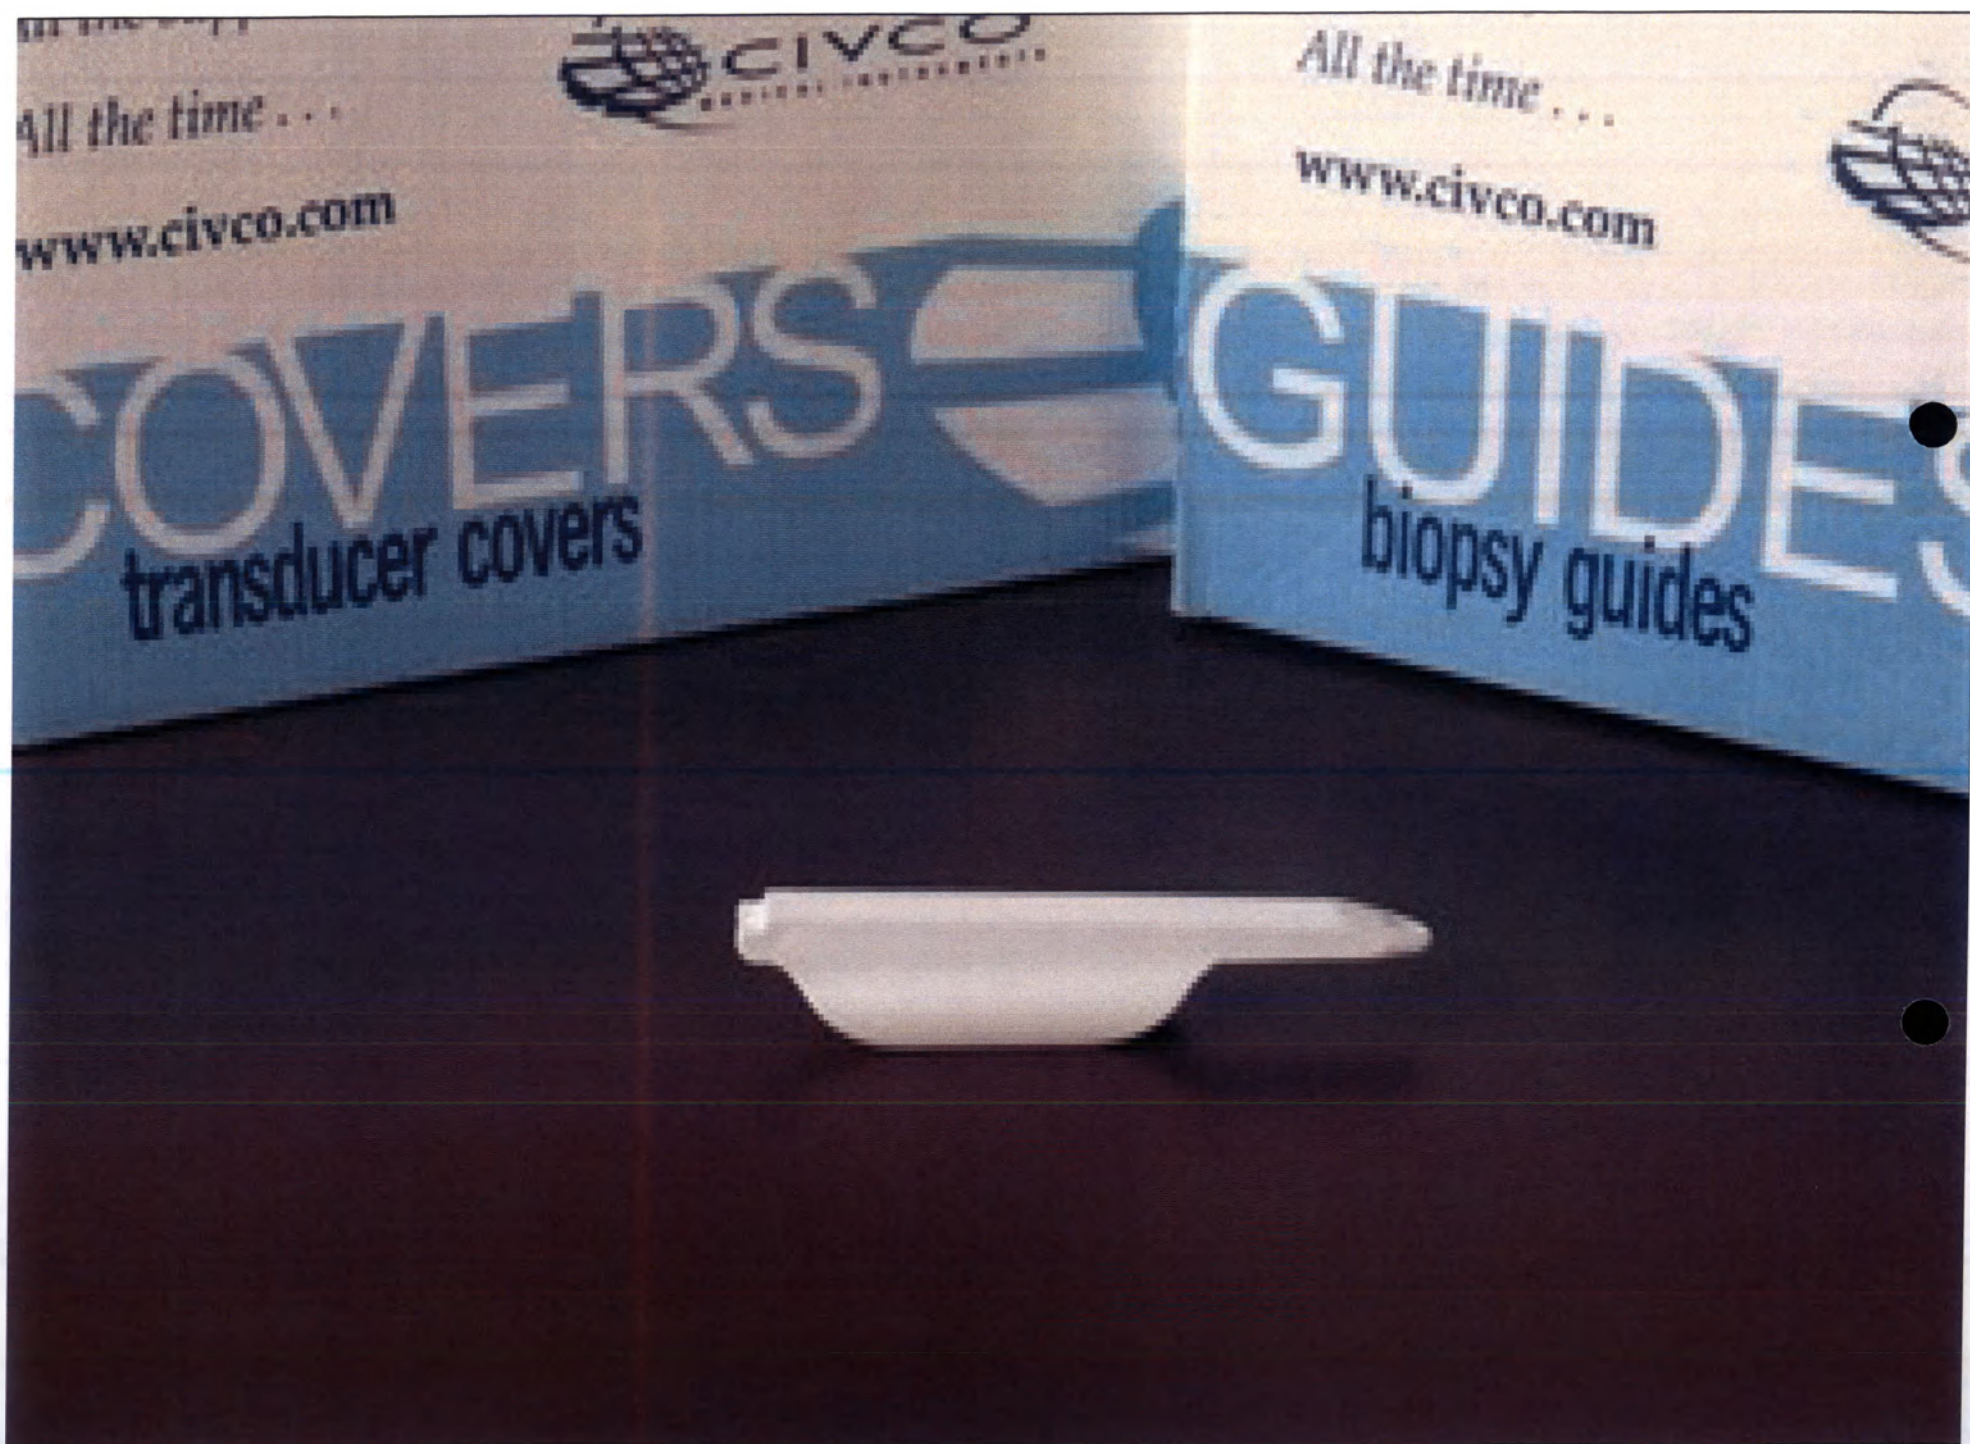

26. Набор биопсийный для датчика ICT (не более 2 шт.): Насадки биопсийные одноразовые (5 шт.);









27. Набор стартовый одноразовый для взятия биопсии для датчика С8 (не более 2 шт.): Насадки биопсийные одноразовые (5 шт.);





27 Набор стартовый одноразовый для взятия биопсии для датчика С8 (не более 2 шт.): Чехлы латексные одноразовые (5 шт.).





28. Набор биопсийный с проводником иглы 18G для датчика L25 (не более 2 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);









28. Набор биопсийный с проводником иглы 18G для датчика L25 (не более 2 шт.): Пакетики с гелем (5 шт.);









29. Набор биопсийный с проводником иглы 21G для датчика L25 (не более 2 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);









29. Набор биопсийный с проводником иглы 21G для датчика L25 (не более 2 шт.): Пакетики с гелем (5 шт.);









30. Набор биопсийный с проводником иглы 22G для датчика L25 (не более 2 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);










30. Набор биопсийный с проводником иглы 22G для датчика L25 (не более 2 шт.): Пакетики с гелем (5 шт.);







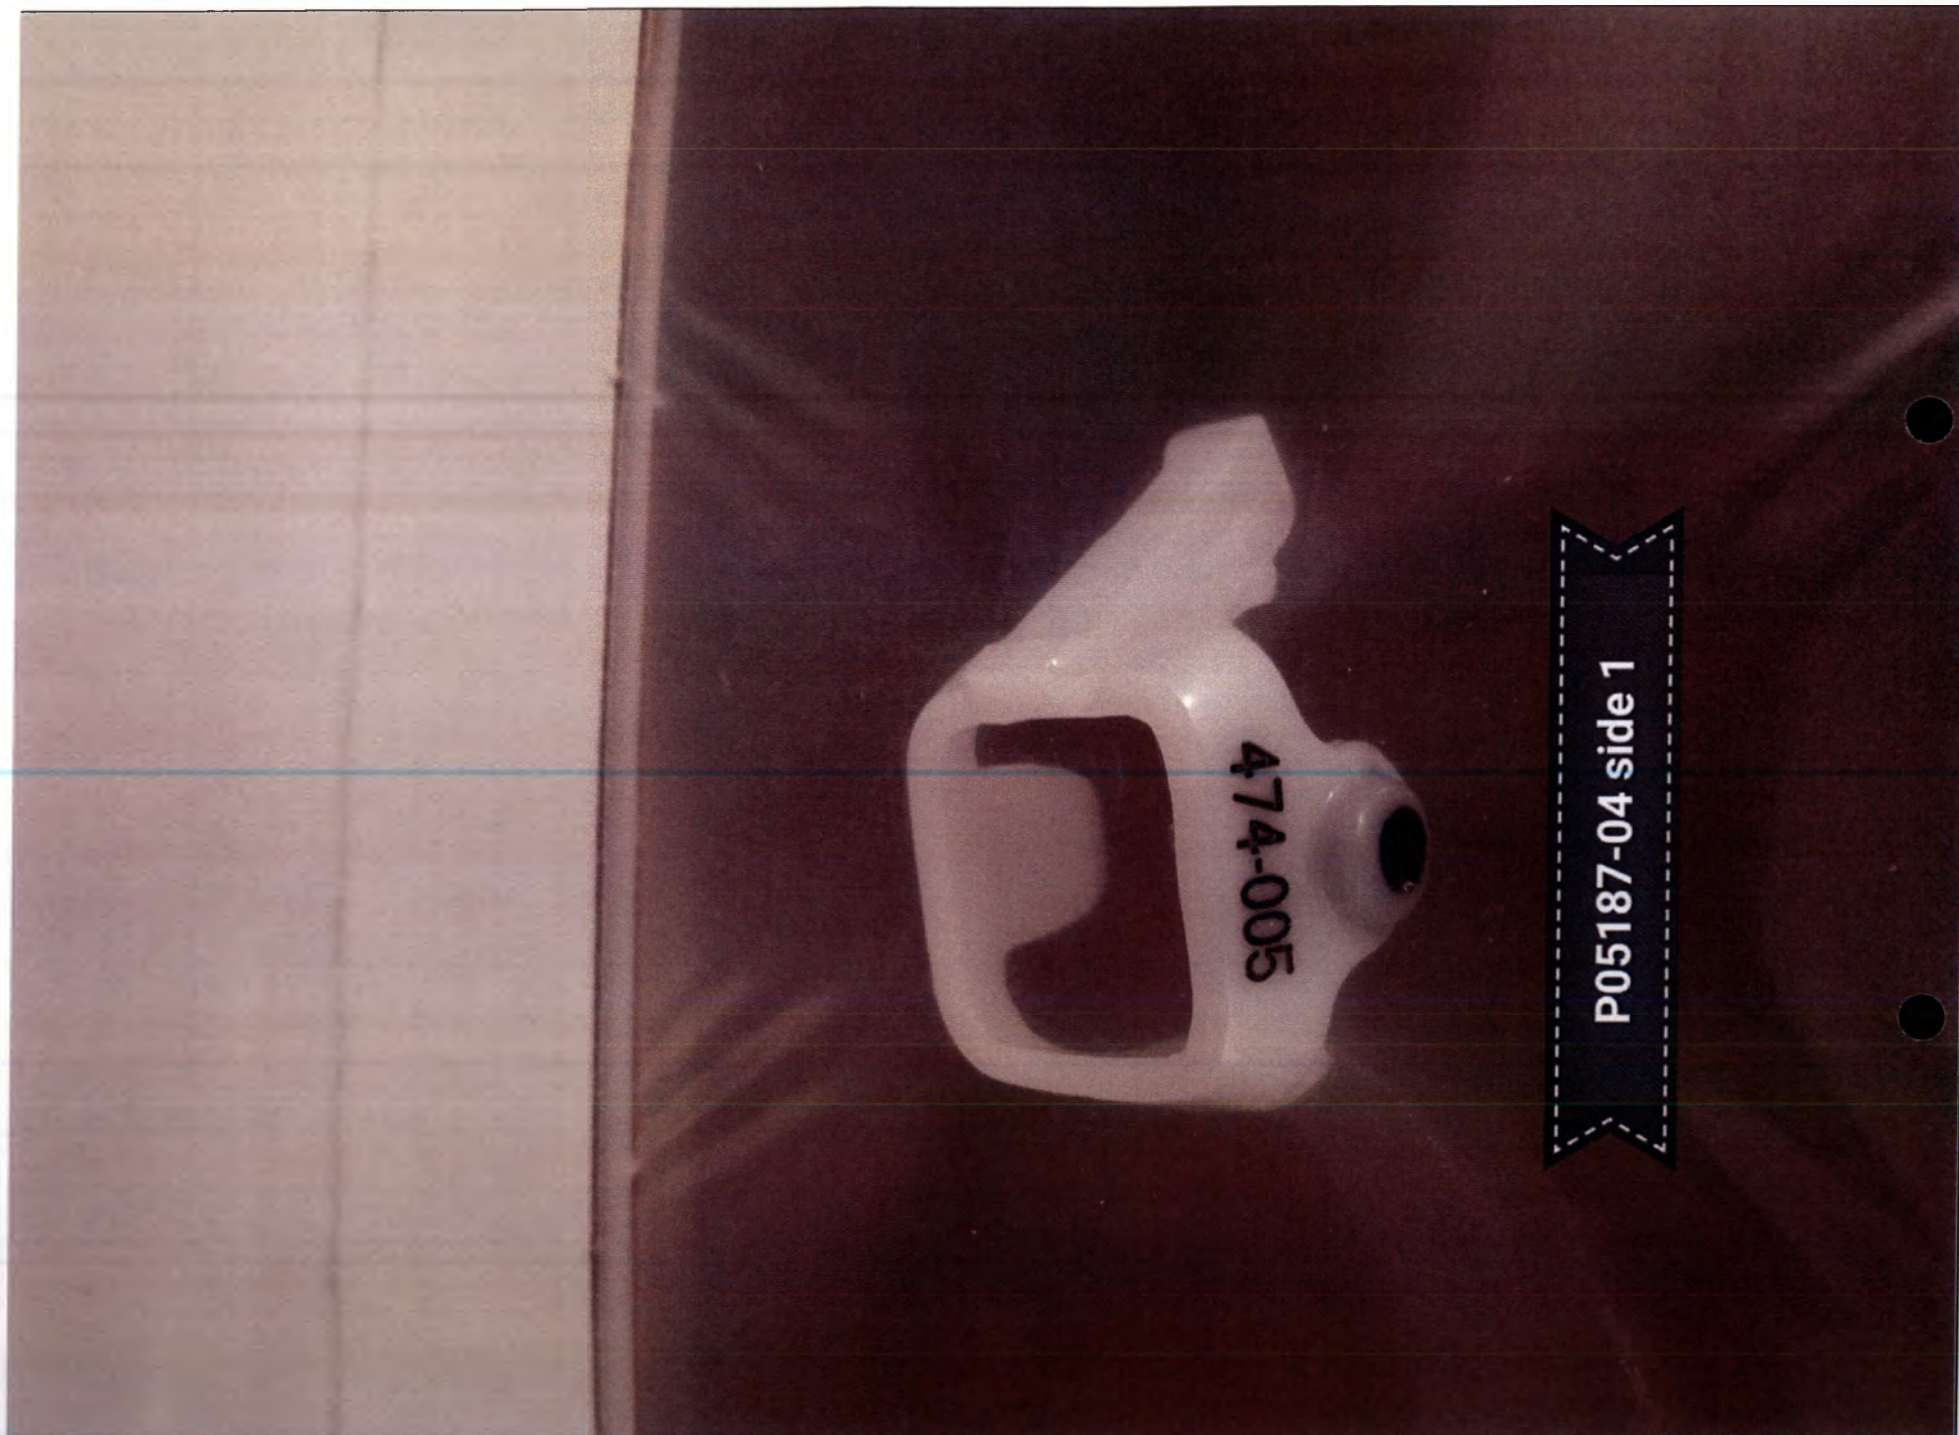

31. Набор биопсийный стартовый для датчика P21/5-1 (не более 5 шт.): Насадка биопсийная;











31. Набор биопсийный стартовый для датчика P21/5-1 (не более 5 шт.): Чехлы латексные одноразовые (5 шт.).



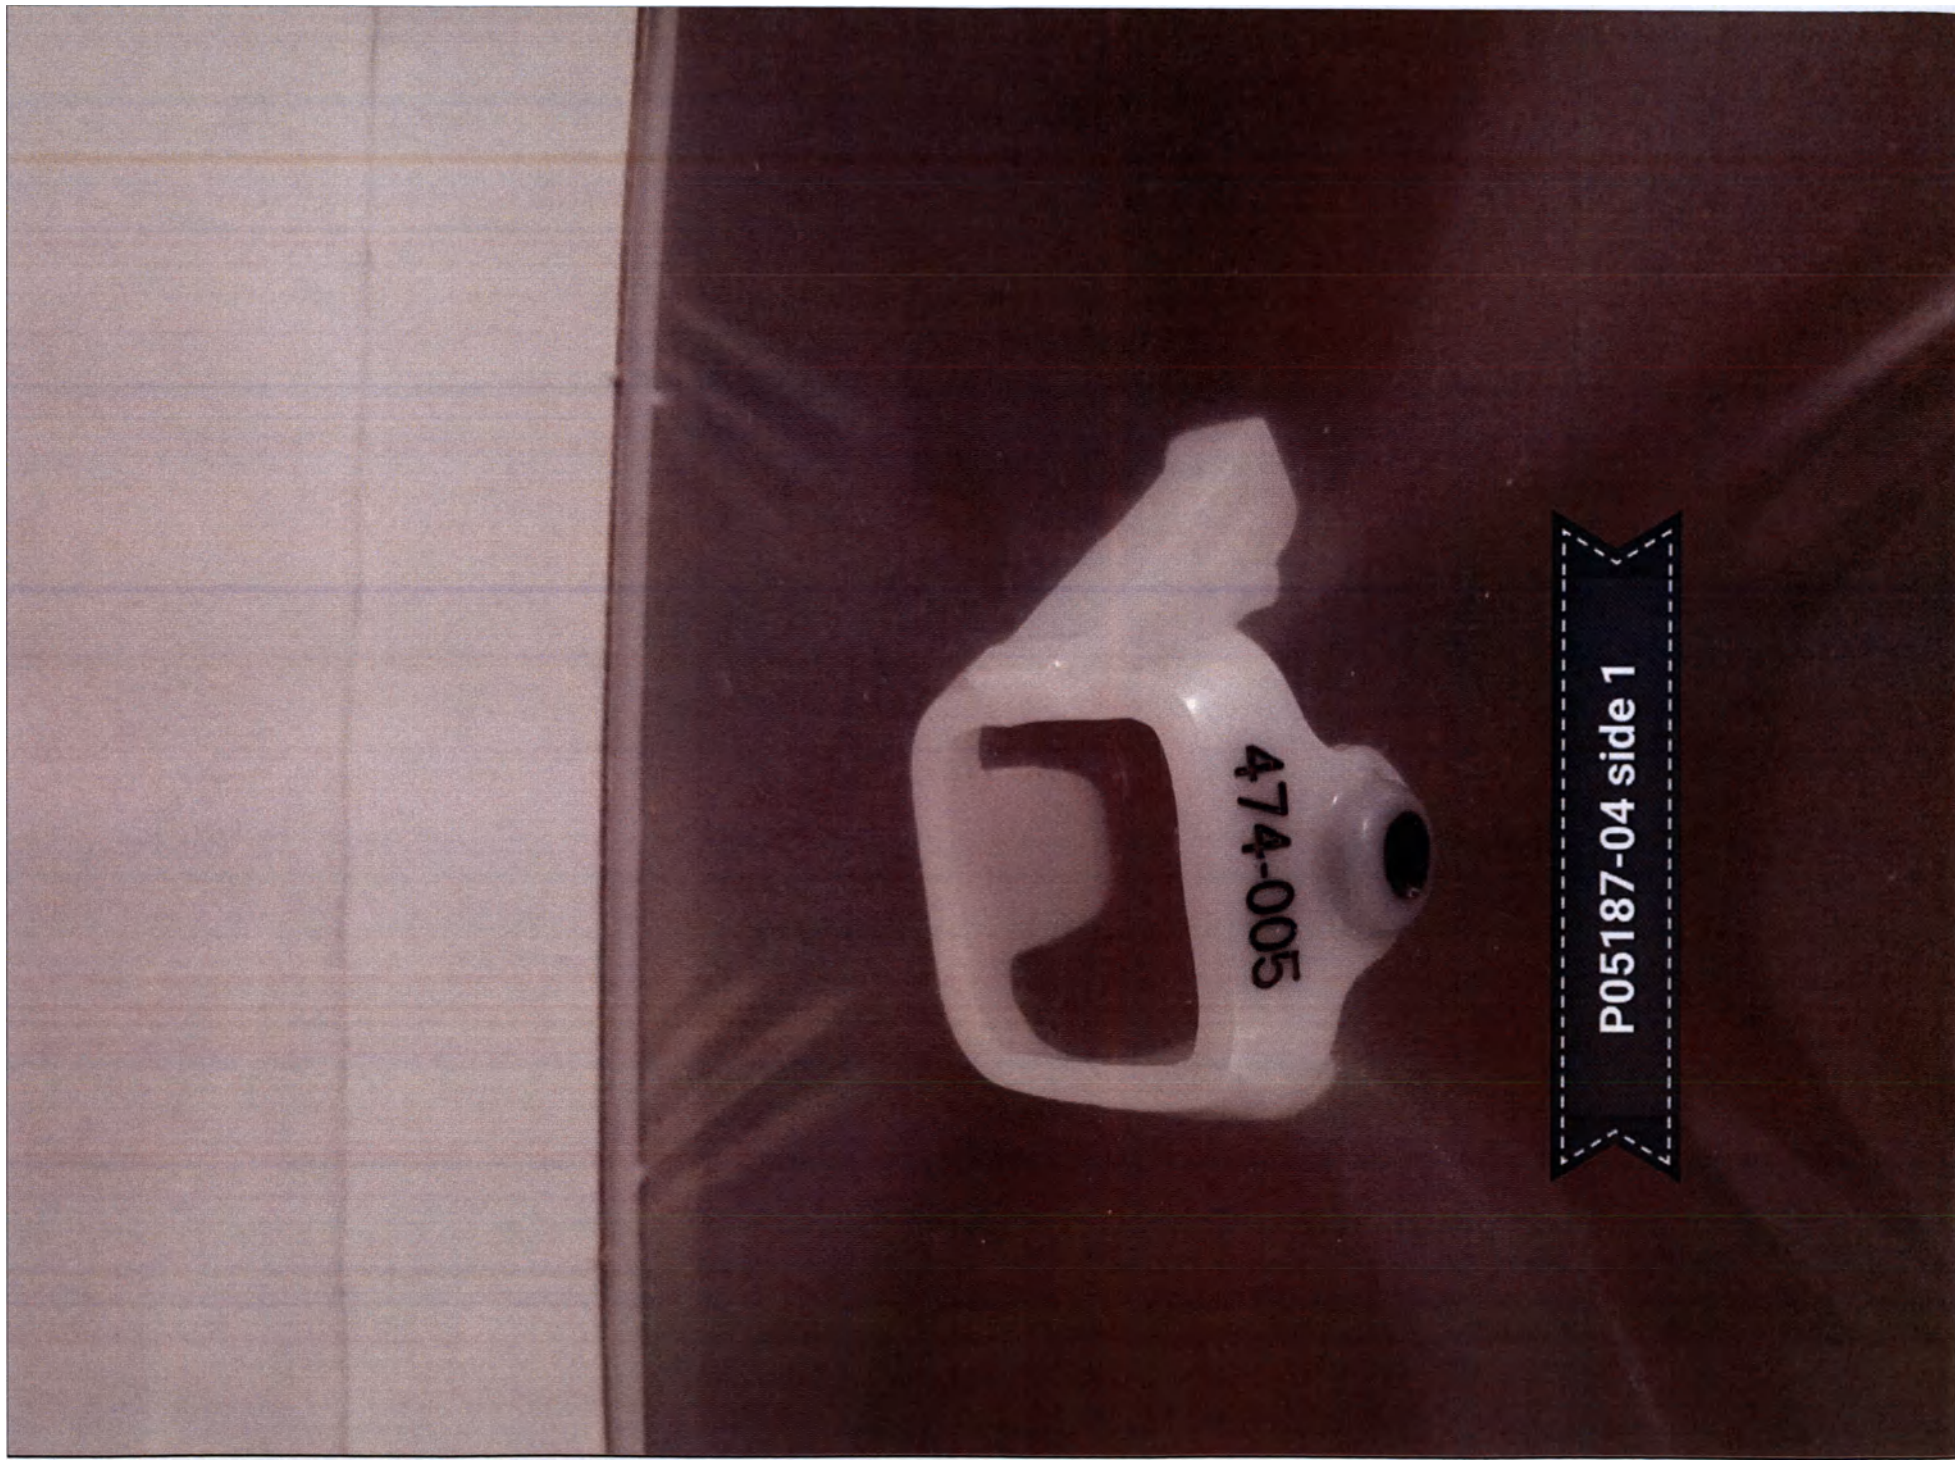



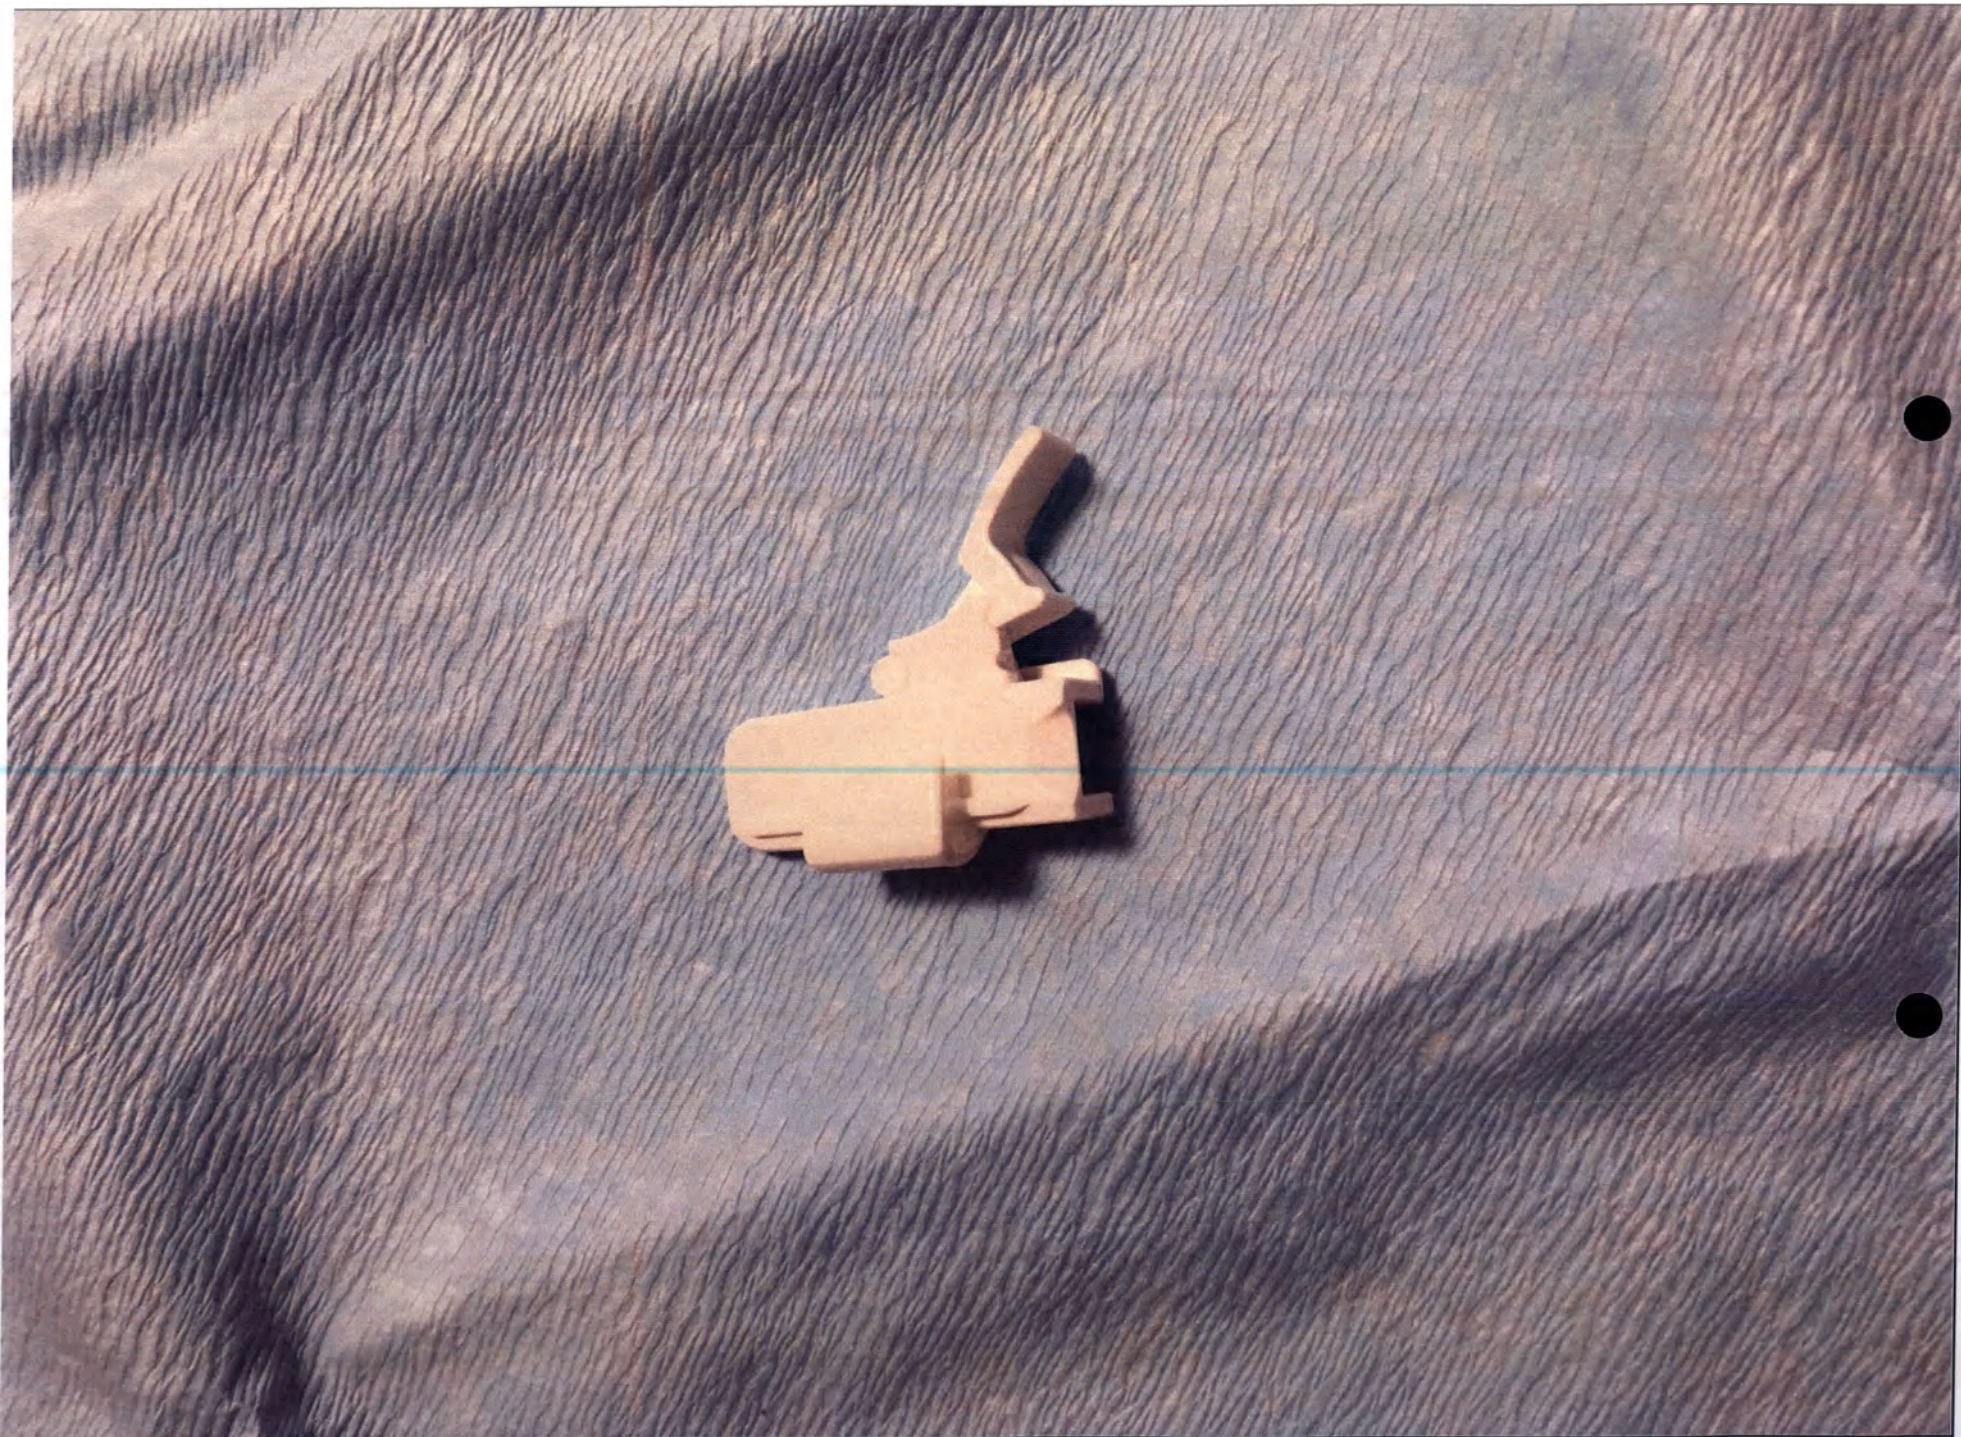

32. Набор биопсийный стартовый для датчика P10 (не более 5 шт.): Проводники для игл одноразовые (5 шт.);









33. Программное обеспечение для передачи и обработки ультразвуковых изображений (не более 4 шт).





24. Переключатель ножной.





35. Видеопринтер медицинский для печати ультразвуковых изображений.









37. Футляр защитный для транспортировки аппарата.





38 Стойка мобильная для размещения аппарата ультразвукового.





39. Блок присоединения трех датчиков.





















44 Расширяемая аккумуляторная батарея для стойки.




















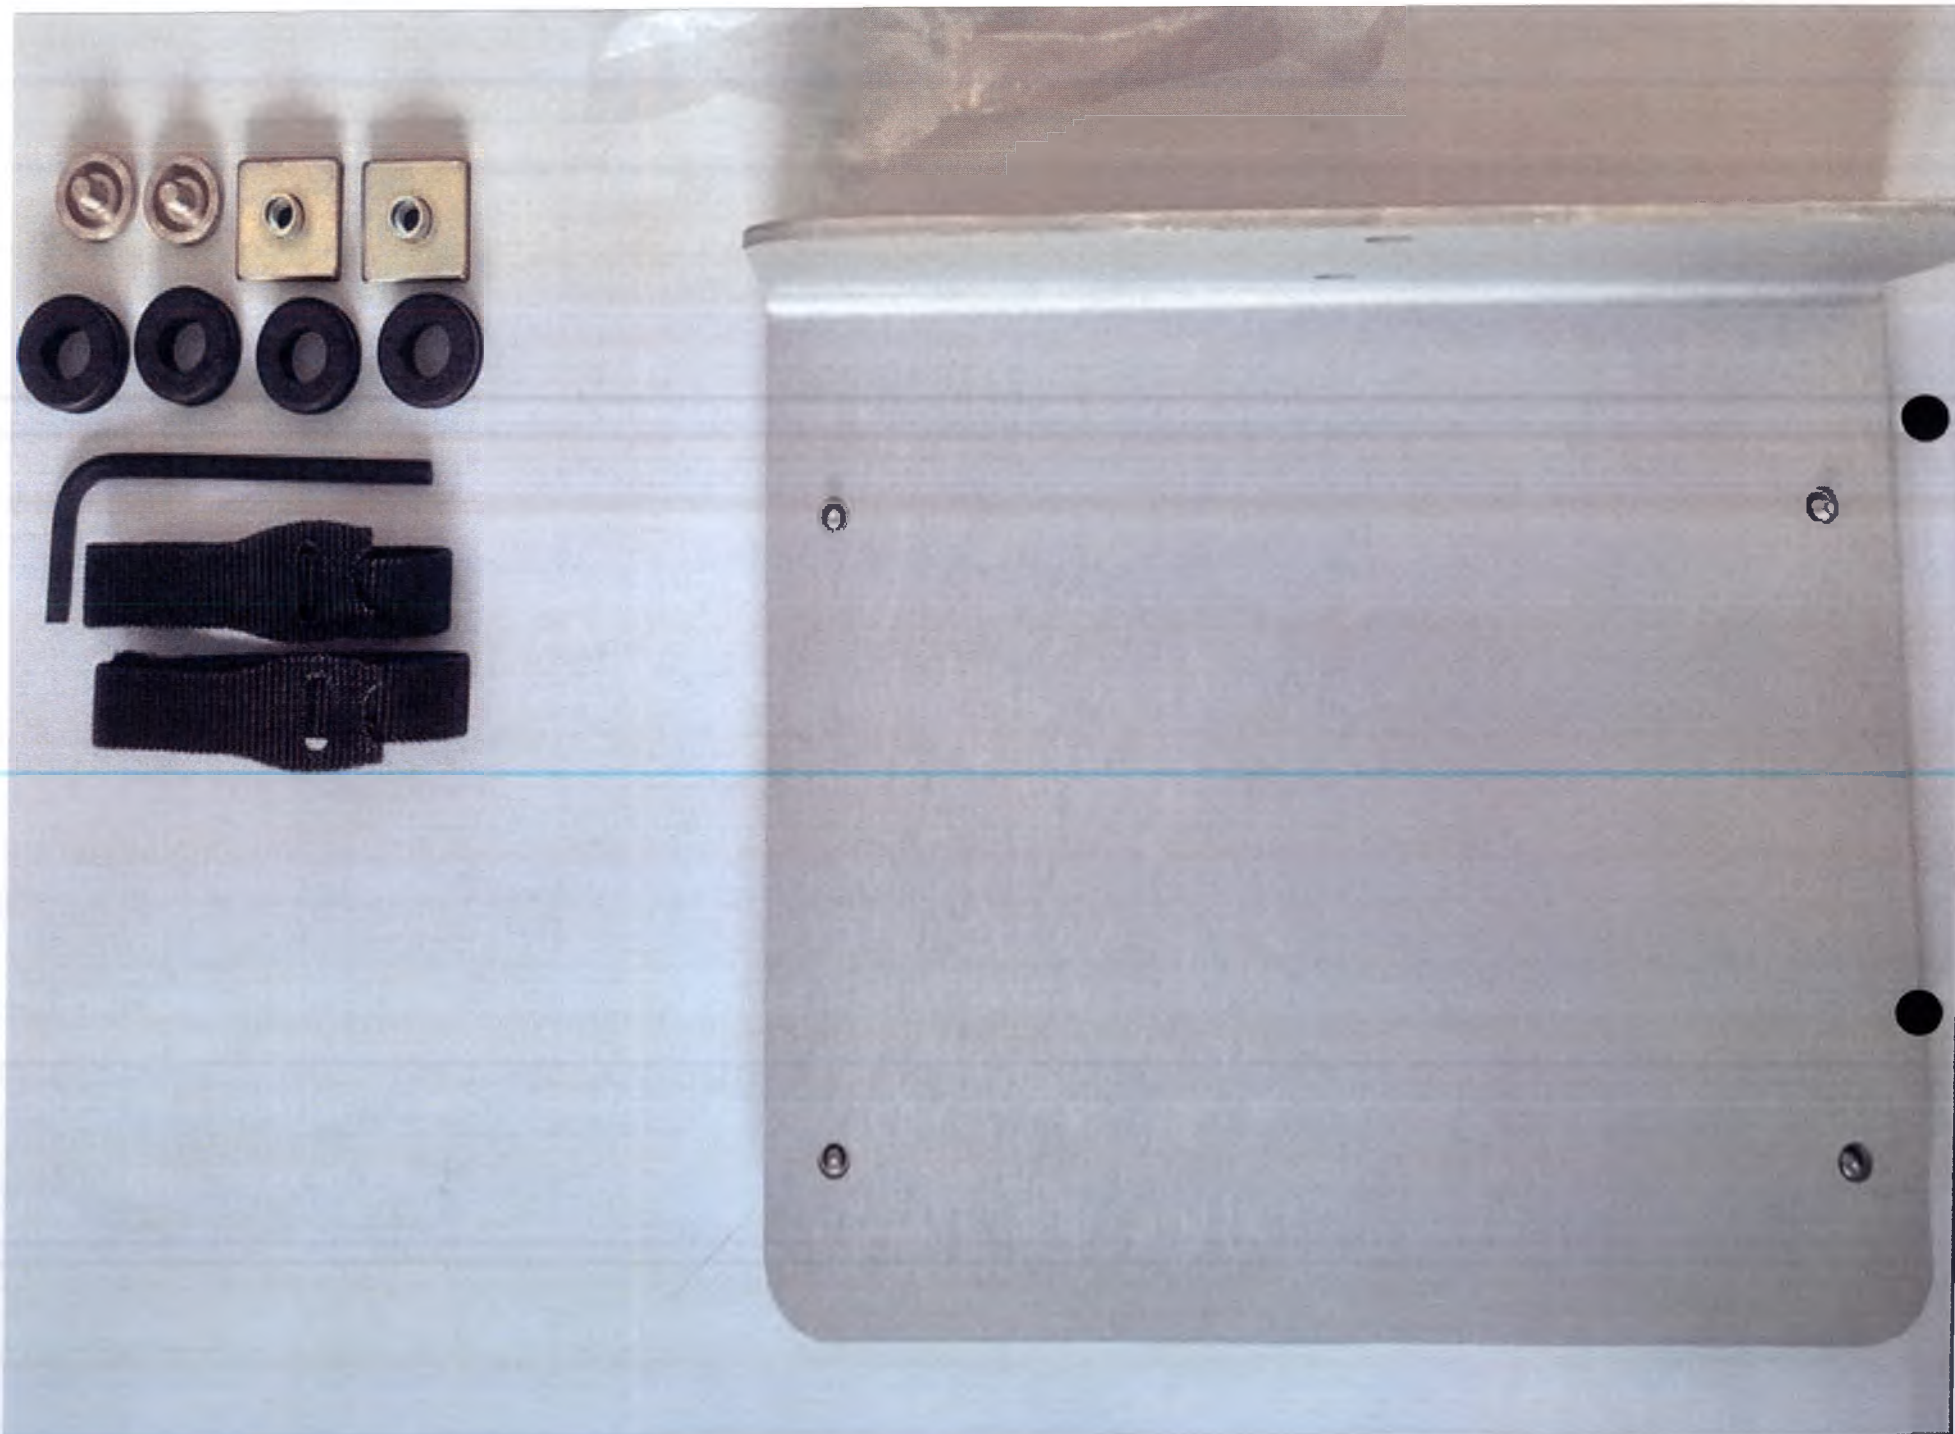





# **Printer Installation Instructions** **SonoSite** **Contents** See also "Cables and connectors" on page 1 **Black & white printer**

## **Overview**


The instructions describe assembly and installation of the following products:

| Product               | Stand installed on |
|-----------------------|--------------------|
| Black & white printer | Edge™ Stand        |

- Edge™ Stand
- Universal Stand

Each product is packaged separately. If installing multiple products on the stand, you may receive duplicate tools, rods and instructions across kits. Please disregard any duplicates.

Install products in the order listed on the enclosed insert. Installation sequence of products on the stand.

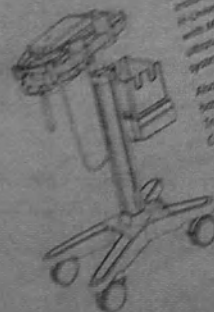

Black & white printer, printer installed on all "Universal" stand with M-Servo ultrasonic system. Also picture, holder and "Tape Connect".

## **Contents**

### **Black & white printer**

| Description         | Illustration |
|---------------------|--------------|
| Nut plate (2)       |              |
| Accessory screw (2) |              |
| Velcro strap (1)    |              |

### **Color printer**

| Description                            | Quantity | Illustration |
|----------------------------------------|----------|--------------|
| Mounting shelf (2)                     |          |              |
| Adapter plate (2)                      |          |              |
| Card catch (4)                         |          |              |
| Nut plate (2)                          |          |              |
| Accessory screw (2)                    |          |              |
| M5-S x 8 Phillips screw, flat head (4) |          |              |
| Velcro strap (3)                       |          |              |













Генеральный директор  
ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС»  
Кеничи Танака



ПРОШИТО И СЪЕДИНЕНО  
ЛИСТА (ЗВ) 44

