

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов

«» 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**АНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО И ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА «ВитаЛайн 200» (VitaLine 200)
ПО ТУ 26.60.12-004-94568735-2018**

**Фото 1. Анализатор автоматический для биохимического и
иммунотурбидиметрического анализа
«ВитаЛайн 200» (VitaLine 200). Общий вид**



Фото 2. Плавкий предохранитель



Фото 3. Кабель последовательной передачи данных

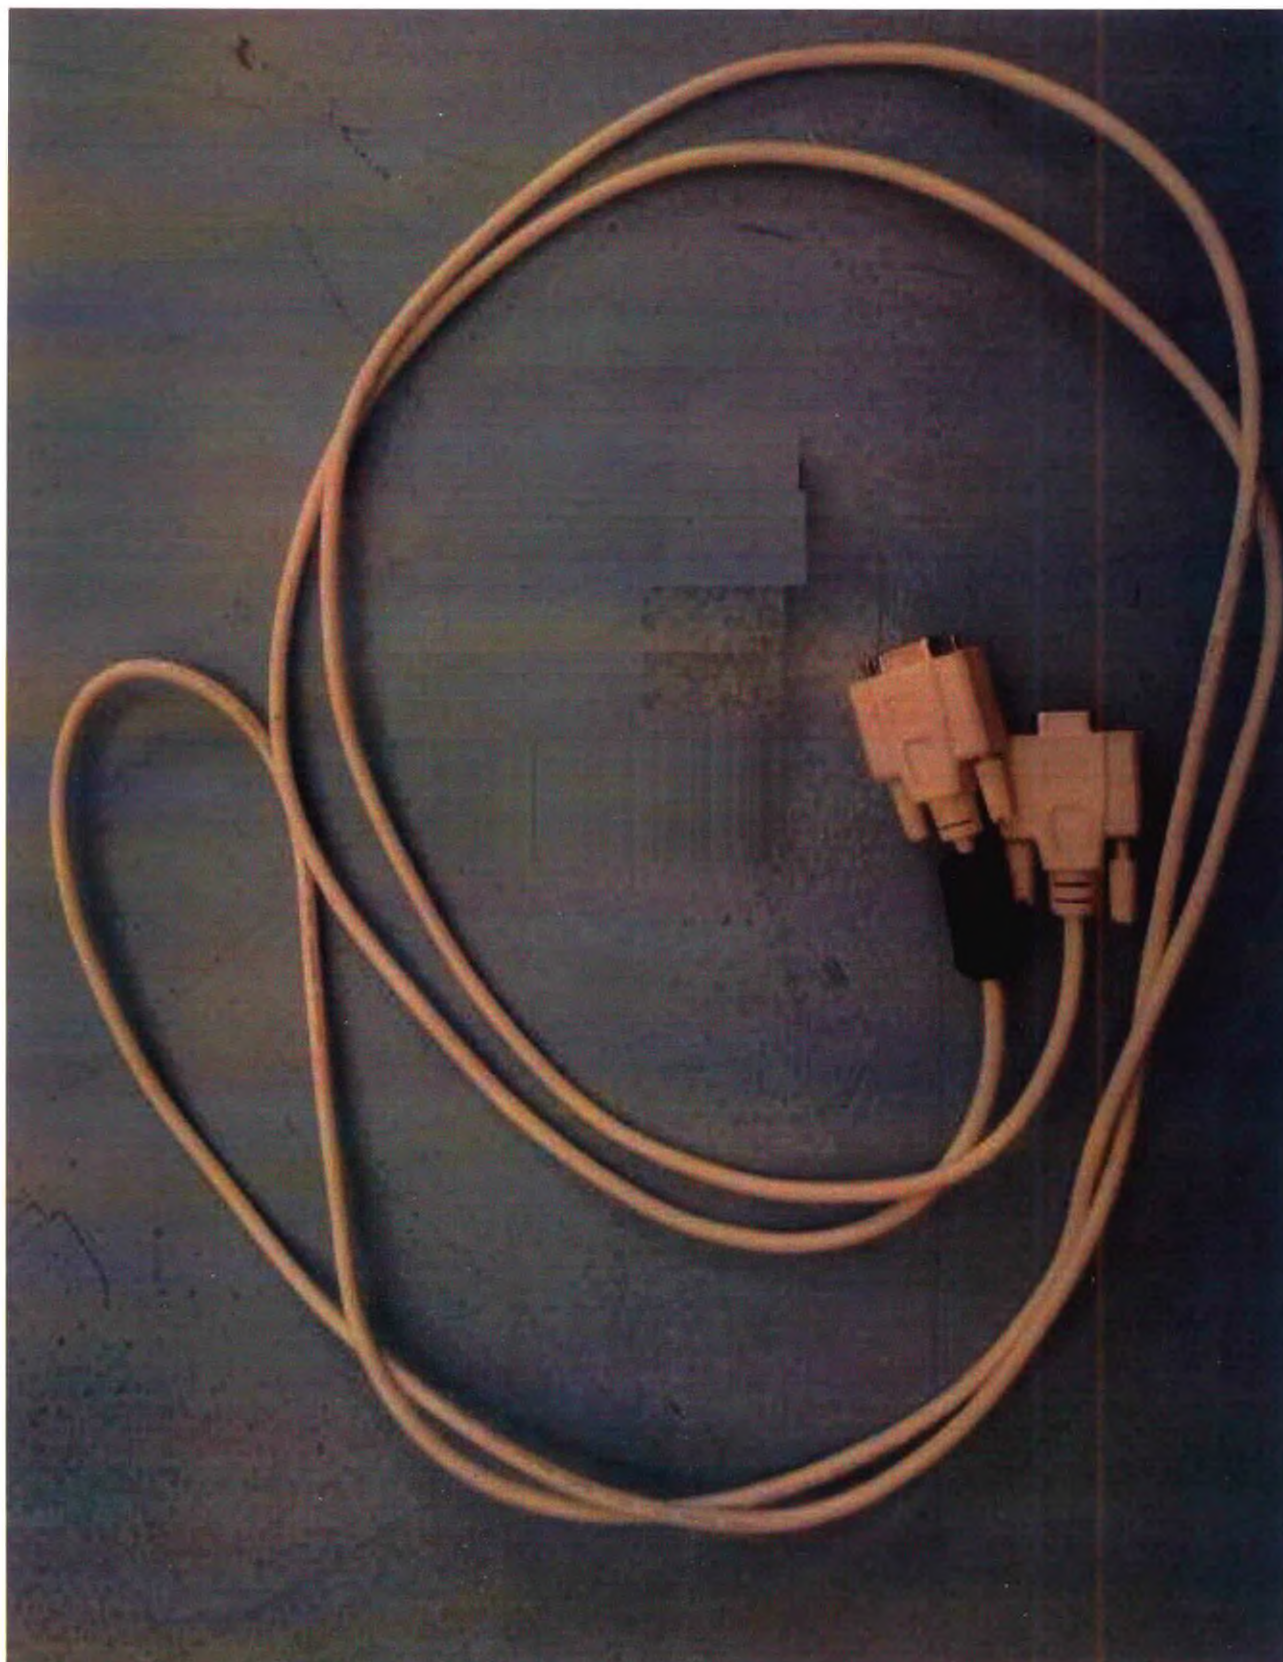


Фото 4. Лампа



Фото 5. Кабель питания

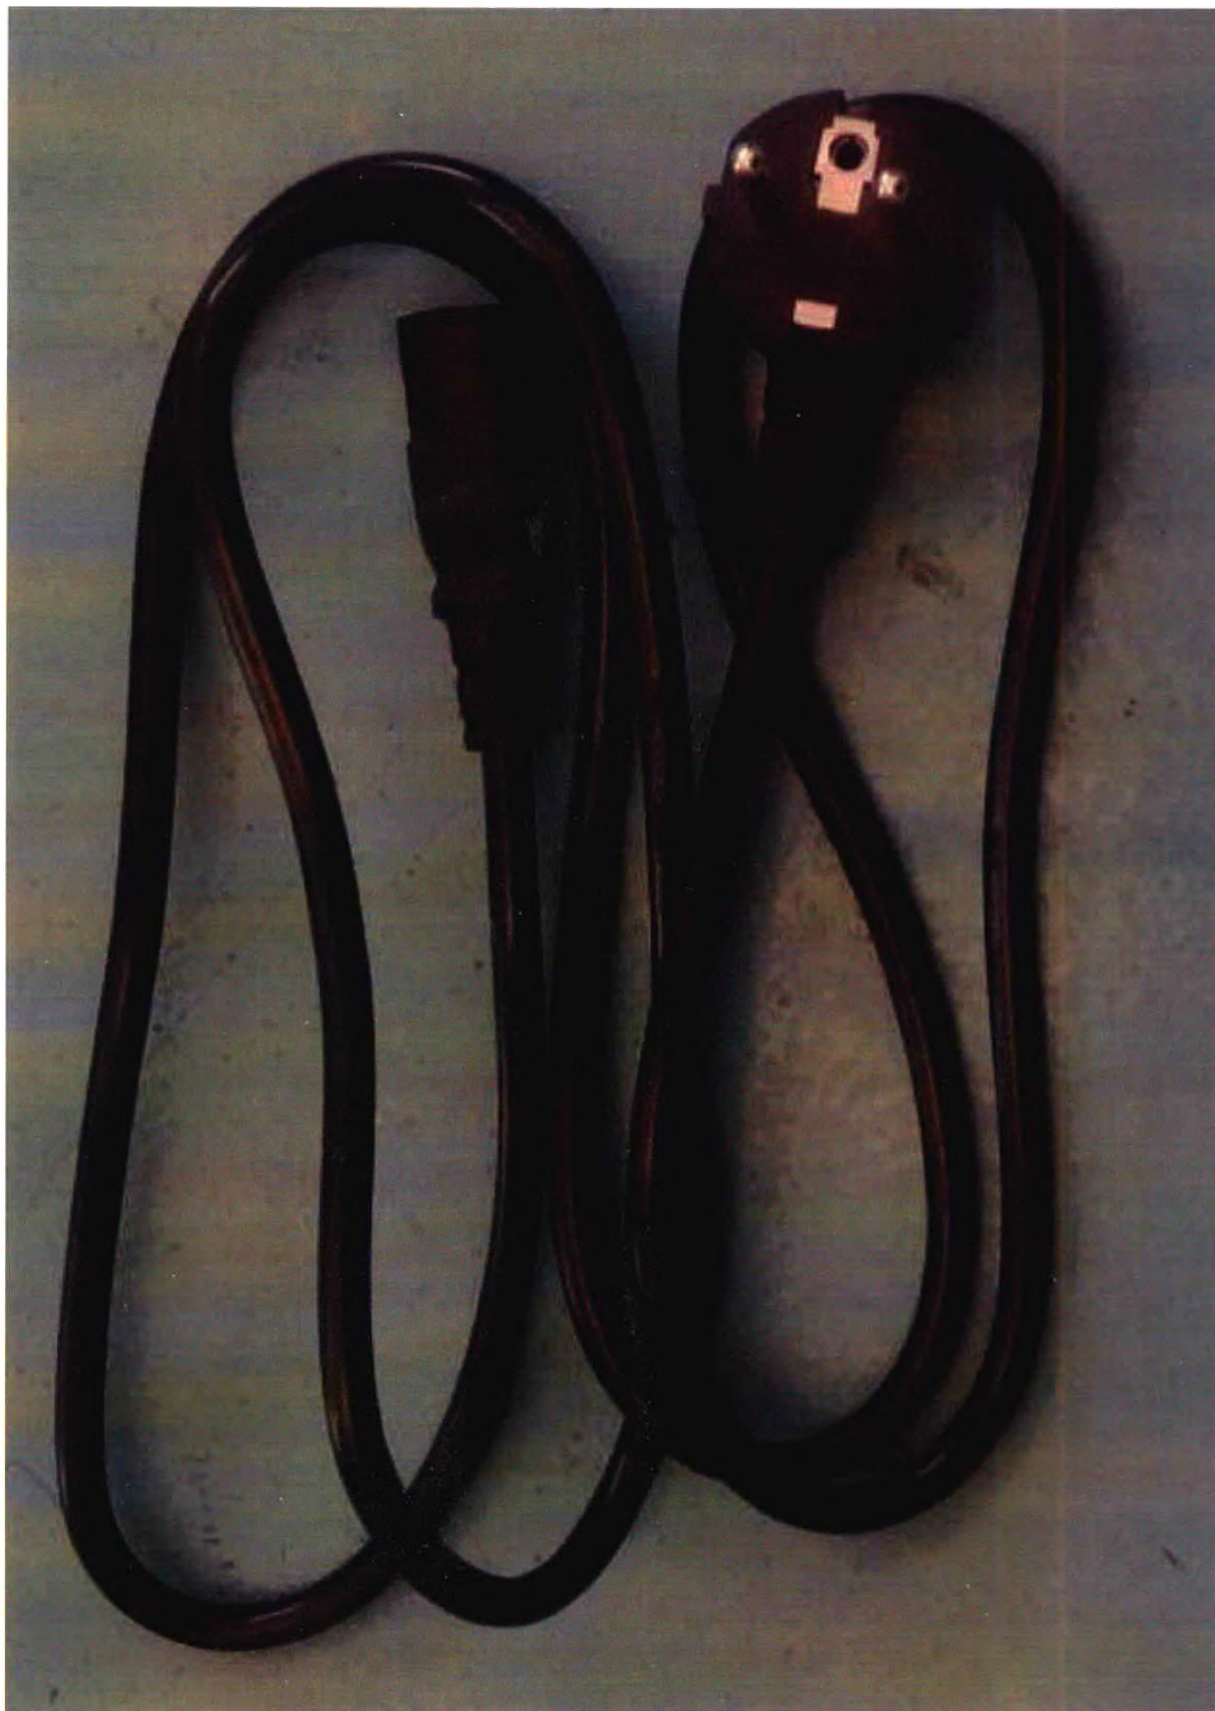


Фото 6. Кабель заземления

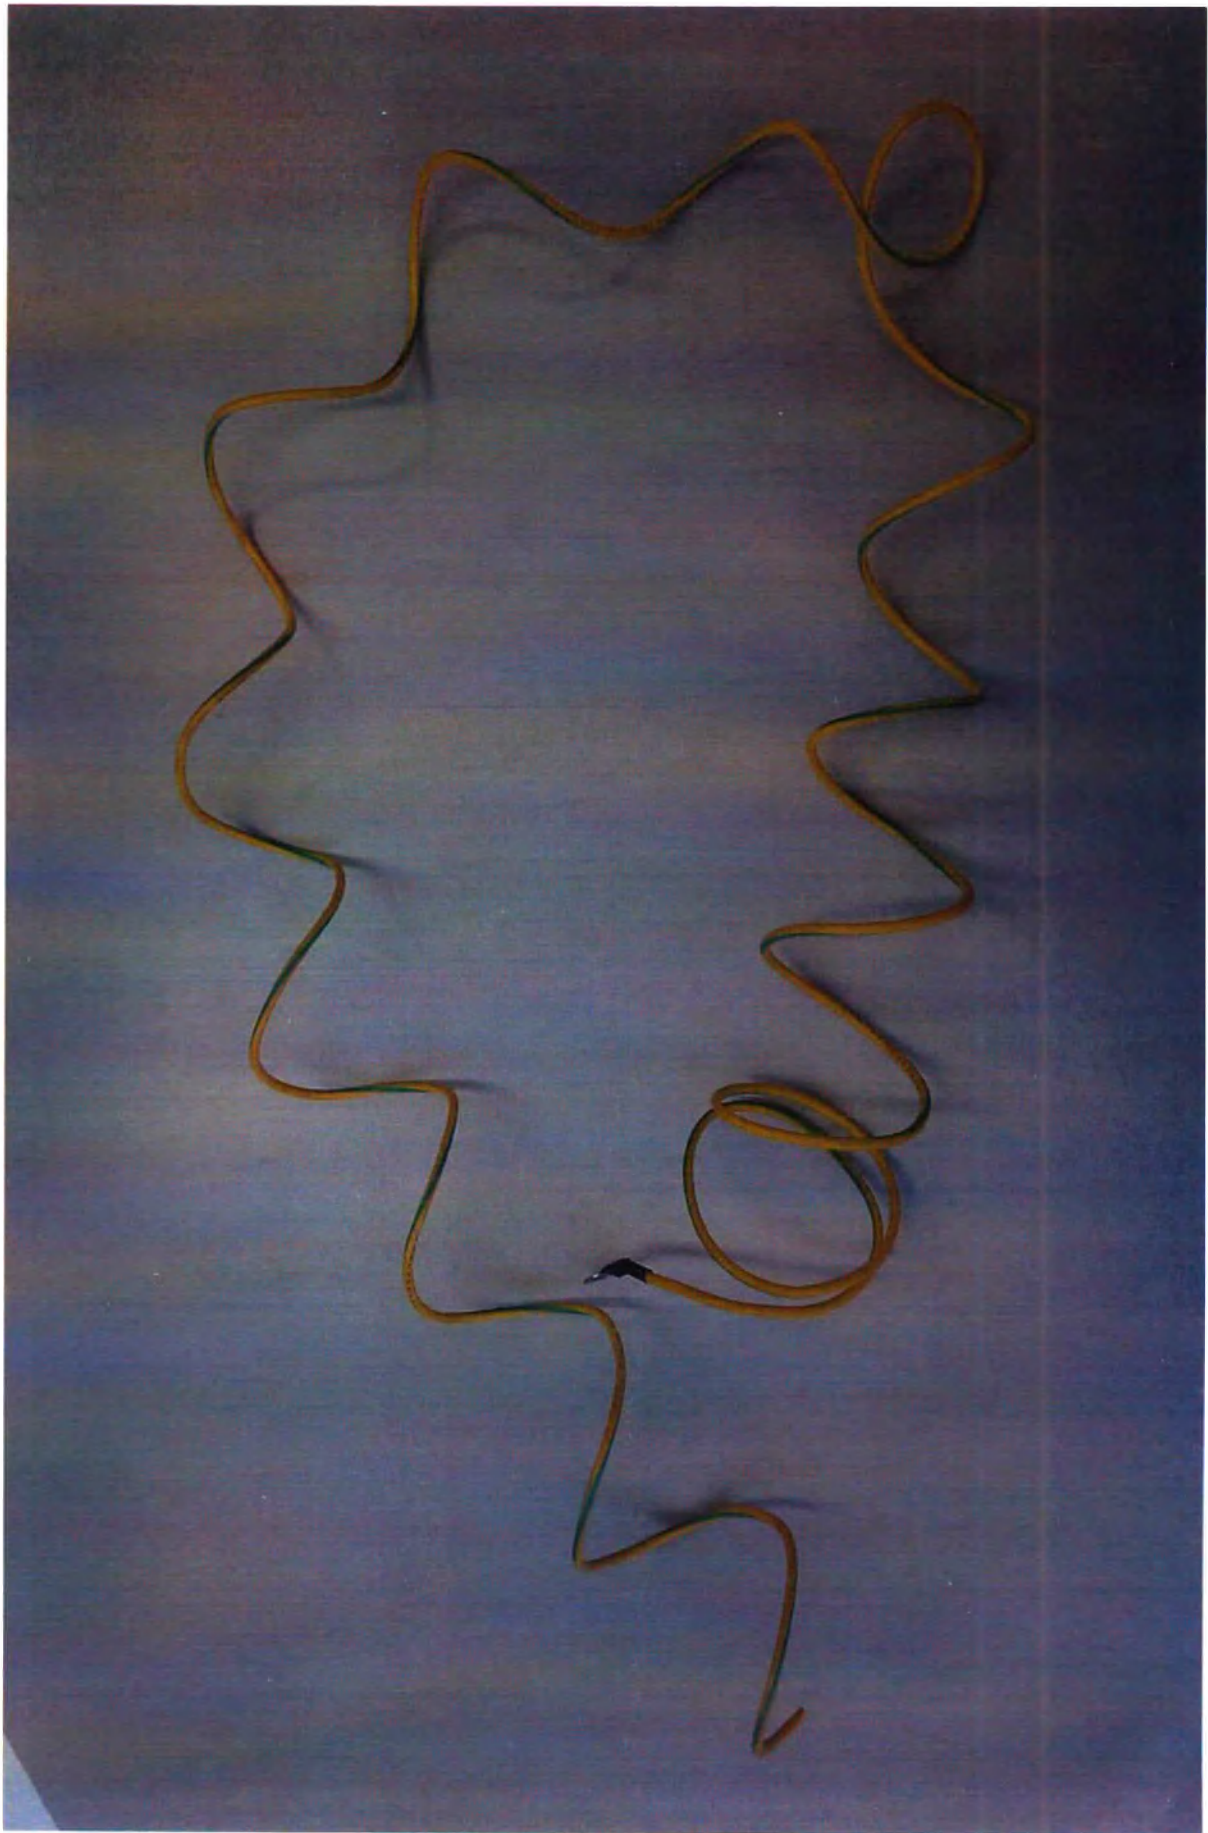


Фото 7. Флаконы для реагентов 18 мл

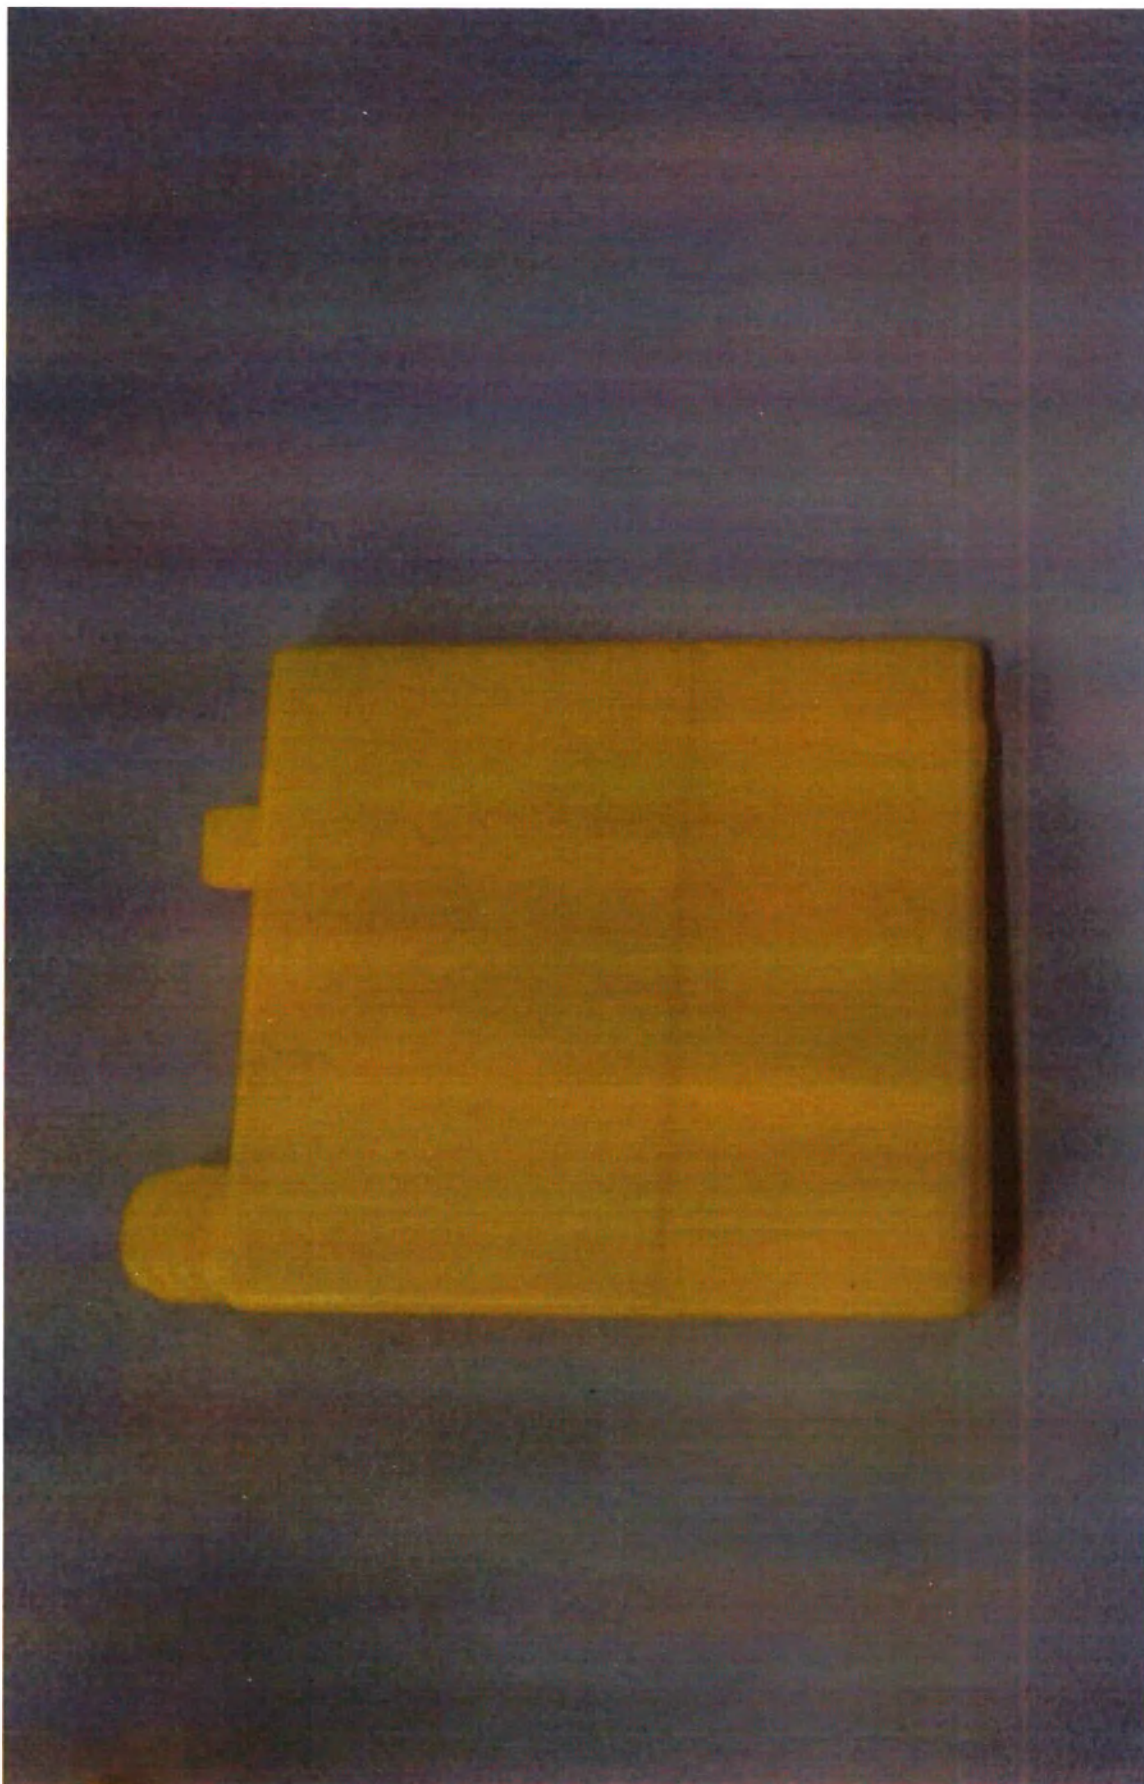


Фото 8. Флаконы для реагентов 5 мл



Фото 9. Крышки флаконов для реагентов

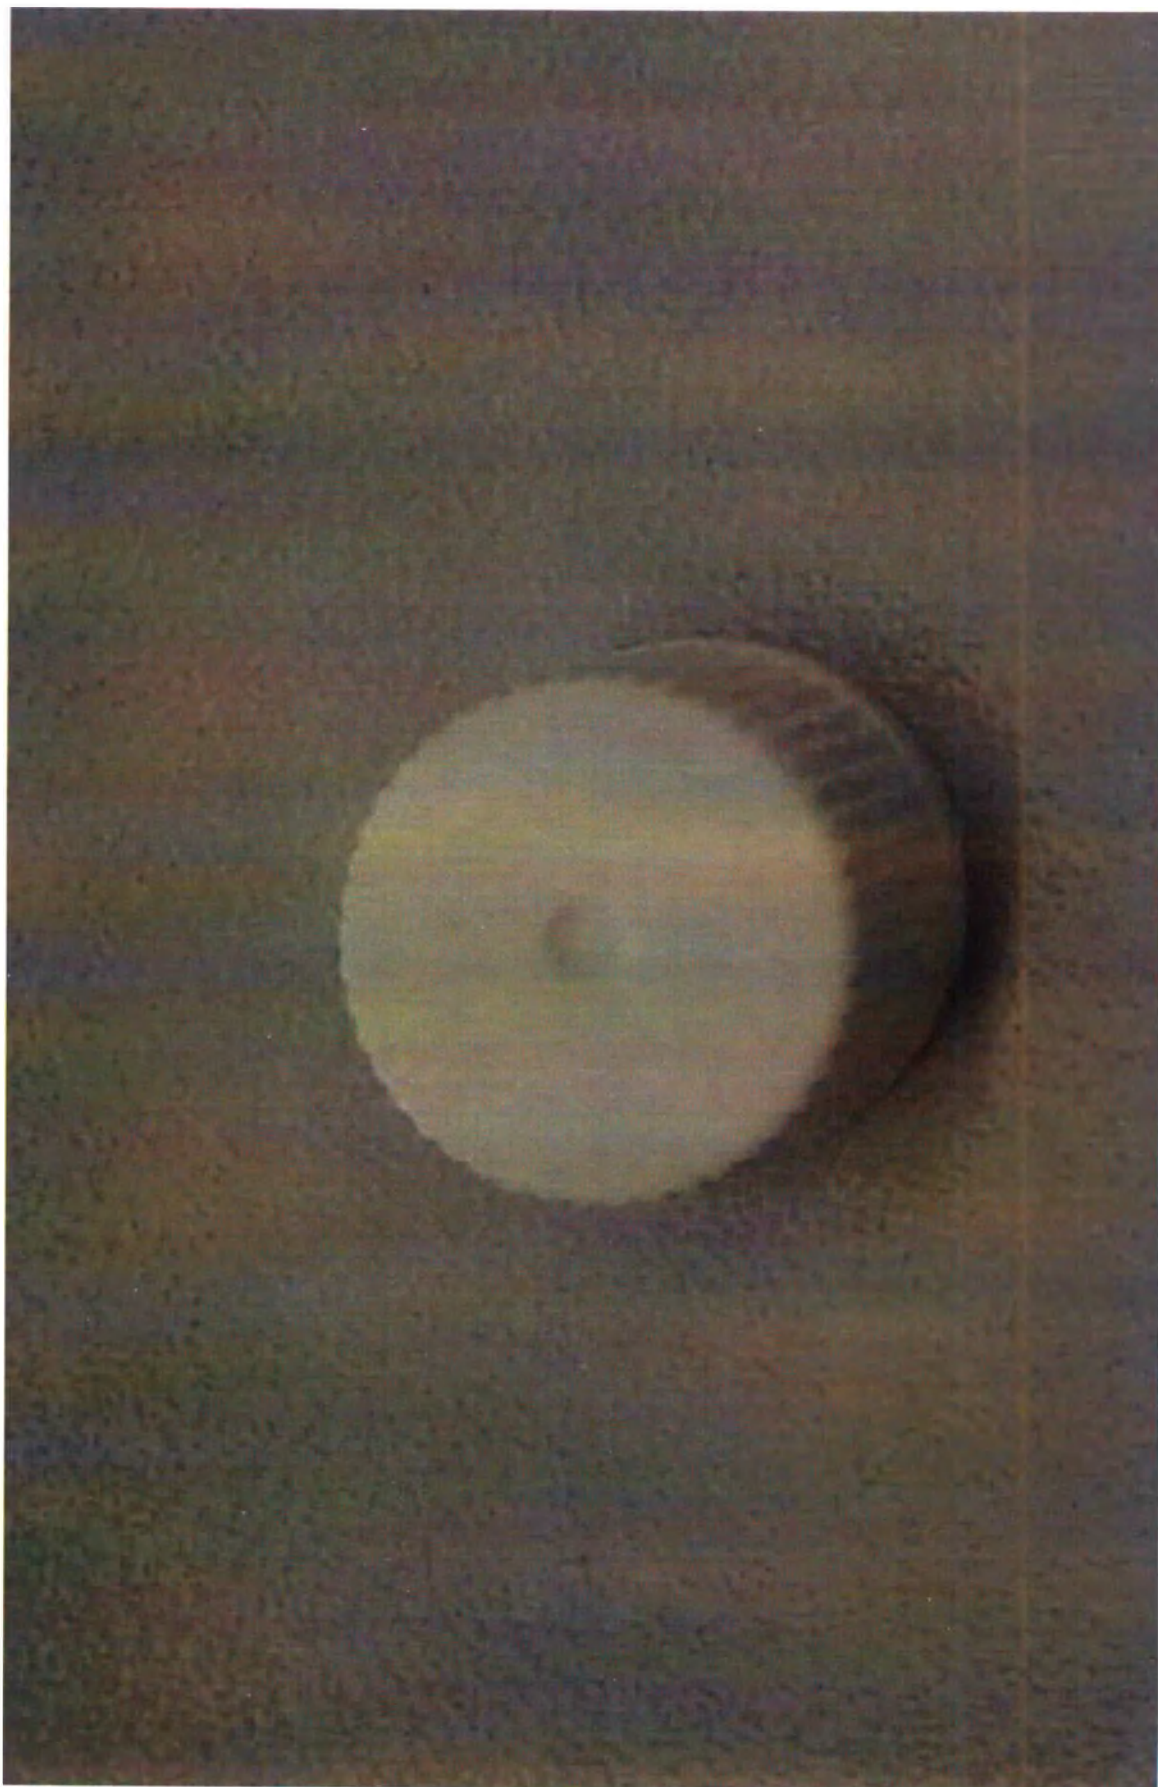


Фото 10. Пробки для флаконов реагентов

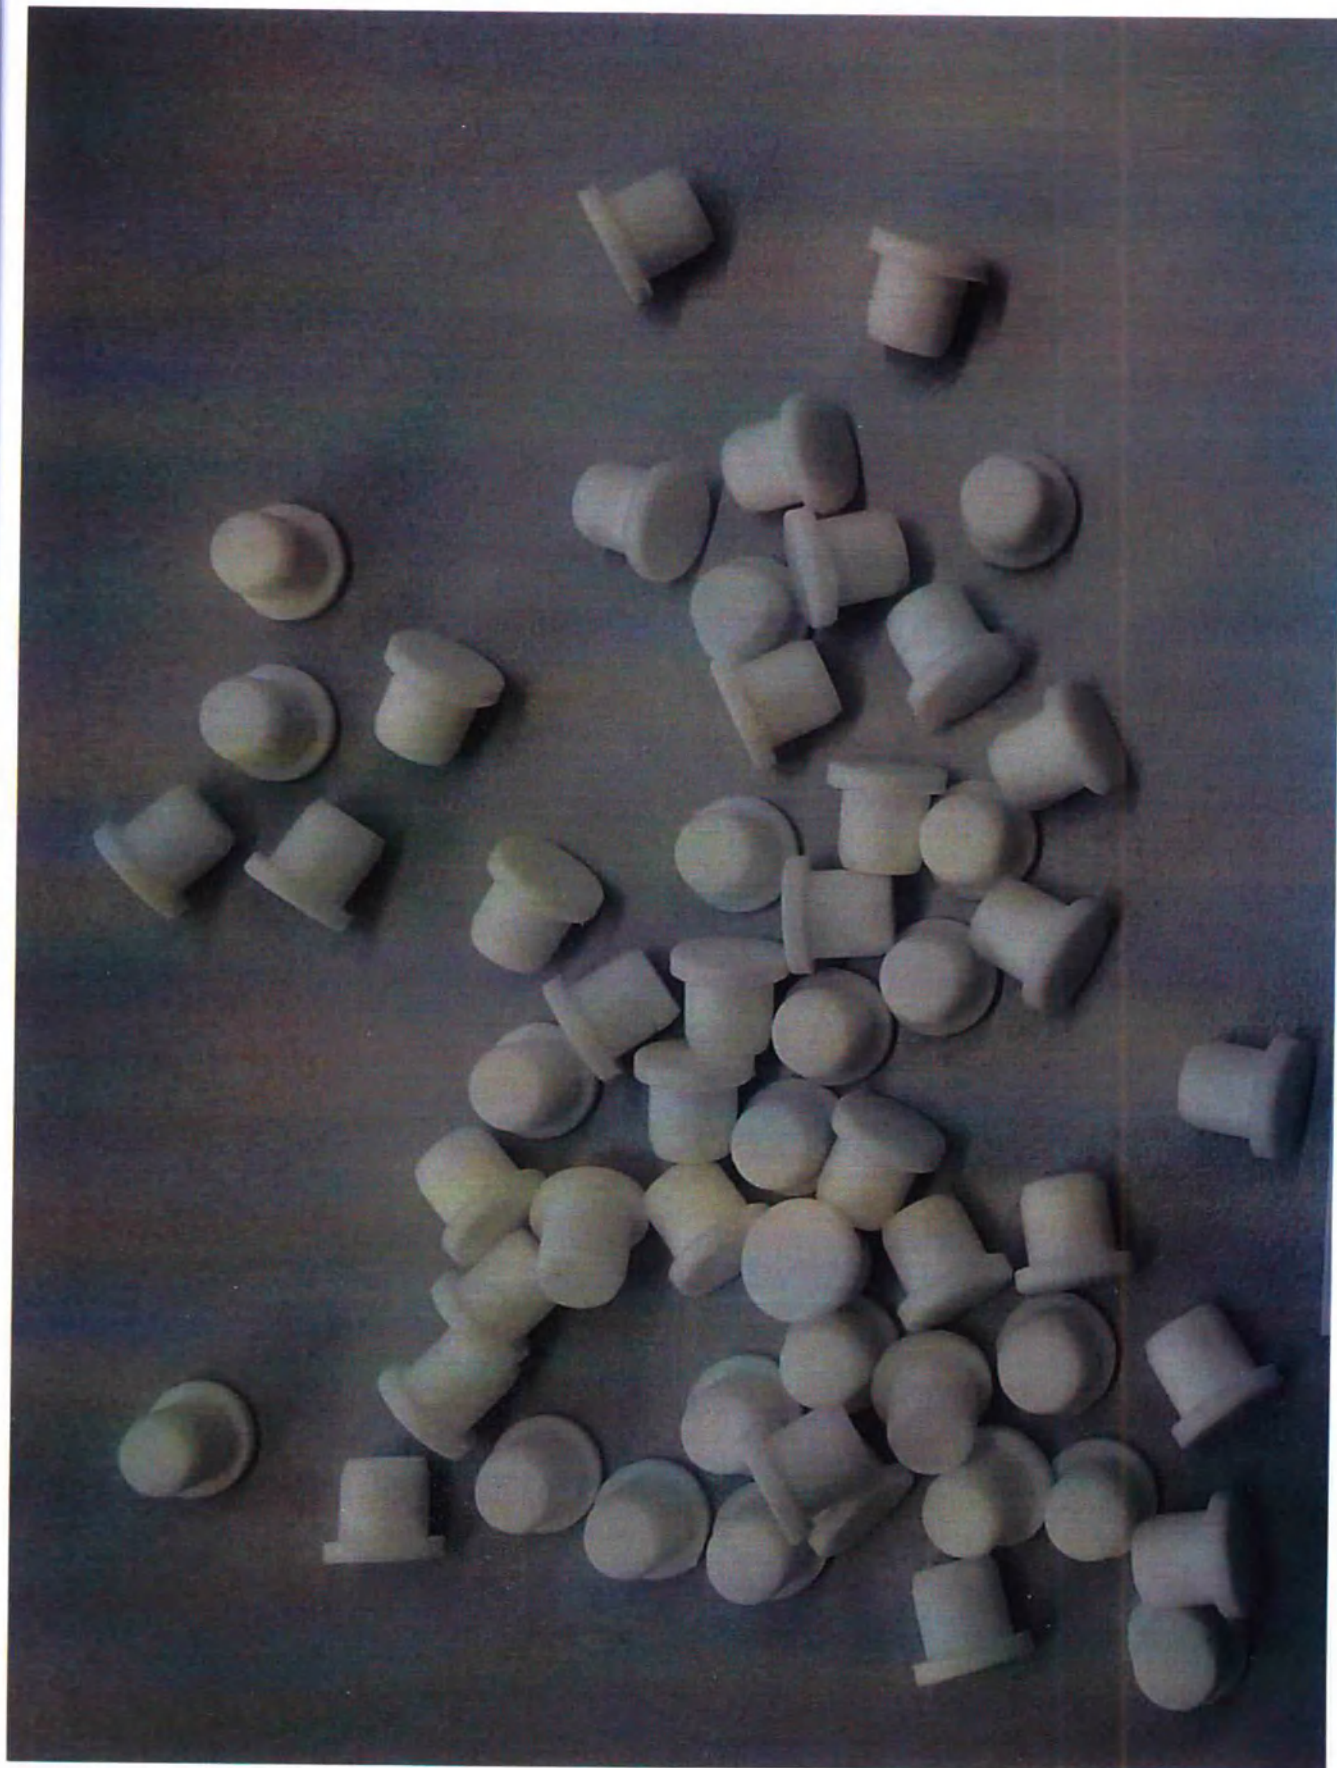


Фото 11. Реакционные кюветы



Фото 12. Пробирки для образцов



Фото 13. Датчик уровня воды с кабелем



Фото 14. Датчик уровня отходов с кабелем

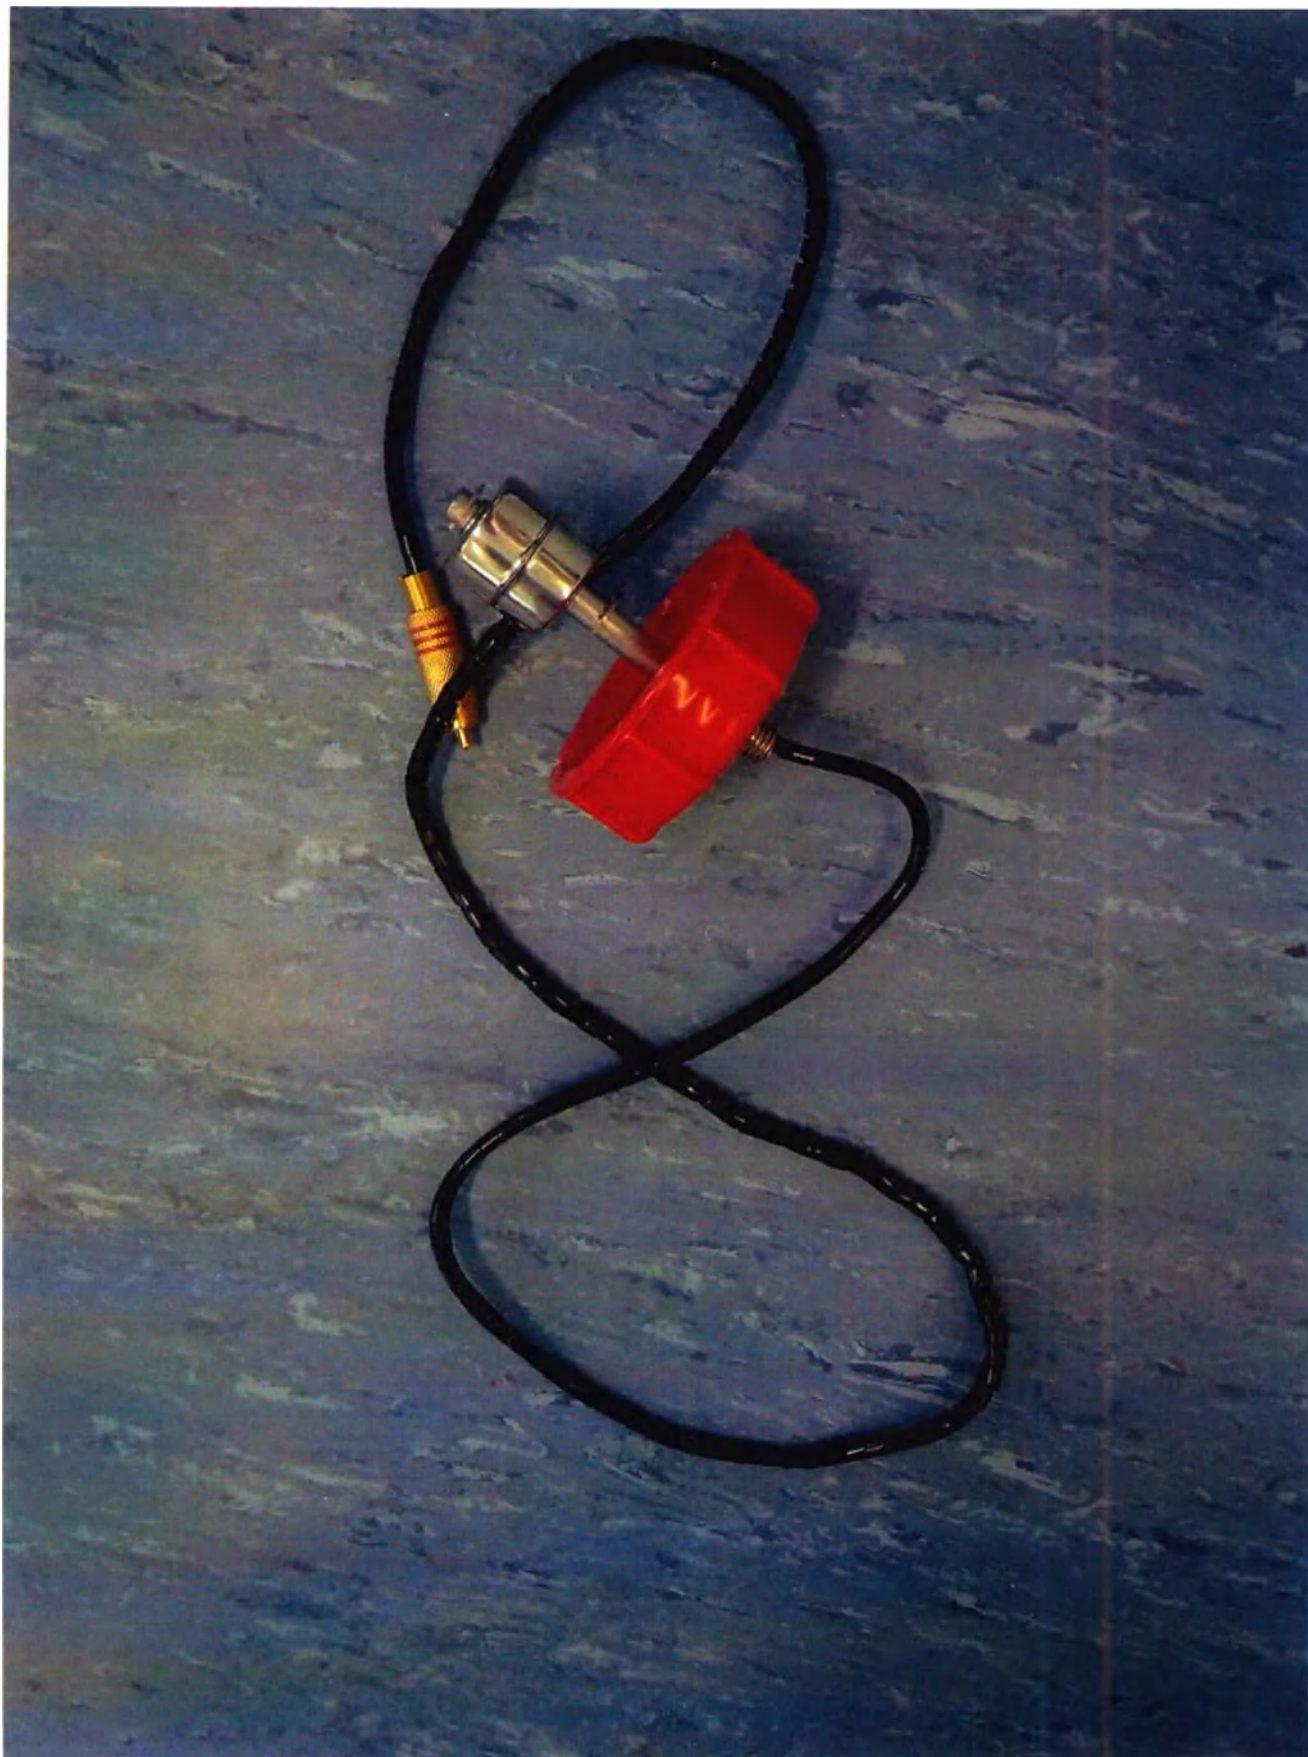


Фото 15. Шланг для воды

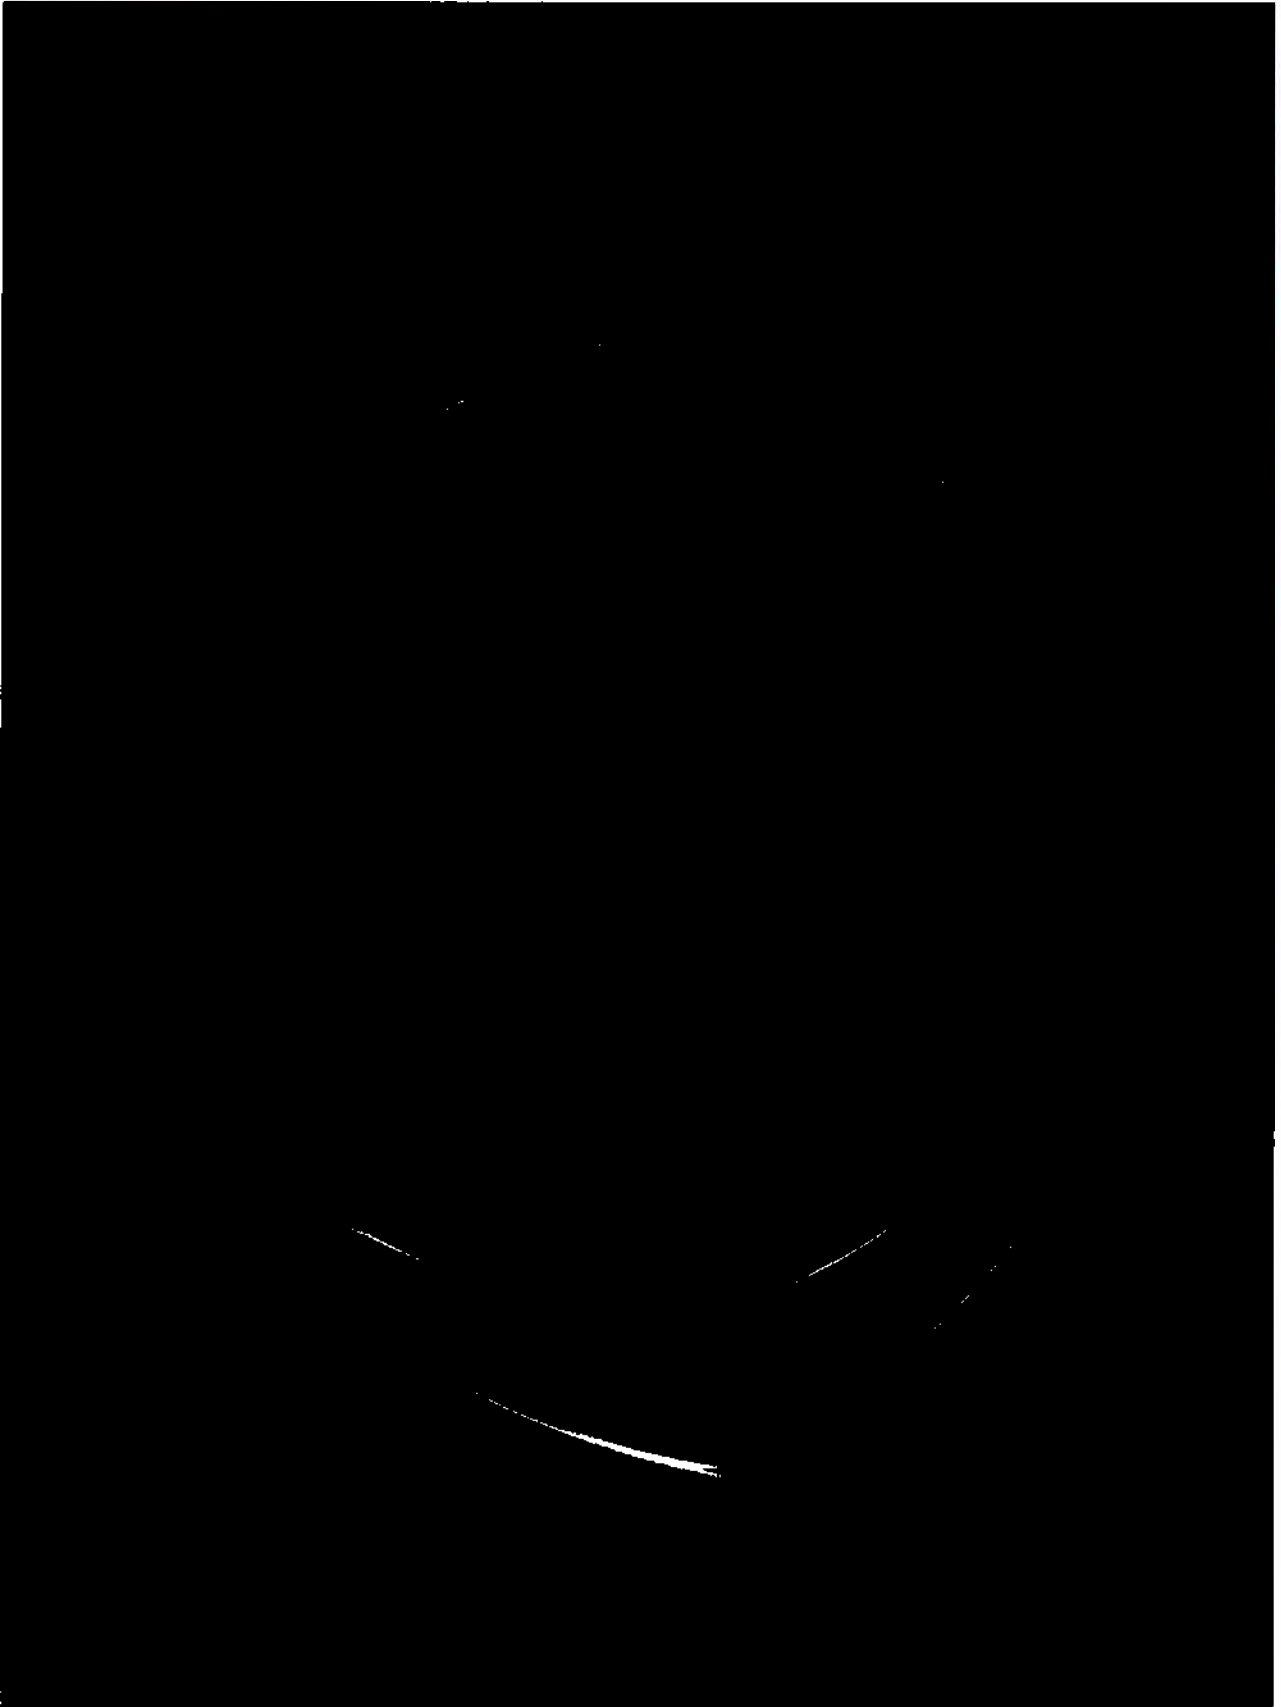


Фото 16. Шланг для отходов

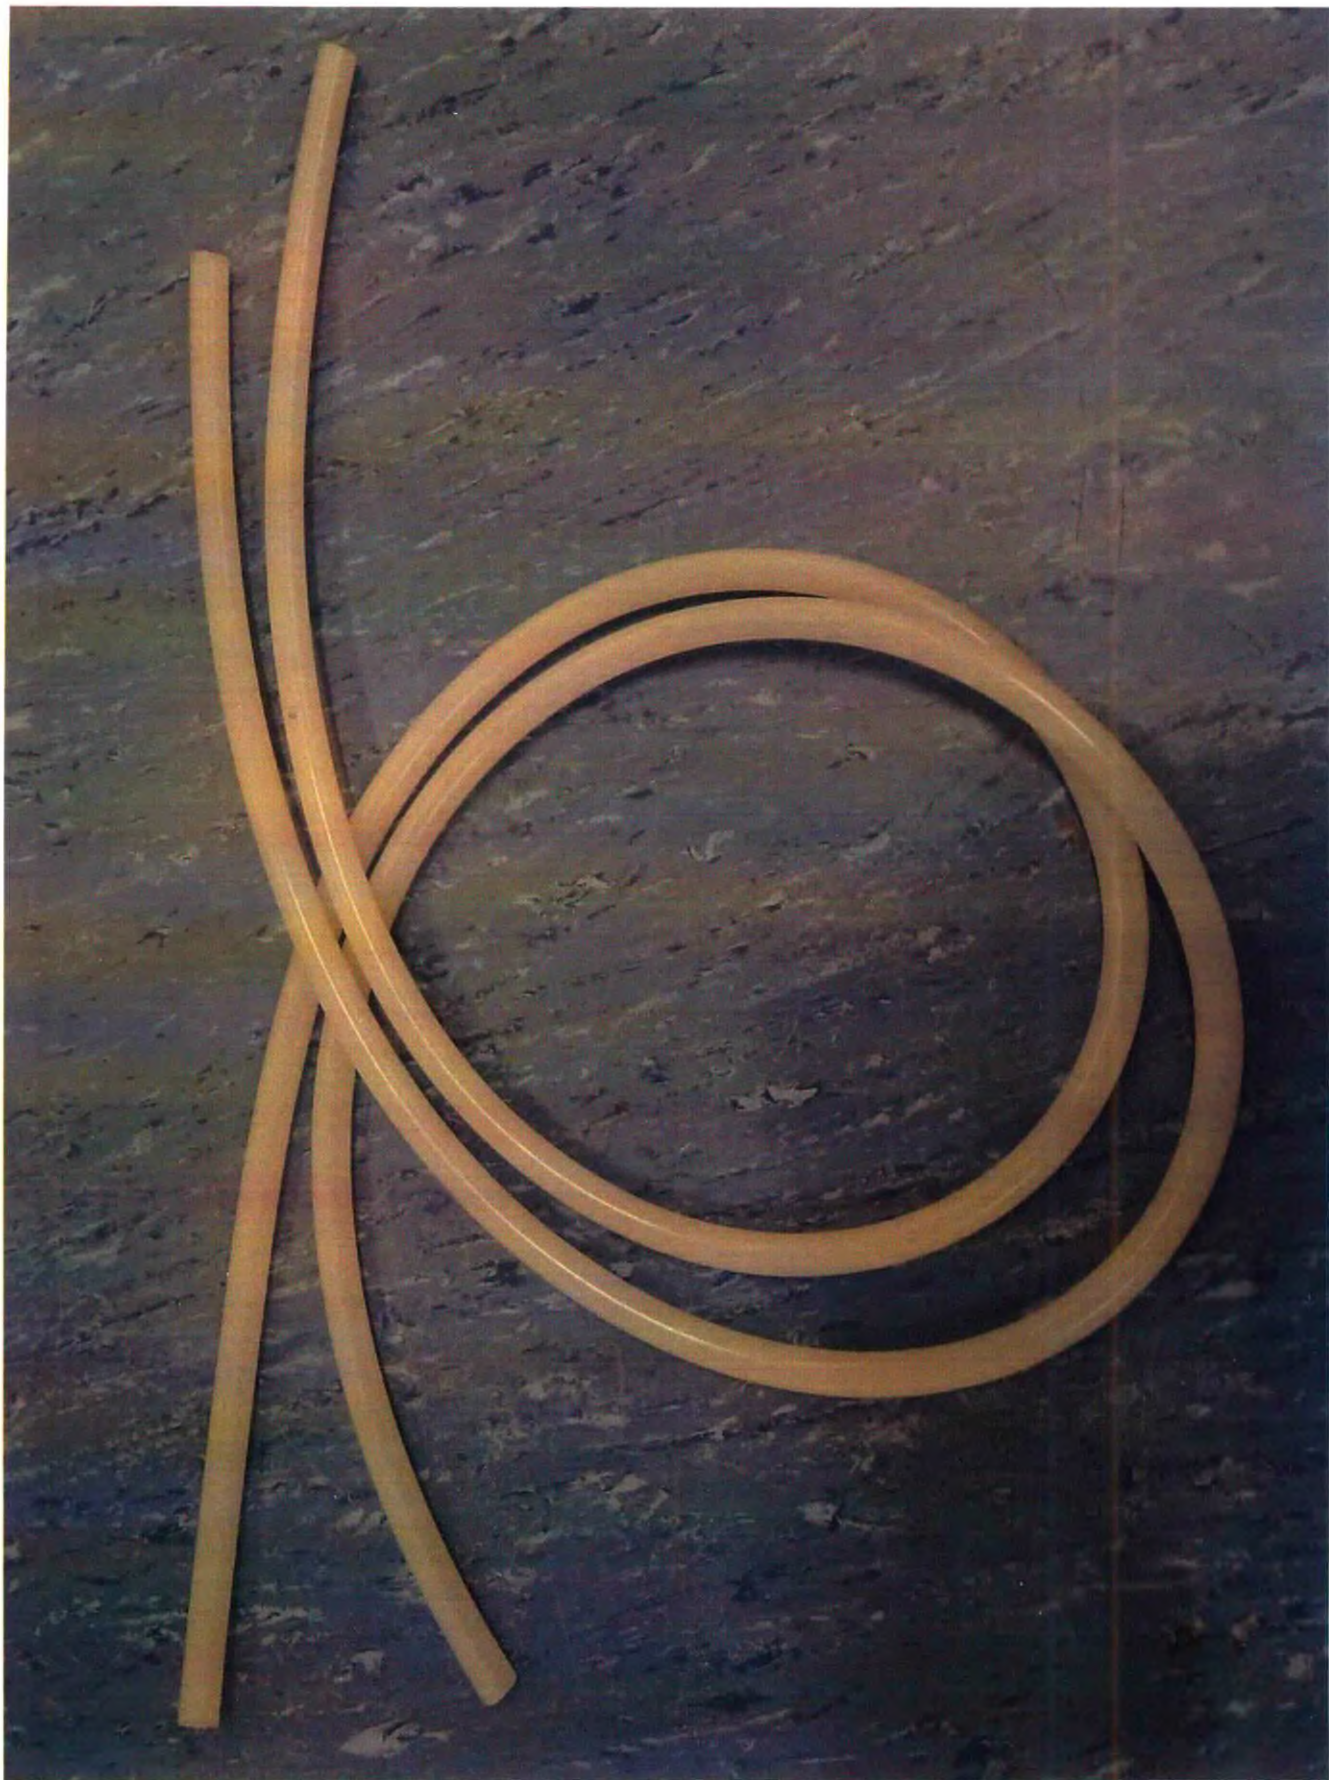


Фото 17. Канистра для дистиллированной воды



Фото 18. Канистра для отходов



Фото 19. Кабель миксера




Фото 20. Насадка для осушающей иглы моющей станции

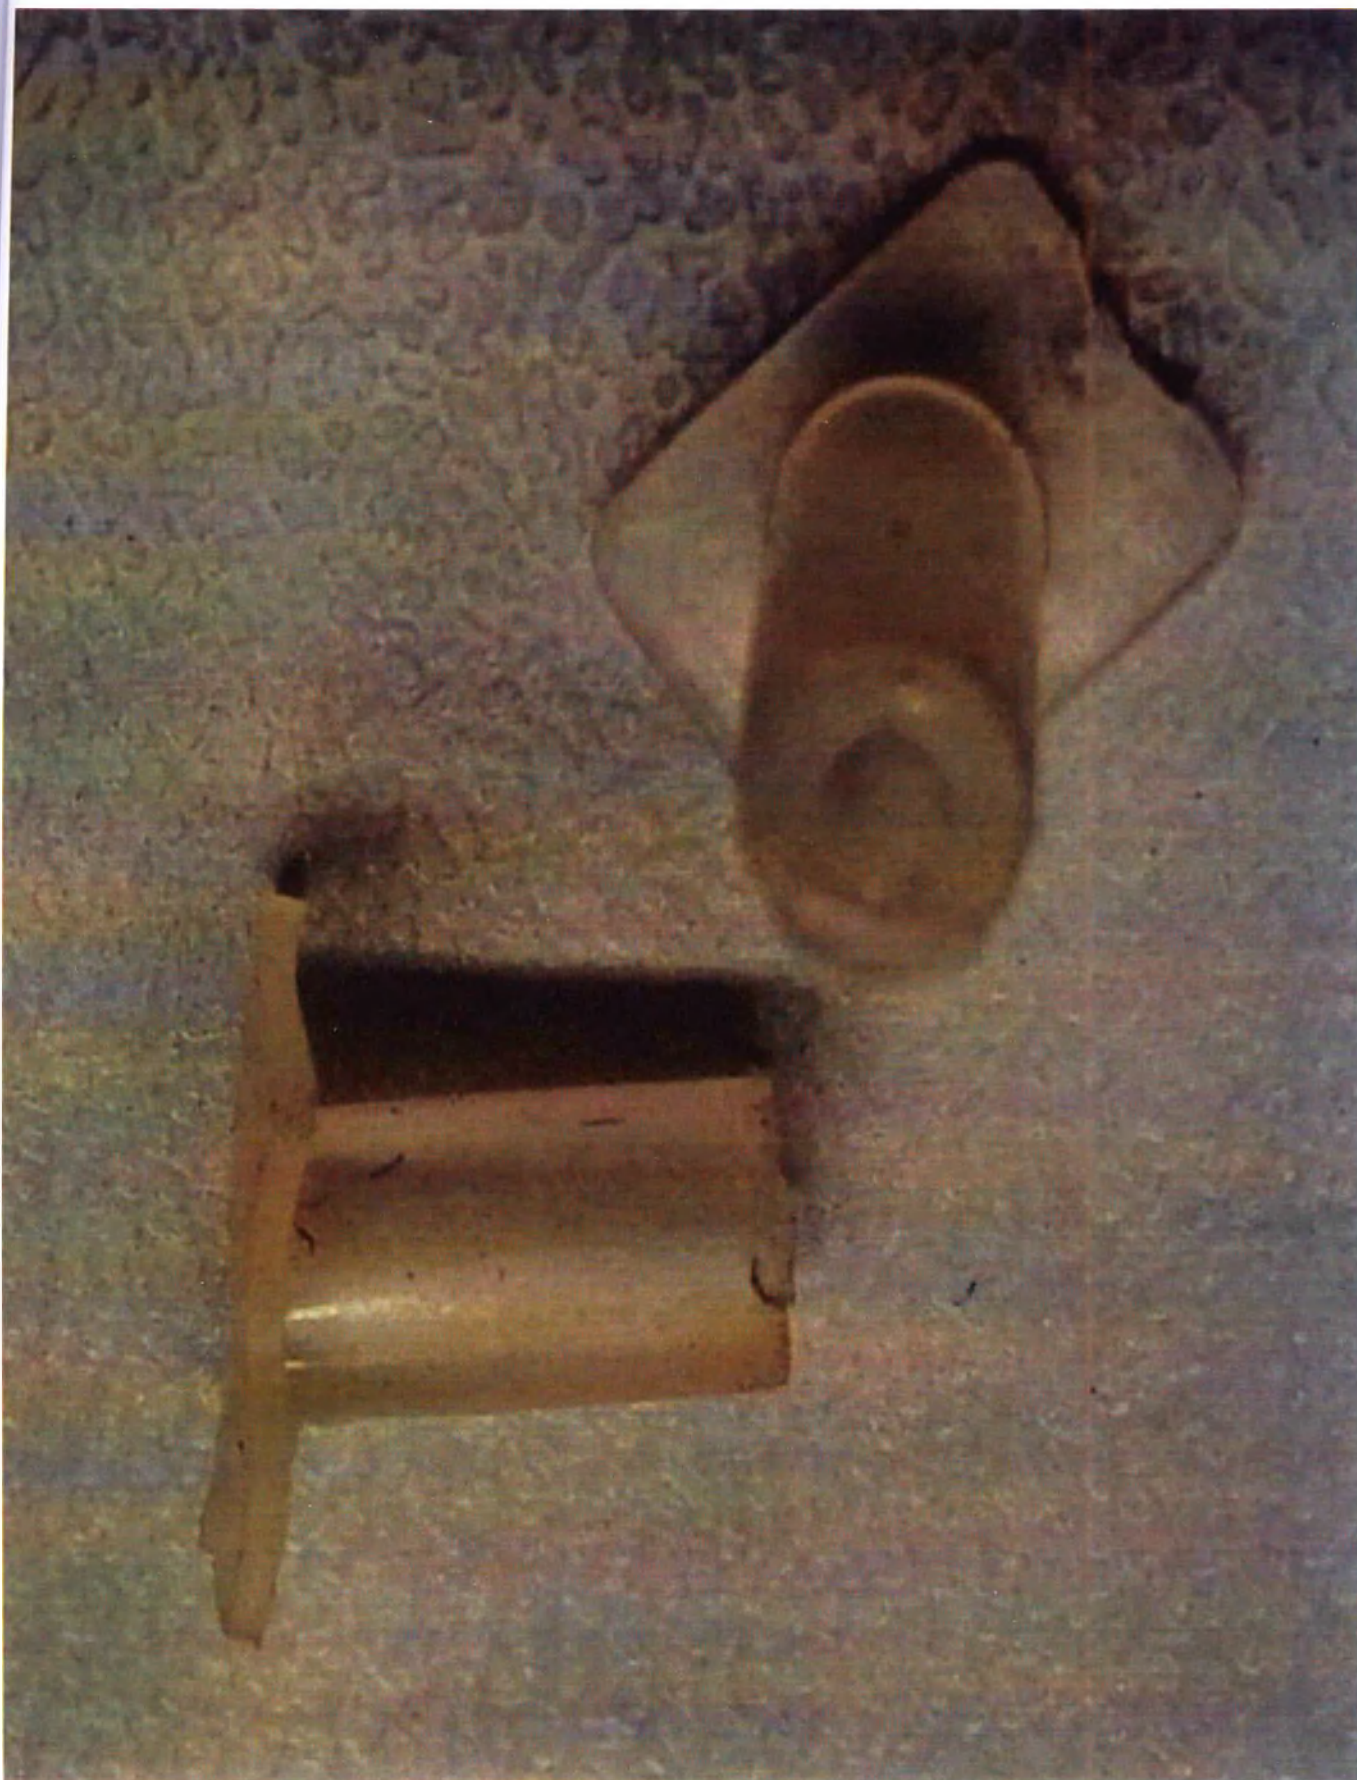


Фото 21. Управляющий ноутбук



Фото 22. Манипулятор типа «мышь»

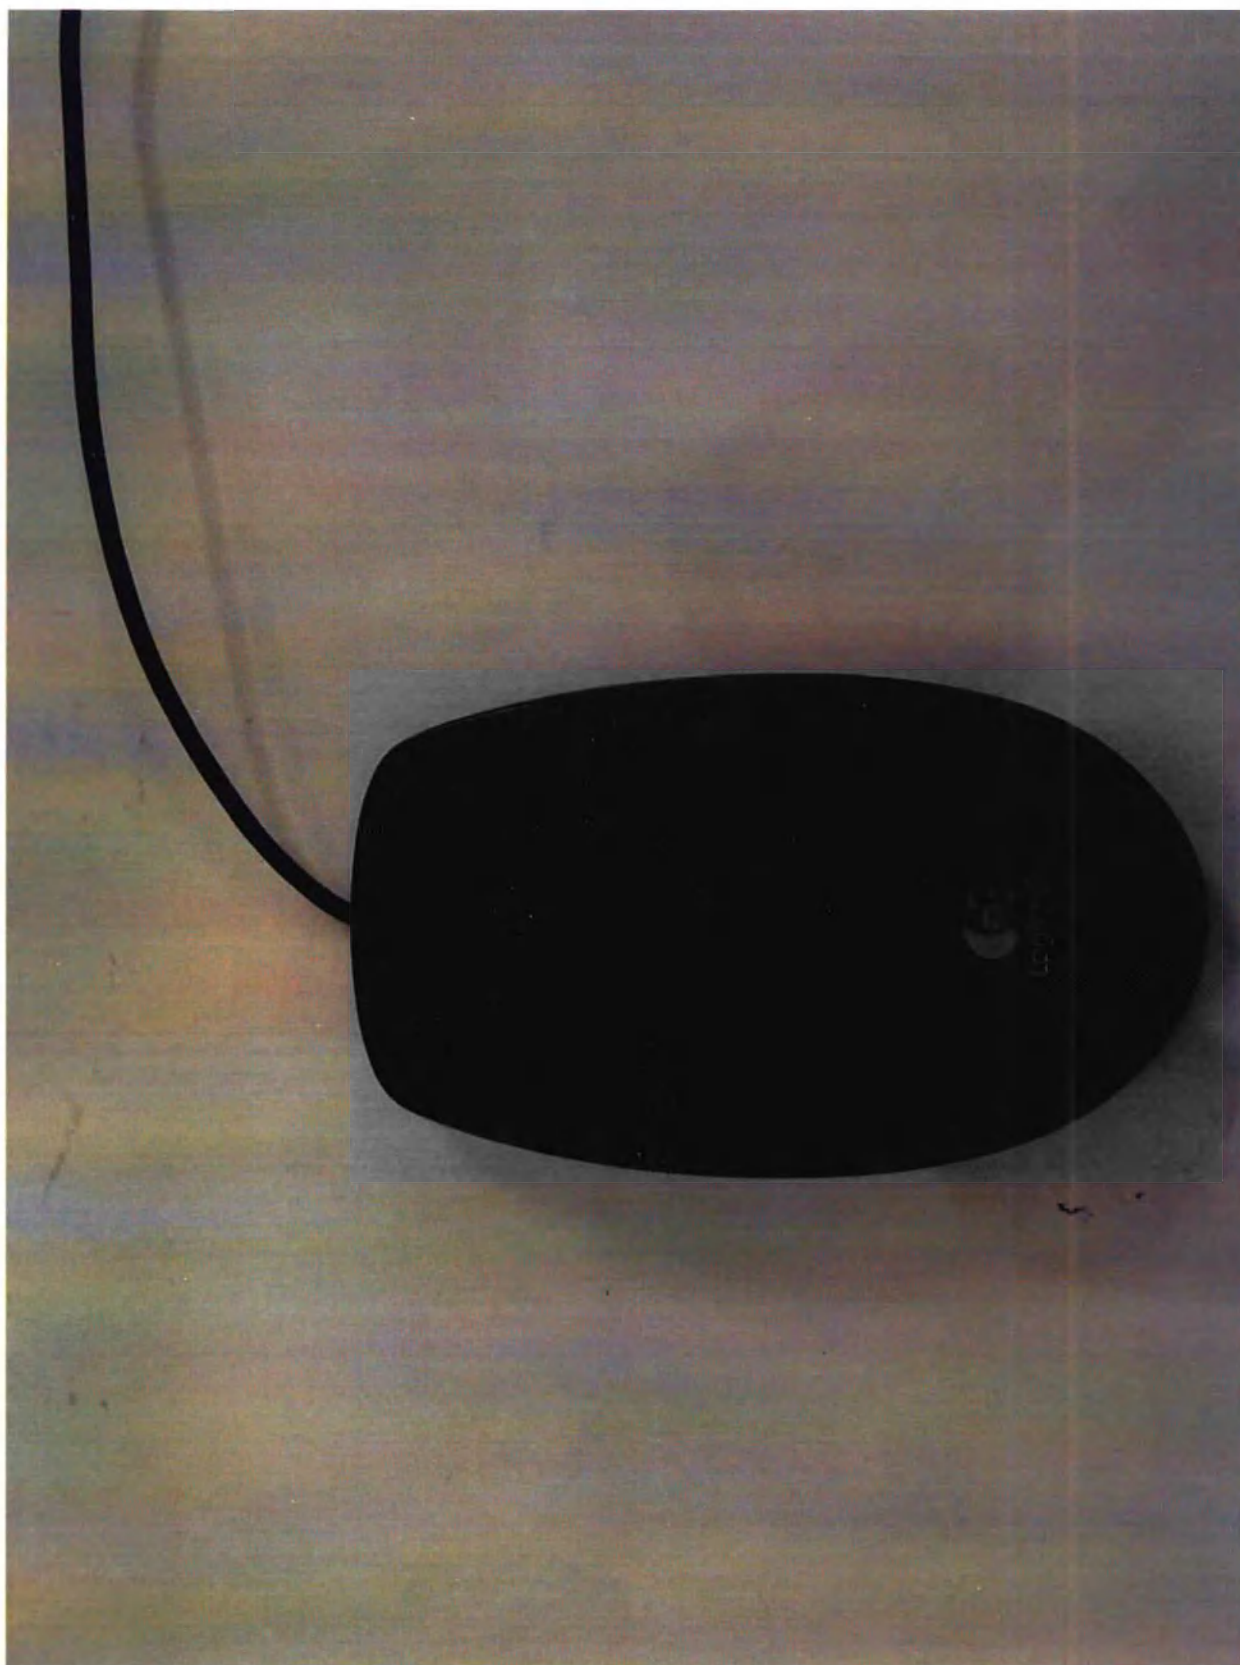


Фото 23. Преобразователь (конвертер) USB-RS232



Фото 24. Маркировка прибора



Фото 25. Изделие в упаковке



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 26 листа(ов)

Руководитель

