


Серия 05062018

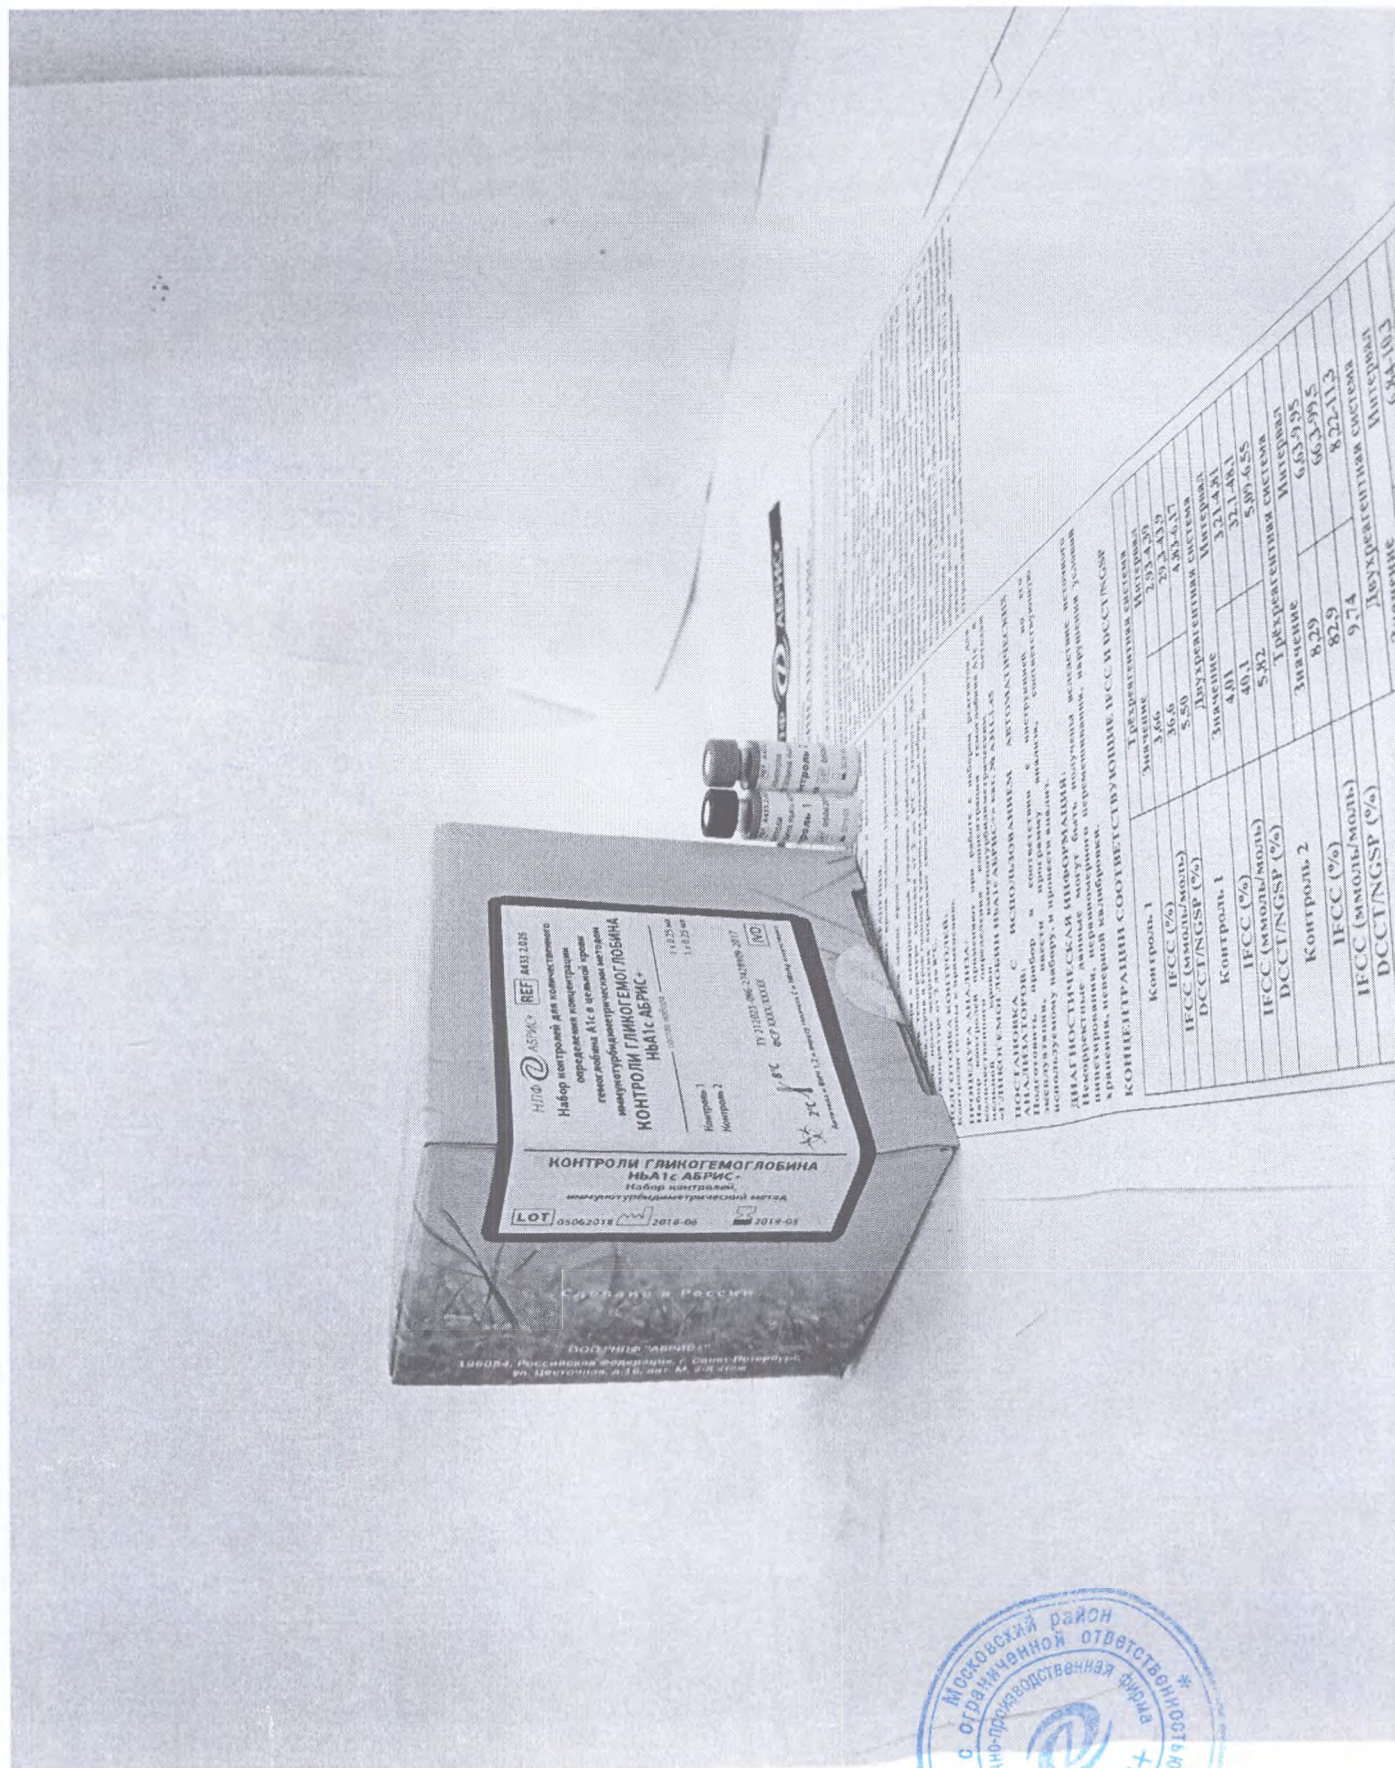


Генеральный директор ООО «НПФ «АБРИС+»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Марковский В.М.

Фотография общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro
 «Набор контролей для количественного определения концентрации гемоглобина A1c в
 цельной крови иммунотурбидиметрическим методом»
 «КОНТРОЛИ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1c АБРИС+»

Серия 06062018

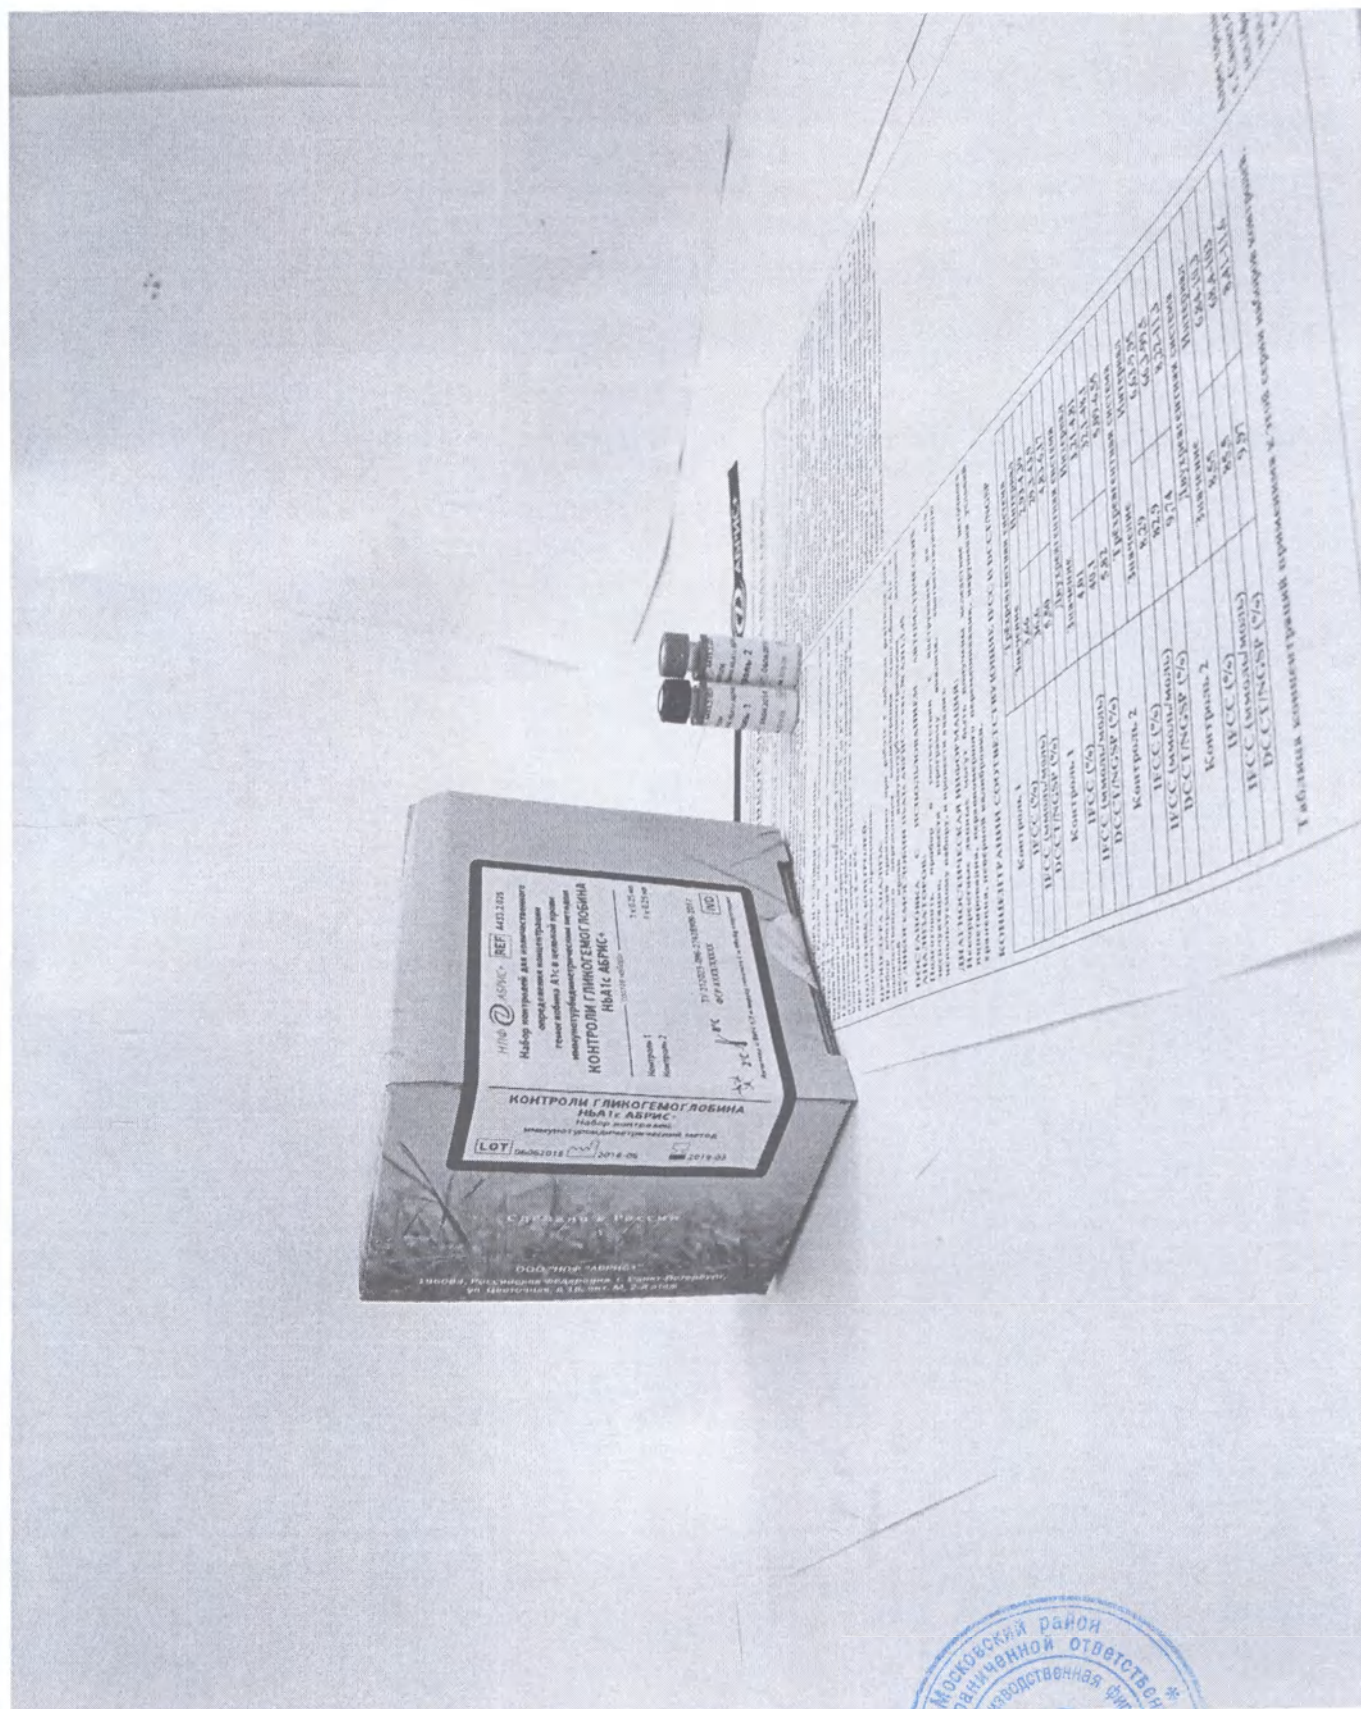


Генеральный директор ООО «НПФ «АБРИС+»


Марковский В.М.

Фотография общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro
 «Набор контролей для количественного определения концентрации гемоглобина A1c в
 цельной крови иммунотурбидиметрическим методом»
 «КОНТРОЛИ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1c АБРИС+»

Серия 31102017

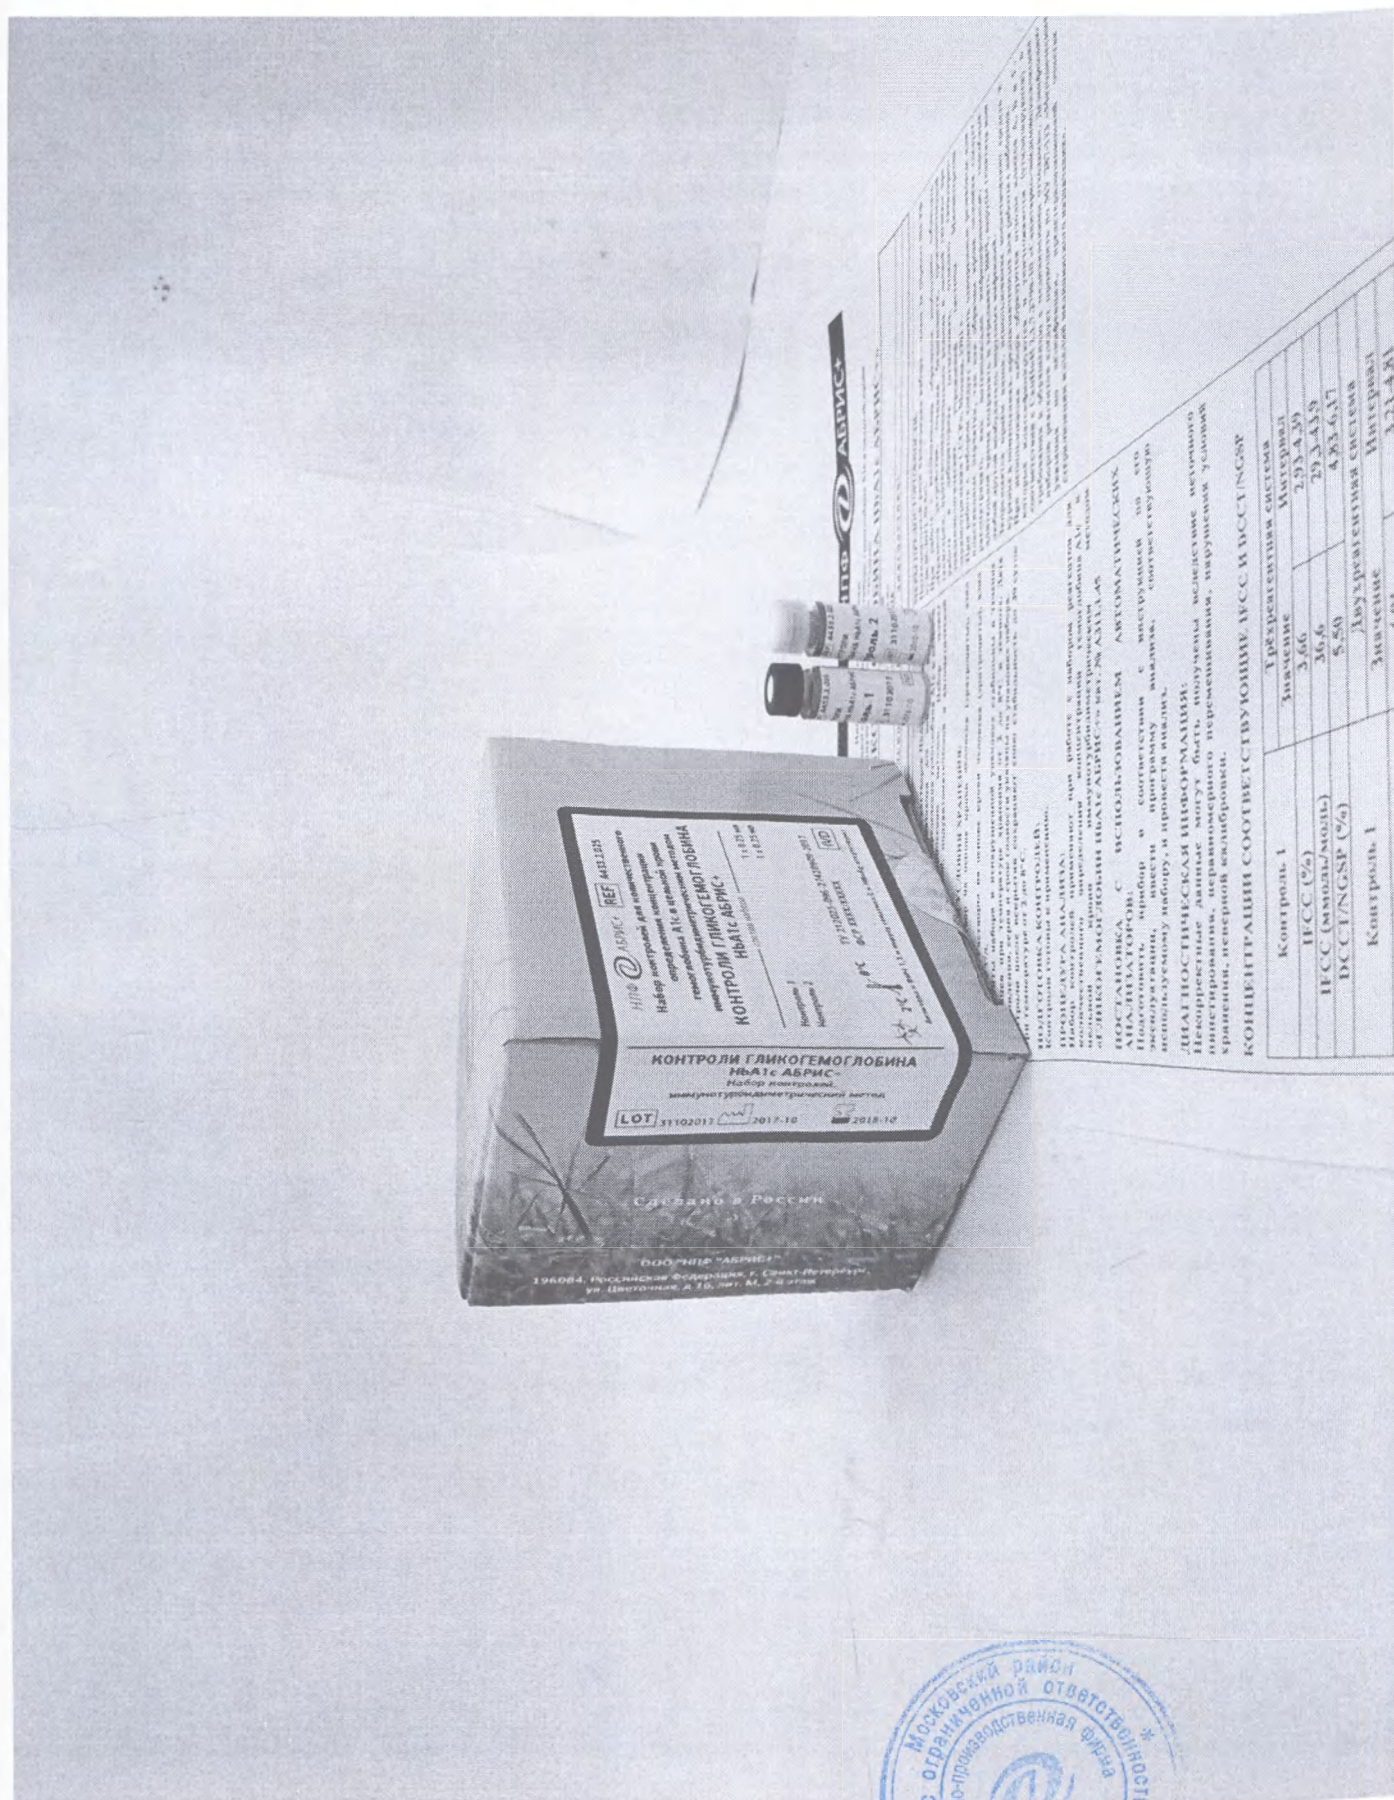

Серия 32102017

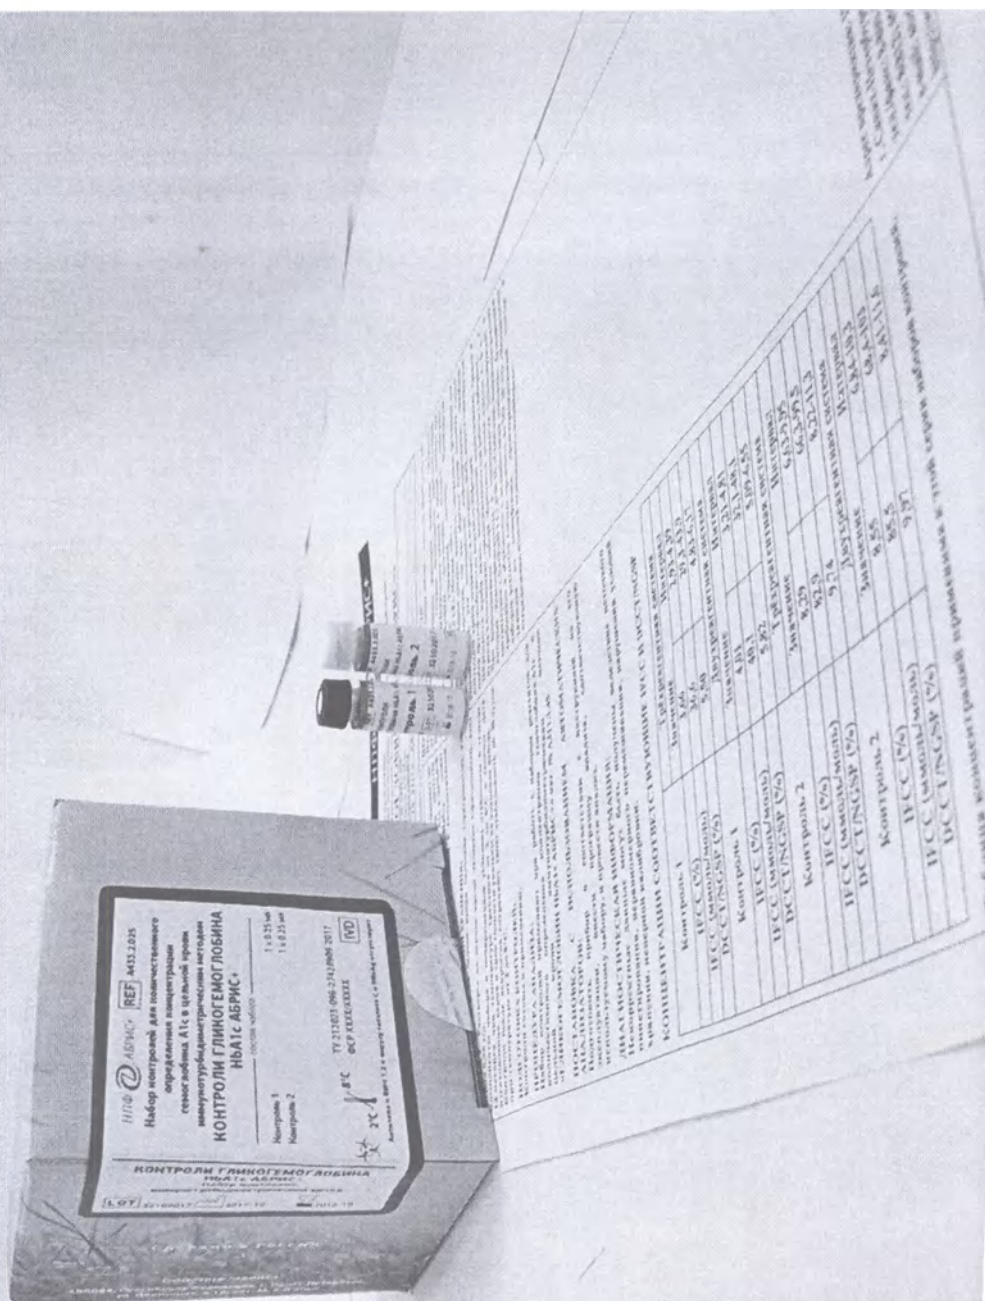

Марковский В.М.

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

