

БИМК-Кардио-Волга

Общество с ограниченной ответственностью «БИМК-Кардио-Волга»

109044 г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 14

Тел.: (495) 660 57 76, 660 57 78, факс: (495) 660 57 79

e-mail: main@bimcvol.ru

www.bimcvol.ru

Генеральный директор

ООО «БИМК-Кардио-Волга»

Тетушкина Н.В.

2018 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:


**Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
варианты исполнения: KL-30, KL-50**

г.Москва, 2018


Оглавление

Общий вид коробок МИ: Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30, KL-50.....	3
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки, боковая сторона, маркировка 1).....	4
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки, боковая сторона, маркировка 2).....	5
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки и индивидуальной упаковки).....	6
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки и вскрытой индивидуальной упаковки).....	7
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (индивидуальная упаковка, лицевая сторона, маркировка 1).....	8
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (индивидуальная упаковка, обратная сторона, маркировка 2).....	9
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (вид извлеченного из индивидуальной упаковки МИ).....	10
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки, боковая сторона, маркировка 1).....	11
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки, боковая сторона, маркировка 2).....	12
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки и индивидуальной упаковки).....	13
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки и вскрытой индивидуальной упаковки).....	14
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (индивидуальная упаковка, лицевая сторона, маркировка 1).....	15
Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (вид извлеченного из индивидуальной упаковки МИ).....	17

Общий вид коробок МИ: Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30, KL-50.

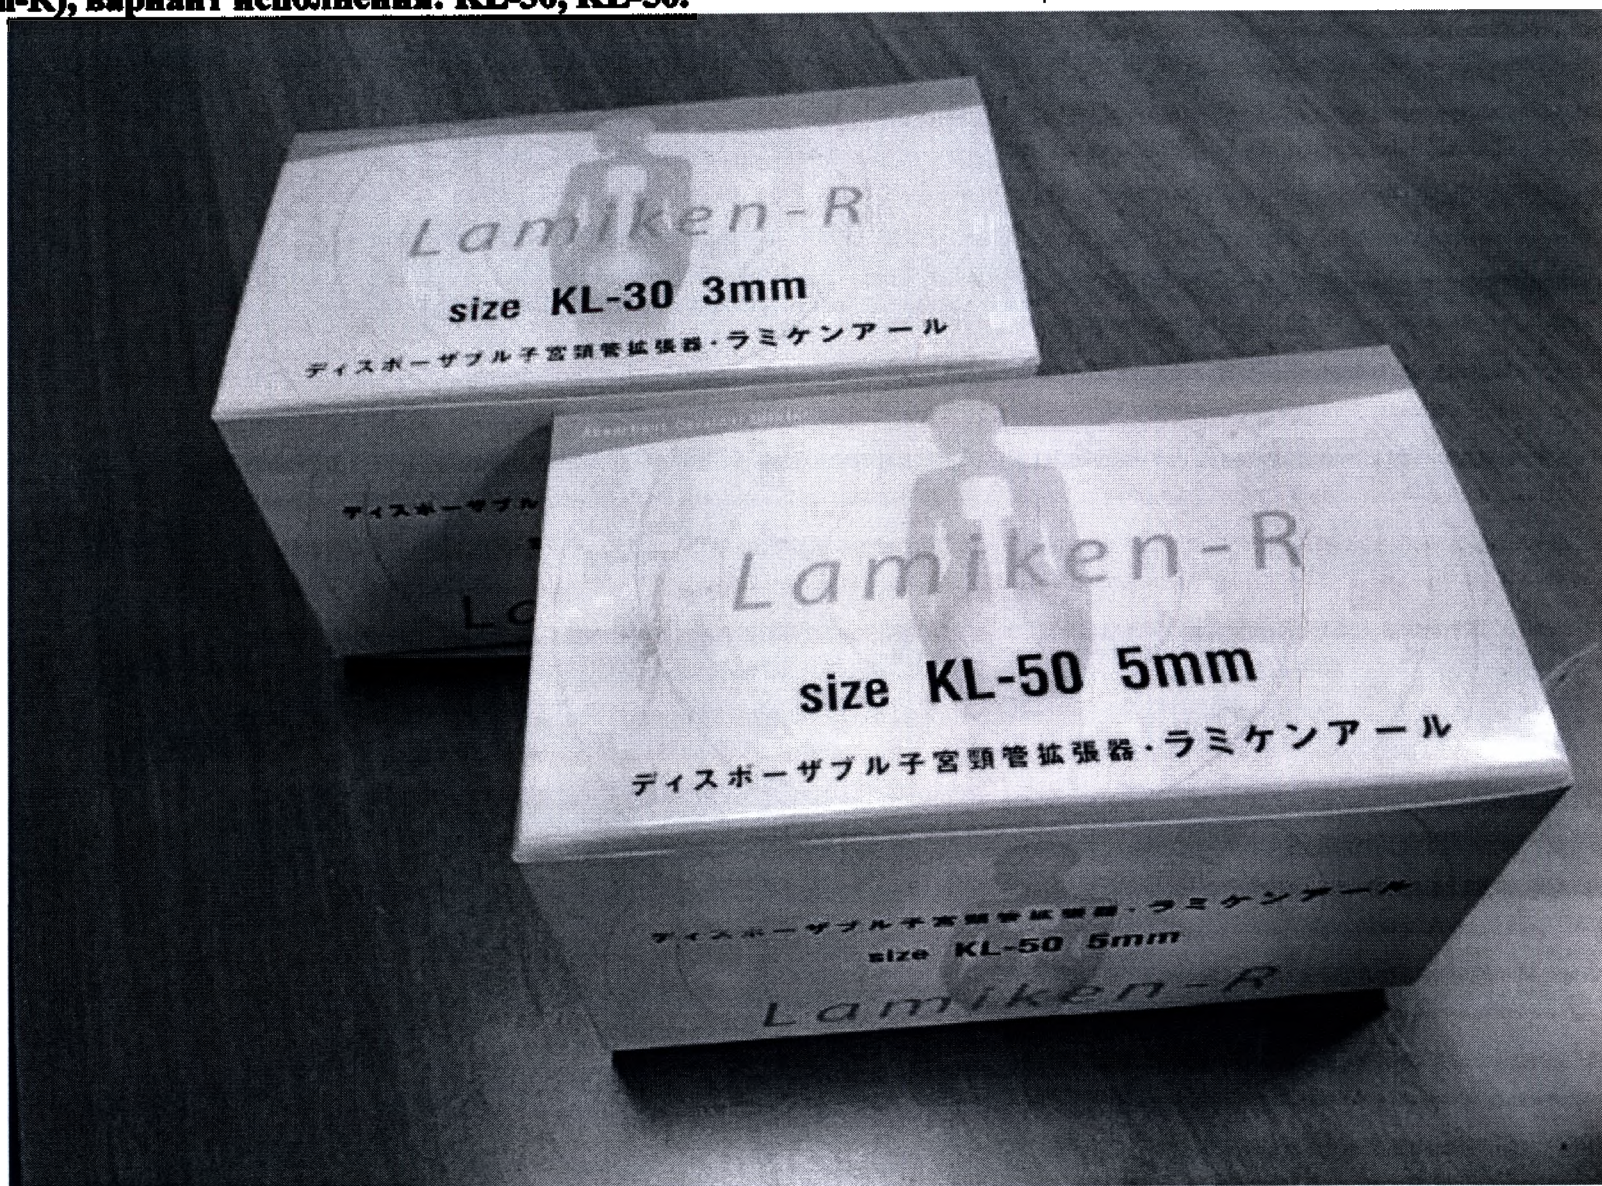

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки, бо-
ковая сторона, маркировка 1).

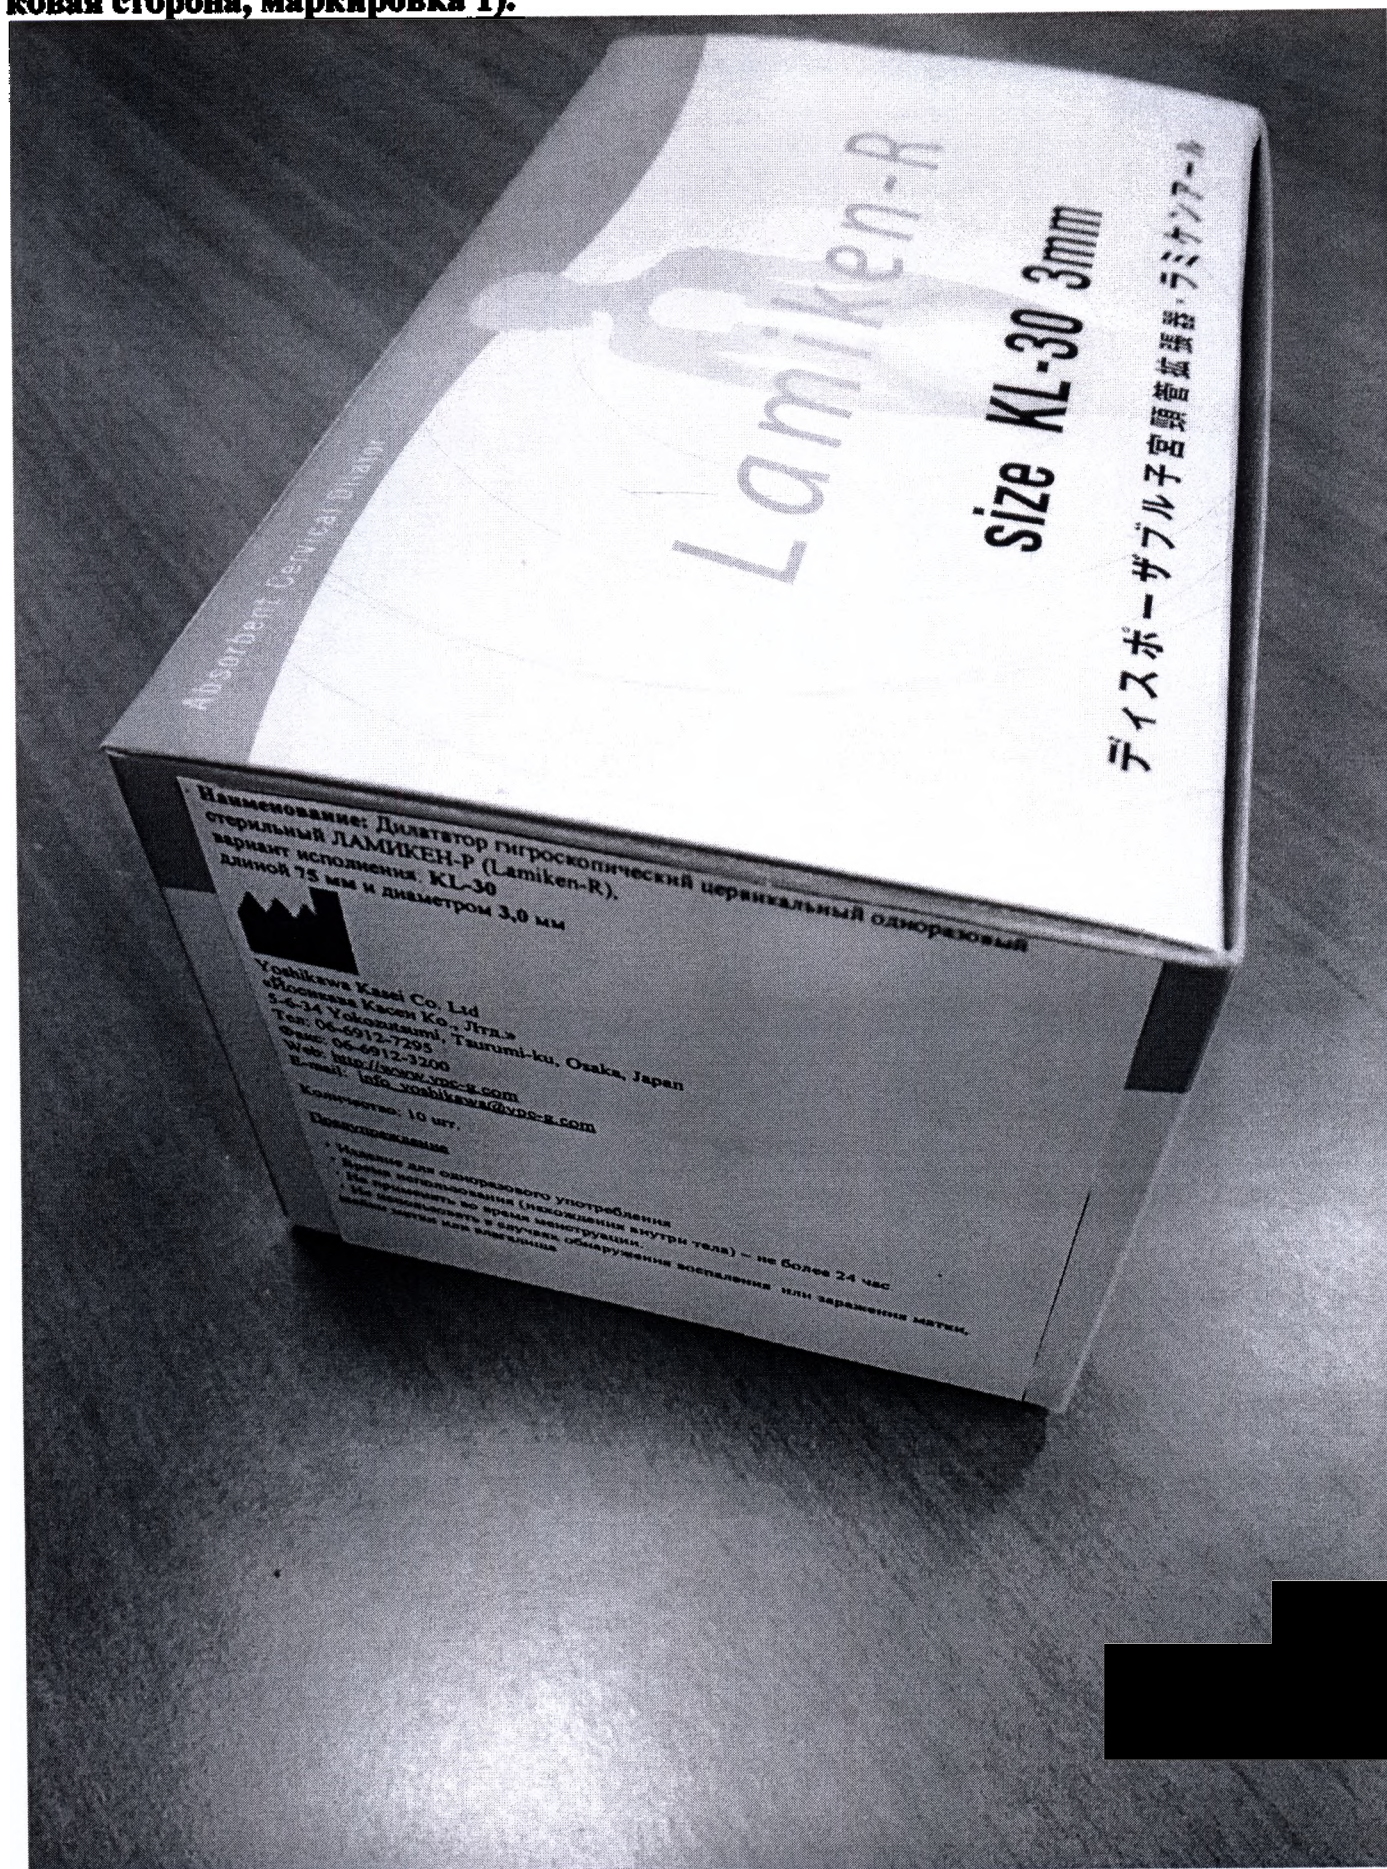

Наименование: Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый
стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
вариант исполнения: KL-30
длиной 75 мм и диаметром 3,0 мм



Yoshikawa Kasei Co., Ltd.
«Йосикава Касей Ко., Лтд.»
5-6-34 Yokohizumi, Taigumi-ku, Osaka, Japan
Tel: 06-6912-7295
Fax: 06-6912-3200
Web: <http://www.ykc-g.com>
E-mail: info_yoshikawa@ykc-g.com

Количество: 10 шт.
Предупреждения

- Не использовать для одноразового употребления
- Время использования (нахождения внутри тела) – не более 24 час
- Не применять во время менструации.
- Не использовать в случае обнаружения воспаления или заражения матки.
- Не использовать в случае повреждения или загрязнения.

Ламикен-Р

size KL-30 3mm

ラミケン-Ｒ

Наименование: Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
вариант исполнения: KL-30: длиной 75 мм и диаметром 3,0 мм

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____
ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ: _____
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты стерилизации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 10°C - 40°C

СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
АБСОЛЮТНО

STERILE R

ИСТОЧНИК: Kato Medical Co., Ltd.
1-12-12, Kato Medical Co., Ltd.
Kato Medical Co., Ltd.
Kato Medical Co., Ltd.
Kato Medical Co., Ltd.

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки и
индивидуальной упаковки).



Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (общий вид коробки и
вскрытой индивидуальной упаковки).



**Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (индивидуальная упаковка, лицевая сторона, маркировка 1).**



**Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (индивидуальная упа-
ковка, обратная сторона, маркировка 2).**


Наименование: Дилататор гигроскопический цервикальный
одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
вариант исполнения: KL-30: длиной 75 мм и диаметром 3,0 мм

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ: _____

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты стерилизации



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

АПИРОГЕННО

STERILE R



Регистрационное удостоверение: _____

EC REP

Ken-Medical Co., Ltd
1-22-18 Minami-mukonosu, Amagasaki-shi,
Hyogo-ken, Japan 661-0033
TEL 06-4962-5060 / FAX 06-4962-5070
Website: www.ken-medical.co.jp
E-mail: h.yamamoto@ken-medical.co.jp

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО
"БИМК-Кардио-Волга"
109044 Москва, 4-ый Крутицкий пер., д.14
Тел.: (495) 660-57-74, 660-57-78
Факс: (495) 660-57-79 E-mail: ain@bimevol.ru

GST-128



(01)04582266800229



製造販売業者


ケン・メディカル株式会社

〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号


TEL 06 (4962) 5060

FAX 06 (4962) 5070


Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-30 (вид извлеченного из индивидуальной упаковки МИ).

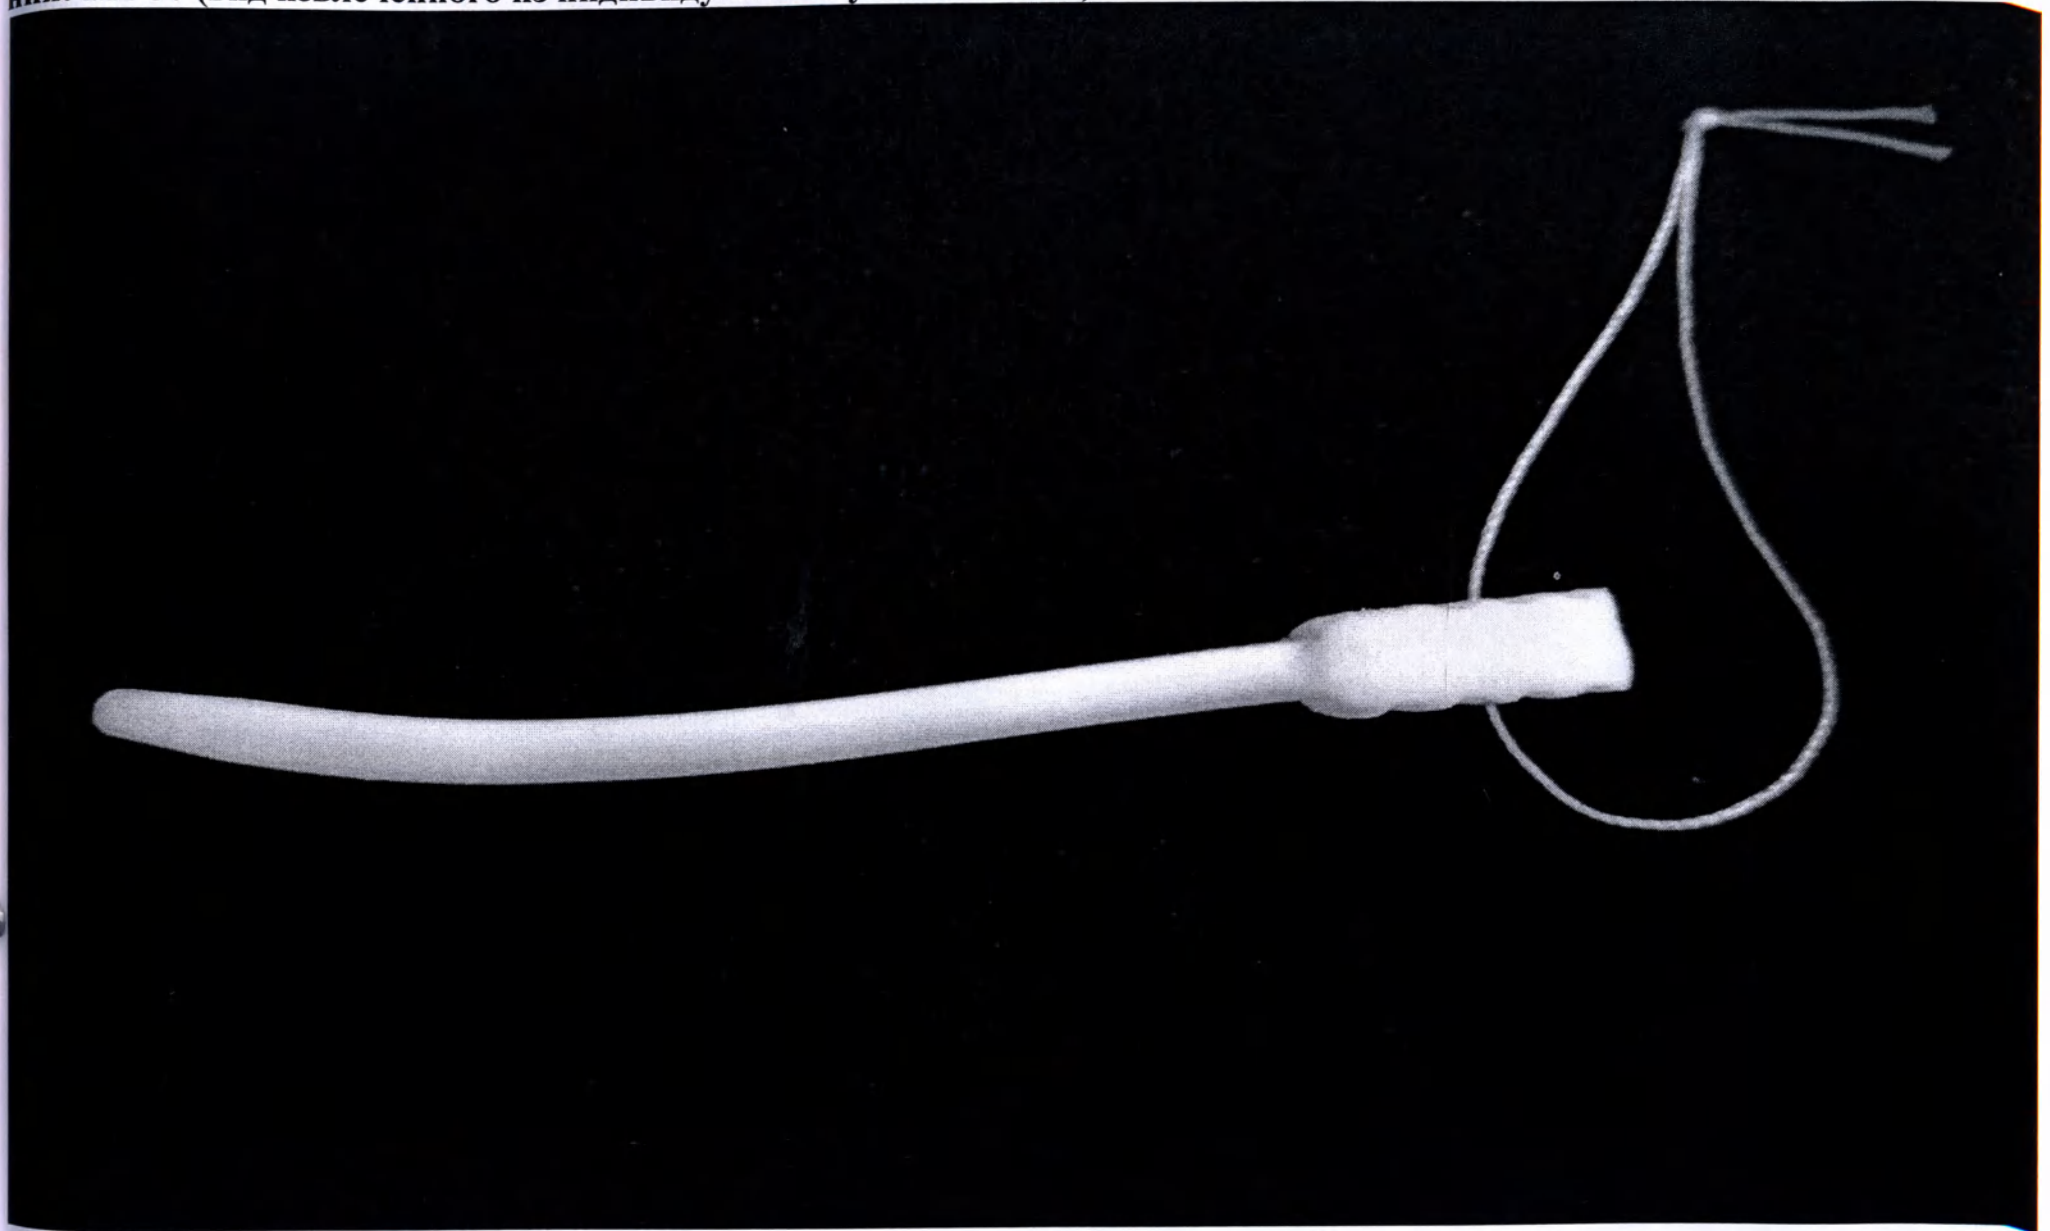

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки, бо-
ковая сторона, маркировка 1).

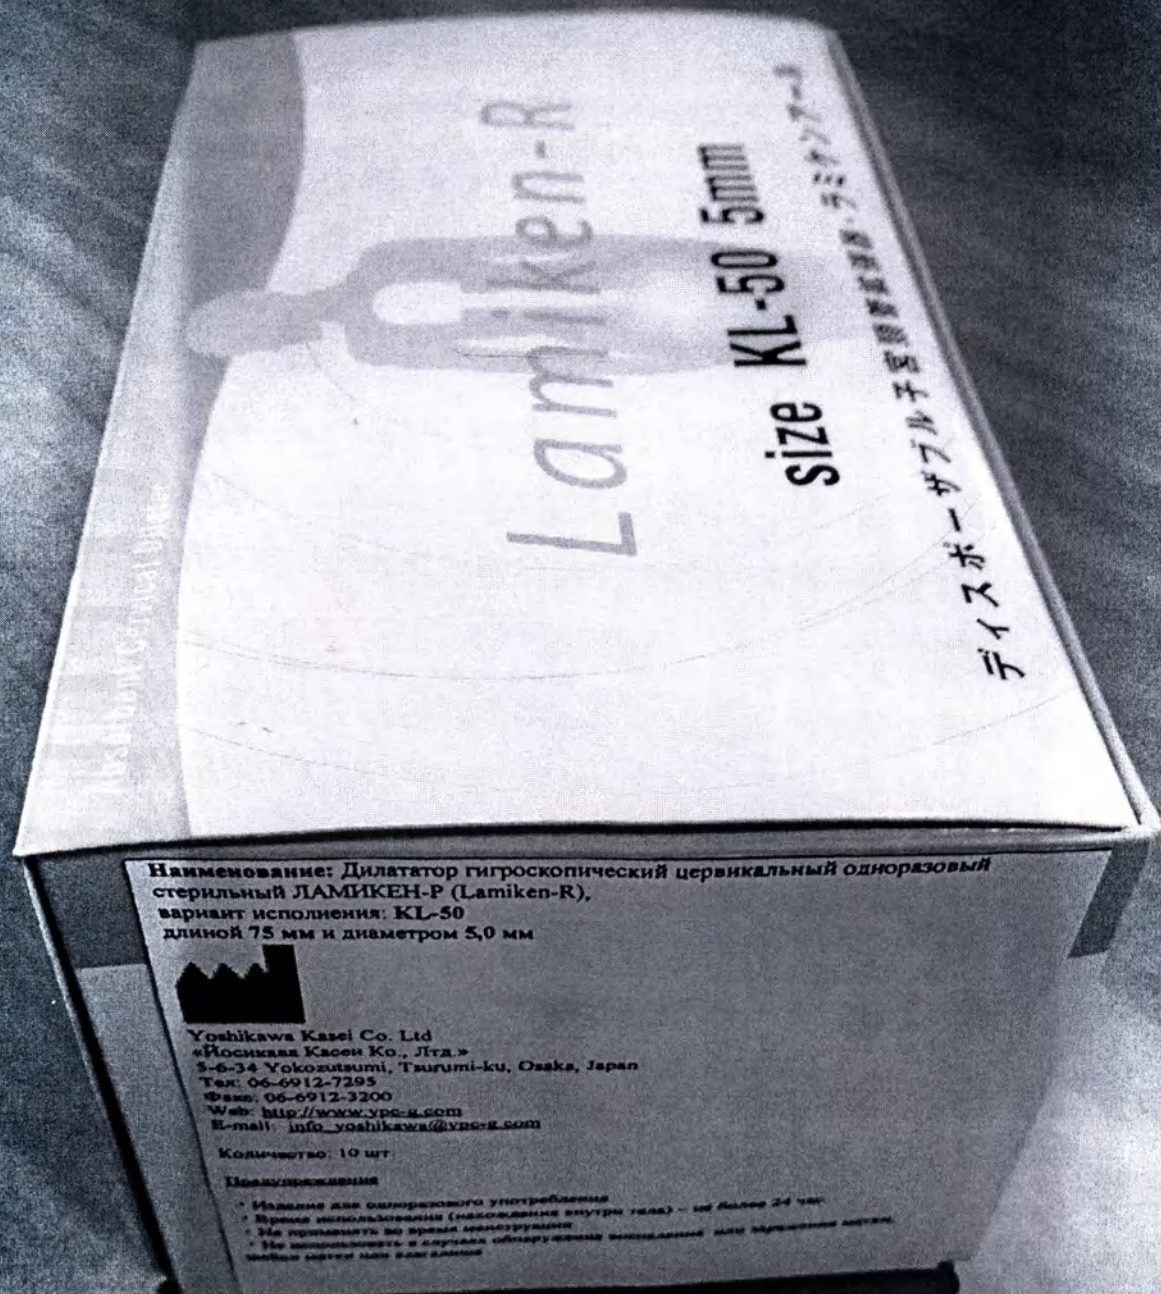

Наименование: Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый
стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
вариант исполнения: KL-50
длиной 75 мм и диаметром 5,0 мм




Yoshikawa Kasei Co. Ltd
«Йосикава Касей Ко., Лтд.»
3-6-34 Yokozutsumi, Tsurumi-ku, Osaka, Japan
Тел: 06-6912-7295
Факс: 06-6912-3200
Web: <http://www.ykc-g.com>
E-mail: info_yoshikawa@ykc-g.com

Количество: 10 шт.

Примечания

- Изделие для однократного использования
- Время использования (нахождения внутри тела) – не более 24 час.
- Не применять во время менструации
- Не использовать в случае обнаружения воспалений или инфекций половых органов

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки, бо-
ковая сторона, маркировка 2).

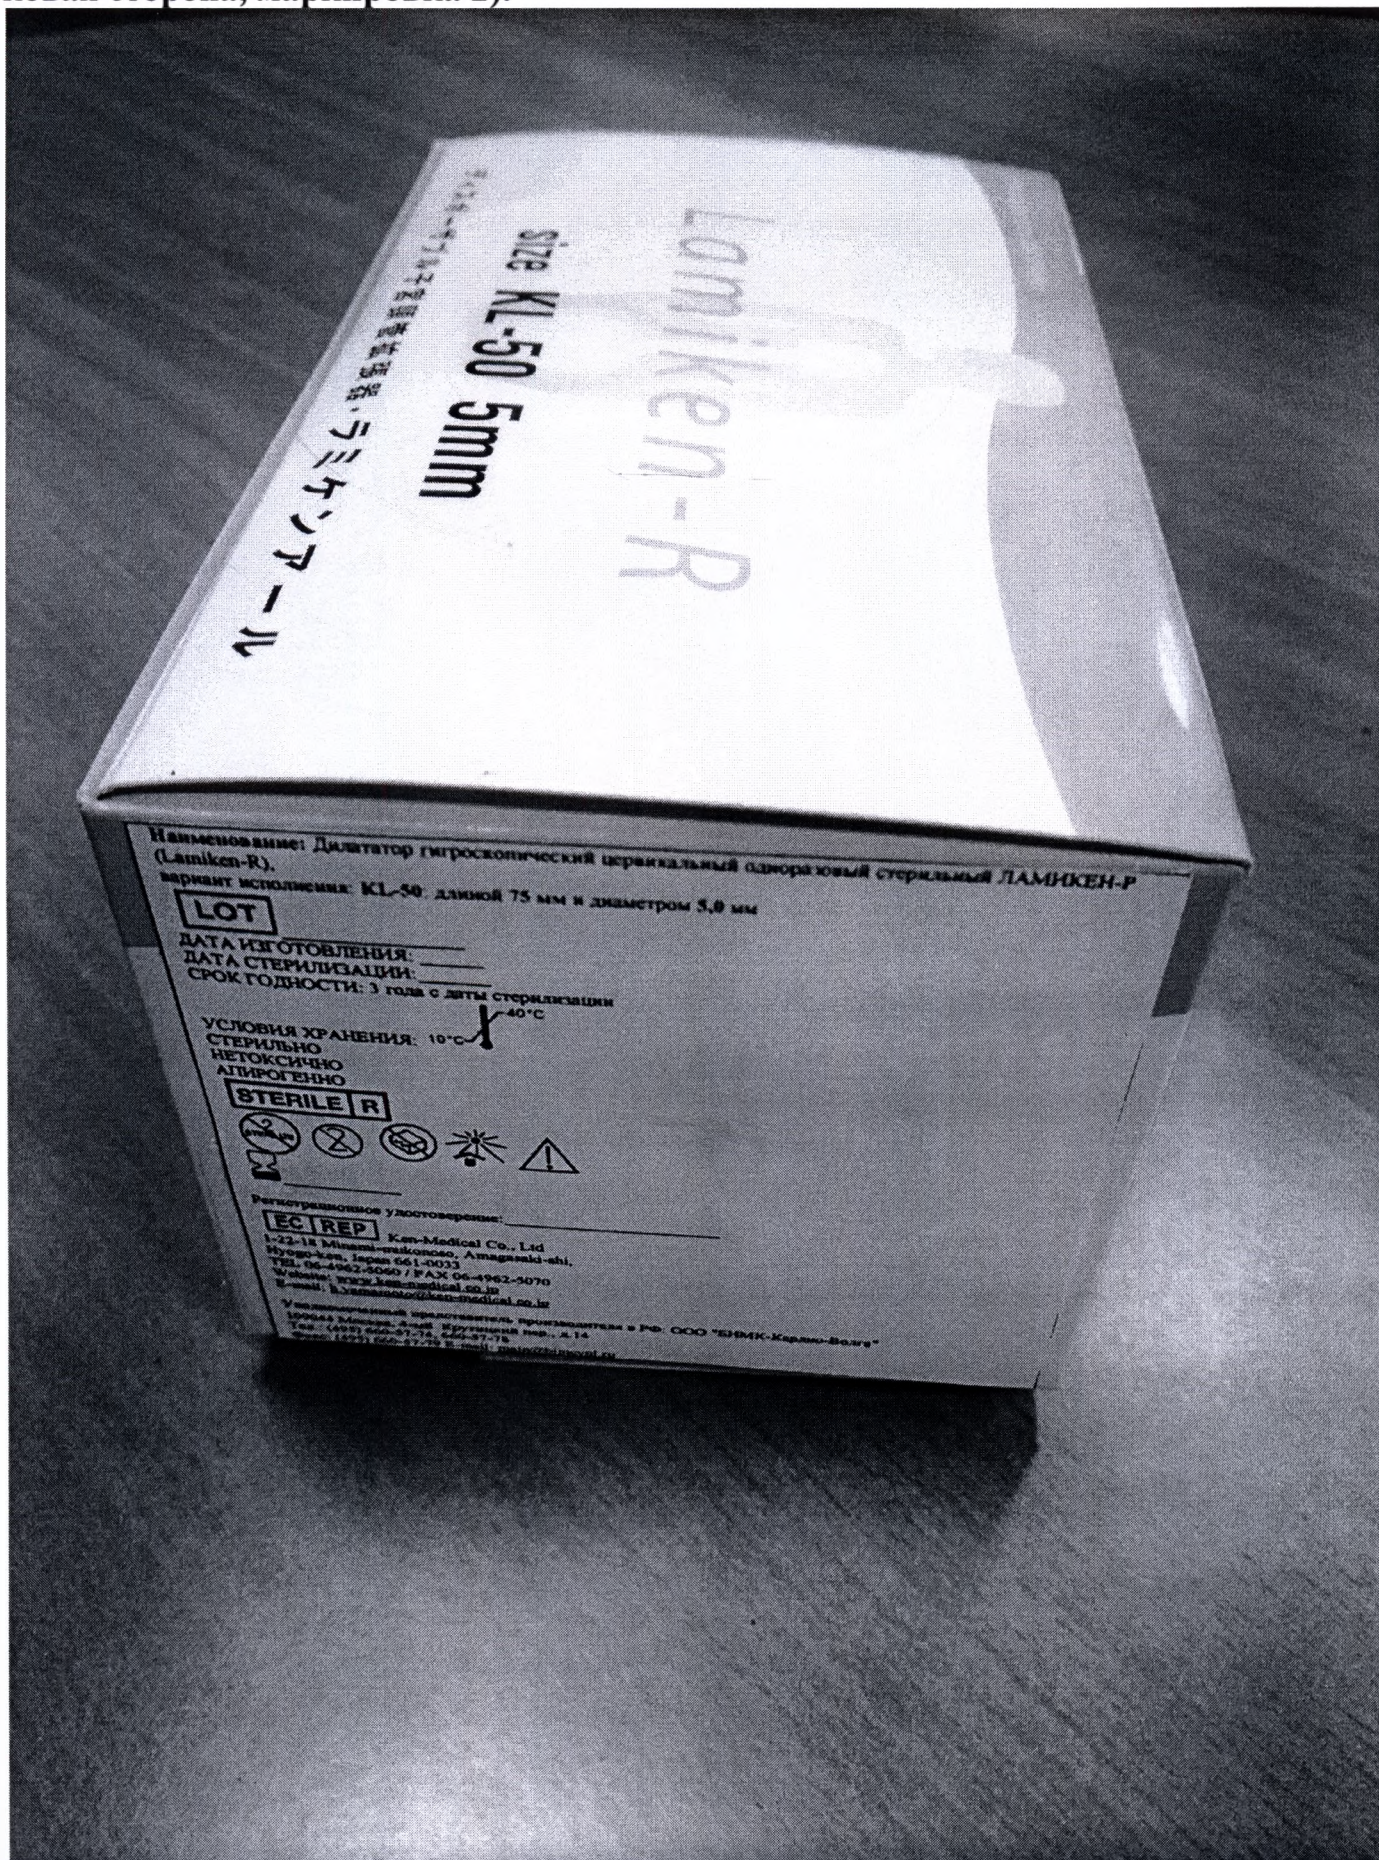

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки и
индивидуальной упаковки).



Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (общий вид коробки и вскрытой индивидуальной упаковки).



Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (индивидуальная упаковка, лицевая сторона, маркировка 1).



Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный
ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (индивидуальная упа-
ковка, обратная сторона, маркировка 2).


Наименование: Дилататор гигроскопический цервикальный
одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R),
вариант исполнения: KL-50: длиной 75 мм и диаметром 5,0 мм

LOT

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____
ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ: _____
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты стерилизации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 10°C — 40°C
СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО
АПИРОГЕННО

STERILE R



Регистрационное удостоверение: _____

EC REP

Ken-Medical Co., Ltd
1-22-18 Minami-mukonosu, Amagasaki-shi,
Hyogo-ken, Japan 661-0033
TEL 06-4962-5060 / FAX 06-4962-5070
Website: www.ken-medical.co.jp
E-mail: h.yamamoto@ken-medical.co.jp

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО
"БИМК-Кардио-Волга"
109044 Москва, 4-ый Крутицкий пер., д. 14
Тел.: (495) 660-57-74, 660-57-78
Факс: (495) 660-57-79 E-mail: main@bimcvol.ru



(01)04582266800236




製造販売業者

ケン・メディカル株式会社


〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06 (4962) 5060 FAX 06 (4962) 5070

Дилататор гигроскопический цервикальный одноразовый стерильный ЛАМИКЕН-Р (Lamiken-R), вариант исполнения: KL-50 (вид извлеченного из индивидуальной упаковки МИ).

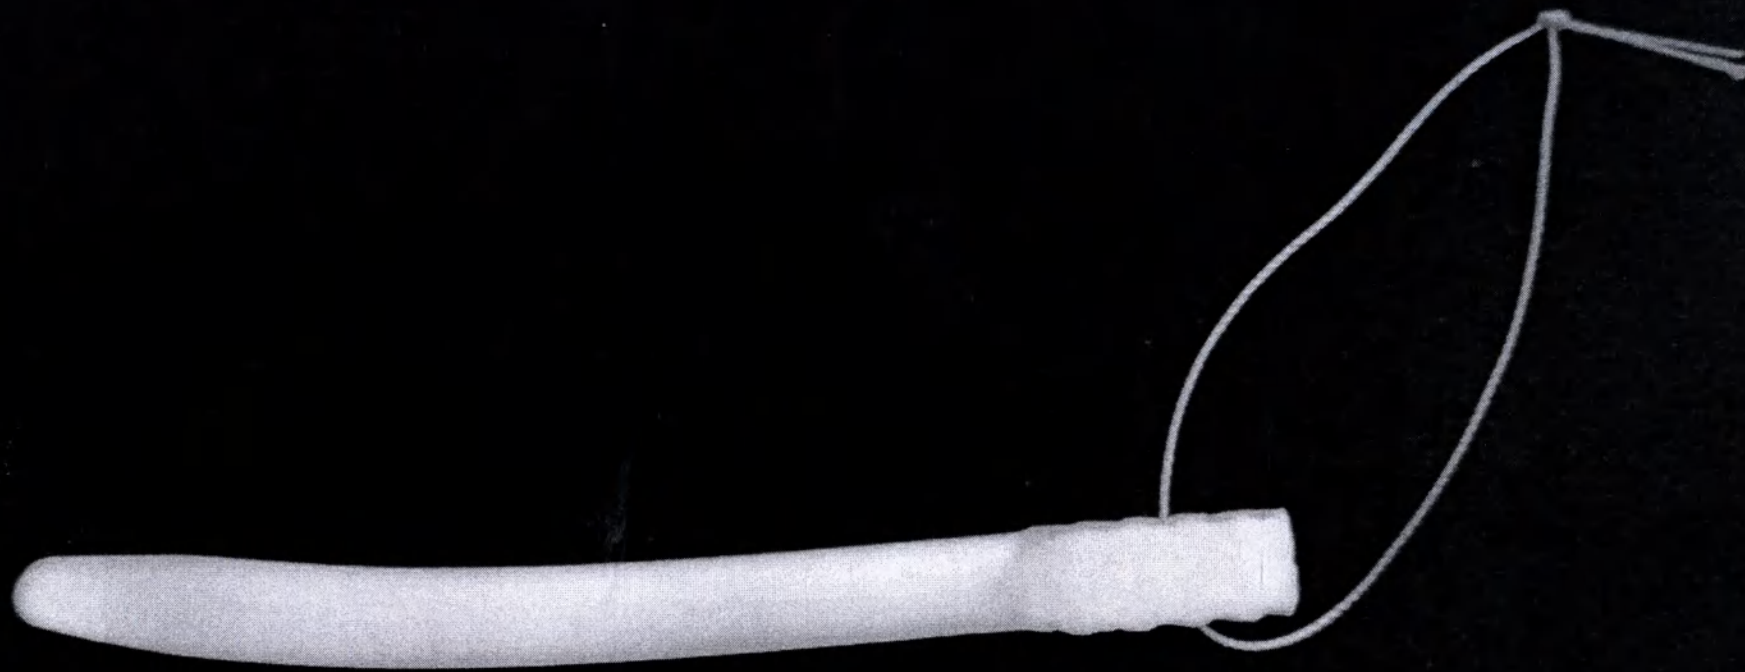

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 17 листов

Генеральный директор
ООО "БИМК-Кардио-Волга"


Тетунашина Н.В.

