

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ООО «Шаклин»


ИП. А.В. Романов


«16 » августа_2018



ФОТОГРАФИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Катетеры медицинские однократного применения Inekta
производства Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.)**

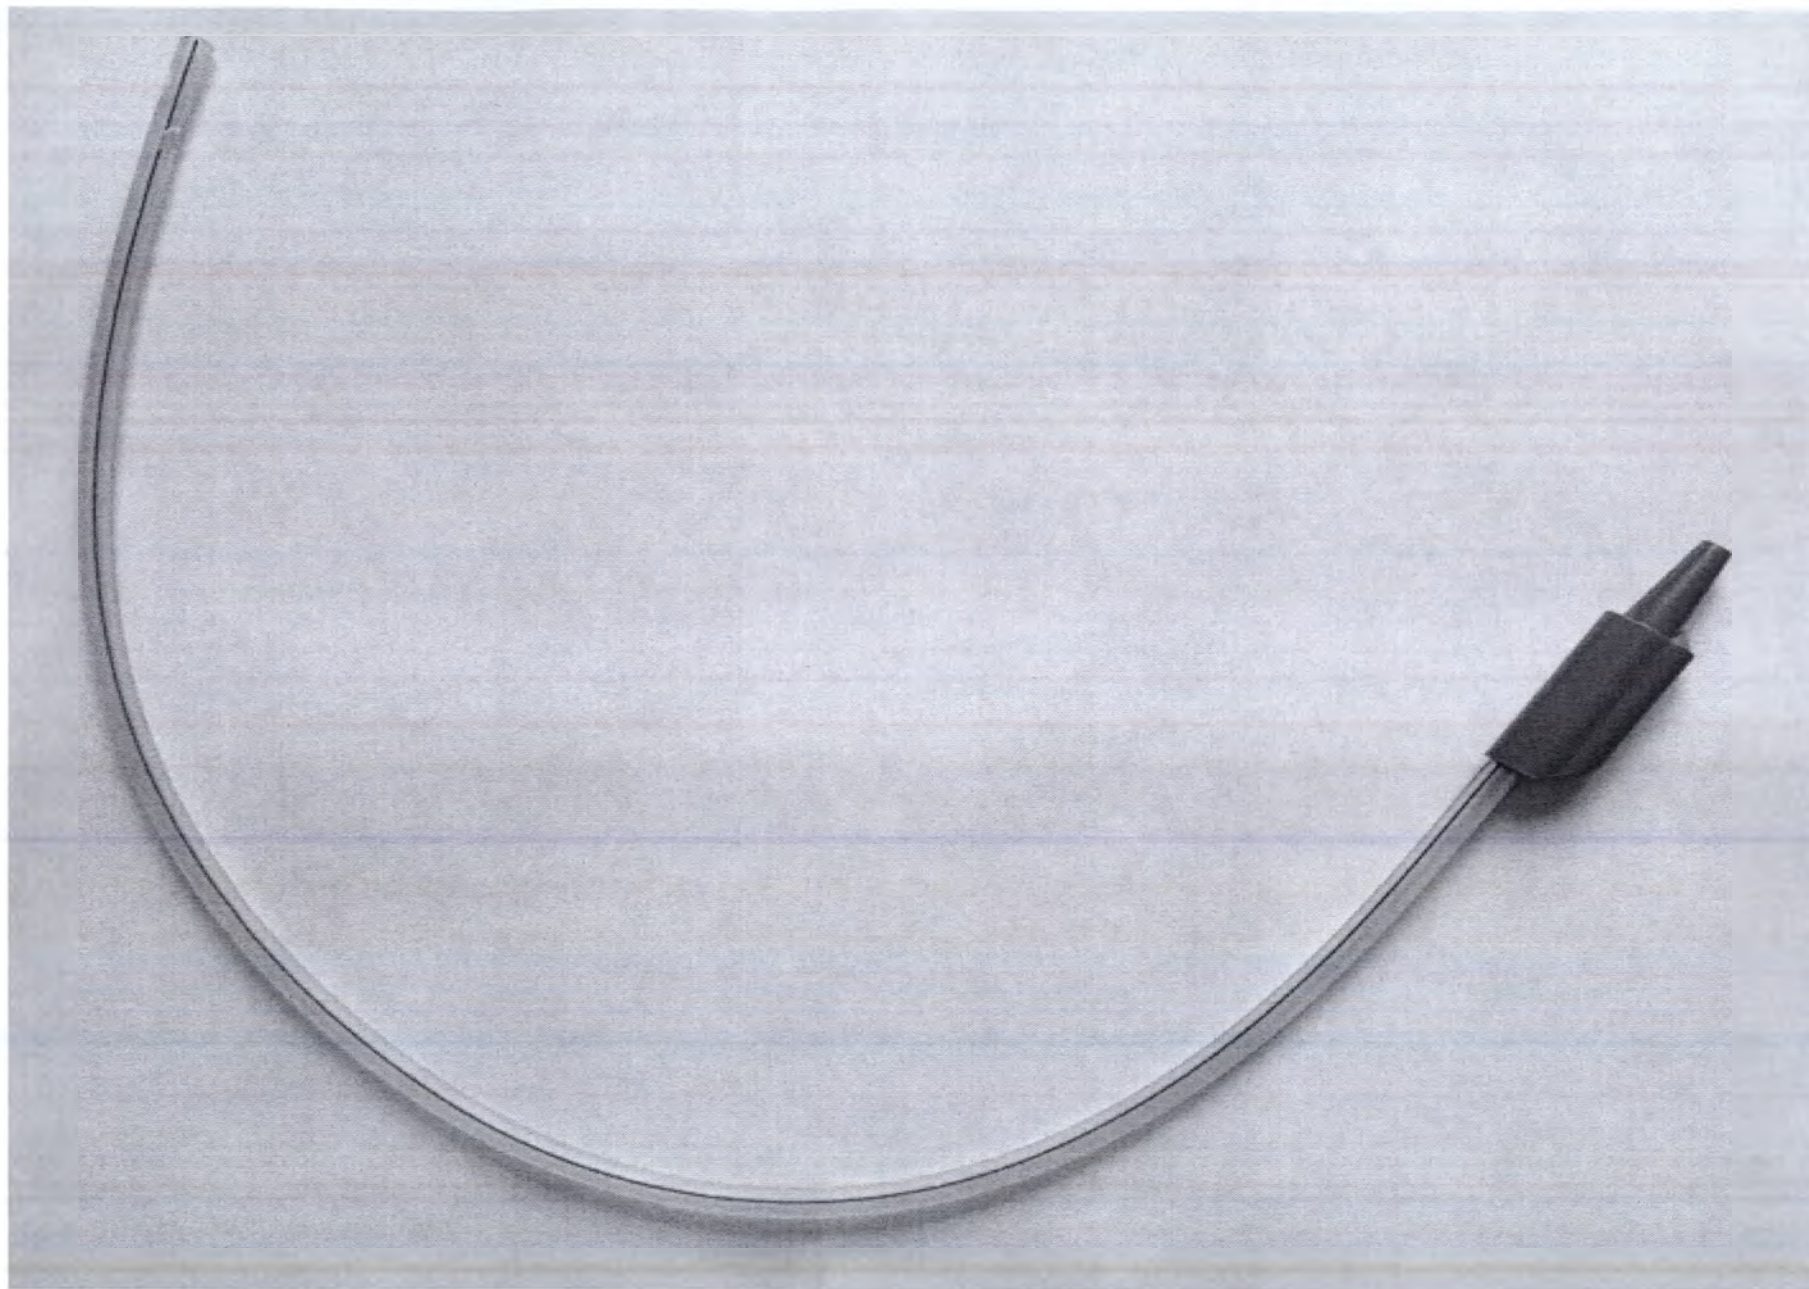

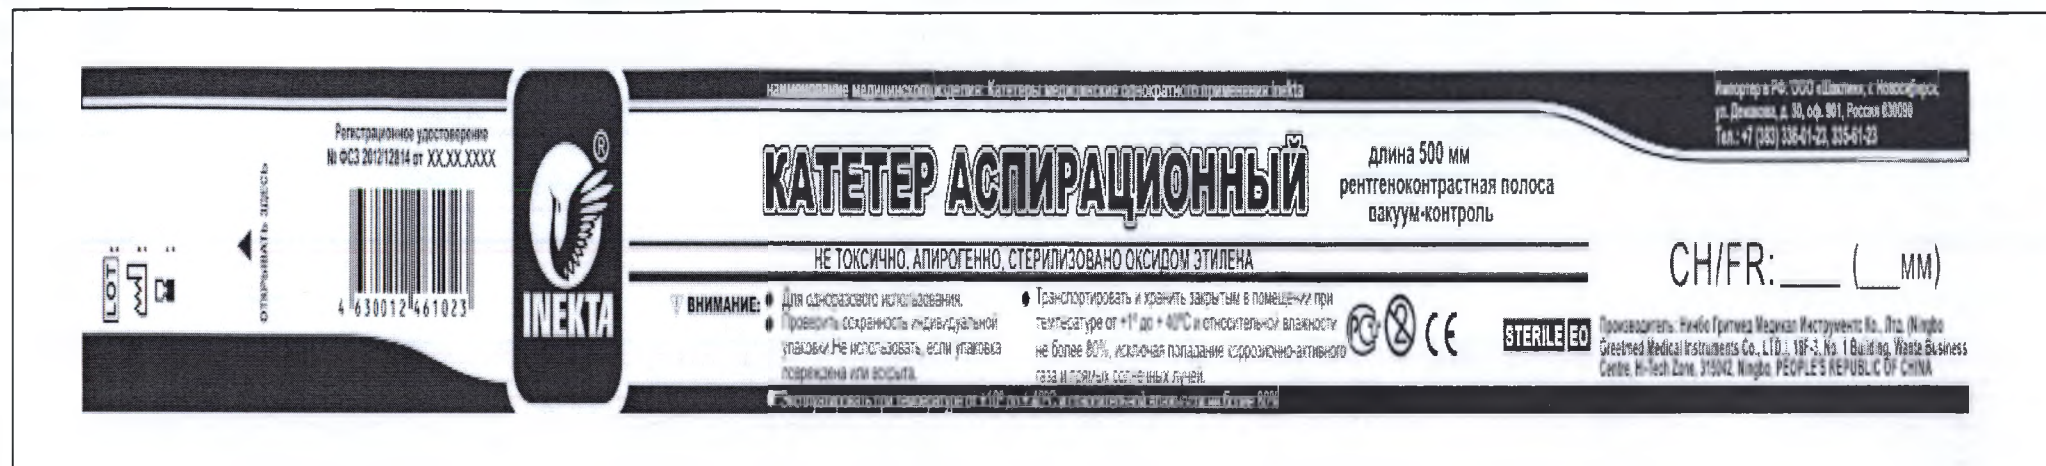



КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

Адрес: г. РФ, 000 «Шанхай» в Новосибирск,
ул. Демидова д. 38 оф. 901 Россия 630090
Тел: +7 (383) 335-61-23, 335-61-25

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

длина 500 мм рентгеноконтрастная полоса вакуум-контроль



CHIEF: (mm) ШТ. ОТЧ. 100

Рентгеноконтрастная полоса

длина 500 мм

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ

STERILE EO CE PG

№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX





Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские одноразового применения Inekta



КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ

длина 500 мм рентгеноконтрастная полоса вакуум-контроль

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ВНИМАНИЕ:

- Для одноразового использования.
- Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.

- Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.




Производитель: Нинбо Гринмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wanta Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: ООО «Шанхай» в Новосибирск, ул. Демидова, д. 38, оф. 901, Россия 630090 Тел: +7 (383) 335-61-23, 335-61-25





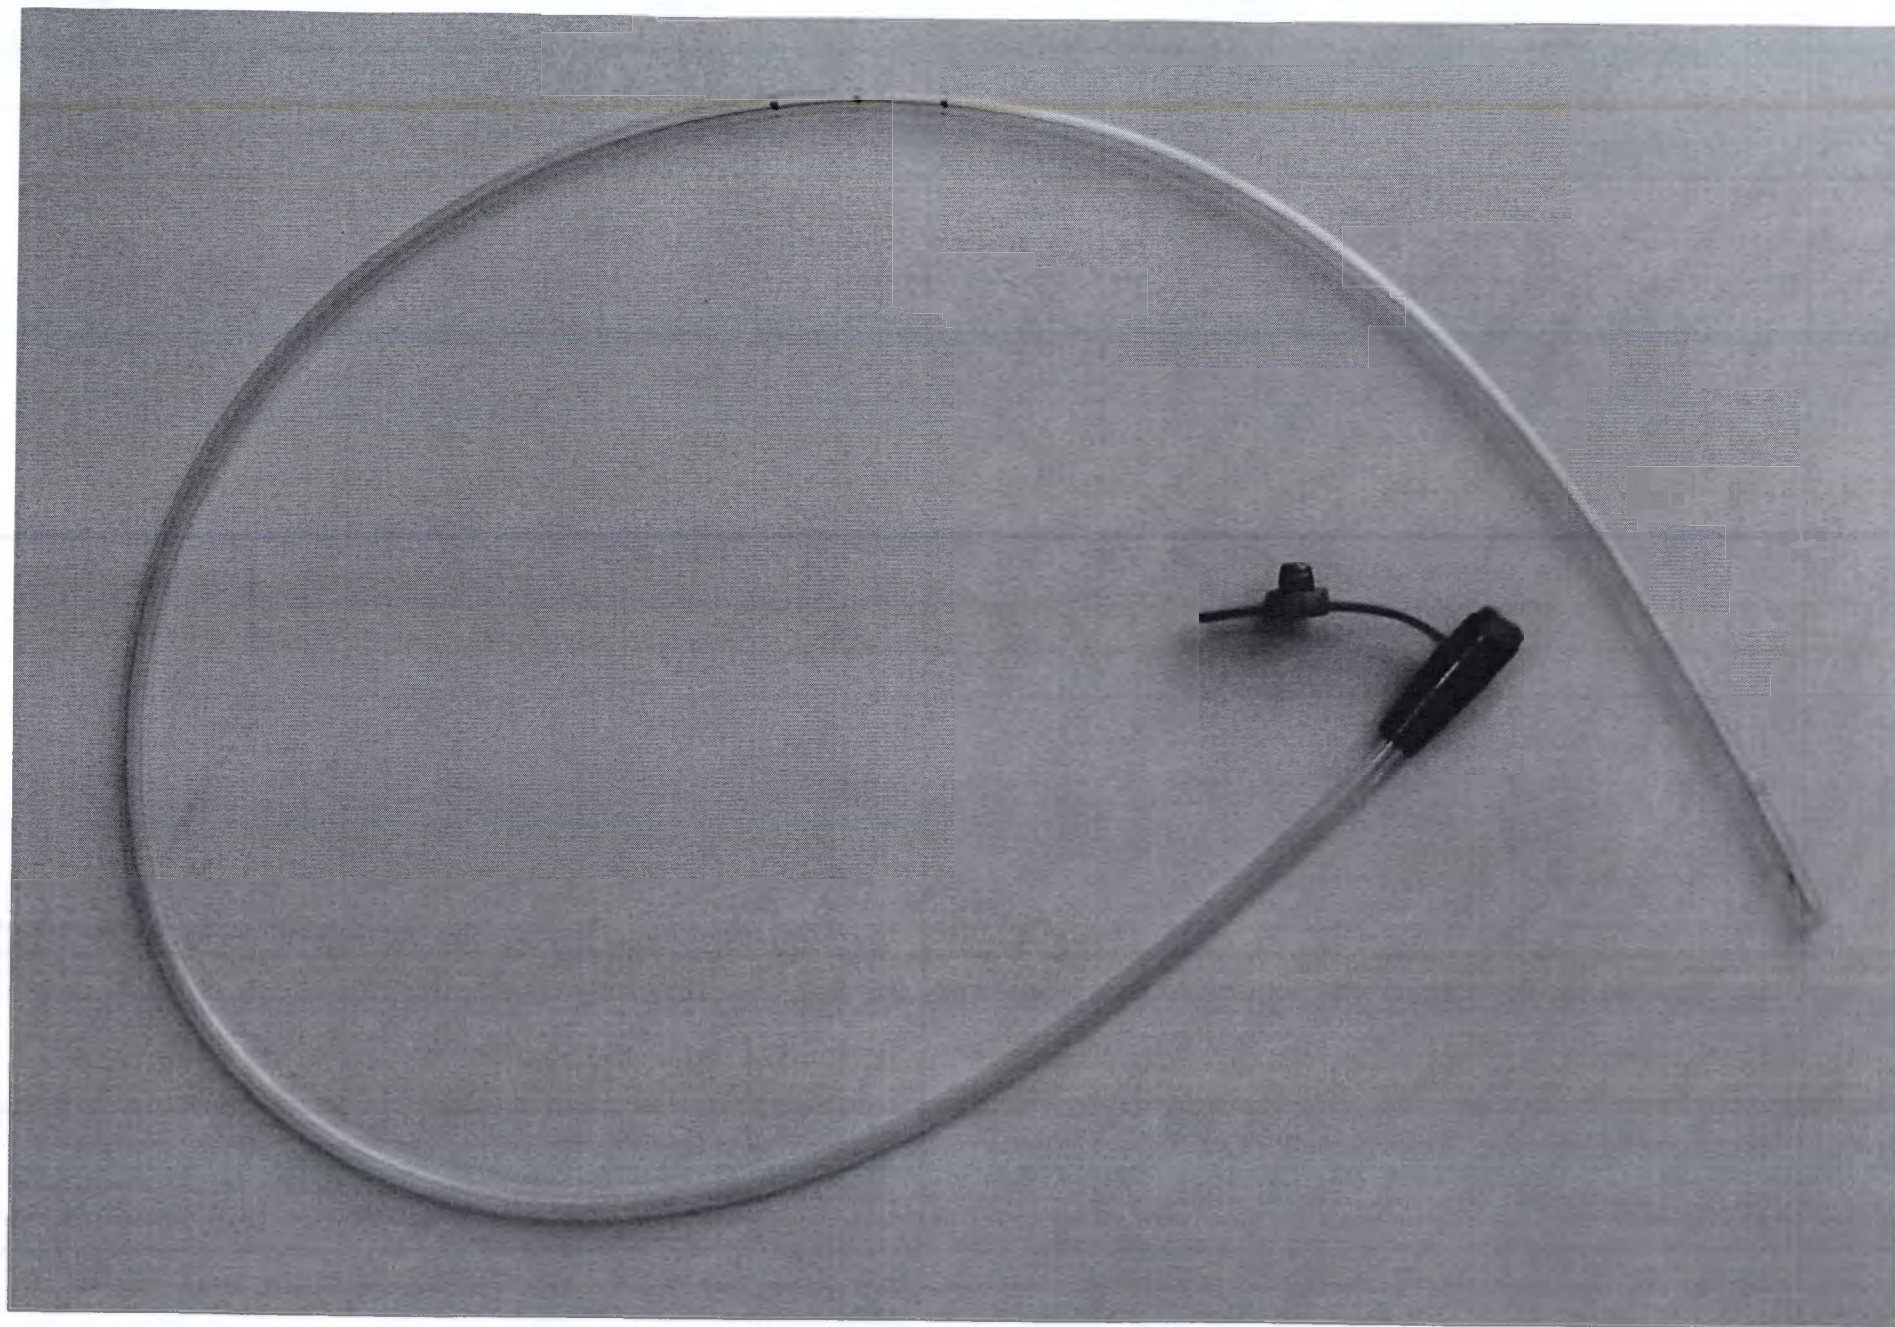

Импортер в РФ: ООО «Шахлин», г. Новосибирск,
ул. Демикова, д. 30, оф. 301, Россия 630090.
Тел. +7 (383) 336-61-23, 335-61-23



наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские одноразового
применения Ineka
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:
1а - 15 см 2а - 16 см 3а - 17 см

CH/FR:

LOT:



STERILE EO НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Производитель: Нинбо Гринмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

- Для одноразового использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки.
Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.

- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%.



Катетер питающий. Макет маркировки групповой упаковки.



КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса

STERILE|EO

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1я - 15 см 2я - 16 см 3я - 17 см





КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса



Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1я - 15 см 2я - 16 см 3я - 17 см

STERILE|EO



КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА



PCSI/MT

CH/RP: QTY:



STERILE|EO

ВНИМАНИЕ:

- Для одноразового использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°C и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов

Регистрационное удостоверение № 003 2012/2814 № XX.XX.XXXX

наименование медицинского изделия. Катетеры медицинского назначения Inekta

КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ


длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)



Импортёр в РФ: ООО «Шалкин», г. Новосибирск,
ул. Демакова, д. 30, оф. 901. Россия 630090.
Тел. +7 (383) 336-01-23. 335-61-23

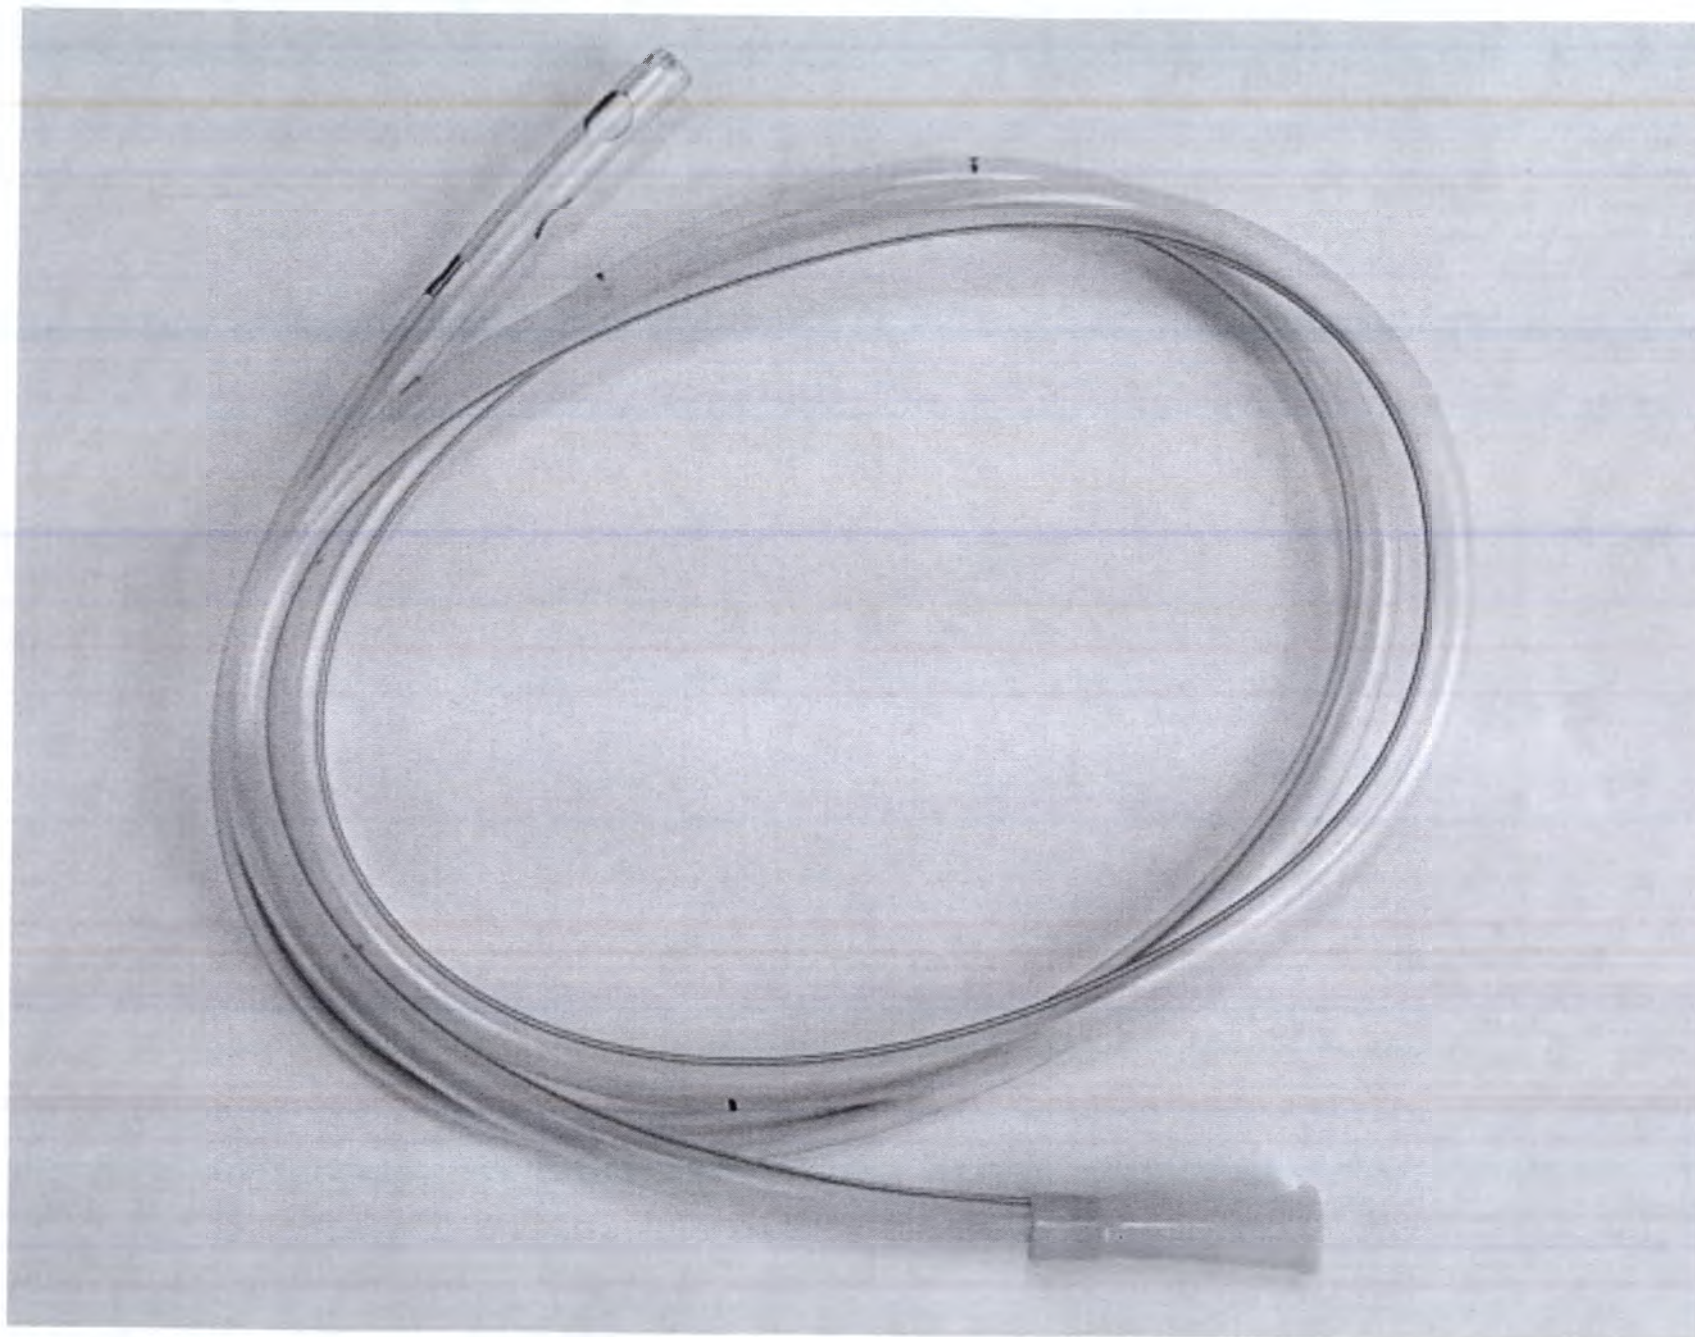

Катетер желудочный. Макет маркировки индивидуальной упаковки.

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

⚠ **ВНИМАНИЕ:**

- Для одноразового использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°C и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°C и относительной влажности не более 80%.

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск,
ул. Демисова, д. 10, оф. 901, Россия 630090.
Тел. +7 (383) 336-01-23, 335-01-23

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:
1я - 40 см, 2я - 45 см, 3я - 50 см, 4я - 55 см, 5я - 60 см.

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного применения Inekta

КАТЕТЕР
ЖЕЛУДОЧНЫЙ

длина 110 см
рентгеноконтрастная полоса

CH/FR:

LOT:



STERILE EO



открывать здесь



КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ

длина 110 см

STERILE EO  

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1я - 40 см	3я - 50 см	5я - 60 см
2я - 45 см	4я - 55 см	



КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ

длина 110 см

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



CH/FR: QTY: LOT: PCS/шт



4 630012 461016

Импортёр в РФ: ООО «Швайн», г. Новосибирск, ул. Демкова, д. 30, оф. 901, Россия 630090, Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23



длина 110 см

КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1я - 40 см	3я - 50 см	5я - 60 см
2я - 45 см	4я - 55 см	

STERILE EO  



наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские одноразового применения Inekta

КАТЕТЕР ЖЕЛУДОЧНЫЙ

длина 110 см

рентгеноконтрастная полоса

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

STERILE EO  

ВНИМАНИЕ:


- Для одноразового использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12514 от XXX.XX.XXXX

Импортёр в РФ: ООО «Швайн», г. Новосибирск, ул. Демкова, д. 30, оф. 901, Россия 630090, Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23


Катетер Нелатона

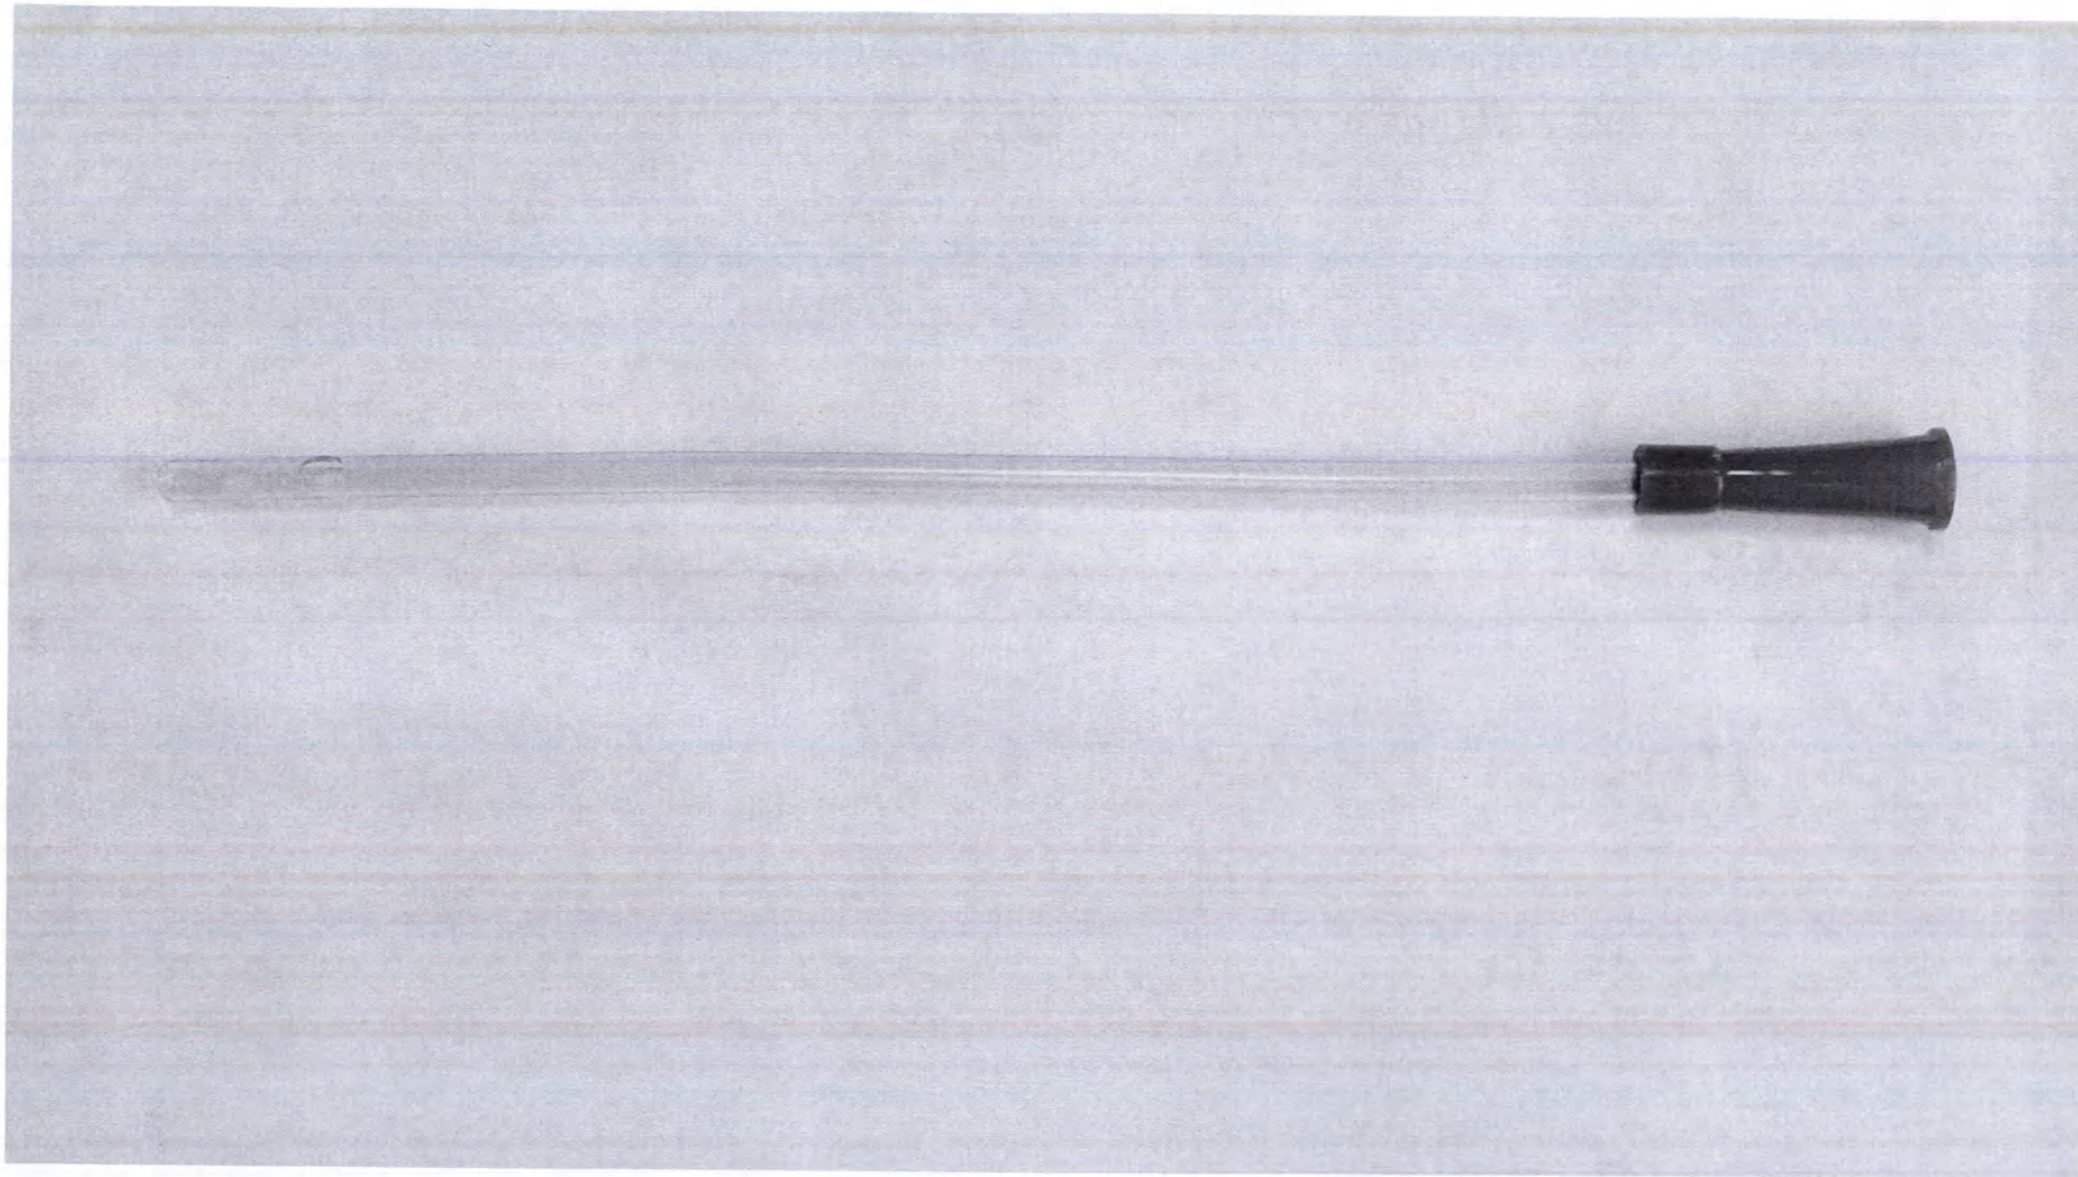

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские
однократного применения Inekta

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ





ИНЕКТА

длина
200 мм

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

- Для однократного использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%

CH/FR:

STERILE EO


LOT

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал
Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed
Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1
Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone,
315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова,
д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23




4 630012 460972

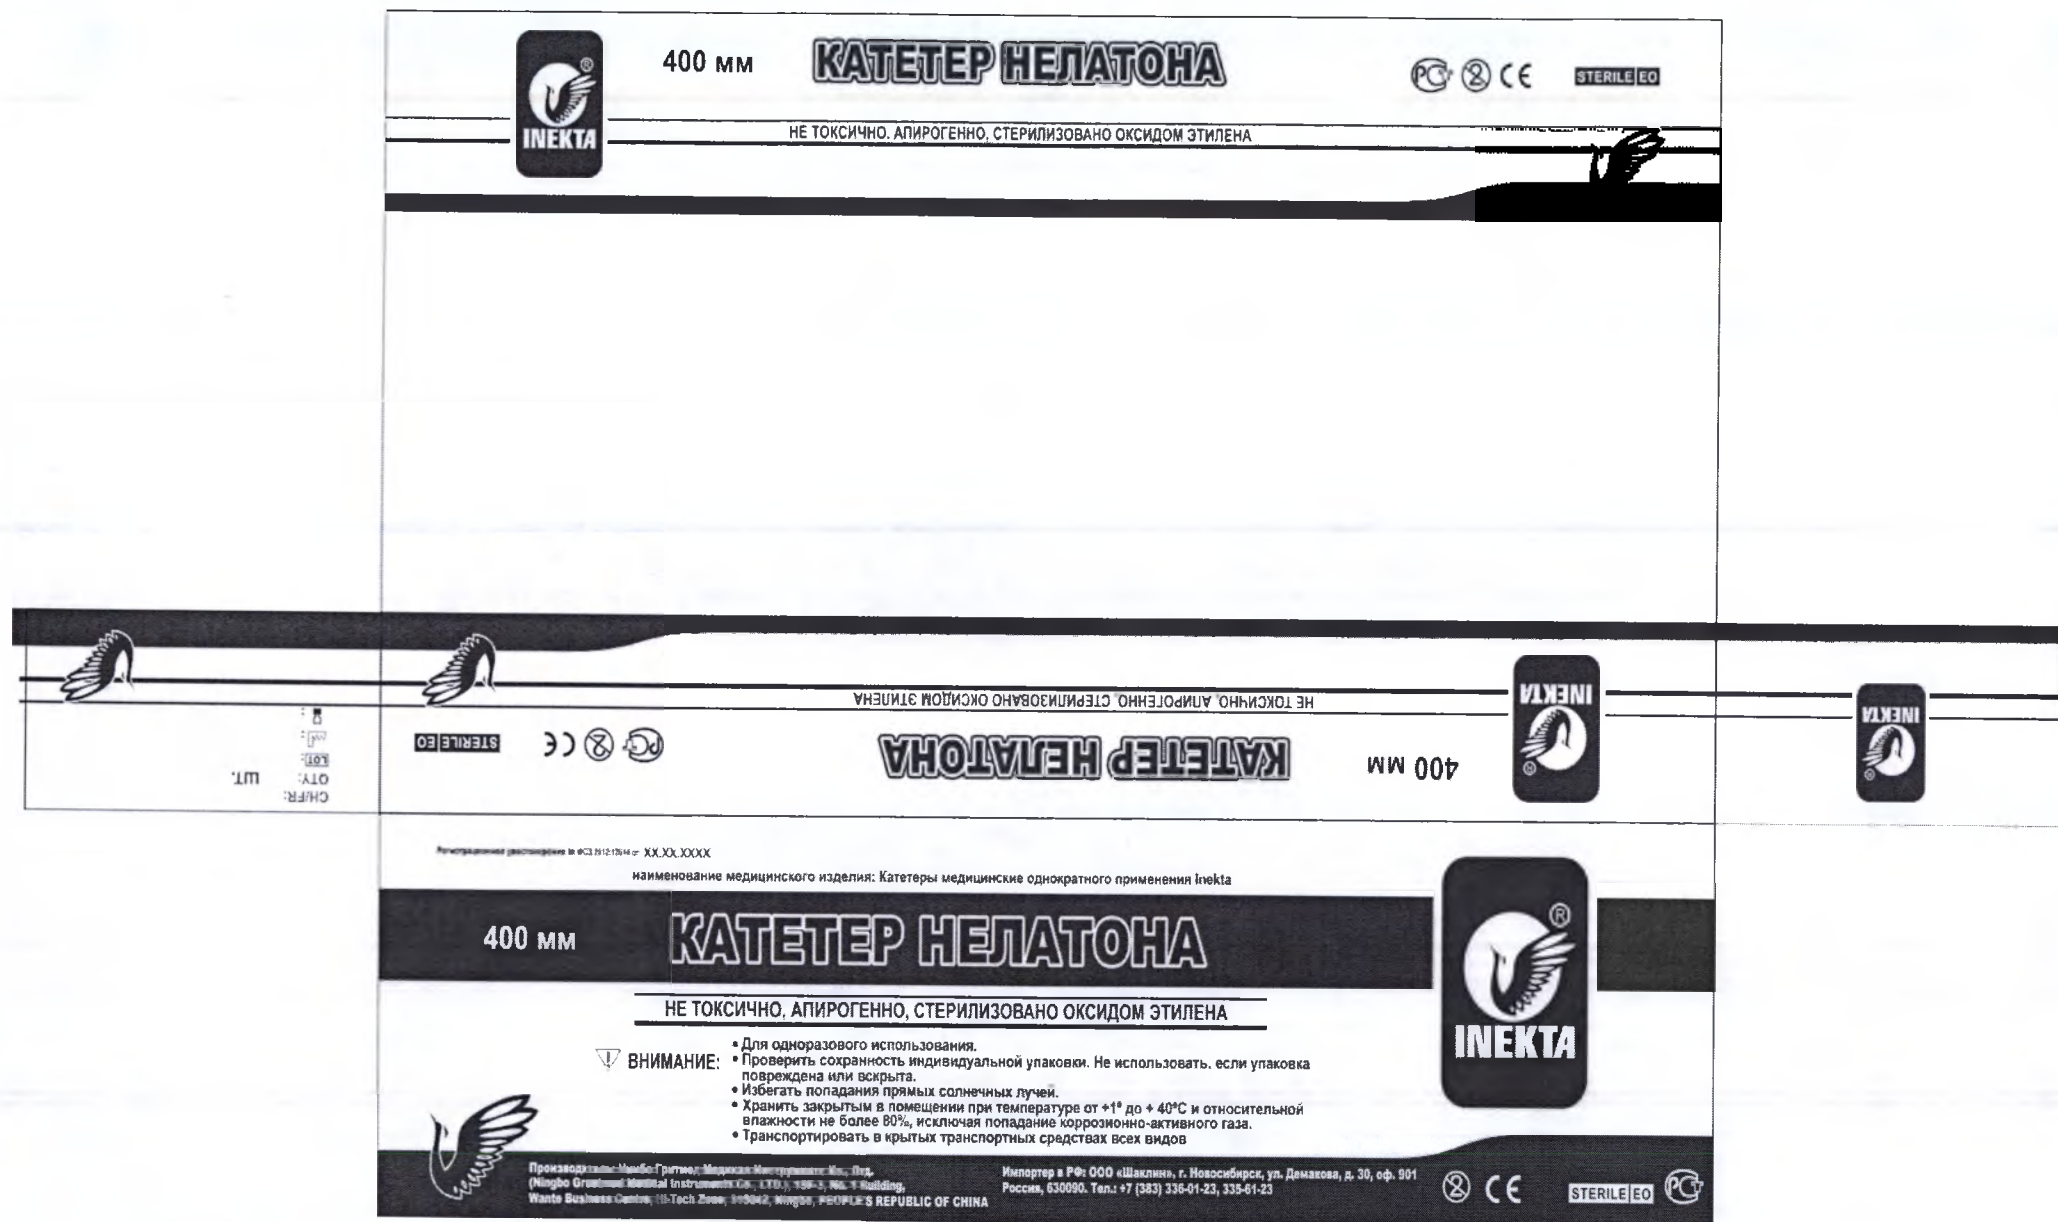


Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, двухходовой)

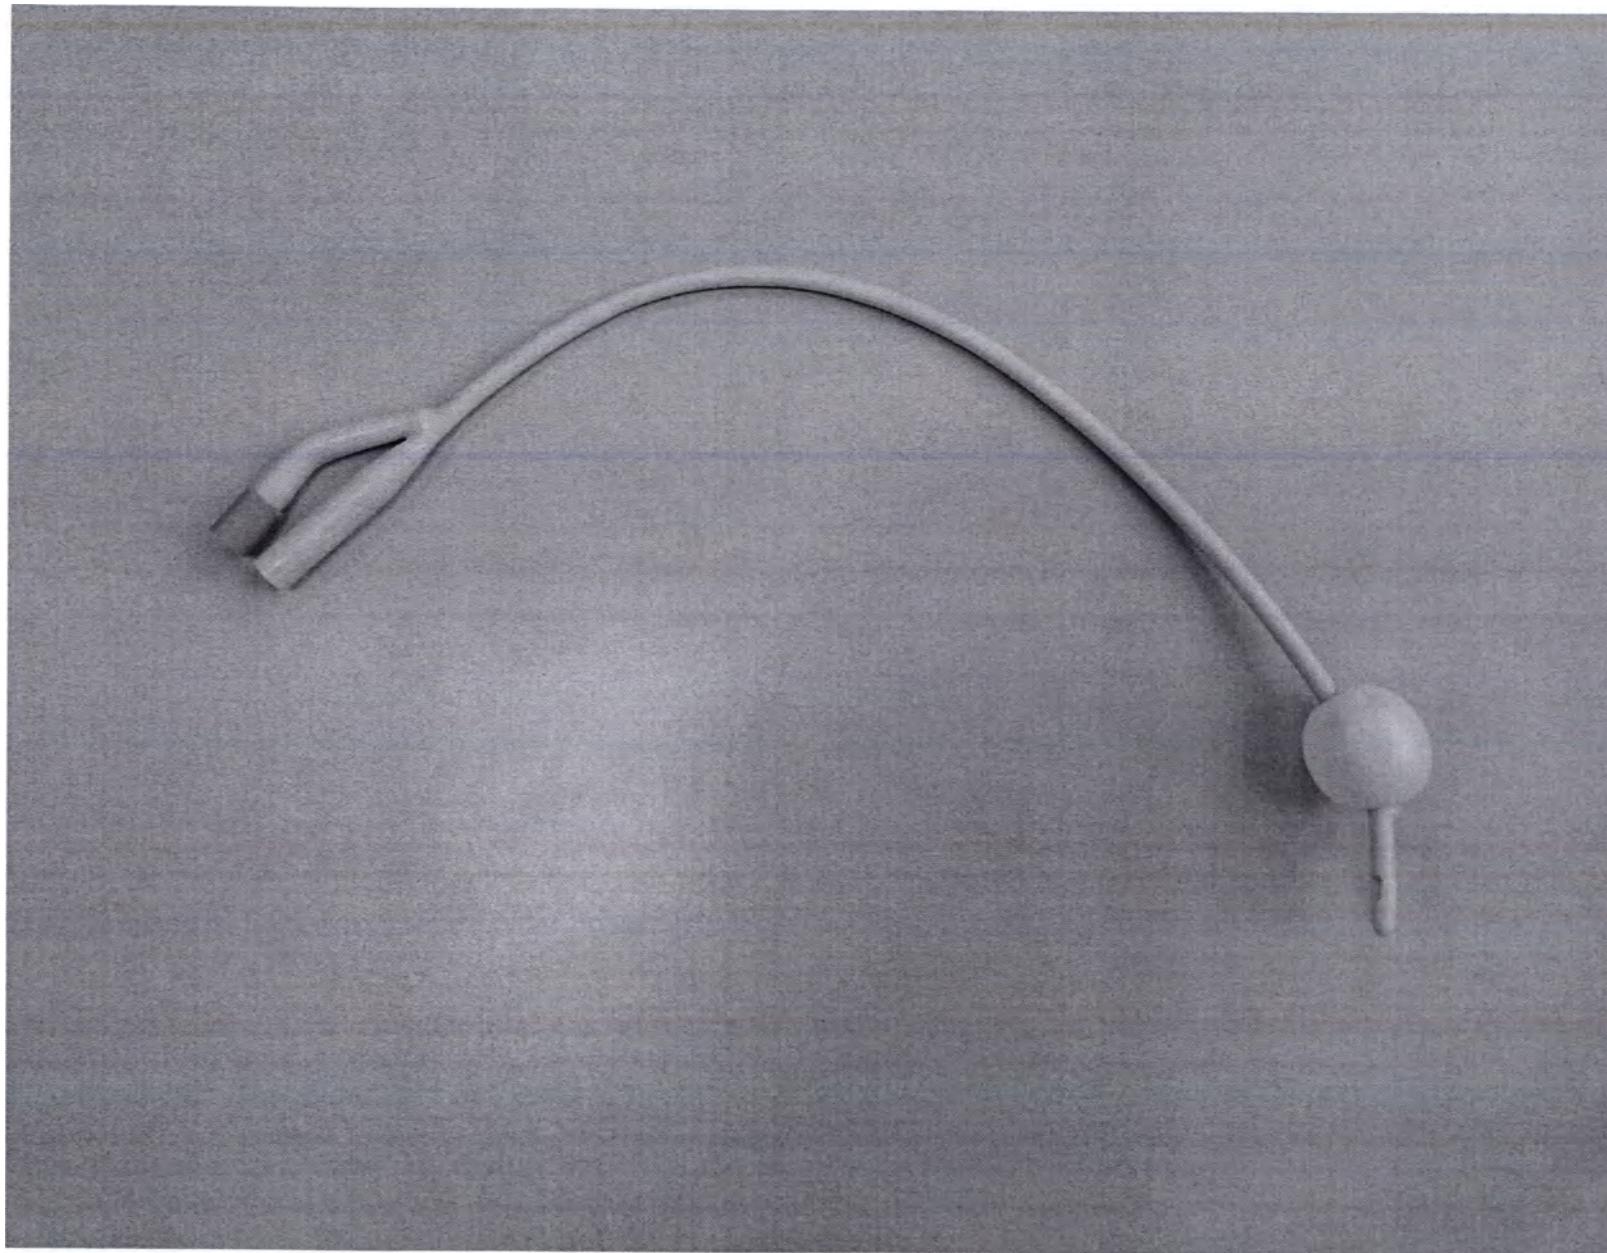

Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, трехходовой)

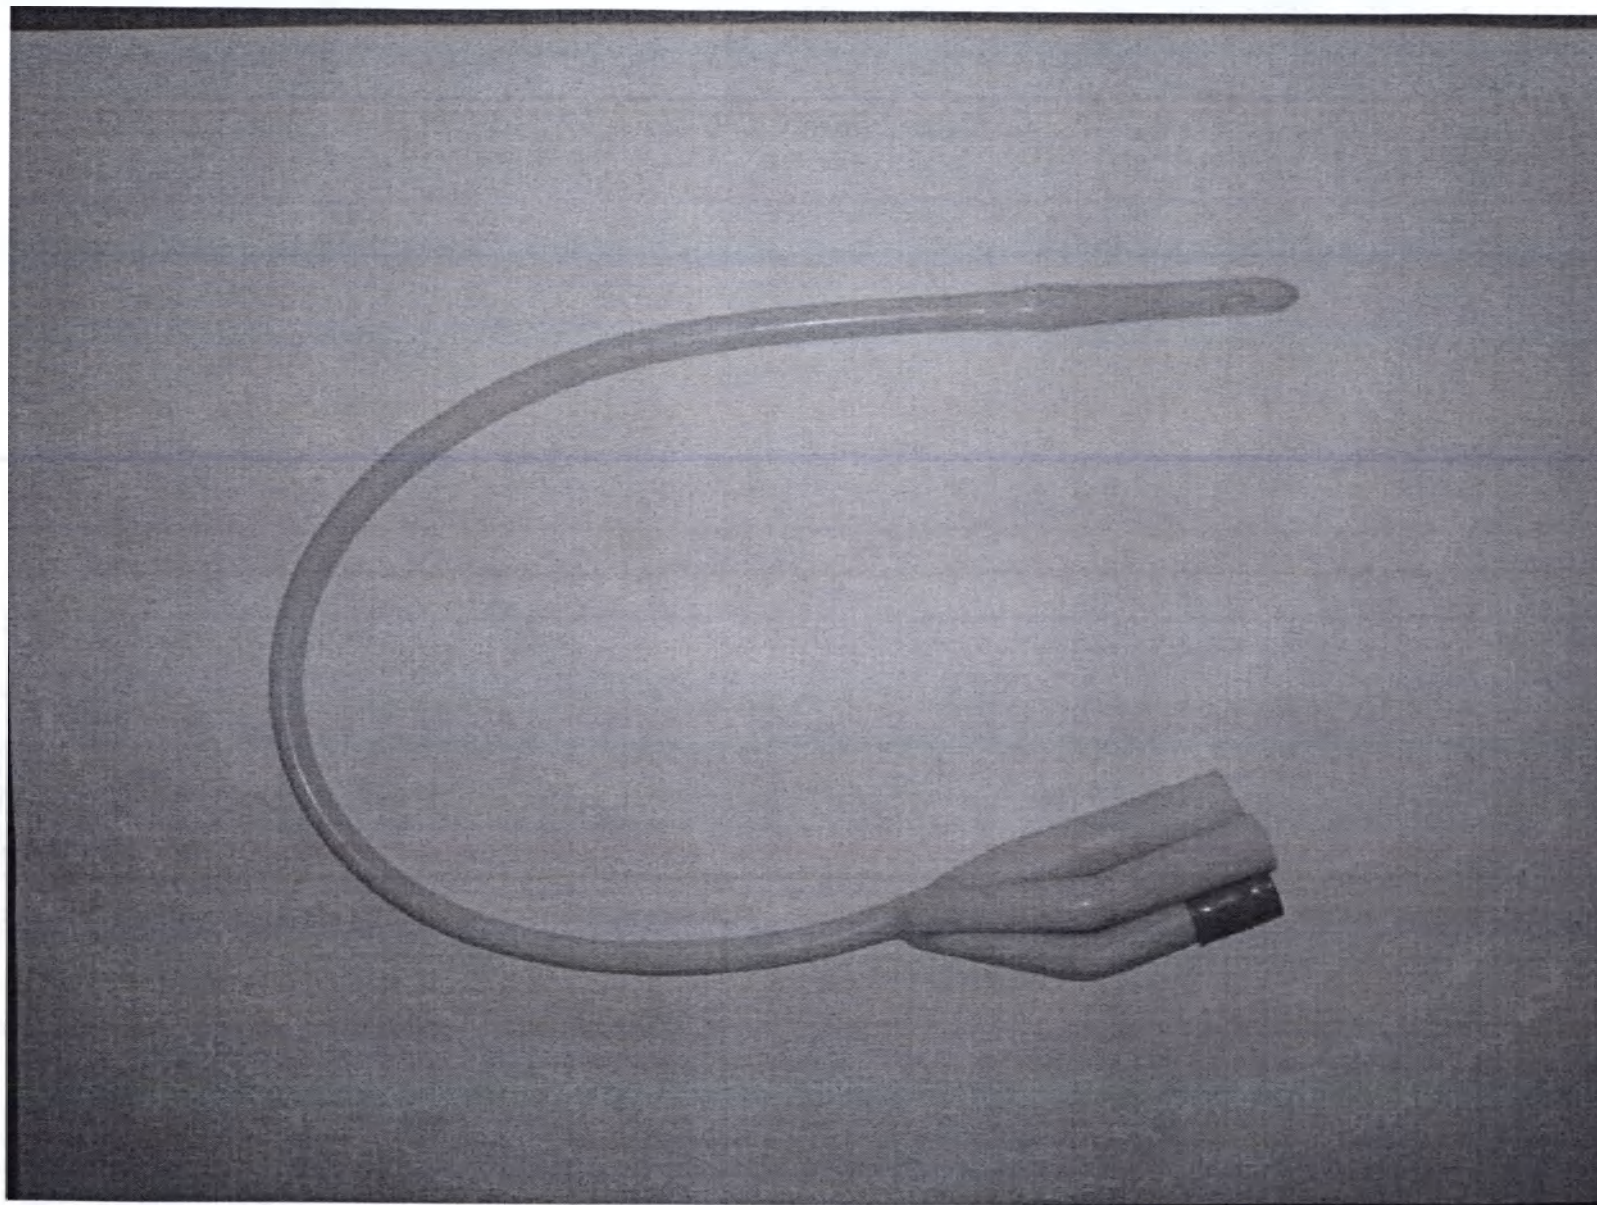

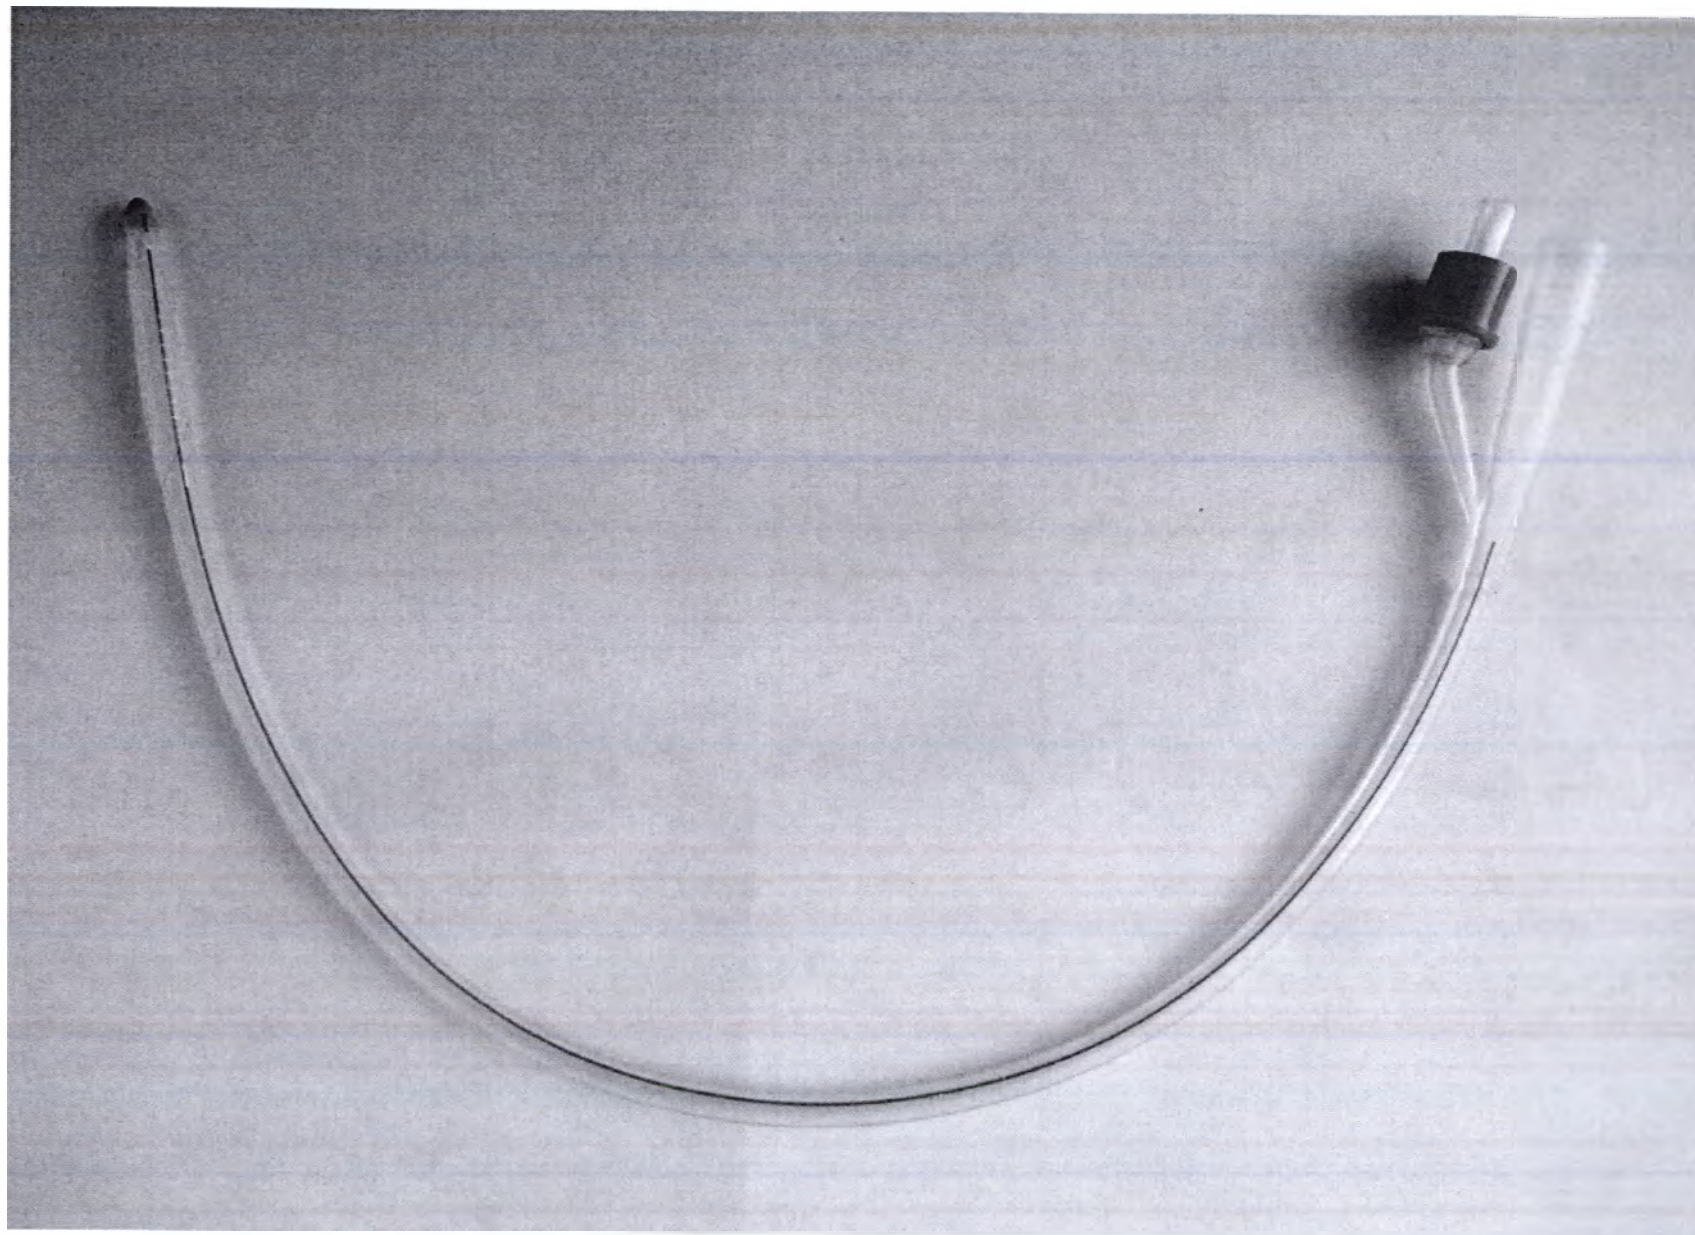


Катетер Фолея. Макет маркировка индивидуальной упаковки (пример).



ВНИМАНИЕ:

- * Для одноразового использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.

STERILE EO



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX



длина 400 мм

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного применения Inekta

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

НЕ ТОКСИЧНО. АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ЛАТЕКСНЫЙ С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901
Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23

3-WAY/3-ХОДОВОЙ

ML:

CH/FR:

LOT:





STERILE EO

НЕ ТОКСИЧНО, АЛКОГОЛЬНО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКИДОМ ЭТИЛЕНА



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

KATEPΦOΛEY



КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

НЕ ТОКСИЧНО. АПИРОГЕННО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ЛАТЕКСНЫЙ С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

**НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА**

ЛАТЕКСНЫЙ С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

CE (PC)


② **STERILE EO**

длина 400 мм

▽ ВНИМАНИЕ:

- * Для одноразового использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°C и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- * Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.


STERILE EO



Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901
Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 336-61-23

3-WAY/3-ХОДОВОЙ
ML: 30
CH/FR:


WEKTA

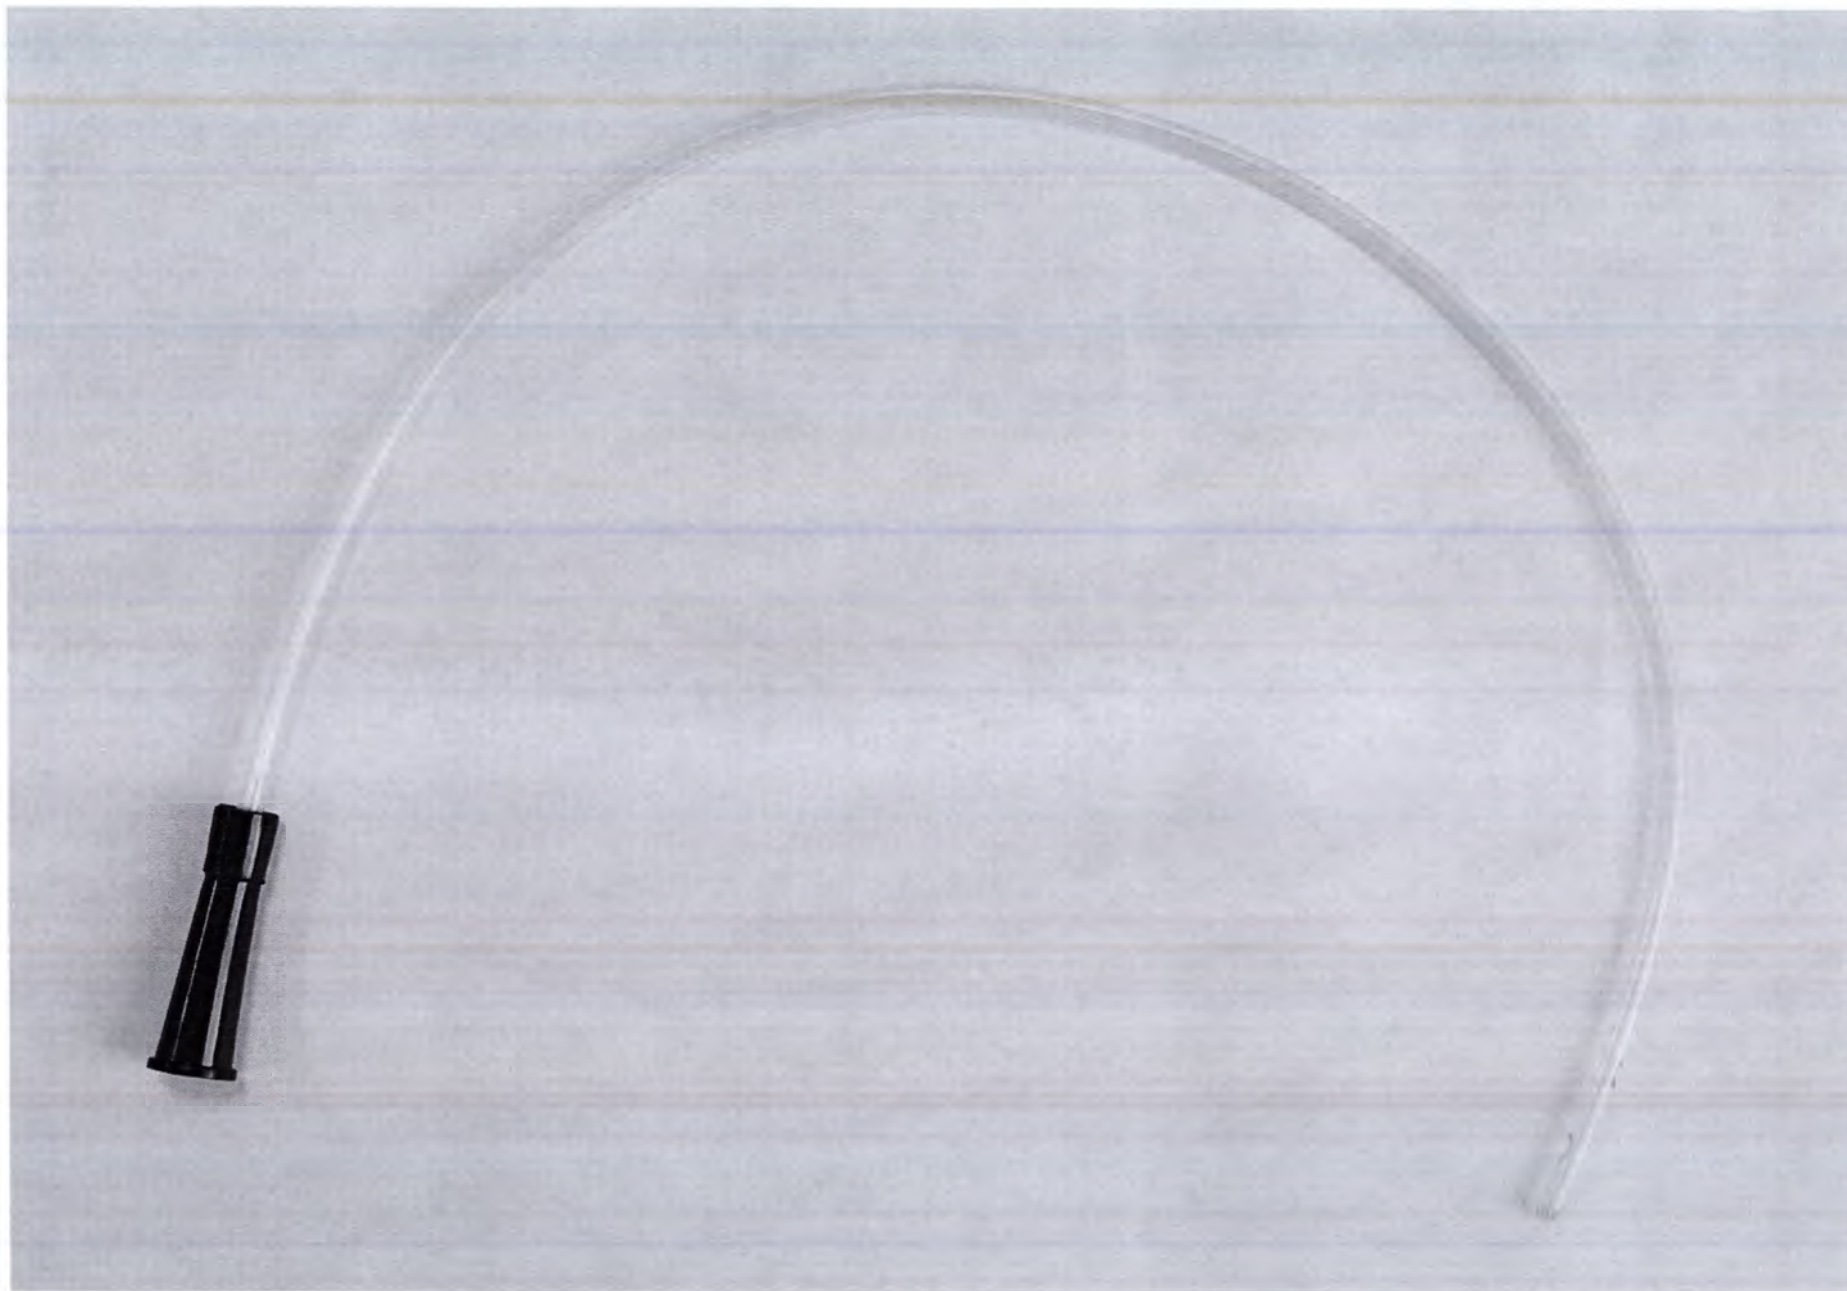

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские
однократного применения Inekta

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814
от XX.XX.XXXX

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



КАТЕТЕР РЕКТАЛЬНЫЙ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

PG **CE** **STERILE EO**

CH/FR:

LOT

4 630012 461047


ВНИМАНИЕ:


- * Для однократного использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- * Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 118F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 333-61-23

длина 400 мм

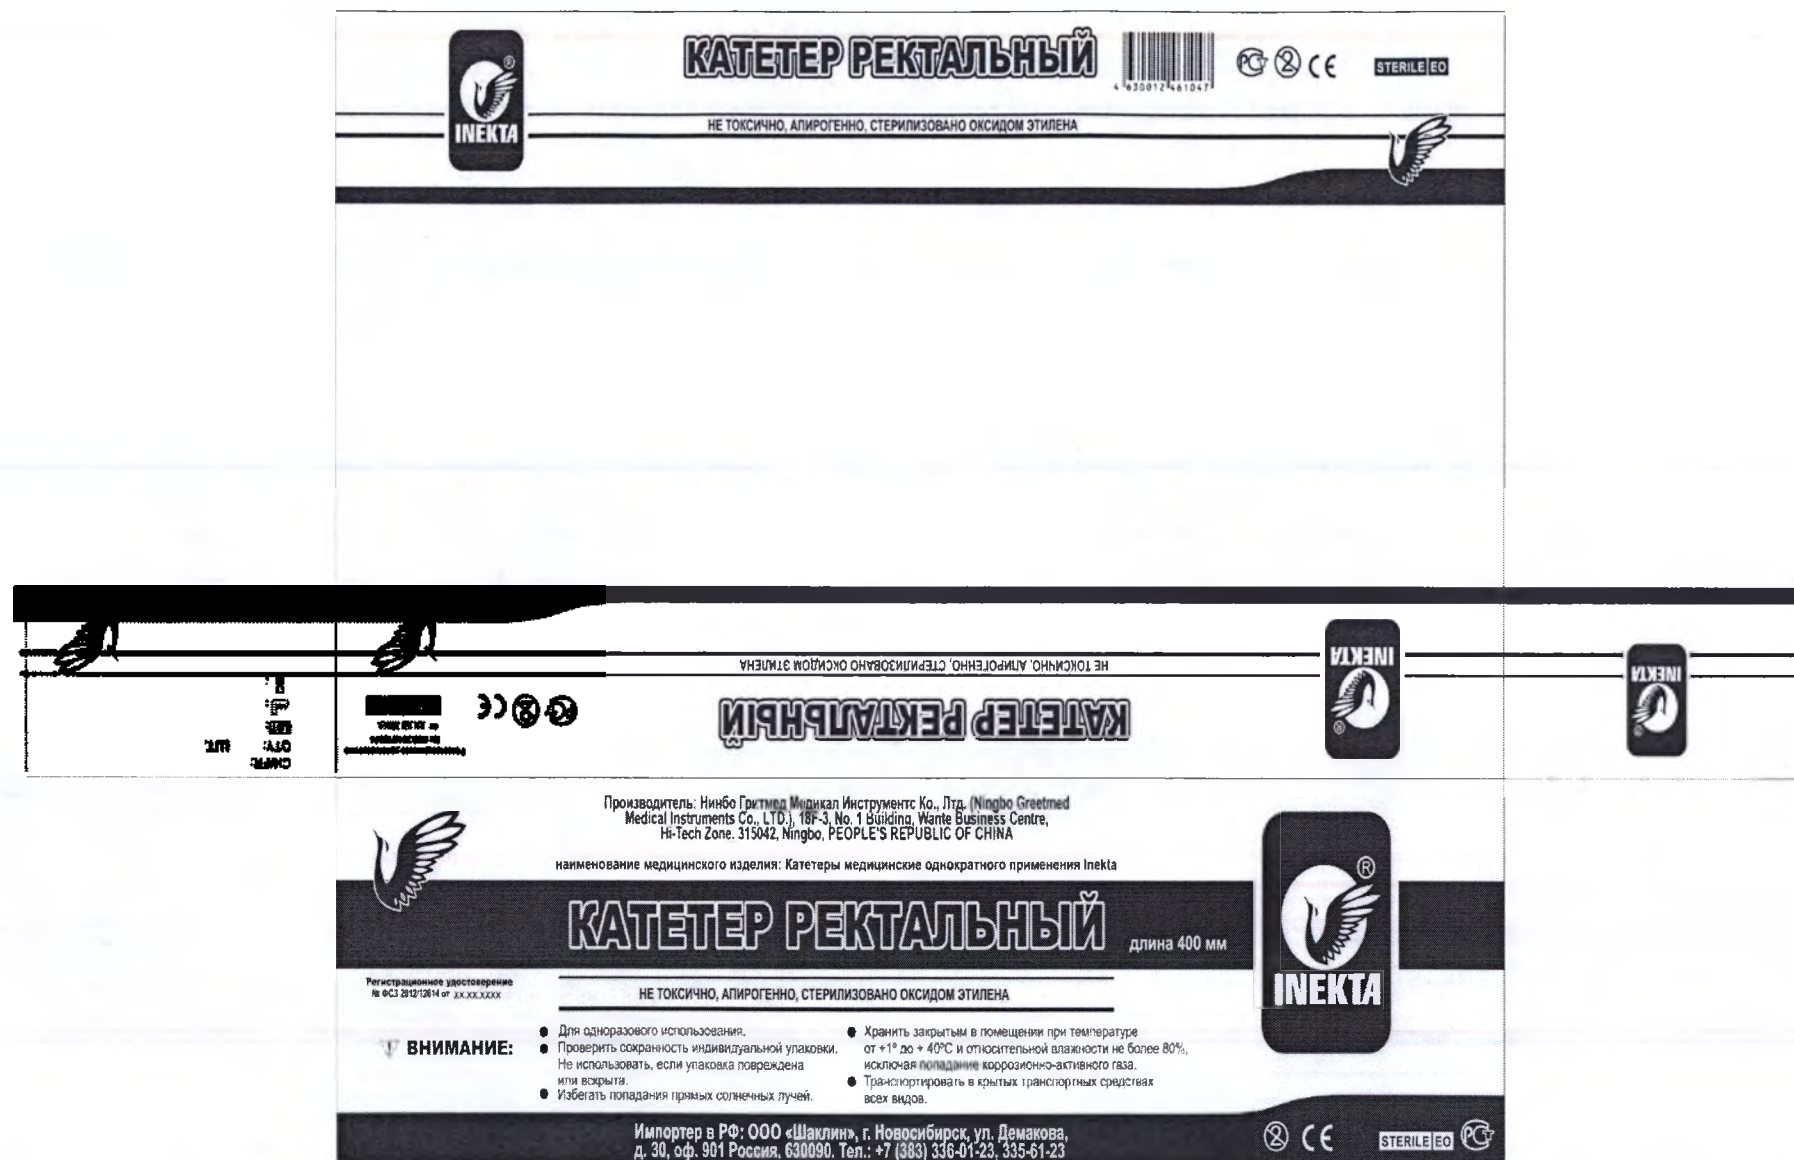

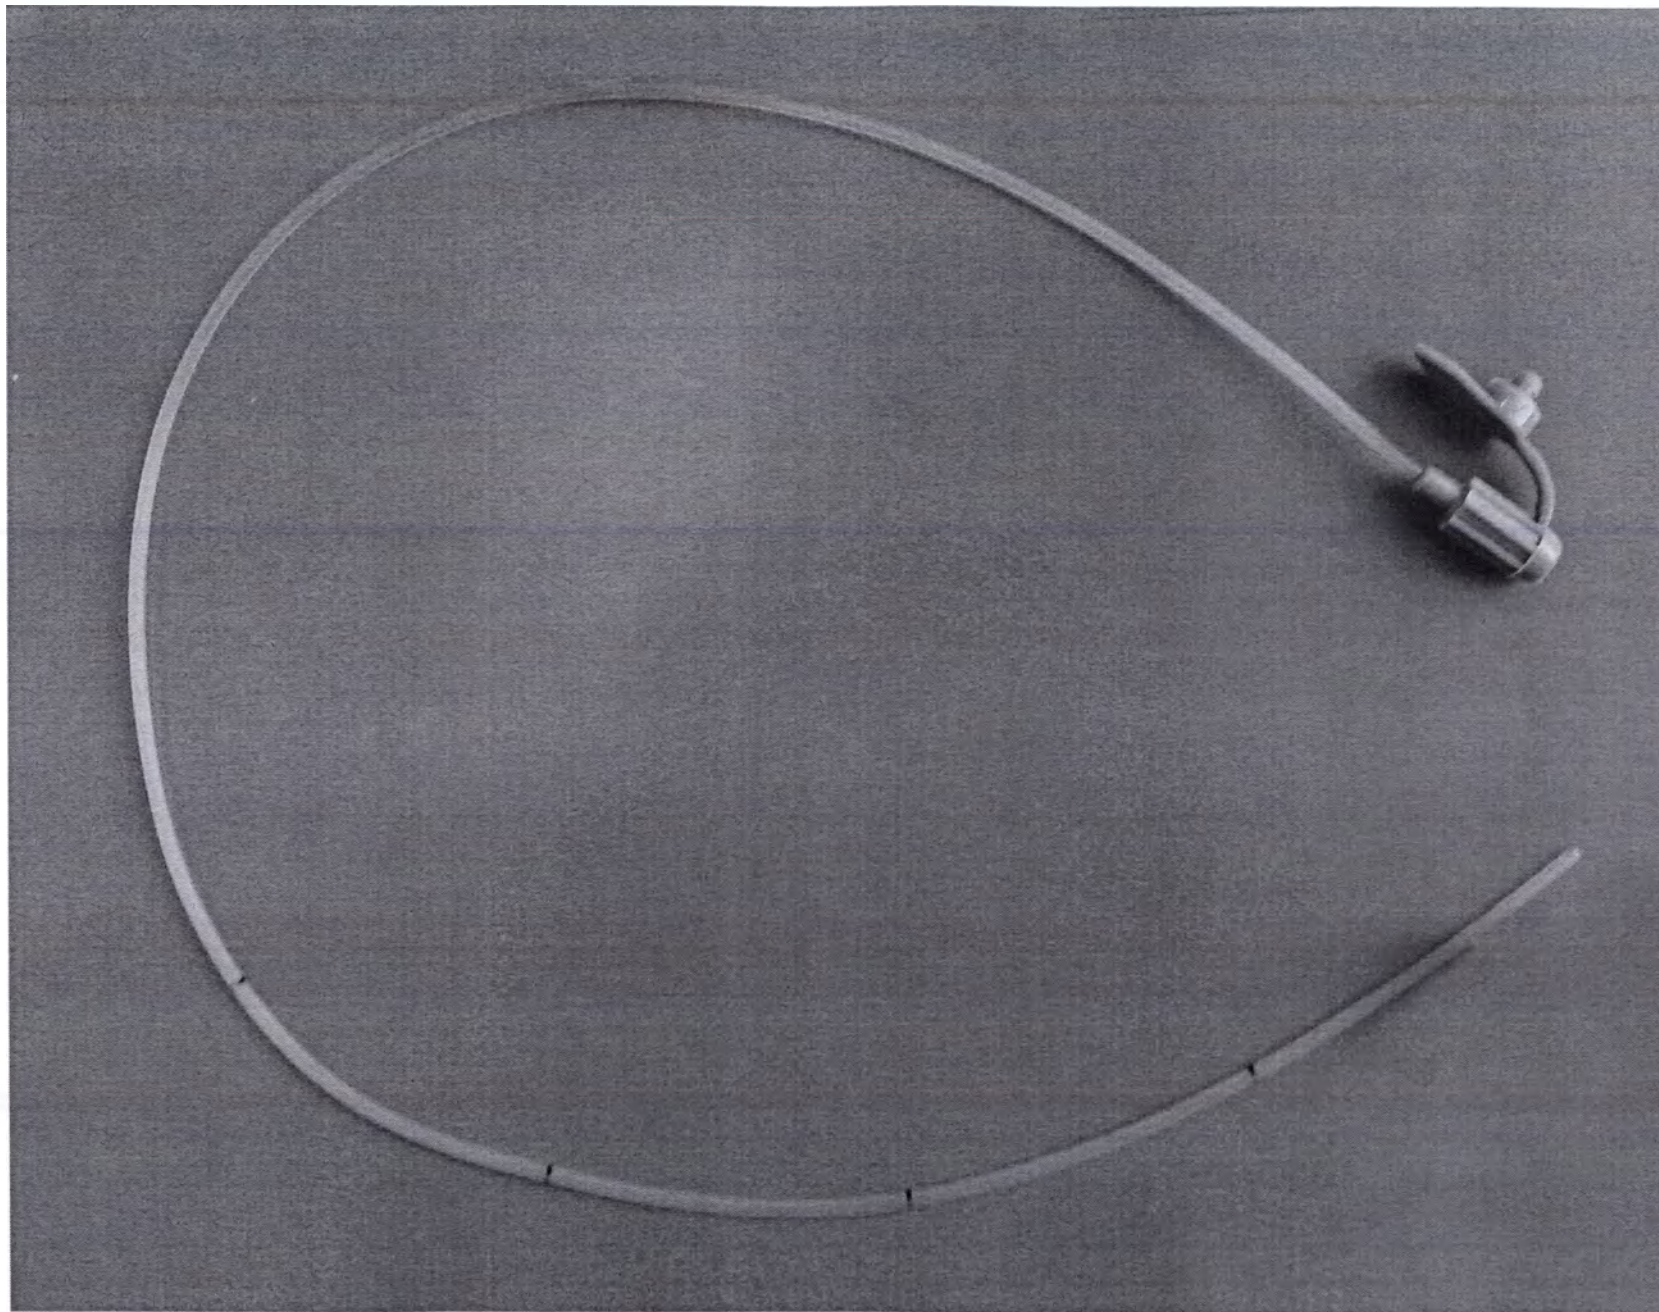

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного
применения Inekta

Катетер Пупочный

Длина 450 мм

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:
1я - 5 см 2я - 10 см 3я - 15 см 4я - 20 см

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814
от XX.XX.XXX г.

ВНИМАНИЕ:
* Для одноразового использования.
* Проверить на сохранность индивидуальной упаковки.
Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
* Транспортировать и хранить закрытым в помещении при
температуре от +1° до +40°С и относительной влажности
не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа
и прямых солнечных лучей.
* Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С
и относительной влажности не более 80%

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901
630090, Россия. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23

CH/FR: _____

Lot: _____

: _____

: _____

НЕ ТОКСИЧНО. АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Катетер Пупочный Длина 450 мм  	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от ХХ.ХХ.ХХХ г. ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	Катетер Пупочный Длина 450 мм  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от ХХ.ХХ.ХХХ г. ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. STERILE EO QTY.: PCS/КОРОБКА	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от ХХ.ХХ.ХХХ г. ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от ХХ.ХХ.ХХХ г. ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА
наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ВНИМАНИЕ: * Для однократного использования. * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. * Избегать попадания прямых солнечных лучей. * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА

Имеем по
44/04015000 (срок)
наименование
Имущество
ООО, Итого
на основании



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ООО «Шаклин»

ИП. А.В. Романов


«19» ноября 2018



ФОТОГРАФИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Катетеры медицинские однократного применения Inekta
производства Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.)**

Катетер аспирационный

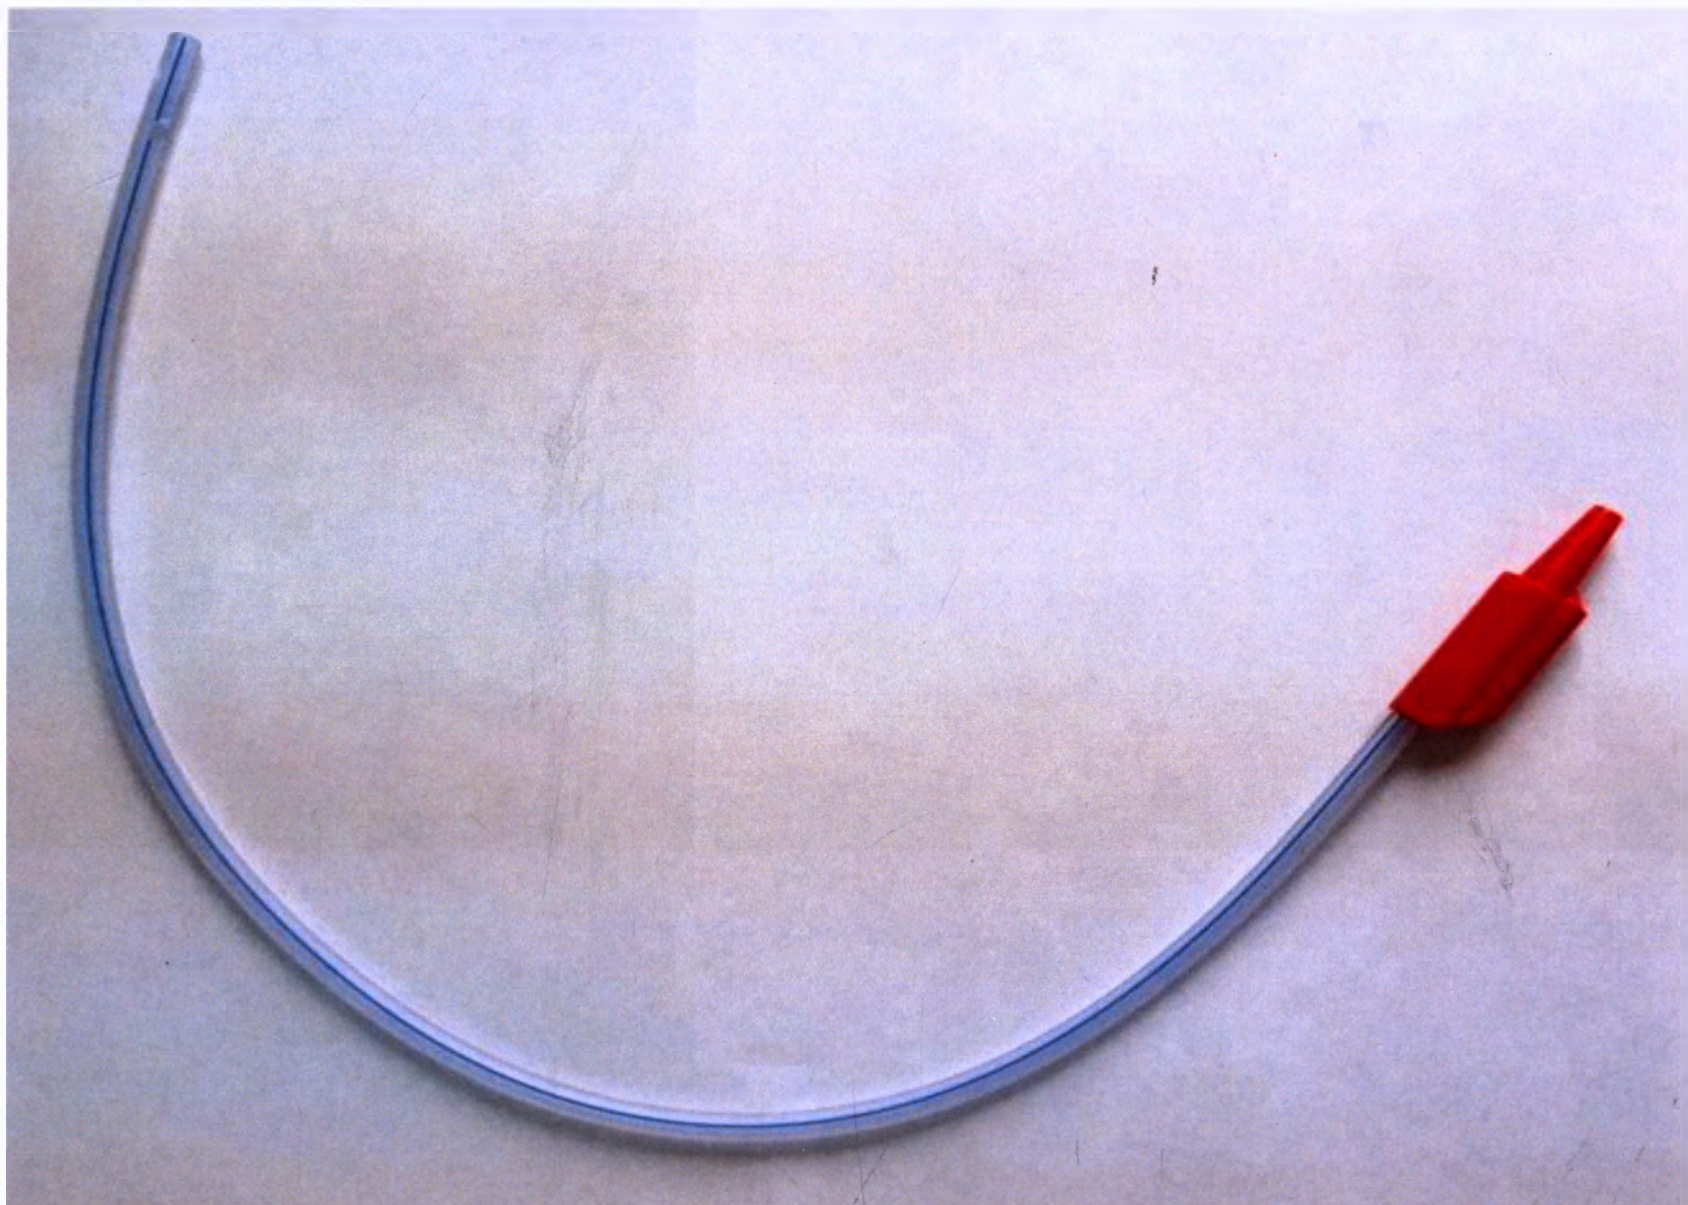


катетер аспирационный в упаковке




атетер аспирационный. Макет маркировки индивидуальной упаковки




Катетер аспирационный. Макет маркировки групповой упаковки

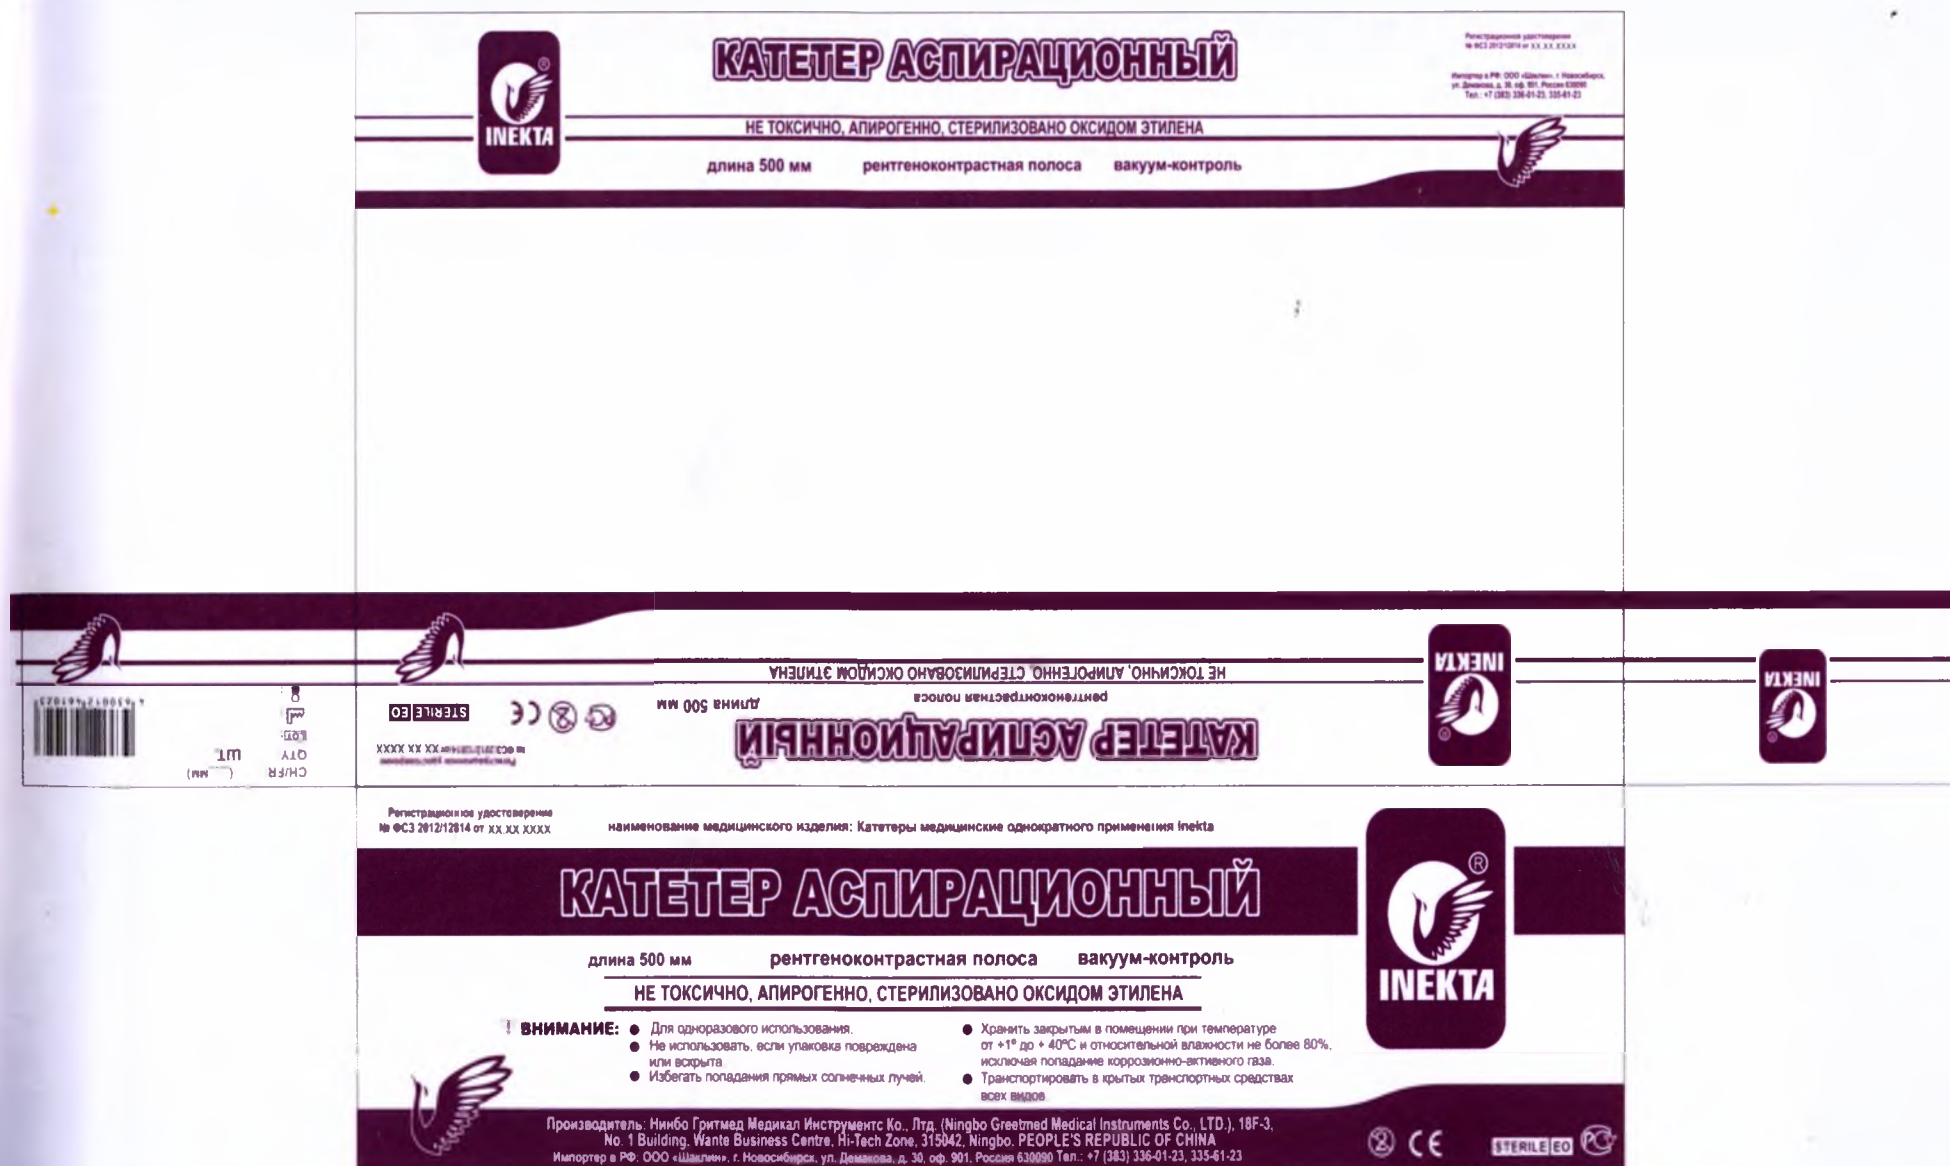

атетер питающий

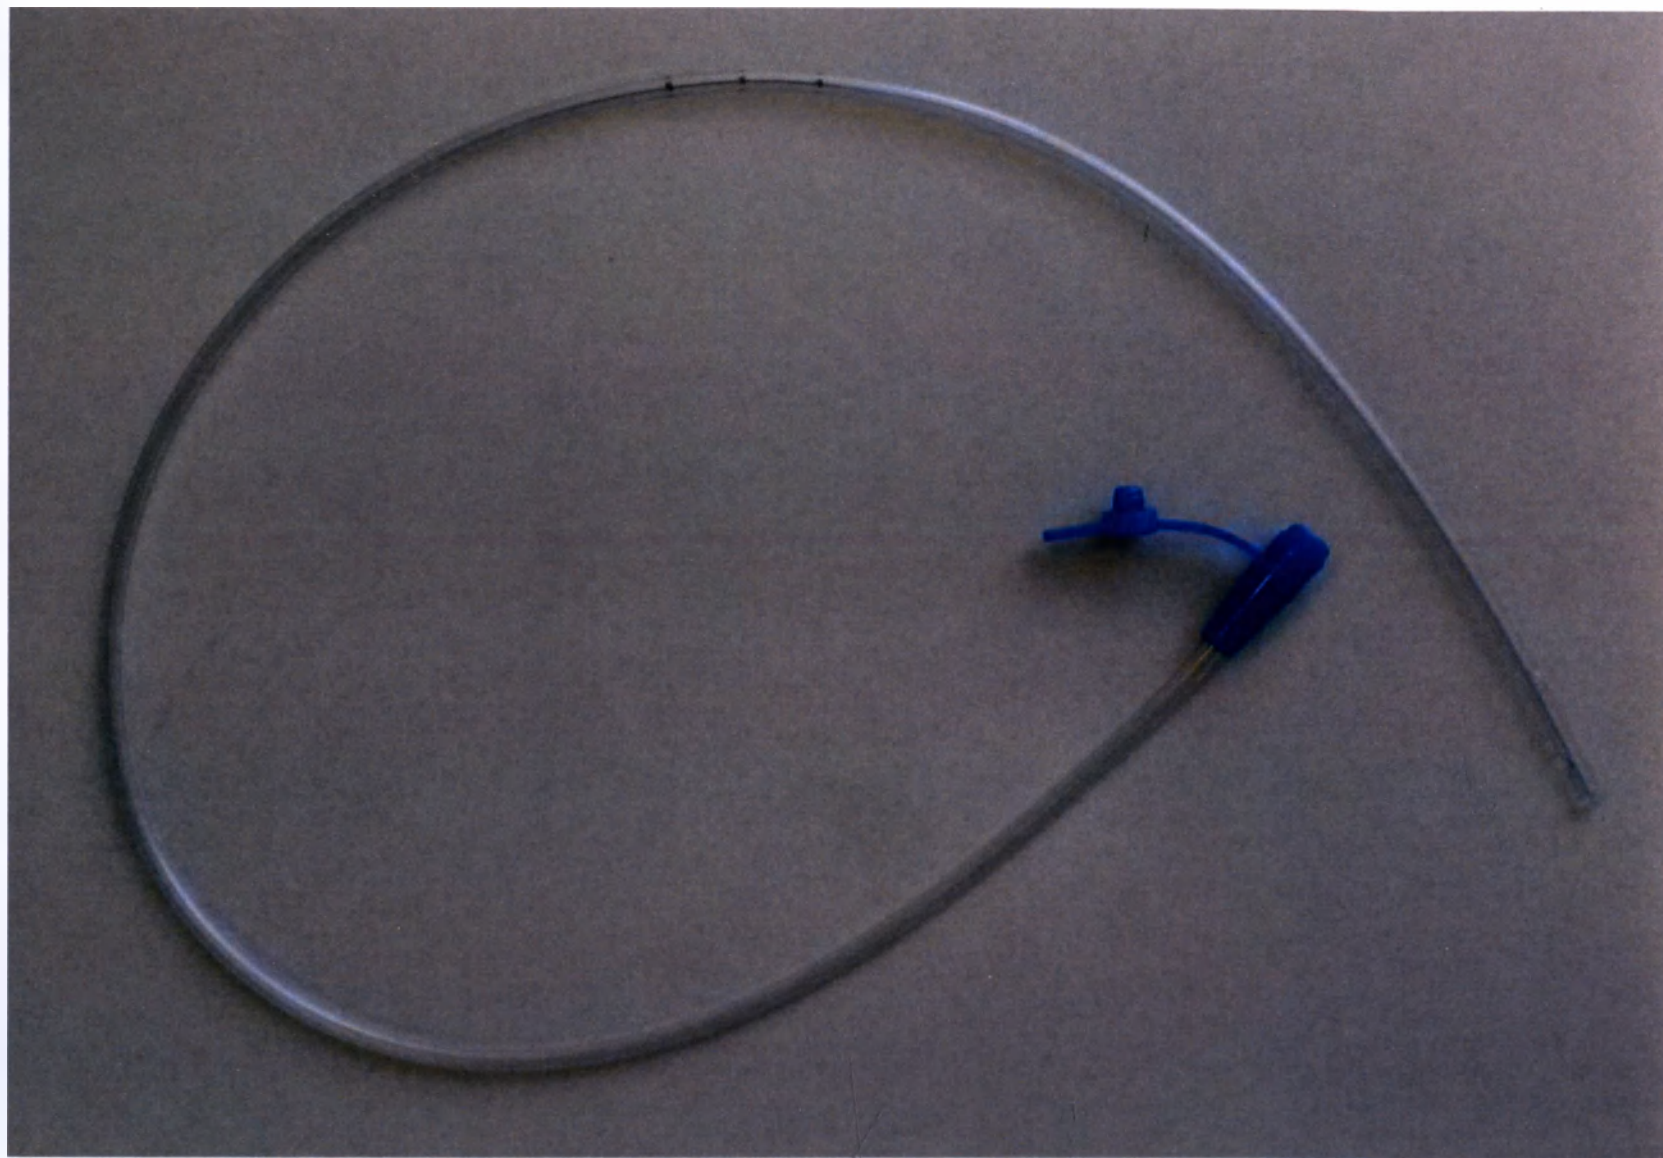

катетер питающий в упаковке

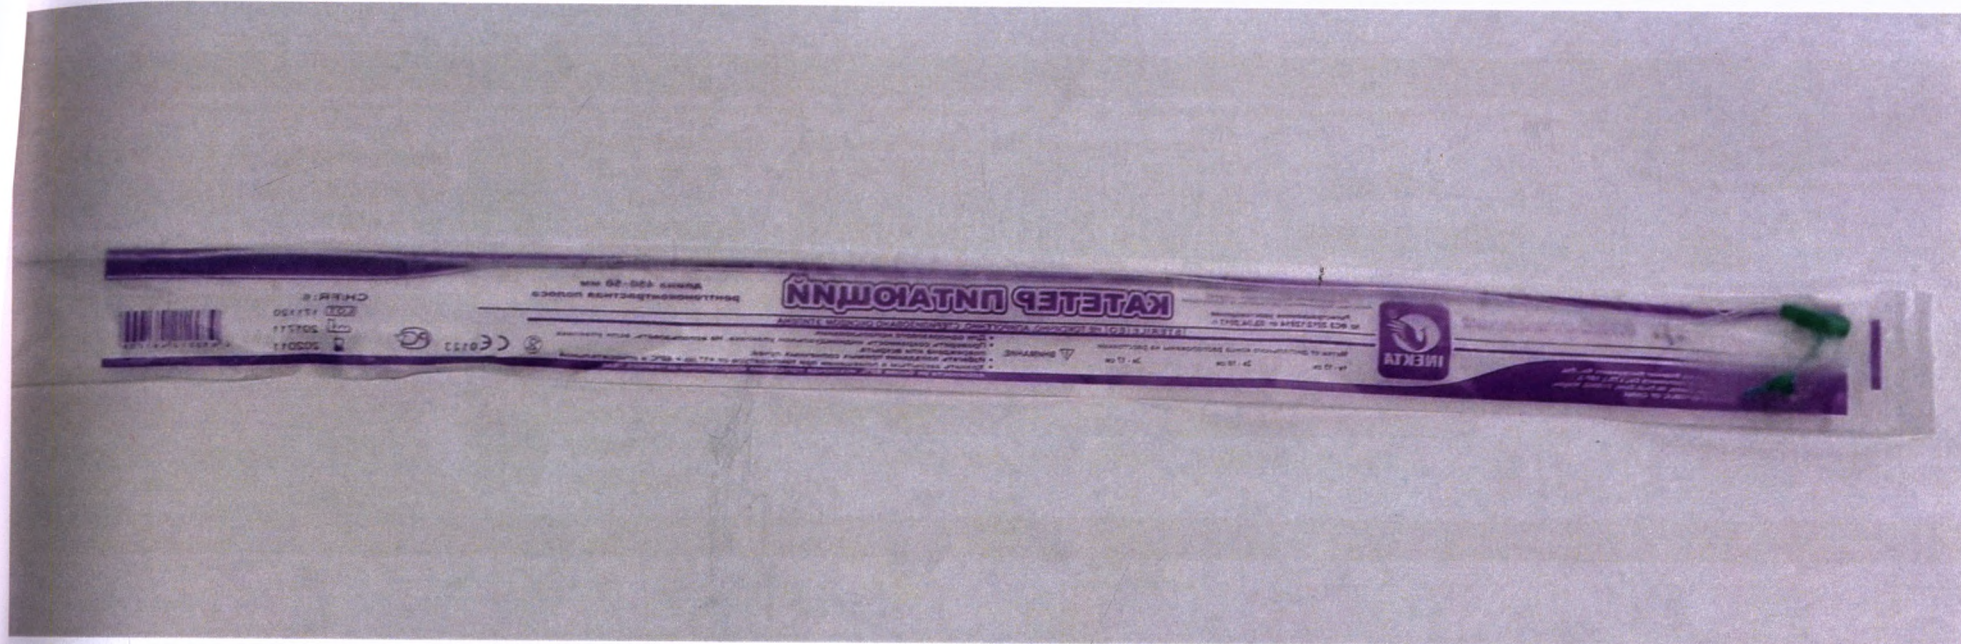

Катетер питающий. Макет маркировки индивидуальной упаковки

открывать
здесь

Импортер в РФ: ООО «Шалтин», г. Новосибирск,
ул. Демикова, д. 30, оф. 901, Россия 630090.
Тел. +7 (383) 336-01-23, 335-61-23



наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного
применения Ineka

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

длина 400 мм
рентгеноконтрастная полоса

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1а - 15 см 2а - 15 см 3а - 17 см

STERILE | EO | НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

CH/FR:

LOT:



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.
Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3,
No. 1 Building, Wente Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


- Для однократного использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки.
- Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.

- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Катетер питающий. Макет маркировки групповой упаковки.

 КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ длина 400 мм рентгеноконтрастная полоса	 Метки от дистального конца расположены на расстоянии: 1я - 15 см 2я - 16 см 3я - 17 см длина 400 мм рентгеноконтрастная полоса НЕ ТОКСИЧНО, АЛЕРГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА STERILE EO CE PC	CH/R: QTY: LOT: PLS/WT  ВНИМАНИЕ: В РФ ООО «Шален» г. Новосибирск, ул. Давыдова, д. 30, оф. 901. Россия 630090. Тел. +7 (383) 336-01-23, 335-01-23
ВНИМАНИЕ: ● Для однократного использования. ● Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. ● Избегать попадания прямых солнечных лучей. ● Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. ● Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов. Сертификатное удостоверение № ФСЗ 2012/3814 от XX.XX.XXXX КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ длина 400 мм рентгеноконтрастная полоса НЕ ТОКСИЧНО, АЛЕРГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Ningbo Gritimed Medical Instruments Co., Ltd. (Ningbo Gritimed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No. 1 Building, Hualie Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) Импортер в РФ: ООО «Шален», г. Новосибирск, ул. Давыдова, д. 30, оф. 901, Россия 630090. Тел. +7 (383) 336-01-23, 335-01-23		

Катетер желудочный

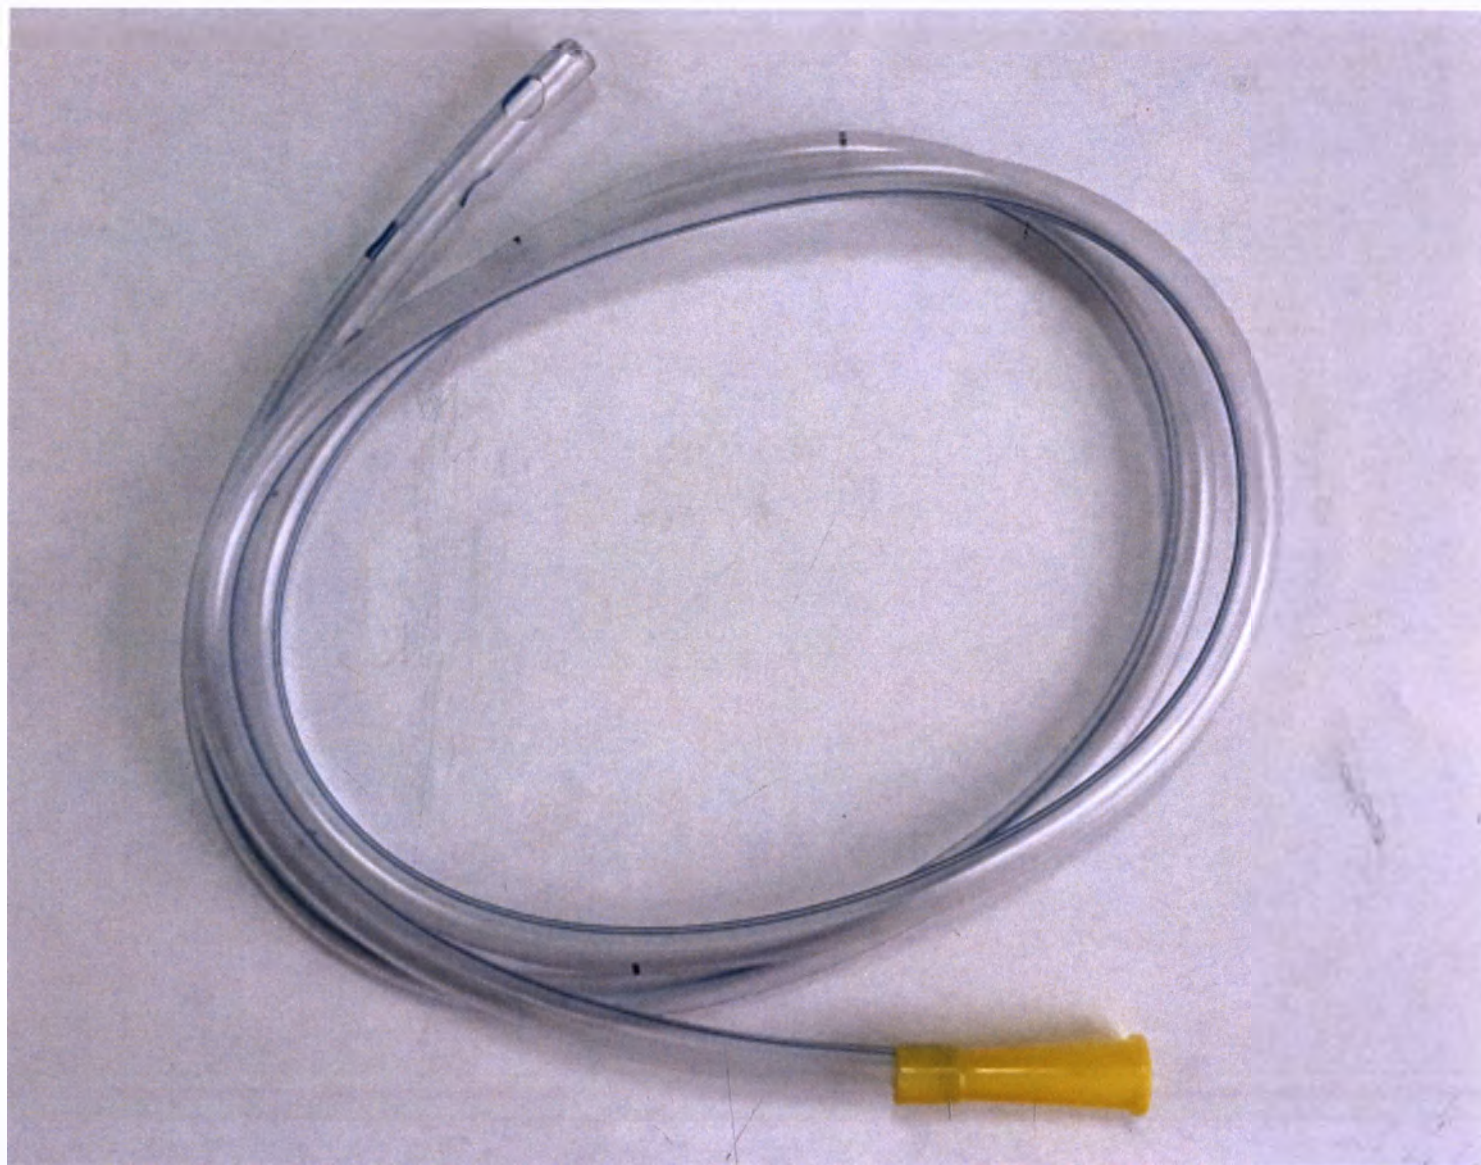

Катетер желудочный в упаковке



Катетер желудочный. Макет маркировки индивидуальной упаковки.

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX

▼ **ВНИМАНИЕ:**

- Для однократного использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°C и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°C и относительной влажности не более 80%.

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск,
ул. Демакова, д. 30, оф. 901, Россия 630090.
Тел. +7 (383) 336-01-23, 335-61-23

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:
1я - 40 см, 2я - 45 см, 3я - 50 см, 4я - 55 см, 5я - 60 см.

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного применения Inekta

КАТЕТЕР
ЖЕЛУДОЧНЫЙ

длина 110 см
рентгеноконтрастная полоса

CH/FR:

LOT:




STERILE EO




открывать здесь


Катетер желудочный. Макет маркировки групповой упаковки.

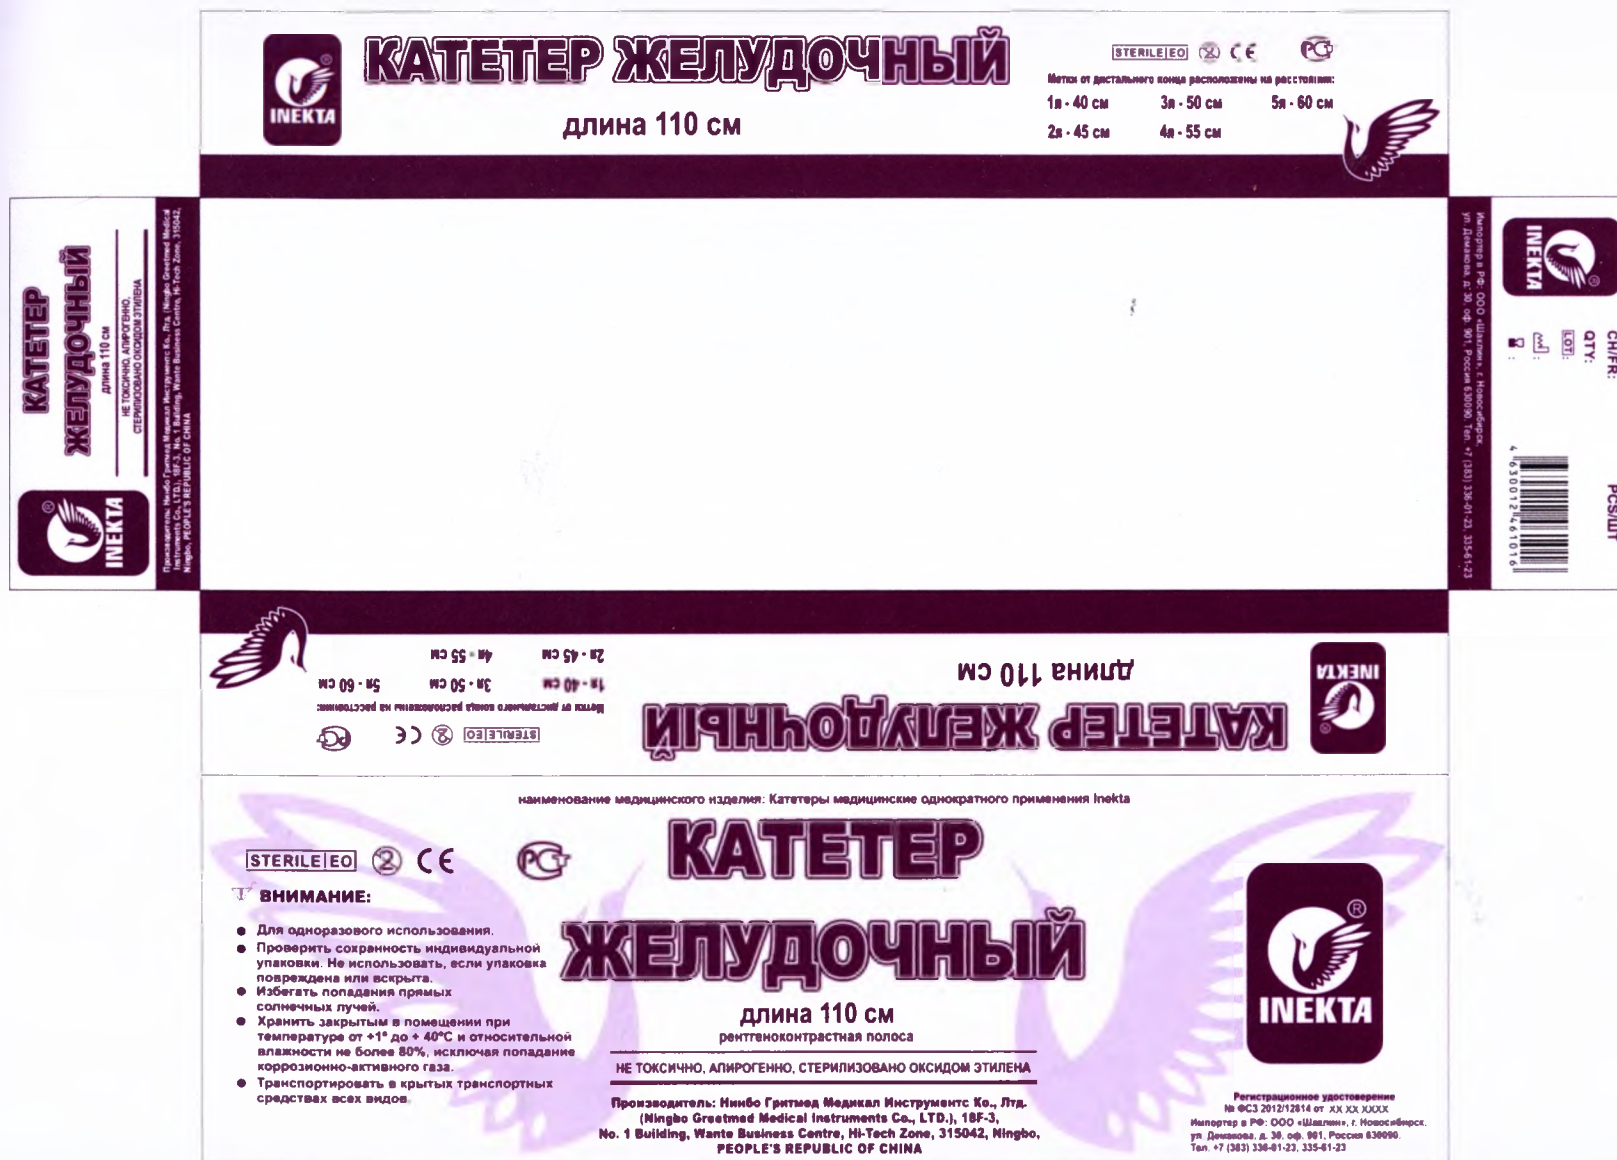

Катетер Нелатона

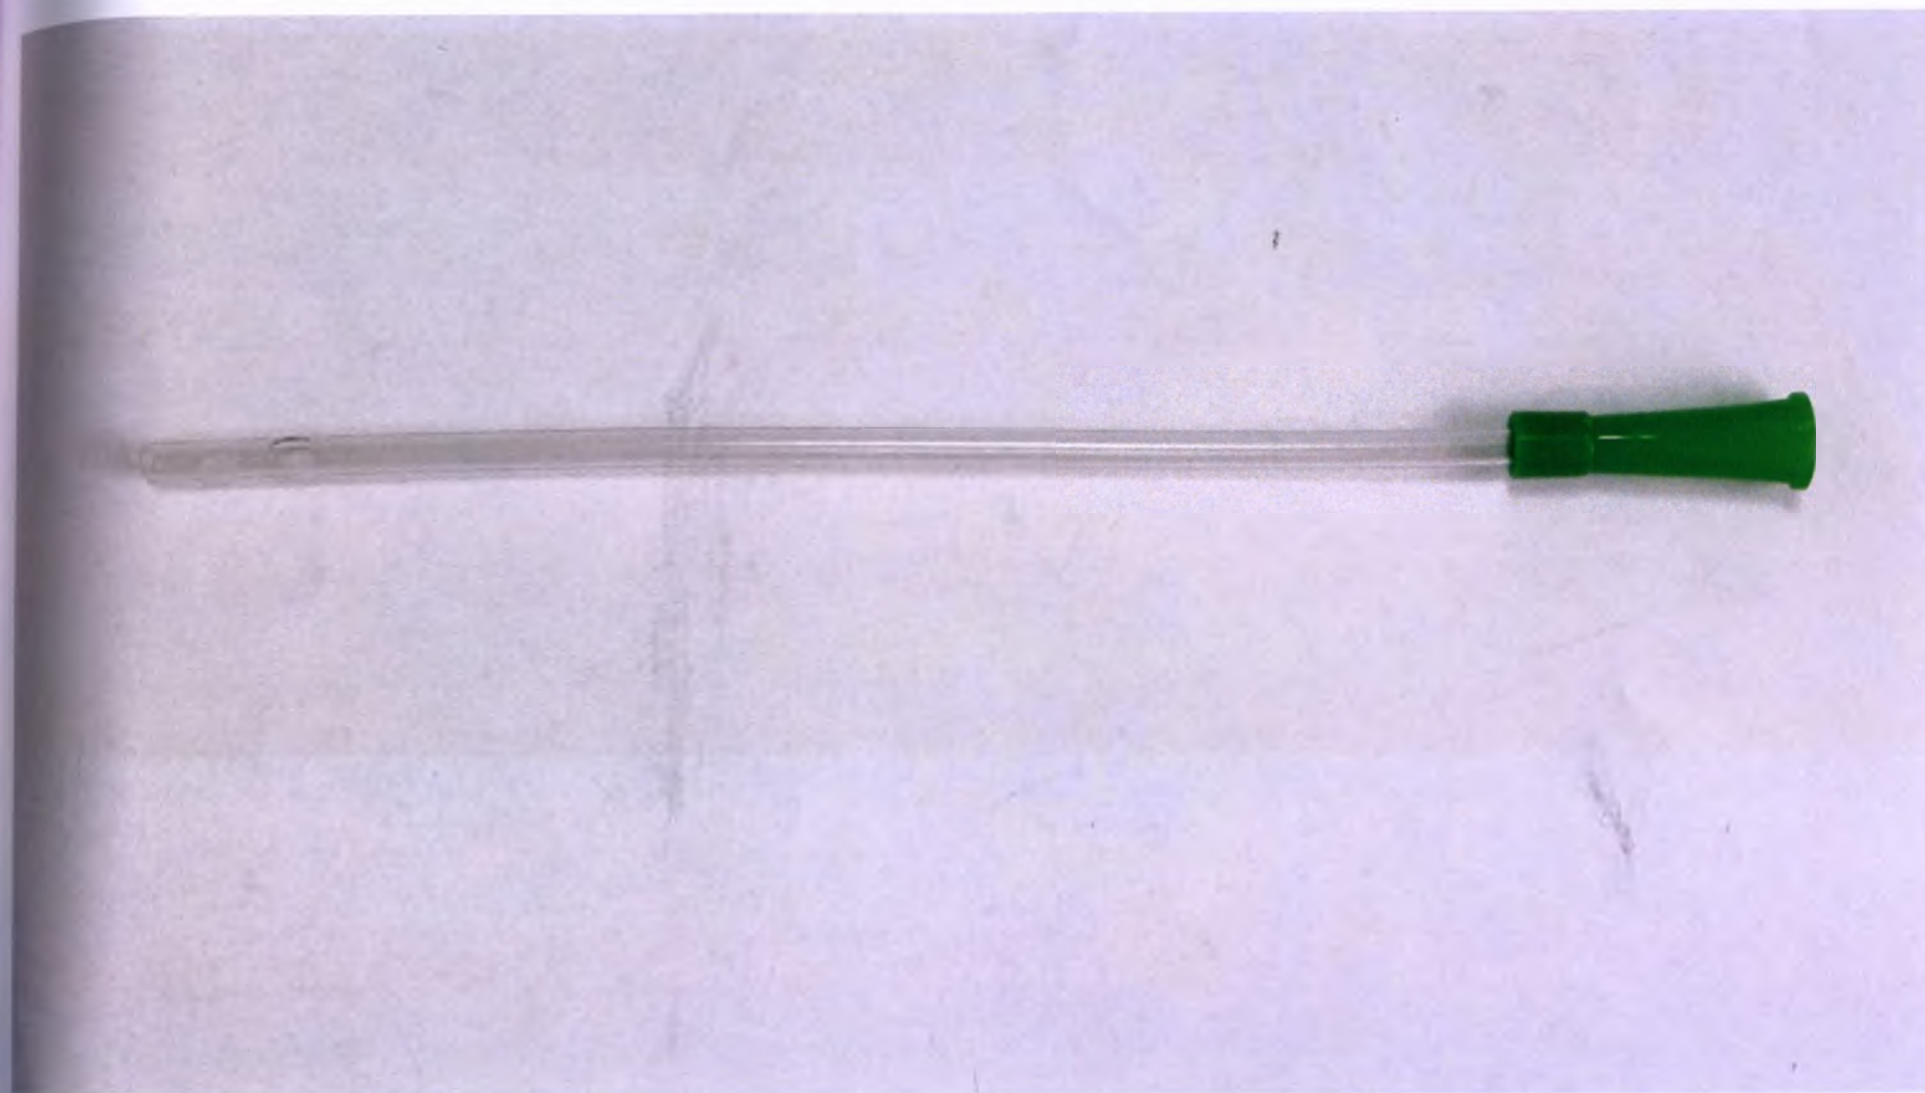

Катетер Нелатона в упаковке

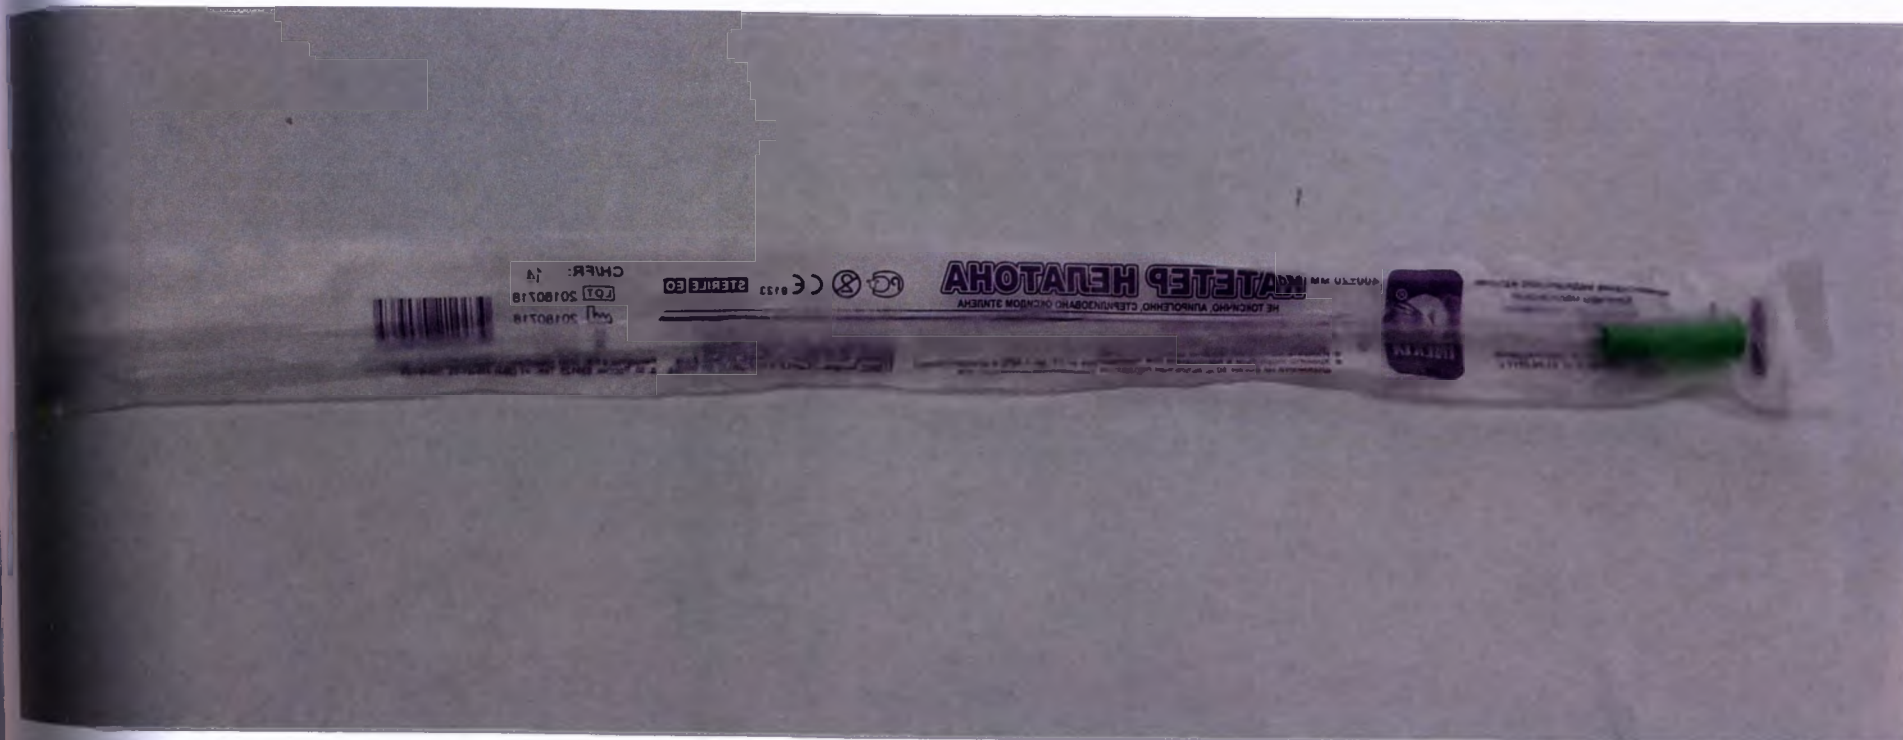

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские
однократного применения Inekta

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX



ИНЕКТА

длина
200 мм

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

- Для однократного использования.
- Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%

PGT  CE

STERILE EO

CH/FR:

LOT





Производитель: Нинбо Гритмед Медикал
Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed
Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1
Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone,
315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова,
30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23




4 630012 461972

Катетер Нелатона. Макет маркировки групповой упаковки.




Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, двухходовой)

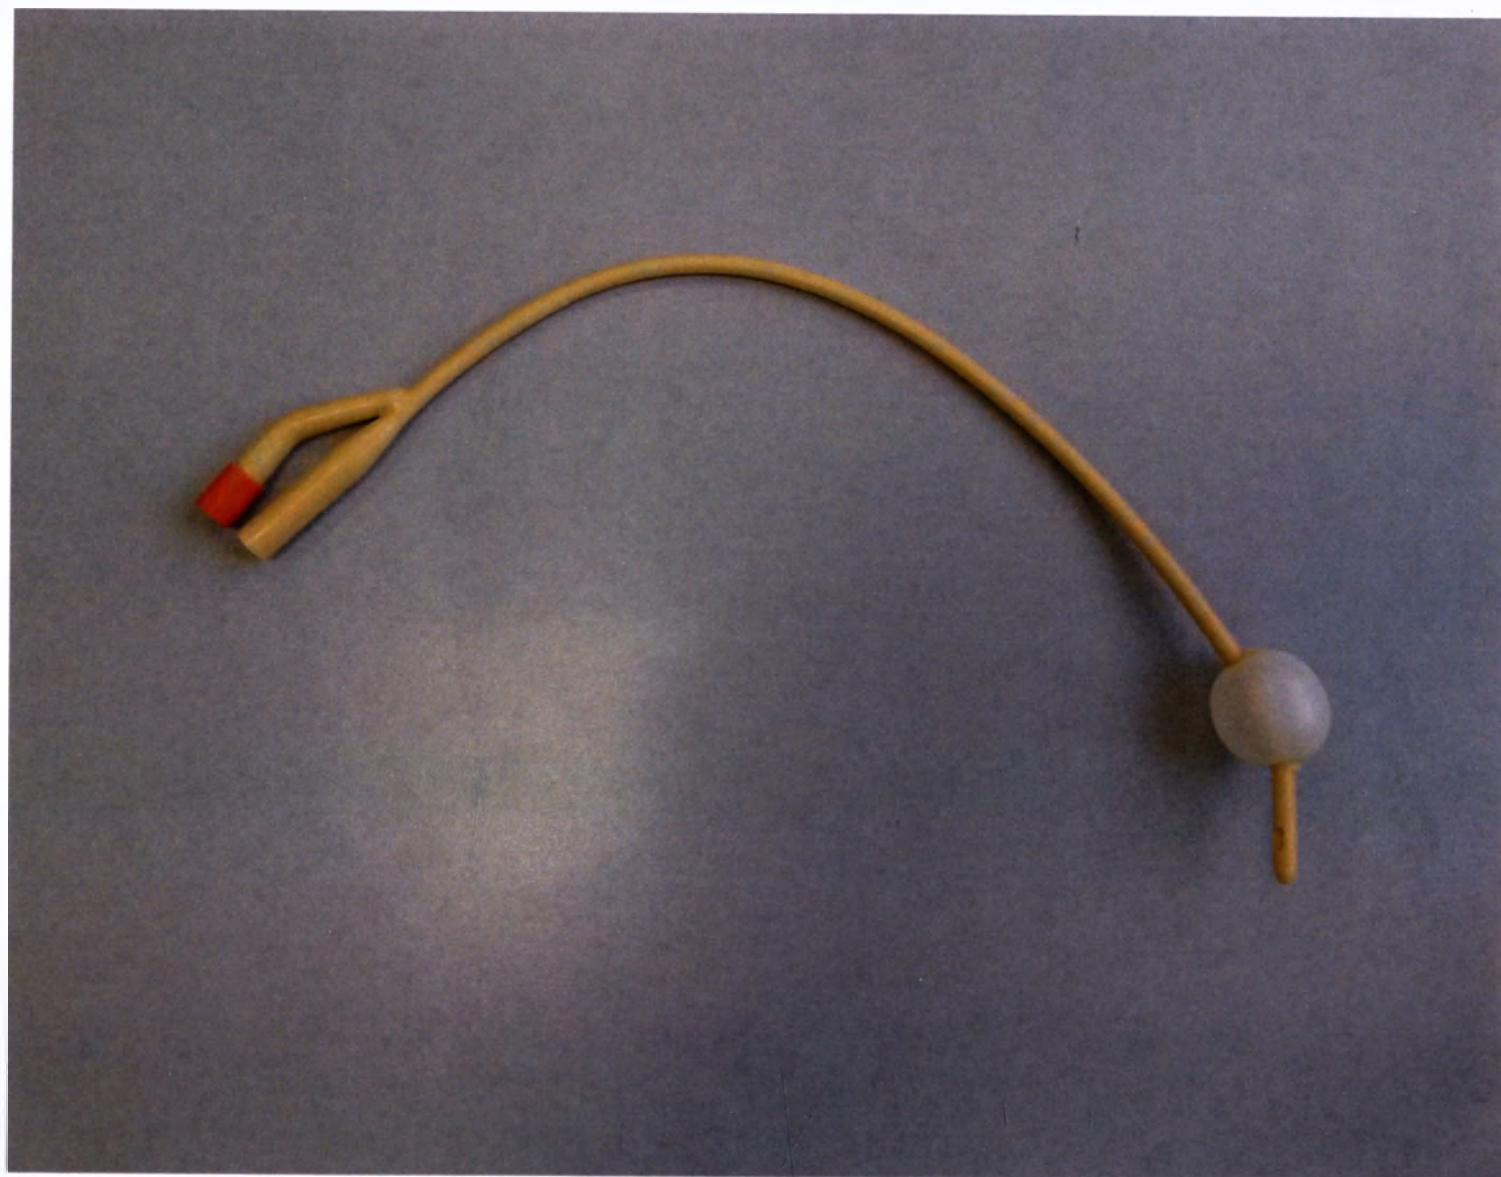

Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, двухходовой) в упаковке




Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, трехходовой)

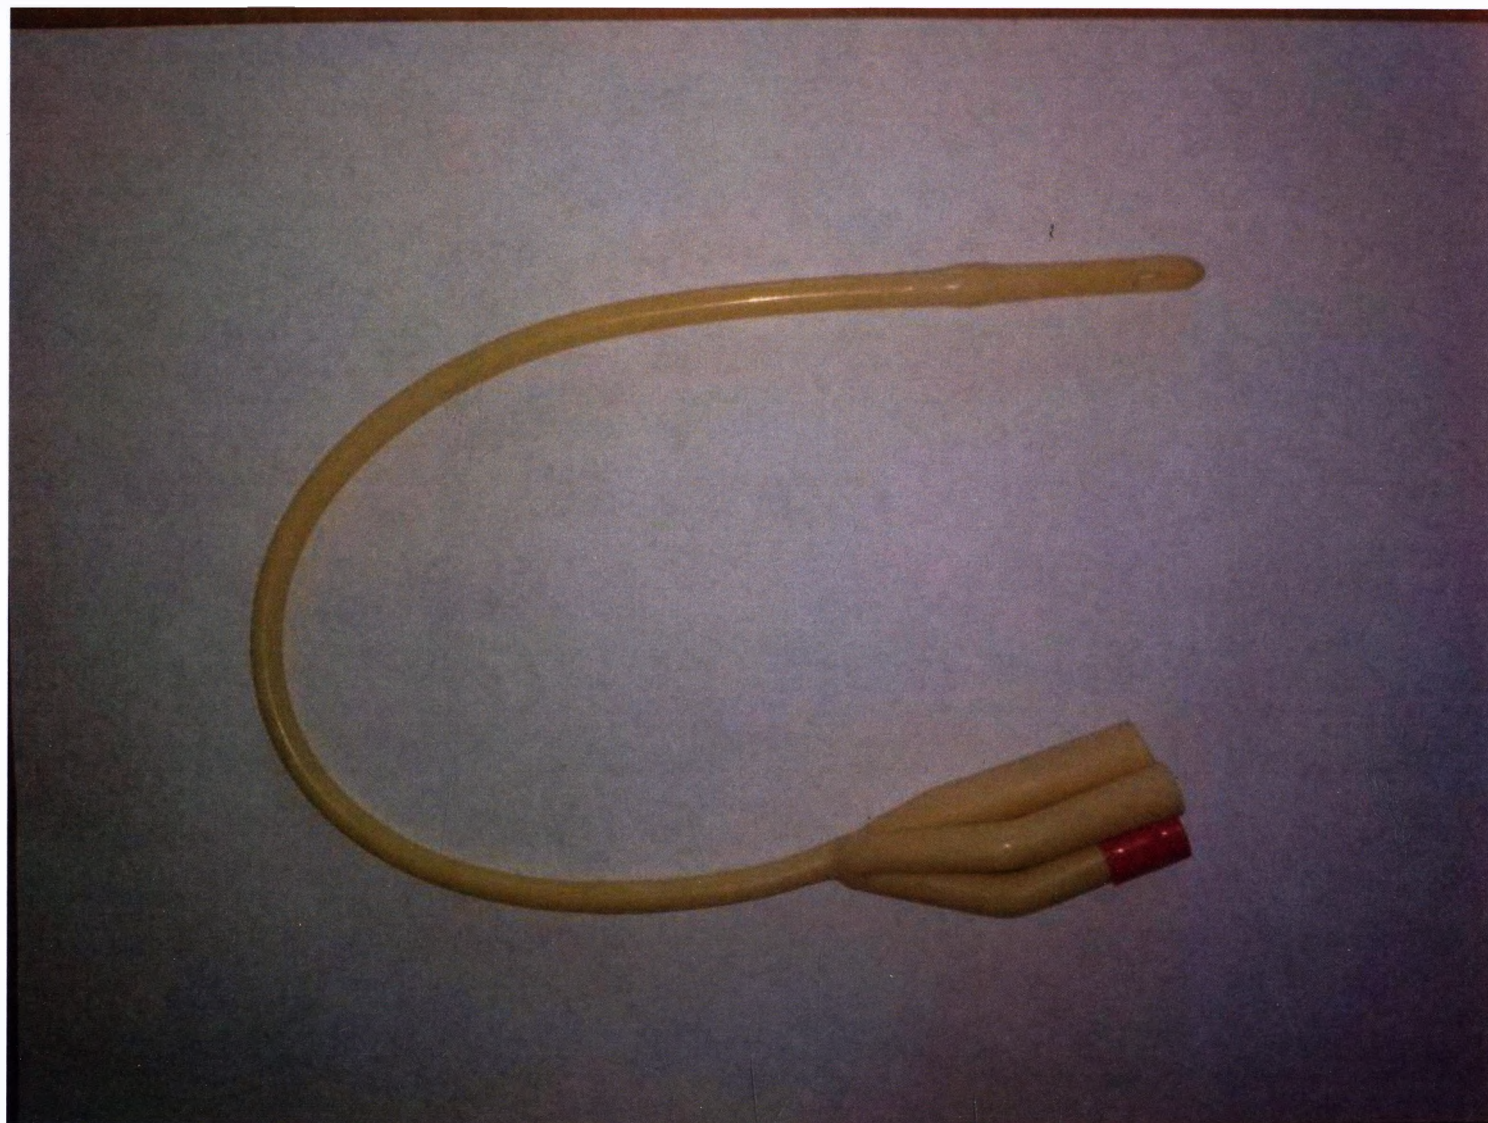


Катетер Фолея (латексный с силиконовым покрытием, трехходовой) в упаковке



Катетер Фолея (силиконовый, двухходовой)

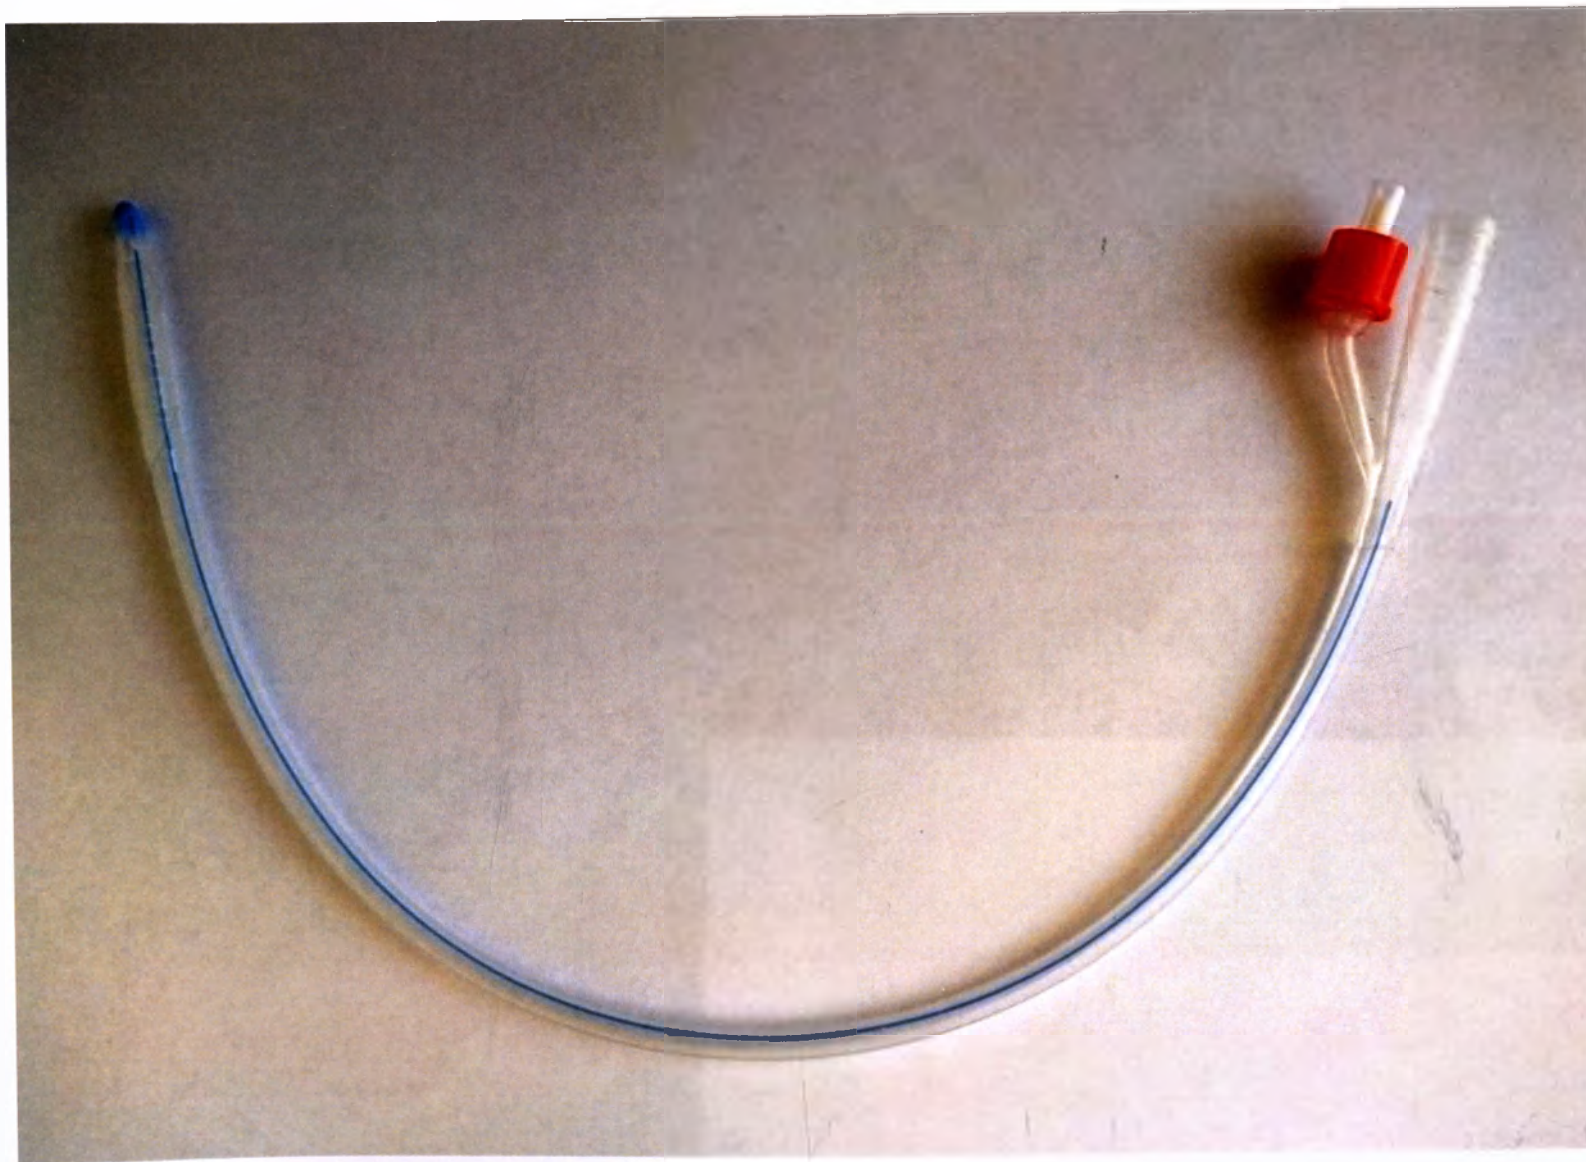

Катетер Фолея (силиконовый, двухходовой) в упаковке

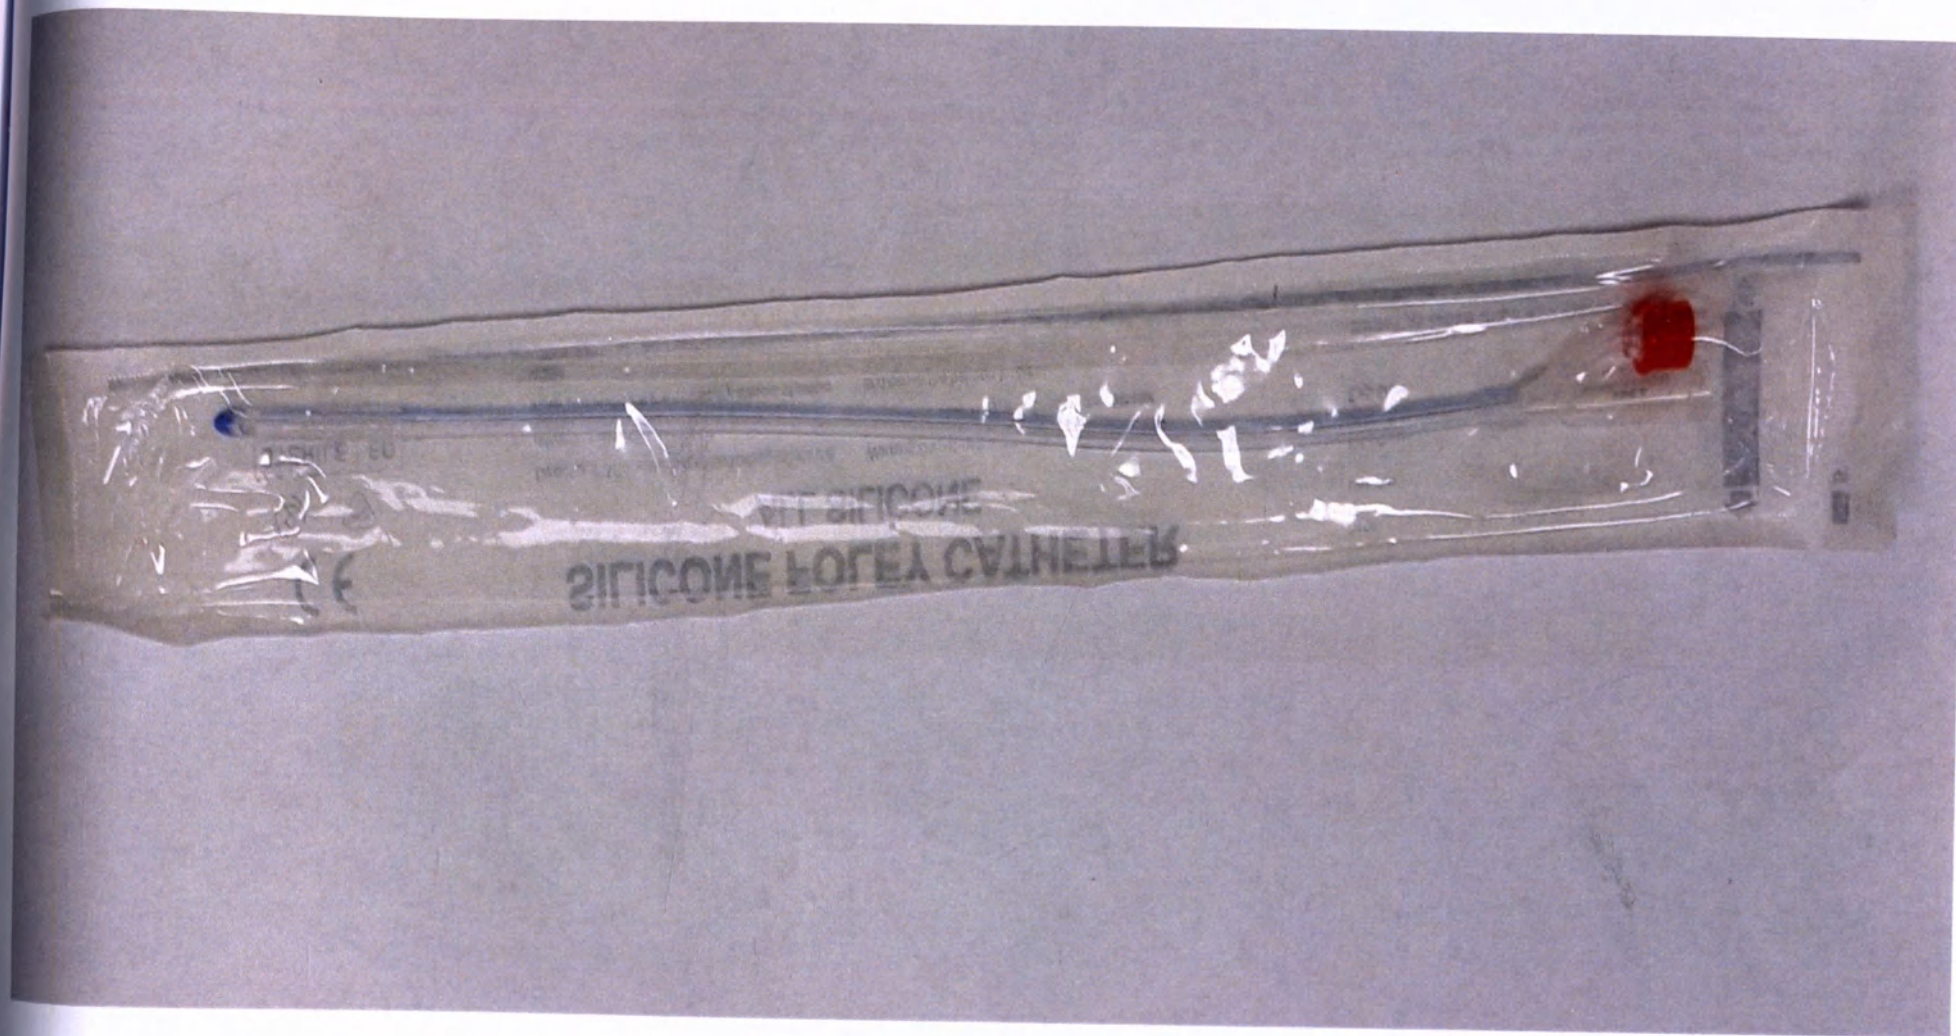

Катетер Фолея. Макет маркировки индивидуальной упаковки (пример).



ВНИМАНИЕ:

- * Для одноразового использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.

STERILE EO



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX



длина 400 мм

наименование медицинского изделия:

Катетеры медицинские одноразового применения Inekta

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ЛАТЕКСНЫЙ С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3,
No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901
Россия. 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23

3-WAY/3-ХОДОВОЙ

ML:

CH/FR:

LOT:



Катетер Фолея. Макет маркировки групповой упаковки (пример).

ML: 3-WAY/3-ХОДОВОЙ
CH/FR: 30



КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ИНЕКТА

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские
однократного применения Inekta

Количество
10 шт/упак.

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

длина 400 мм

ВНИМАНИЕ:

- * Для однократного использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°C и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- * Транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов.

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демкина, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ


НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

КАТЕТЕР ФOLEЯ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО.
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ИНЕКТА


Катетер ректальный

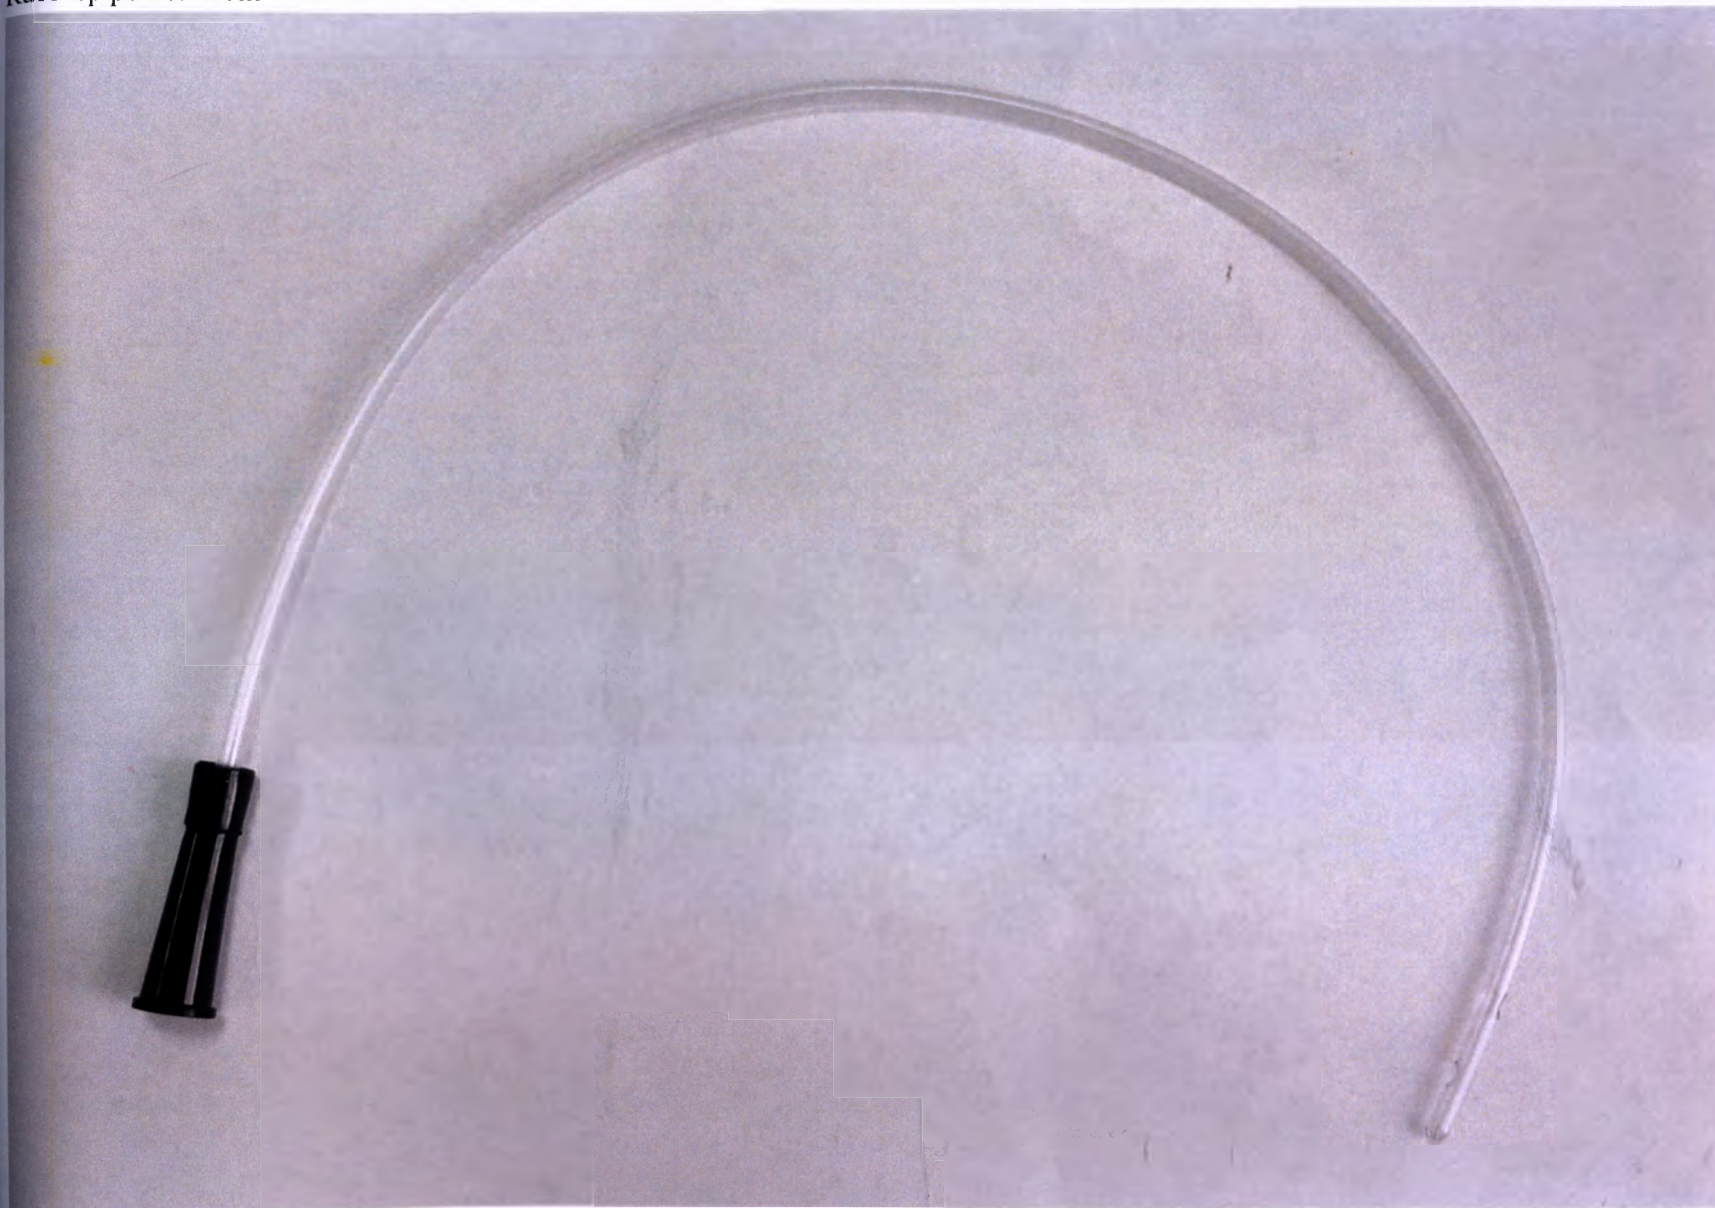



Катетер ректальный. Макет маркировки индивидуальной упаковки.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

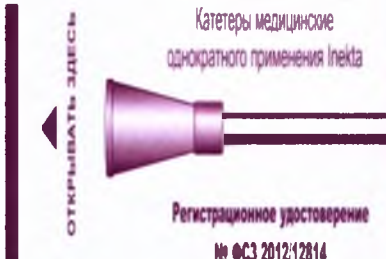

наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские
однократного применения Inekta

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814
от XX.XX.XXXX



КАТЕТЕР РЕКТАЛЬНЫЙ

НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

ВНИМАНИЕ:

- * Для однократного использования.
- * Проверить сохранность индивидуальной упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- * Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.
- * Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

CH/FR:

LOT




4 630012 461047


длина 400 мм

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Импортер в РФ: ООО «Шалтин», г. Новосибирск, ул. Демидова, д. 30, оф. 901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 335-61-23, 335-61-23

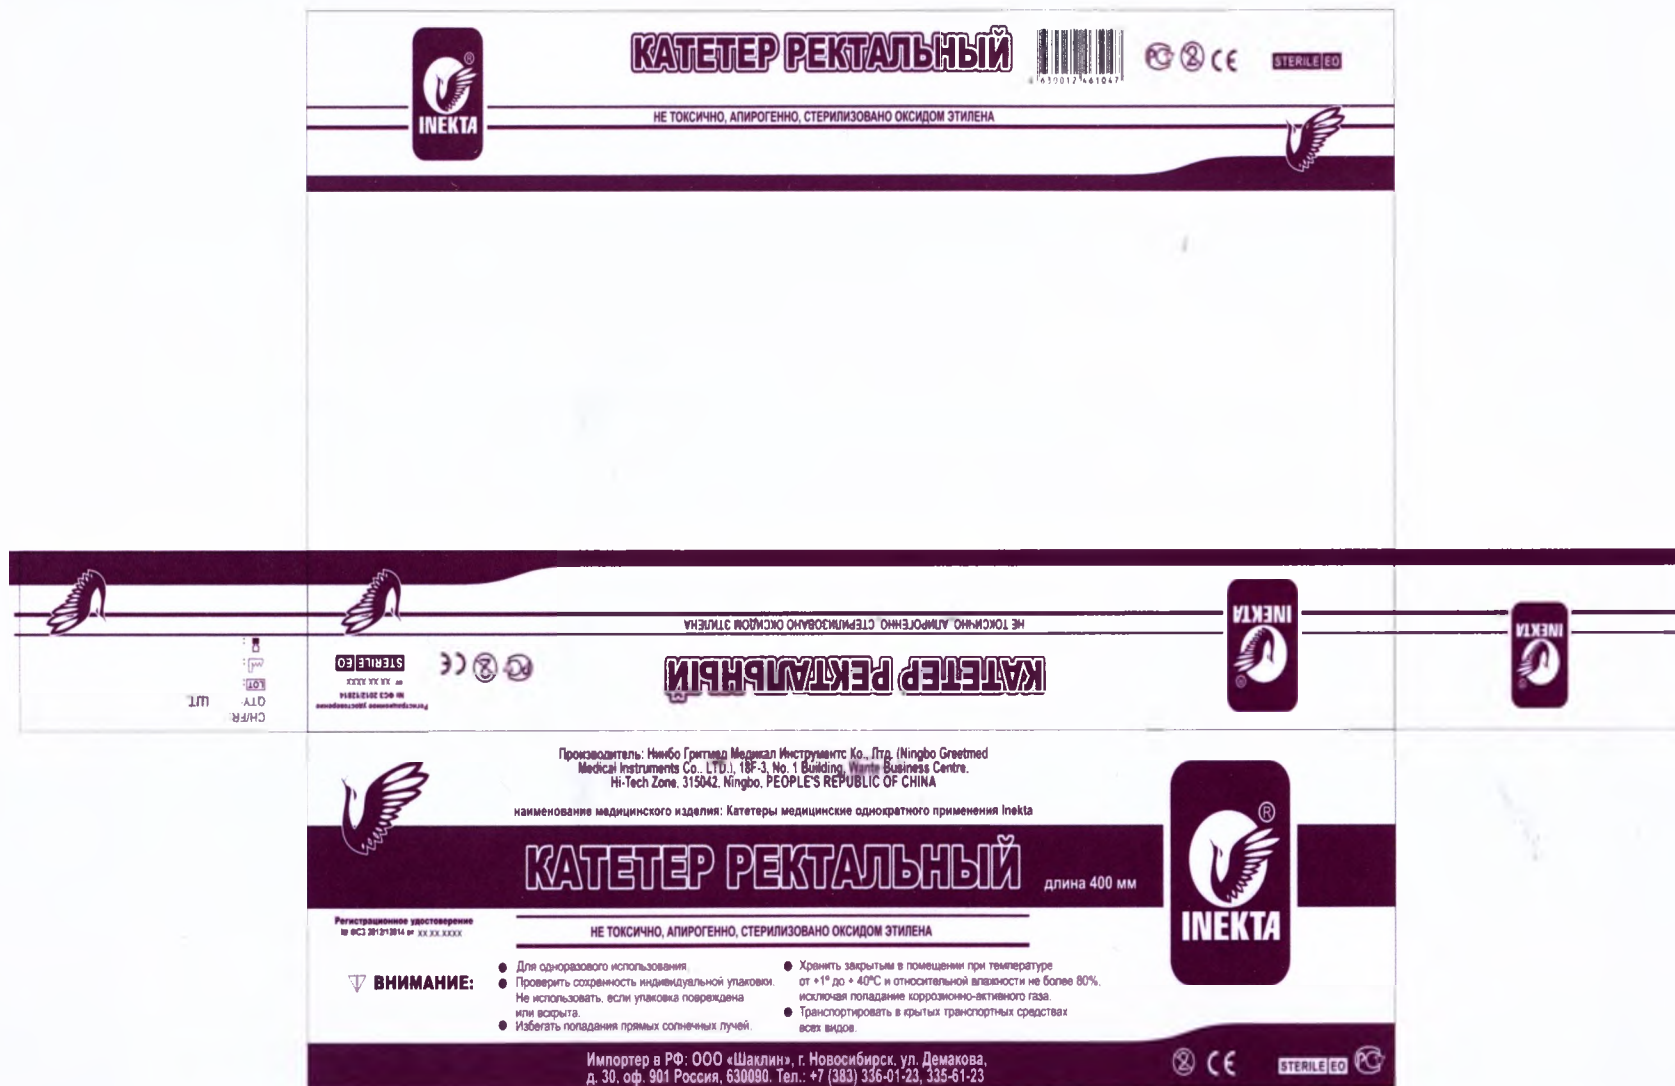

Катетер пупочный

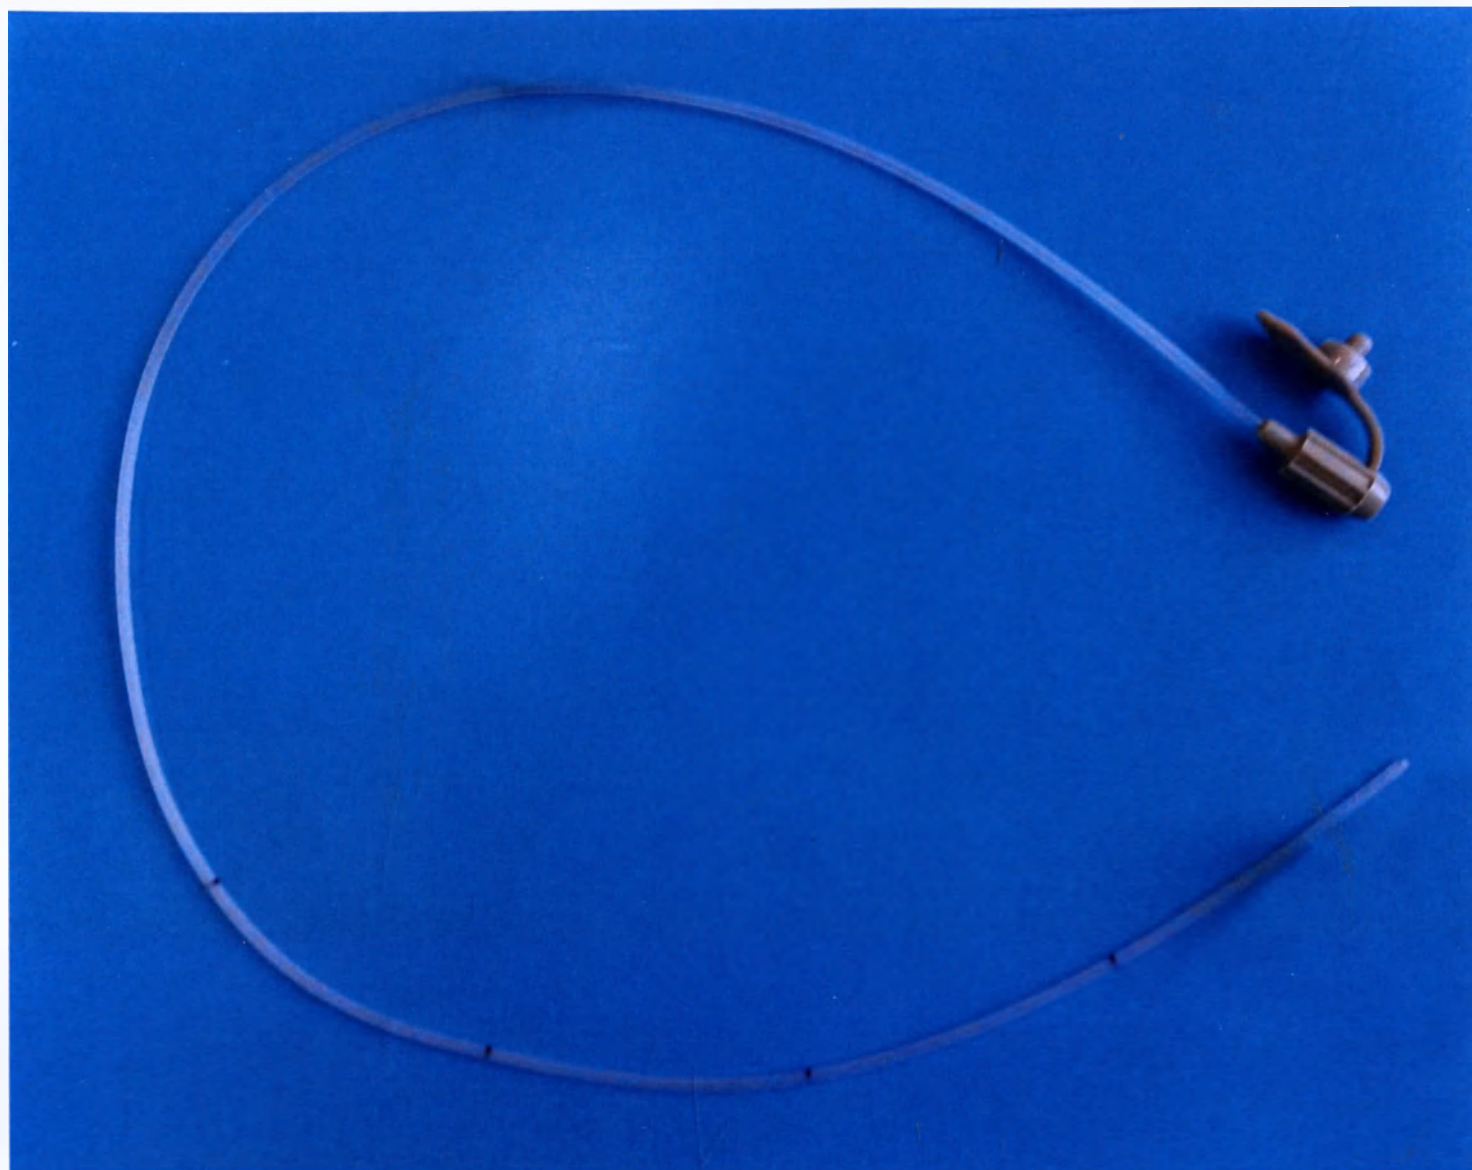

Катетер пупочный в упаковке

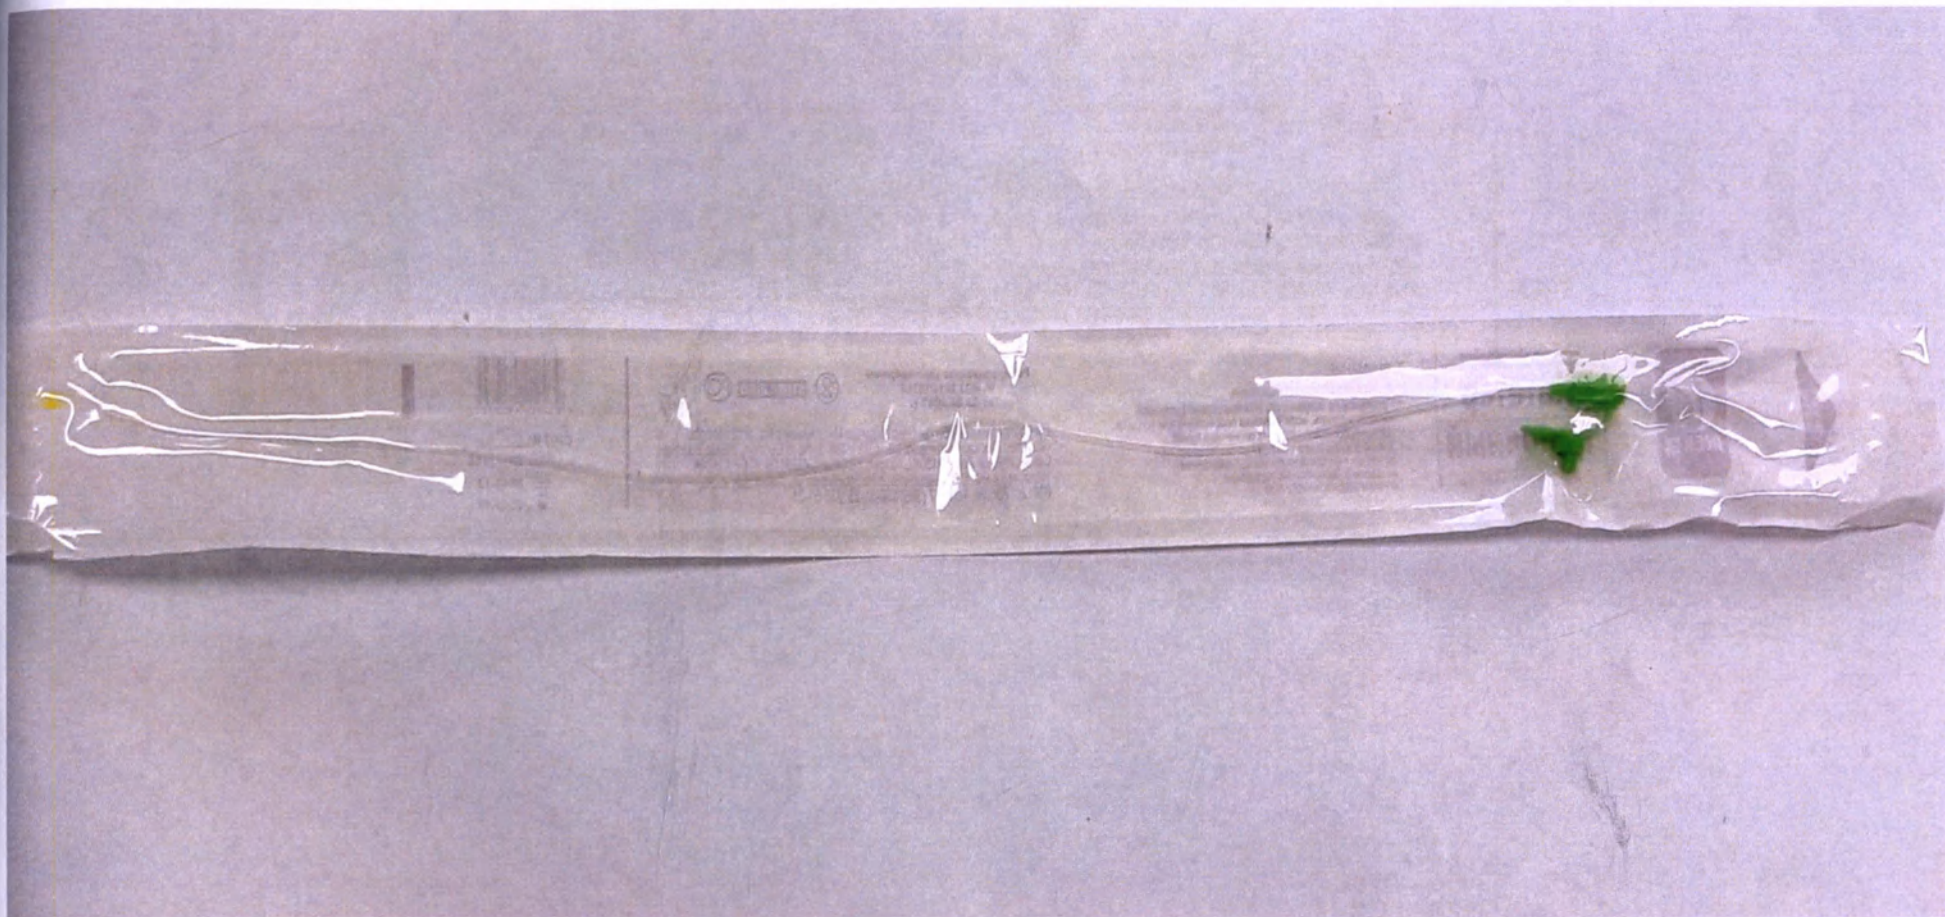

Катетер пупочный. Макет маркировки индивидуальной упаковки.



наименование медицинского изделия:
Катетеры медицинские однократного
применения Inekta

Катетер Пупочный

Длина 450 мм

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:
1я - 5 см 2я - 10 см 3я - 15 см 4я - 20 см

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12814
от XX.XX.XXXX г.



ВНИМАНИЕ:

- * Для однократного использования.
- * Проверить на сохранность индивидуальной упаковки.
Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта.
- * Транспортировать и хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа и прямых солнечных лучей.
- * Эксплуатировать при температуре от +10° до +40°С и относительной влажности не более 80%

Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Импортёр в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901 630090, Россия. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23



CH/FR: _____

LOT: _____



НЕ ТОКСИЧНО. АПИРОГЕННО
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Катетер пупочный. Макет маркировки групповой упаковки

Катетер Пупочный Длина 450 мм  	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Нинбо Гринмед Медицинские Инструменты Ко., Лтд. (Ningbo Greentmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шакли», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф.901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX г. ВНИМАНИЕ: • Для однократного использования. • Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. • Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. • Избегать попадания прямых солнечных лучей. • Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	СМР: 100 Катетер Пупочный Длина 450 мм 
Катетер Пупочный	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Производитель: Нинбо Гринмед Медицинские Инструменты Ко., Лтд. (Ningbo Greentmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шакли», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф.901 Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-01-23, 335-61-23 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX г. ВНИМАНИЕ: • Для однократного использования. • Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. • Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. • Избегать попадания прямых солнечных лучей. • Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа. QTY.: PCS/КОРОБКА	Катетер Пупочный
Катетер Пупочный	наименование медицинского изделия: Катетеры медицинские однократного применения Inekta Катетер Пупочный НЕ ТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА Длина 450 мм 4 630012 461030 STERILE ISO QTY.: PCS/КОРОБКА Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12814 от XX.XX.XXXX г. ВНИМАНИЕ: • Для однократного использования. • Проверить на сохранность индивидуальной упаковки. • Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта. • Избегать попадания прямых солнечных лучей. • Хранить закрытым в помещении при температуре от +1° до +40°С и относительной влажности не более 80%, исключая попадание коррозионно-активного газа.	Катетер Пупочный

Тугошито не
33 (тридцати трех)
местах
Управлений по Шенгену
и Россасов

