

Фотографические изображения медицинского изделия

Монитор CO2 портативный реанимационный «КапноТест» по ТУ 26.60.12-022-52777873-2018 с принадлежностями



Монитор CO2 портативный реанимационный «КапноТест», исполнение МПАГ.941433.001



Монитор CO2 портативный реанимационный «КапноТест», исполнение МПАГ.941433.001-01





МЕДПЛАНТ

производительное предприятие

Монитор CO₂ портативный
реанимационный «КапноТест»

ТУ 26.60.12-022-52777873-2018



IP43


APC _____


SN


0001



2018

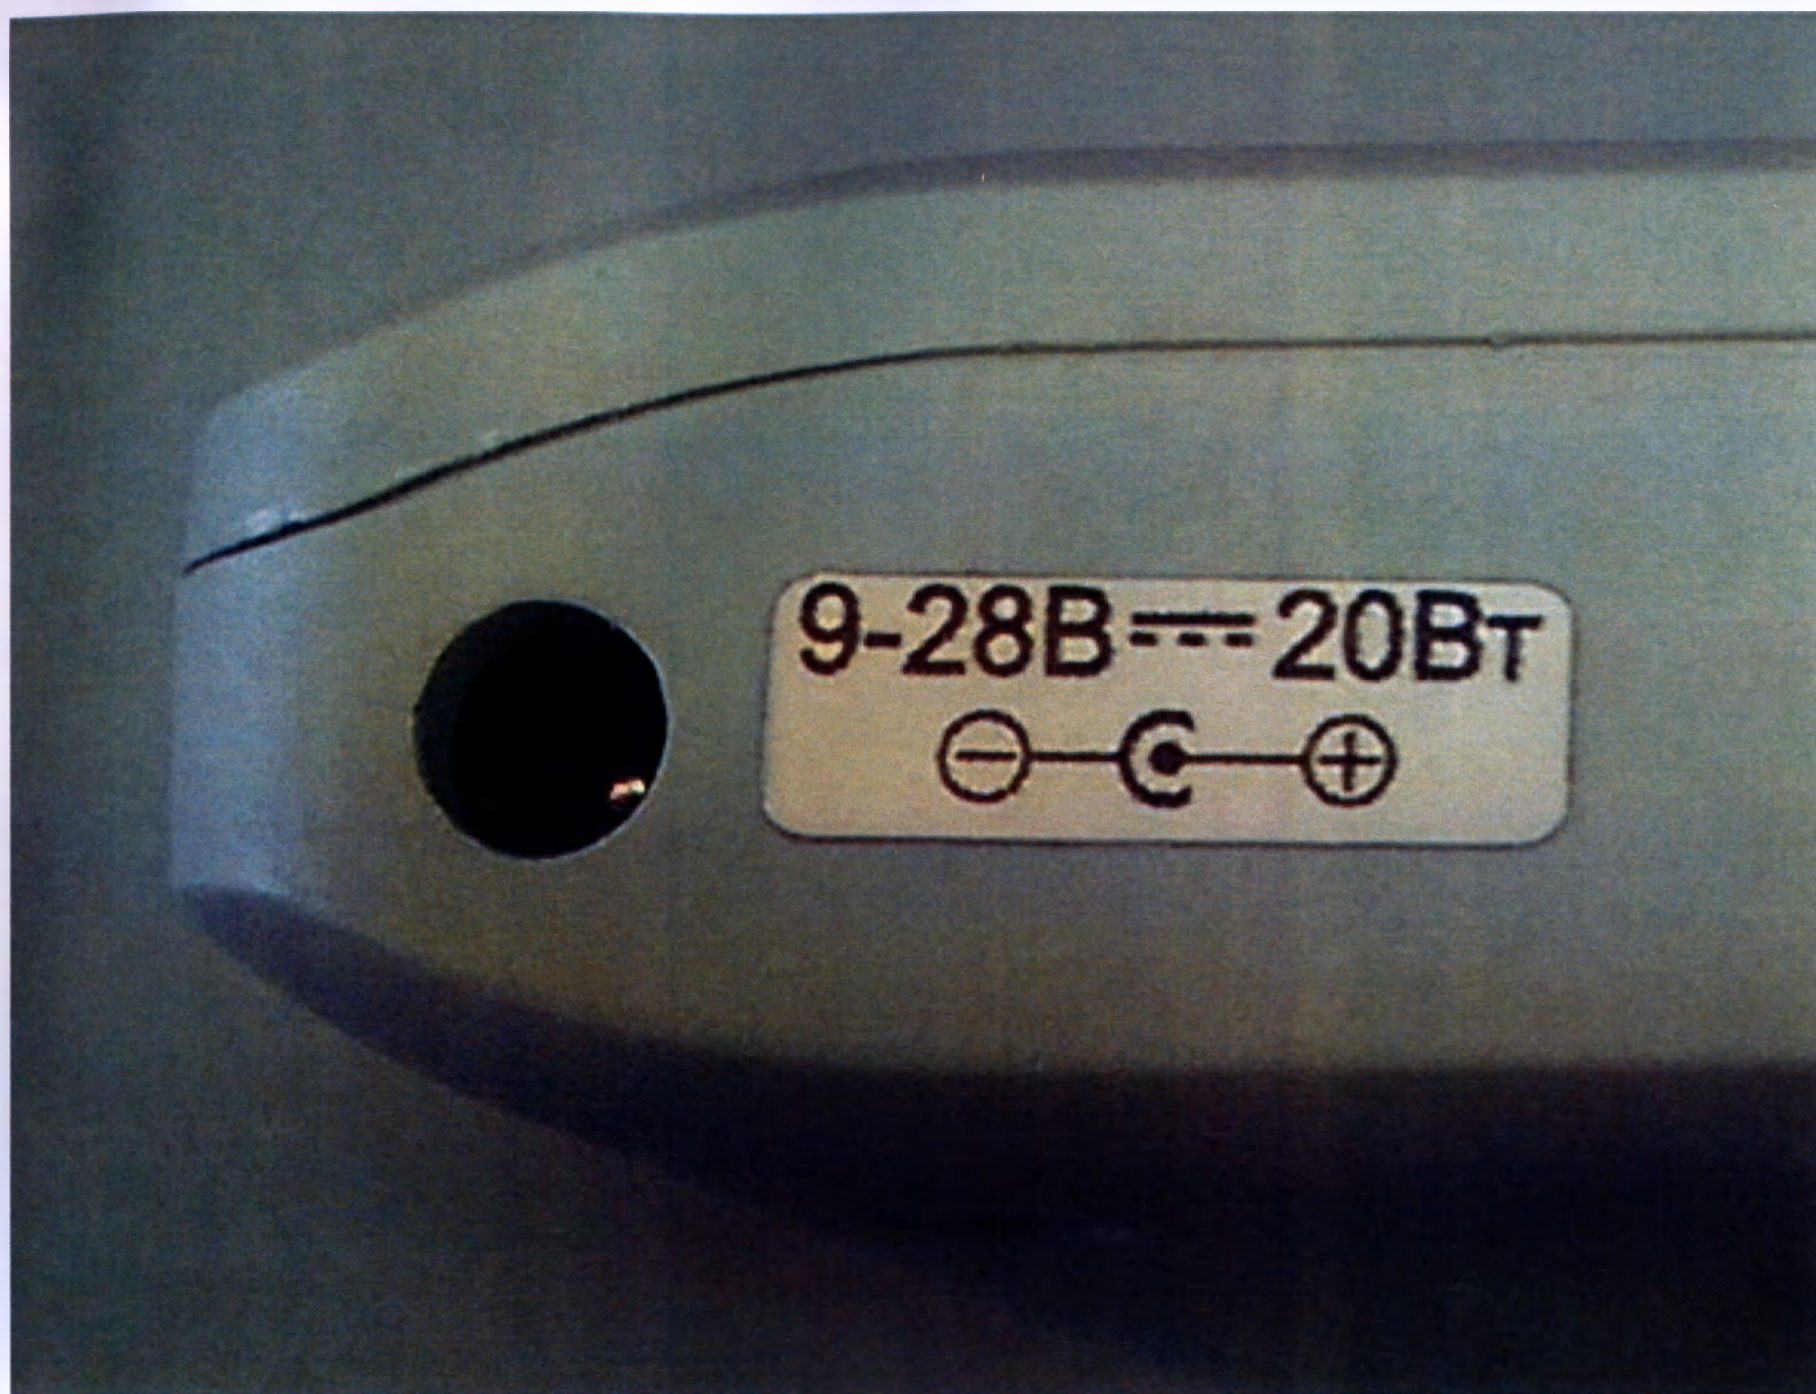

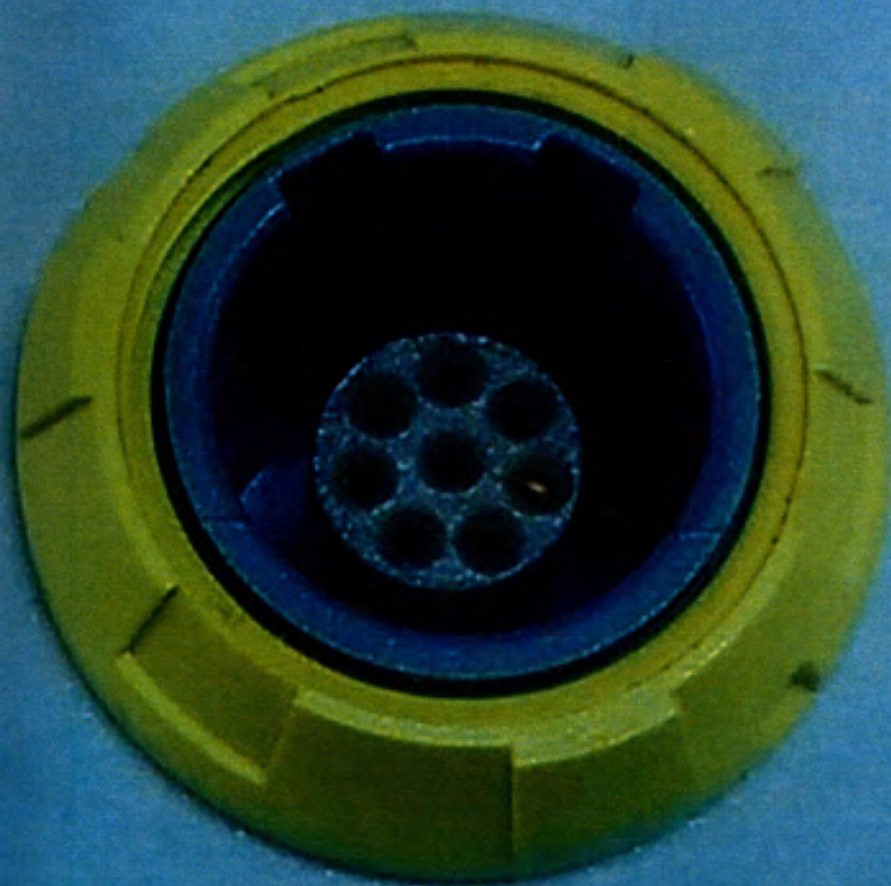

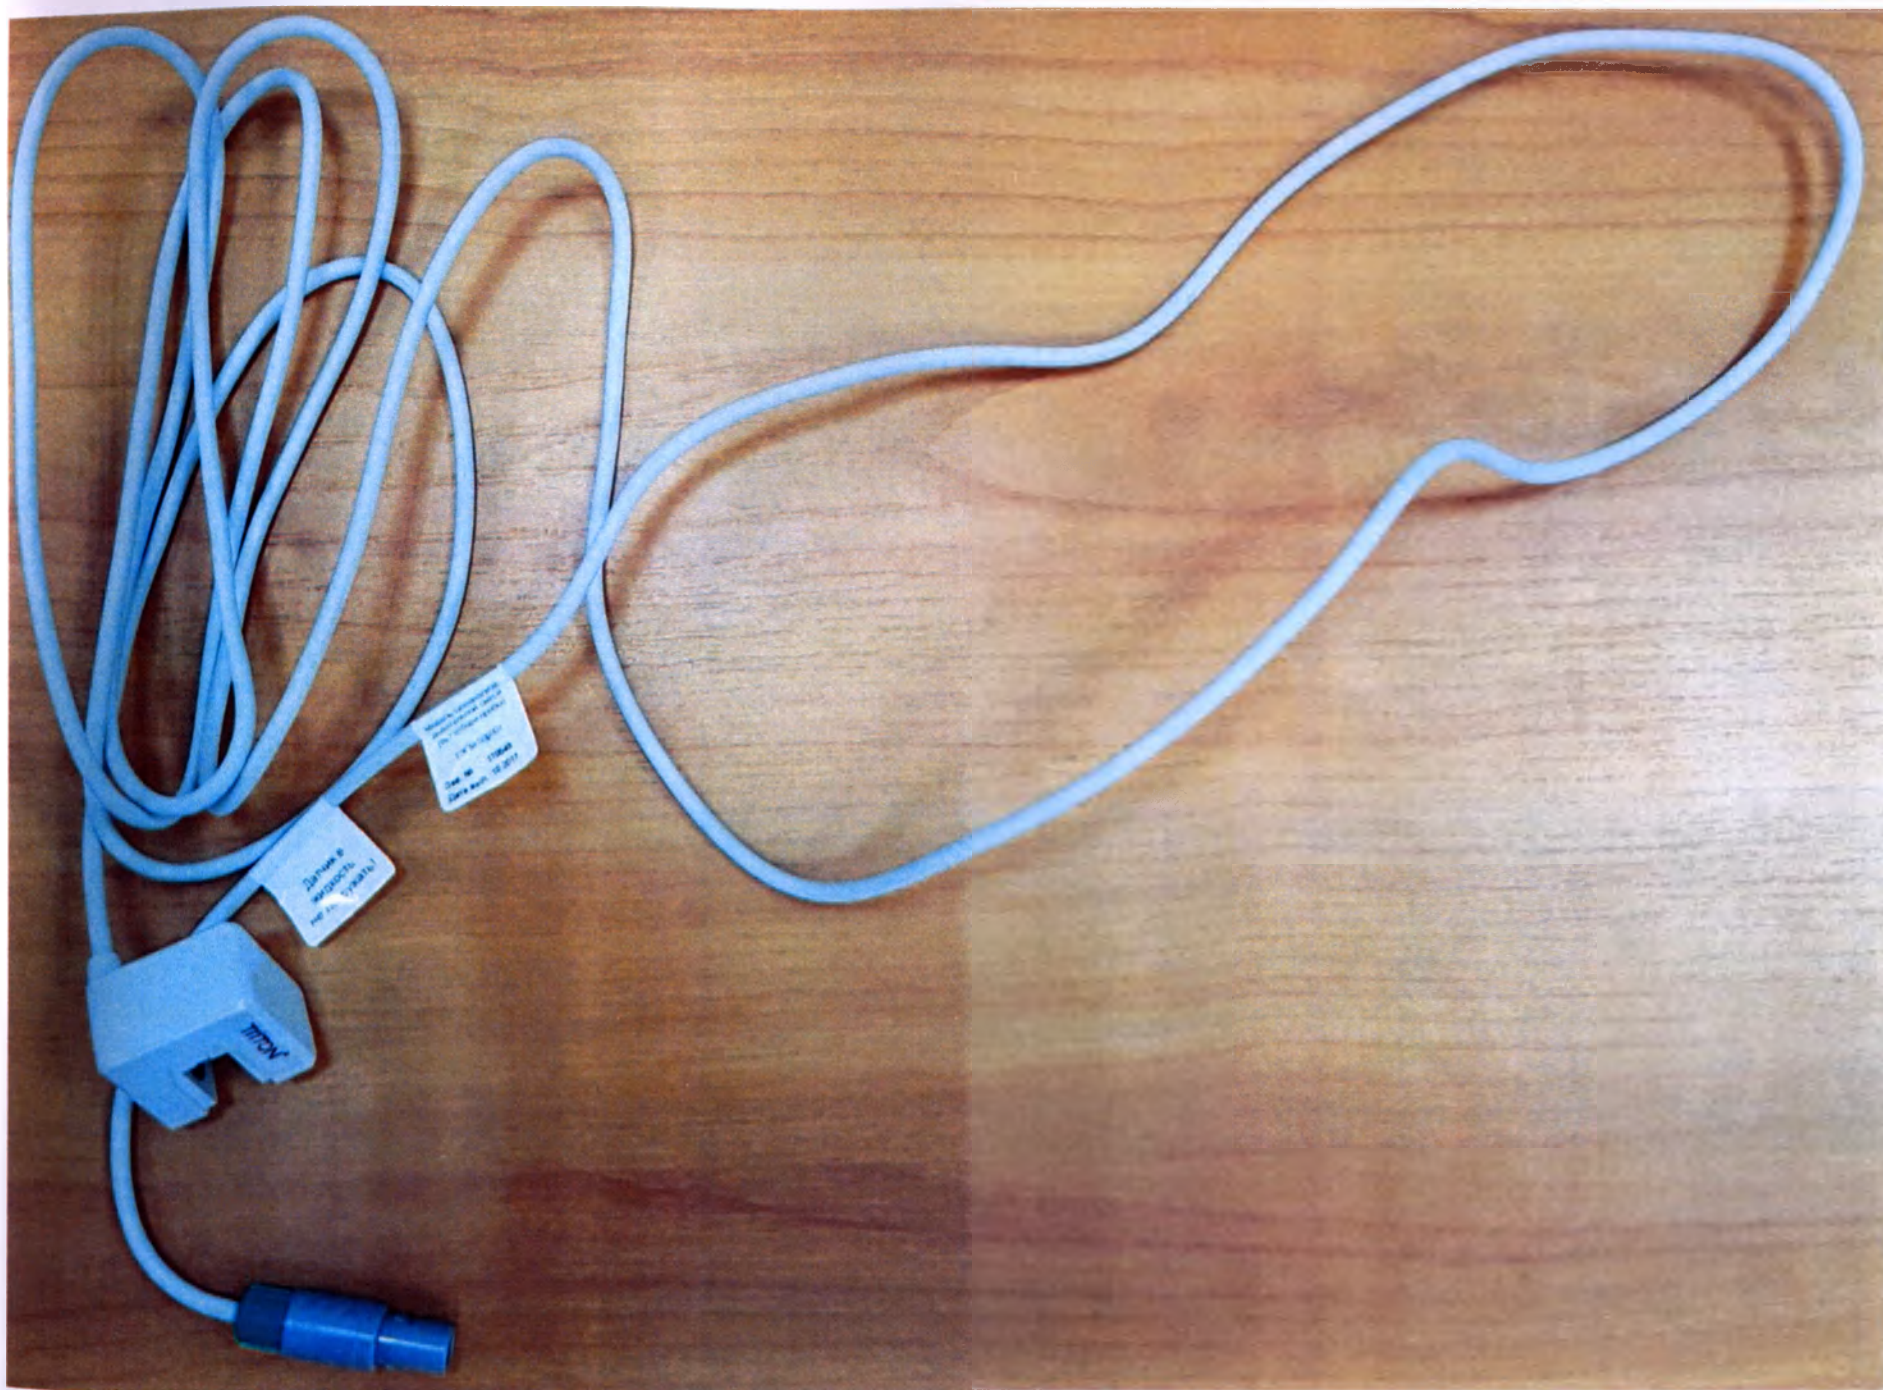



Стекло

Метод стерилизации


287-113 67 3 (2.1998)

Средний срок службы 2 года

TRITON®

Вентиляционный адаптер многоразовый:

- ☒ Взрослый / детский (ТЭСМ.706020)
- ☐ Детский / неонатальный (ТЭСМ.706021)



16.10.2017

LOT

17016




Вентиляционный адаптер многоразовый детский / неонатальный производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия

ТРИТОН

Вентиляционный адаптер многоразовый:

☐ Взрослый / детский (ТЭСМ.706020)

☒ Детский / неонатальный (ТЭСМ.706021)



14.05.2018


LOT

18008


Маркировка: Вентиляционный адаптер многоразовый взрослый / детский производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия



Вентиляционный
адаптер одноразовый
взрослый 2101-00
Повторно не
использовать!

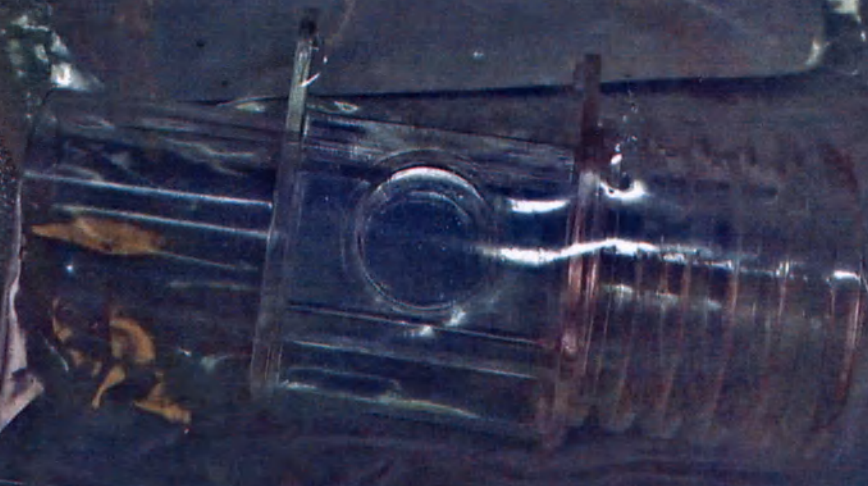

Вентиляционный
адаптер одноразовый
детский 2102-00
Повторно не
использовать!

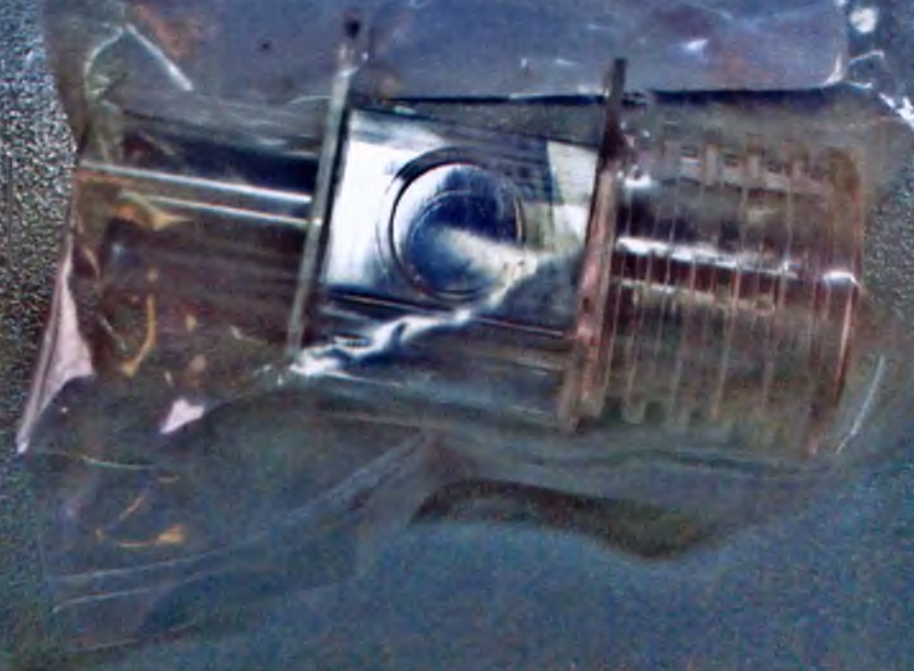



Вентиляционный
адаптер
многоходовый
взрослый 2103-00



Вентиляционный
адаптер
многообразный
детский **2104-00**





Order No.:
GSM36B12-P1J

AC / DC MEDICAL ADAPTOR



MODEL NO.: GSM36B12

INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.9-0.45A

OUTPUT: 12V  3A, 36W MAX.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



IP22




Indoor use only

MW03

MADE IN CHINA



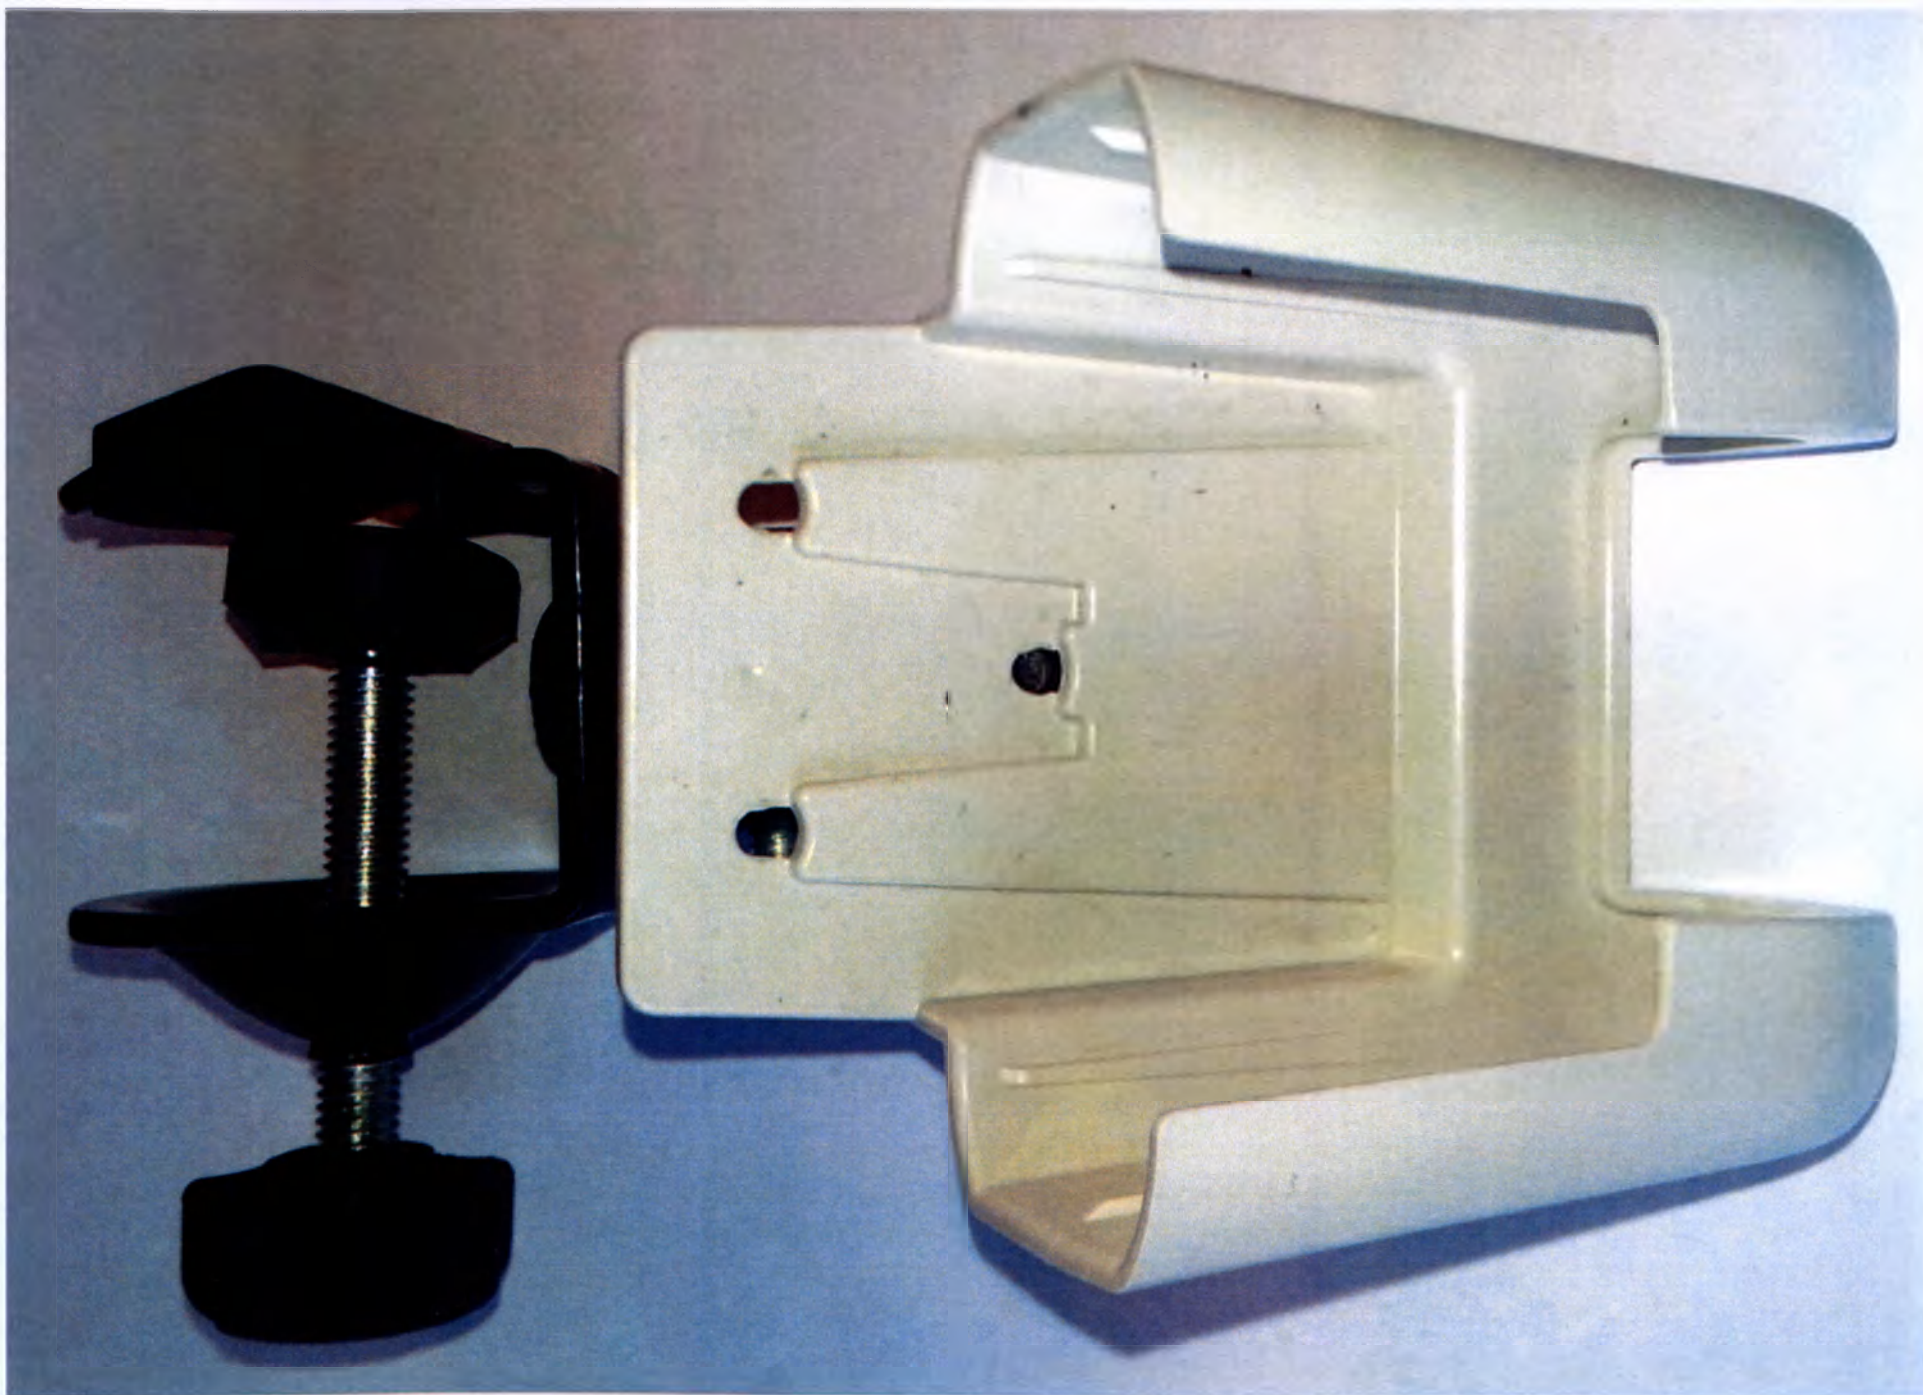



Монитор CO₂
портативный
реанимационный
«КапноТест»

Монитор CO₂
портативный
реанимационный
«КапноТест»



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

Монитор CO₂
портативный
реанимационный
«КапноТест»

МЕДПЛАНТ

Монитор CO₂ портативный реанимационный «КапноТест»



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

Монитор CO₂ портативный реанимационный «КапноТест»

ТУ 26.60.12-022-52777873-2018

Рег.уд. № _____

Арт. № _____



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

Монитор CO₂ портативный реанимационный «КапноТест»



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

тел.: +7(495)223-6016, +7(495)223-6638

e-mail: medplant@medplant.ru www.medplant.ru



ООО «МЕДПЛАНТ»

109316, РФ, Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5



Условия хранения - 1



EN ISO 13485

Питание: (220±22)В; 36 ВА или от 9В/36Вт до 28/36Вт

Год и месяц упаковывания: см. паспорт

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью — 28 —

цифрами

(двадцать восемь)

прописью

) листов

Генеральный директор ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М.

подпись



**Монитор CO2 портативный реанимационный «КапноТест»
по ТУ 26.60.12-022-52777873-2018 с принадлежностями**

**Дополнение
к фотографическим изображениям**

Вентиляционный адаптер одноразовый взрослый 2101-00



Вентиляционный адаптер одноразовый детский 2102-00

Сделано в России

КЛИНИПАК

ПОВРЕЖДЕННУЮ УПАКОВКУ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

75 x 150 mm

Маркировка вентиляционного адаптера одноразового взрослого 2101-00


Вентиляционный адаптер
одноразовый взрослый
REF 2101-00
Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd,
Китай



Только для одного пациента

Стерилизация может изменить
функциональные свойства изделия

Маркировка вентиляционного адаптера одноразового детского 2102-00

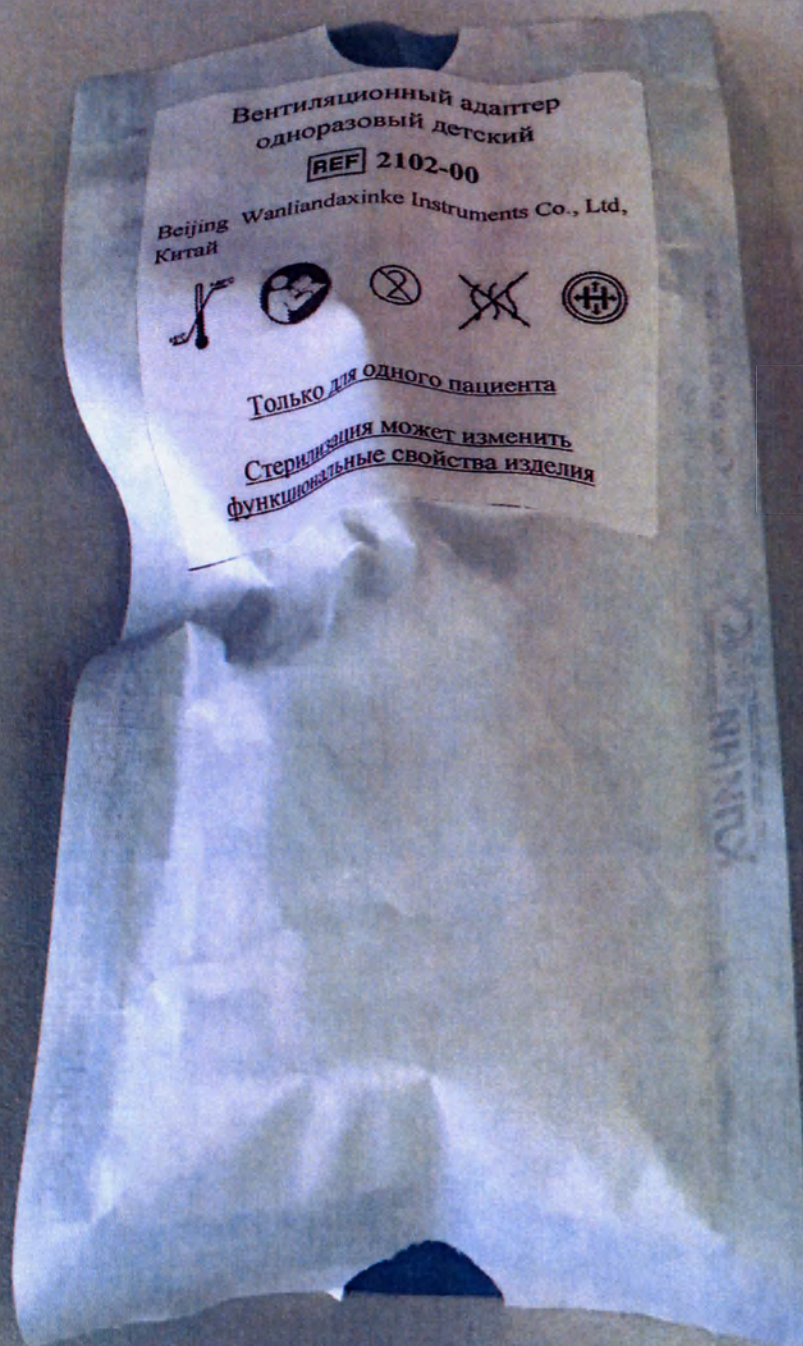

Вентиляционный адаптер
одноразовый детский

REF 2102-00


Beijing Wanliandaxinke Instruments Co., Ltd.
Китай



Только для одного пациента

Стерилизация может изменить
функциональные свойства изделия

Маркировка вентиляционных адаптеров многоразовых
взрослого 2103-00, детского 2104-00

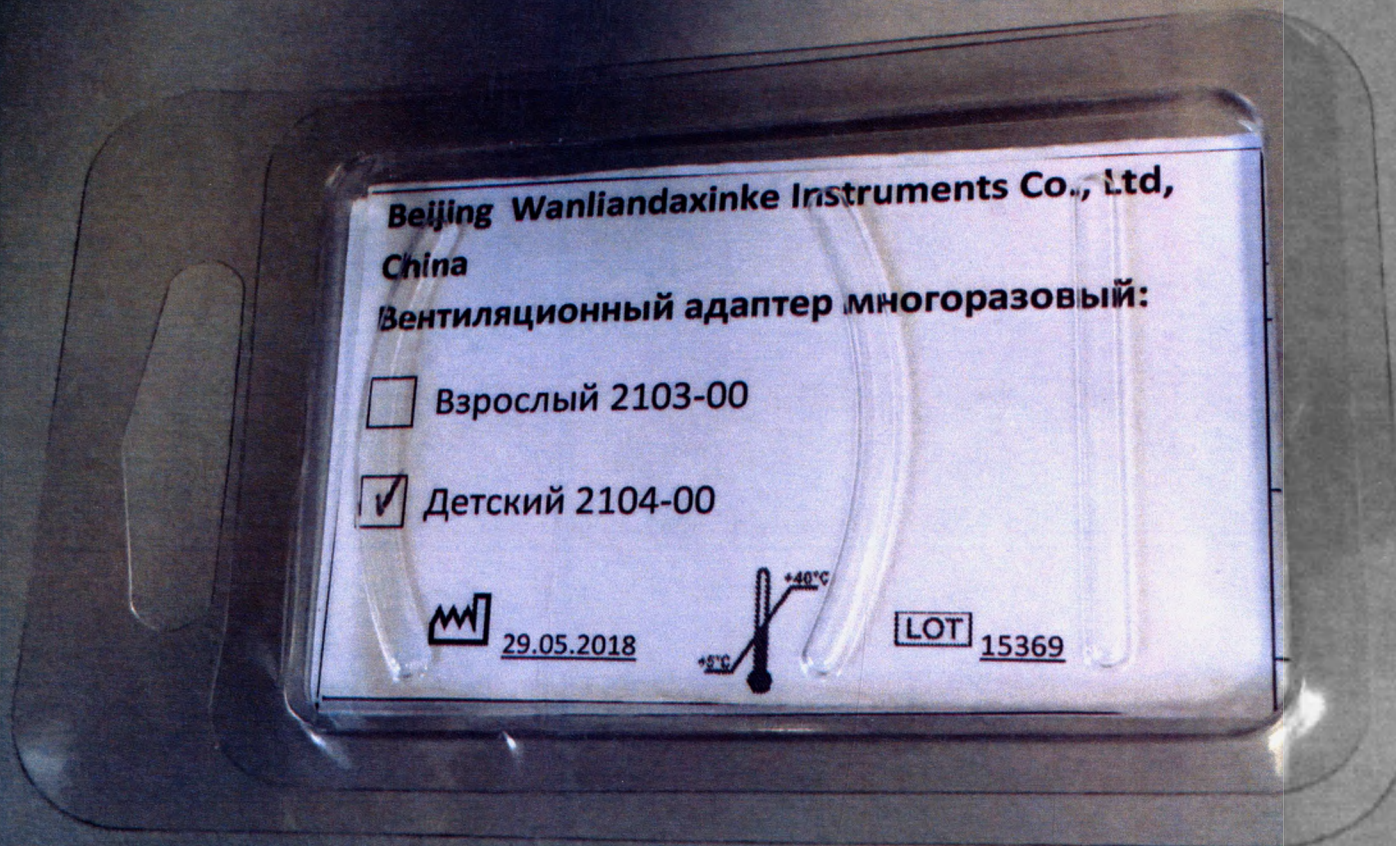

Маркировка вентиляционных адаптеров многоразовых
взрослого/детского ТЭСМ.706020, детского/неонатального ТЭСМ.706021

TRITON®

Вентиляционный адаптер многоразовый:

- ☒ Взрослый / детский (ТЭСМ.706020)
- ☐ Детский / неонатальный (ТЭСМ.706021)



14.06.2018



LOT

18010

Всего прошито, пронумеровано

скреплено печатью

Цифрами

прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Должность

ФИО

ХАРДИНА С.М.

Подпись

