


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Трейдомед Инвест»




Соболева Э. Ж.
2019 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**

«Система для обследования электрофизиологических функций зрения, варианты исполнения Diopsys NOVA, Diopsys NOVA ARGOS и Diopsys NOVA RETINA PLUS, с принадлежностями»

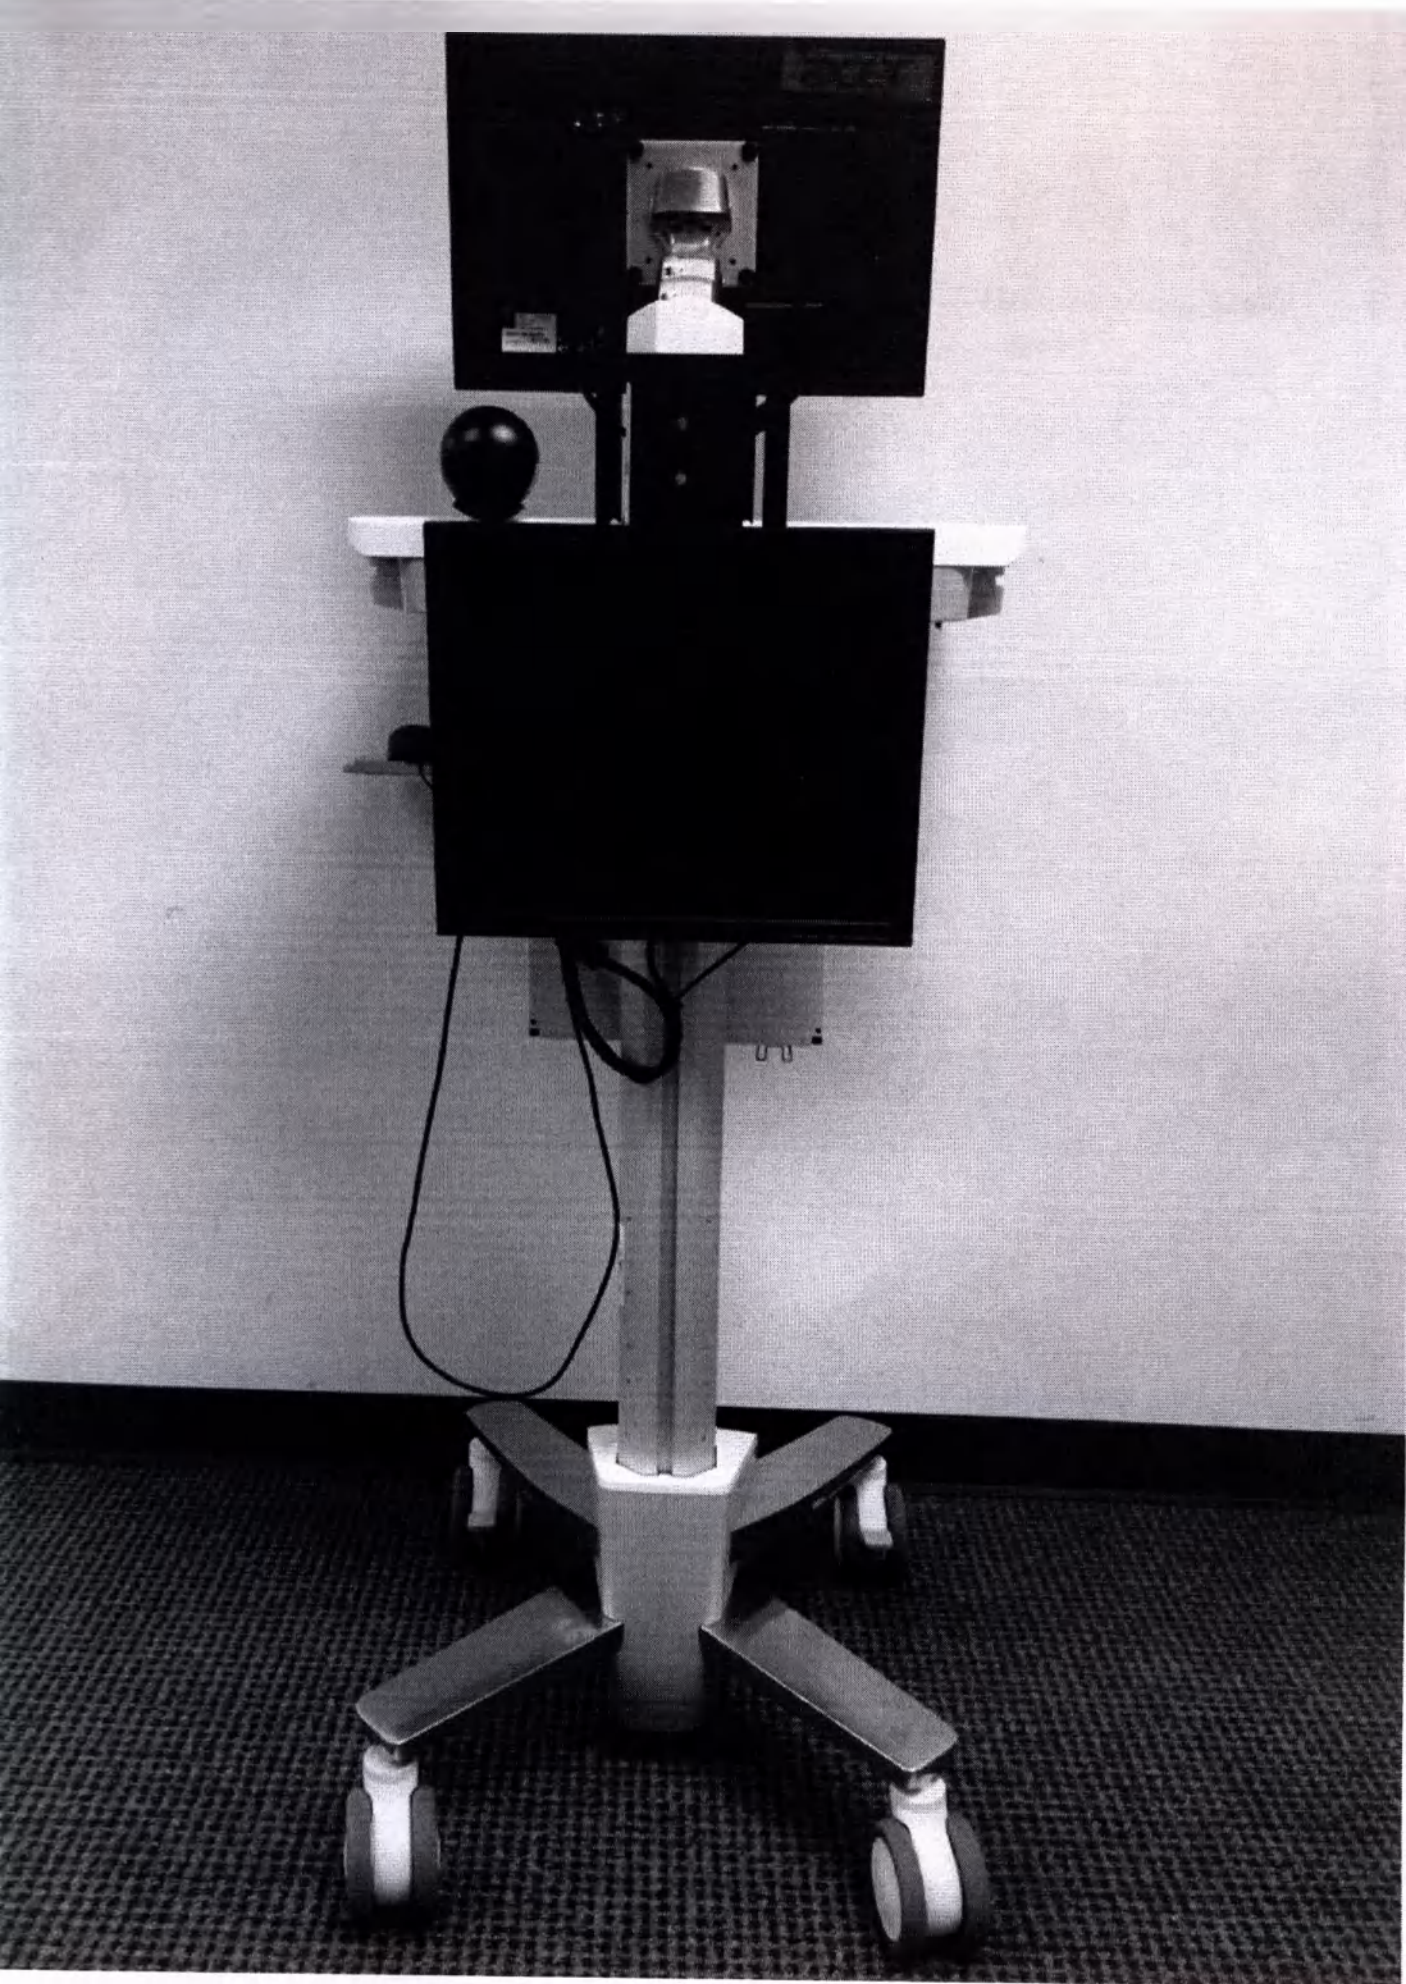

ка мобильная с основным блоком с предустановленным программным обеспечением версии 627.7535 и монитором для пациента

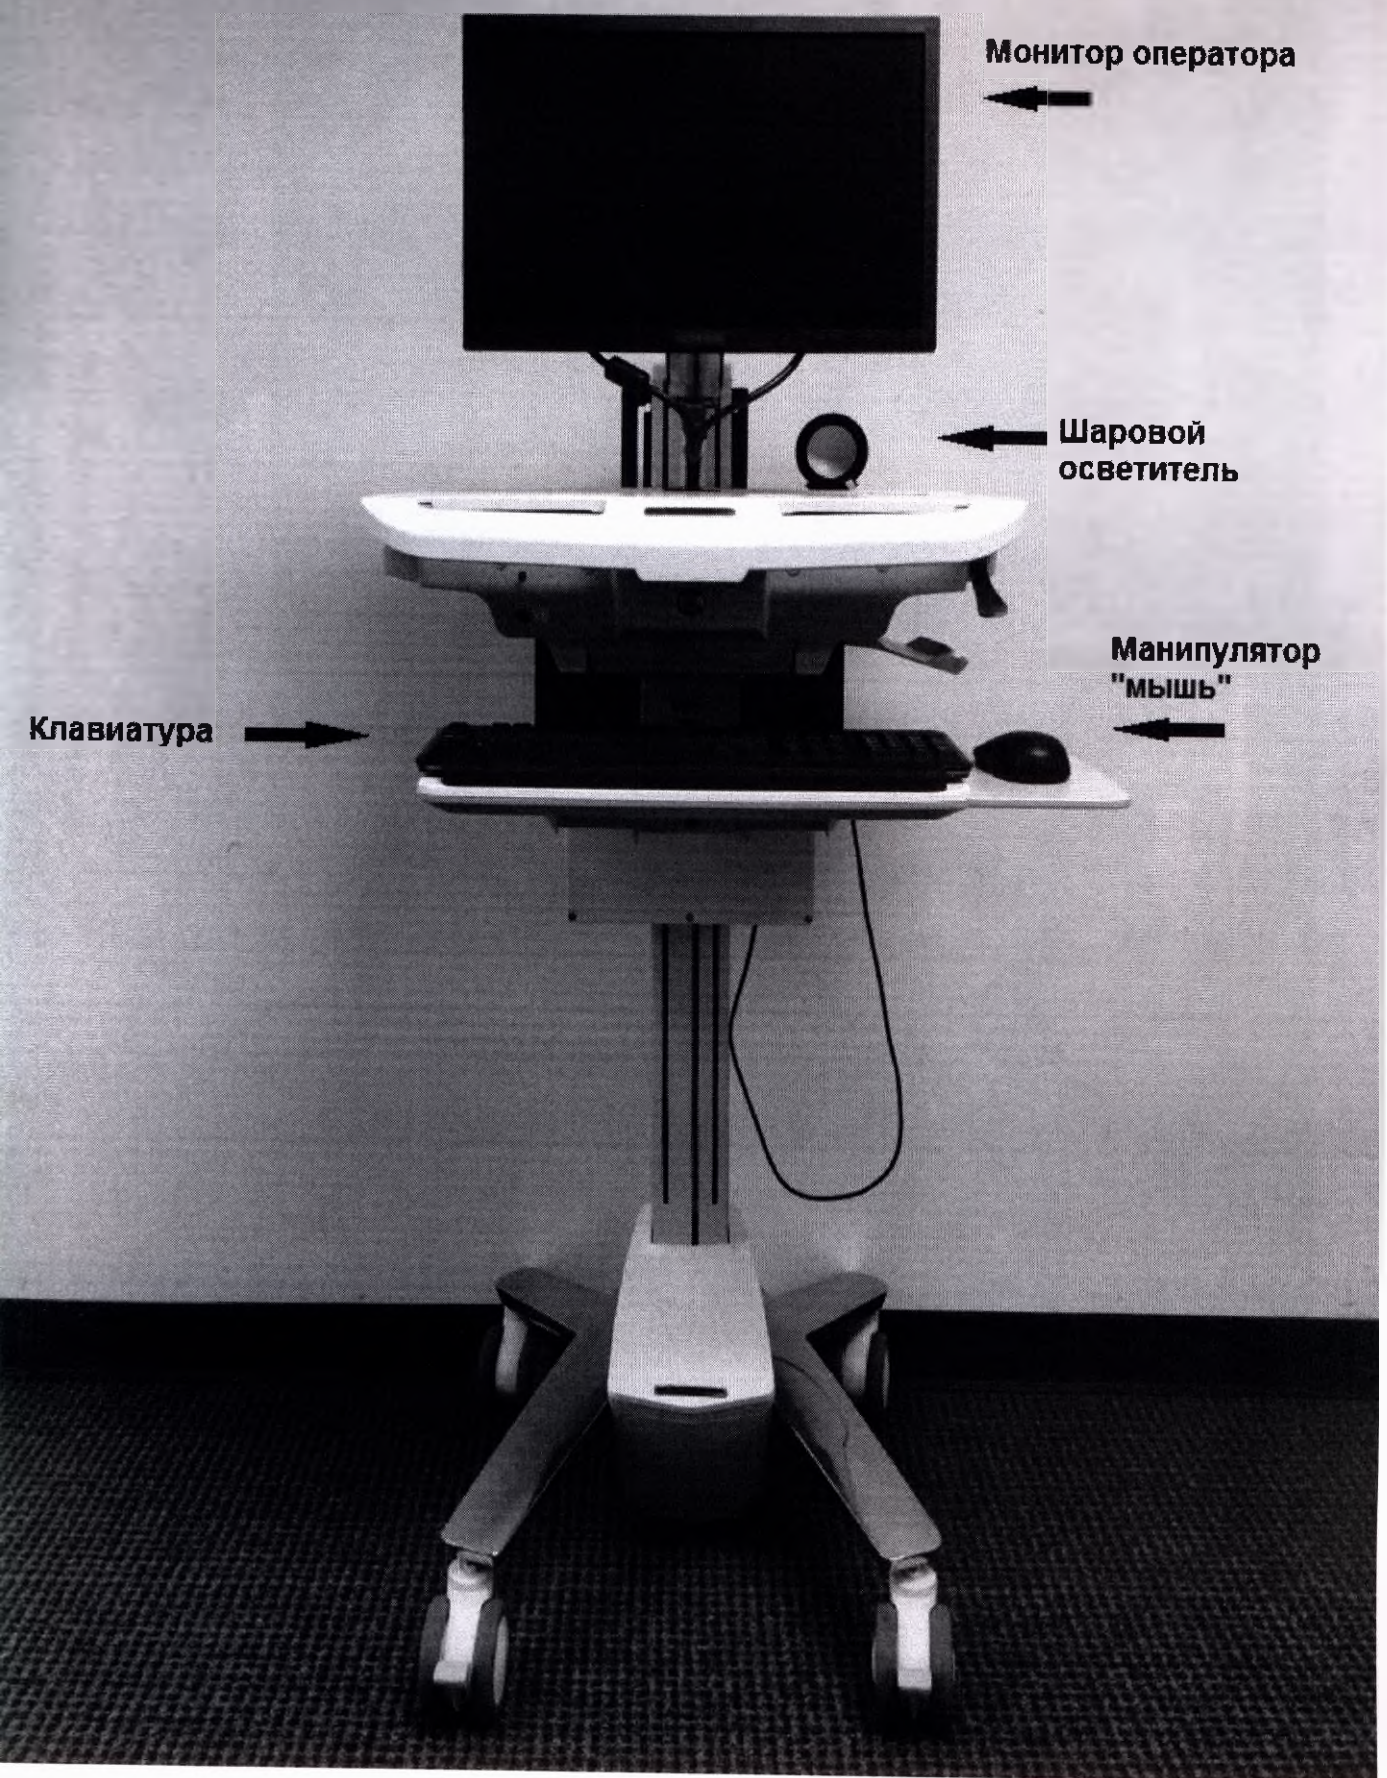

Система Diopsys NOVA

Основной блок с предустановленным
программным обеспечением версии 2.19.26627.7535
с монитором для пациента


Монитор оператора

Клавиатура USB беспроводная

Система Diopsys NOVA ARGOS

(при необходимости)

Ноутбук

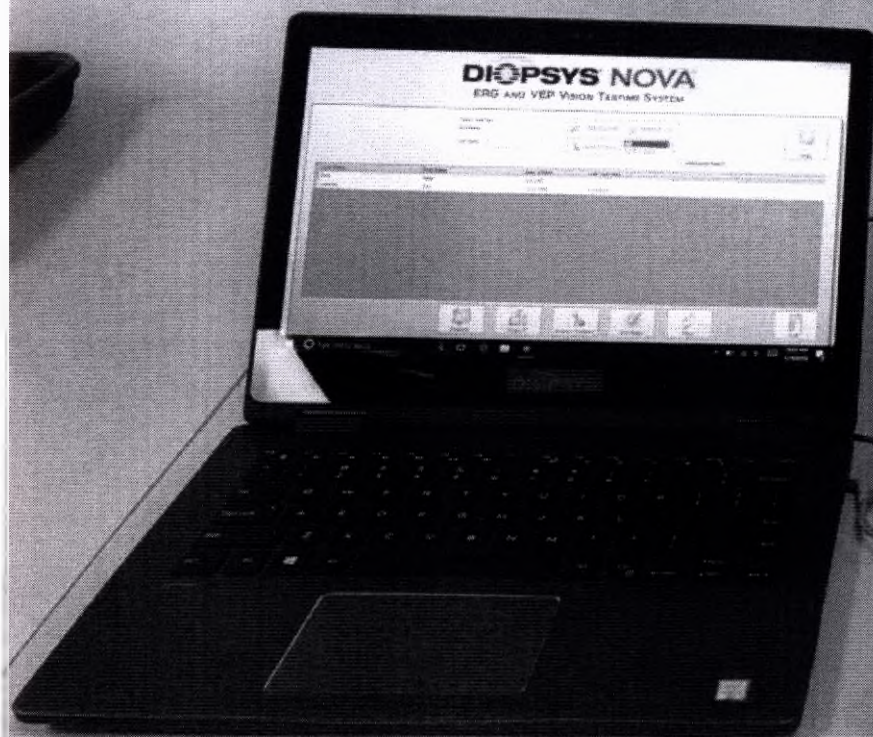


Разветвитель

Основной блок с
предустановленным
программным обеспечением
версии 2.19.26627.7535

Система Diopsys NOVA RETINA PLUS




Сетевой кабель

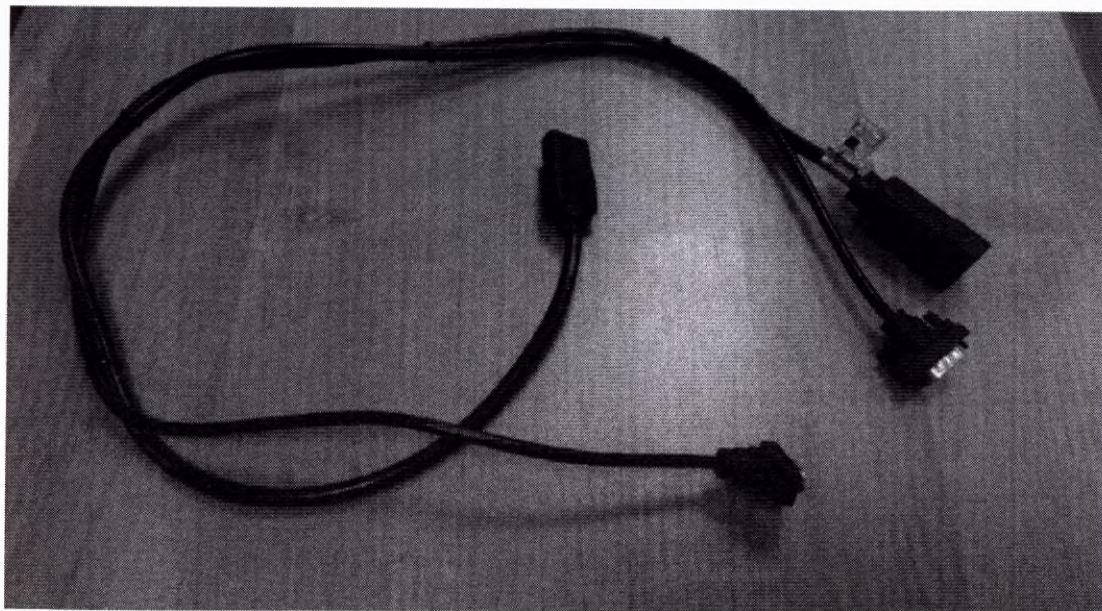

Комплект кабелей для монитора оператора (сетевой кабель и кабели VGA)



Кабель соединительный усилителя сигнала ЭЭГ

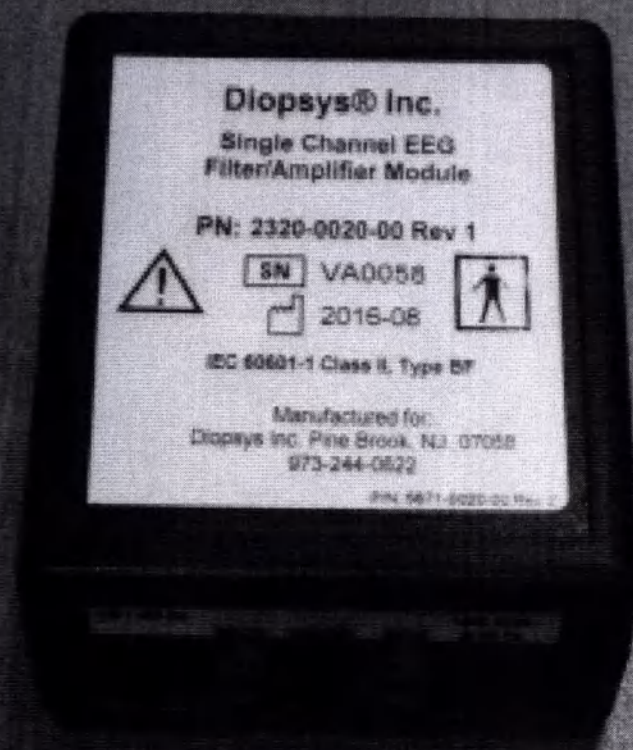

Усилитель сигнала ЭЭГ.



Держатель шарового осветителя.

Версия

13c

2.15.19

Система для обследования электрофизиологических функций
зрения, варианты исполнения

Diopsys NOVA

Diopsys NOVA ARGOS

Diopsys NOVA RETINA PLUS

с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Настоящее руководство является исключительной собственностью Diopsys, Inc.
Приведенные в руководстве данные являются конфиденциальной информацией.

Если данный документ обнаружите бесplatно, пожалуйста, верните его по адресу:

Diopsys, Inc.

16 Chapin Rd., Suite 911-912

Pine Brook, NJ 07038

Телефон: 973-244-0622

Факс: 973-244-0670


www.diopsys.com

Копирайт: © 2019 Diopsys, Inc.


ОО-2019-16

5602-0010-00 версия 13c

Diopsys, Inc. • 16 Chapin Road, Suite 911 - 912 • P.O. Box 672 • Pine Brook, NJ 07038 • www.diopsys.com

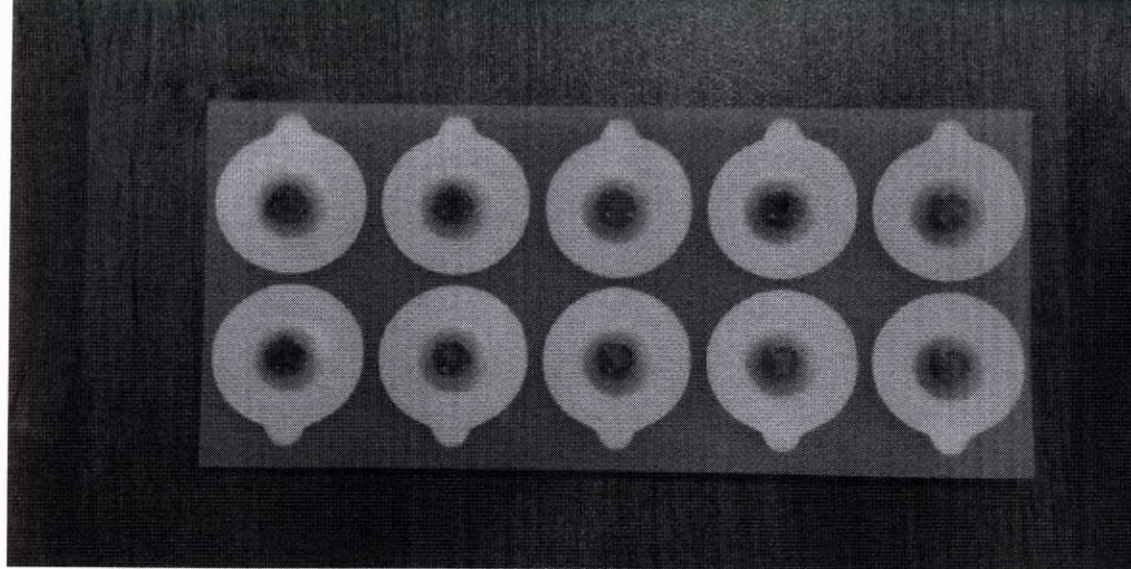


Электроды одноразовые для ЭЭГ

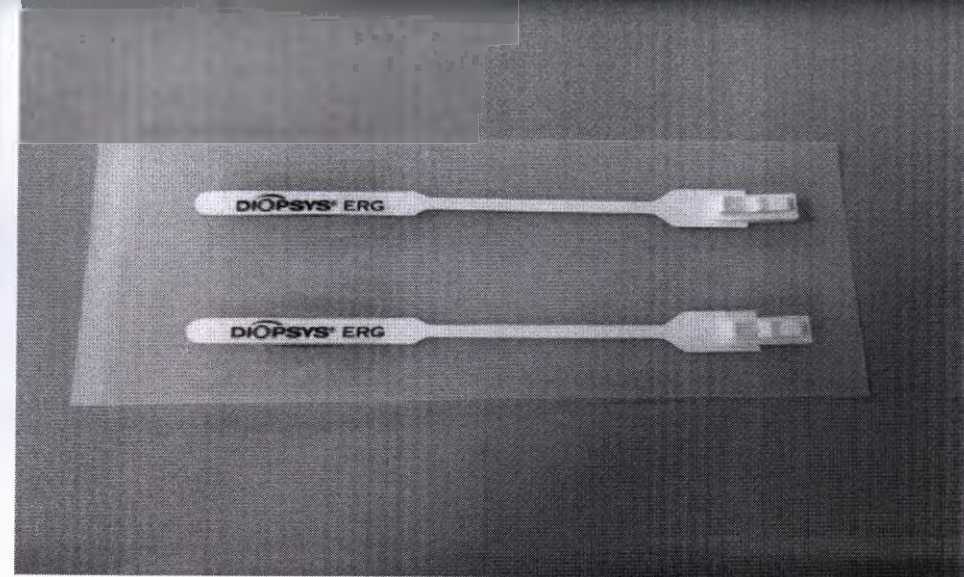

Электроды одноразовые на веко для ЭРГ




Комплект кабелей для ЭЭГ

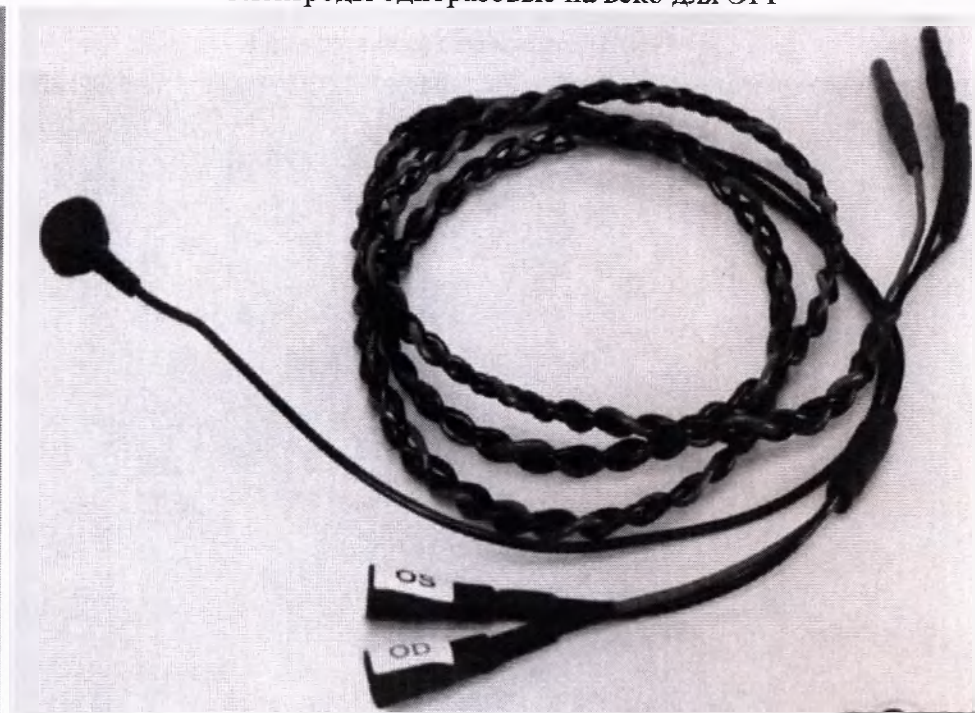

Комплект кабелей для ЭРГ



Салфетки очищающие для век OCuSOFT Lid Scrub (30 шт./1 уп.)

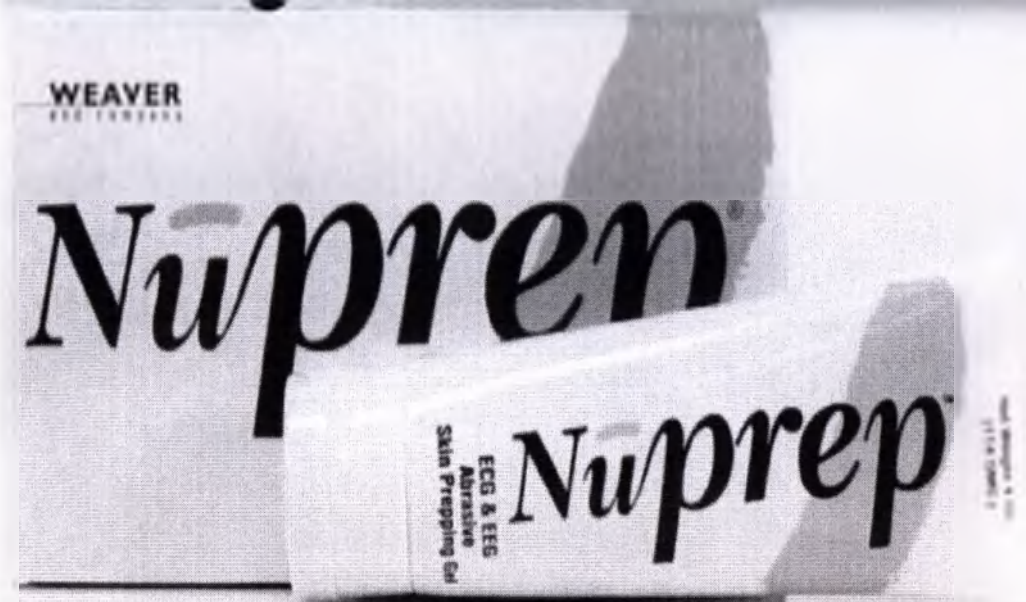


Гель для подготовки кожи NuPrep




Паста проводящая Ten20




Тампоны марлевые нестерильные, 5,1 x 5,1 см (200 шт./1 уп.)

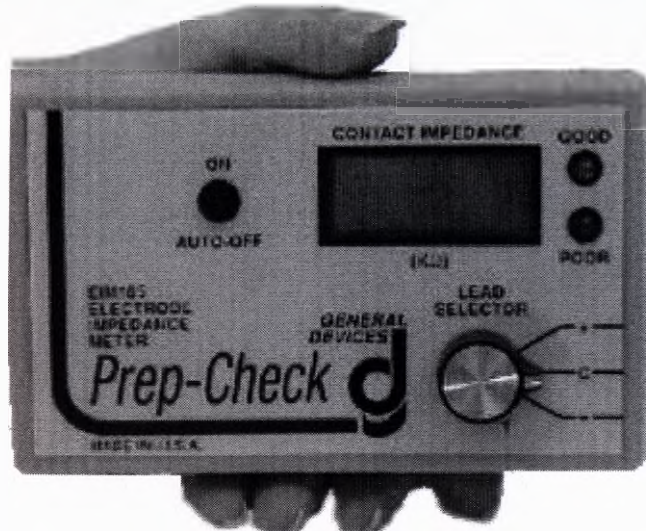

Измеритель импеданса

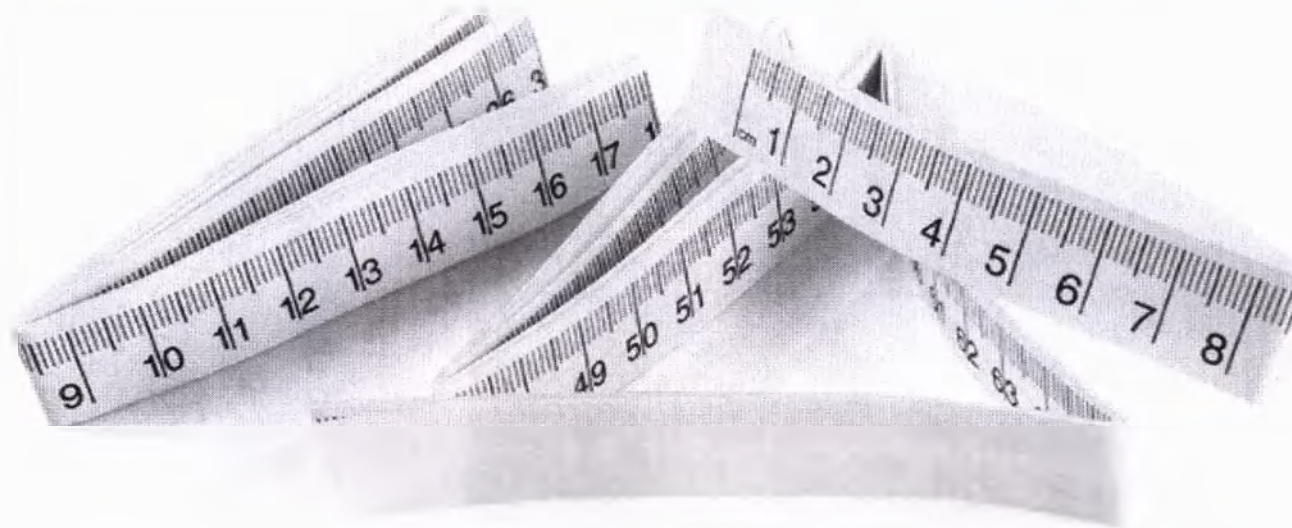

Измерительная лента

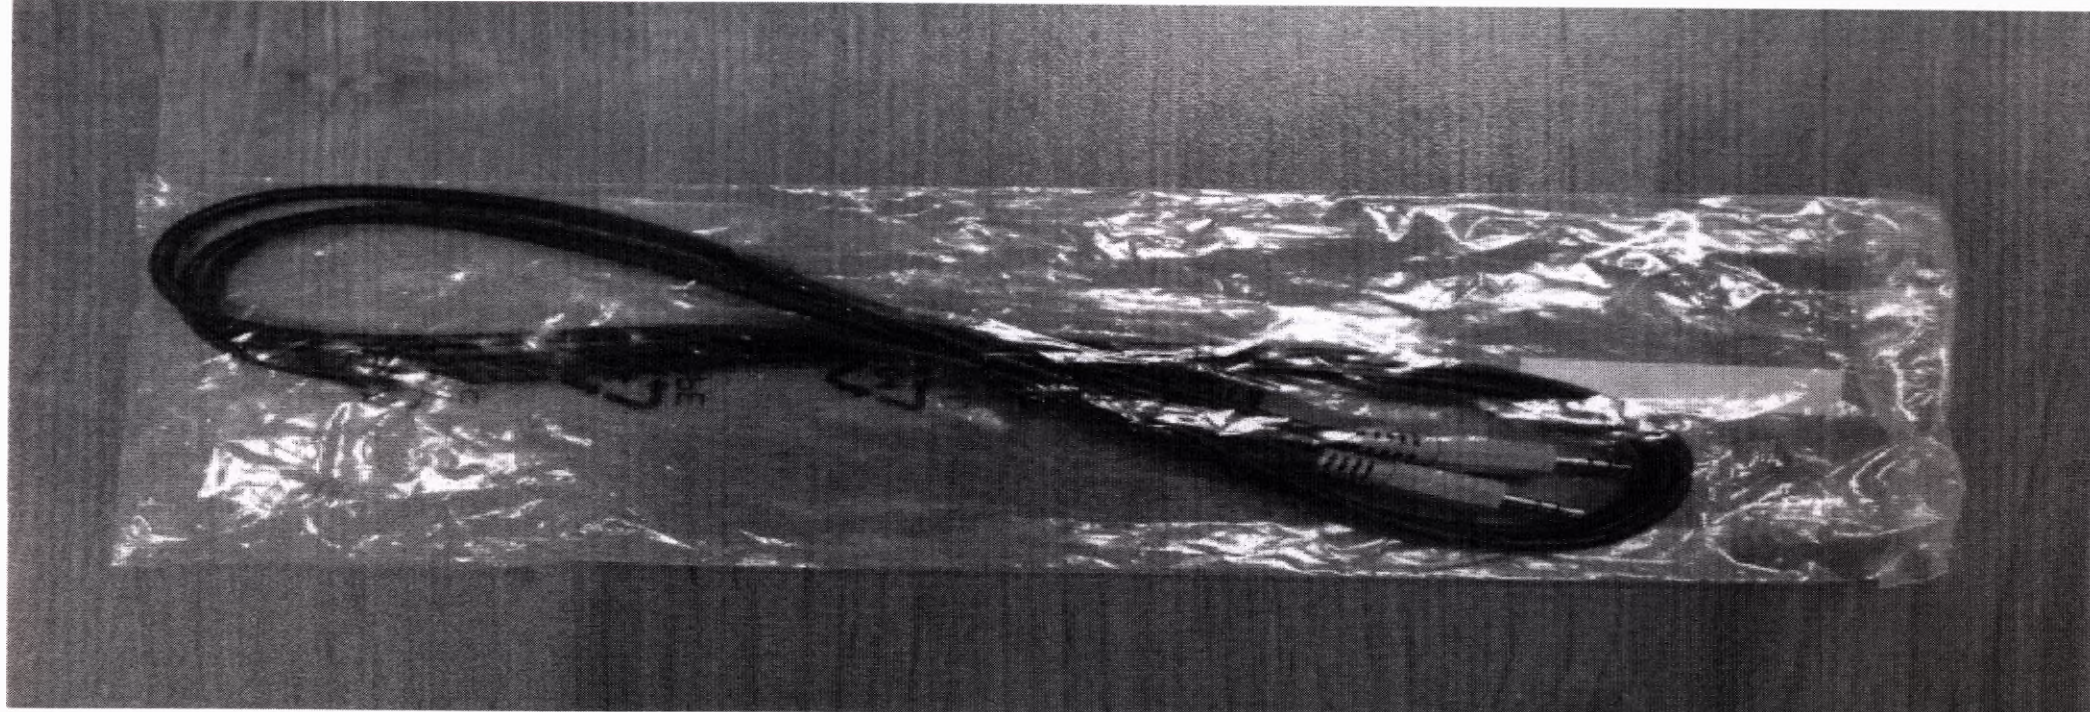


Кабель AUX (при необходимости)




Ключ




Брелоки (при необходимости)

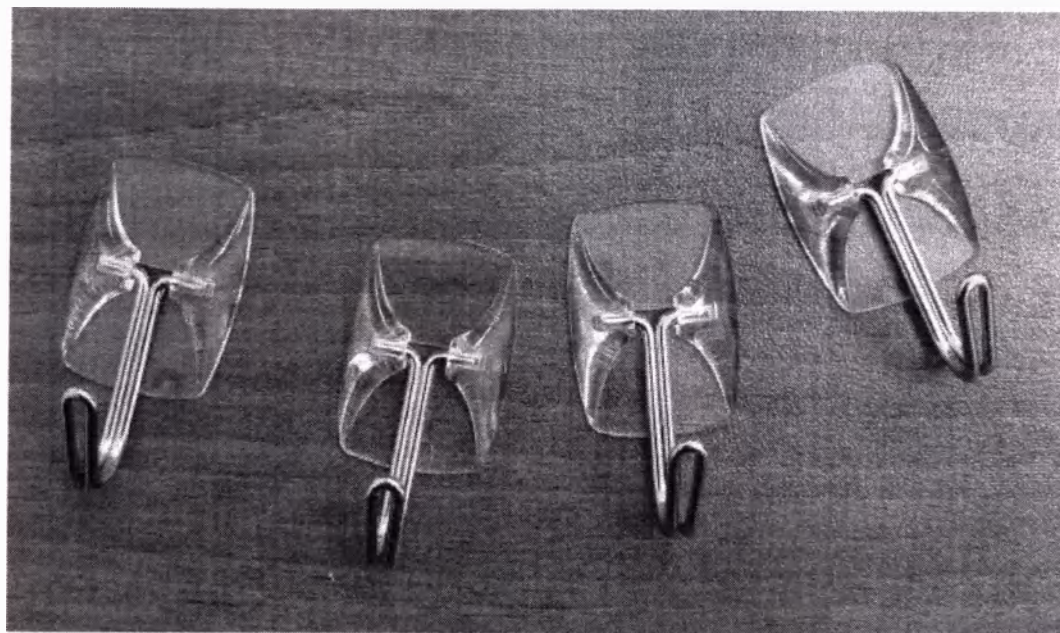

Крючки (при необходимости)

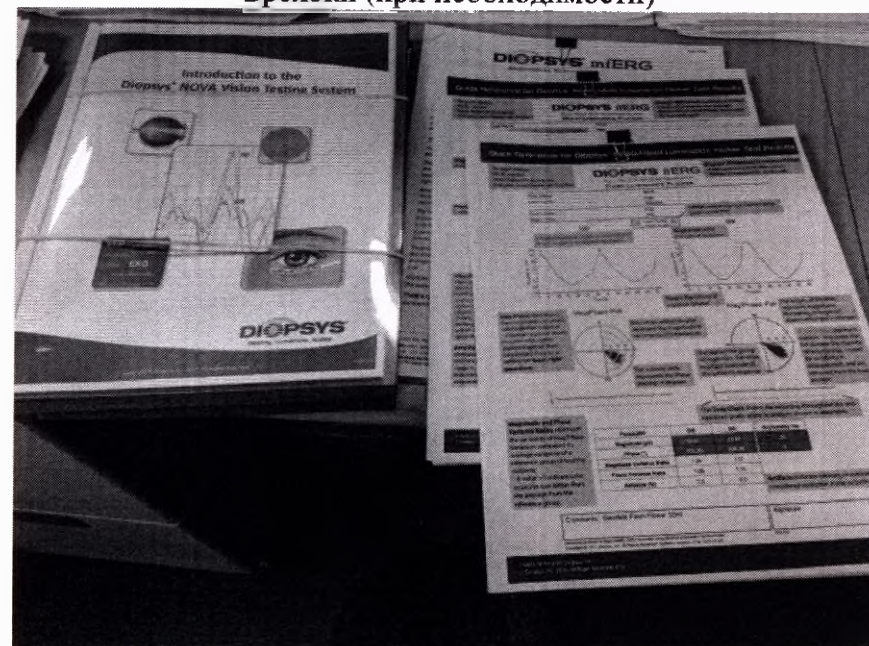


Комплект сопроводительной документации (при необходимости)

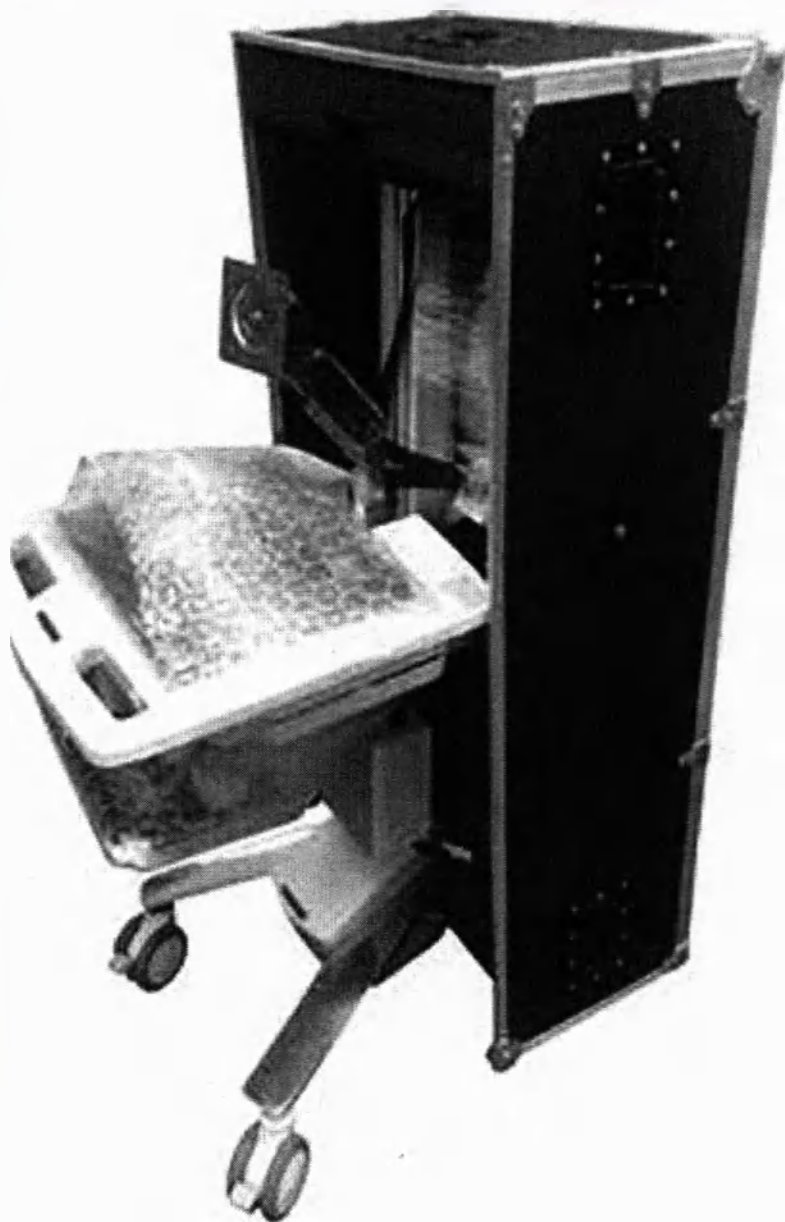

Кейс для транспортировки системы Diopsys NOVA



Кейс для транспортировки системы Diopsys NOVA ARGOS

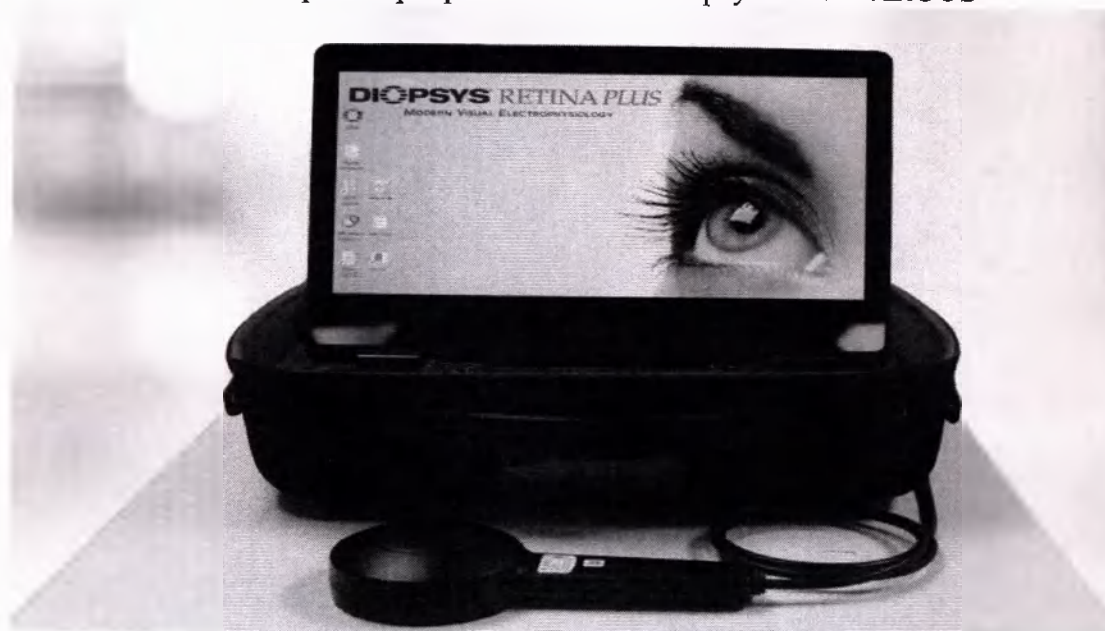

Кейс для транспортировки системы Diopsys NOVA RETINA PLUS

Решо прошито
15 листов

