




Фотографические материалы медицинского изделия.

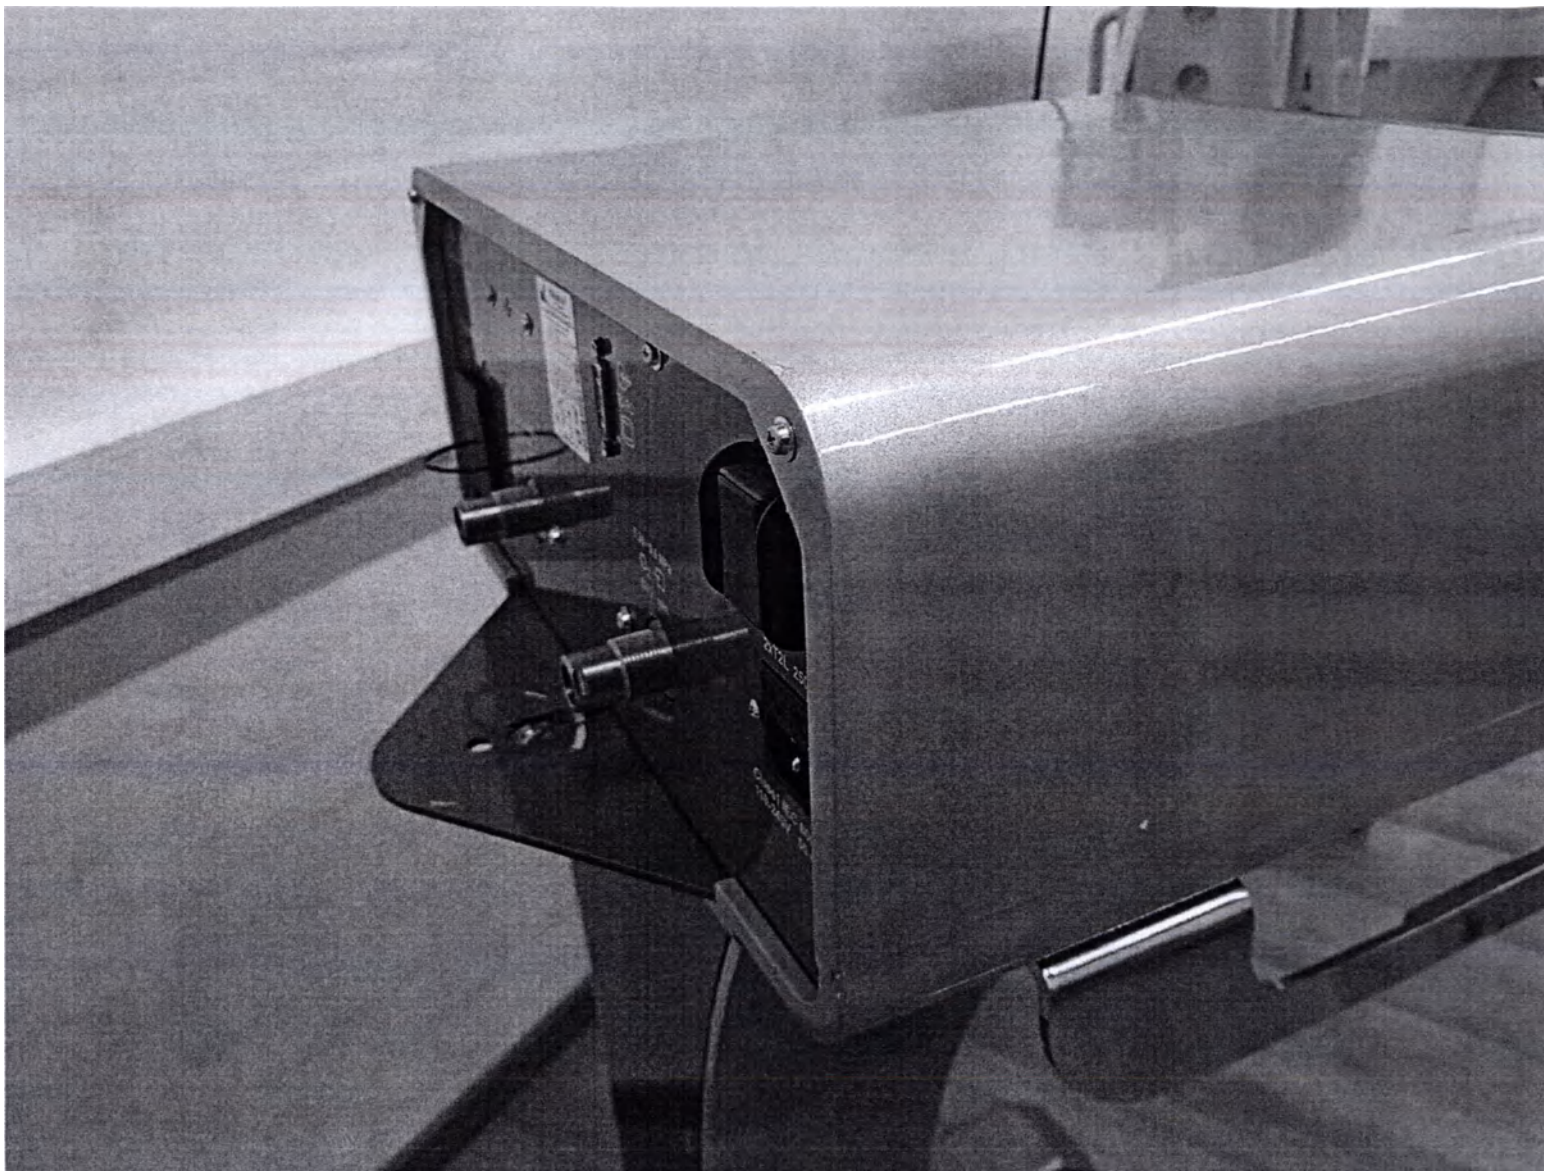


Основной блок Basic с панелью управления

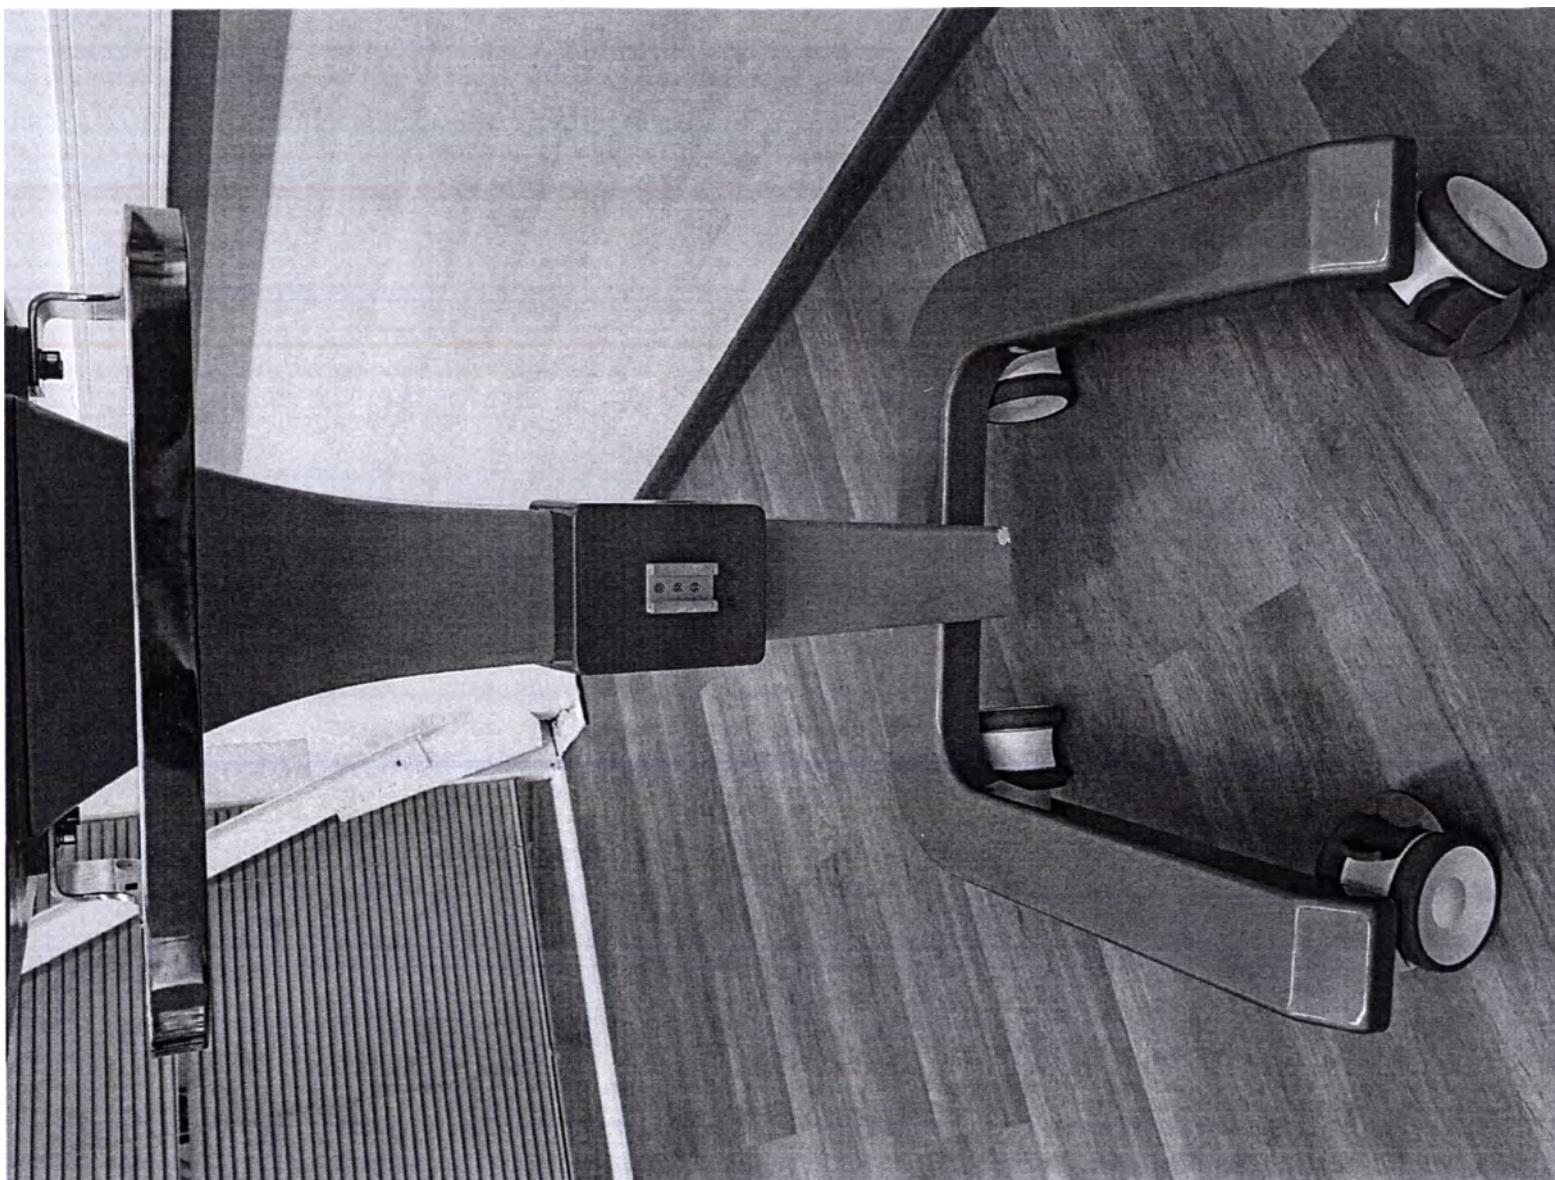


Стойка Profi

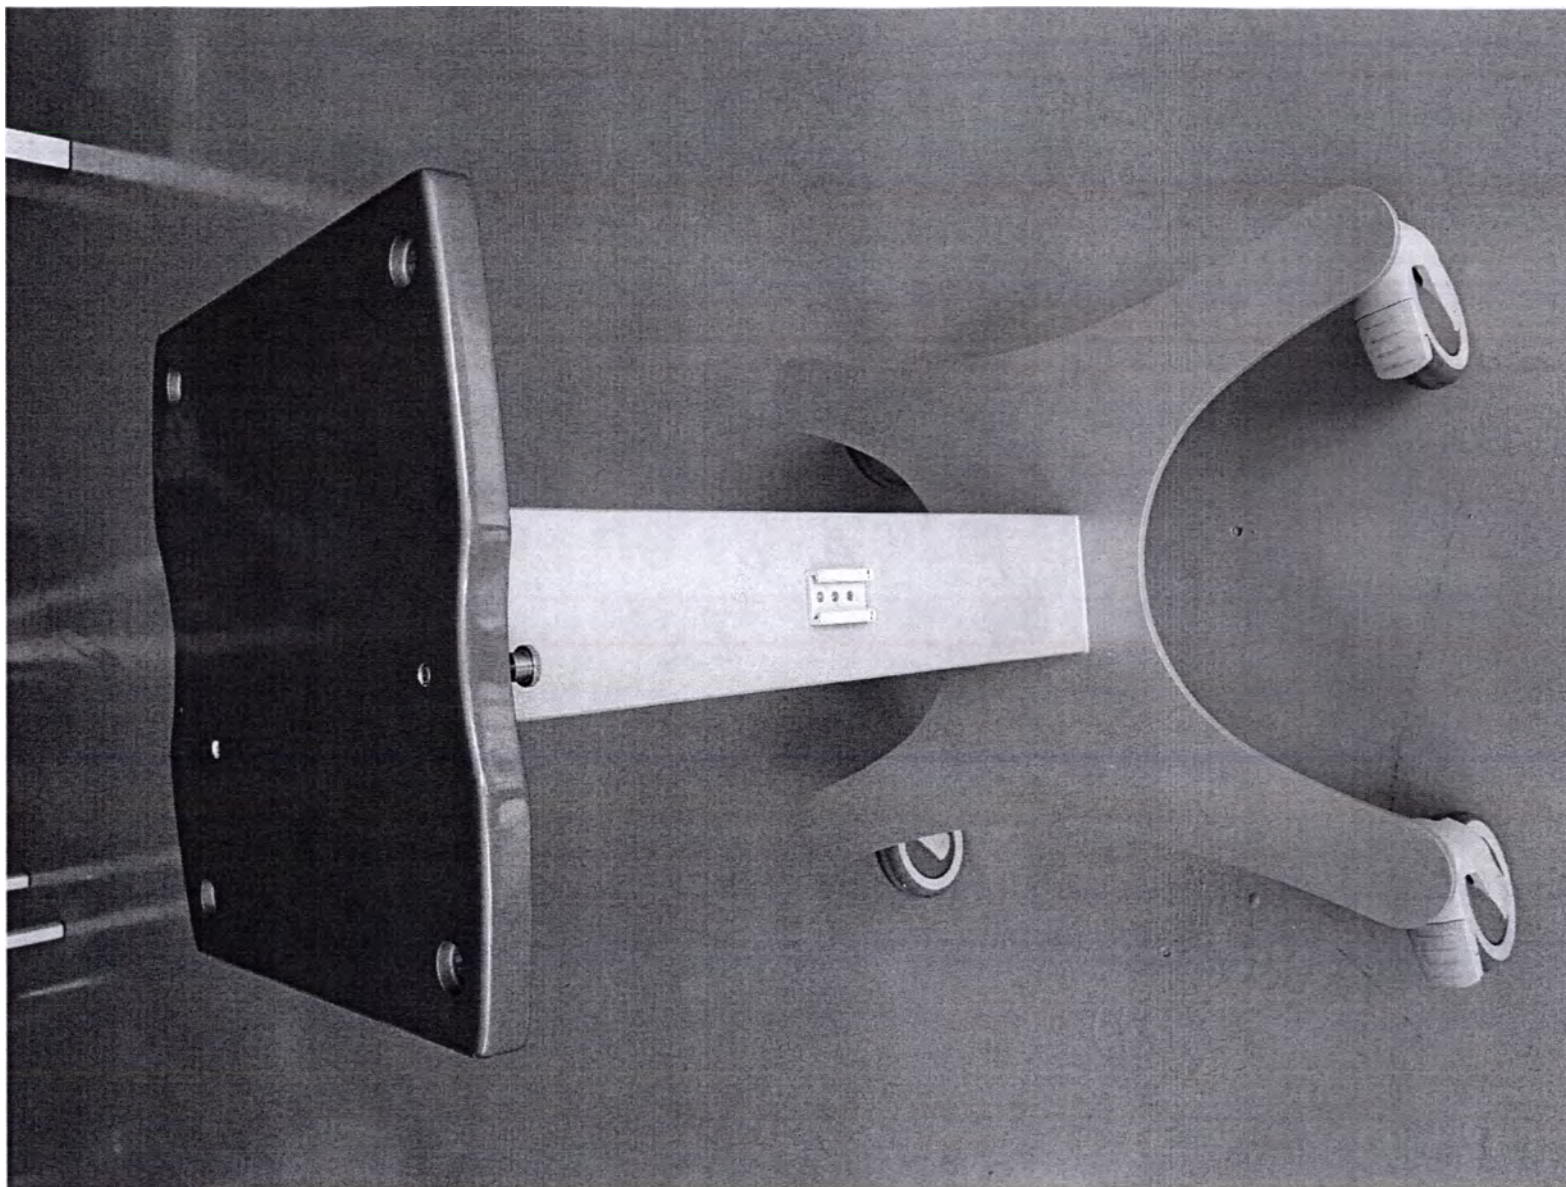


Стойка Basic

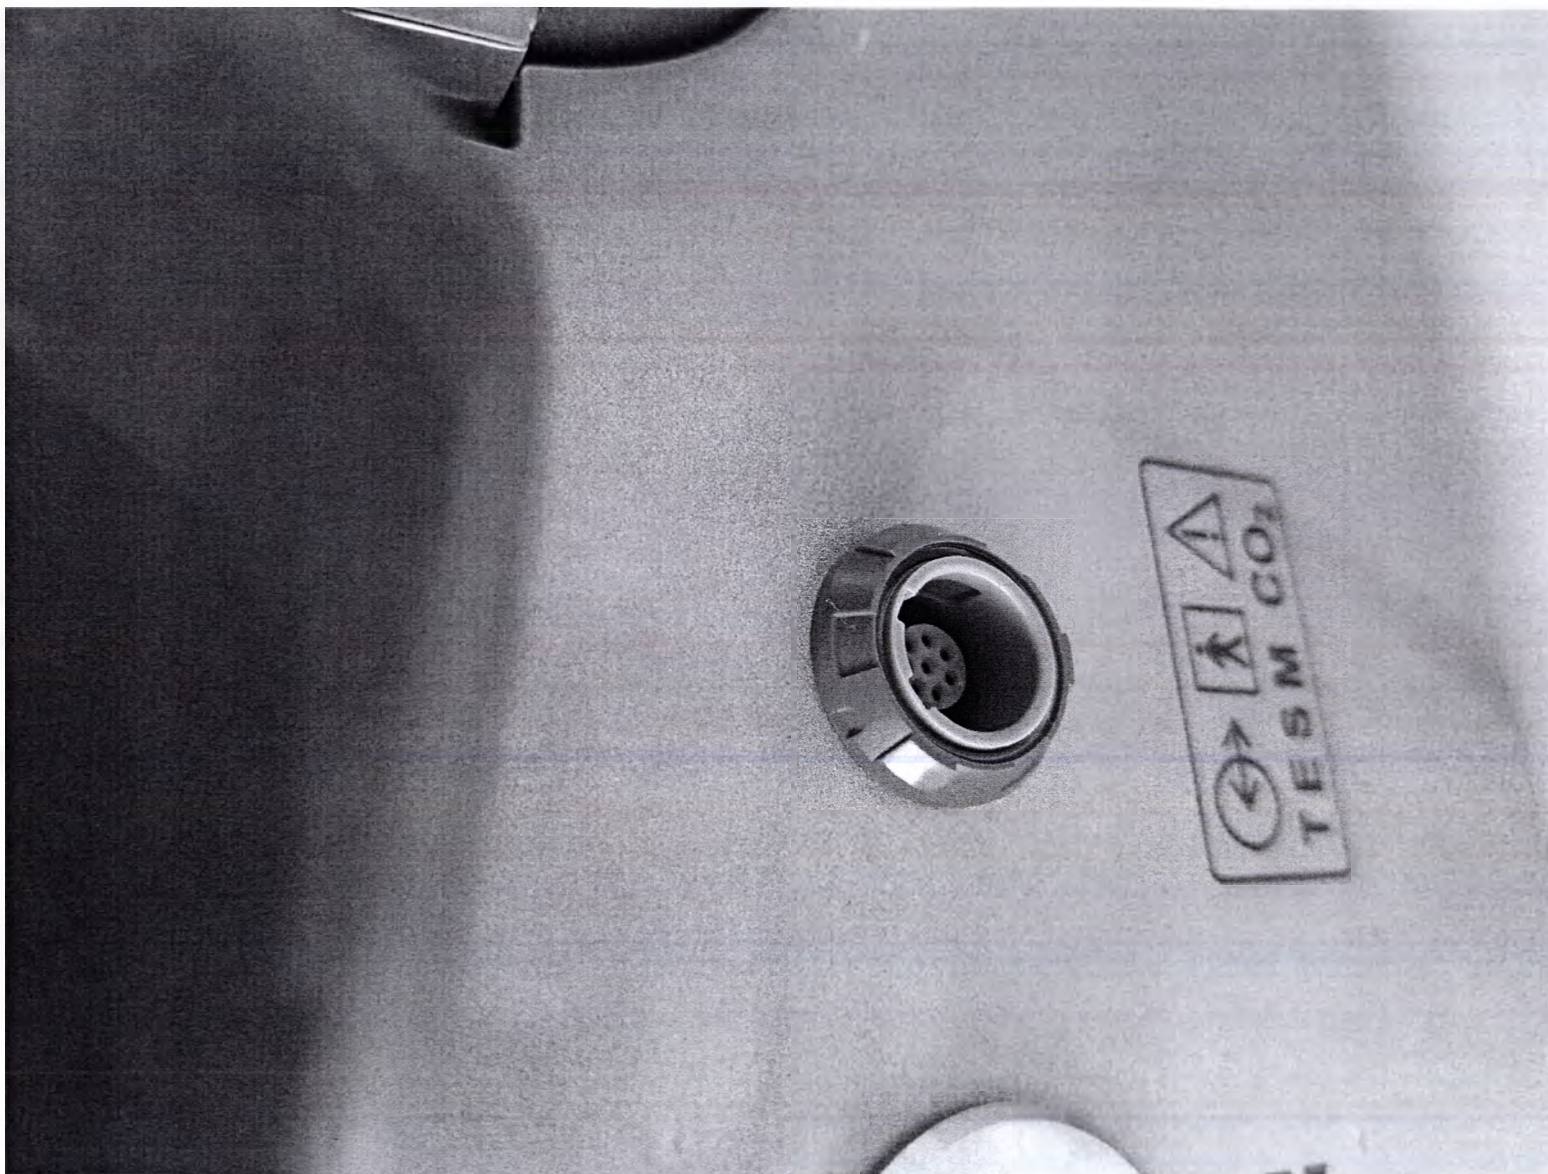

Модуль мониторинга CO₂ – в прямом потоке ТРИТОН

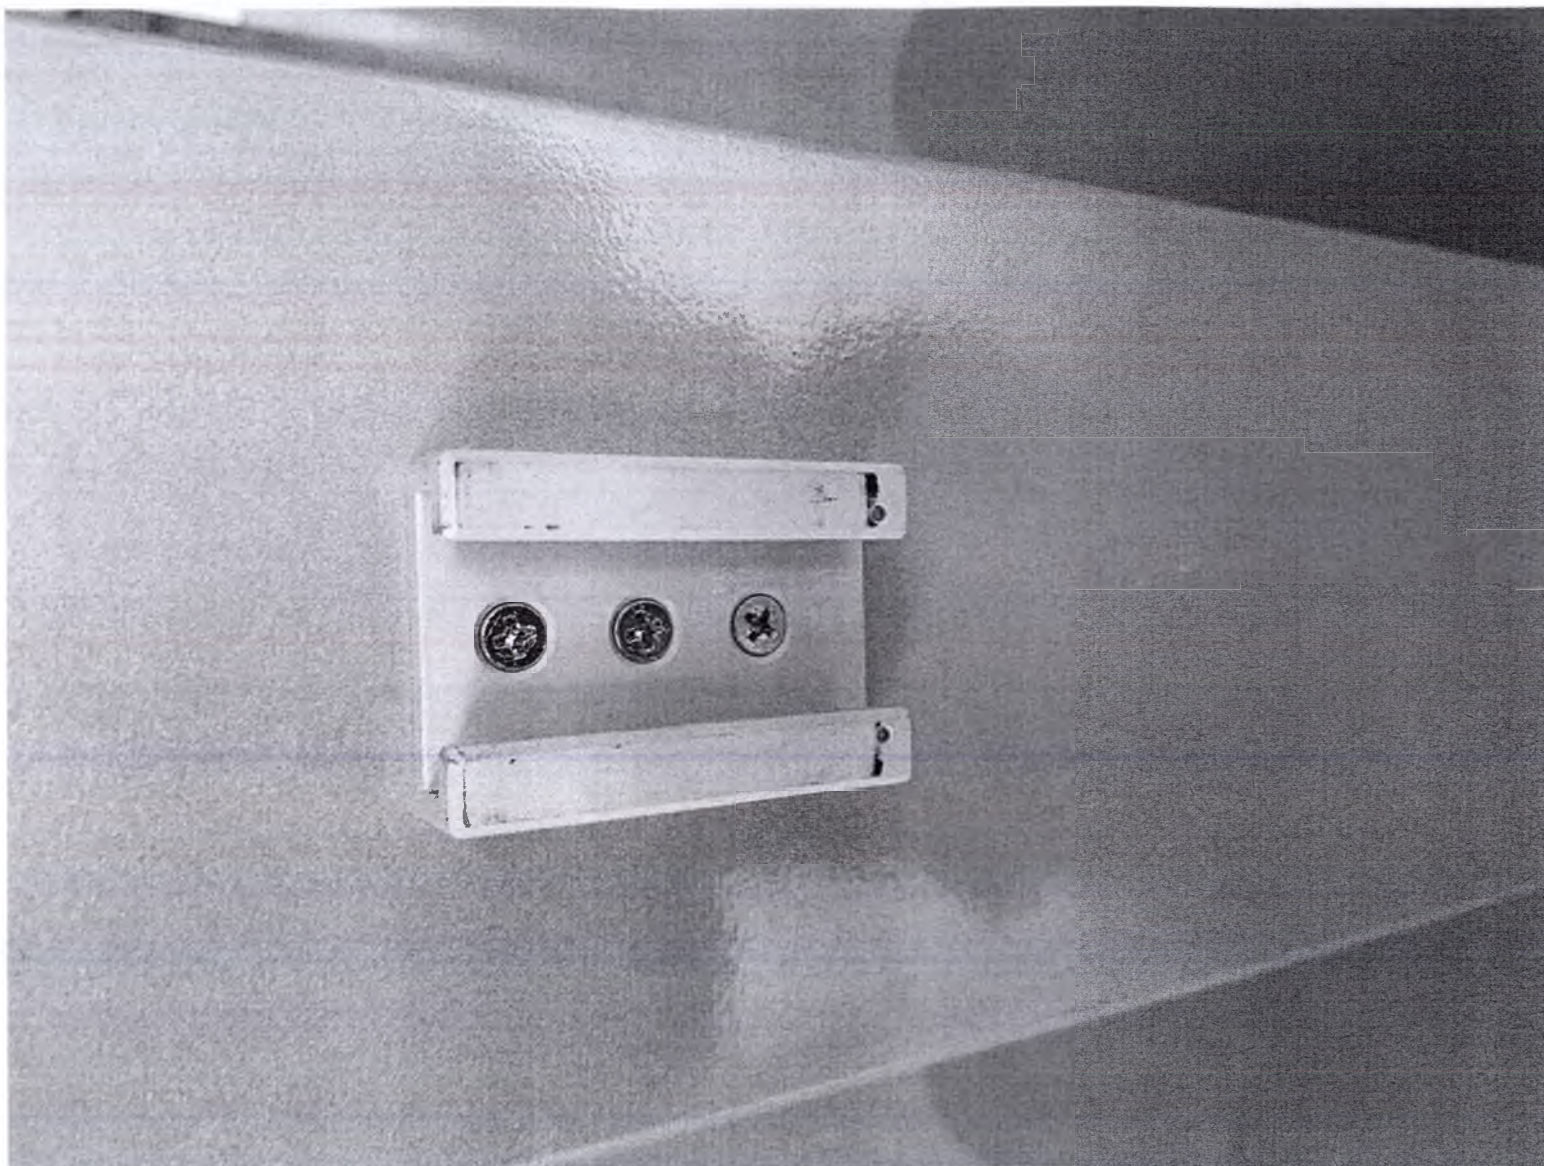

Крепление 2

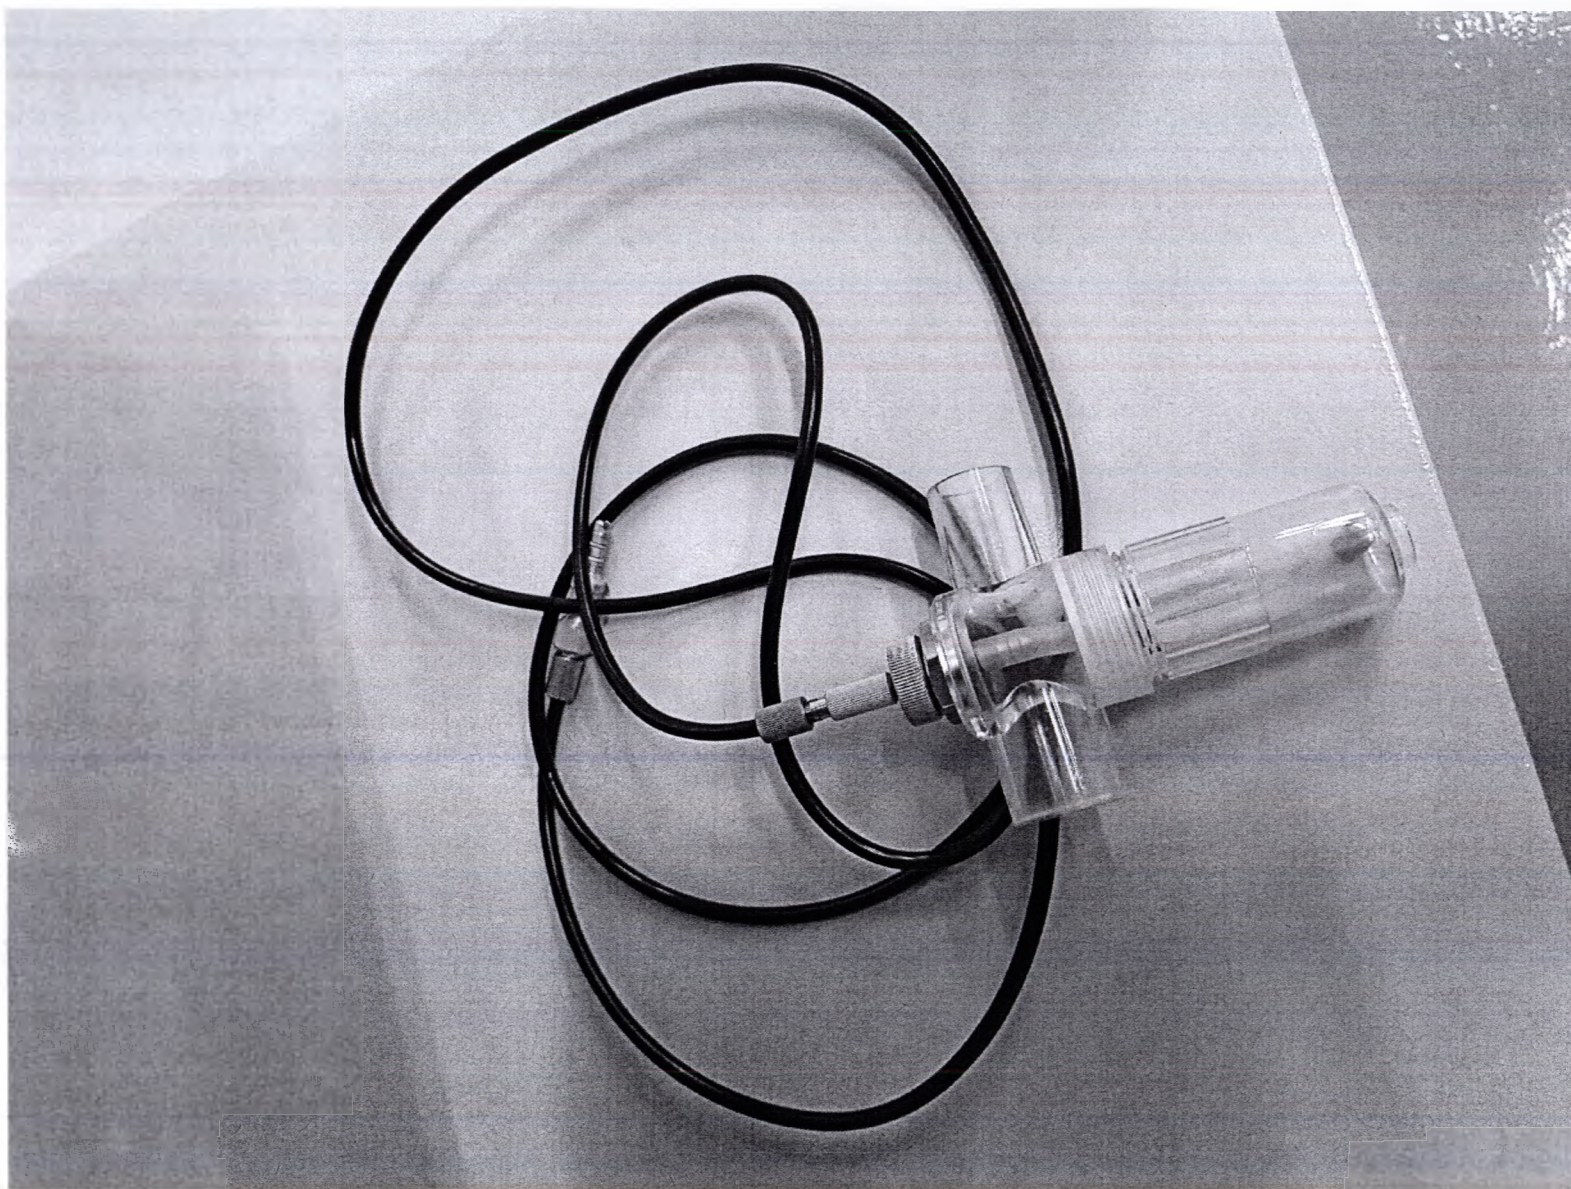


Небулайзер пневматический



Датчик O₂ MOX 3




Air адаптер для взрослых

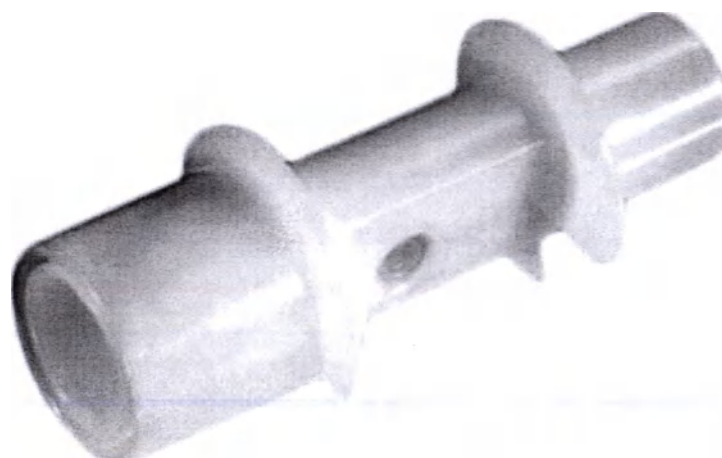


Air адаптер для детей




Airway адаптер

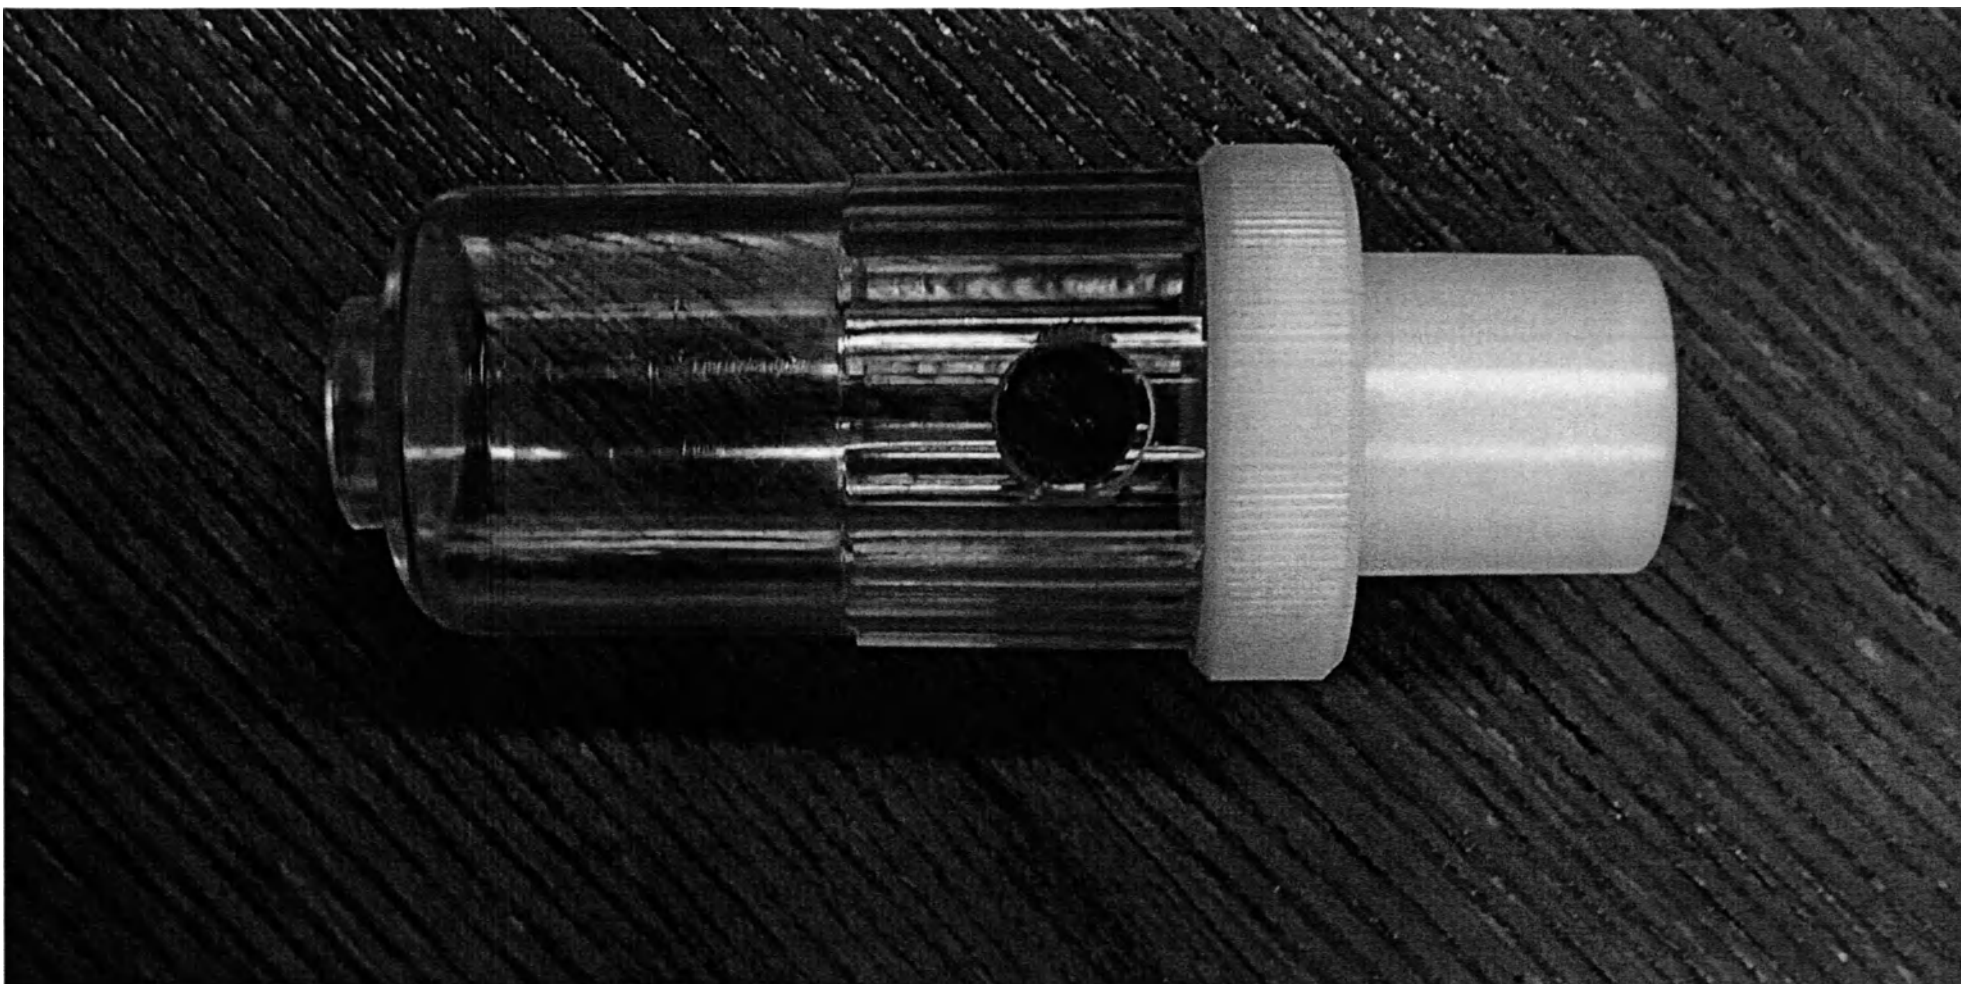


Сосуд для отхода

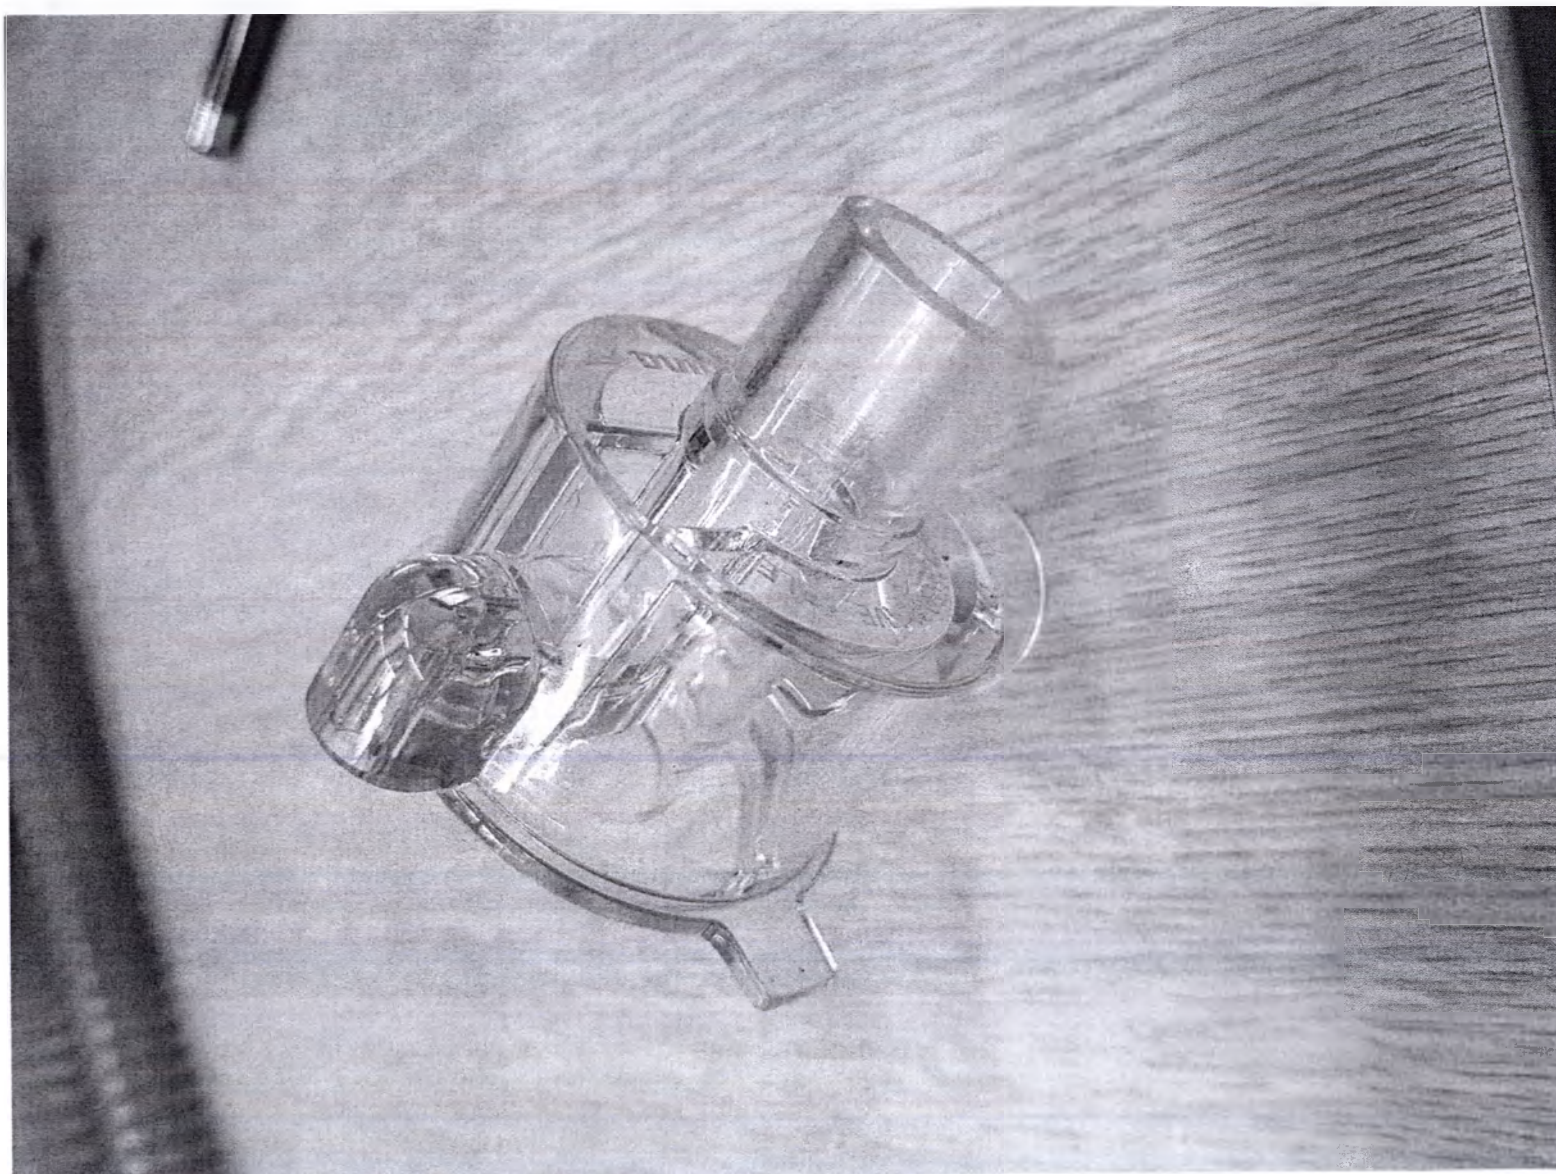


Экспираторный клапан

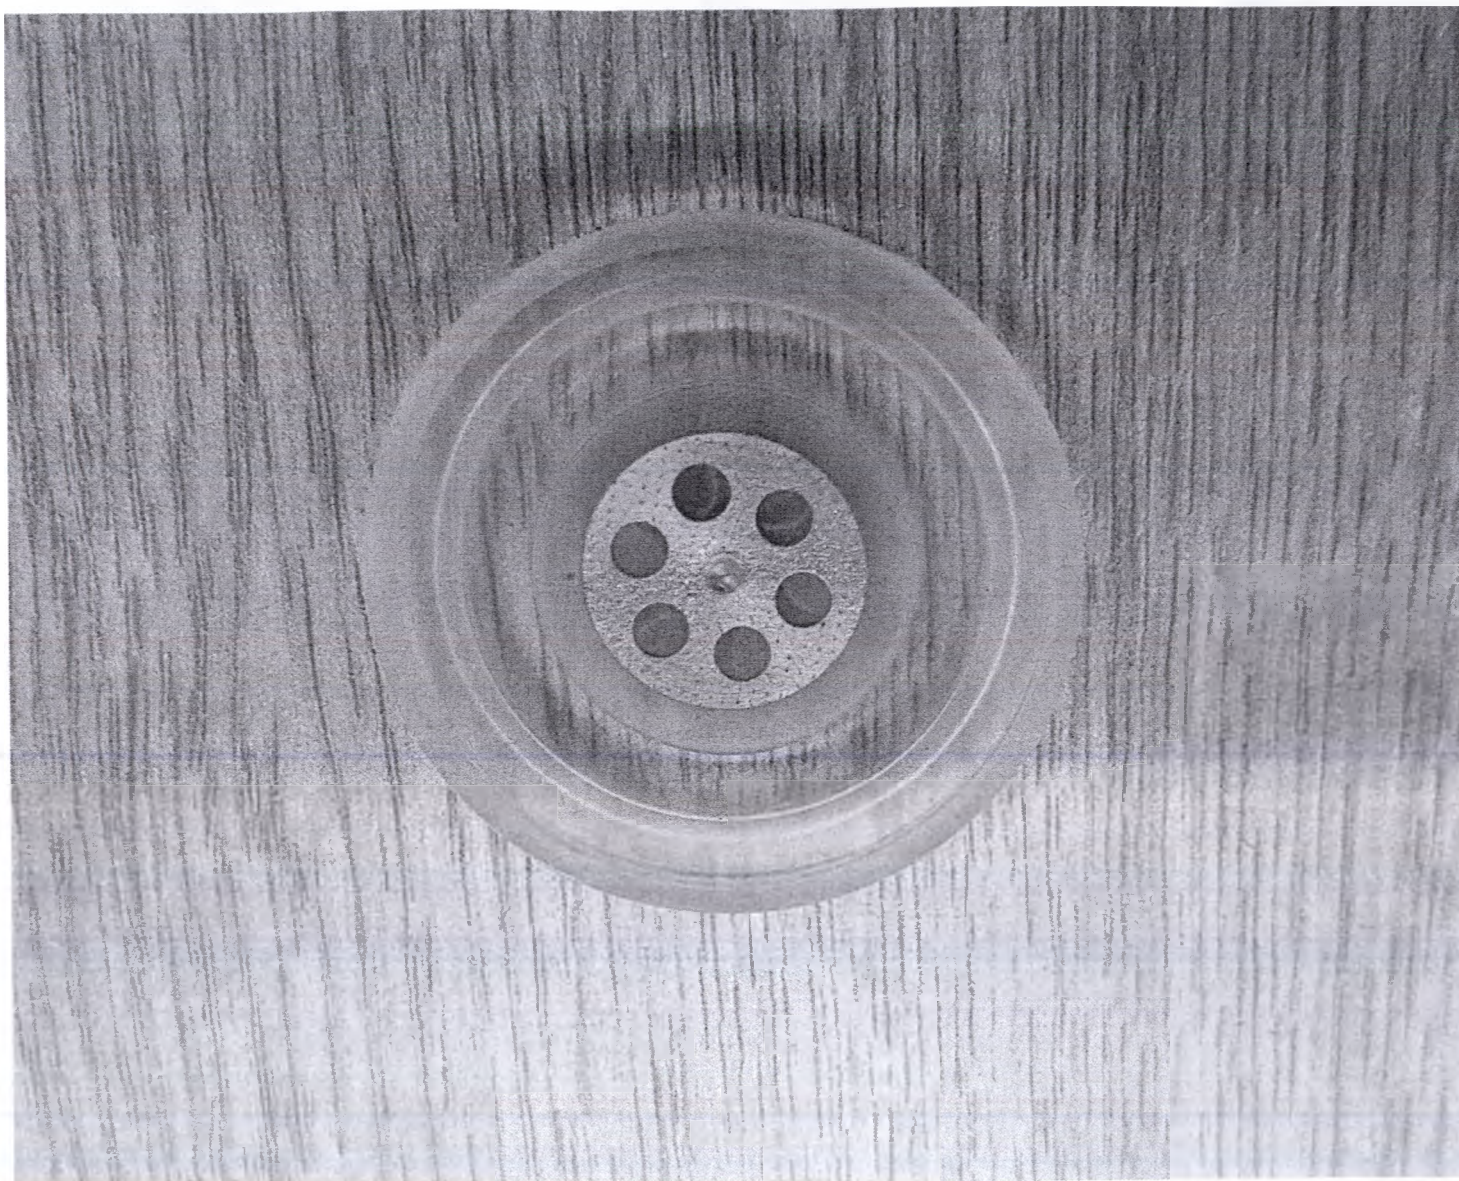


Экспирационная мембрана

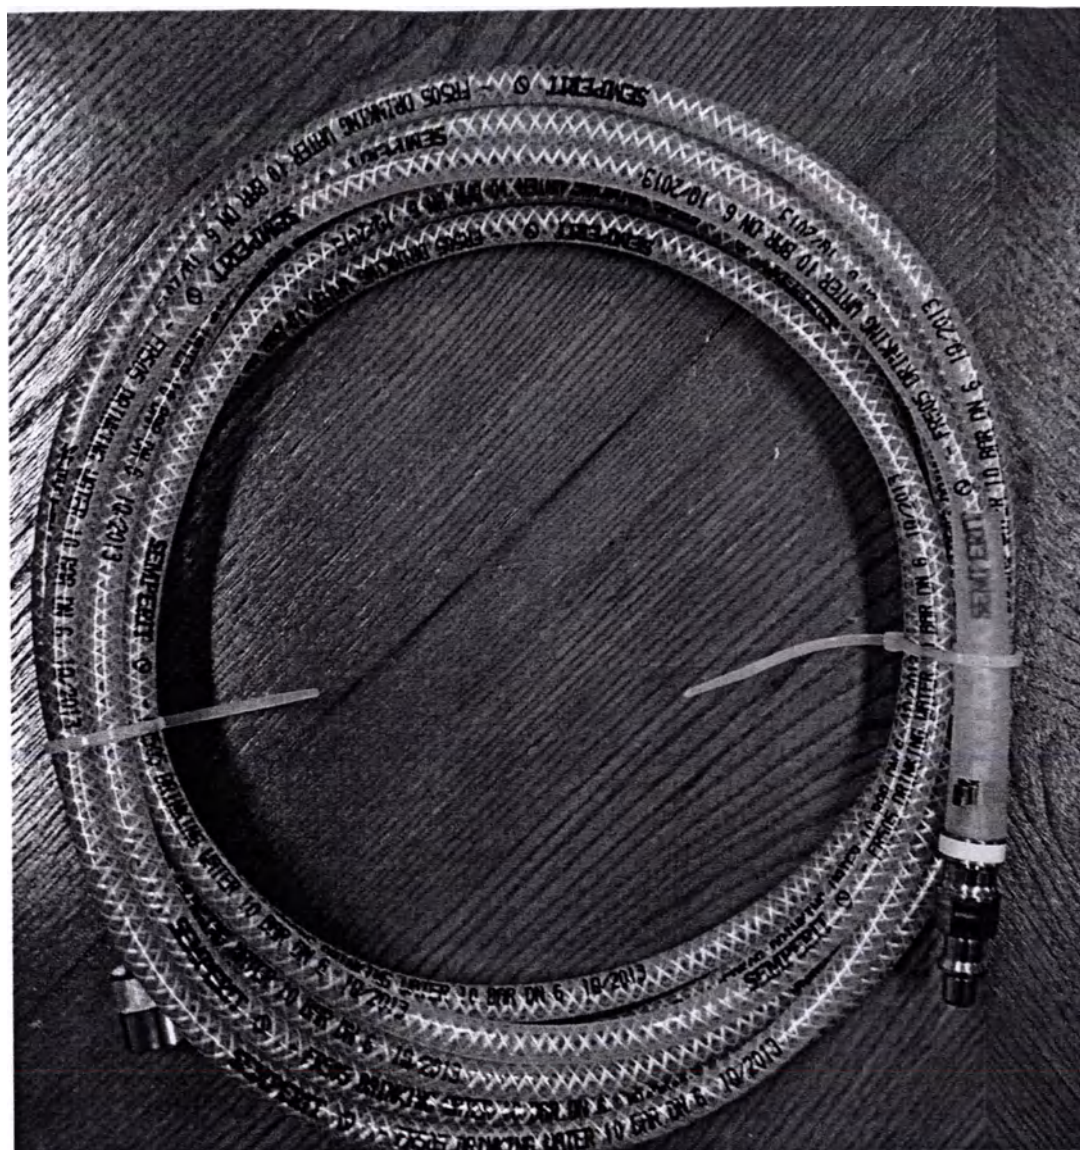


Подводящий шланг DIN O₂

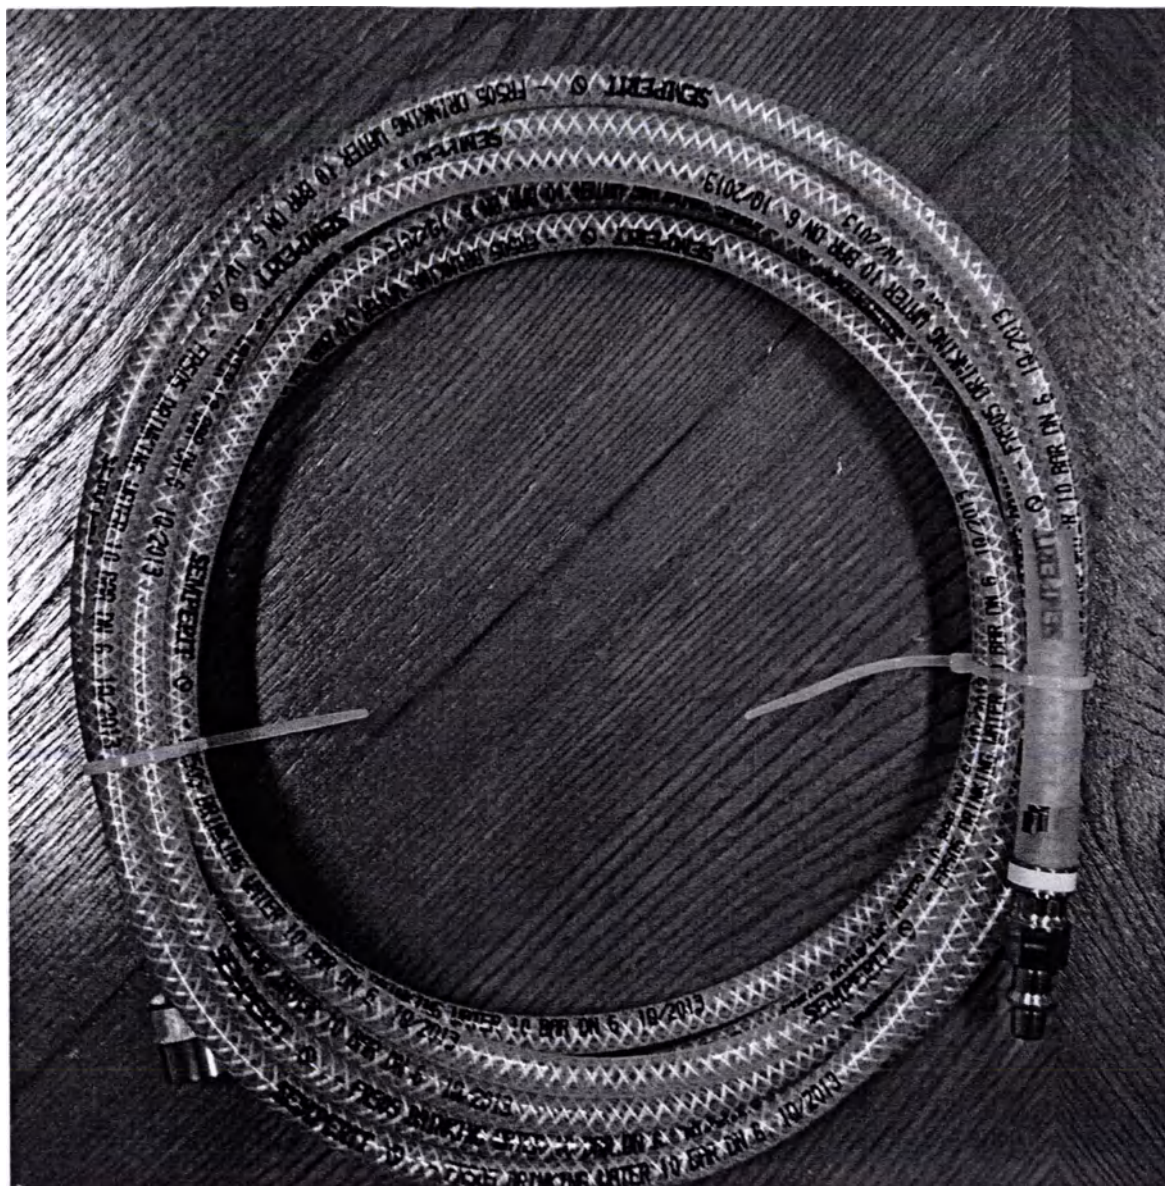


Подводящий шланг DIN AIR

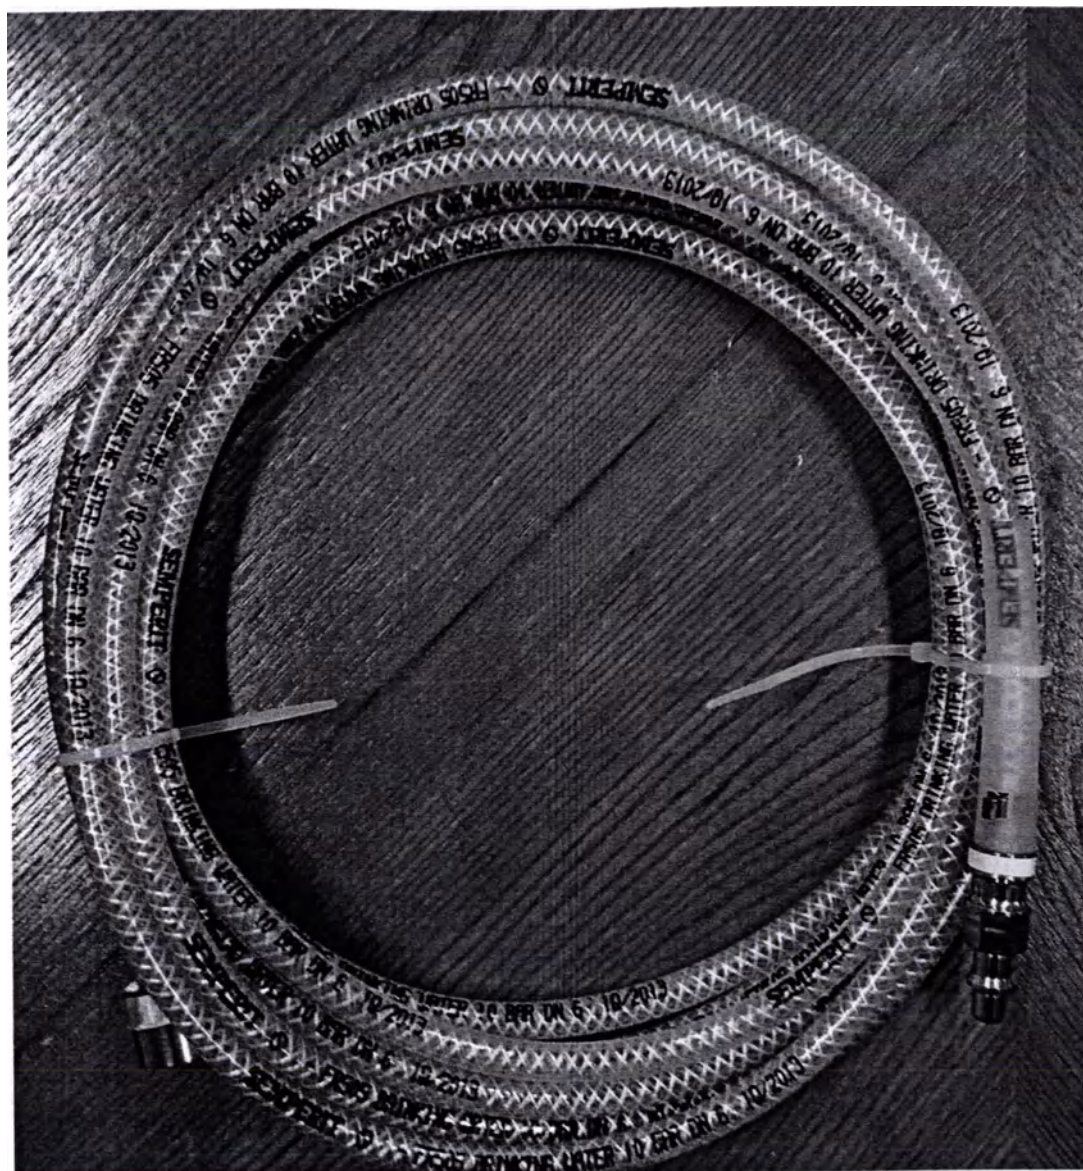


Подводящий шланг MEDI-DIN O₂

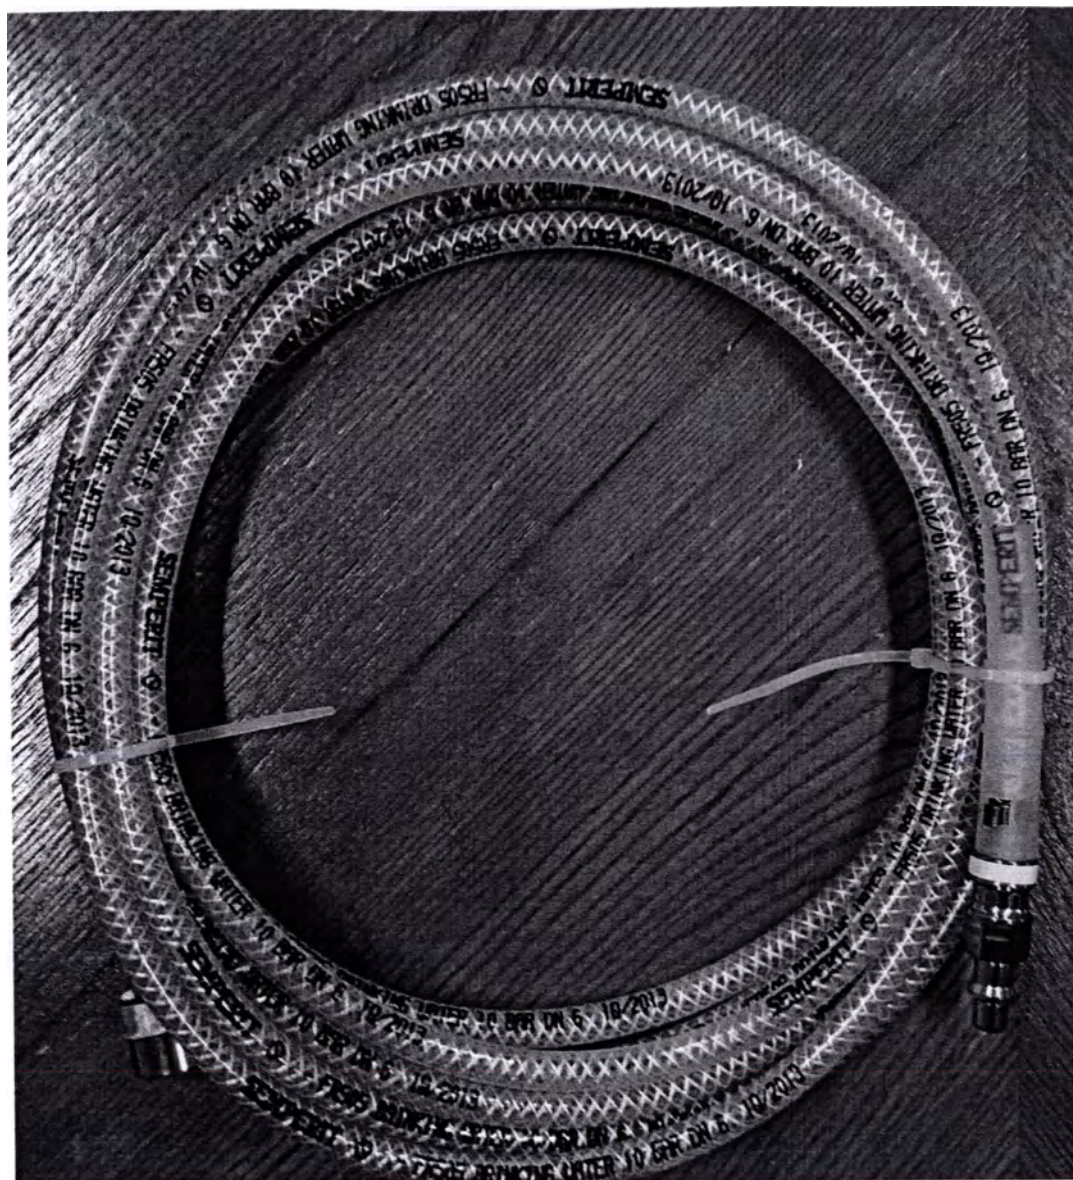

Подводящий шланг MEDI-DIN AIR

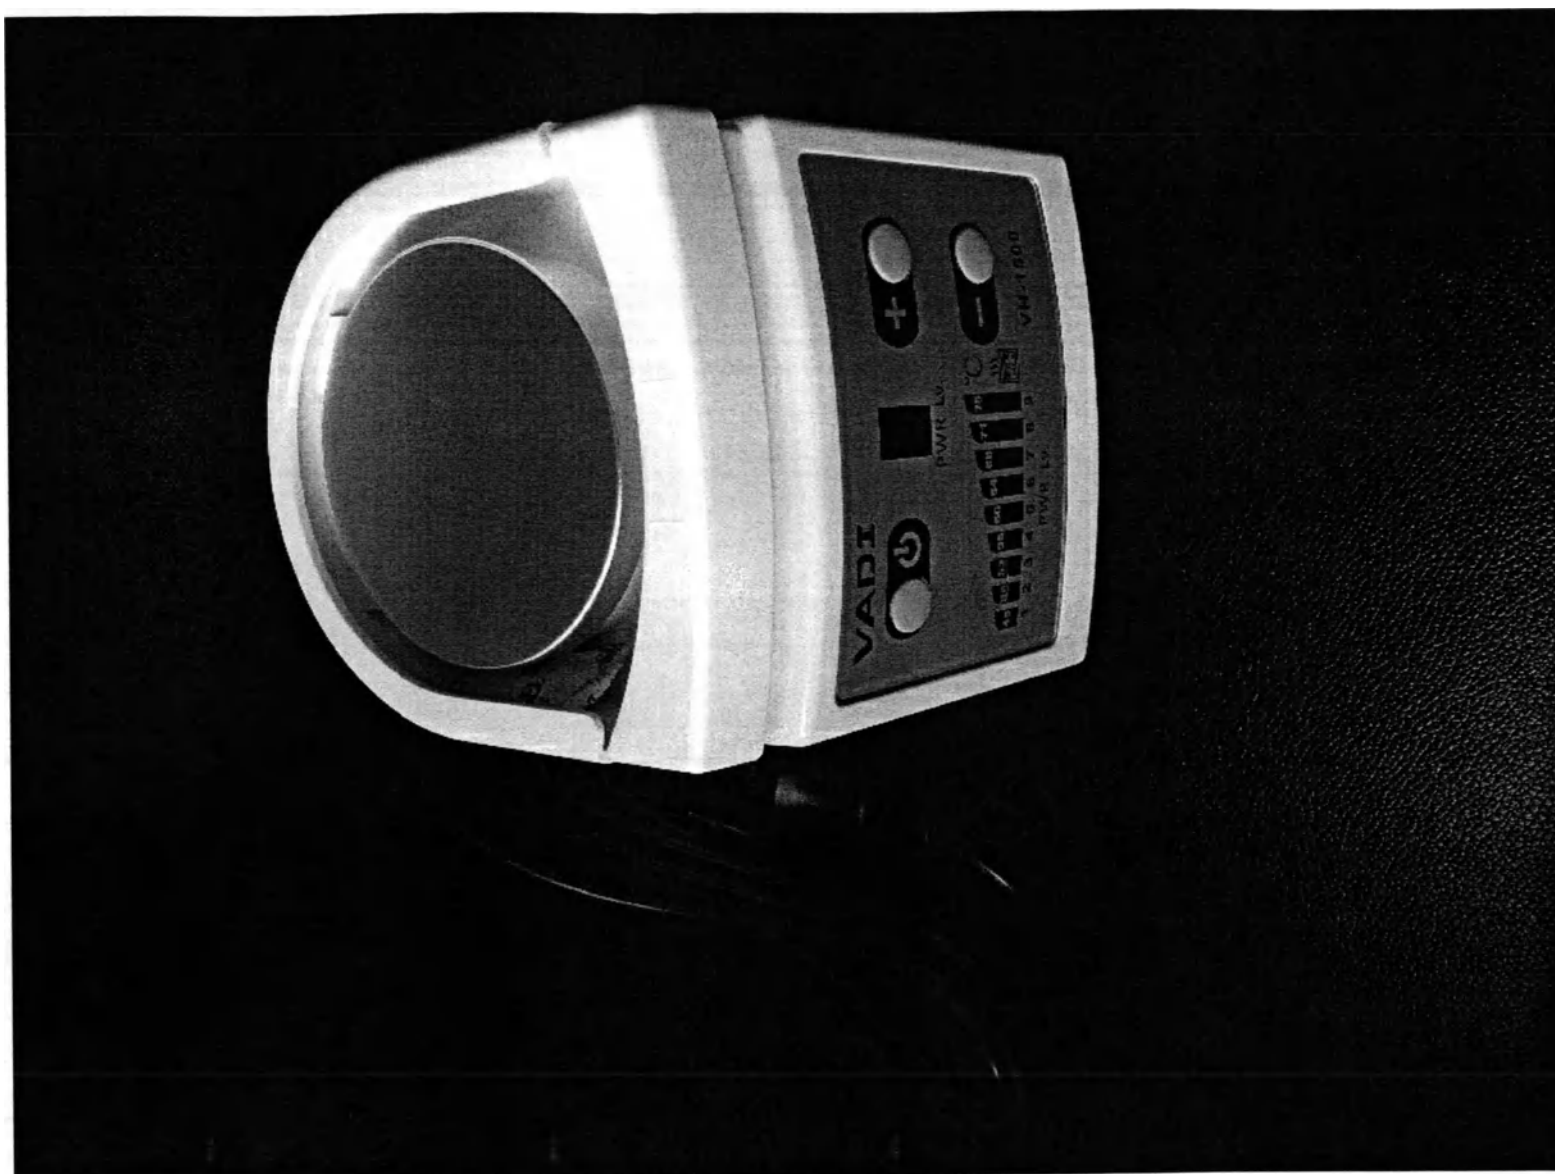


Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-1500

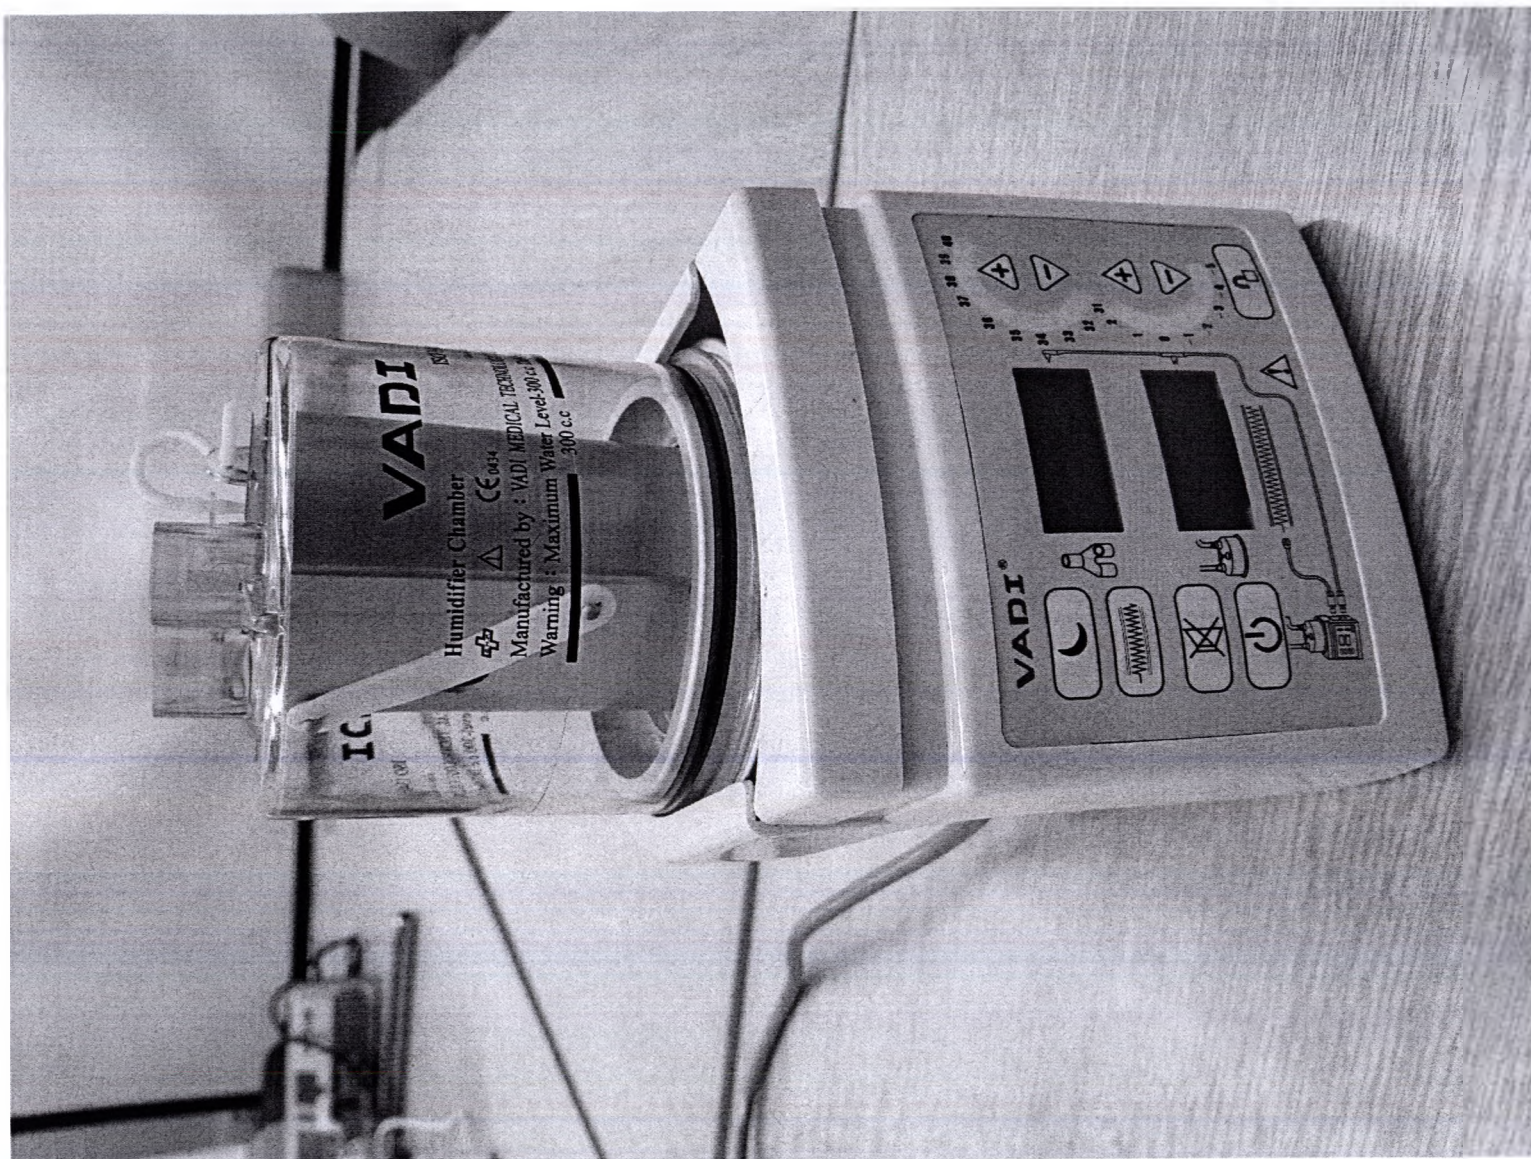


Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-3000




Увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР» – "УОМЗ" по ТУ 9444-121-07539541-2011 с принадлежностями рег. удостоверение № РЗН 2015/2620 от 29.04.2015г. АО "ПО "УОМЗ" Россия

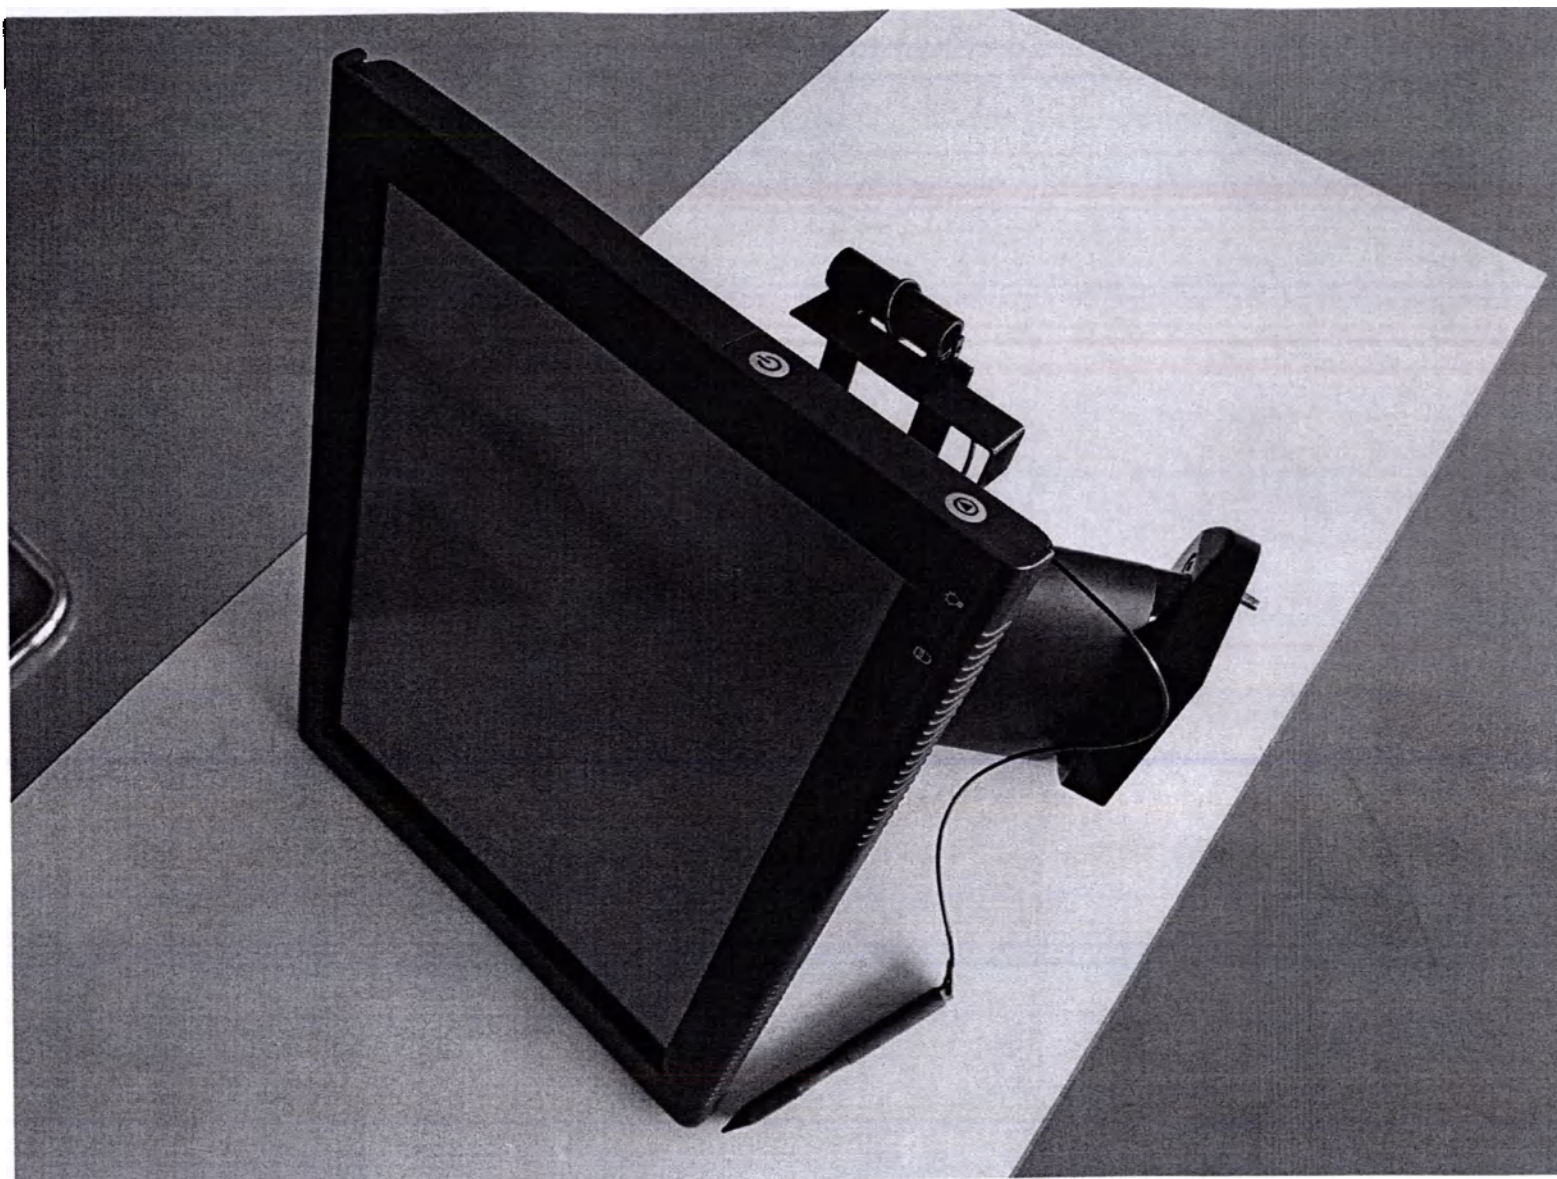

Дополнительный монитор дыхательных функции Profilungs

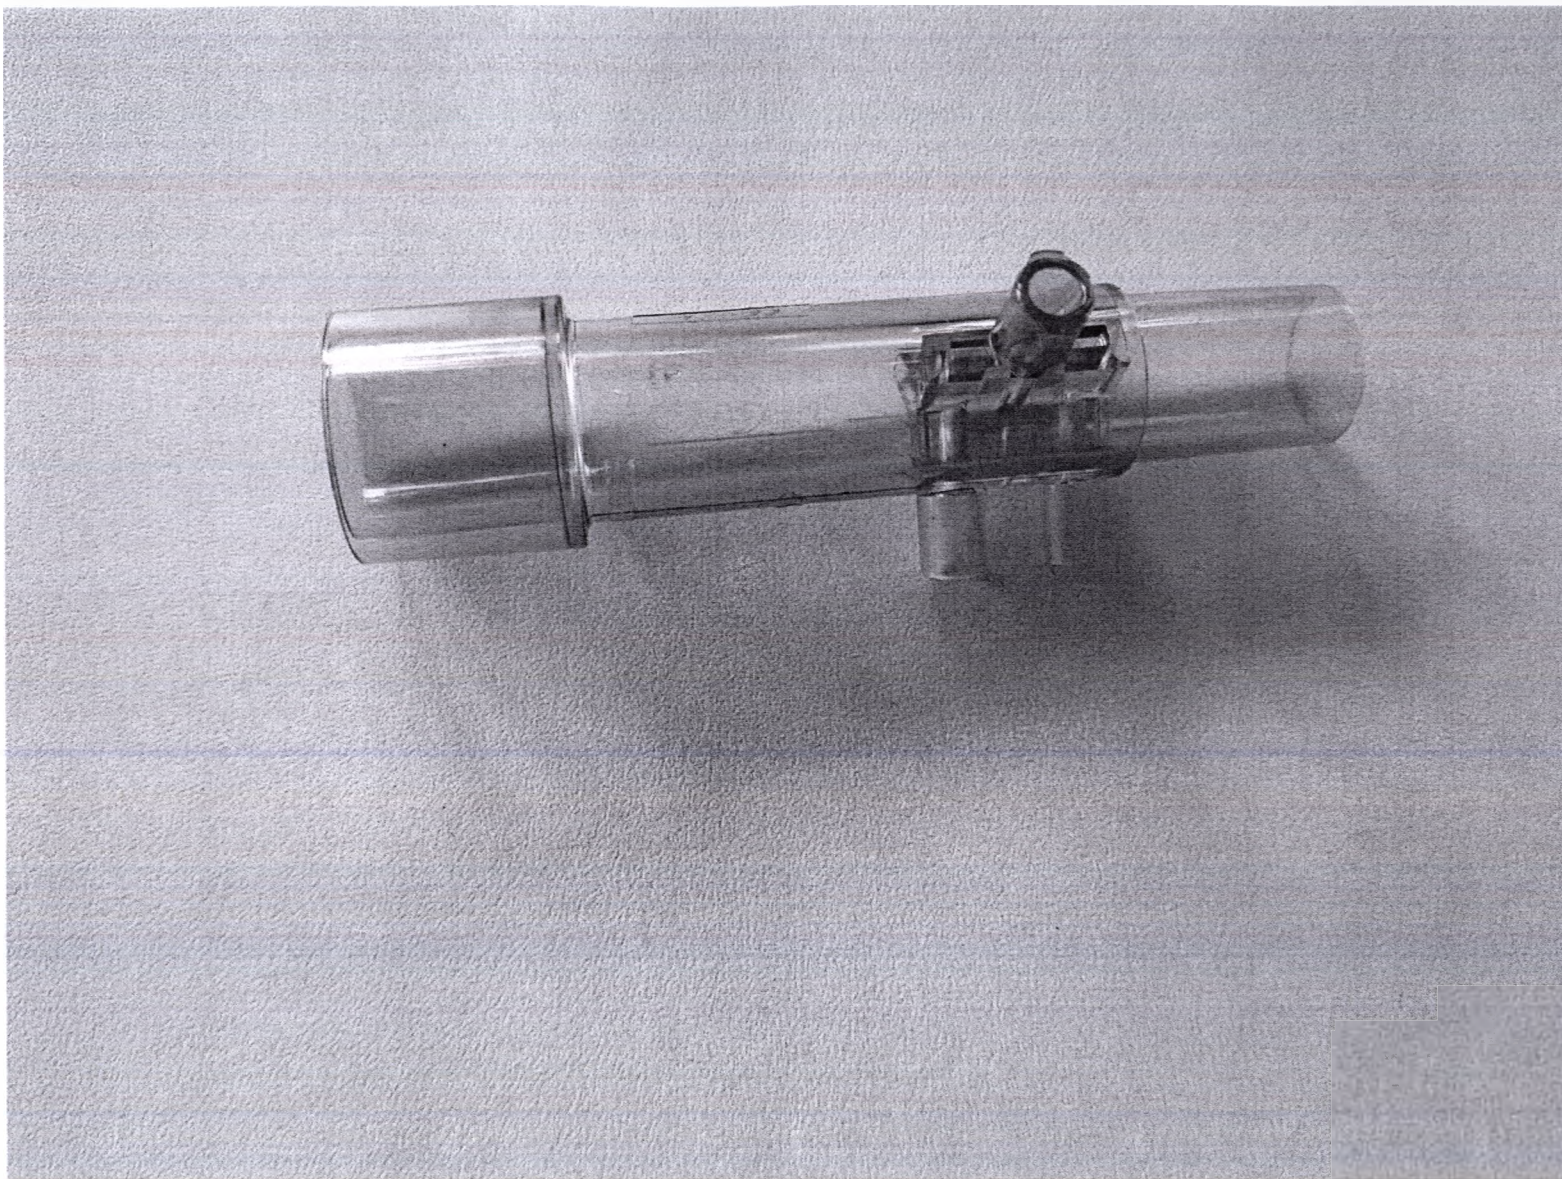


Датчик потока D-LITE

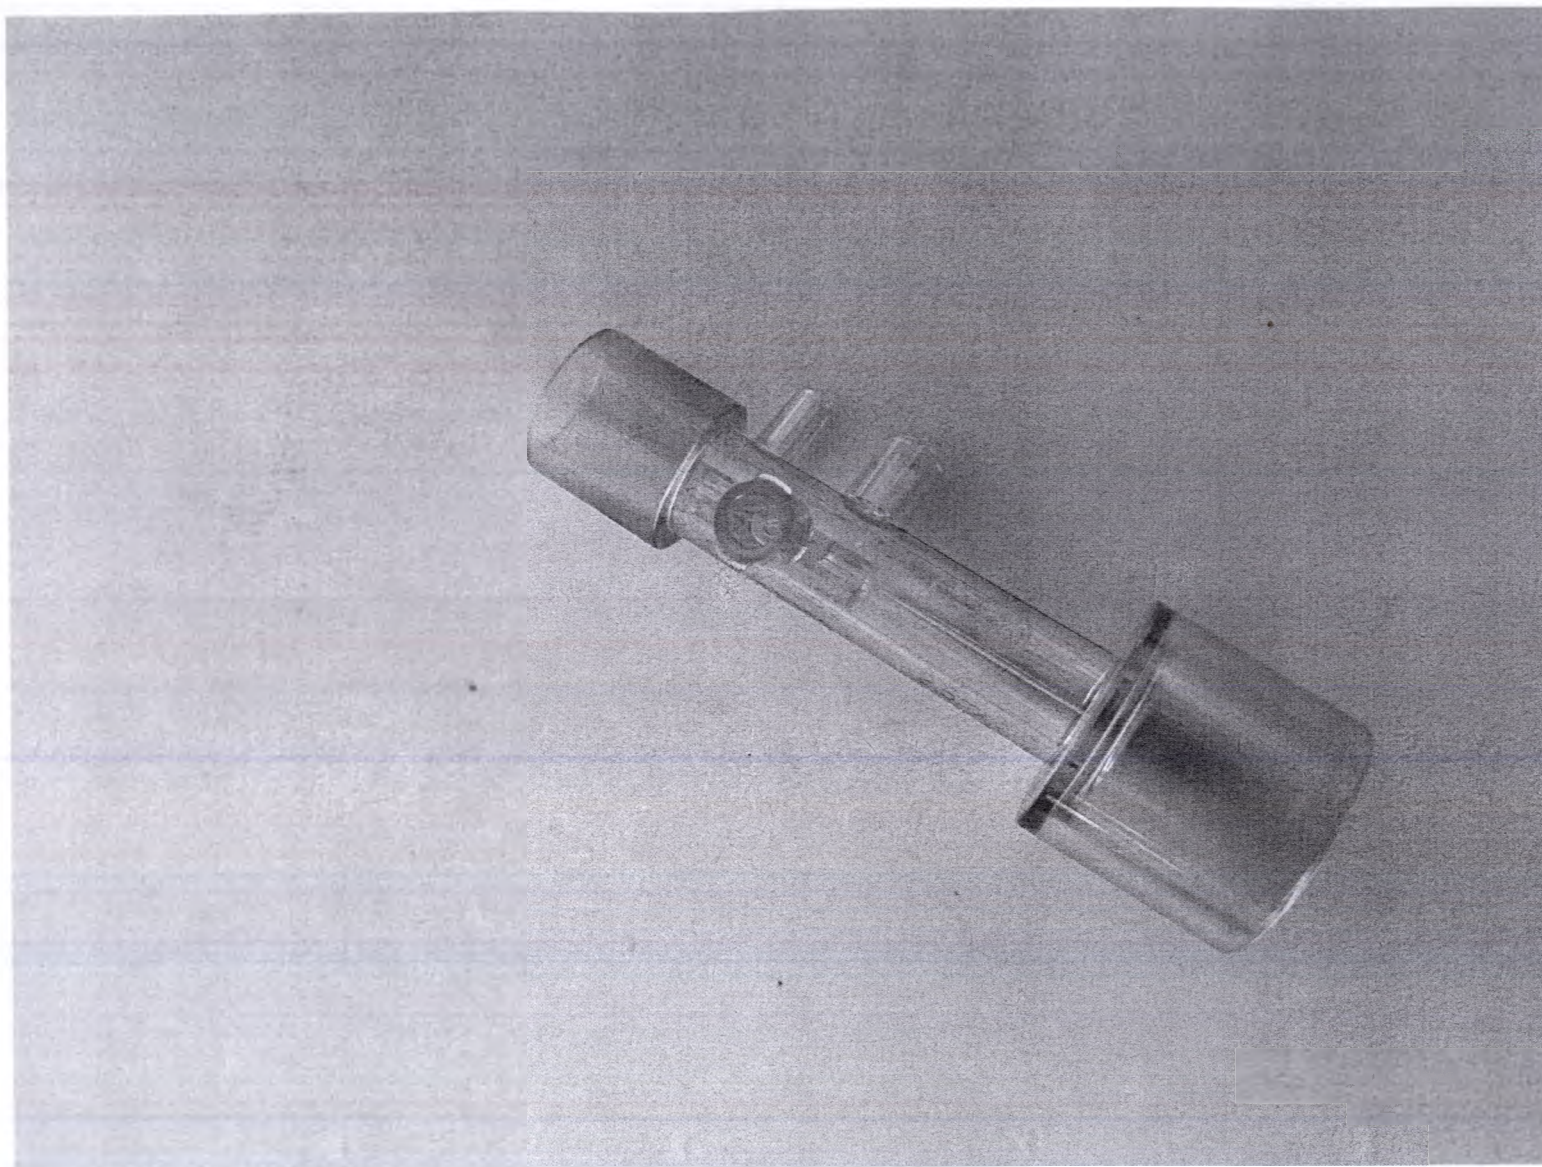


Датчик потока PEDI-LITE




Комплект переходников

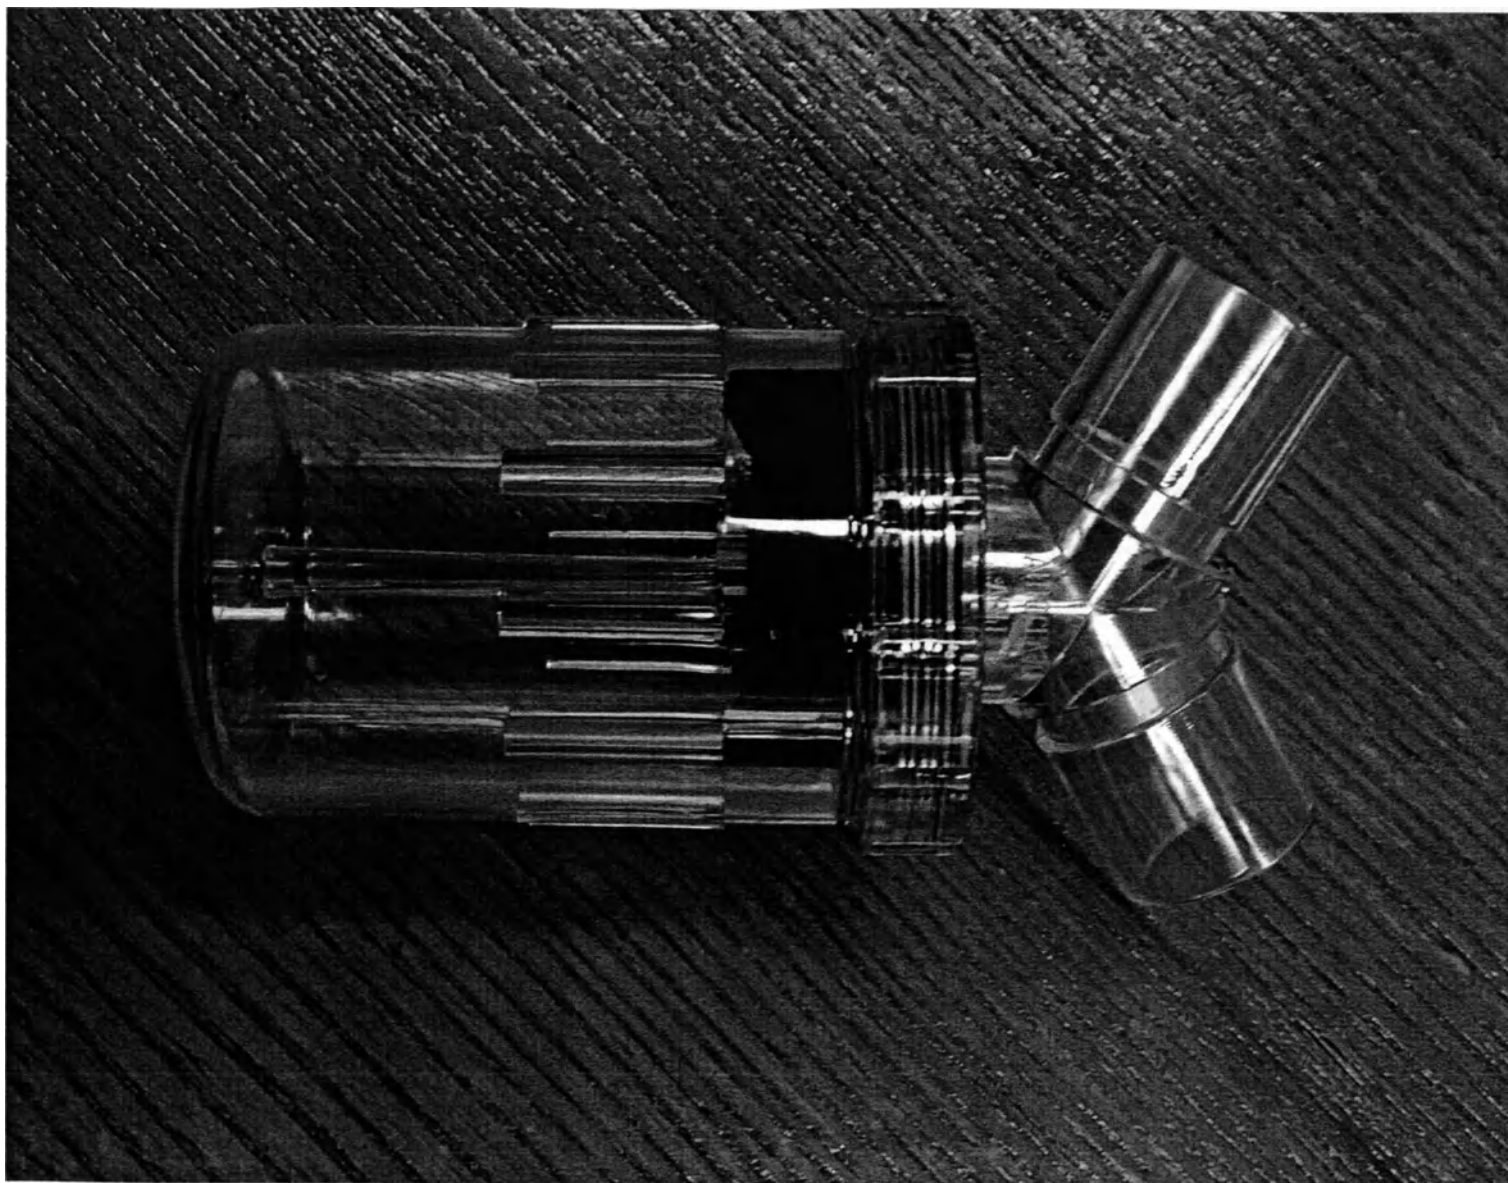


Влагосборник неонатальный

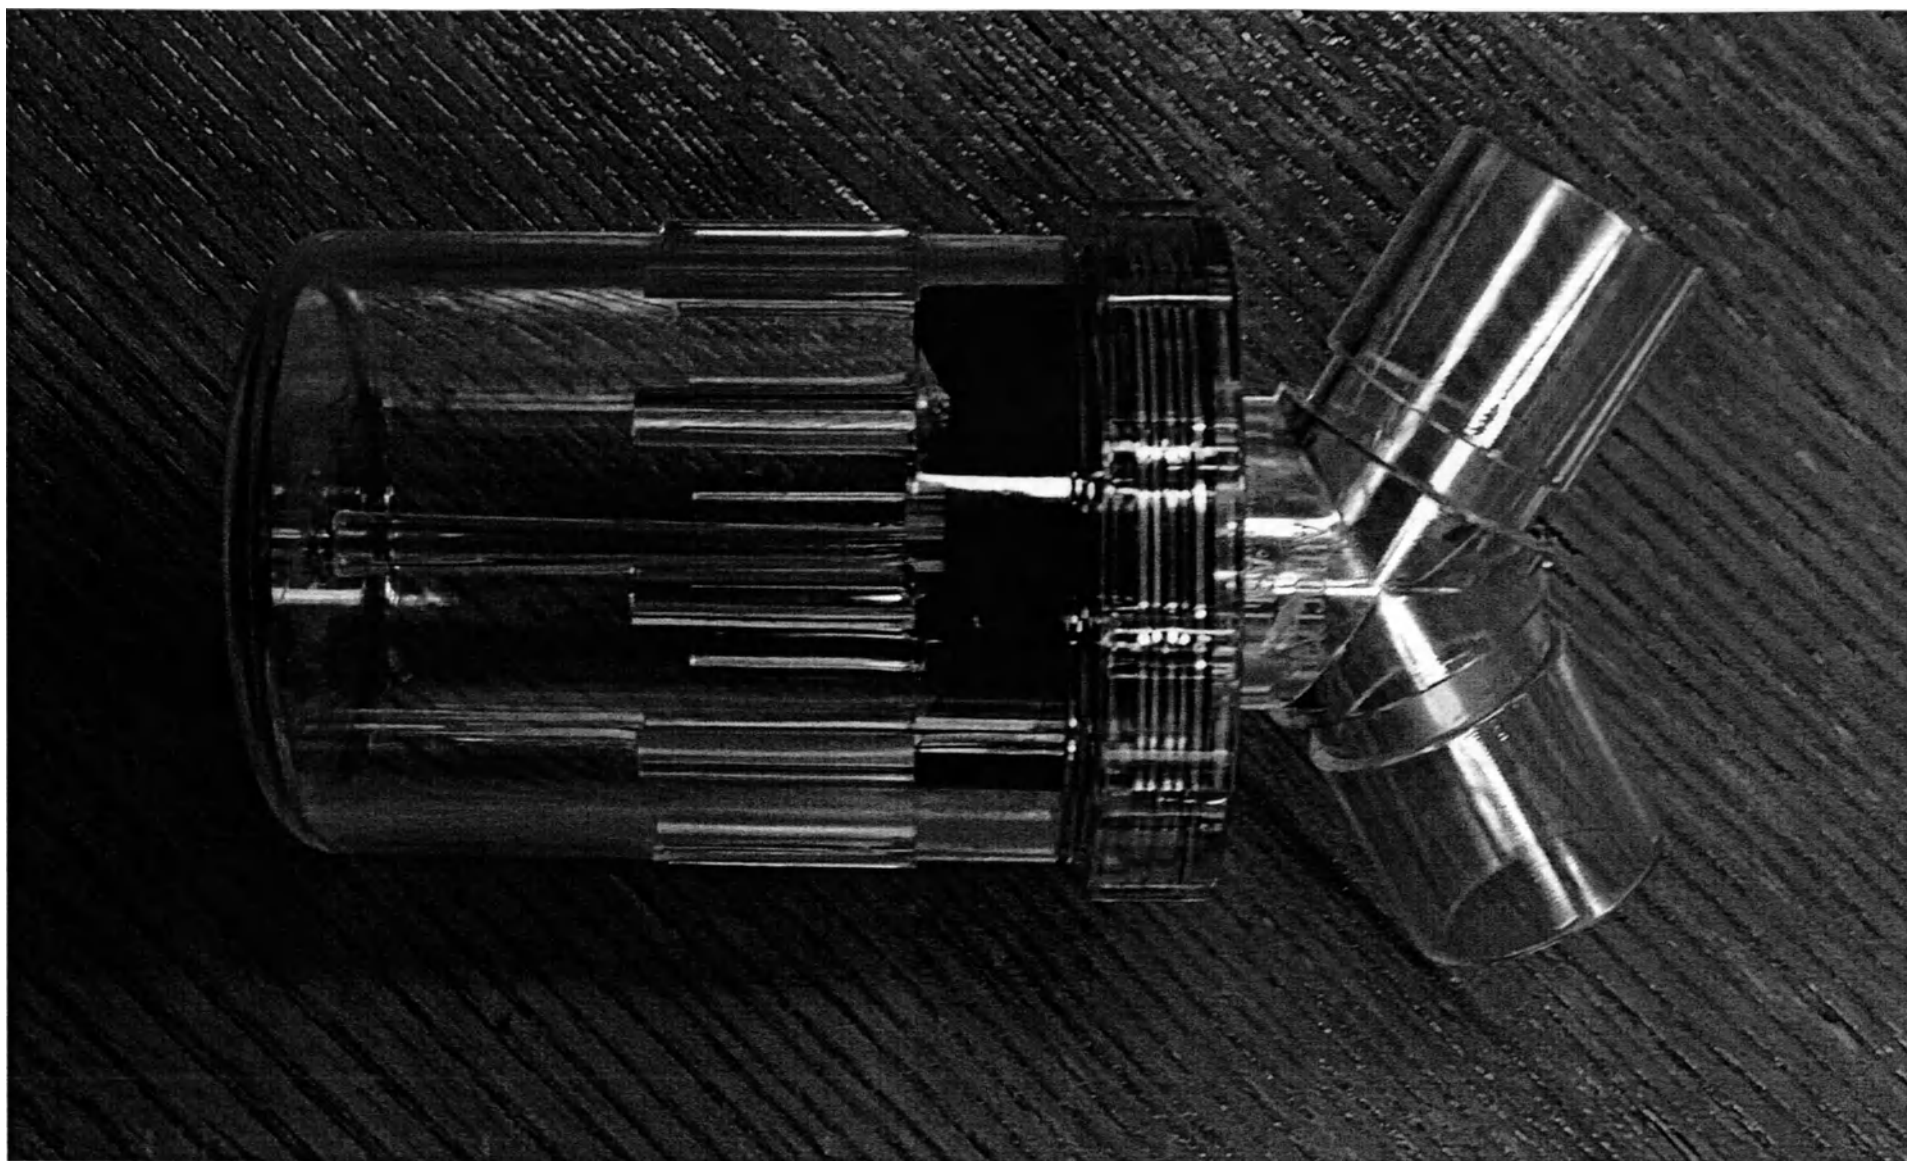

Влагосборник взрослый

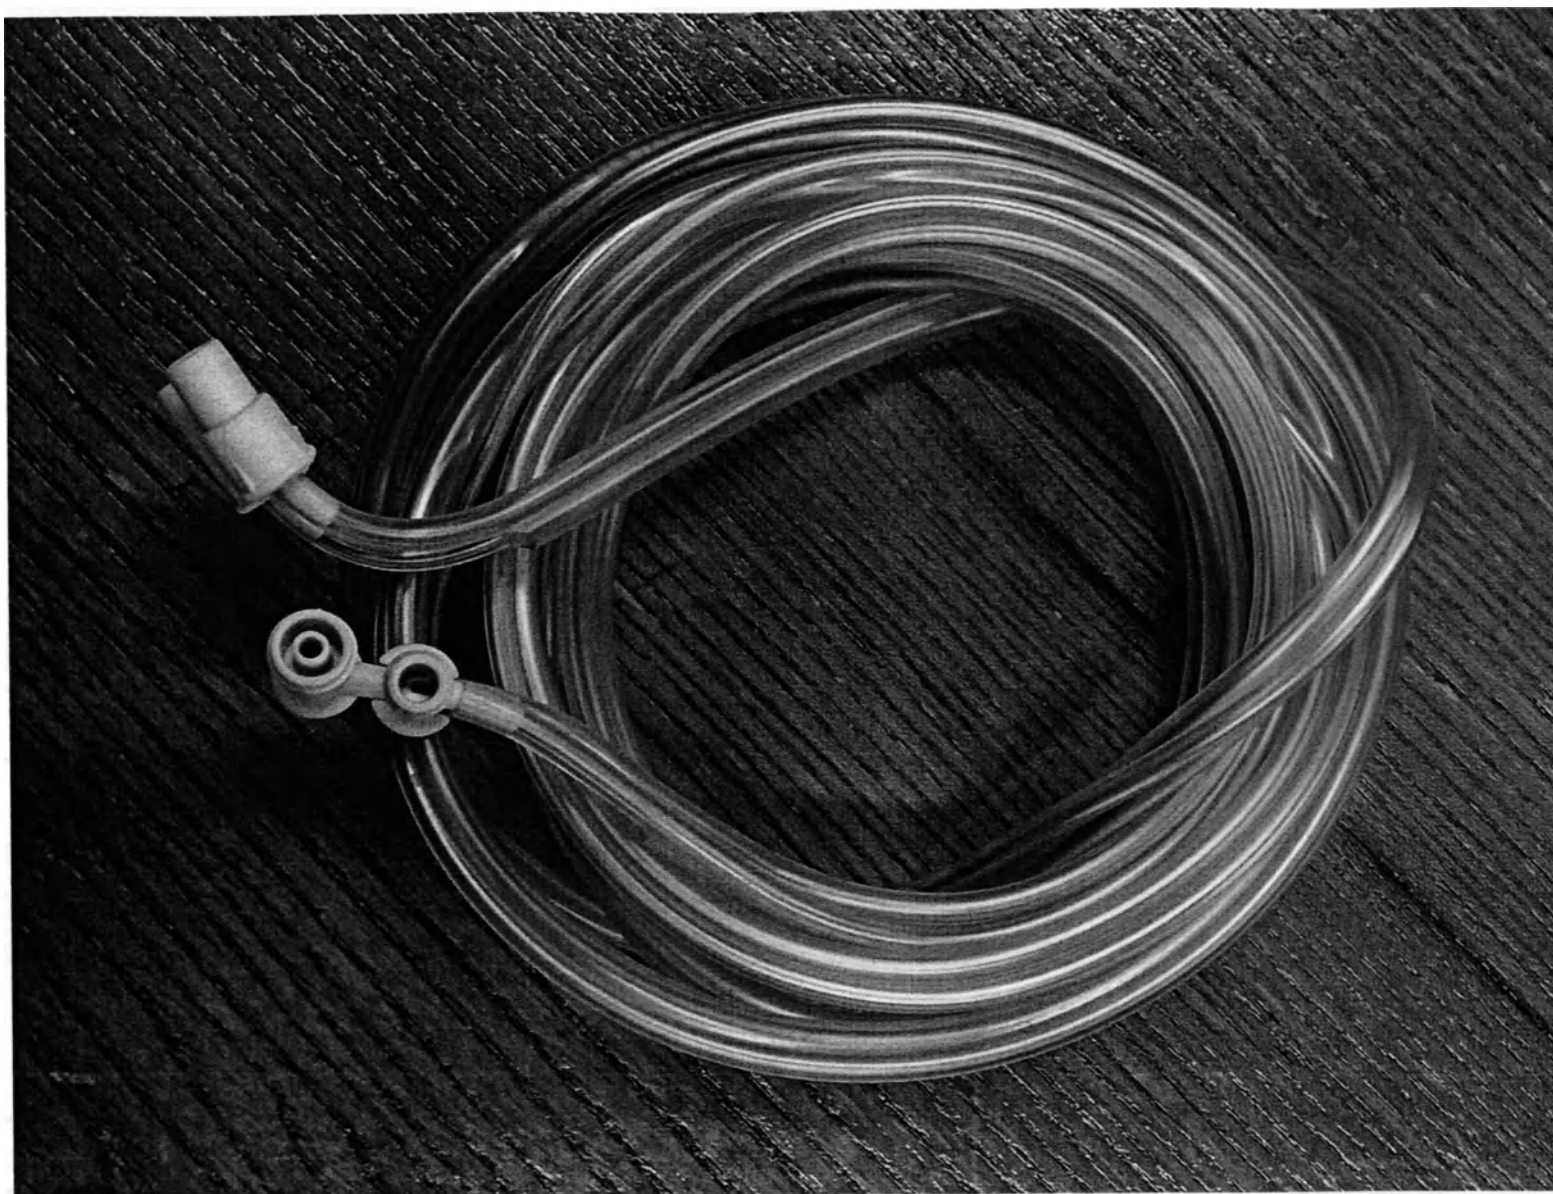


Спирометрический шланг 2м

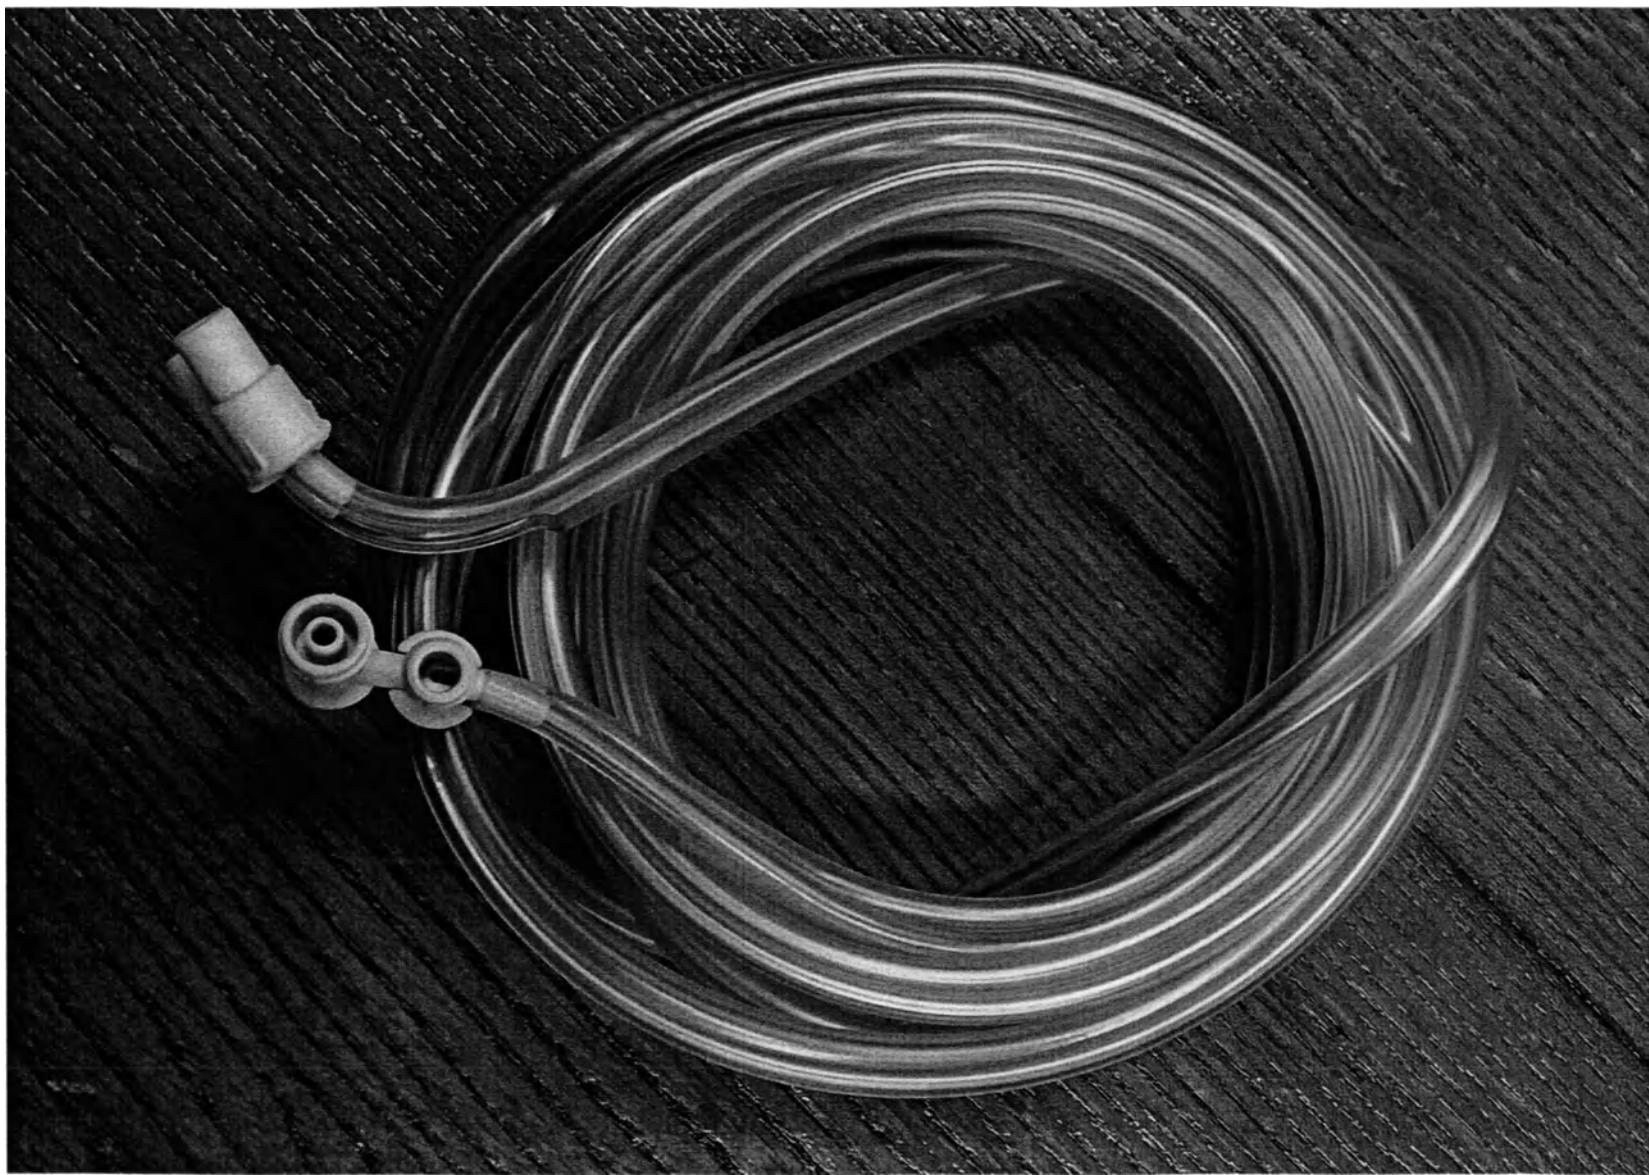


Спирометрический шланг 3м




Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

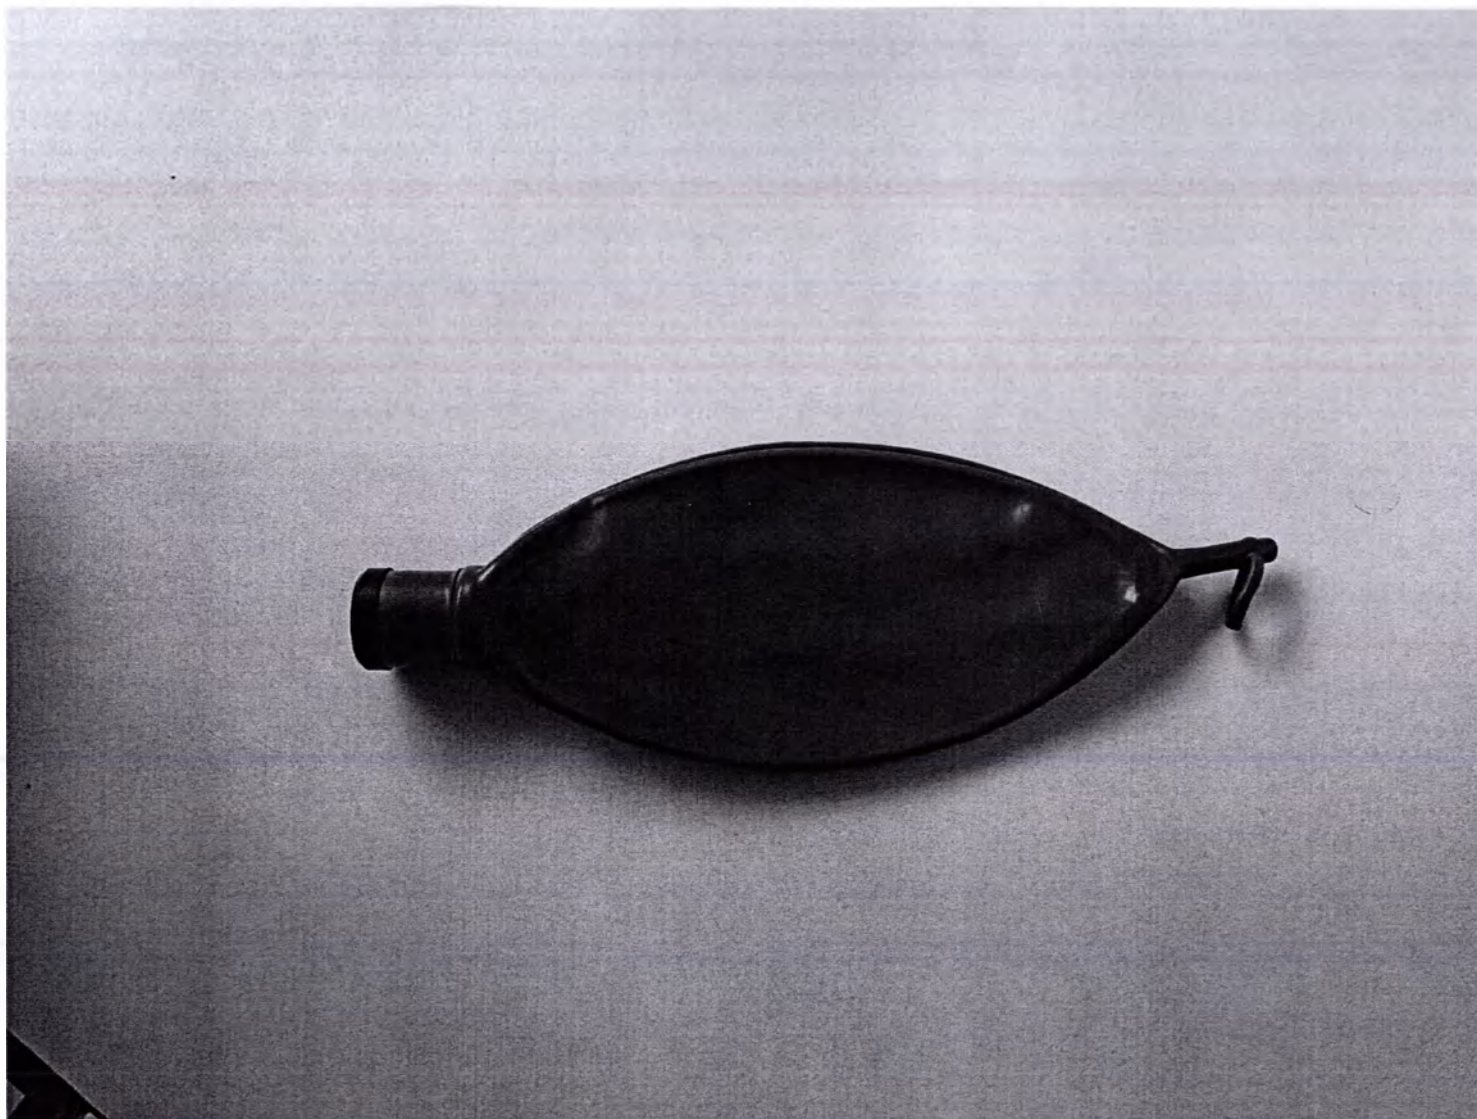


Дыхательные мешки объемом 1,0 л, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

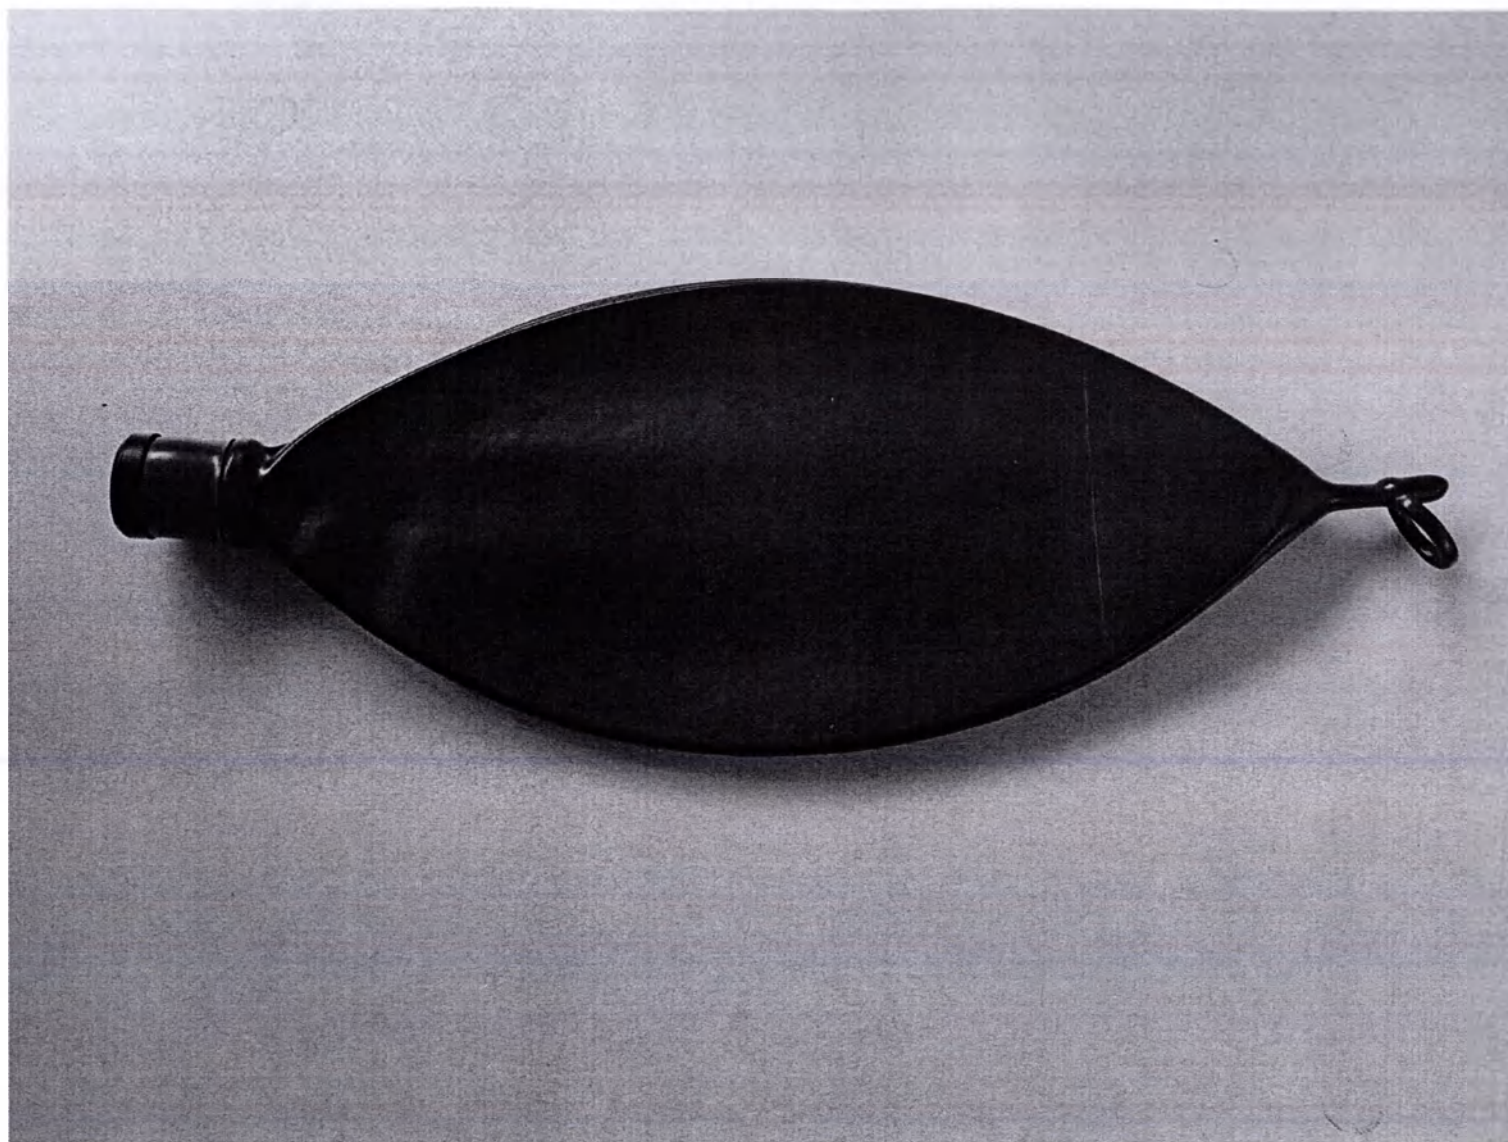


Дыхательные мешки объемом 3,0 л, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

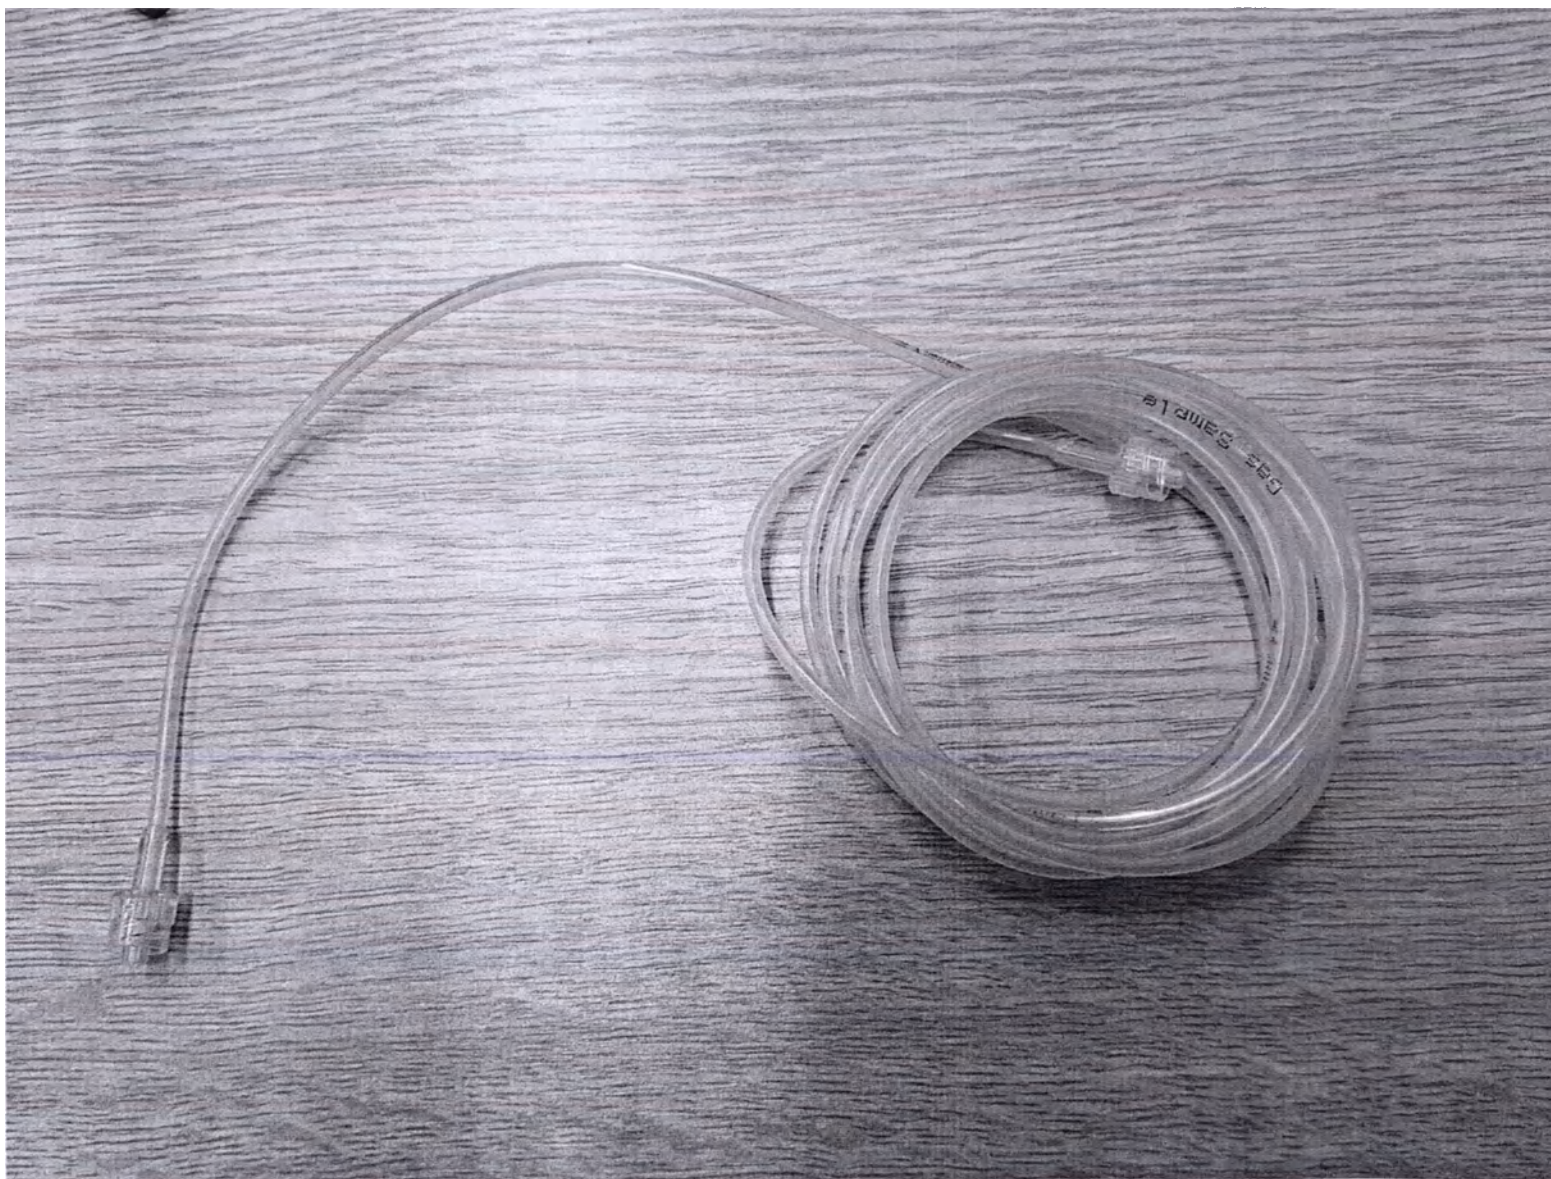

Шланг проб для взрослых 2,5 м

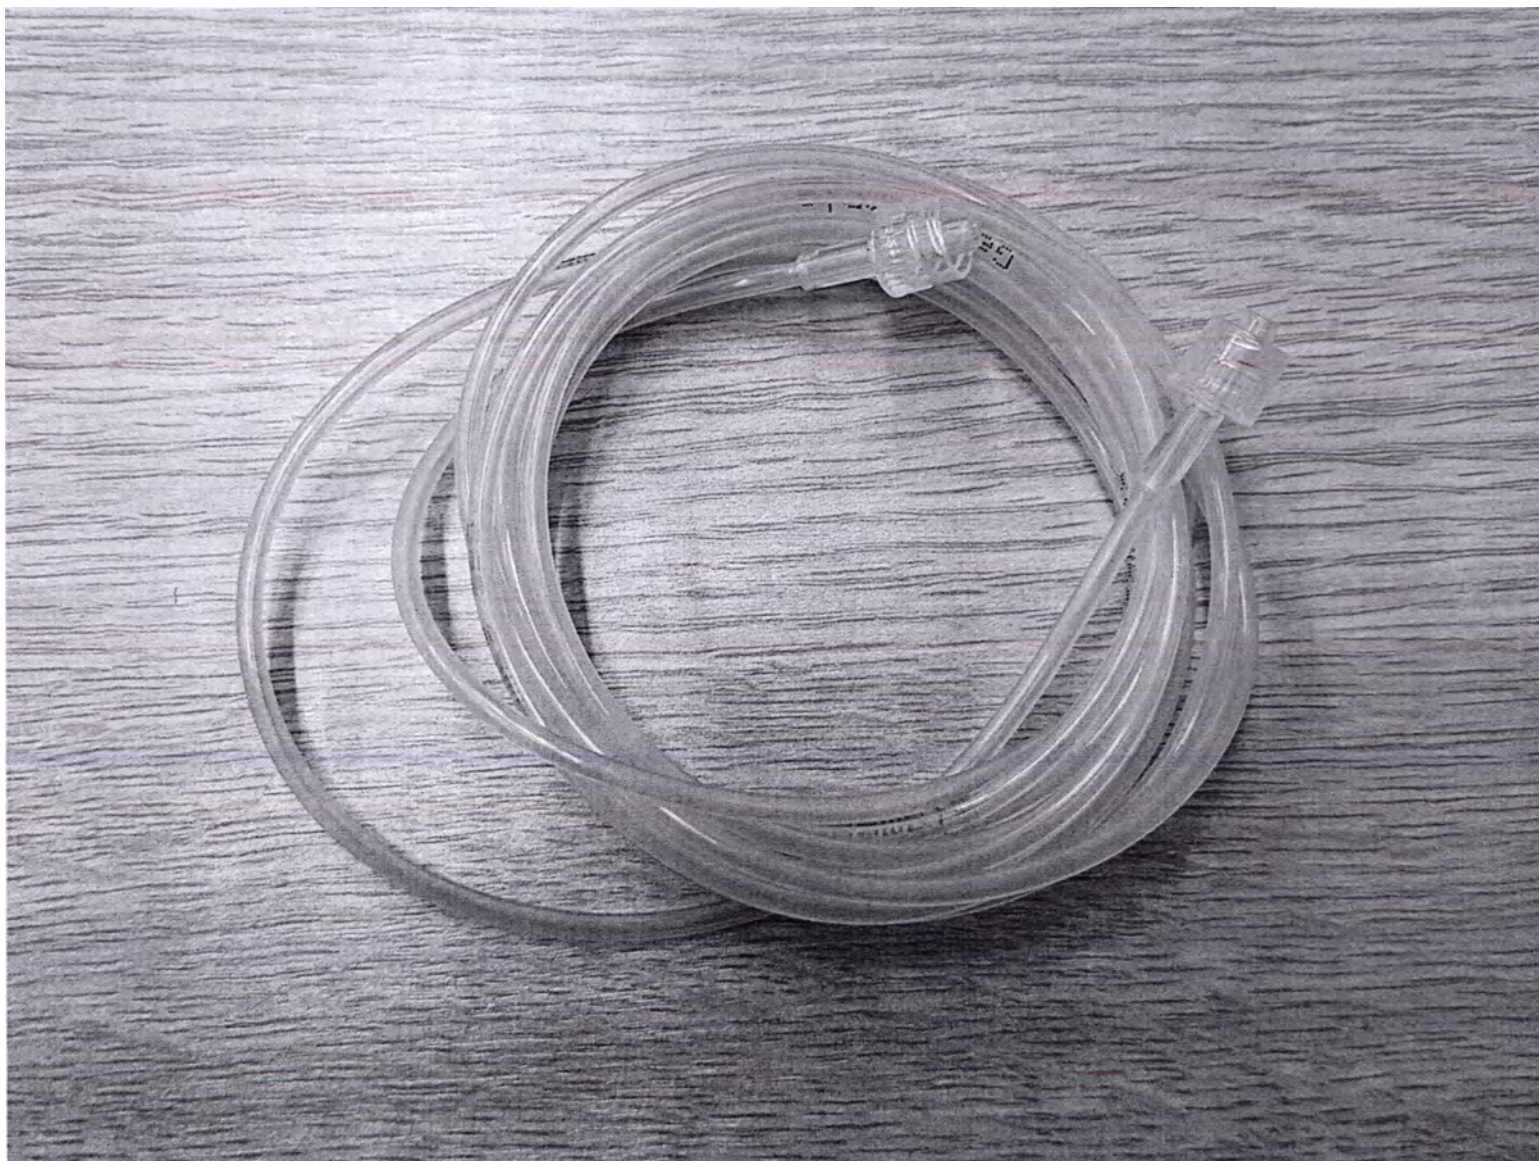

Шланг проб для детей 2,5 м

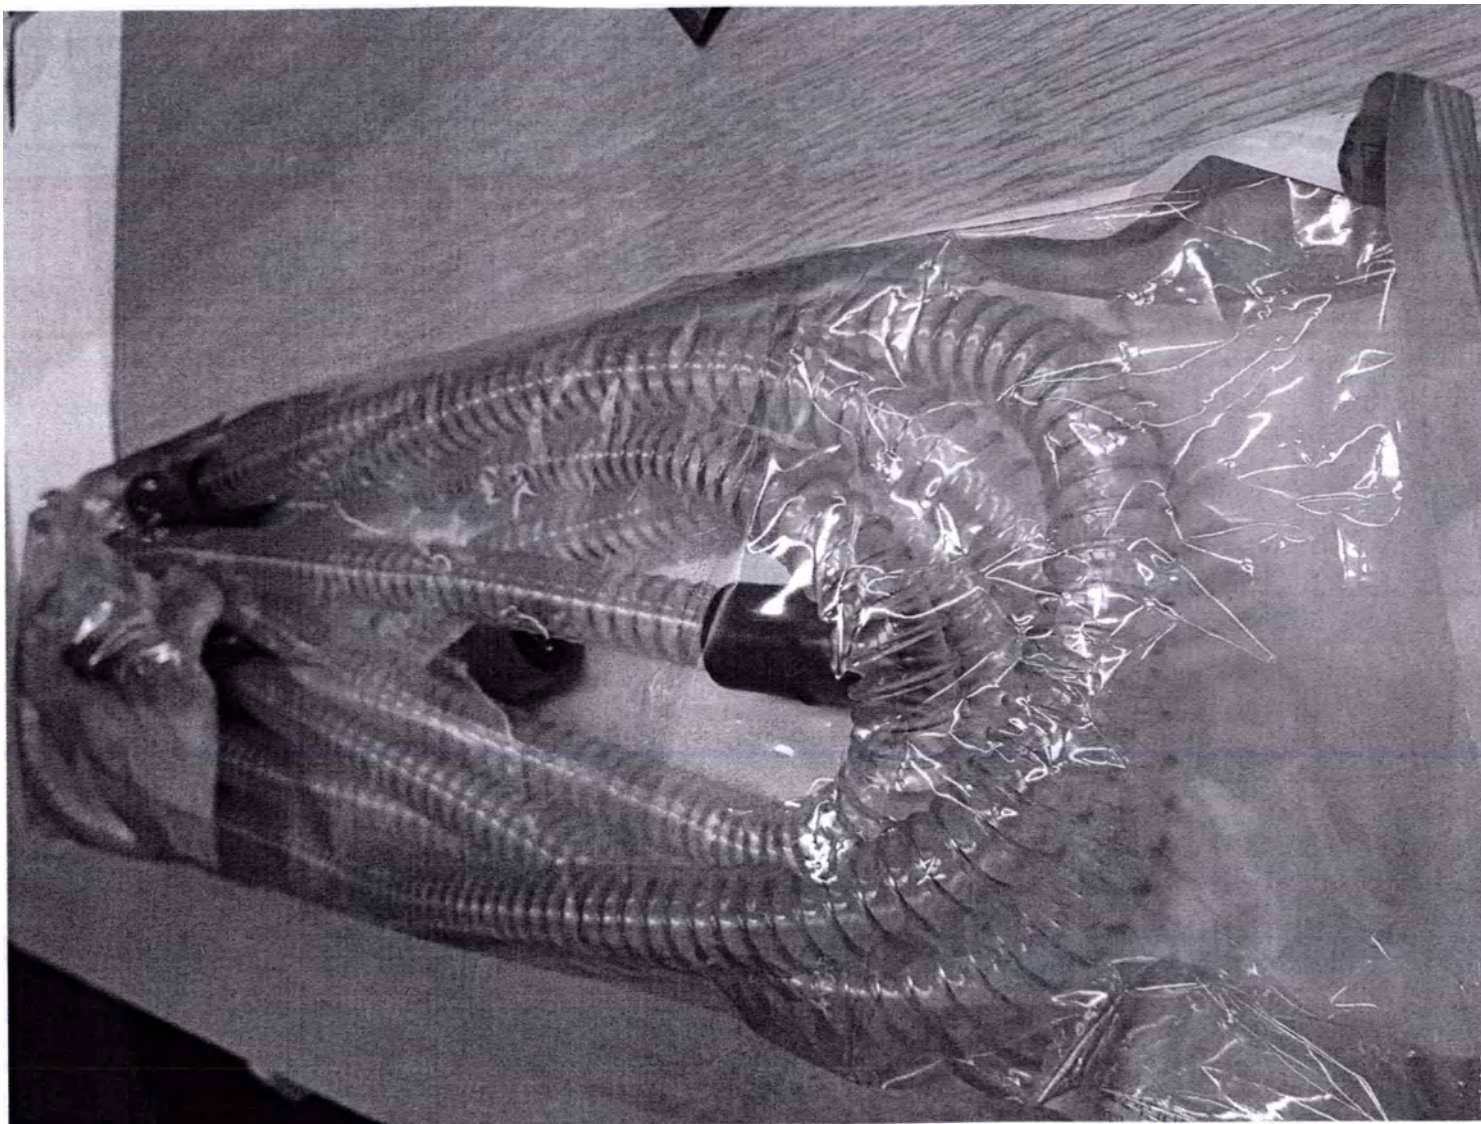

Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-«МС-1» по ТУ 9398-001-72474991-2005. регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07116 от 16.03.2010 г., производства ООО «Медсиликон», Россия



Кабель сетевой



Chirana


Аппарат искусственной вентиляции лёгких

Chirolog SV Basic


по ТУ 32.50.21-002-04569240-2018

Руководство по обслуживанию


**Аппарат искусственной вентиляции лёгких CHIROLOG с принадлежностями
по ТУ 32.50.21-002-04569240-2018 в исполнении CHIROLOG SV AURA Profi**

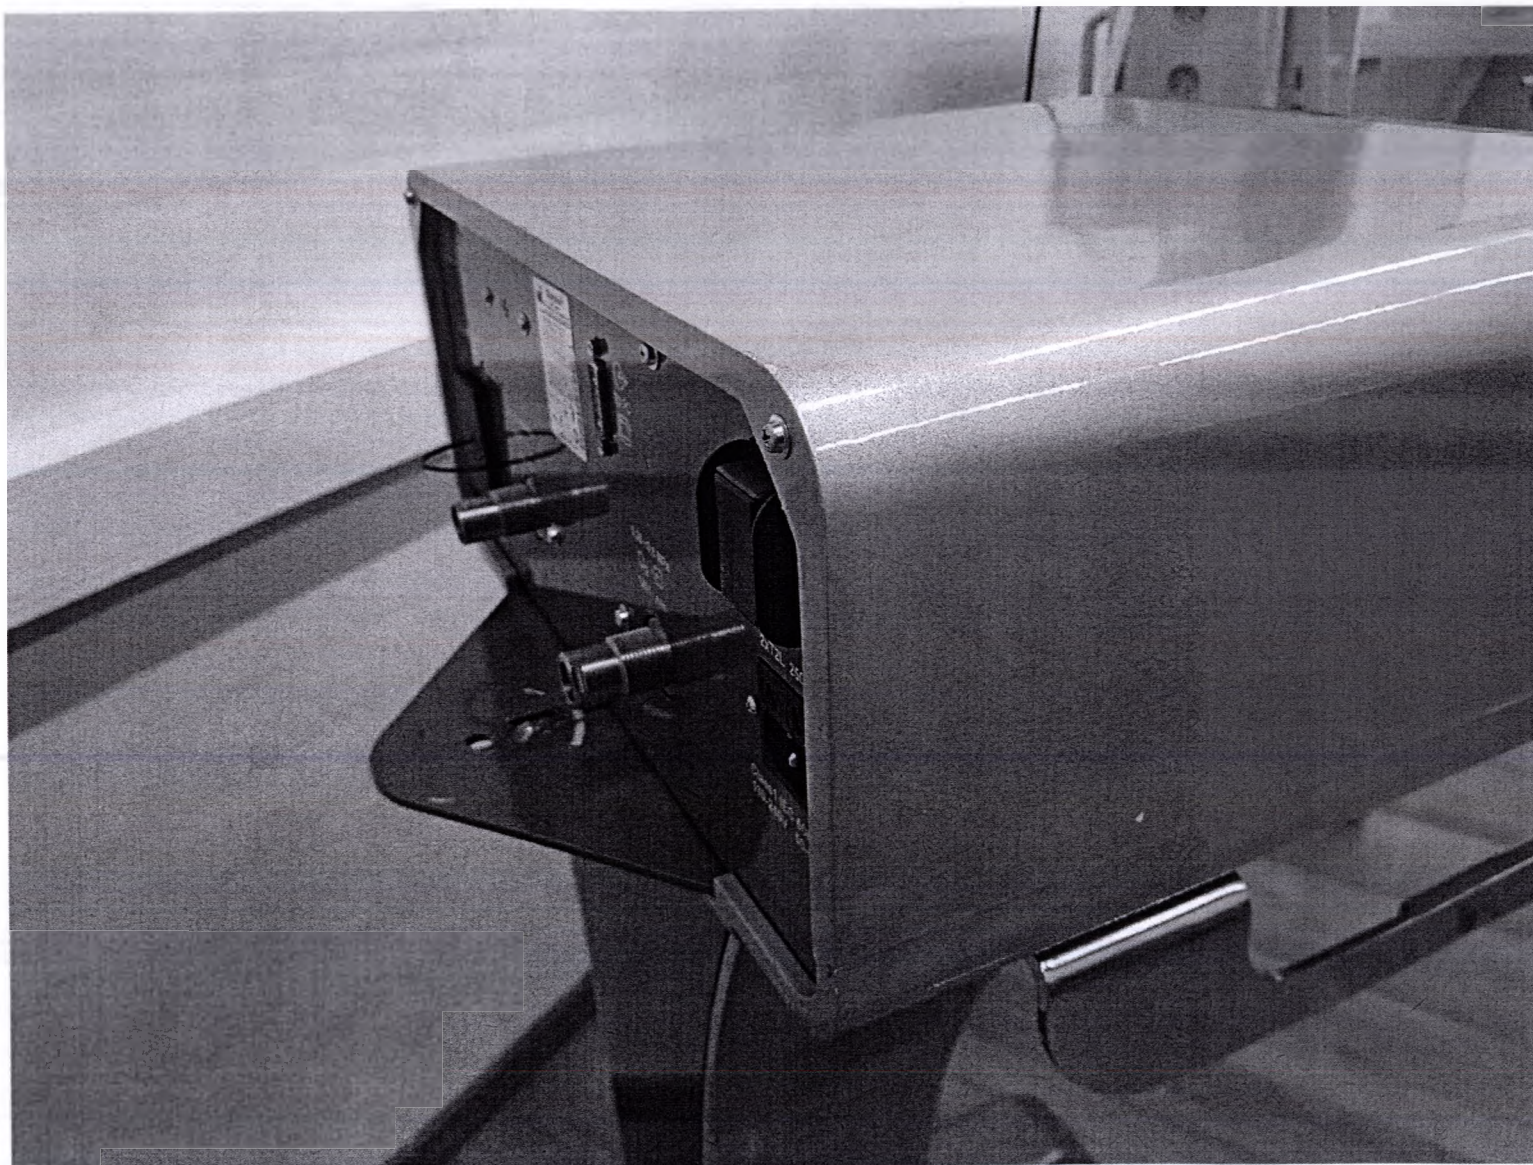


Основной блок AURA Profi с газовыми входами

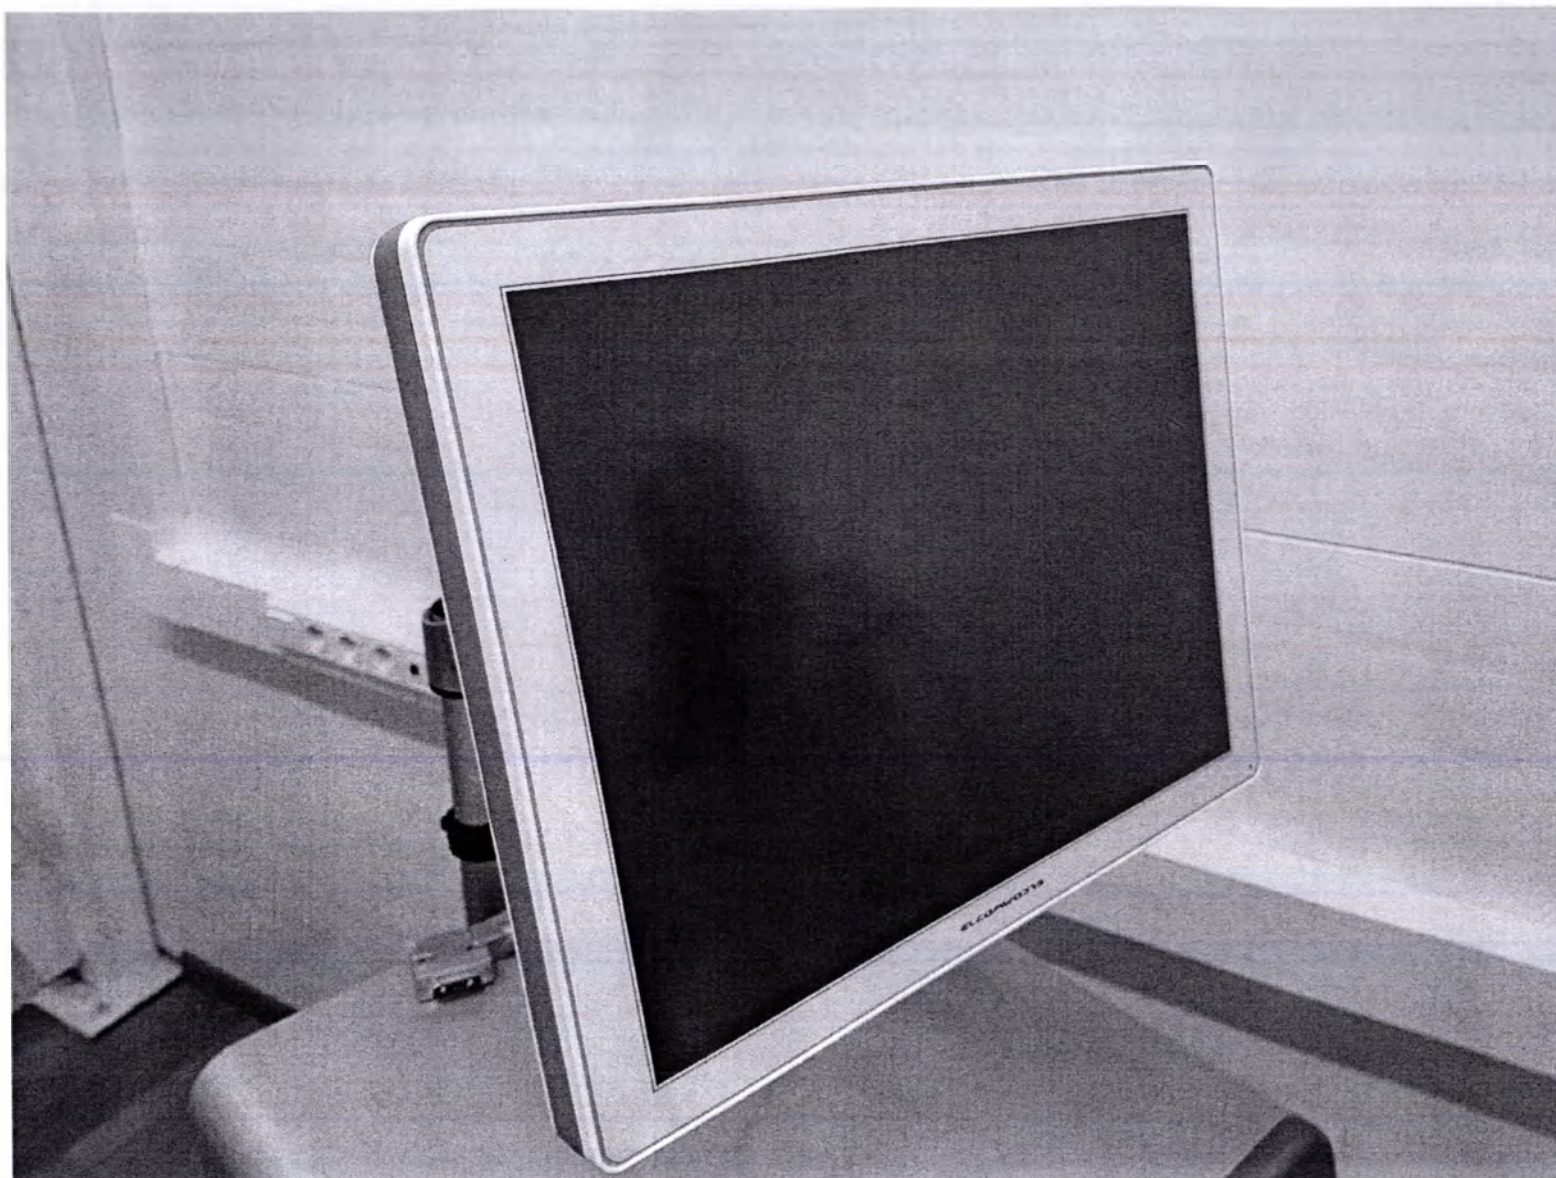

Панель управления AURA Profi

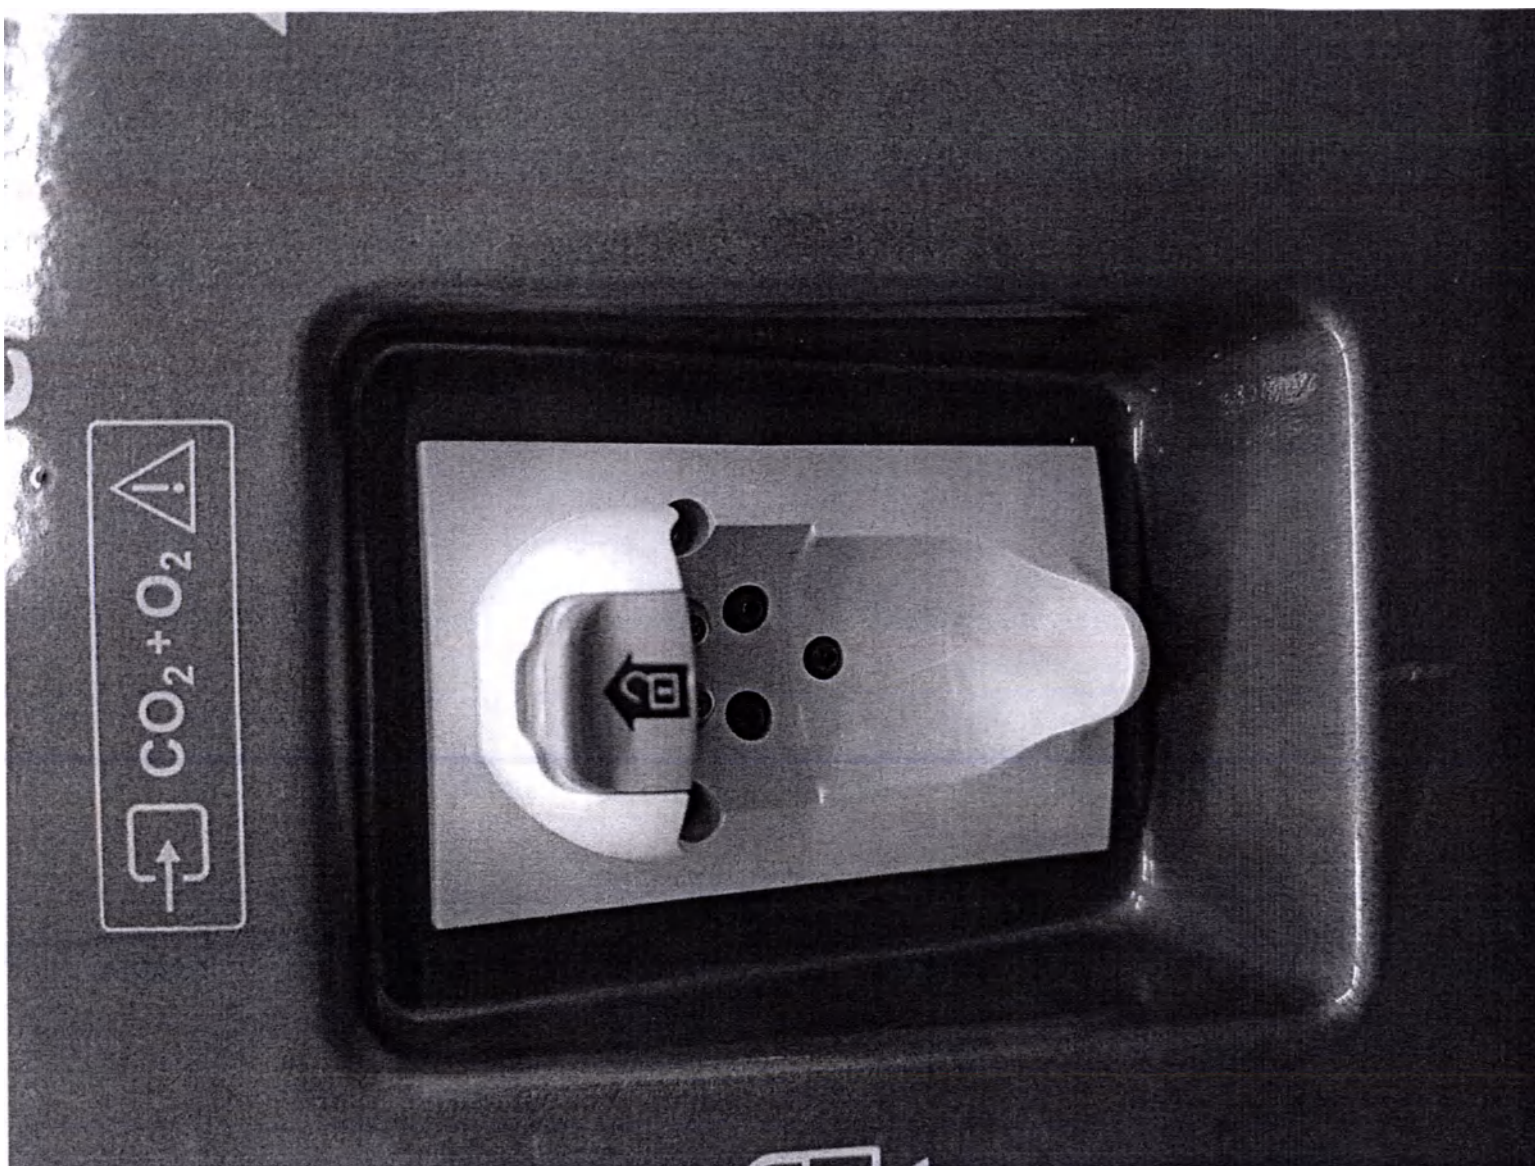

Модуль мониторинга CO₂, O₂ – в боковом потоке ARTEMA

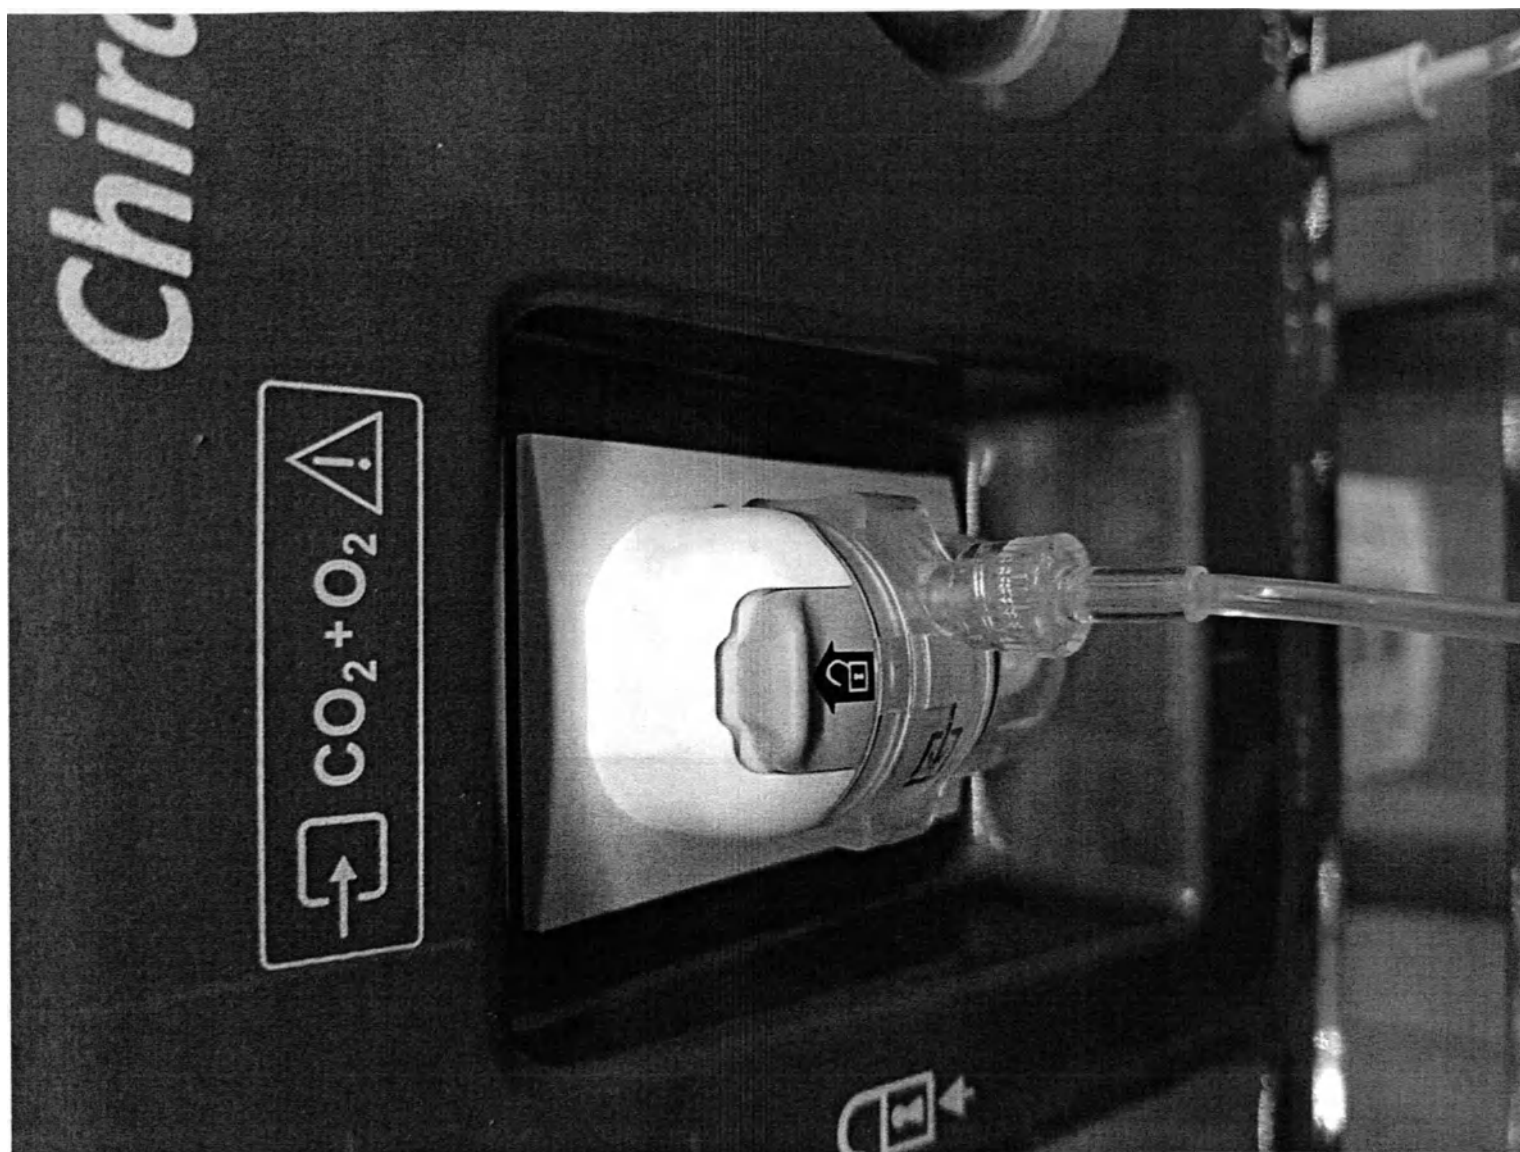


Модуль мониторинга CO_2 , O_2 – в боковом потоке ТРИТОН




Модуль мониторинга CO₂ – в боковом потоке ARTEMA



Модуль мониторинга CO₂ – в боковом потоке ТРИТОН

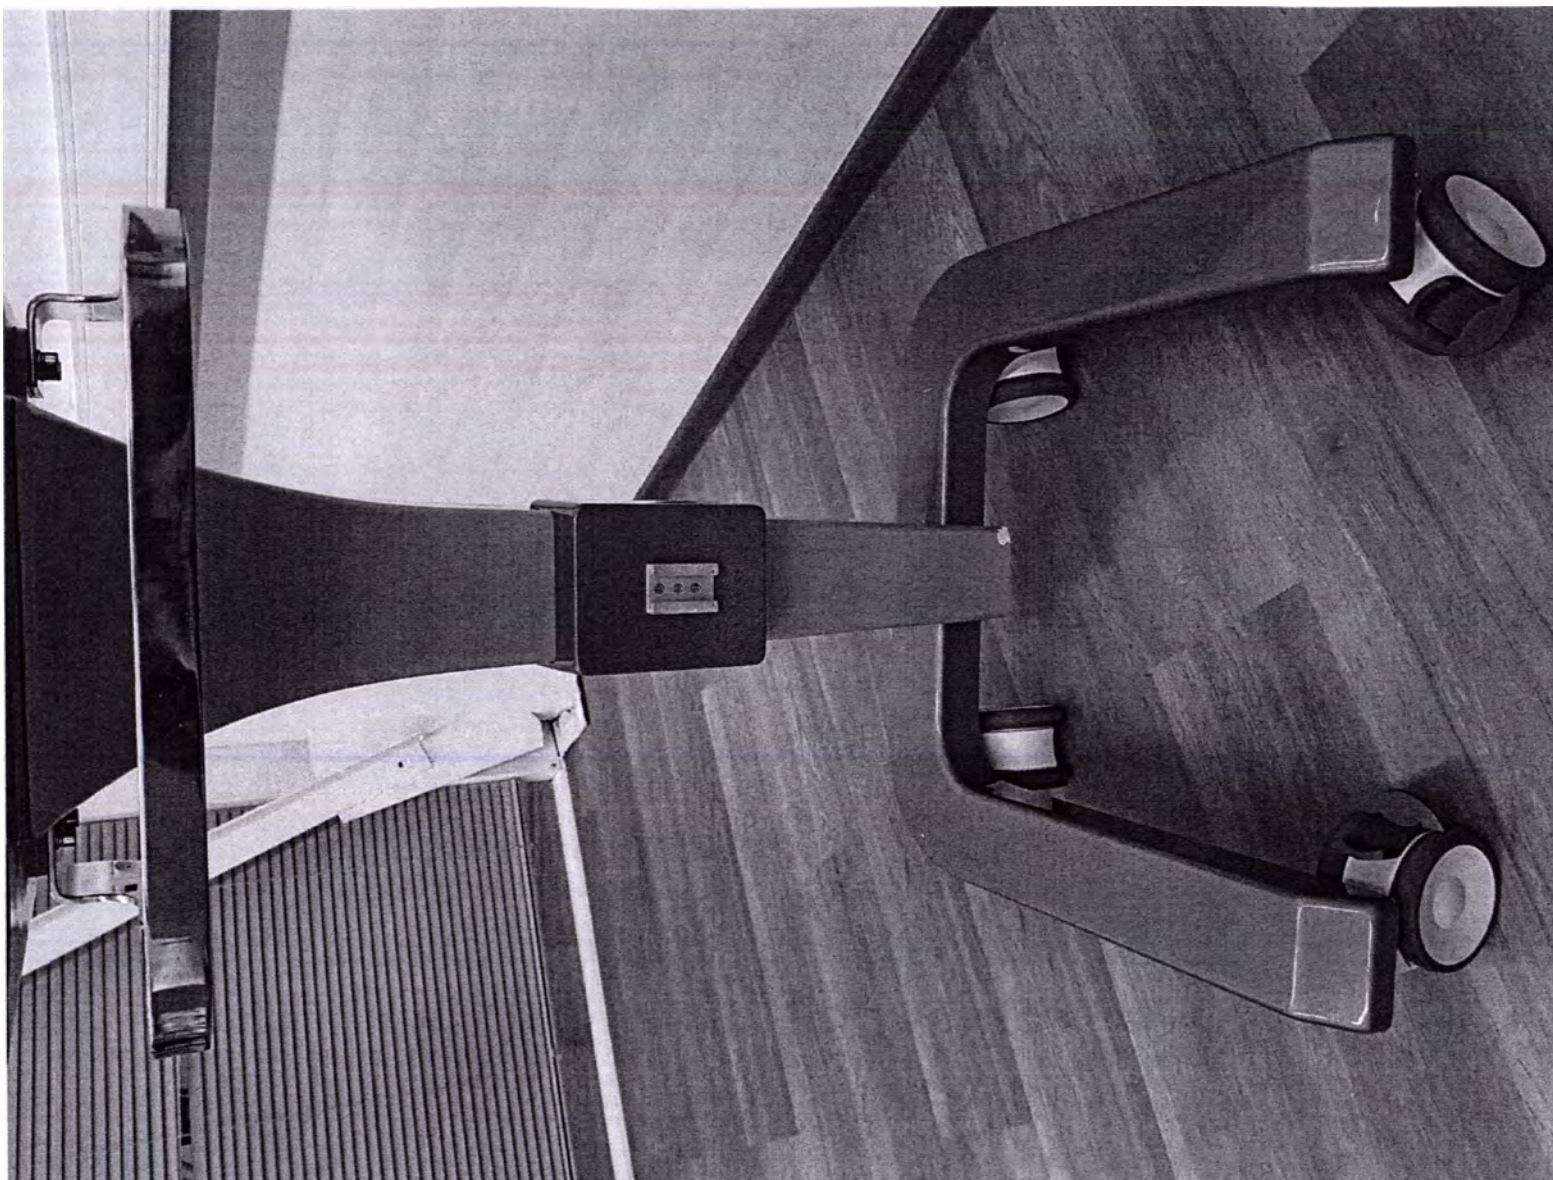


Стойка Profi

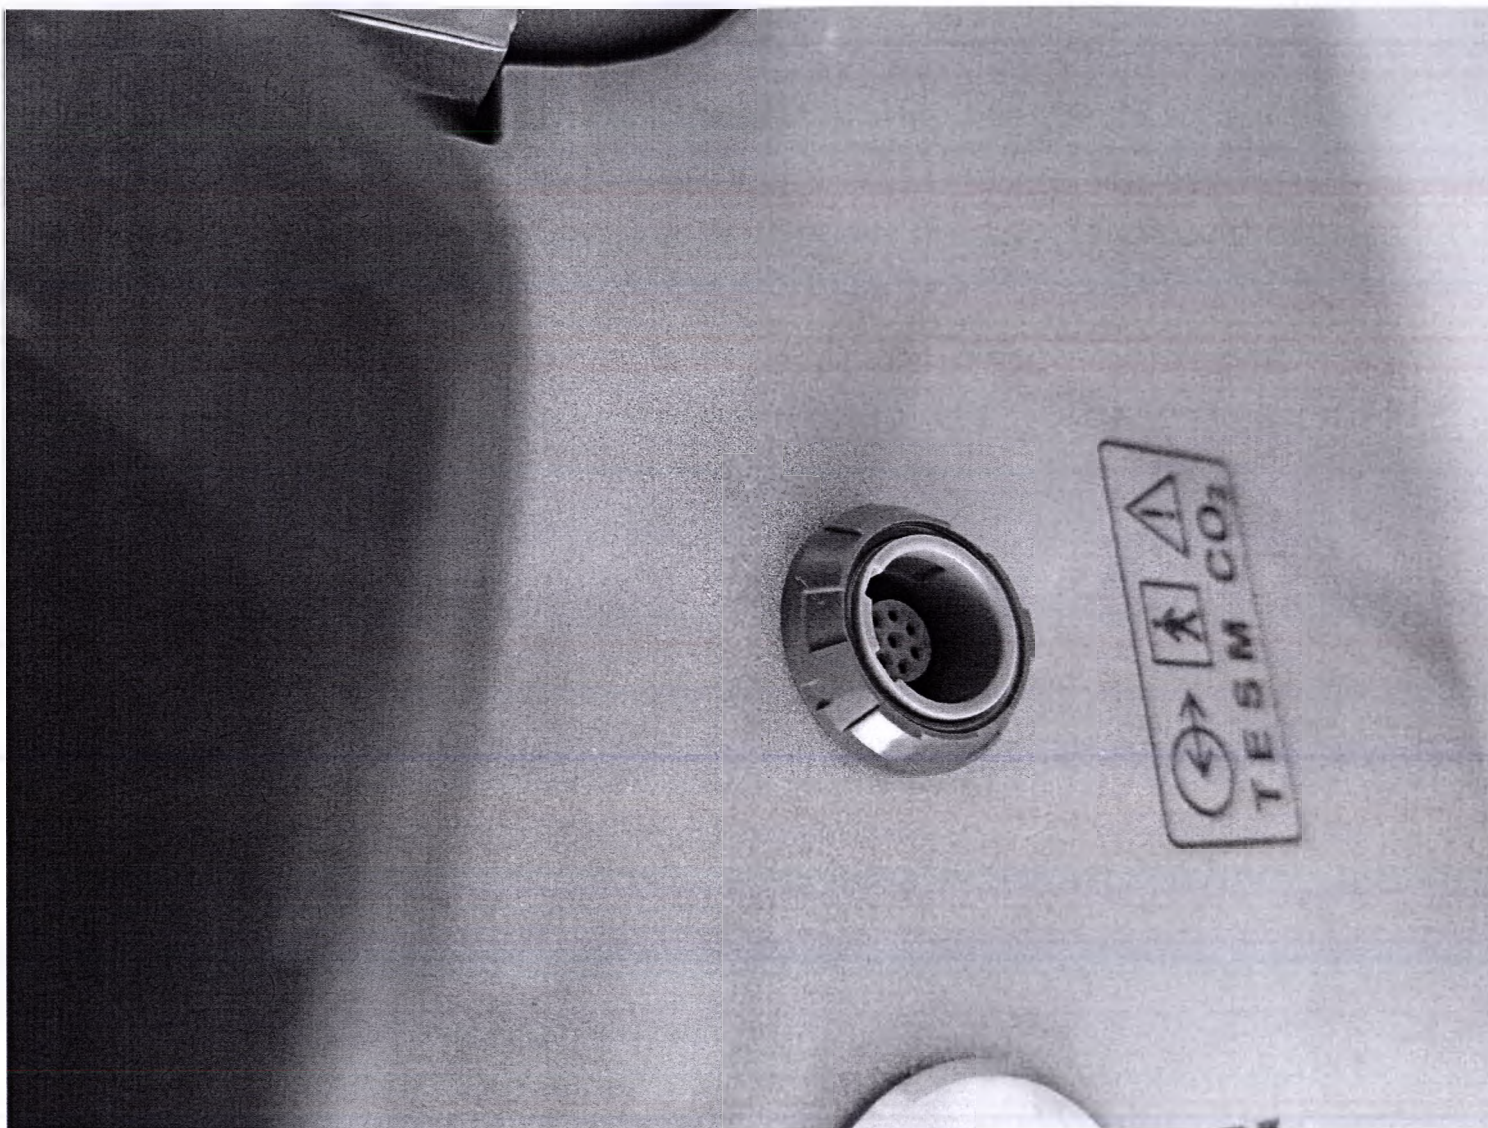


Модуль мониторинга CO₂ – в прямом потоке ТРИТОН



Модуль мониторинга CO₂ – в прямом потоке IRMA.

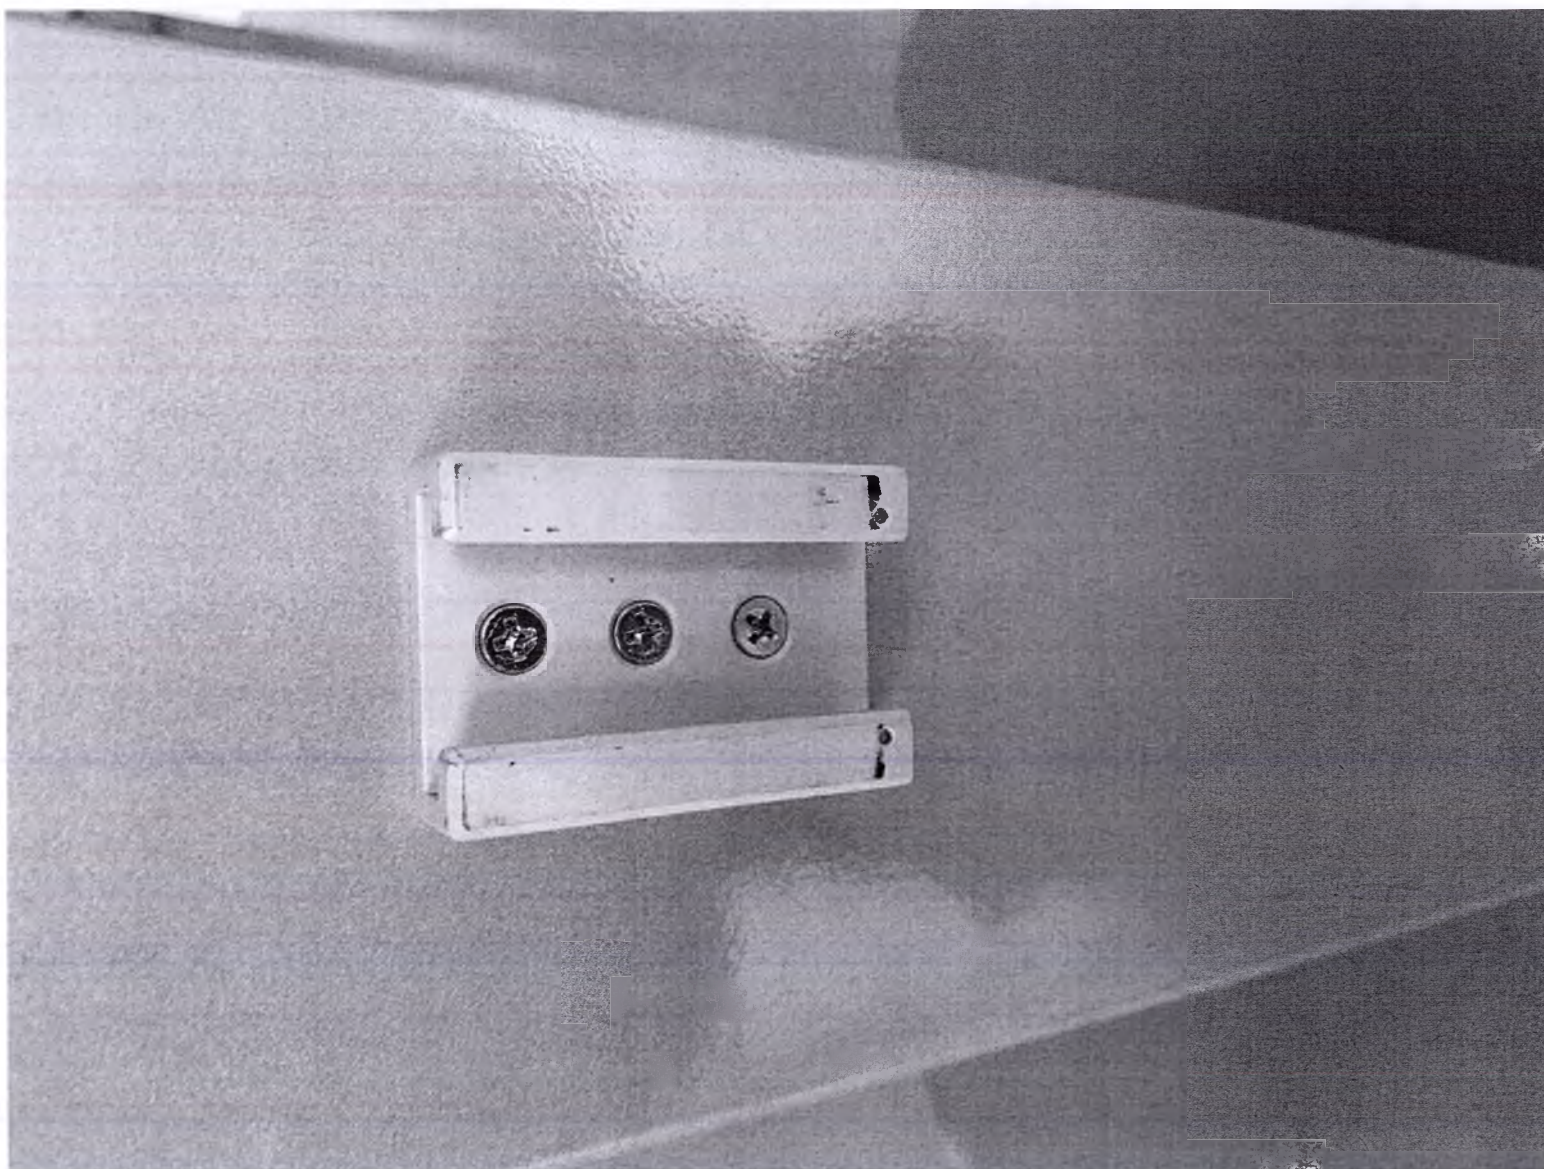

Крепление 2

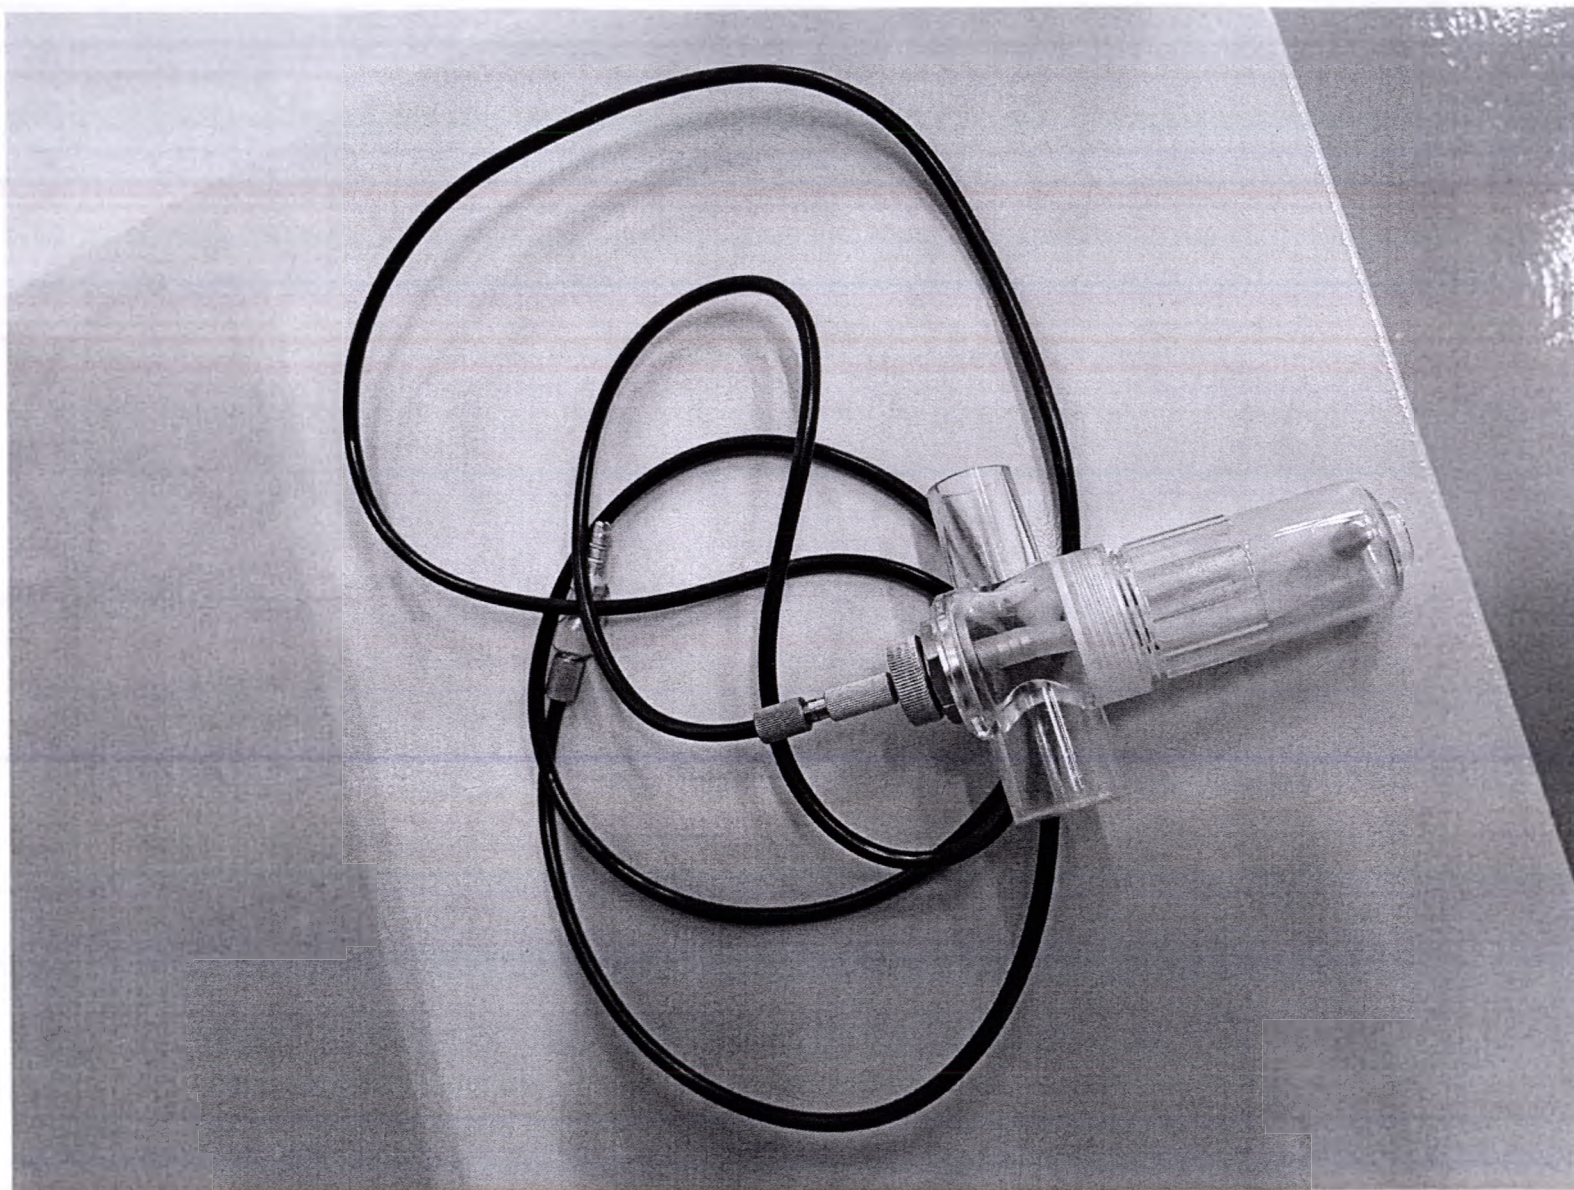

Небулайзер пневматический




Небулайзер Аеронев с принадлежностями рег. удостоверение № ФСЗ 2010/08746 от 29.12.2010.



Датчик O₂ MOX 3




Air адаптер для взрослых

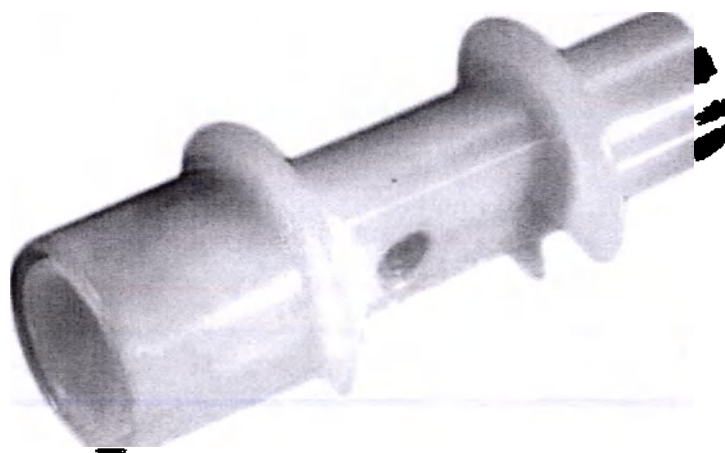


Air адаптер для детей




Airway адаптер

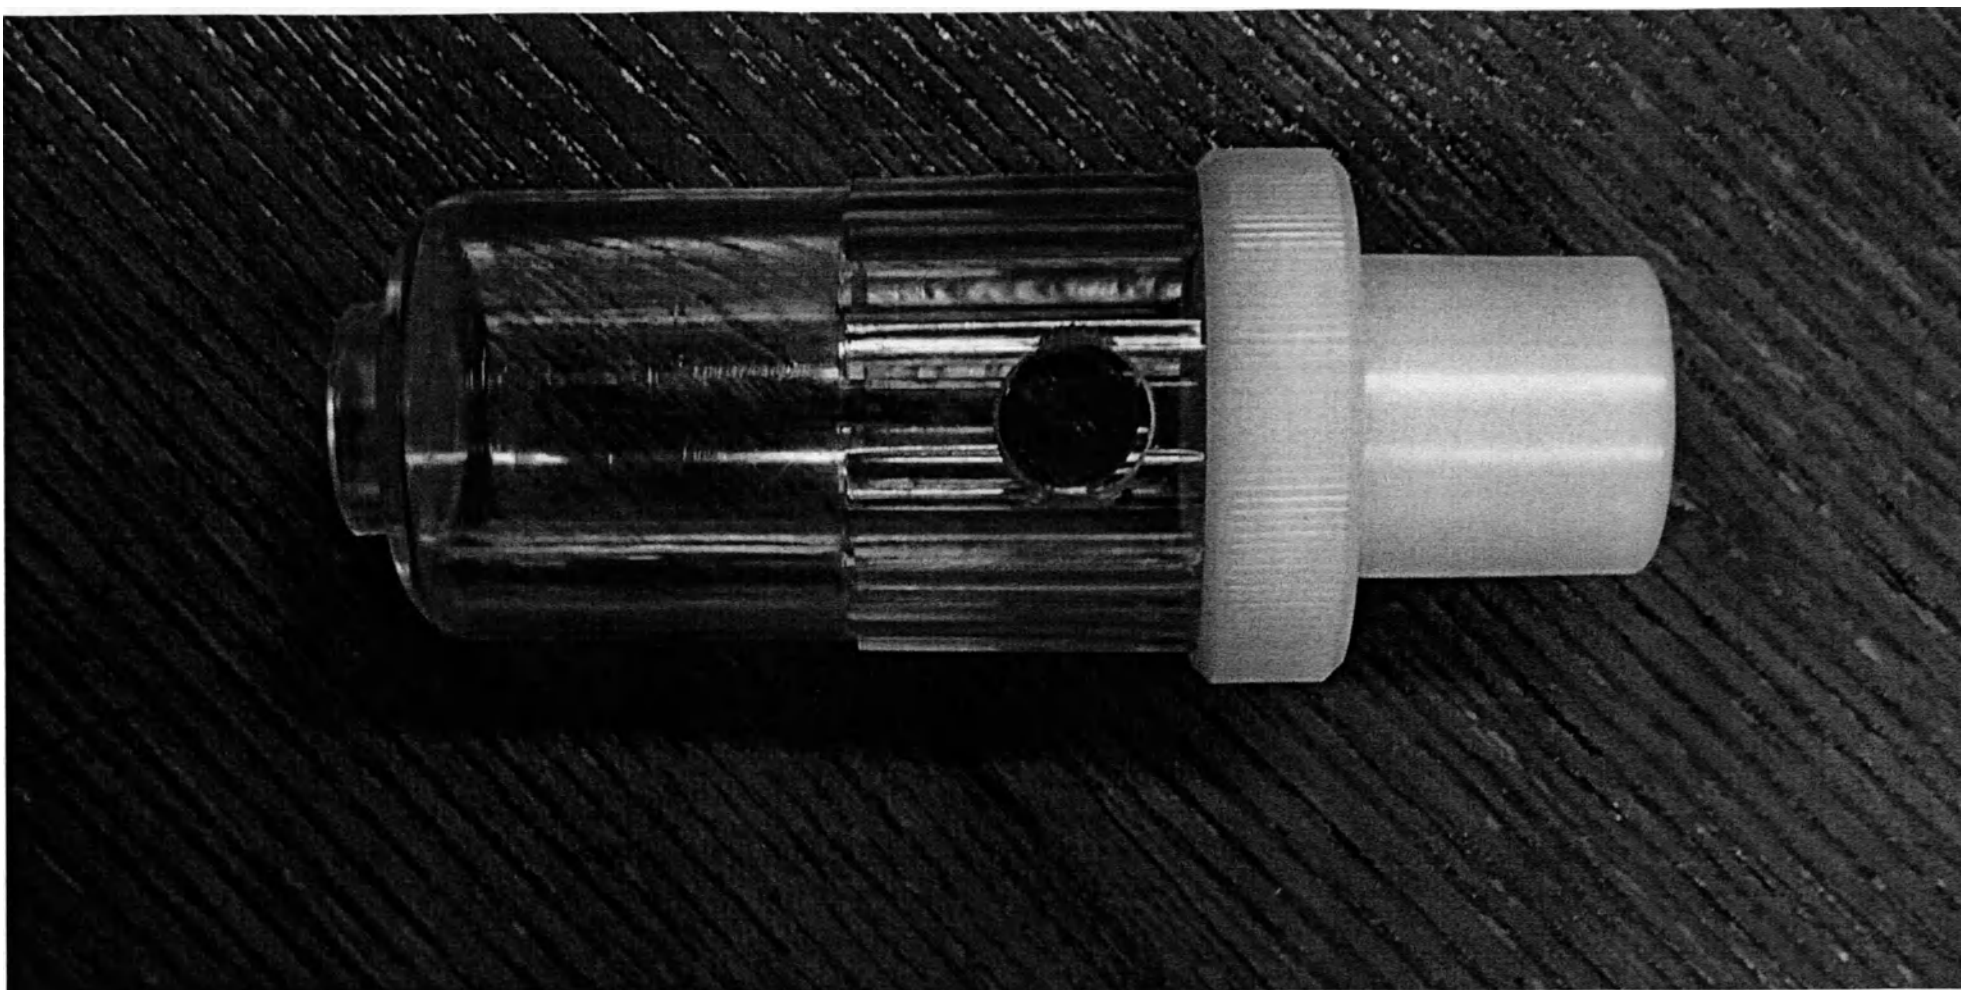


Сосуд для отхода

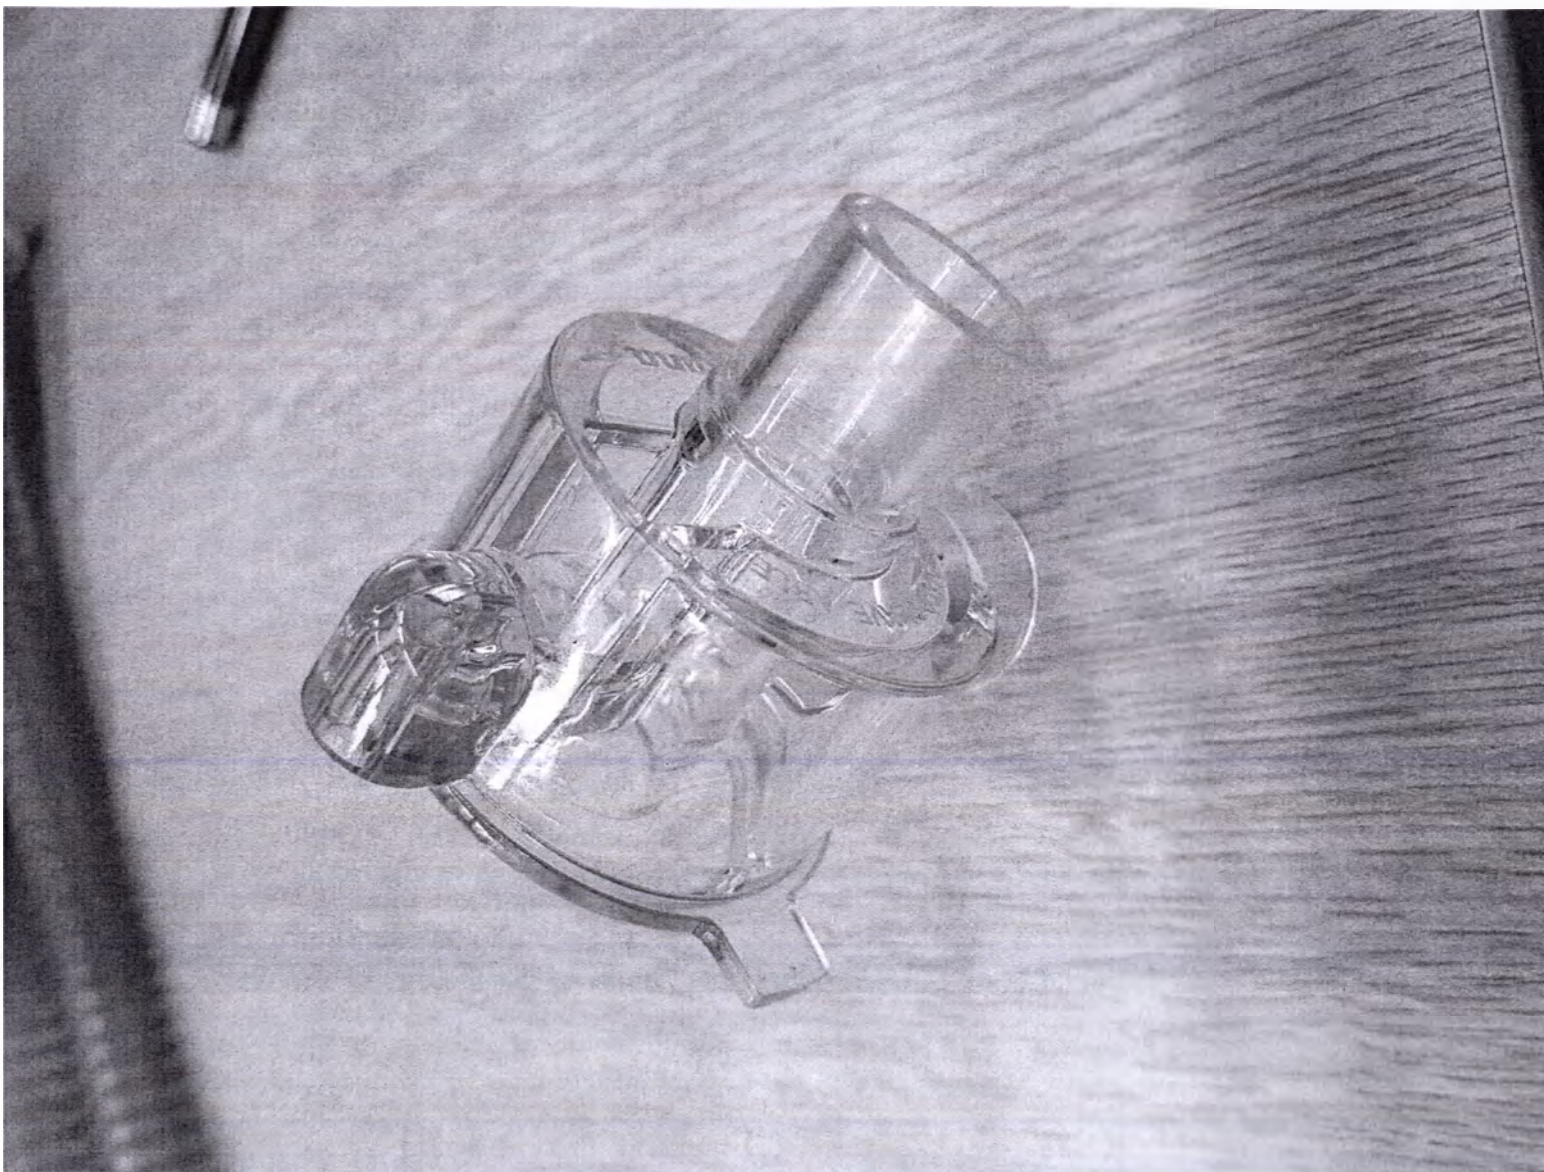


Экспираторный клапан

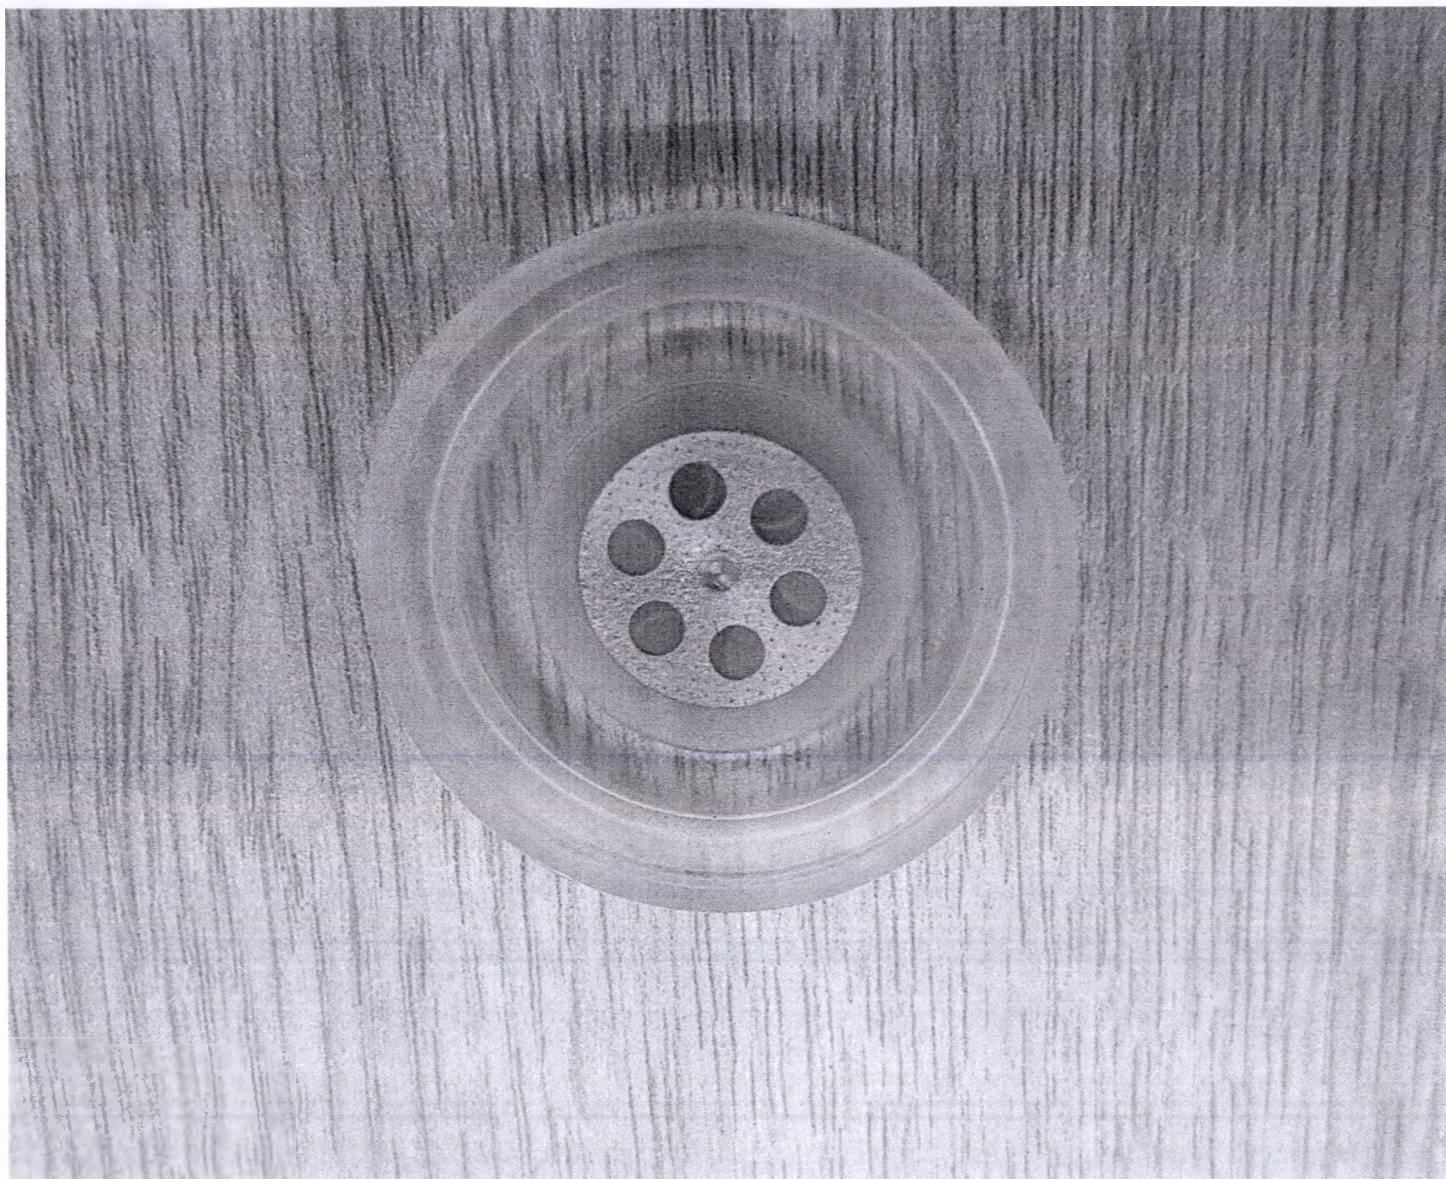


Экспирационная мембрана

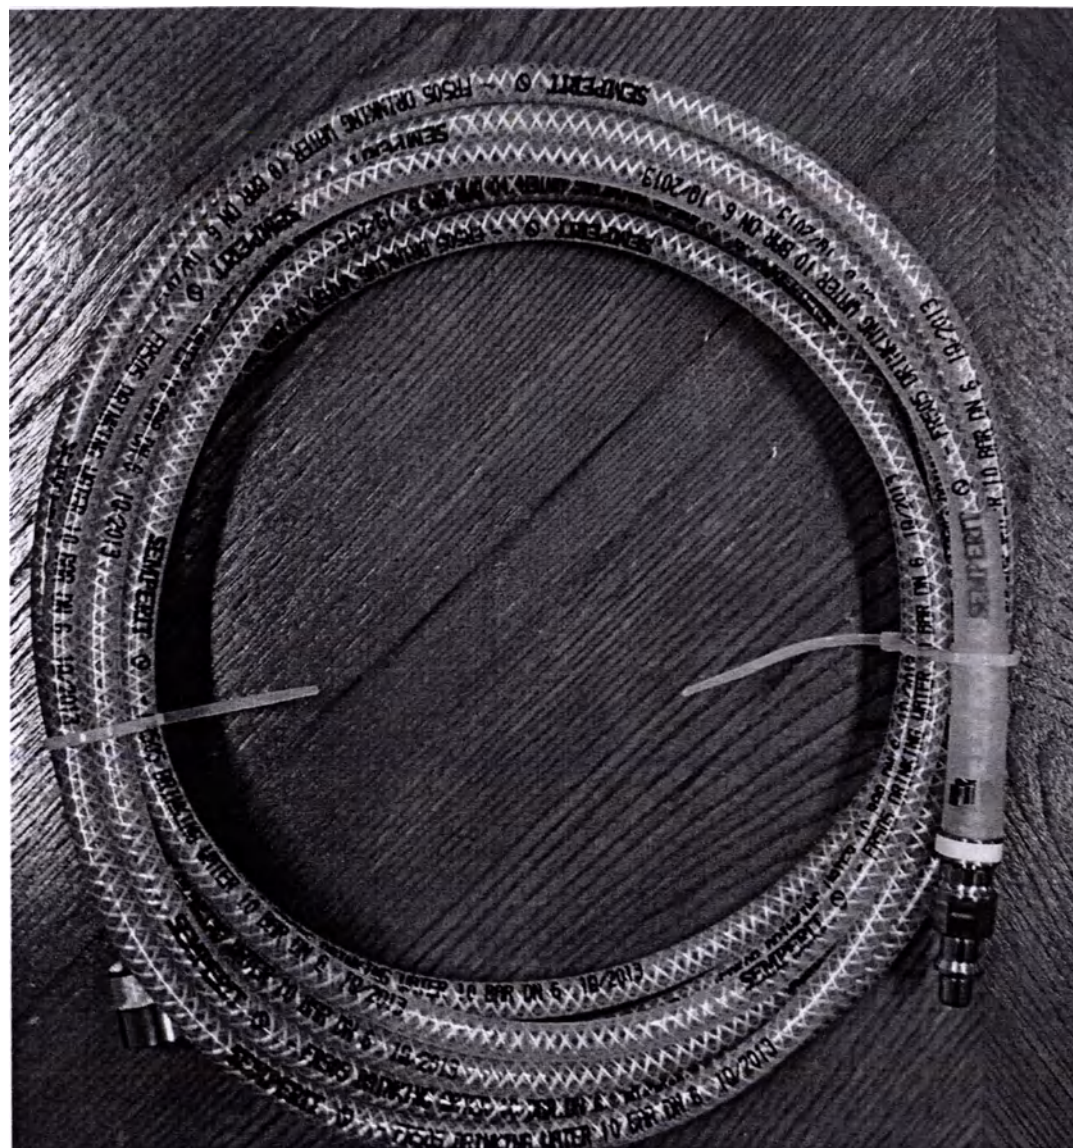


Подводящий шланг DIN O₂

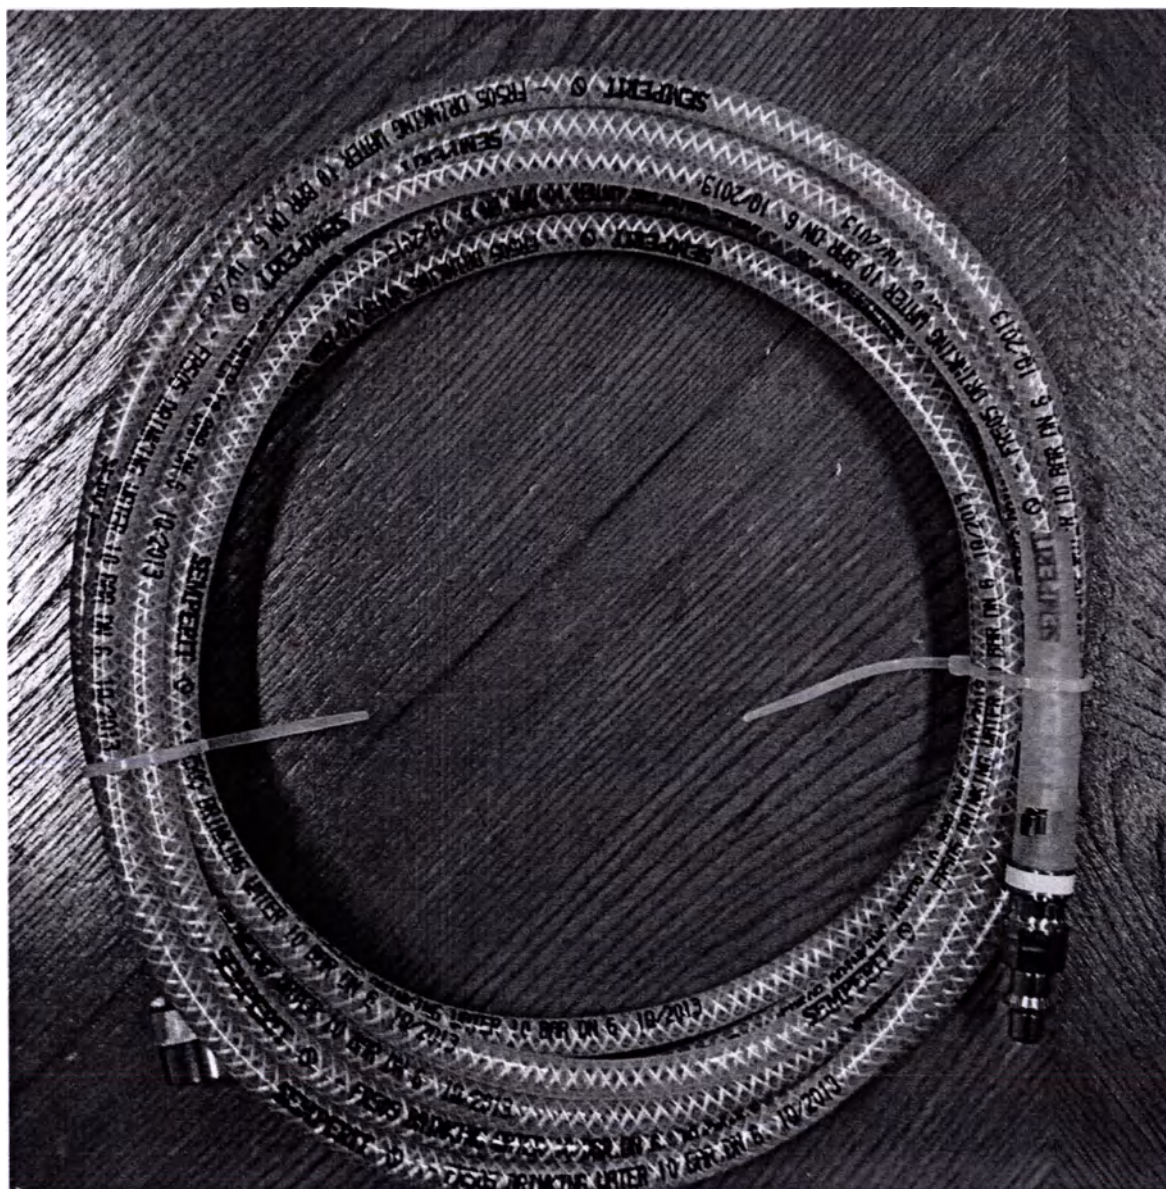


Подводящий шланг DIN AIR

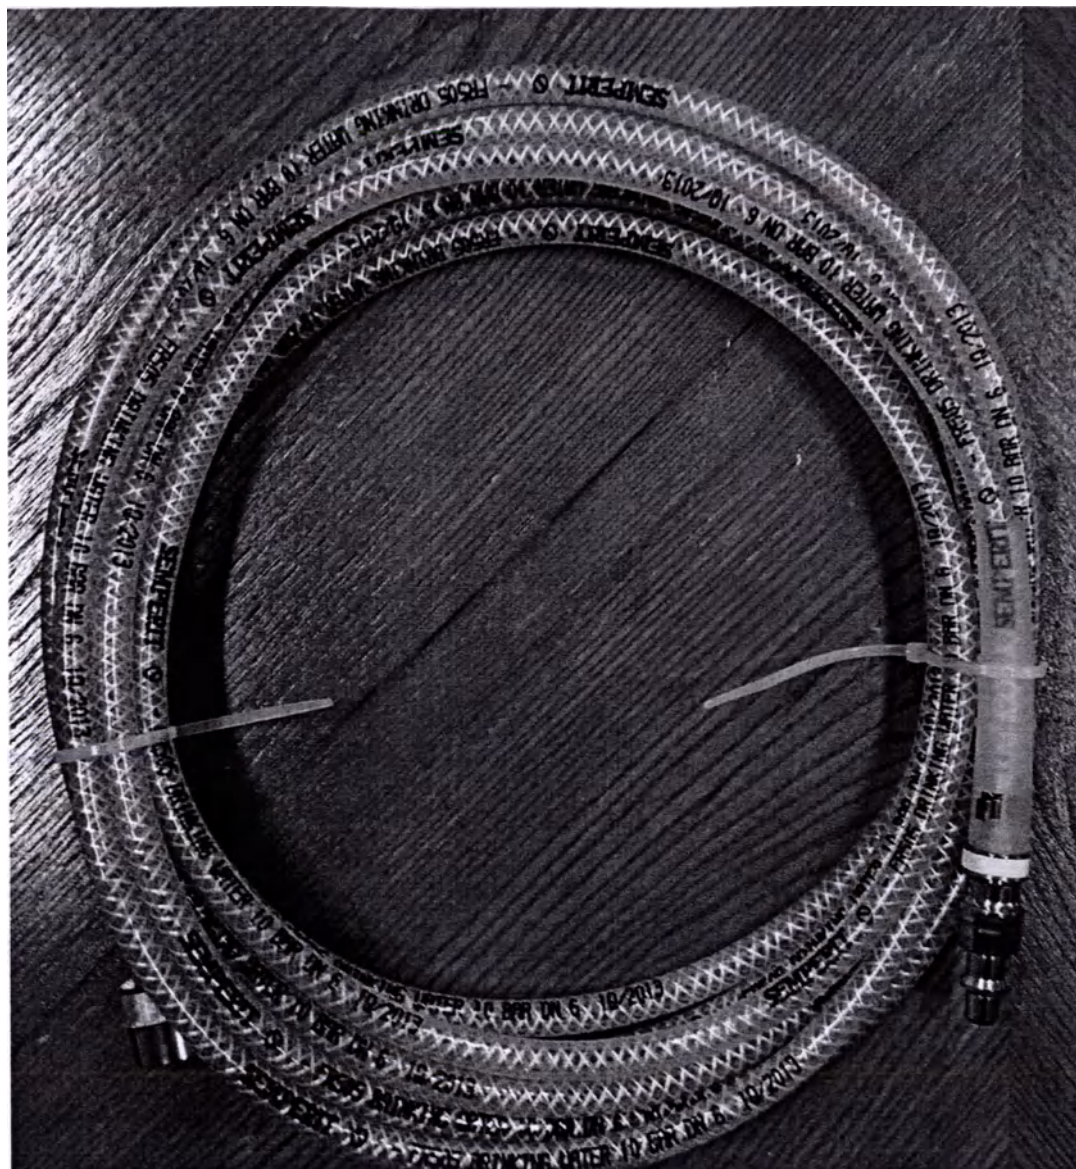


Подводящий шланг MEDI-DIN O₂

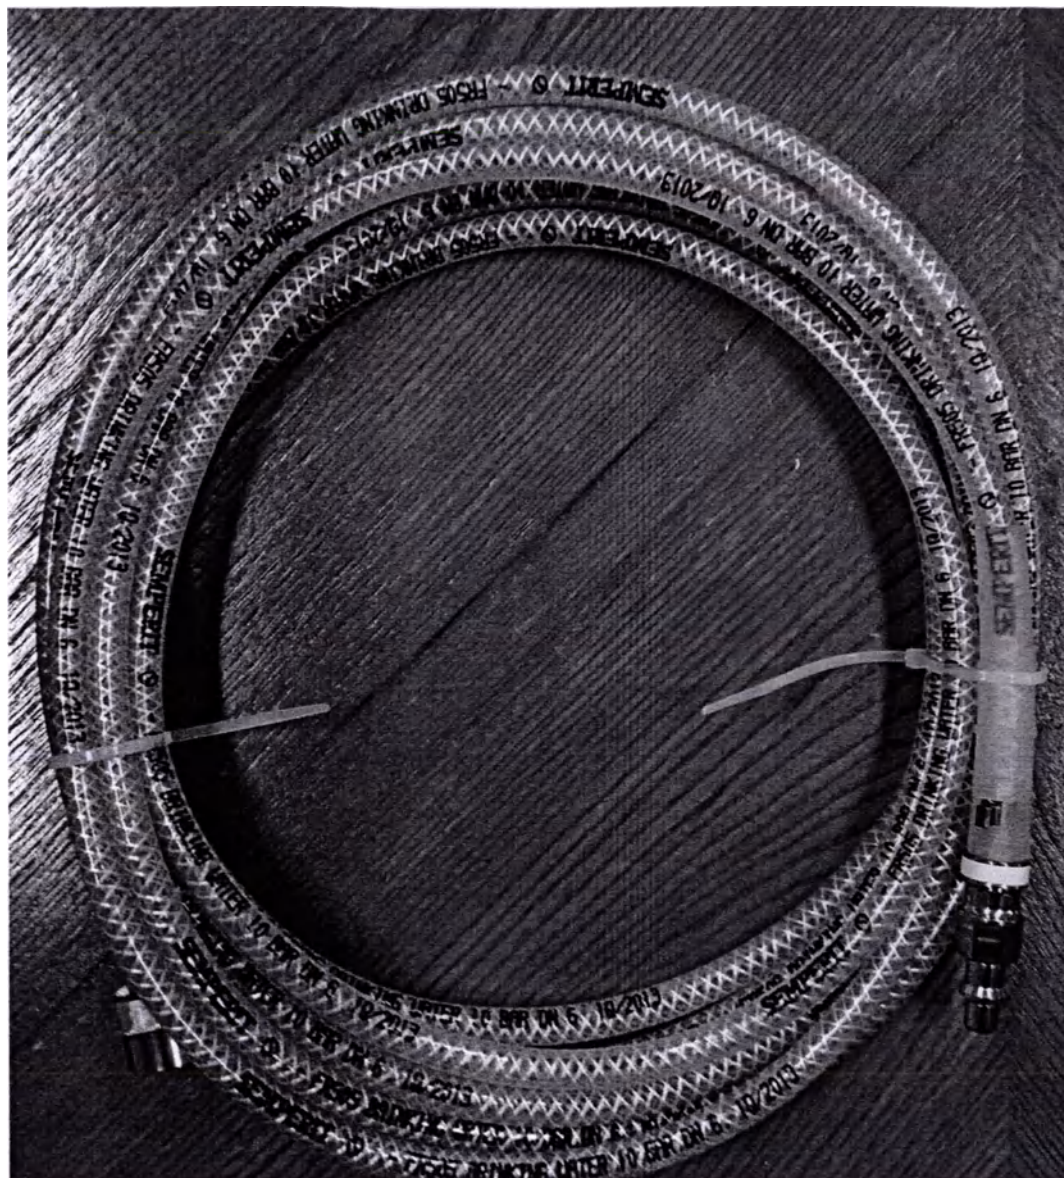

Подводящий шланг MEDI-DIN AIR

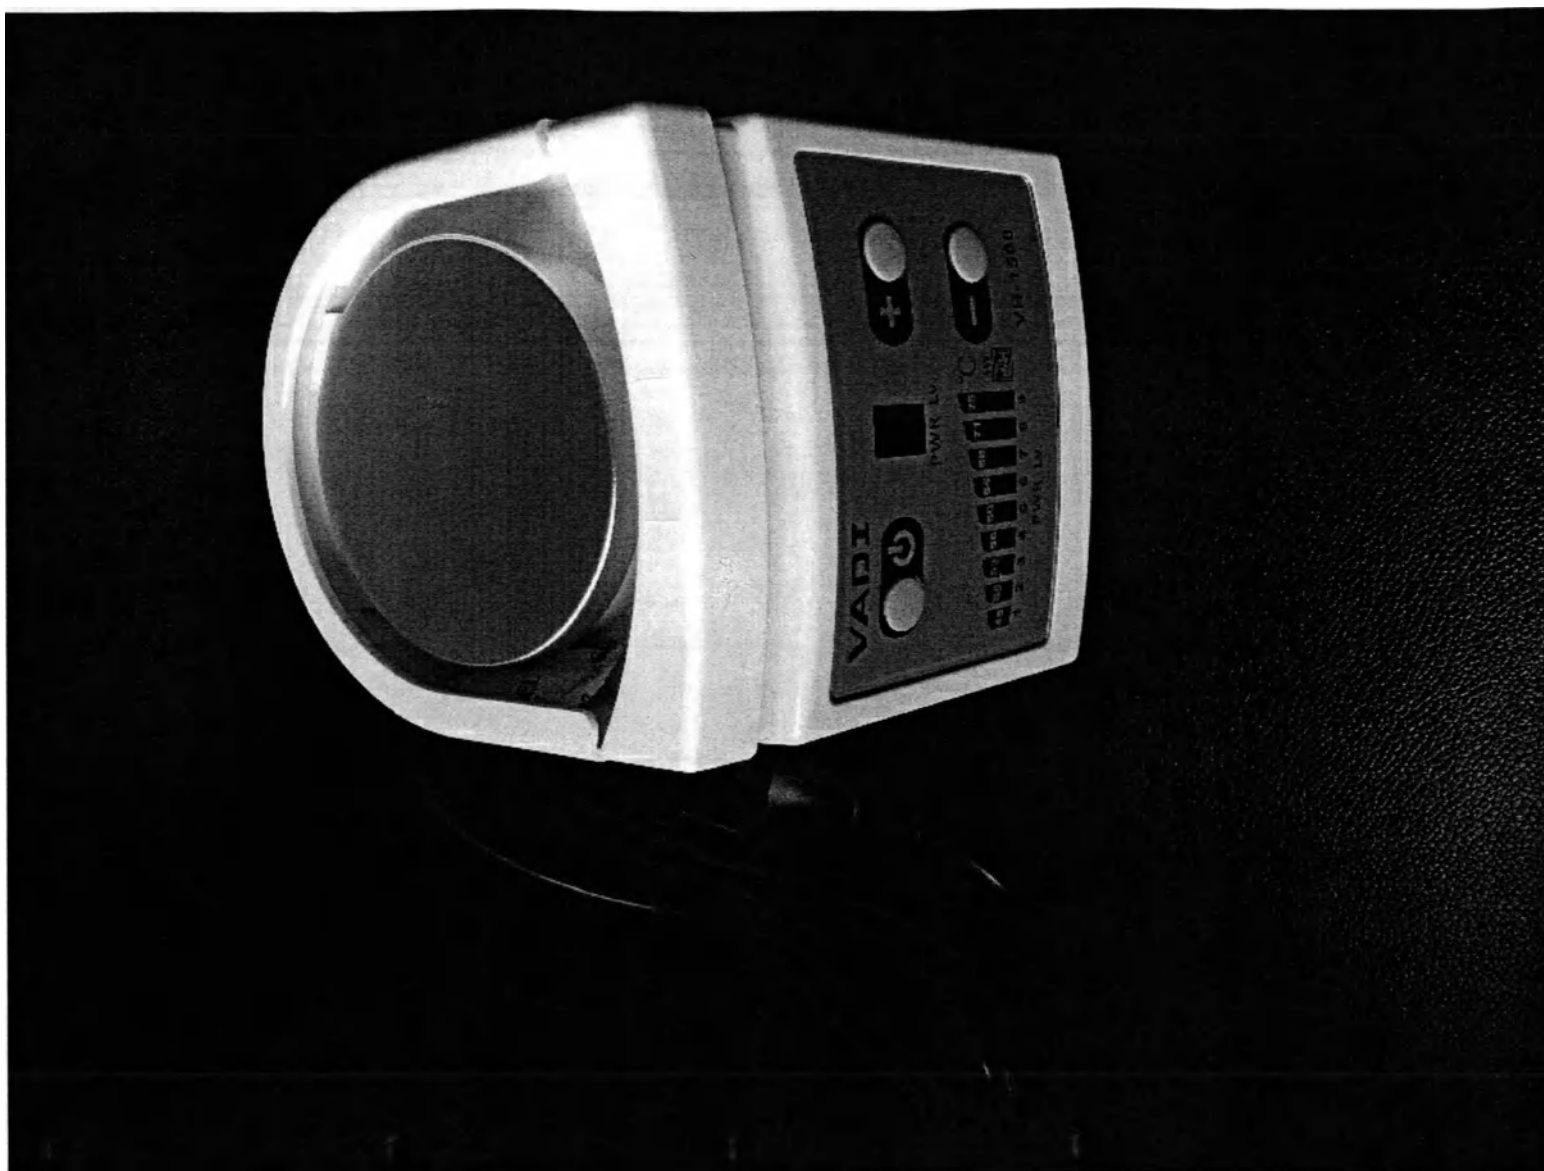


Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-1500

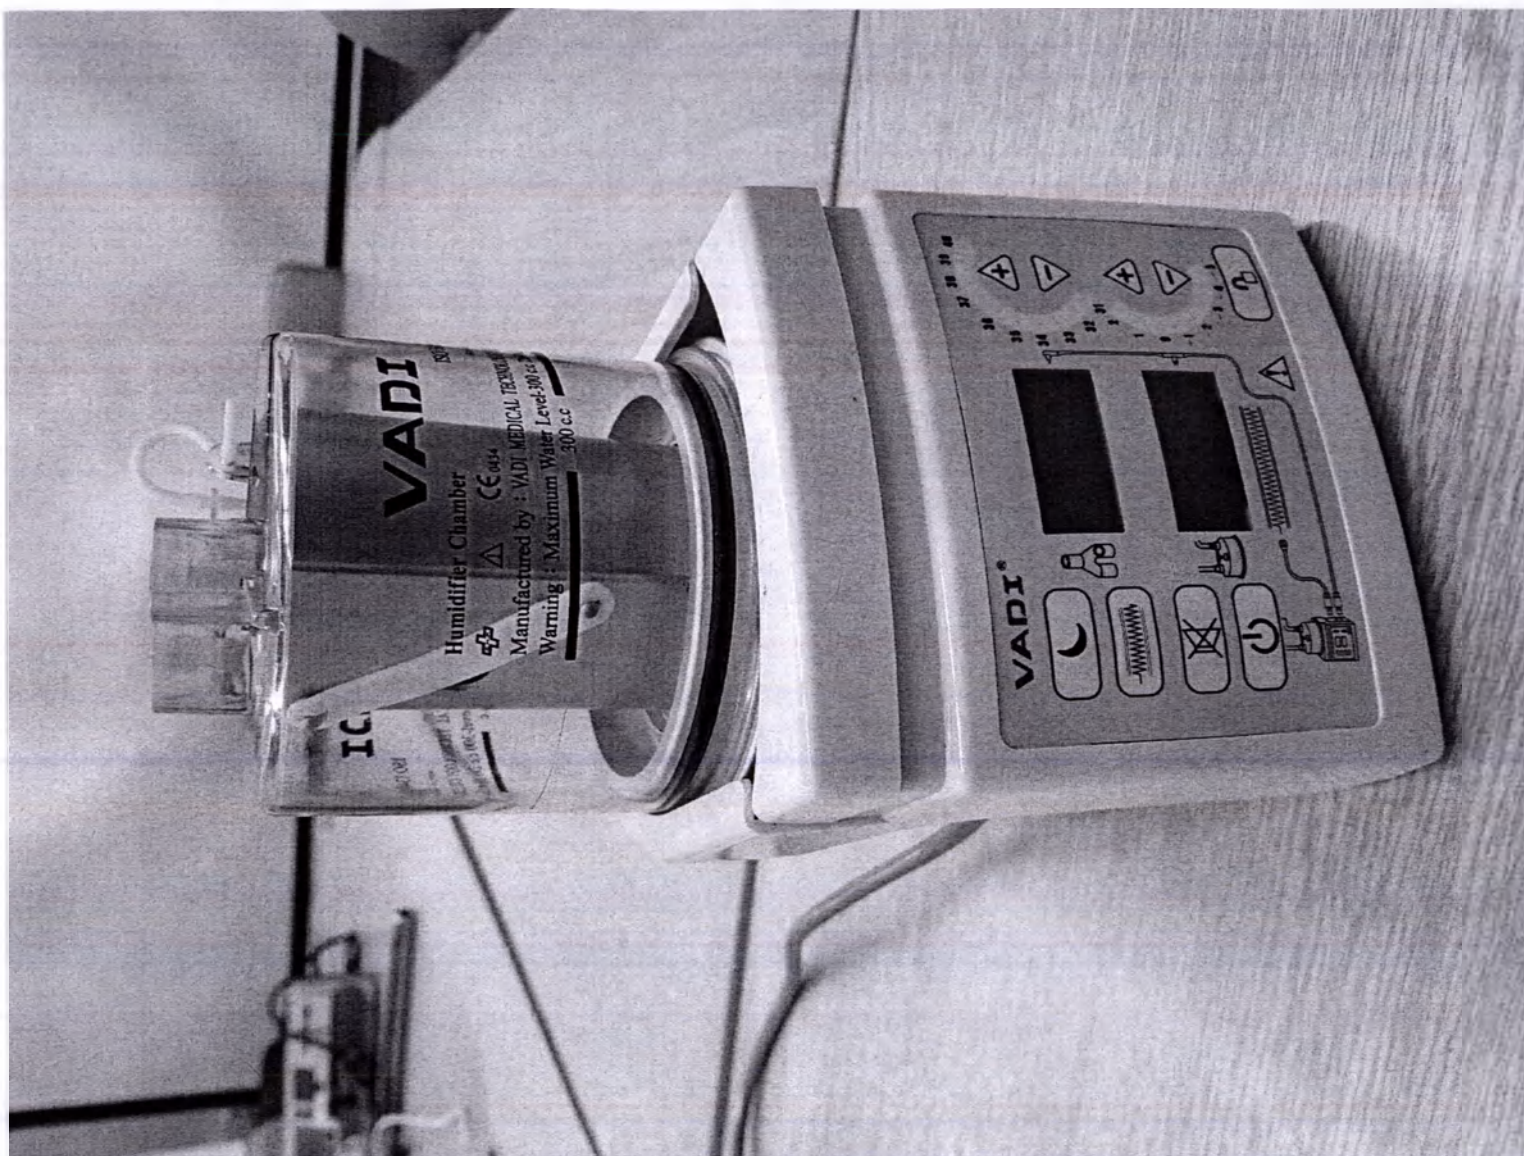


Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-3000



Увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР» – "УОМЗ" по ТУ 9444-121-07539541-2011 с принадлежностями рег. удостоверение № РЗН 2015/2620 от 29.04.2015г. АО "ПО "УОМЗ" Россия

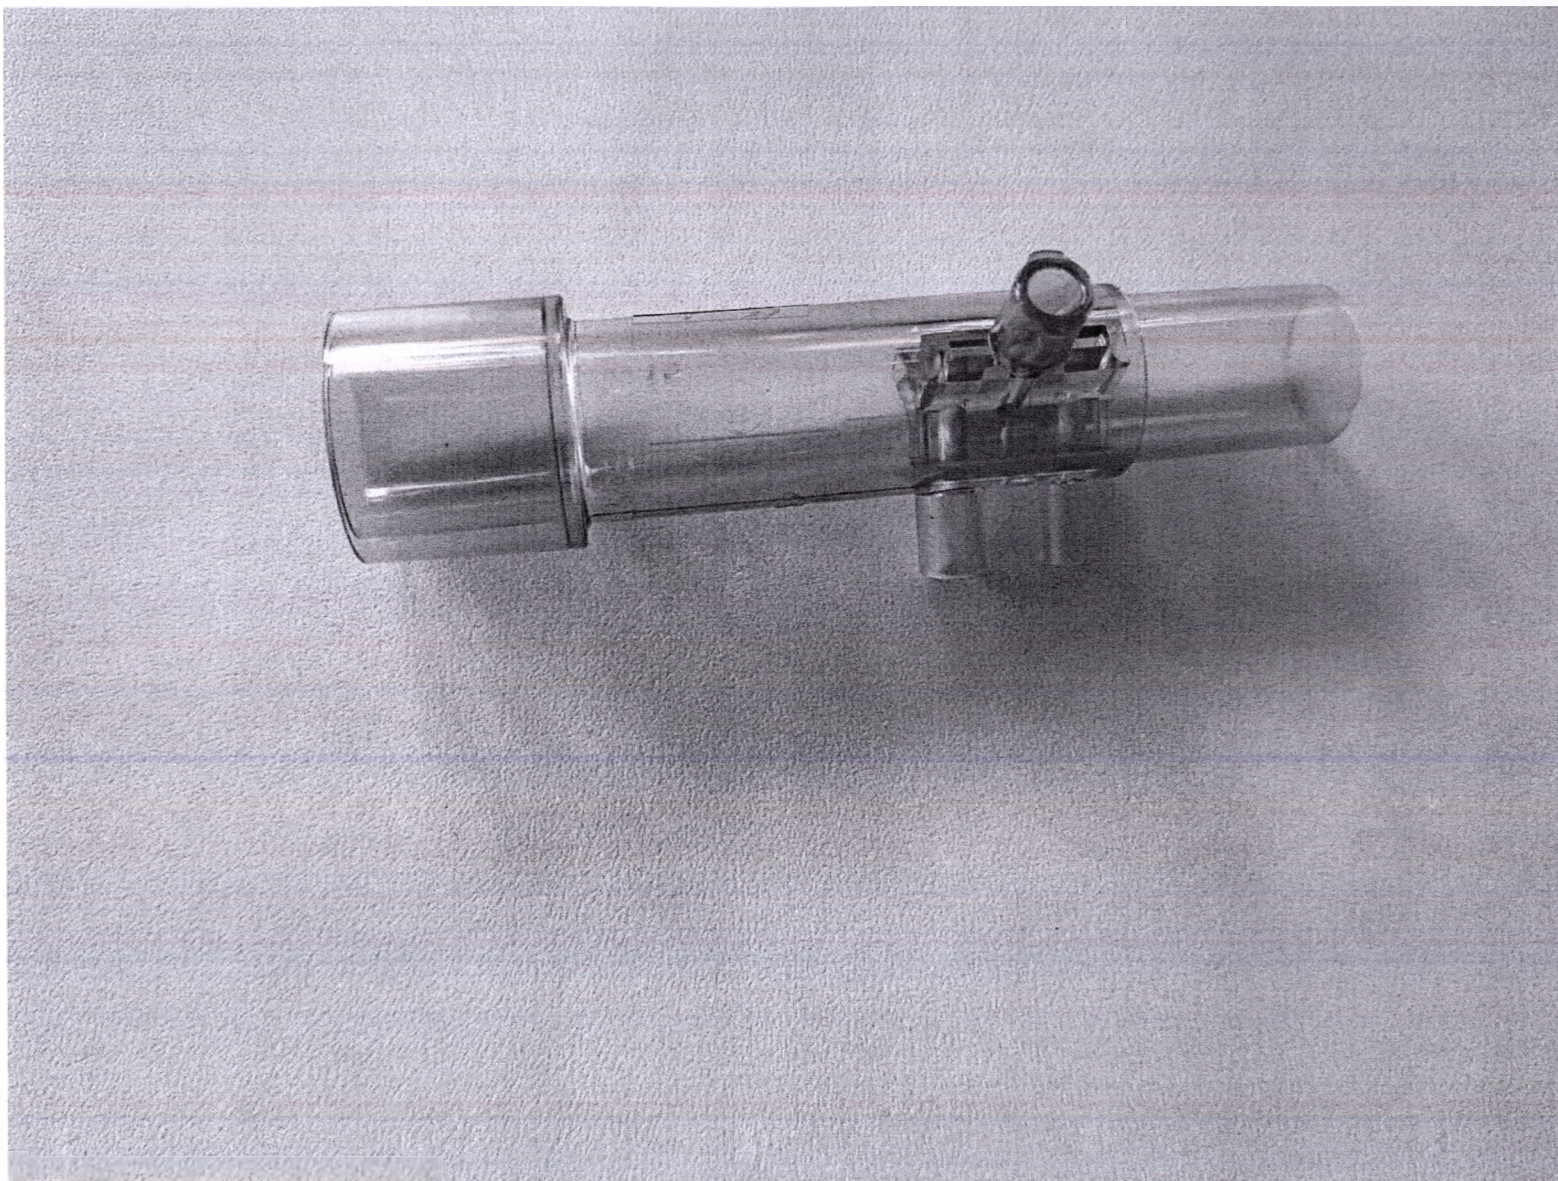


Датчик потока D-LITE

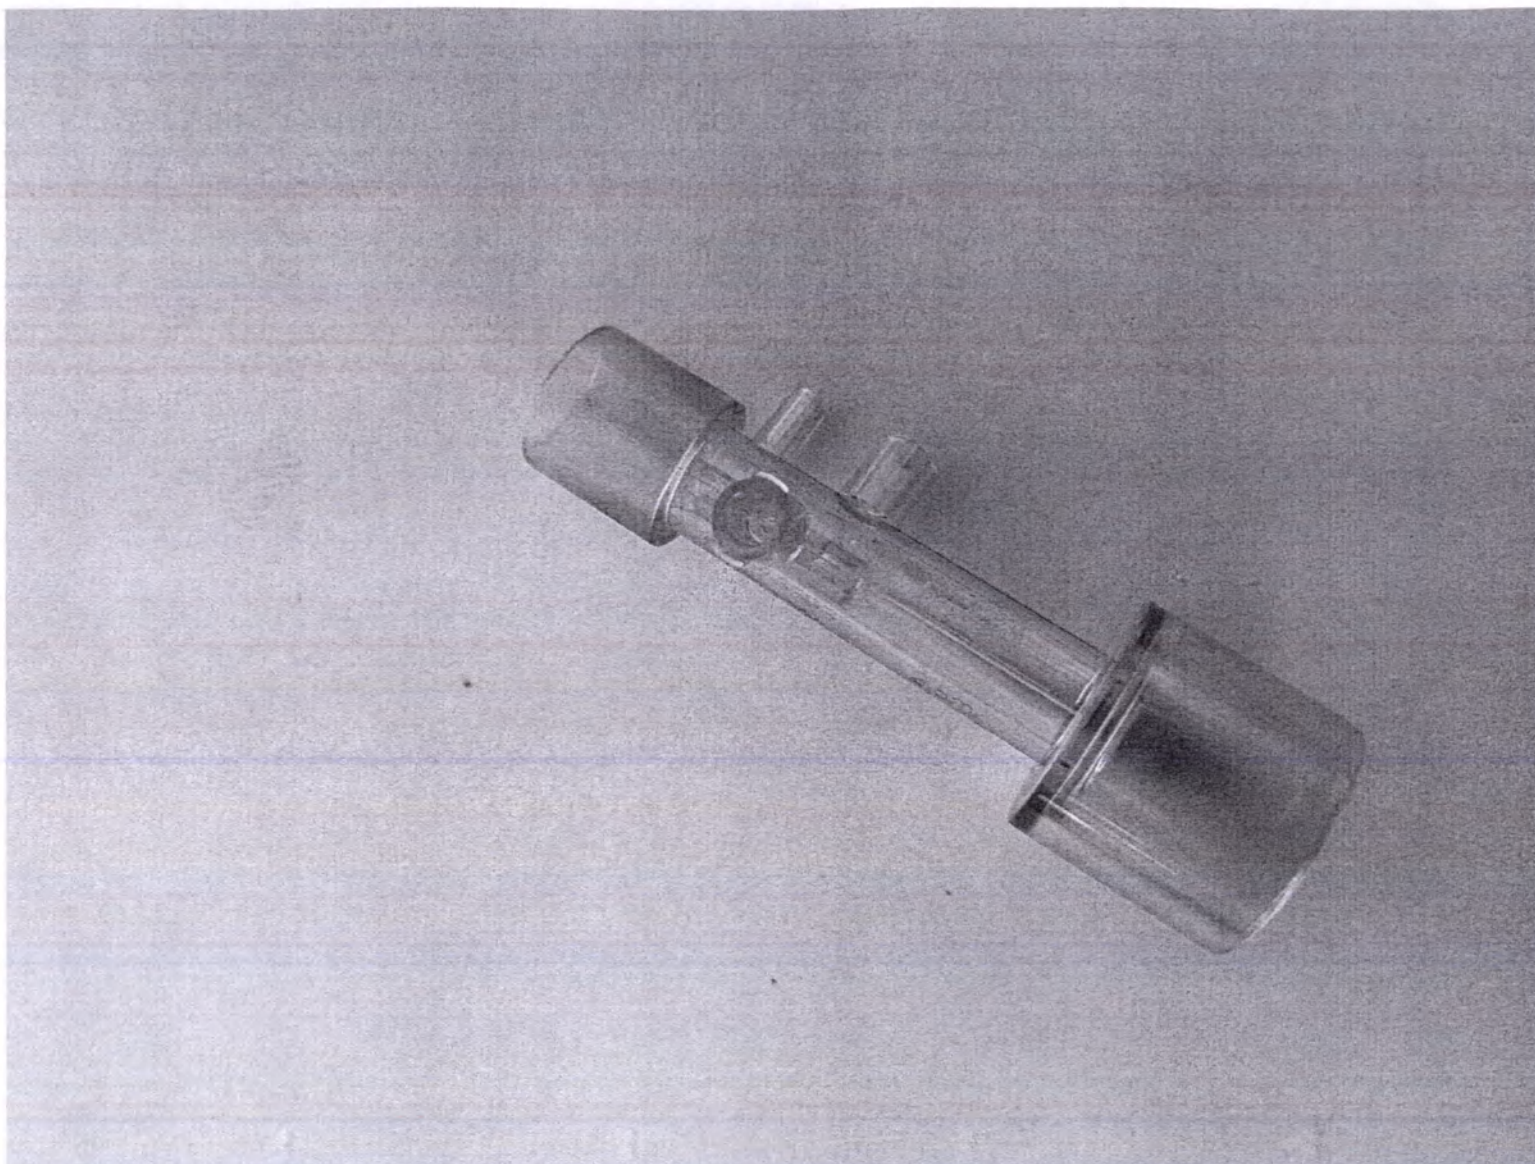


Датчик потока PEDI-LITE



Комплект переходников

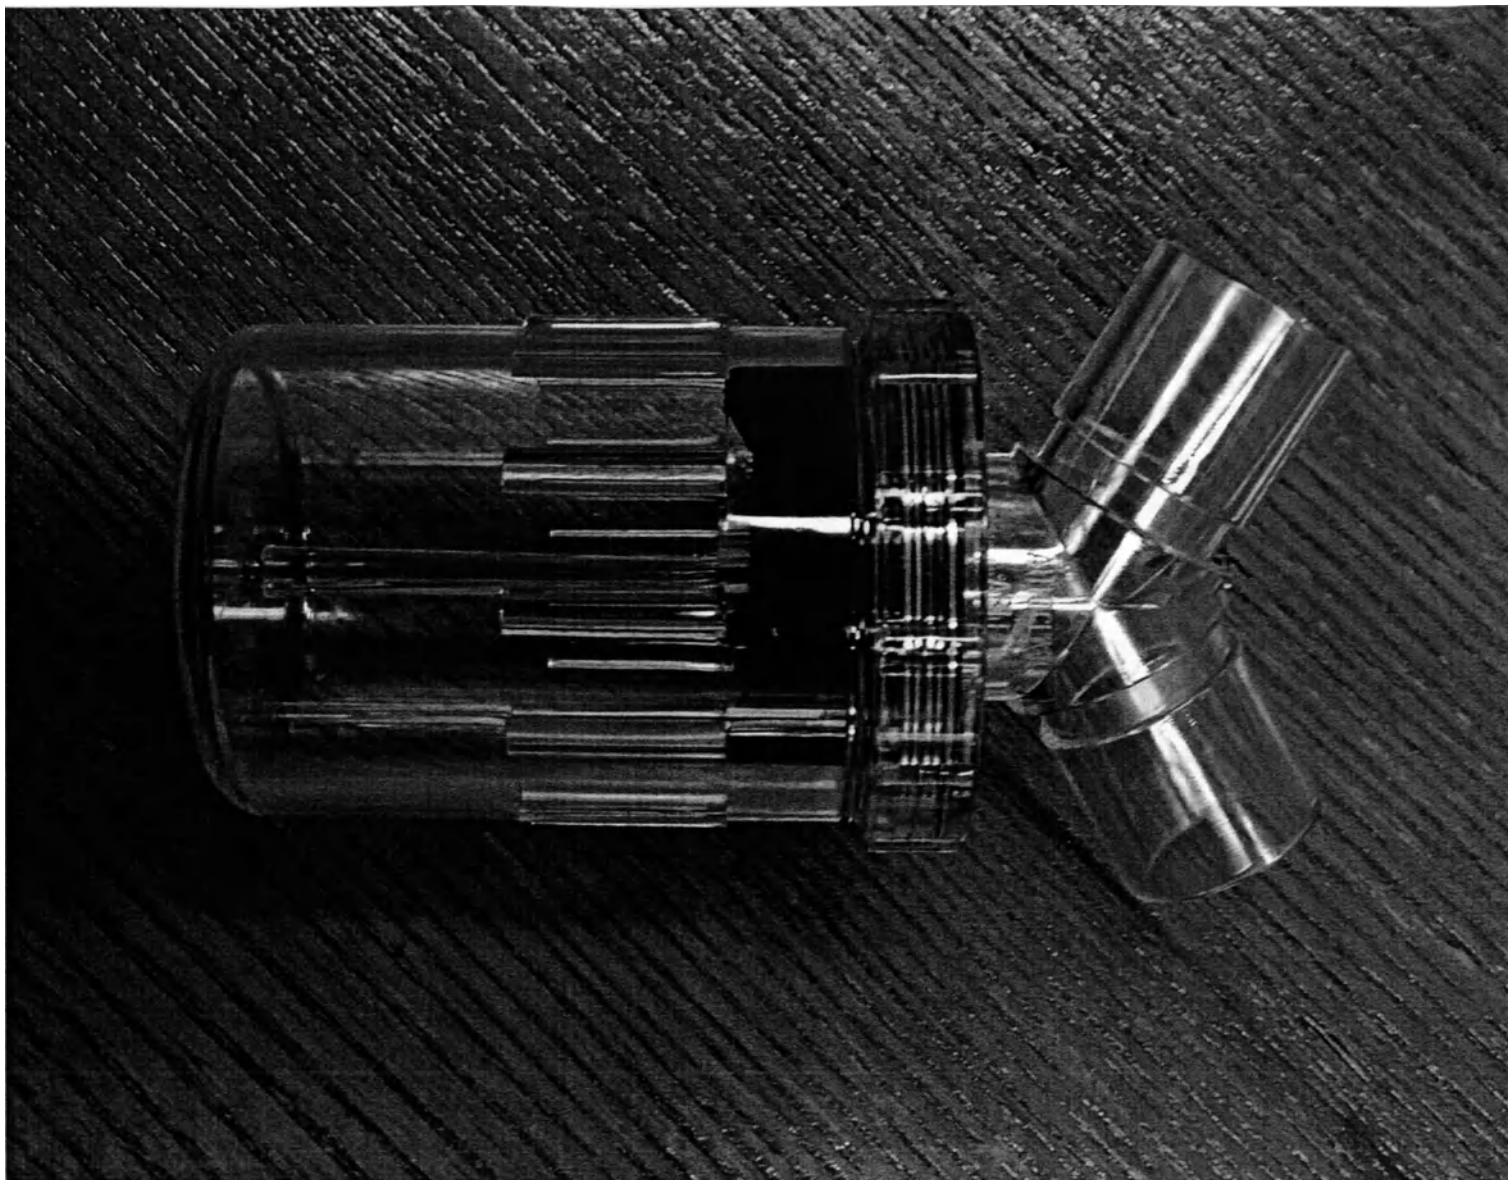

Влагосборник неонатальный

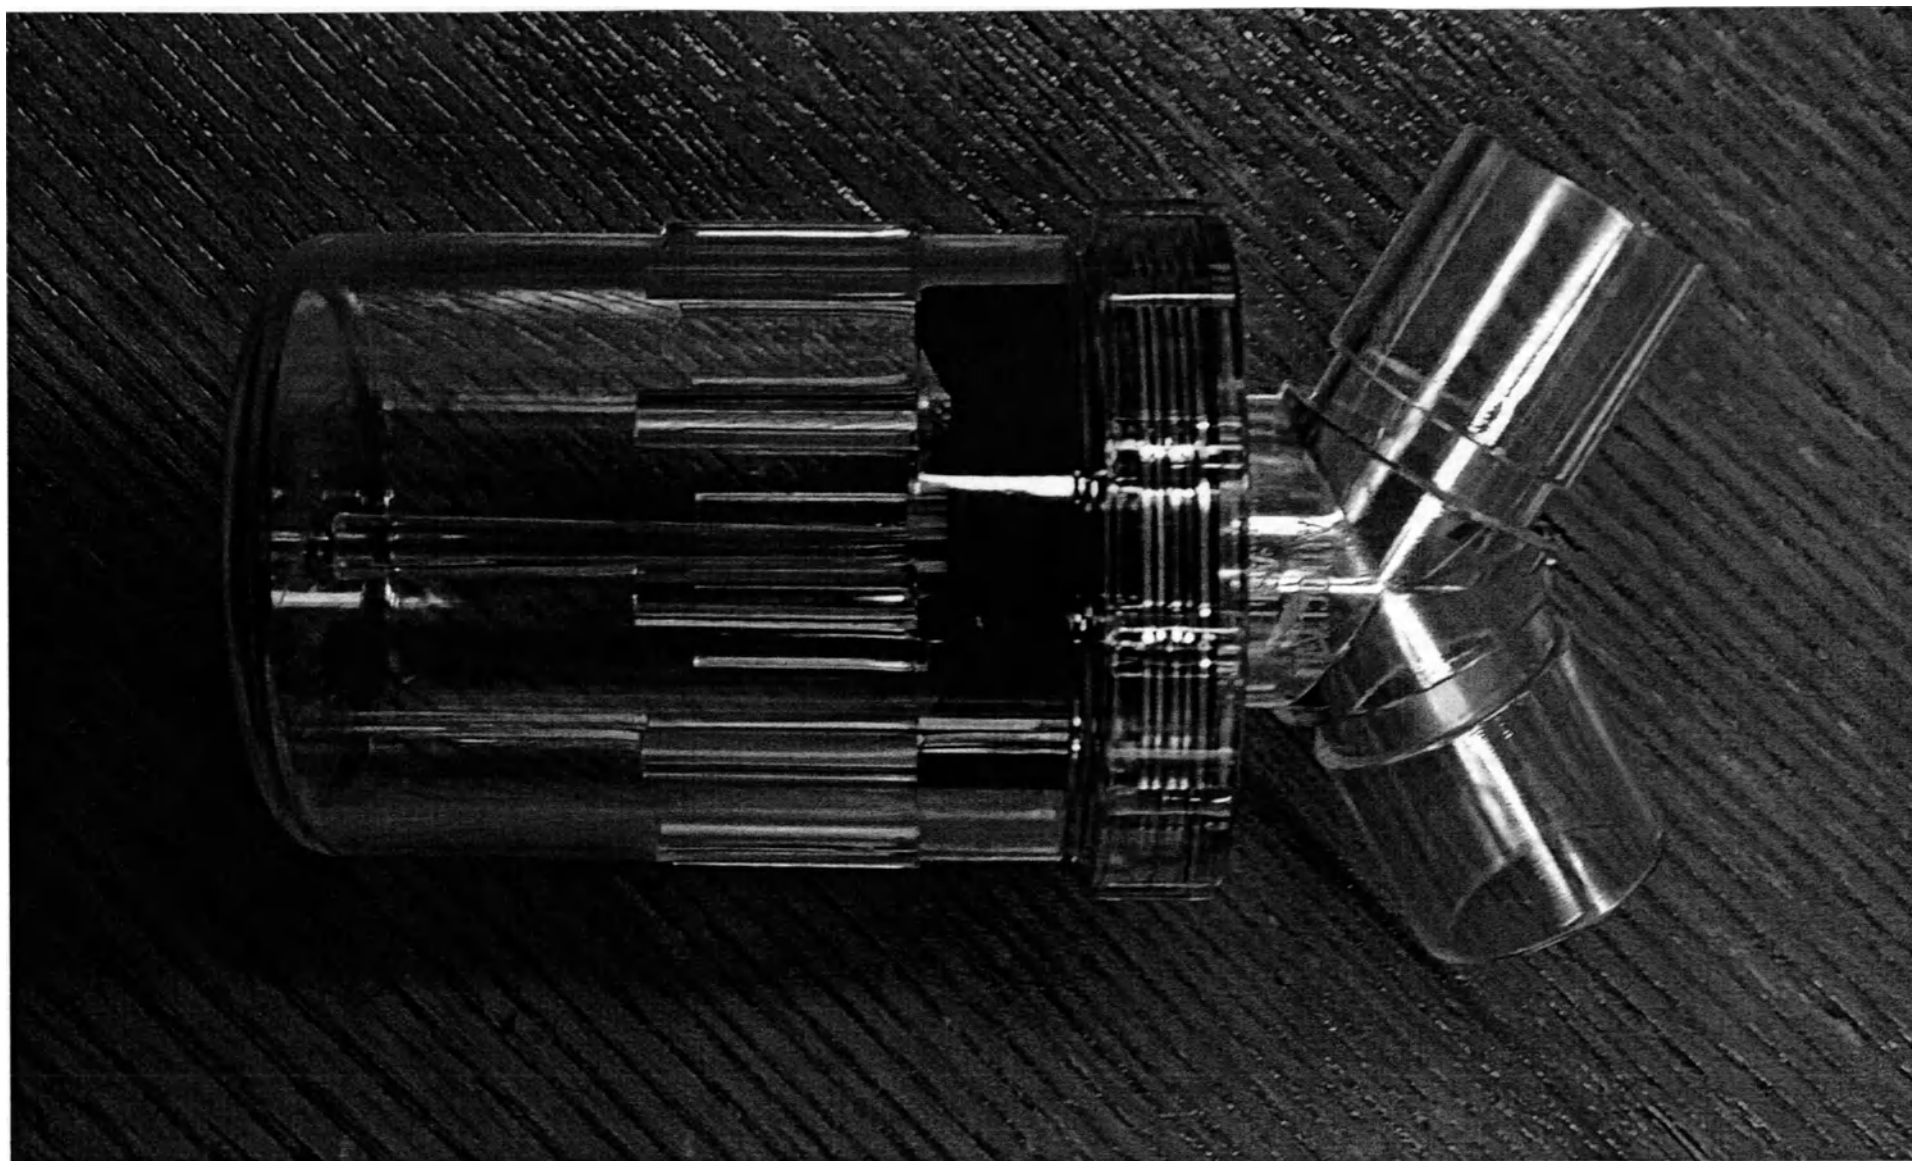

Влагосборник взрослый




Спирометрический шланг 2м




Спирометрический шланг 3м




Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

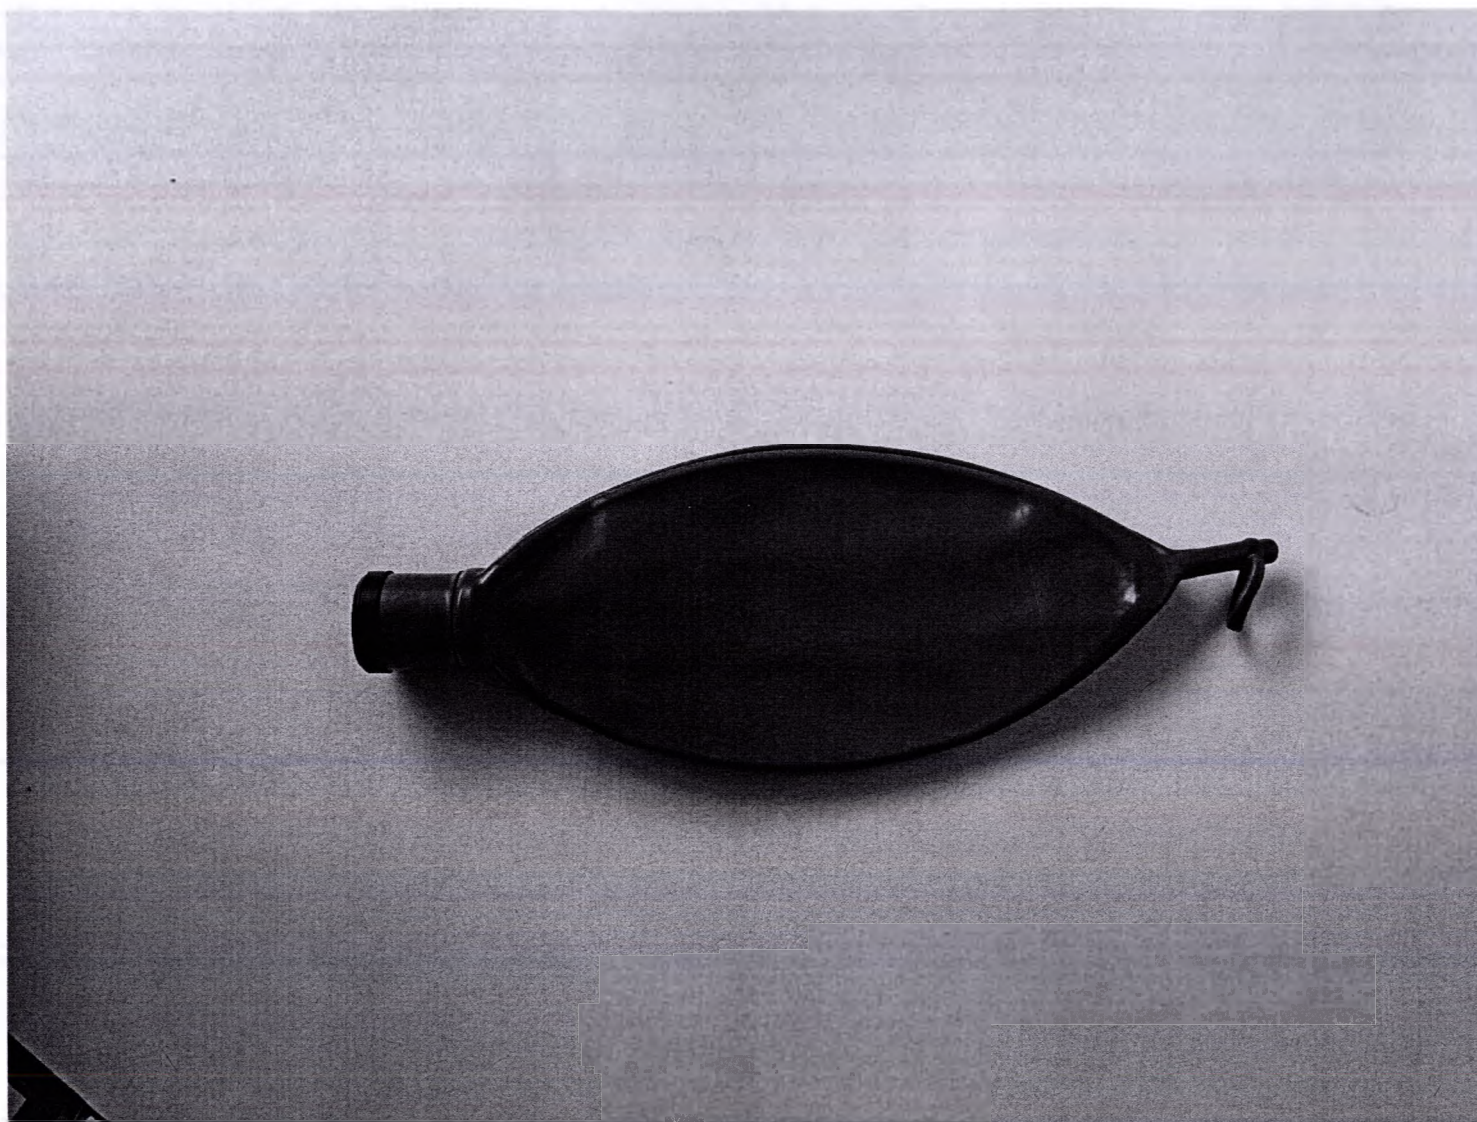


Дыхательные мешки объемом 1,0 л, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

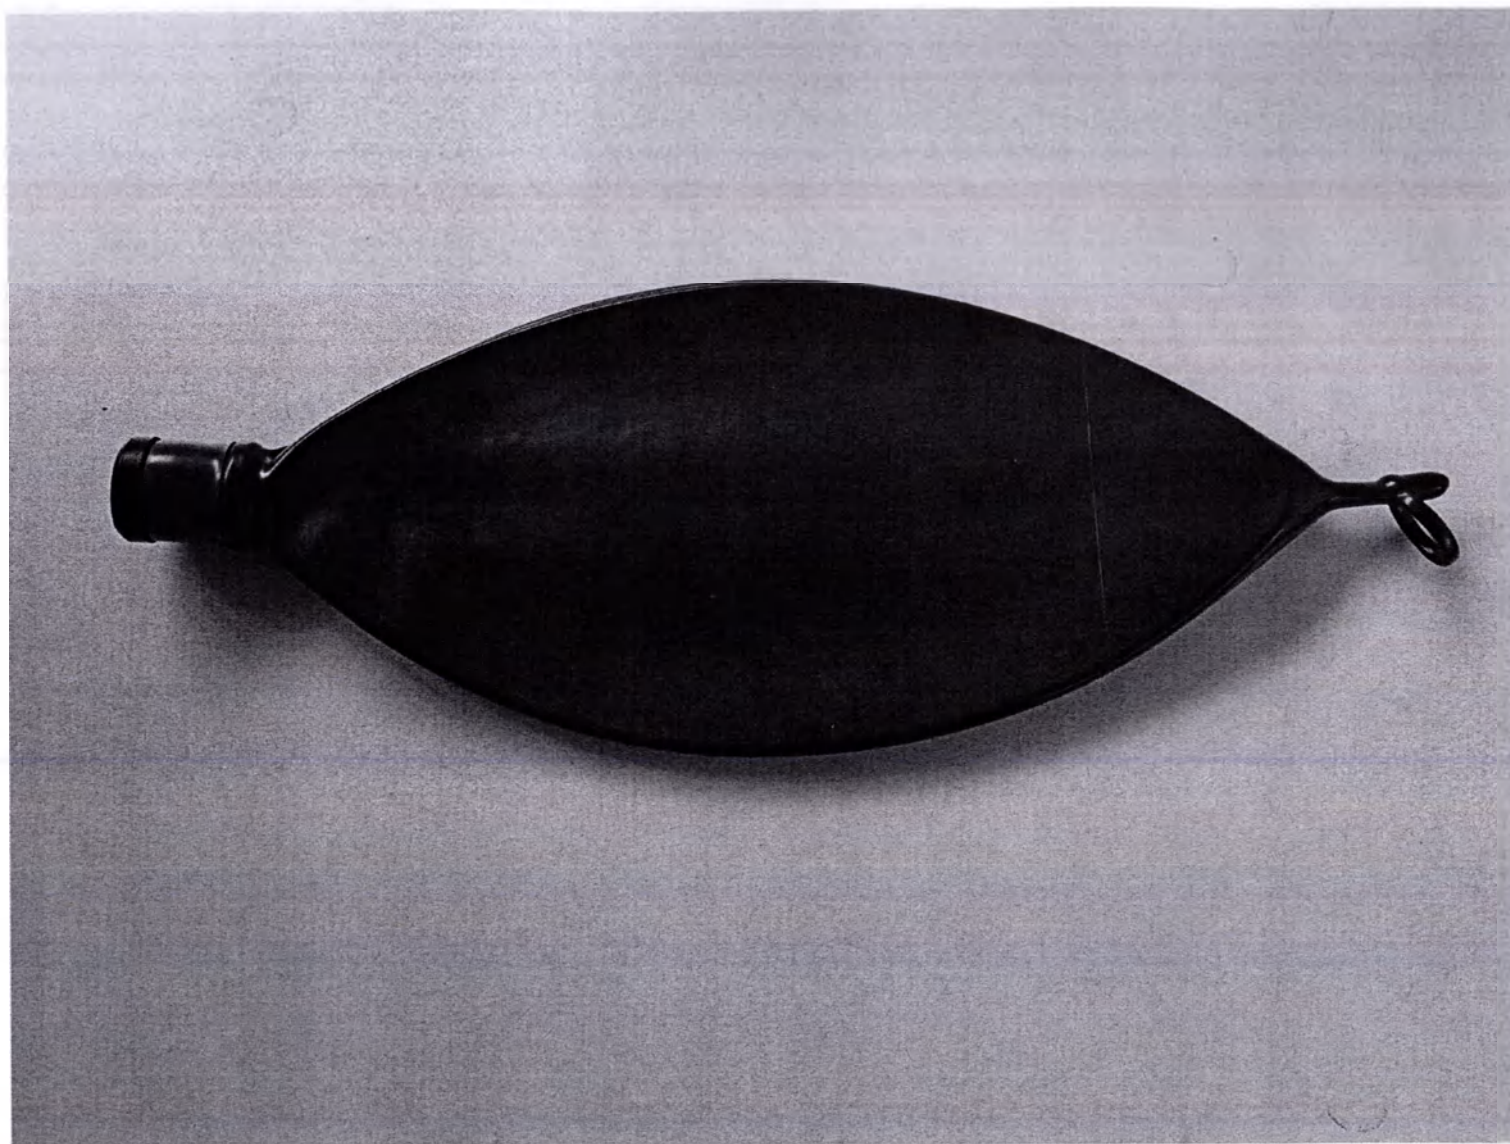


Дыхательные мешки объемом 3,0 л, Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03551 от 11.05.2011 г., производства «Intersurgical Ltd», (Великобритания)

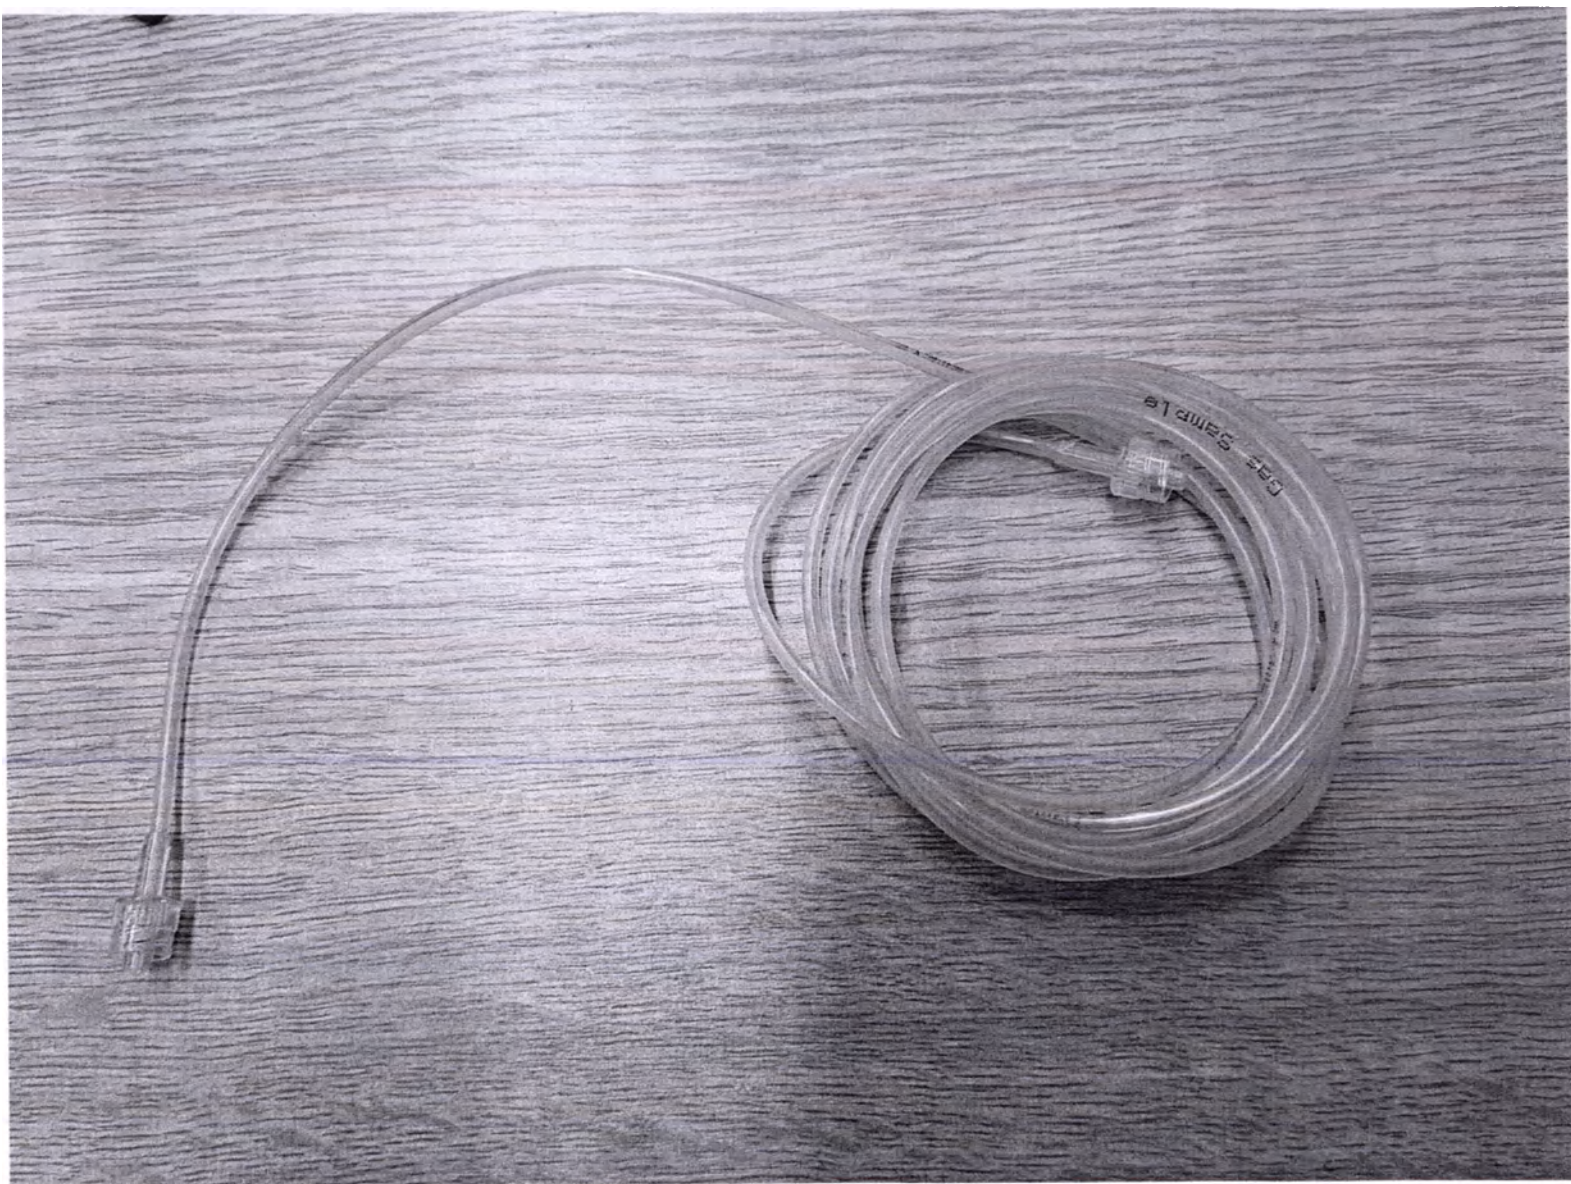


Шланг проб для взрослых 2,5 м

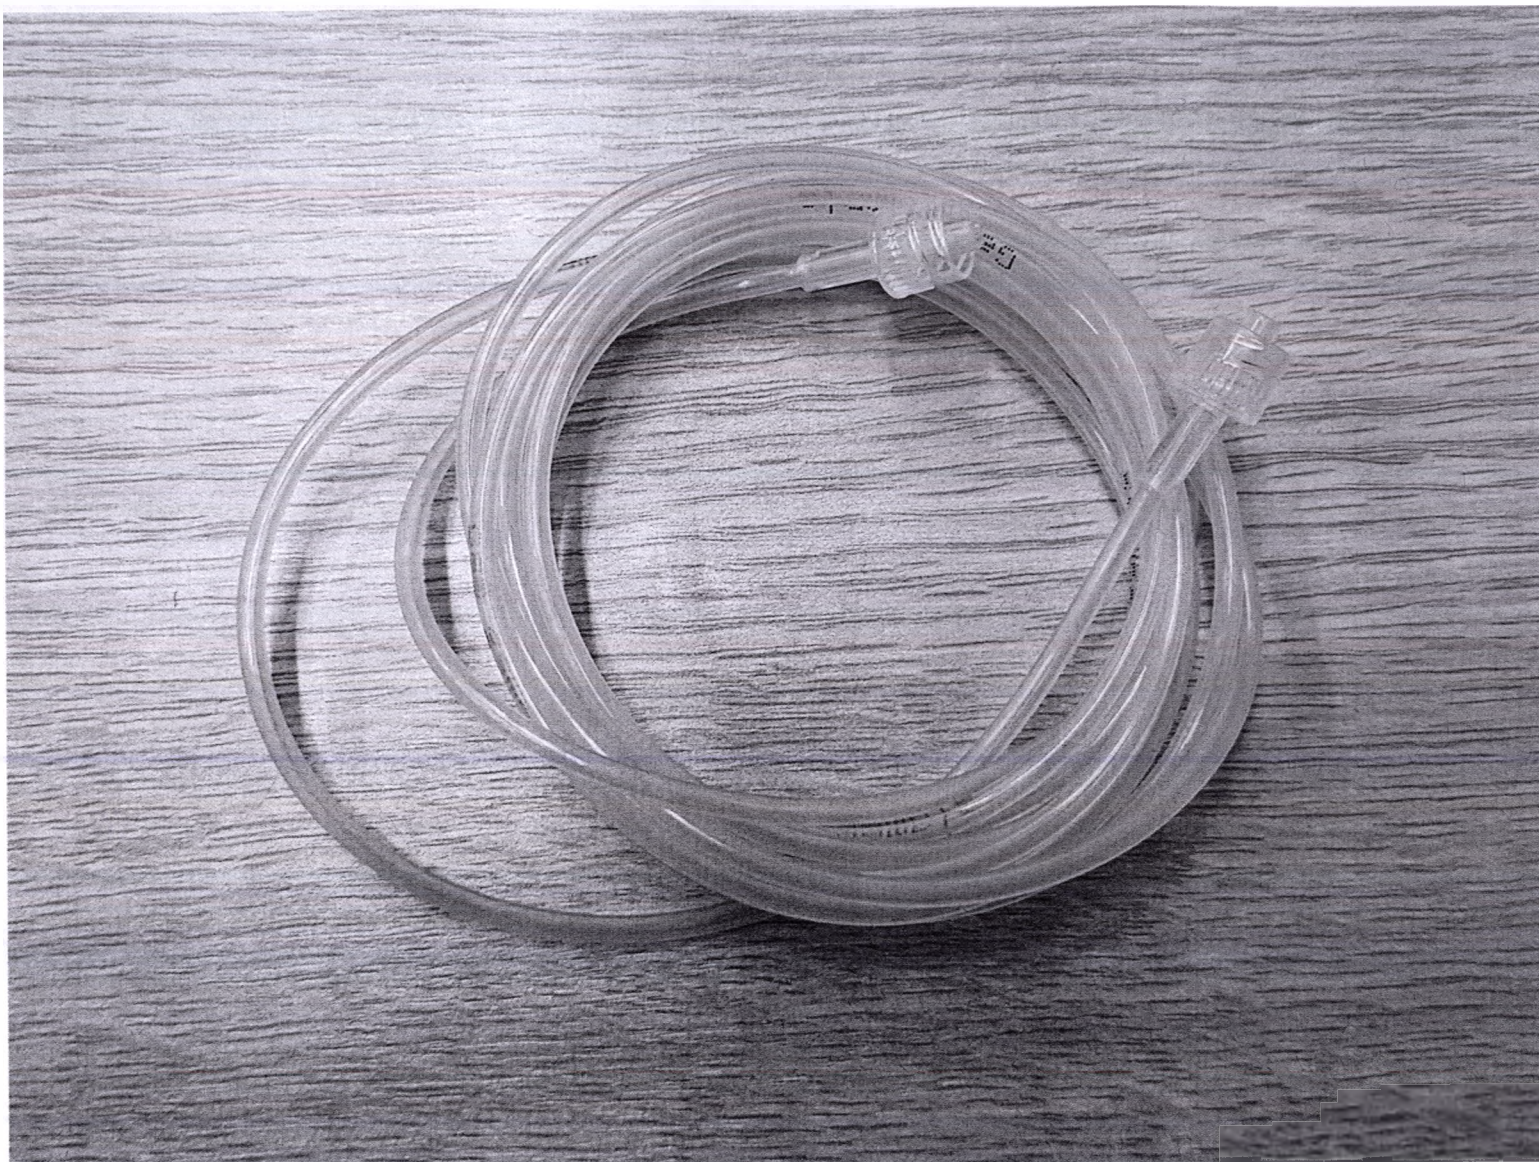

Шланг проб для детей 2,5 м

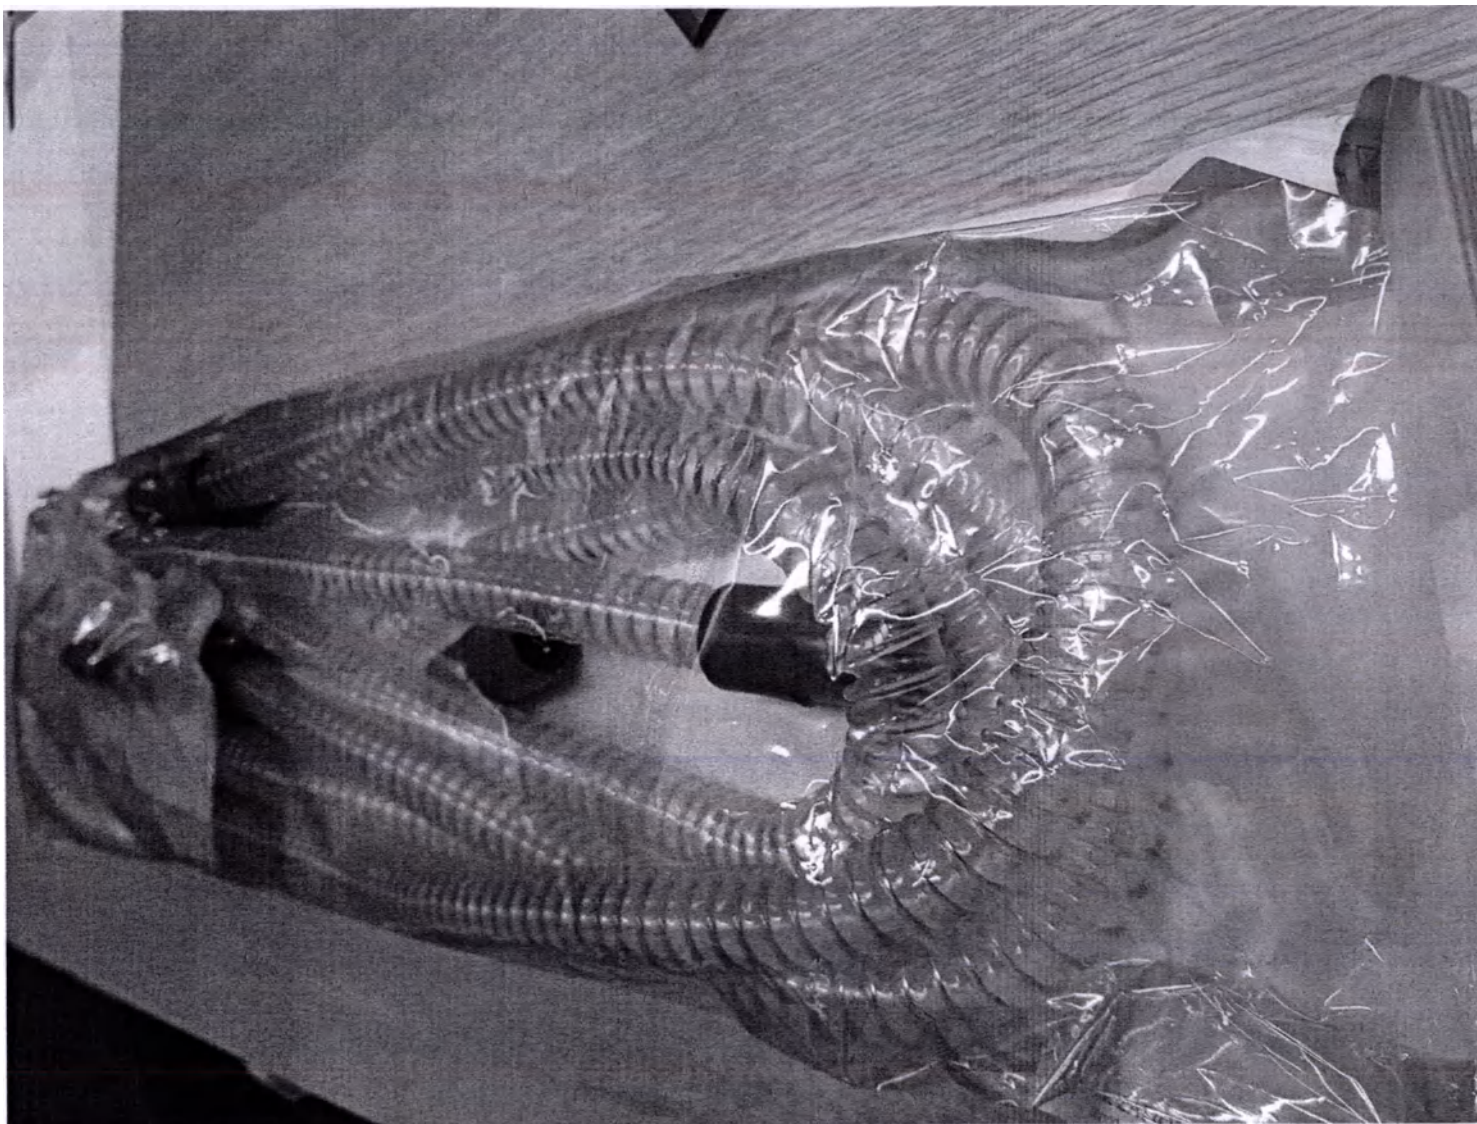

Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-«МС-1» по ТУ 9398-001-72474991-2005. регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07116 от 16.03.2010 г., производства ООО «Медсиликон», Россия

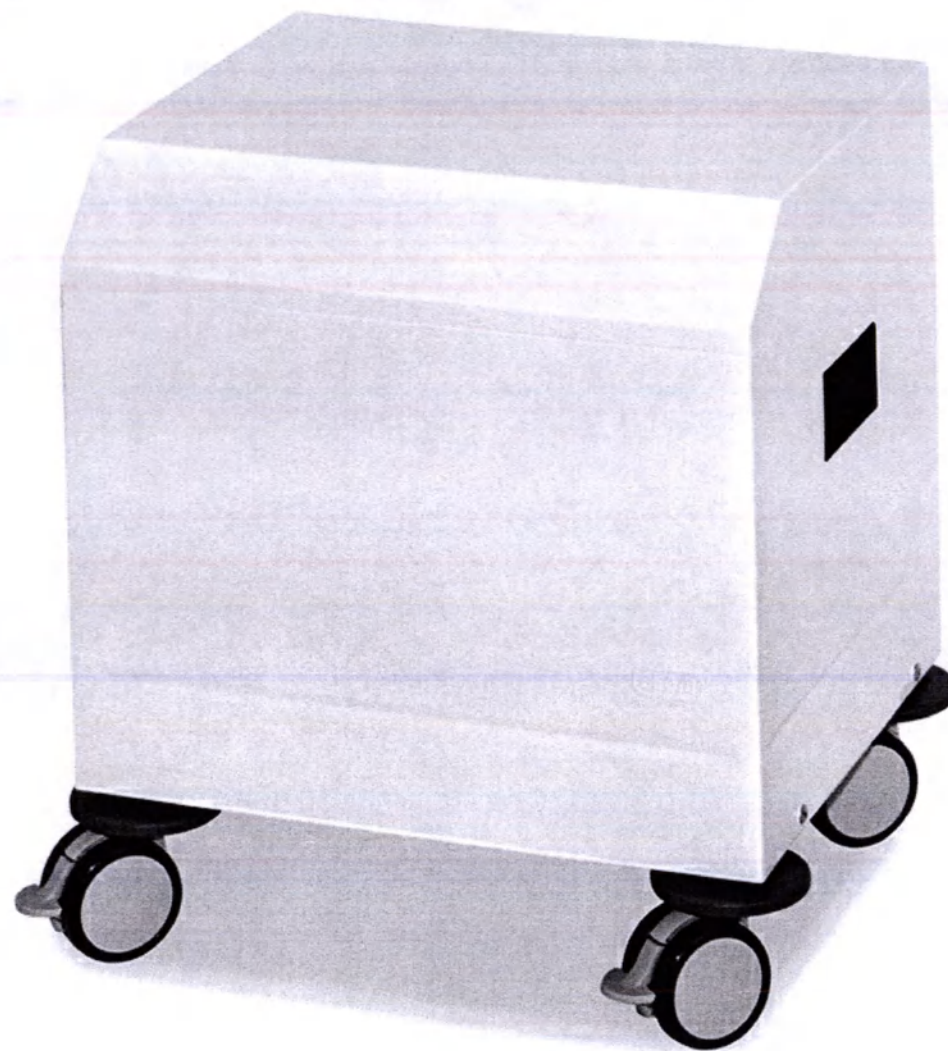

Компрессор ЕКОМ DK50DE рег. удостоверение № ФСЗ 2011/10543 от 13.09.2011г



Кабель сетевой



Chirana


Аппарат искусственной вентиляции лёгких

Chirolog SV AURA Profi


по ТУ 32.50.21-002-04569240-2018

Руководство по обслуживанию

Принадлежности

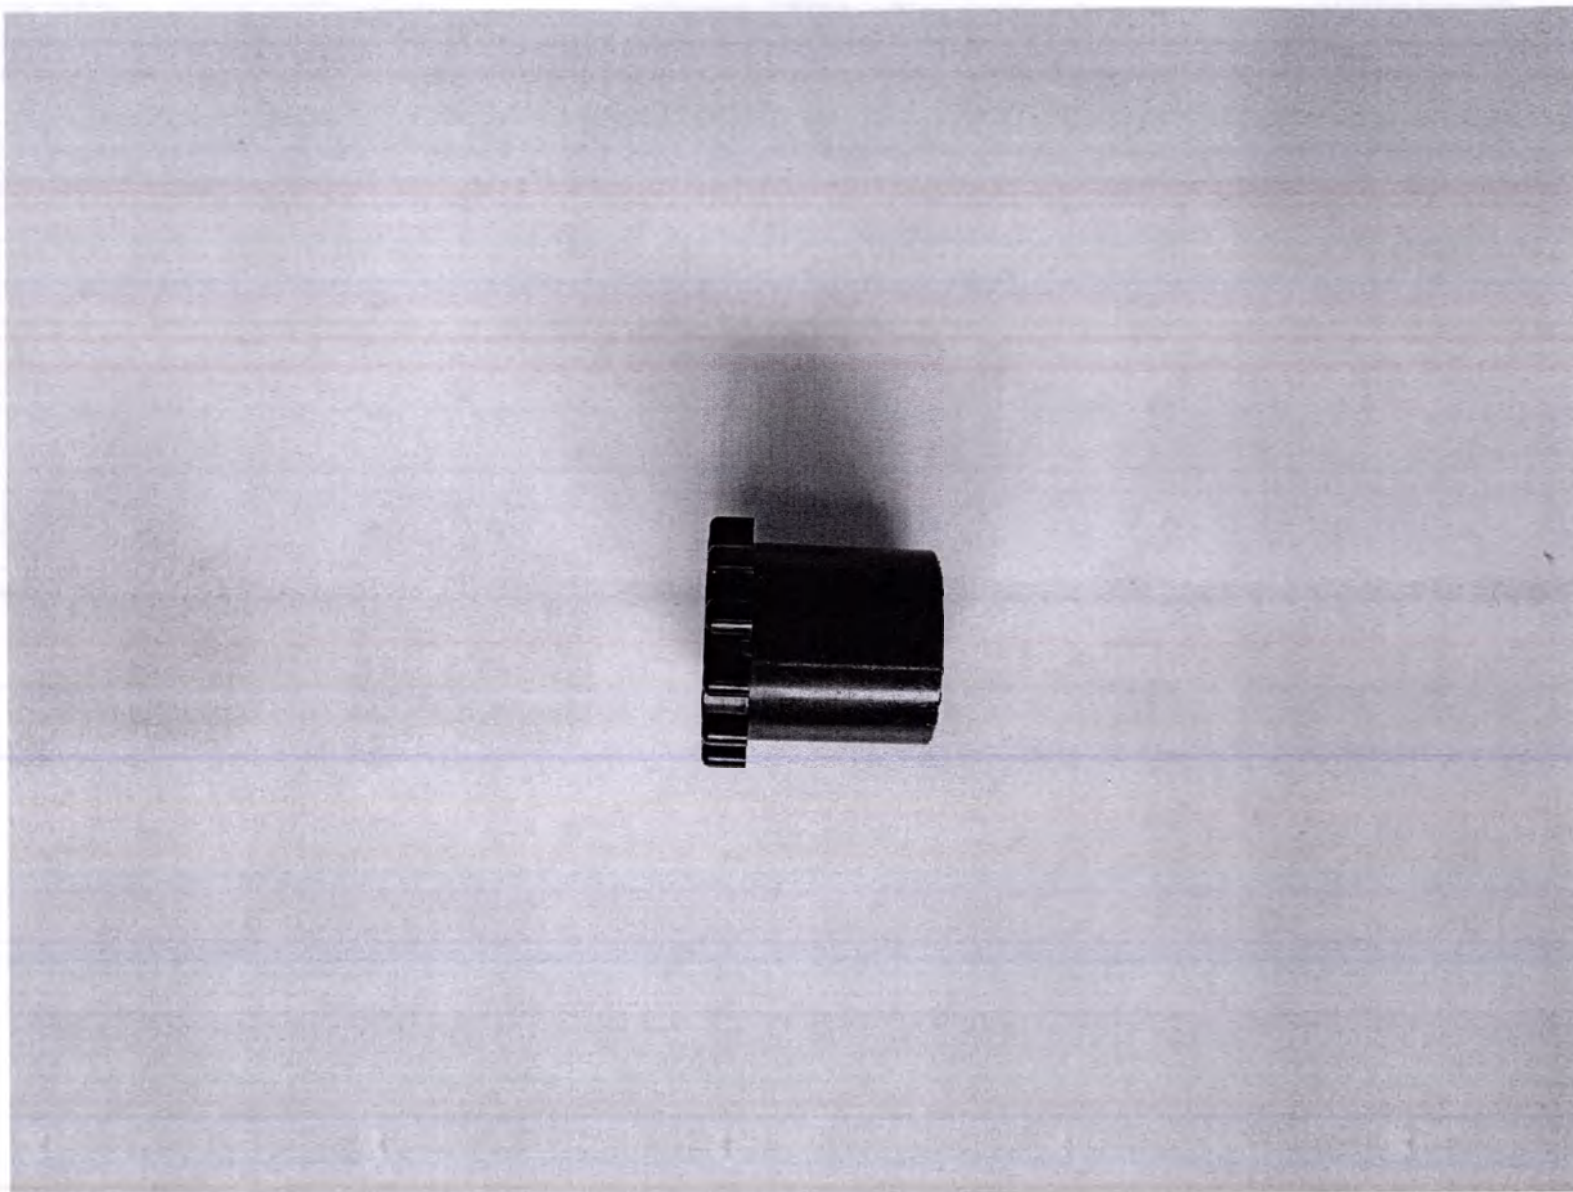


Пробка пластиковая 22F

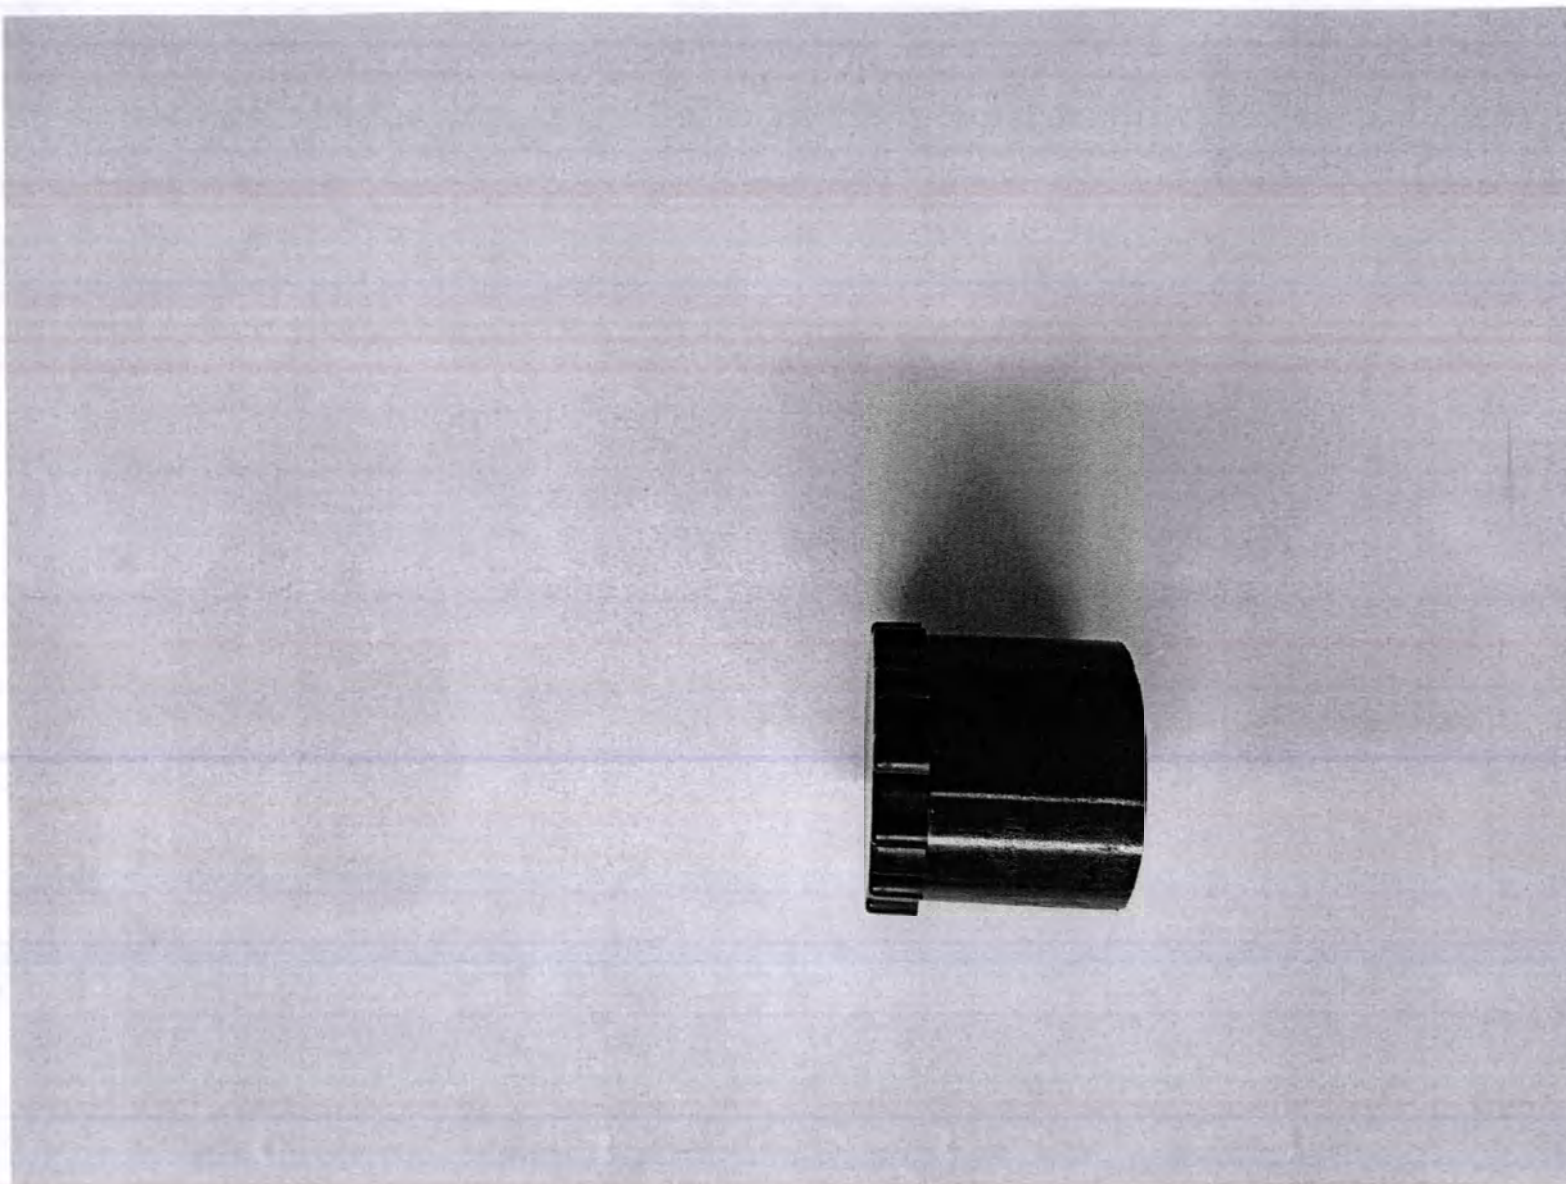


Пробка пластиковая 22М




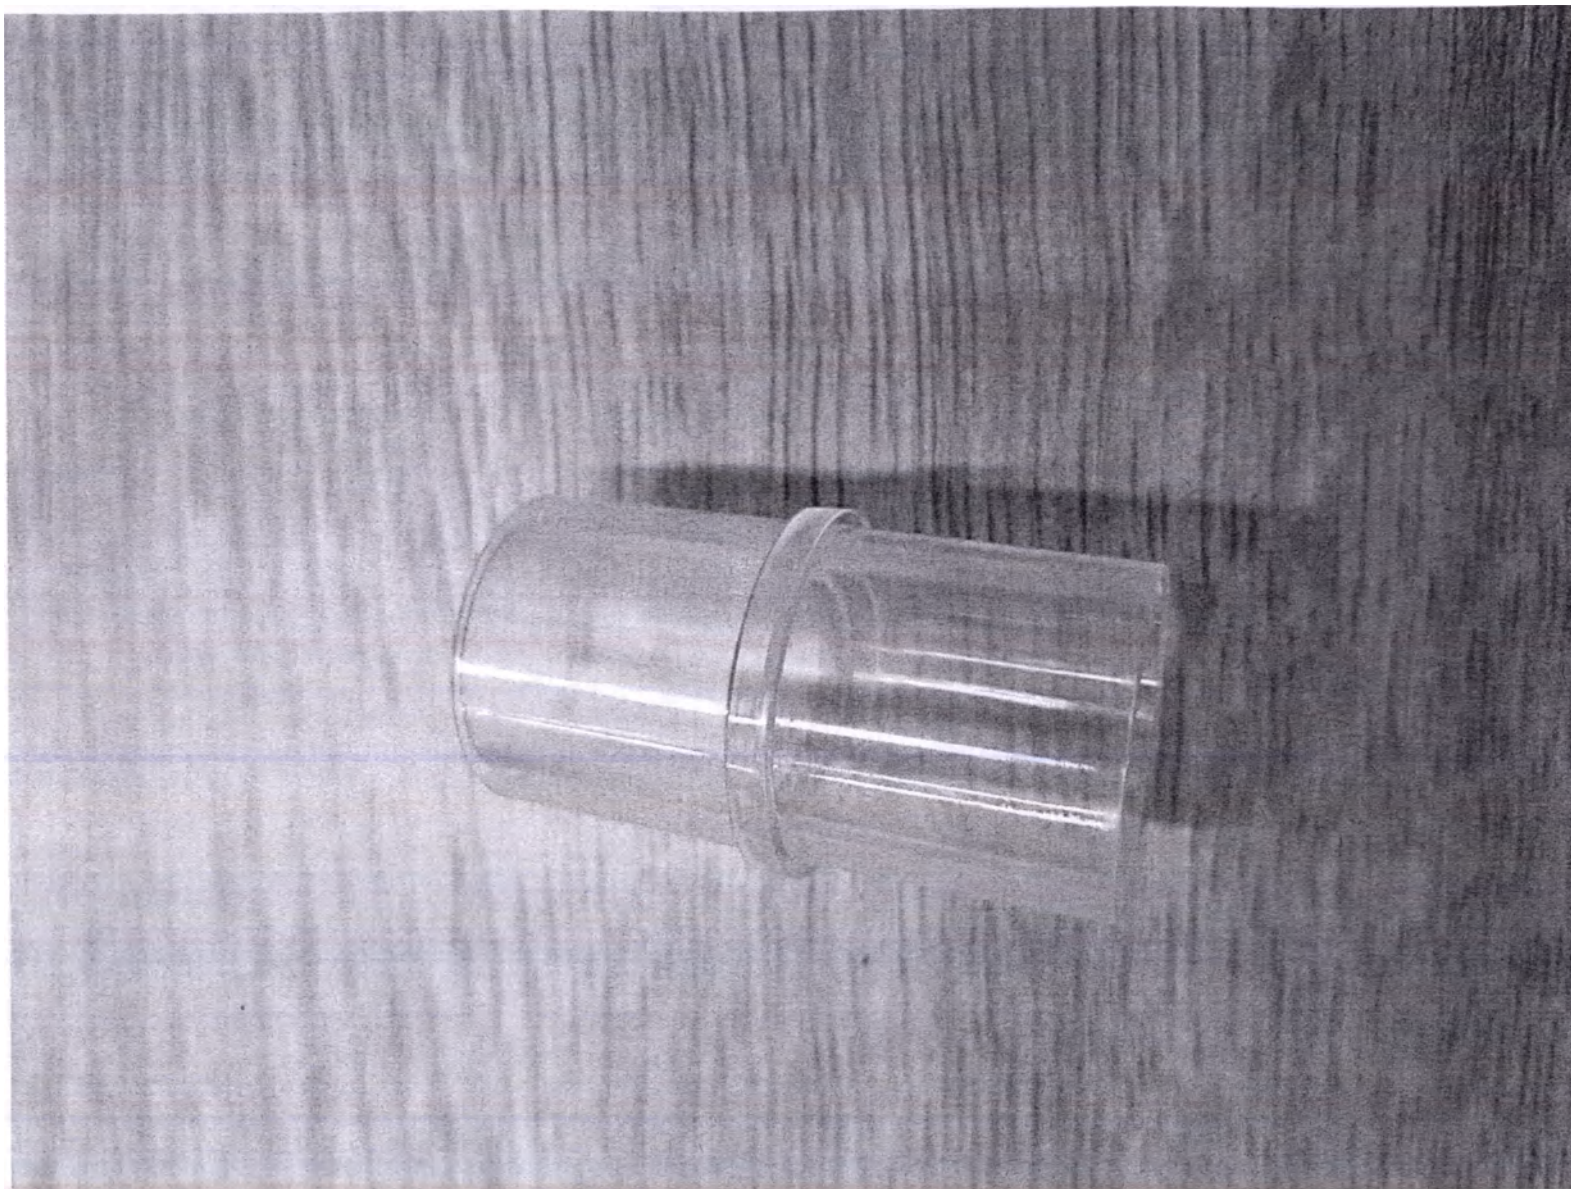

Адаптер Р20

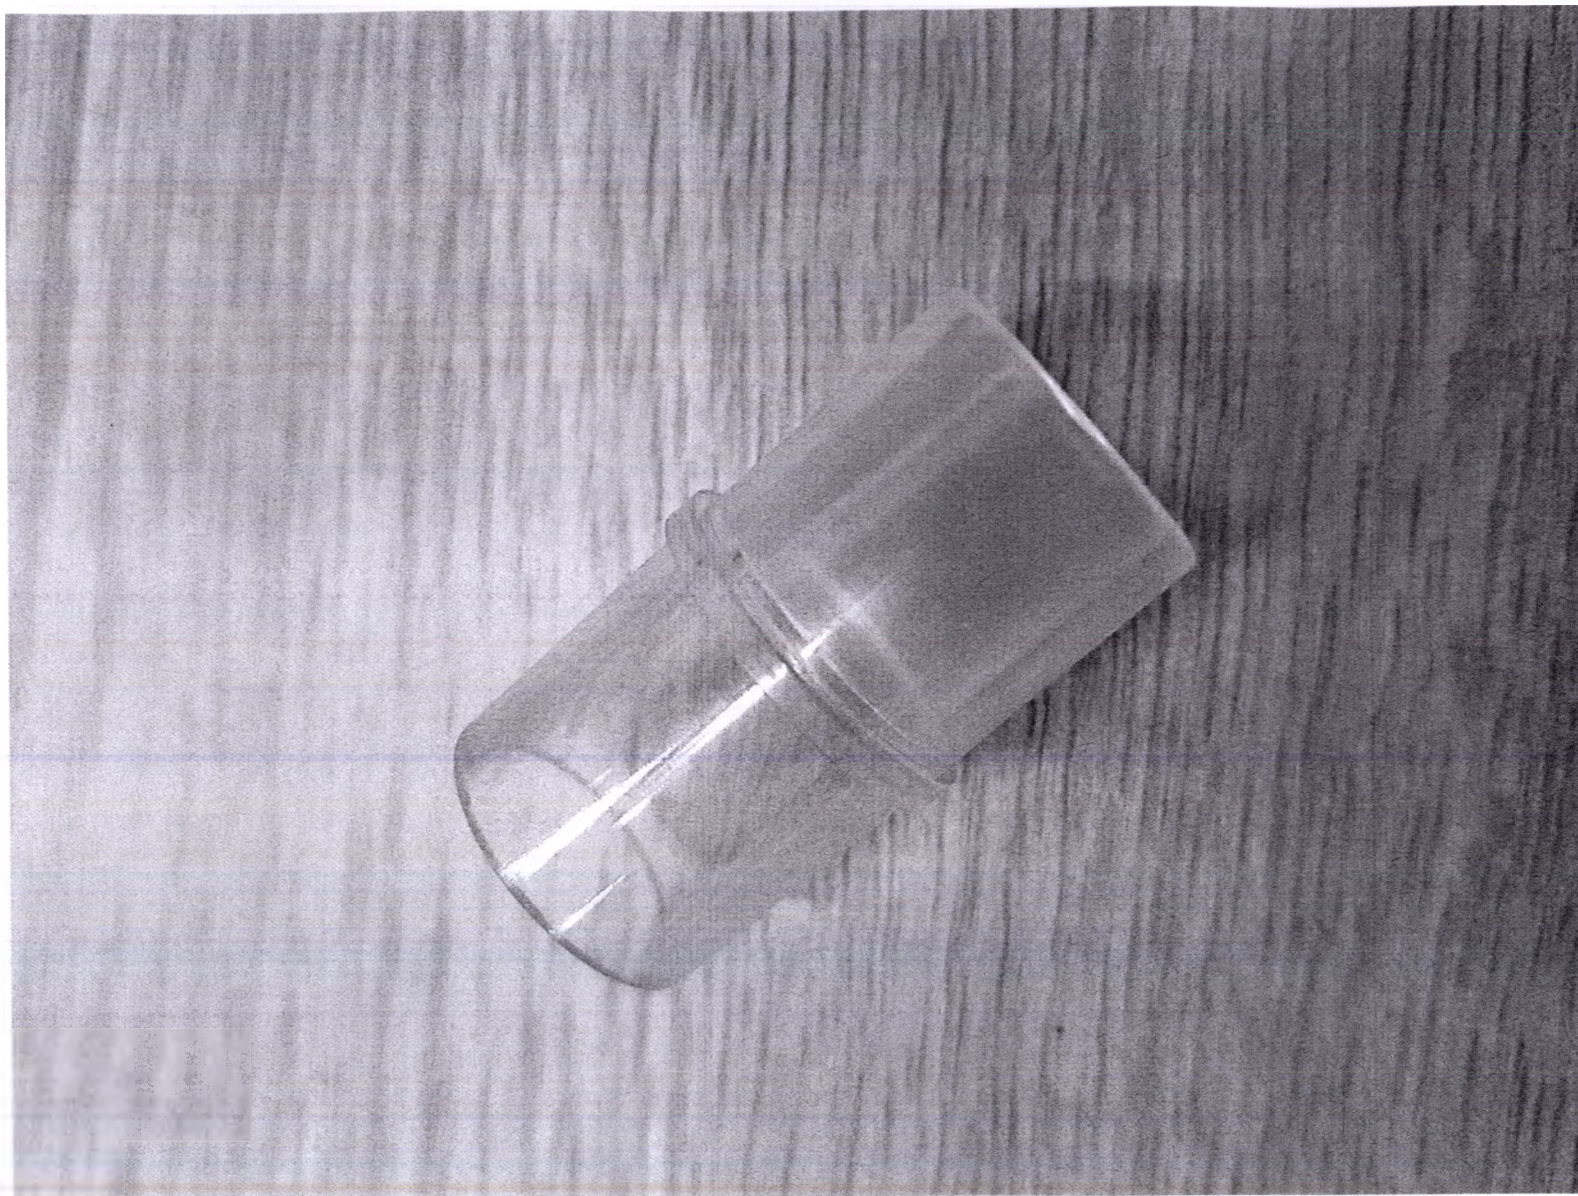


Адаптер 30F/22М

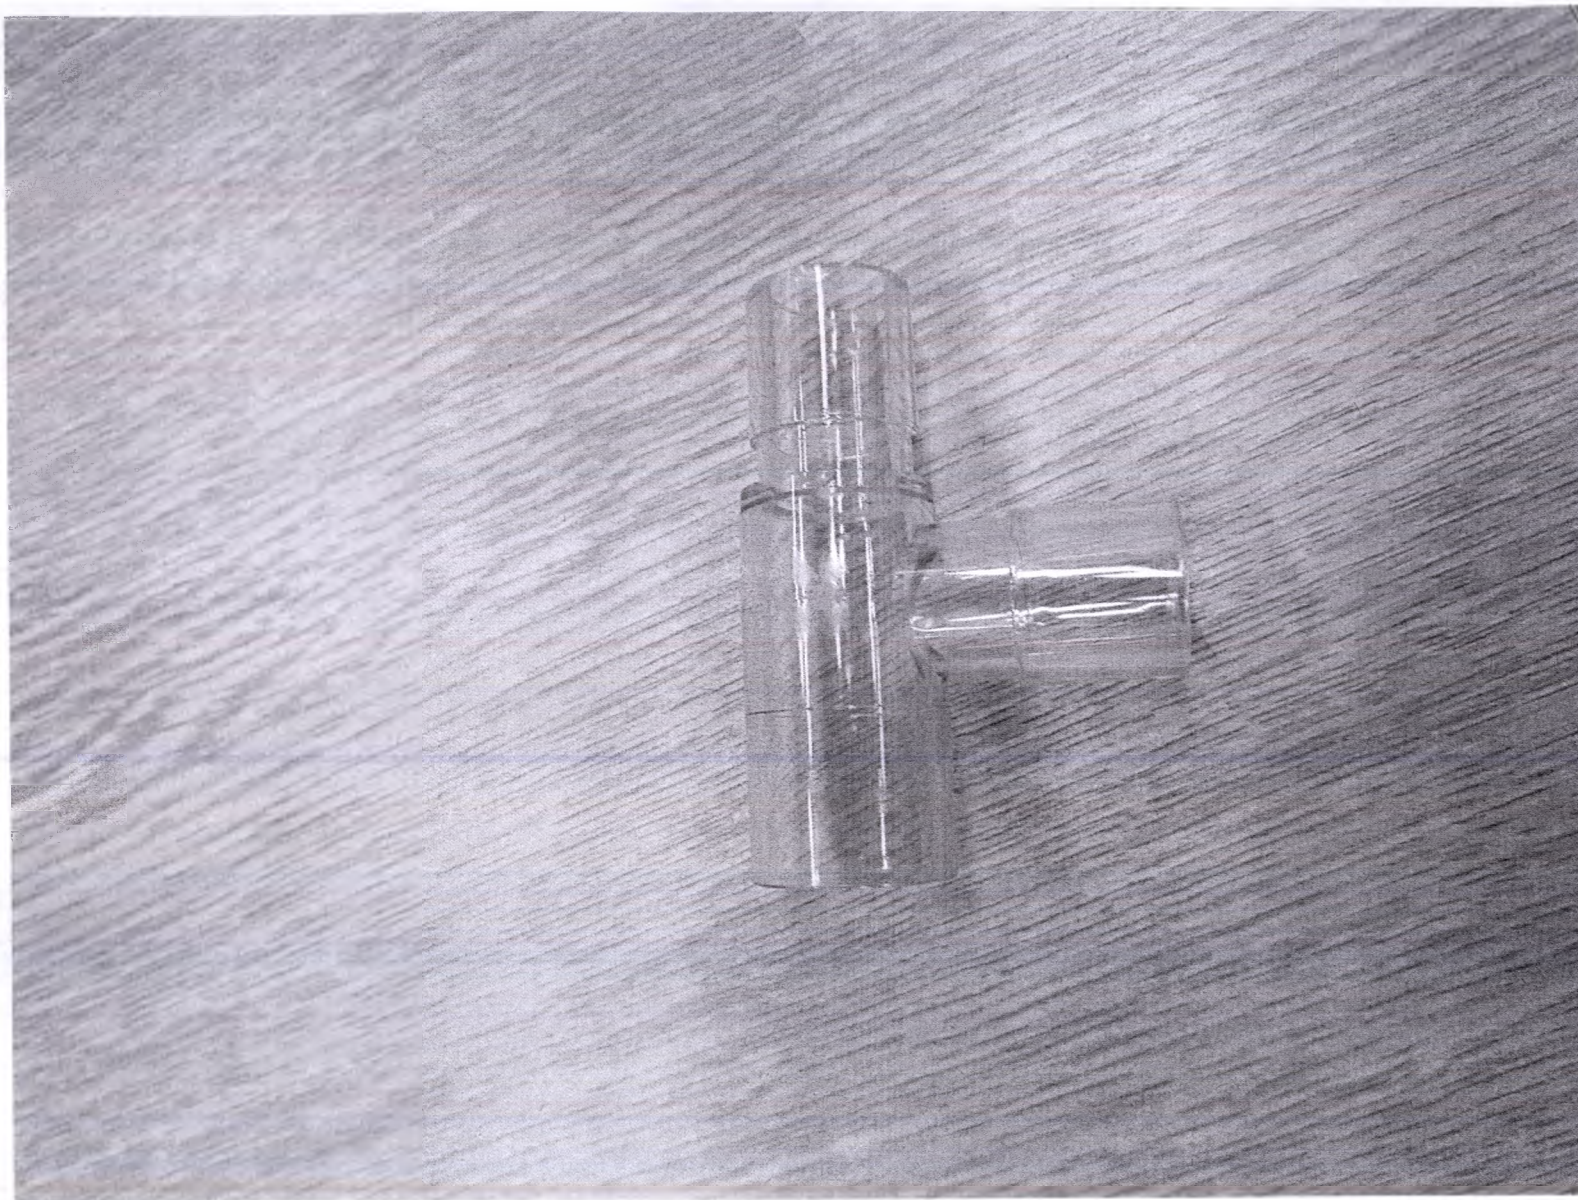

Т – образный тройник 2М/1F



Коммуникационный кабель LAN



Коммуникационный кабель RS- 232

