

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.


« 05 » октября 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТА МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Наконечник эндодонтический со встроенным апекслокатором Tri Auto ZX2
(TR-ZX2) с принадлежностями.**


Производства J. MORITA MFG. CORP.,

адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Япония.

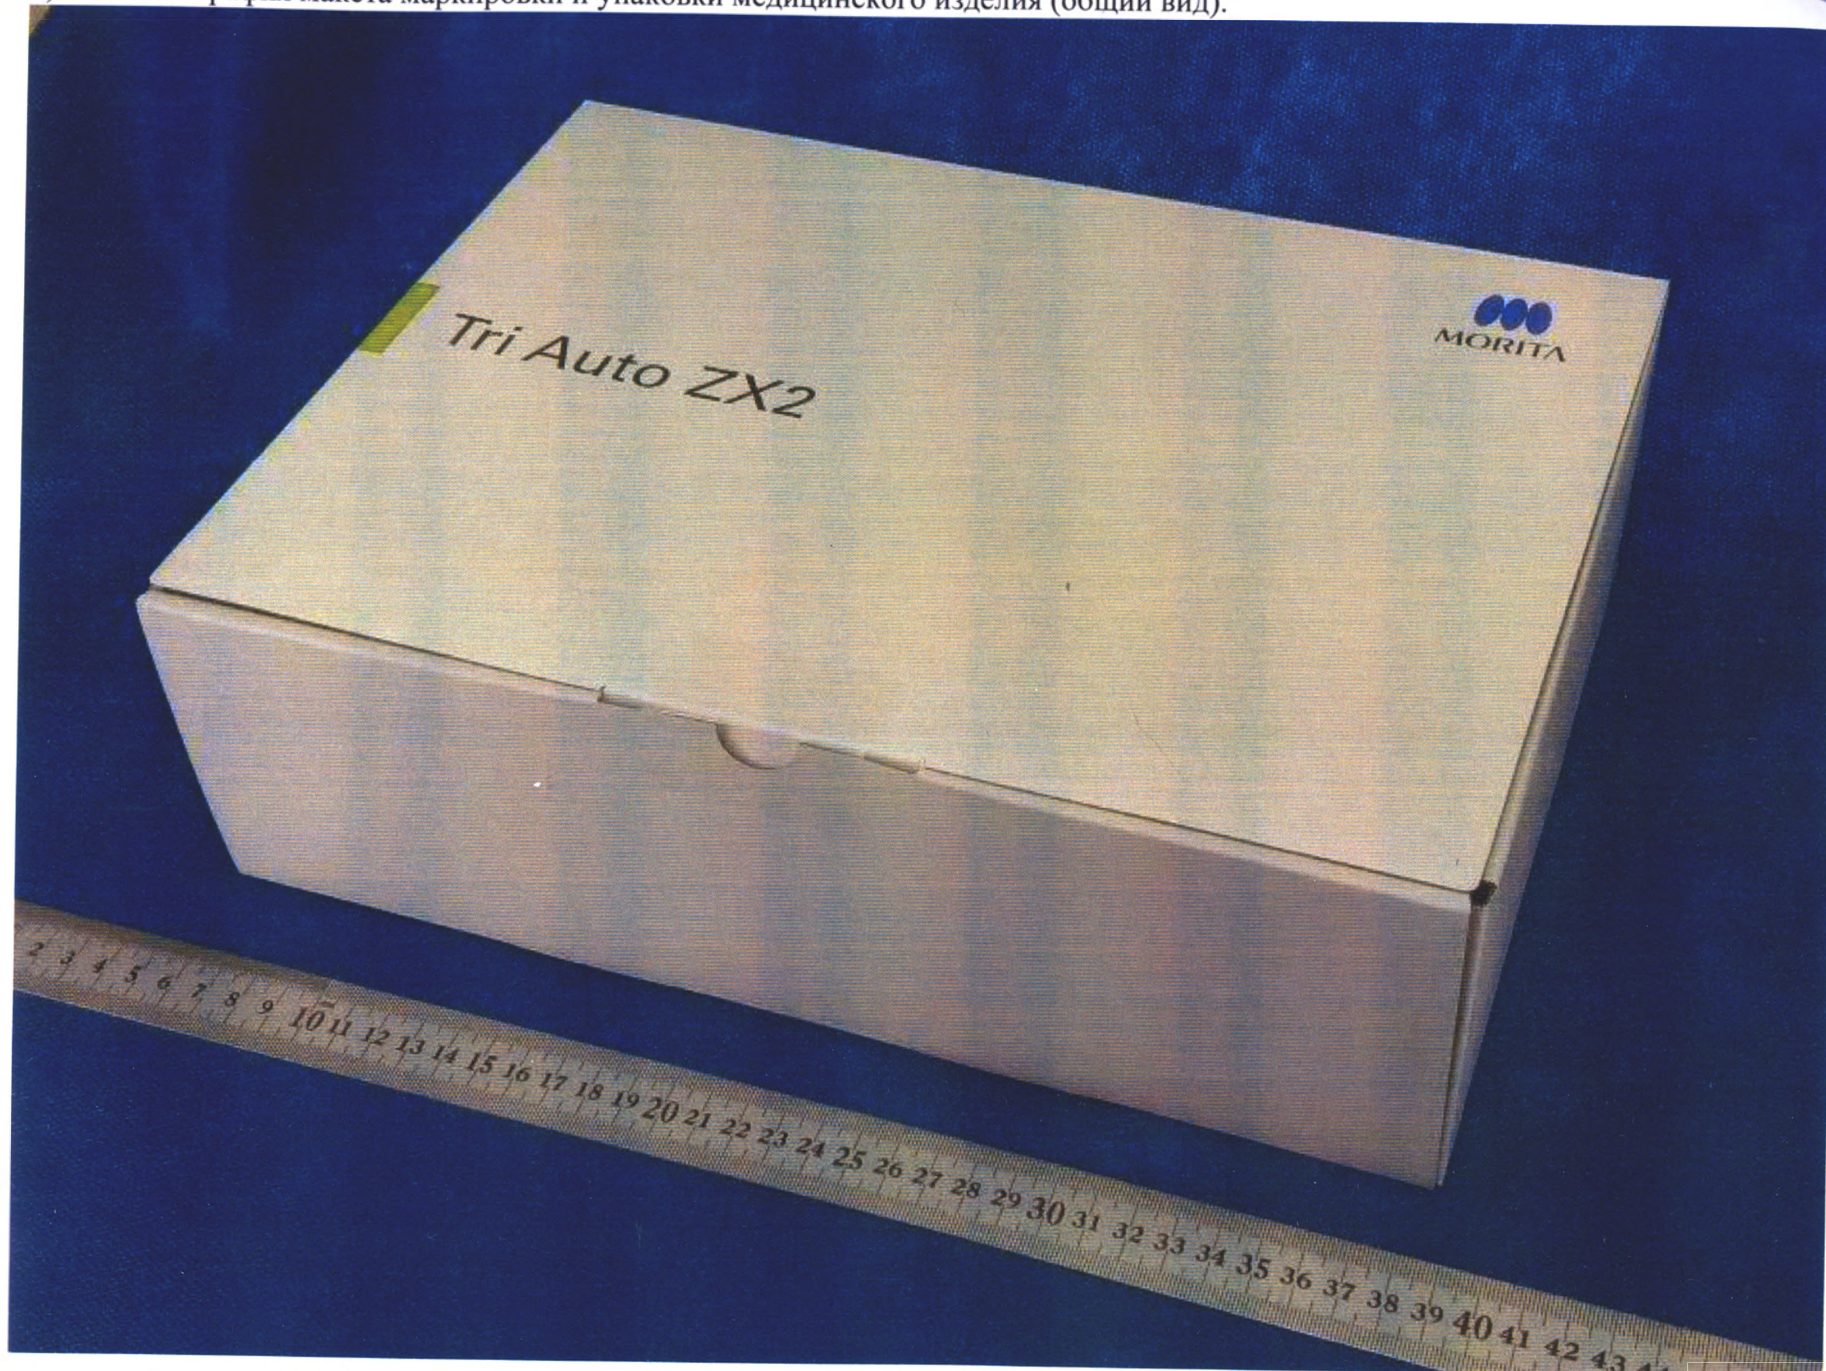


2) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид спереди).

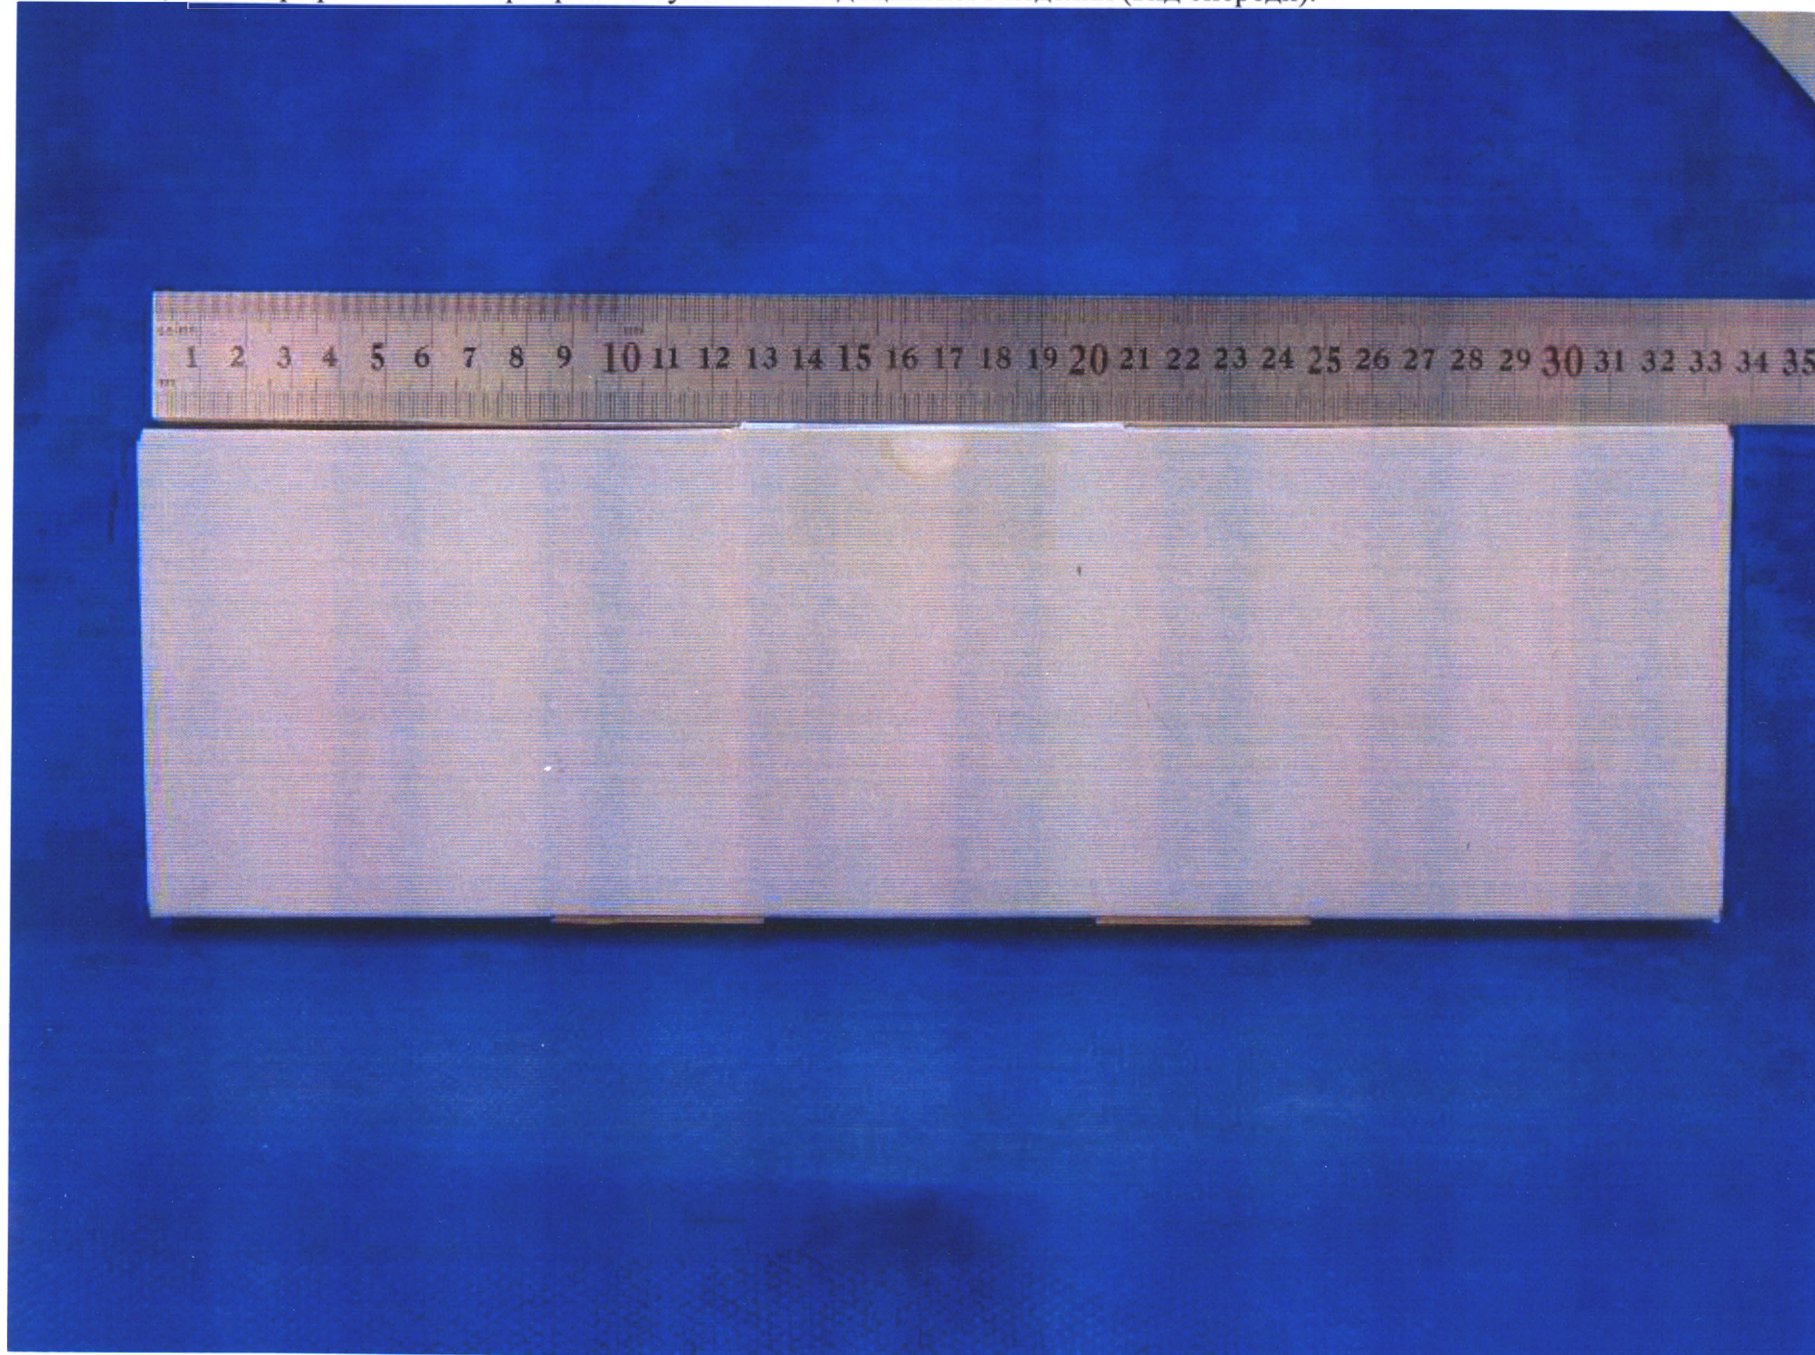


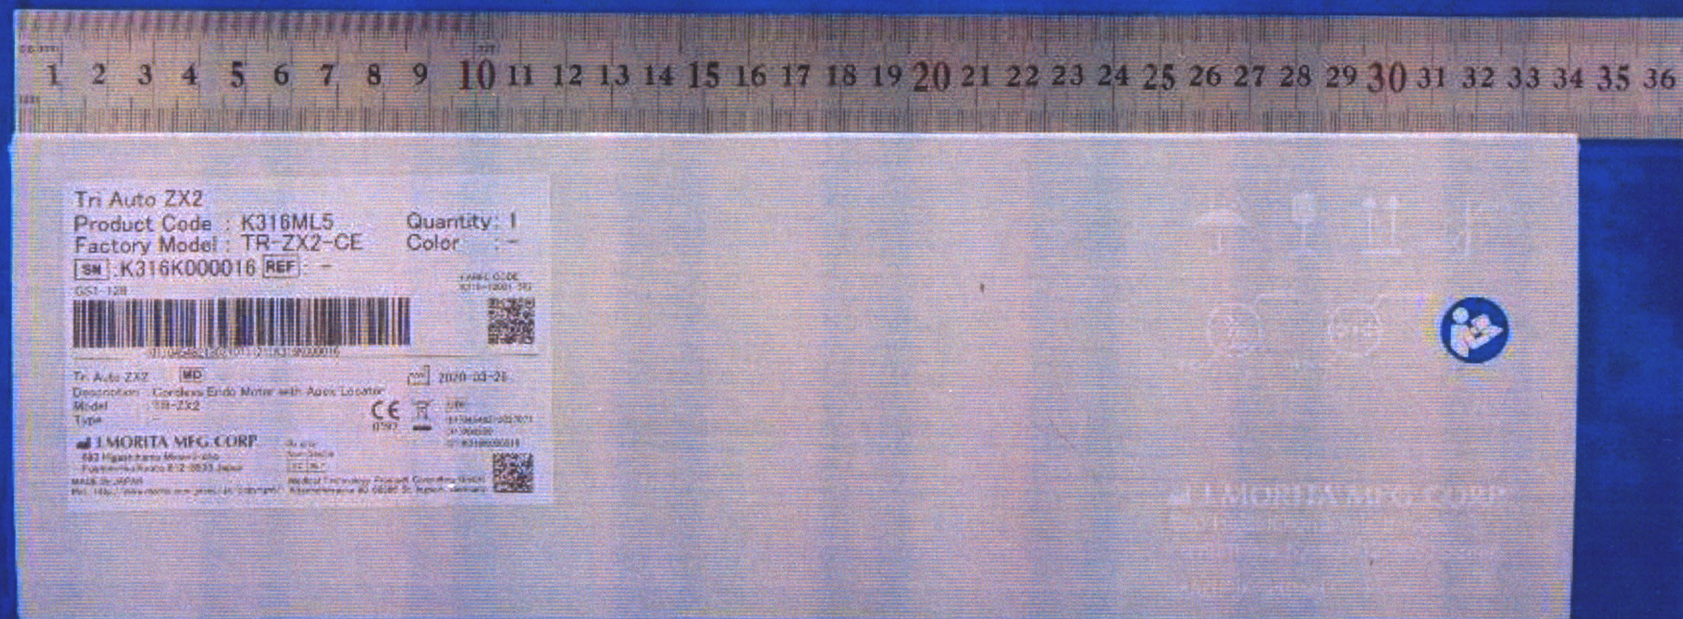


4) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид справа).

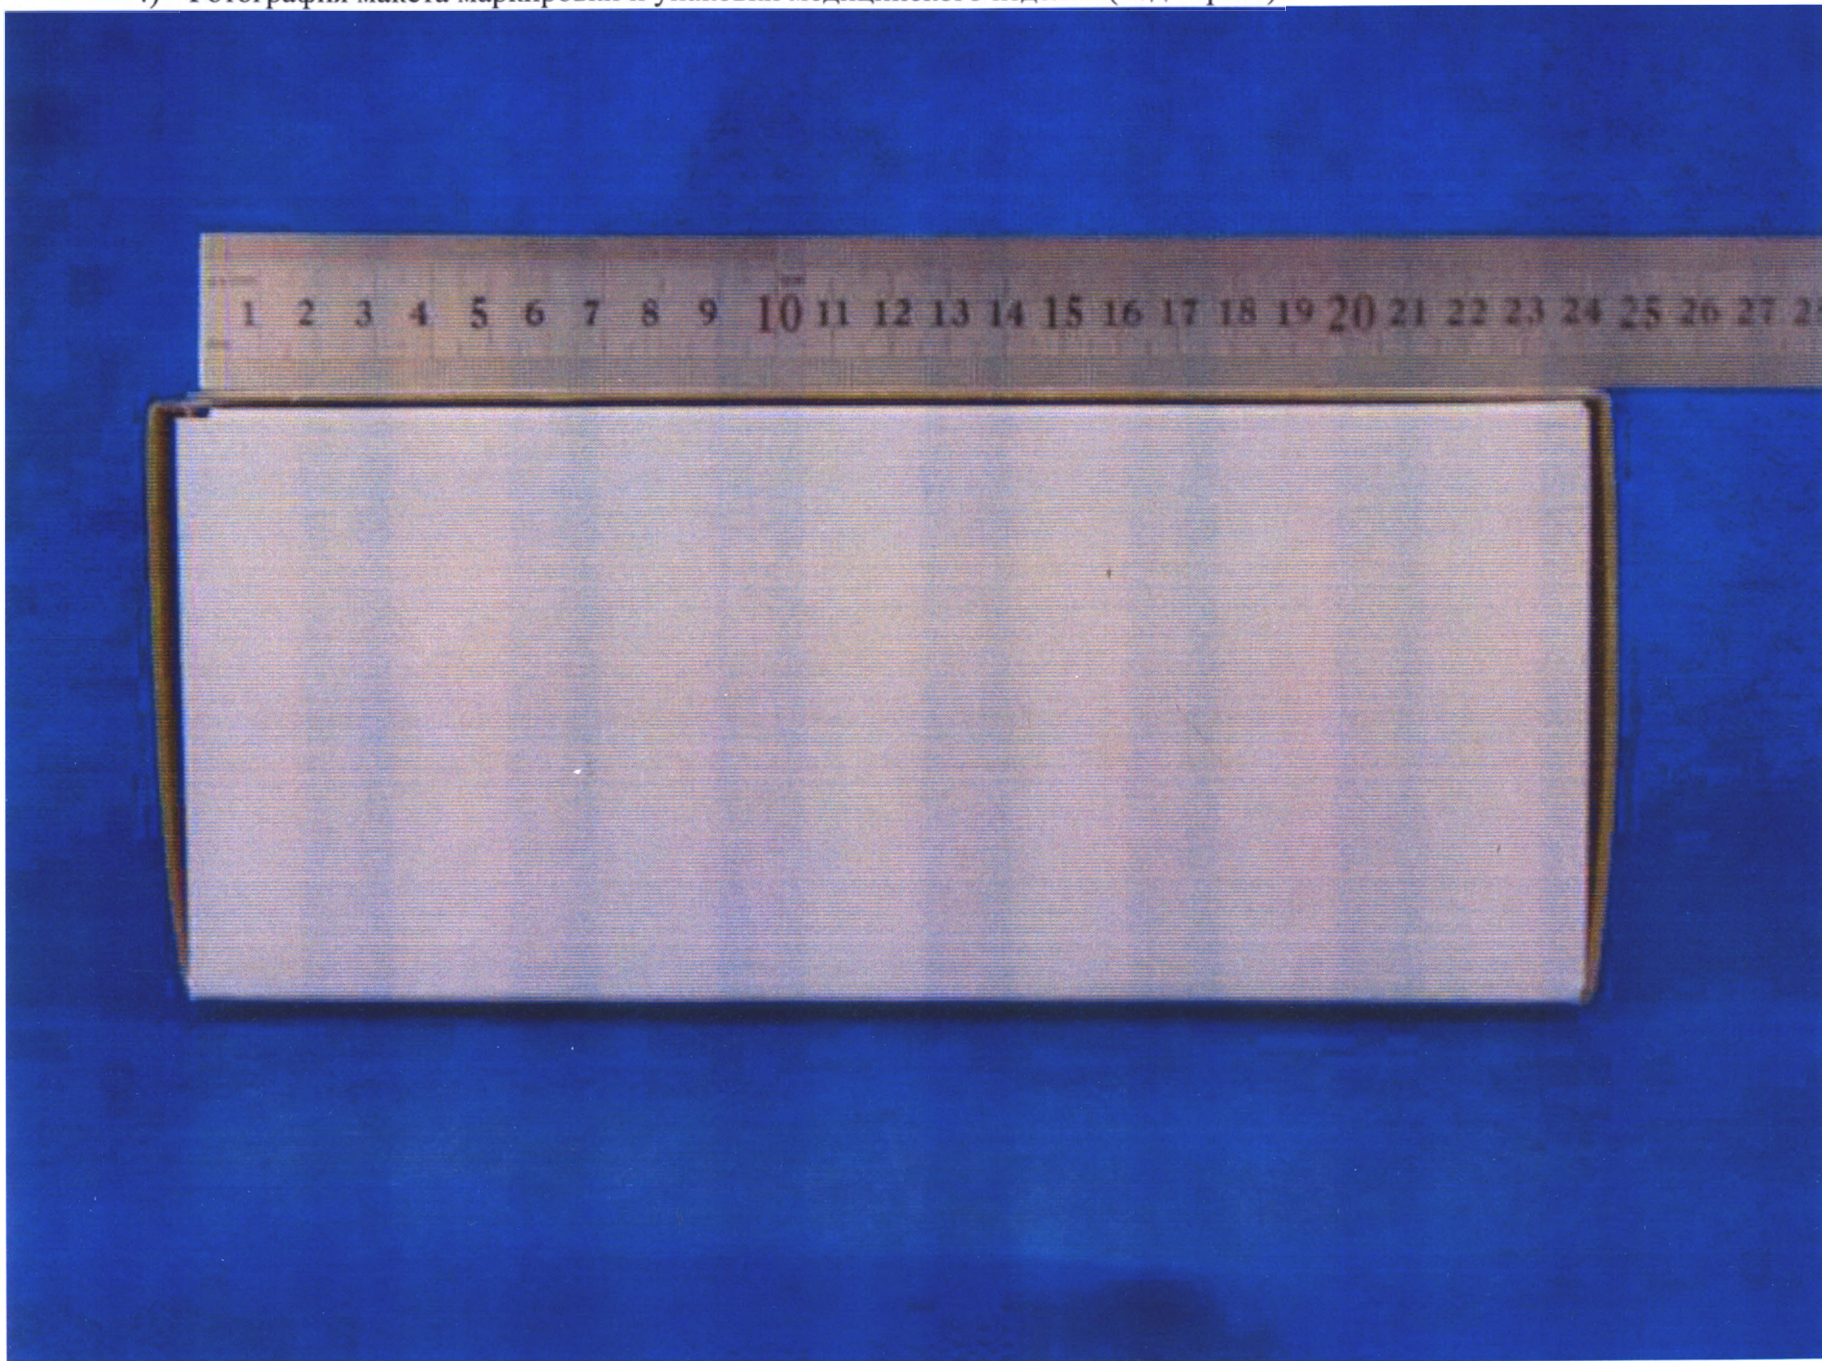

5) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид слева).

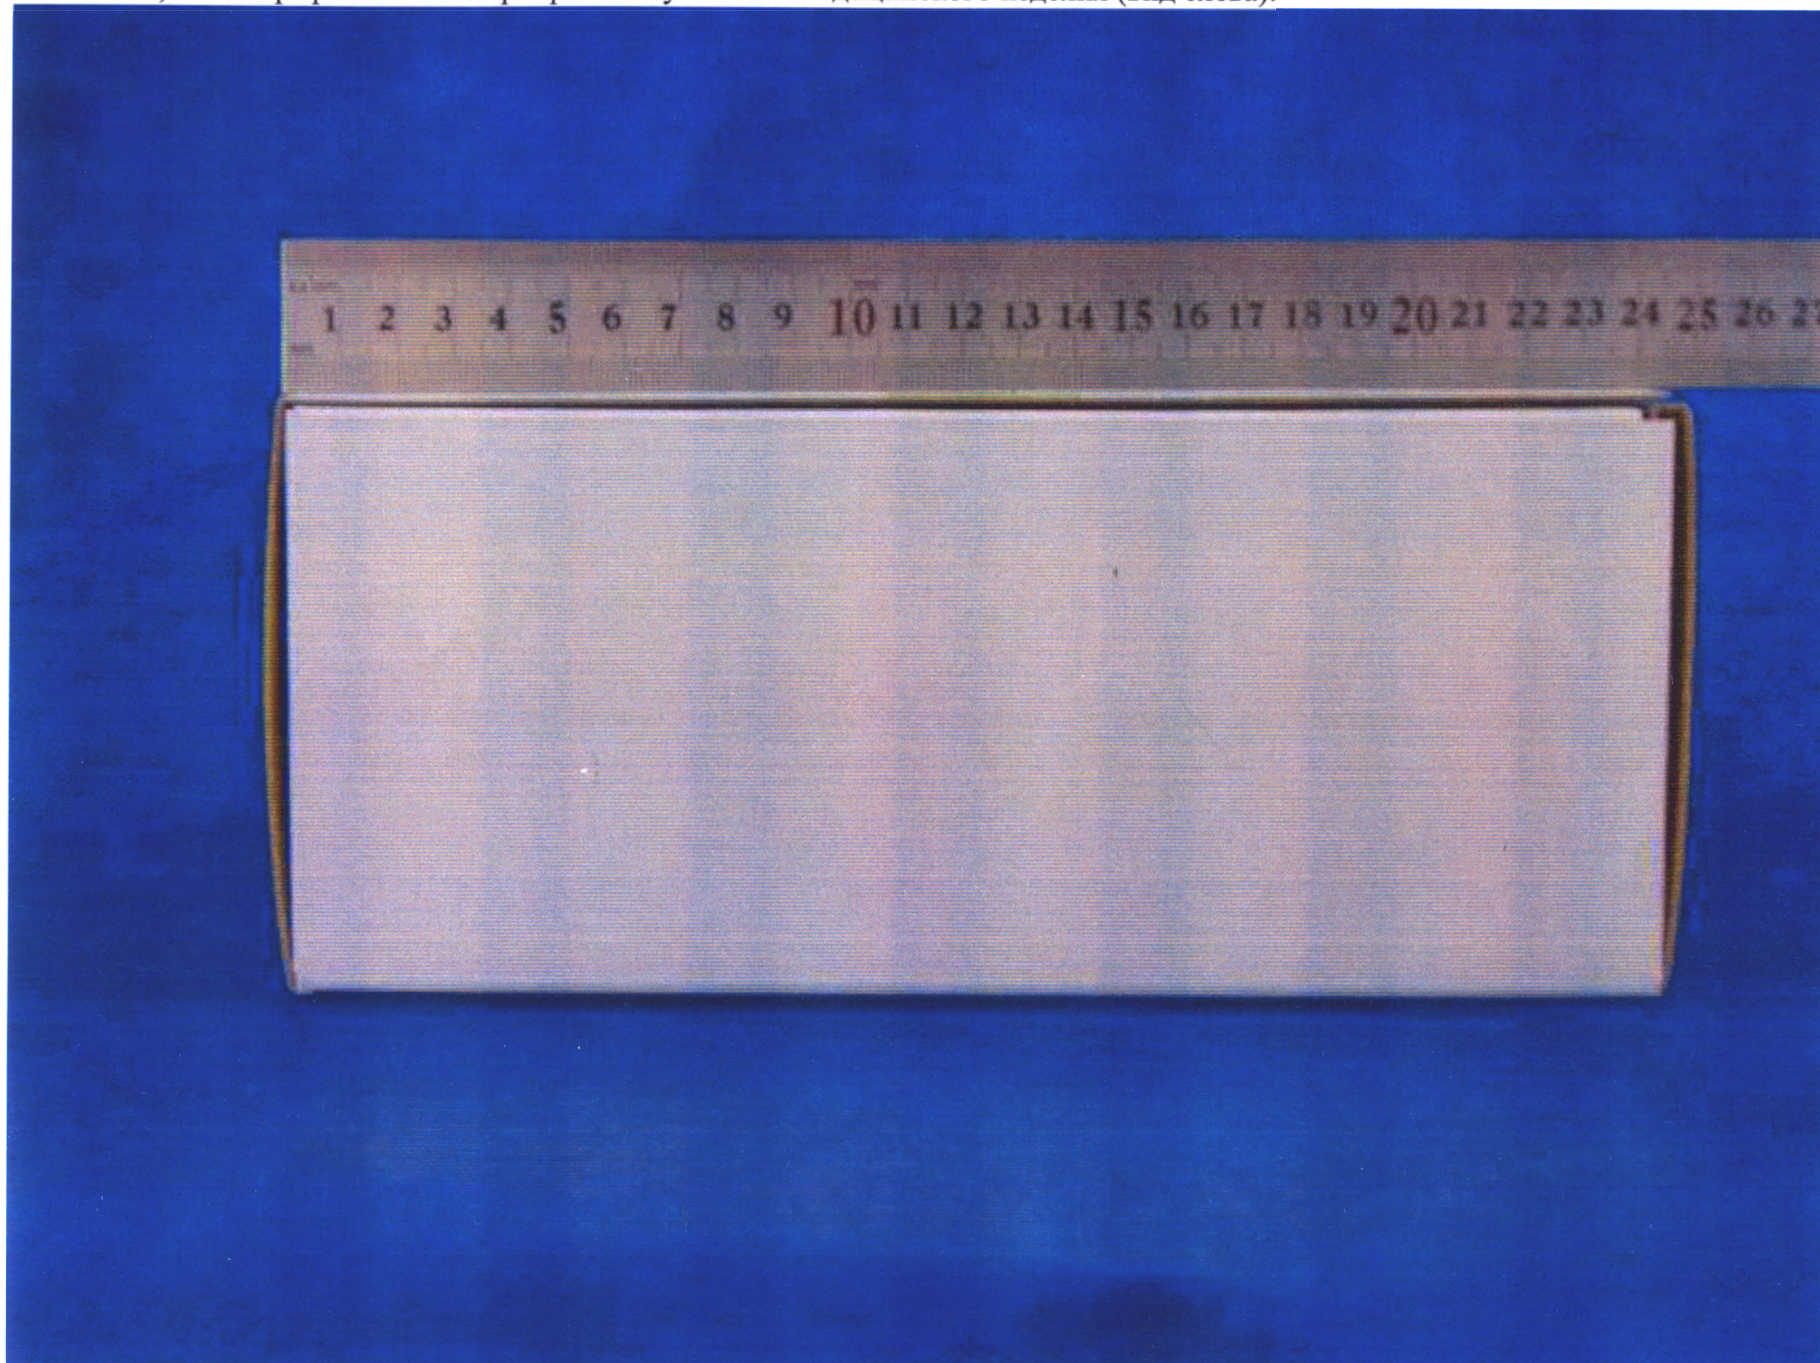

6) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид сверху).

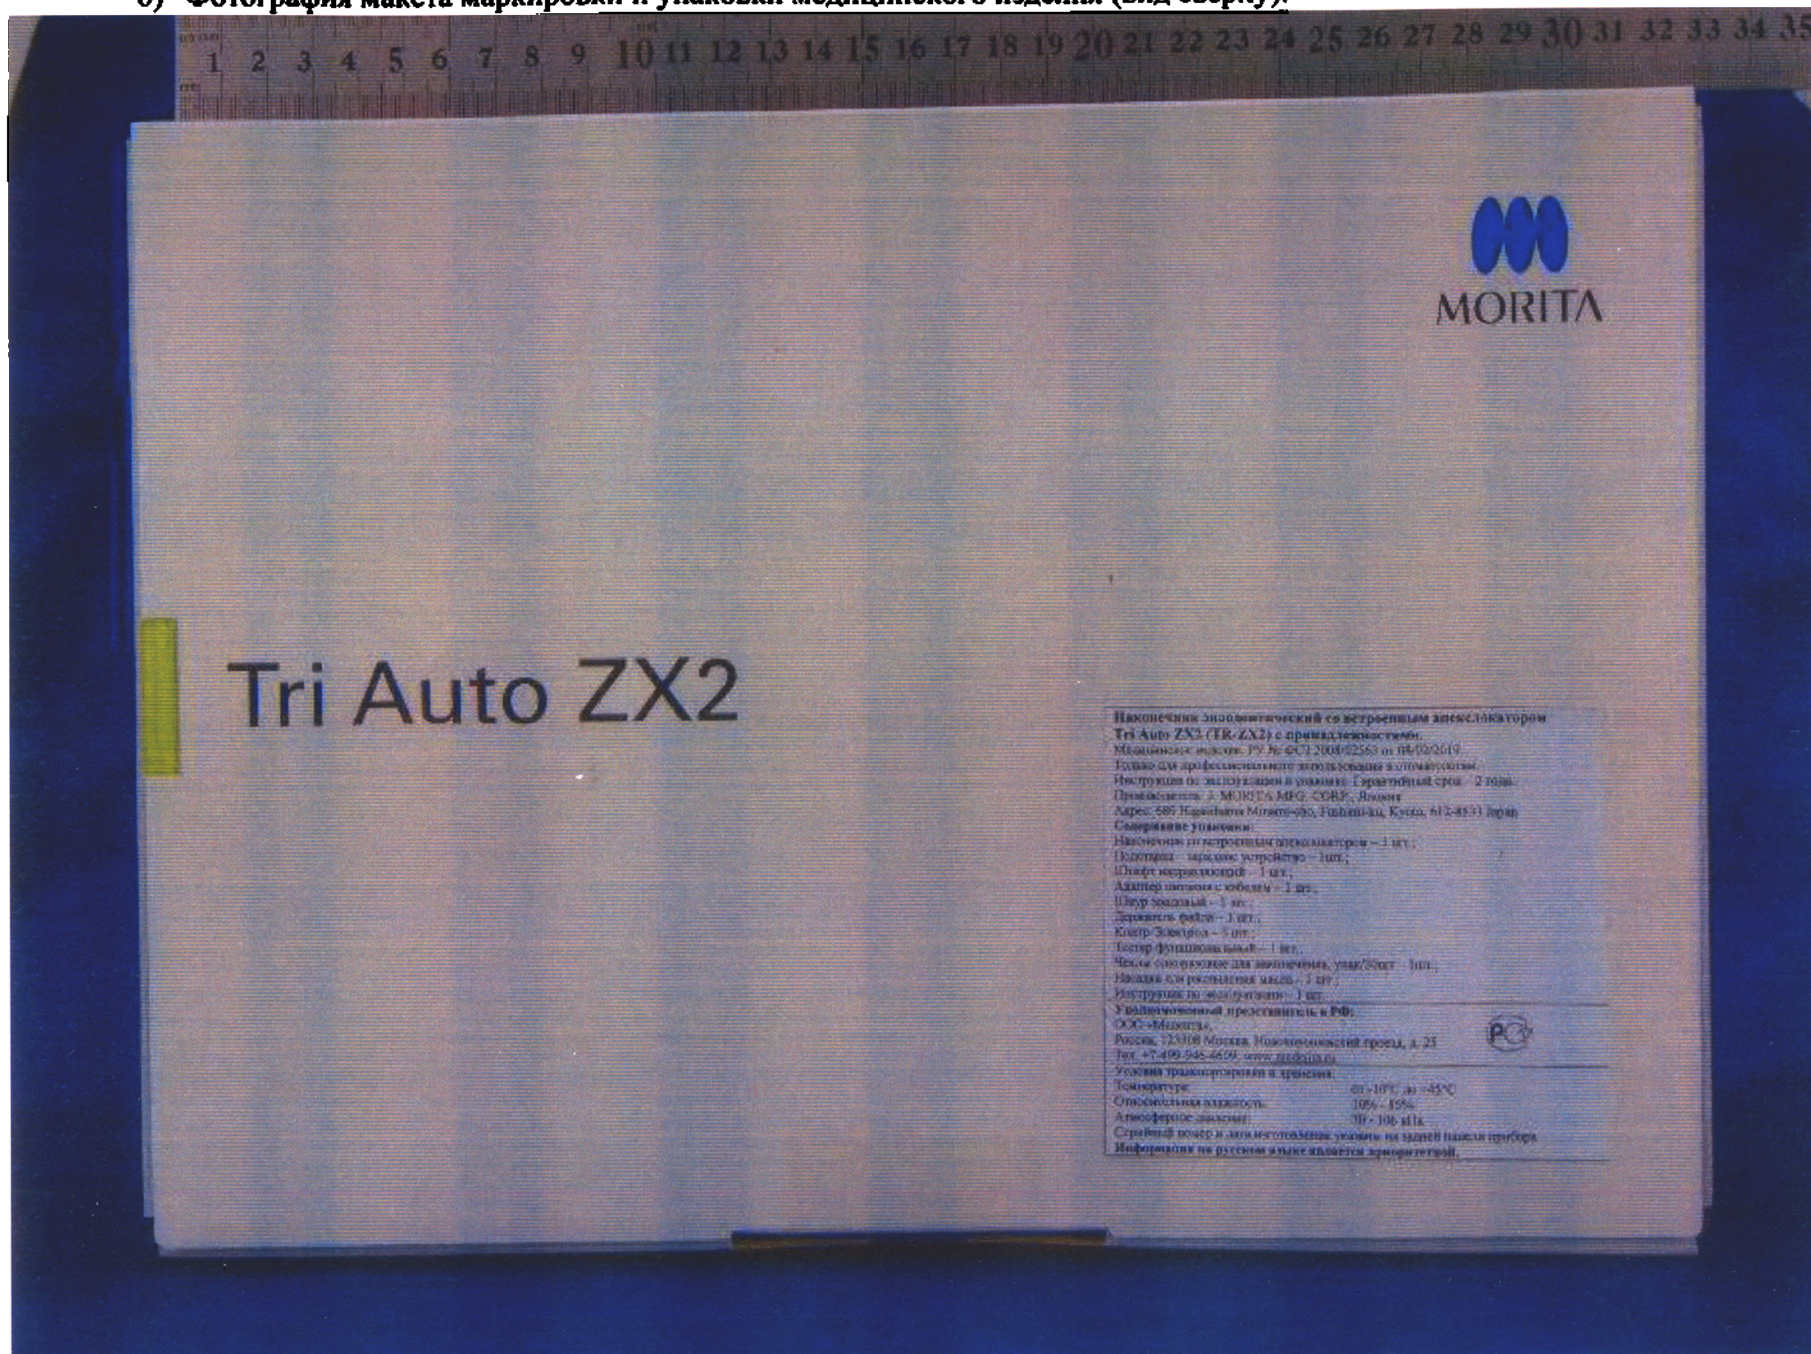

**Наконечник эндодонтический со встроенным апекслокатором
Tri Auto ZX2 (TR-ZX2) с принадлежностями.**

Медицинское изделие. РУ № ФСЗ 2008/02563 от 08/02/2019.

Только для профессионального использования в стоматологии.

Инструкция по эксплуатации в упаковке. Гарантийный срок – 2 года.

Производитель: J. MORITA MFG. CORP., Япония

Адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan

Содержание упаковки:

Наконечник со встроенным апекслокатором – 1 шт.;

Подставка – зарядное устройство – 1 шт.;

Штифт направляющий – 1 шт.;

Адаптер питания с кабелем – 1 шт.;

Шнур зондовый – 1 шт.;

Держатель файла – 1 шт.;

Контр-Электрод – 3 шт.;

Тестер функциональный – 1 шт.;

Чехлы одноразовые для наконечника, упак/30шт – 1 шт.;

Насадка для распыления масла – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Медента»,

Россия, 123308 Москва, Новохорошевский проезд, д. 25

Тел. +7-499-946-4609, www.medenta.ru



Условия транспортировки и хранения:

Температура: от -10°C до +45°C


Относительная влажность: 10% - 85%

Атмосферное давление: 70 - 106 кПа

Серийный номер и дата изготовления указаны на задней панели прибора.

Информация на русском языке является приоритетной.


8) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (вид снизу).

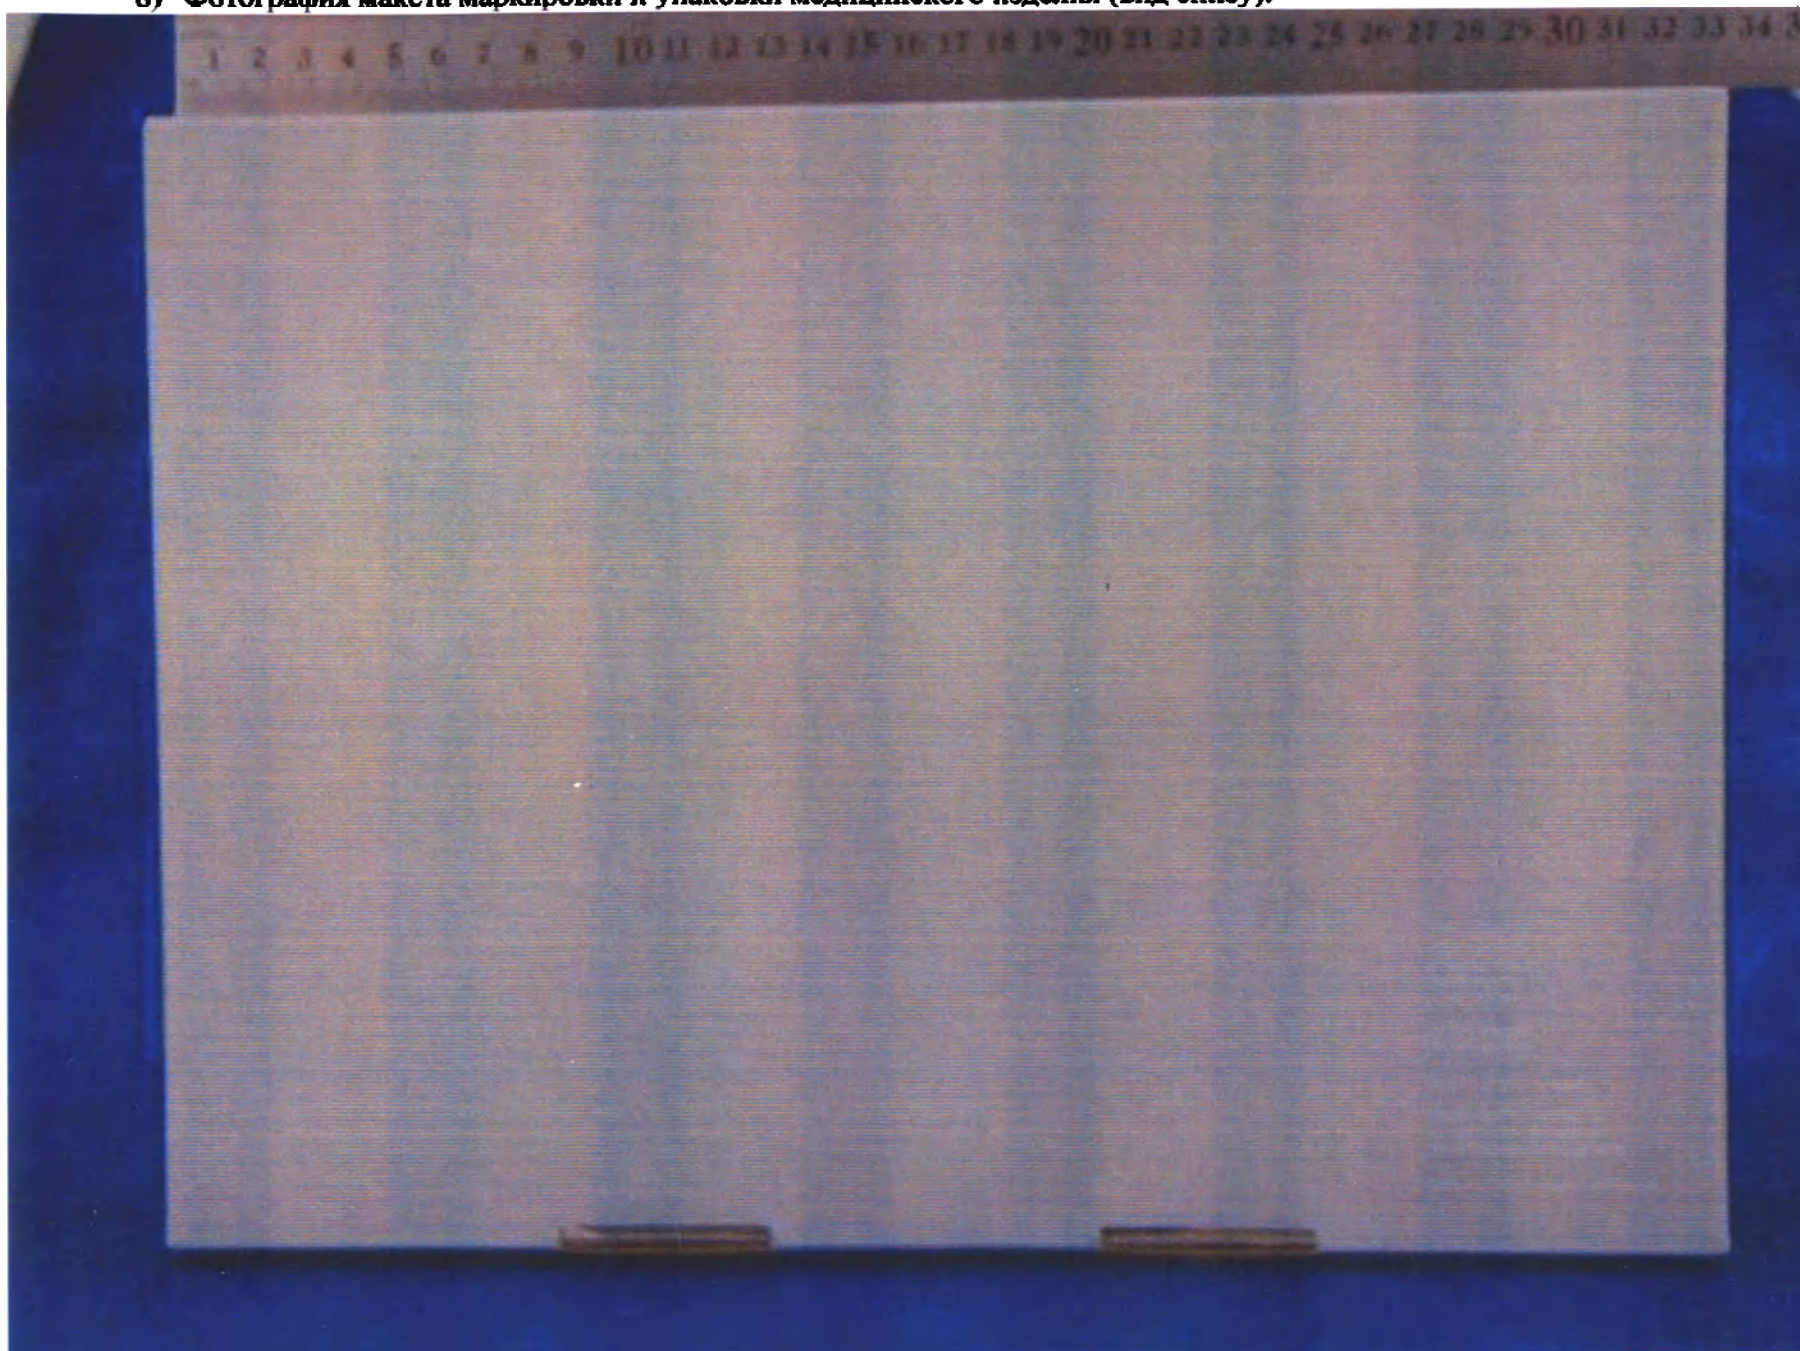

9) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (содержимое упаковки).



10) Фотография подставки (зарядного устройства) медицинского изделия (общий вид).

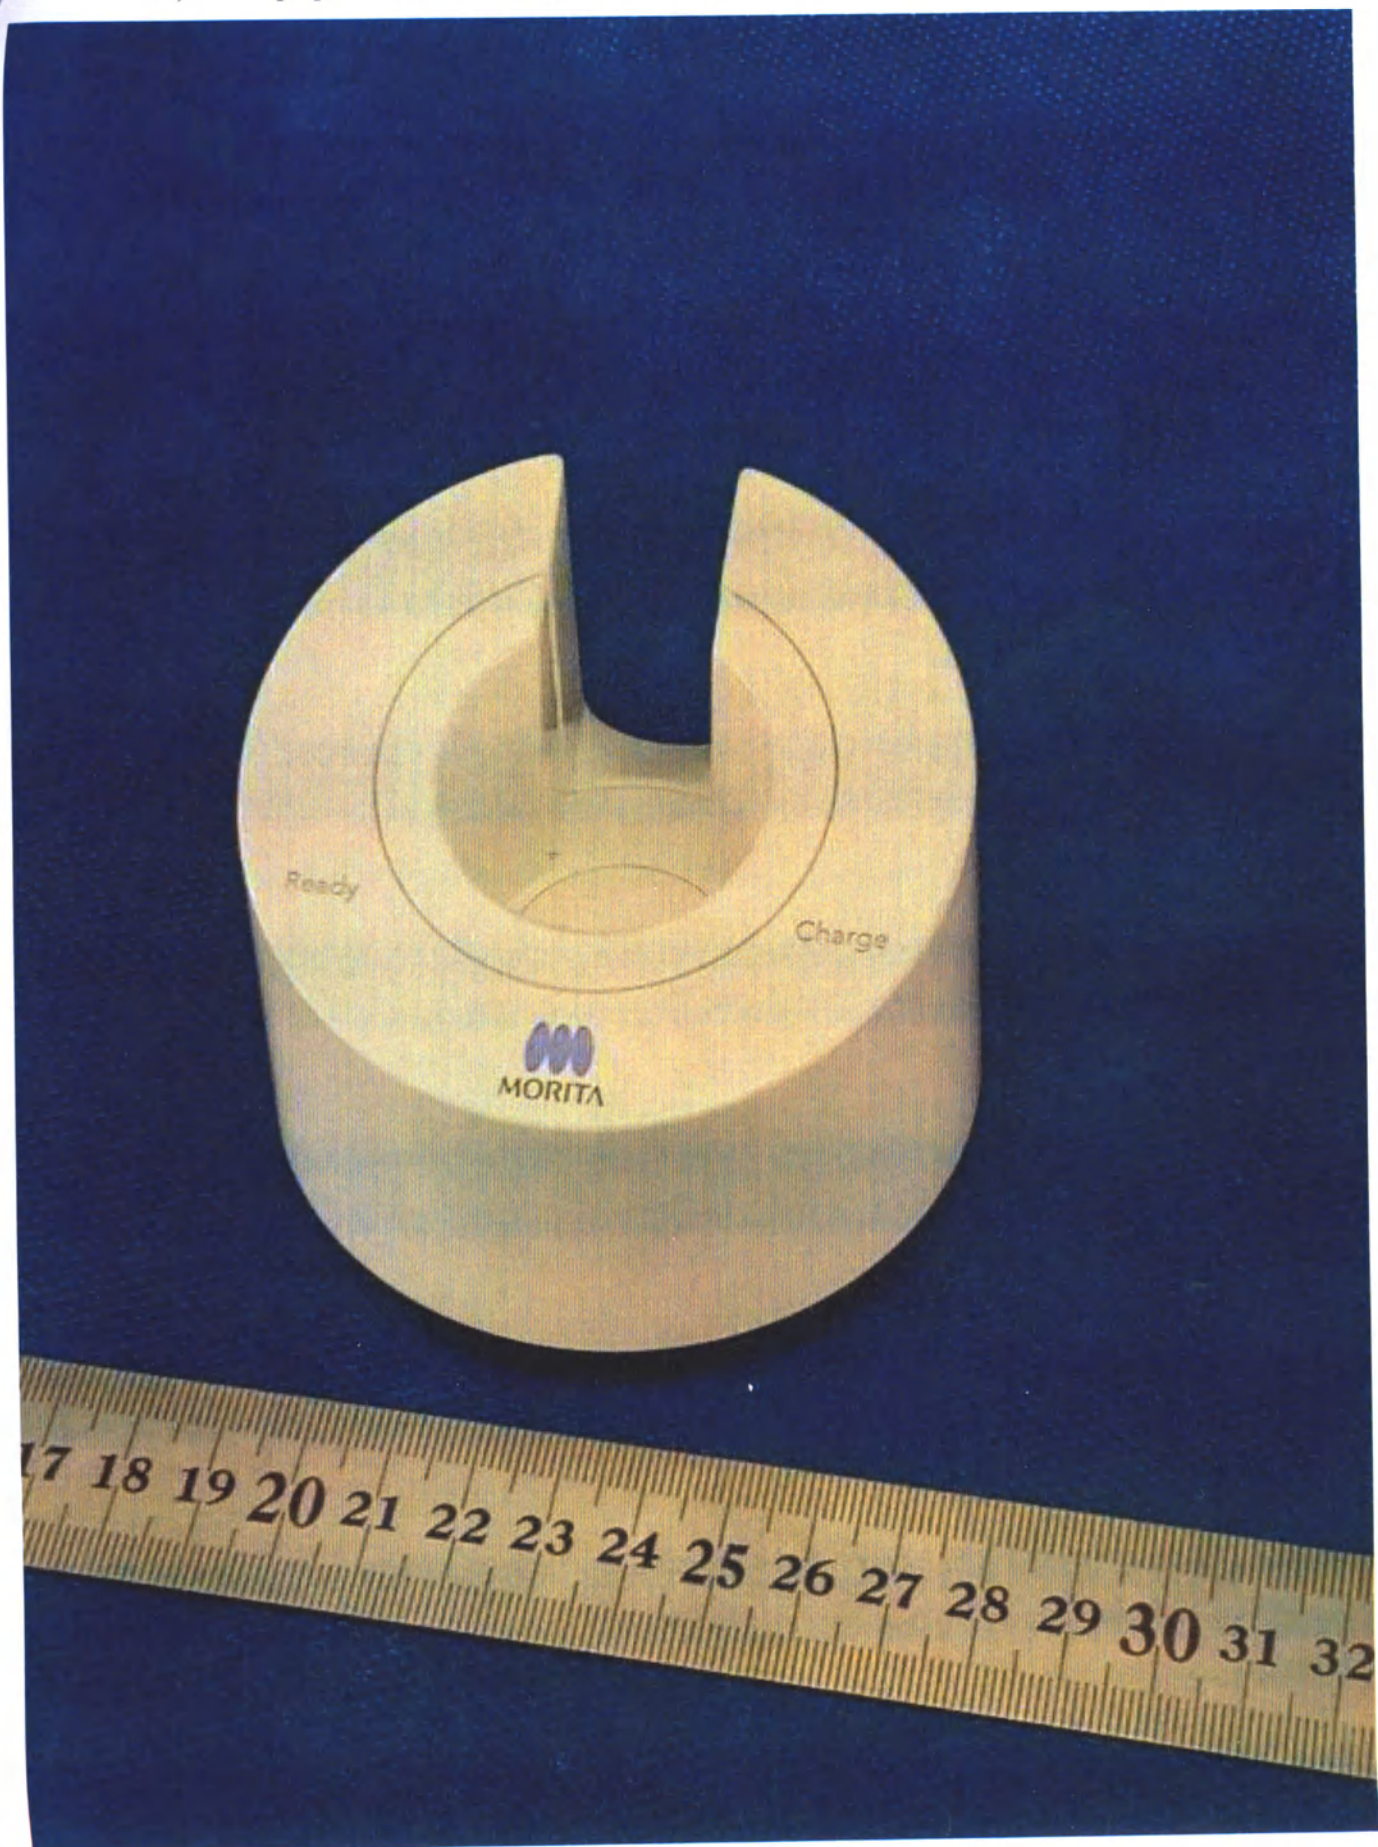



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

15 всего листов

Ген. Директор ООО «Медента»

В. В. Терехов

