




«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель коммерческого
отдела Бизнес-юнита
«Радиология»

АО «БАЙЕР» Юшков А.А.

2019 г.




////
АО «БАЙЕР»

107113, Россия, Москва
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Материалы расходные для системы инфузионной www.bayer.ru
для позитронно-эмиссионной томографии
MEDRAD Intego, в наборах

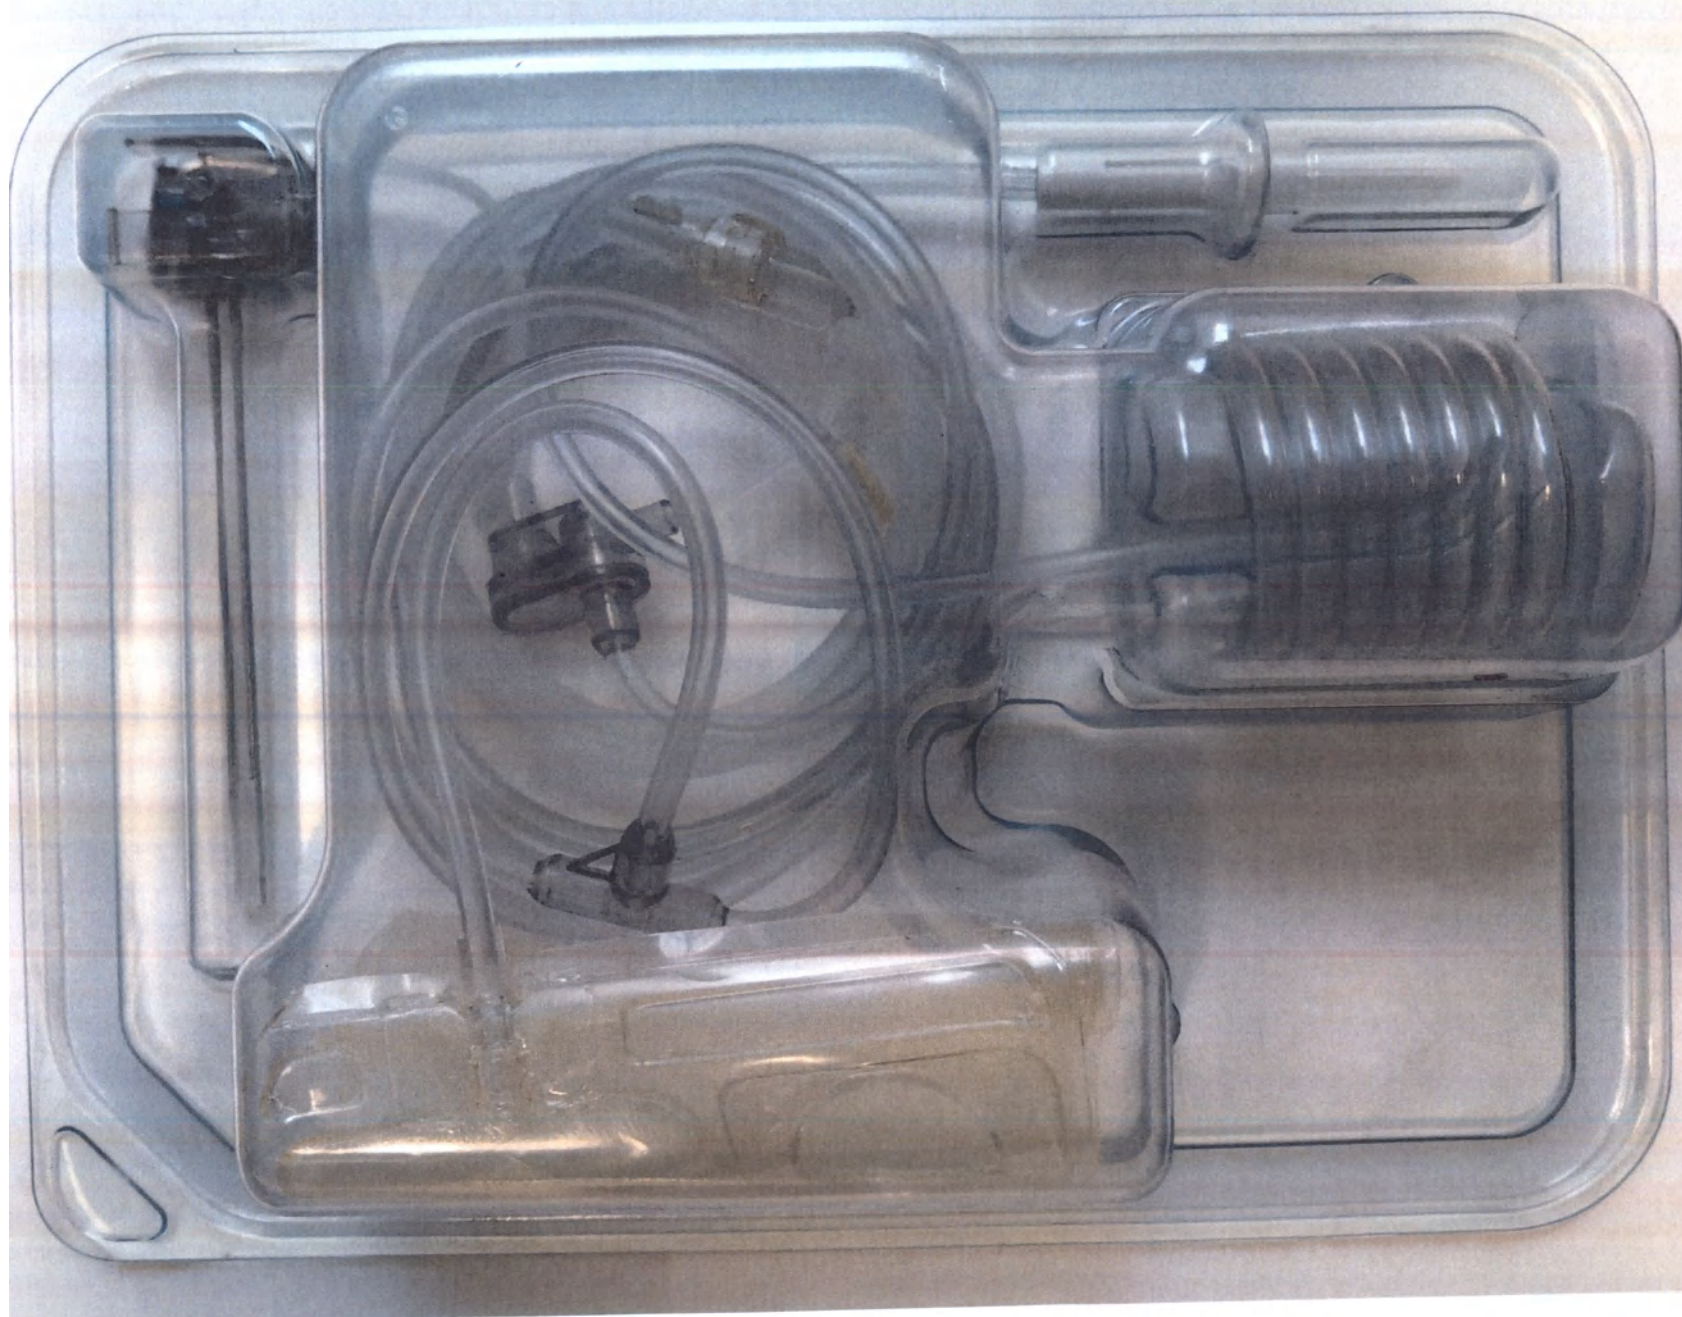

Набор одноразовый стерильный для введения источника (SAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD



MEDRAD® Intego

Sterile Disposables | Dispositifs jetables stériles
Source Administration Set | Nécessaire à perfusion de la source

REF Catalog Number INT CSS
Référence Catalogue



Non-pyrogenic fluid path
Ligne d'injection apyrogène



Do not use if package is opened or damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.
Attention : Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte.



For use with one vial of media only.
A n'utiliser qu'avec un seul flacon de produit.

STERILE R

Sterilized using irradiation.
Stérilisé par irradiation.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex
N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel



Do not re-sterilize.
Ne pas restériliser

Rx Only. Refer to warnings and cautions on instruction sheet.
Uniquement sur ordonnance. Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde figurant dans le mode d'emploi.

Patent Information: www.radpatents.bayer.com
Information sur les brevets :

Made in Mexico for:
Fabriqué au Mexique pour:



Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Bayer

DN-250613 Rev. A



0086



(01) 00616258020242



Use By
Utiliser avant le

2021-04-17



Date of
Manufacture
Date de
fabrication

2018-04-17



Lot Number
Numéro de lot

60122027



(01)00616258020242
(11)180417
(17)210417
(10)60122027

DN-243157 Rev. C



MEDRAD® Intego

Sterile Disposables | Одноразовый стерильный Source Administration Set | Набор для введения источника

REF Catalog Number: INT CSS
Номер по каталогу



Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged
Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on instructions for use packaged in each carton
ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку



For use with one vial of media only
Для использования только с одной емкостью препарата

STERILE R

Sterilized using irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения натурального латекса



Do not re-sterilize
Повторно НЕ стерилизовать

Rx Only

Patent Information/
Патентная информация:
www.radpatents.bayer.com

Bayer

CE 0066



Use By
Использовать до

XX.XX.XXXX



Date of
Manufacture
Дата
изготовления

XX.XX.XXXX

LOT

Lot Number
Номер партии

XXXXXXXXXX

Made in Mexico for:
Сделано в Мексике для:



Производитель

Импортер на территорию
России: АО «БАЙЕР»
Бизнес-центр
«Радиология», 107113,
3-я Рыбинская ул.,
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэр Инк., США
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



RU № XXXXXXX of XXX
201X года

EC


REP

Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands


Набор одноразовый стерильный для введения источника (SAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD Intego (проект маркировки на русском языке)

Нетоксично внутри


Дополнительная маркировка для каждой пользовательской упаковки:

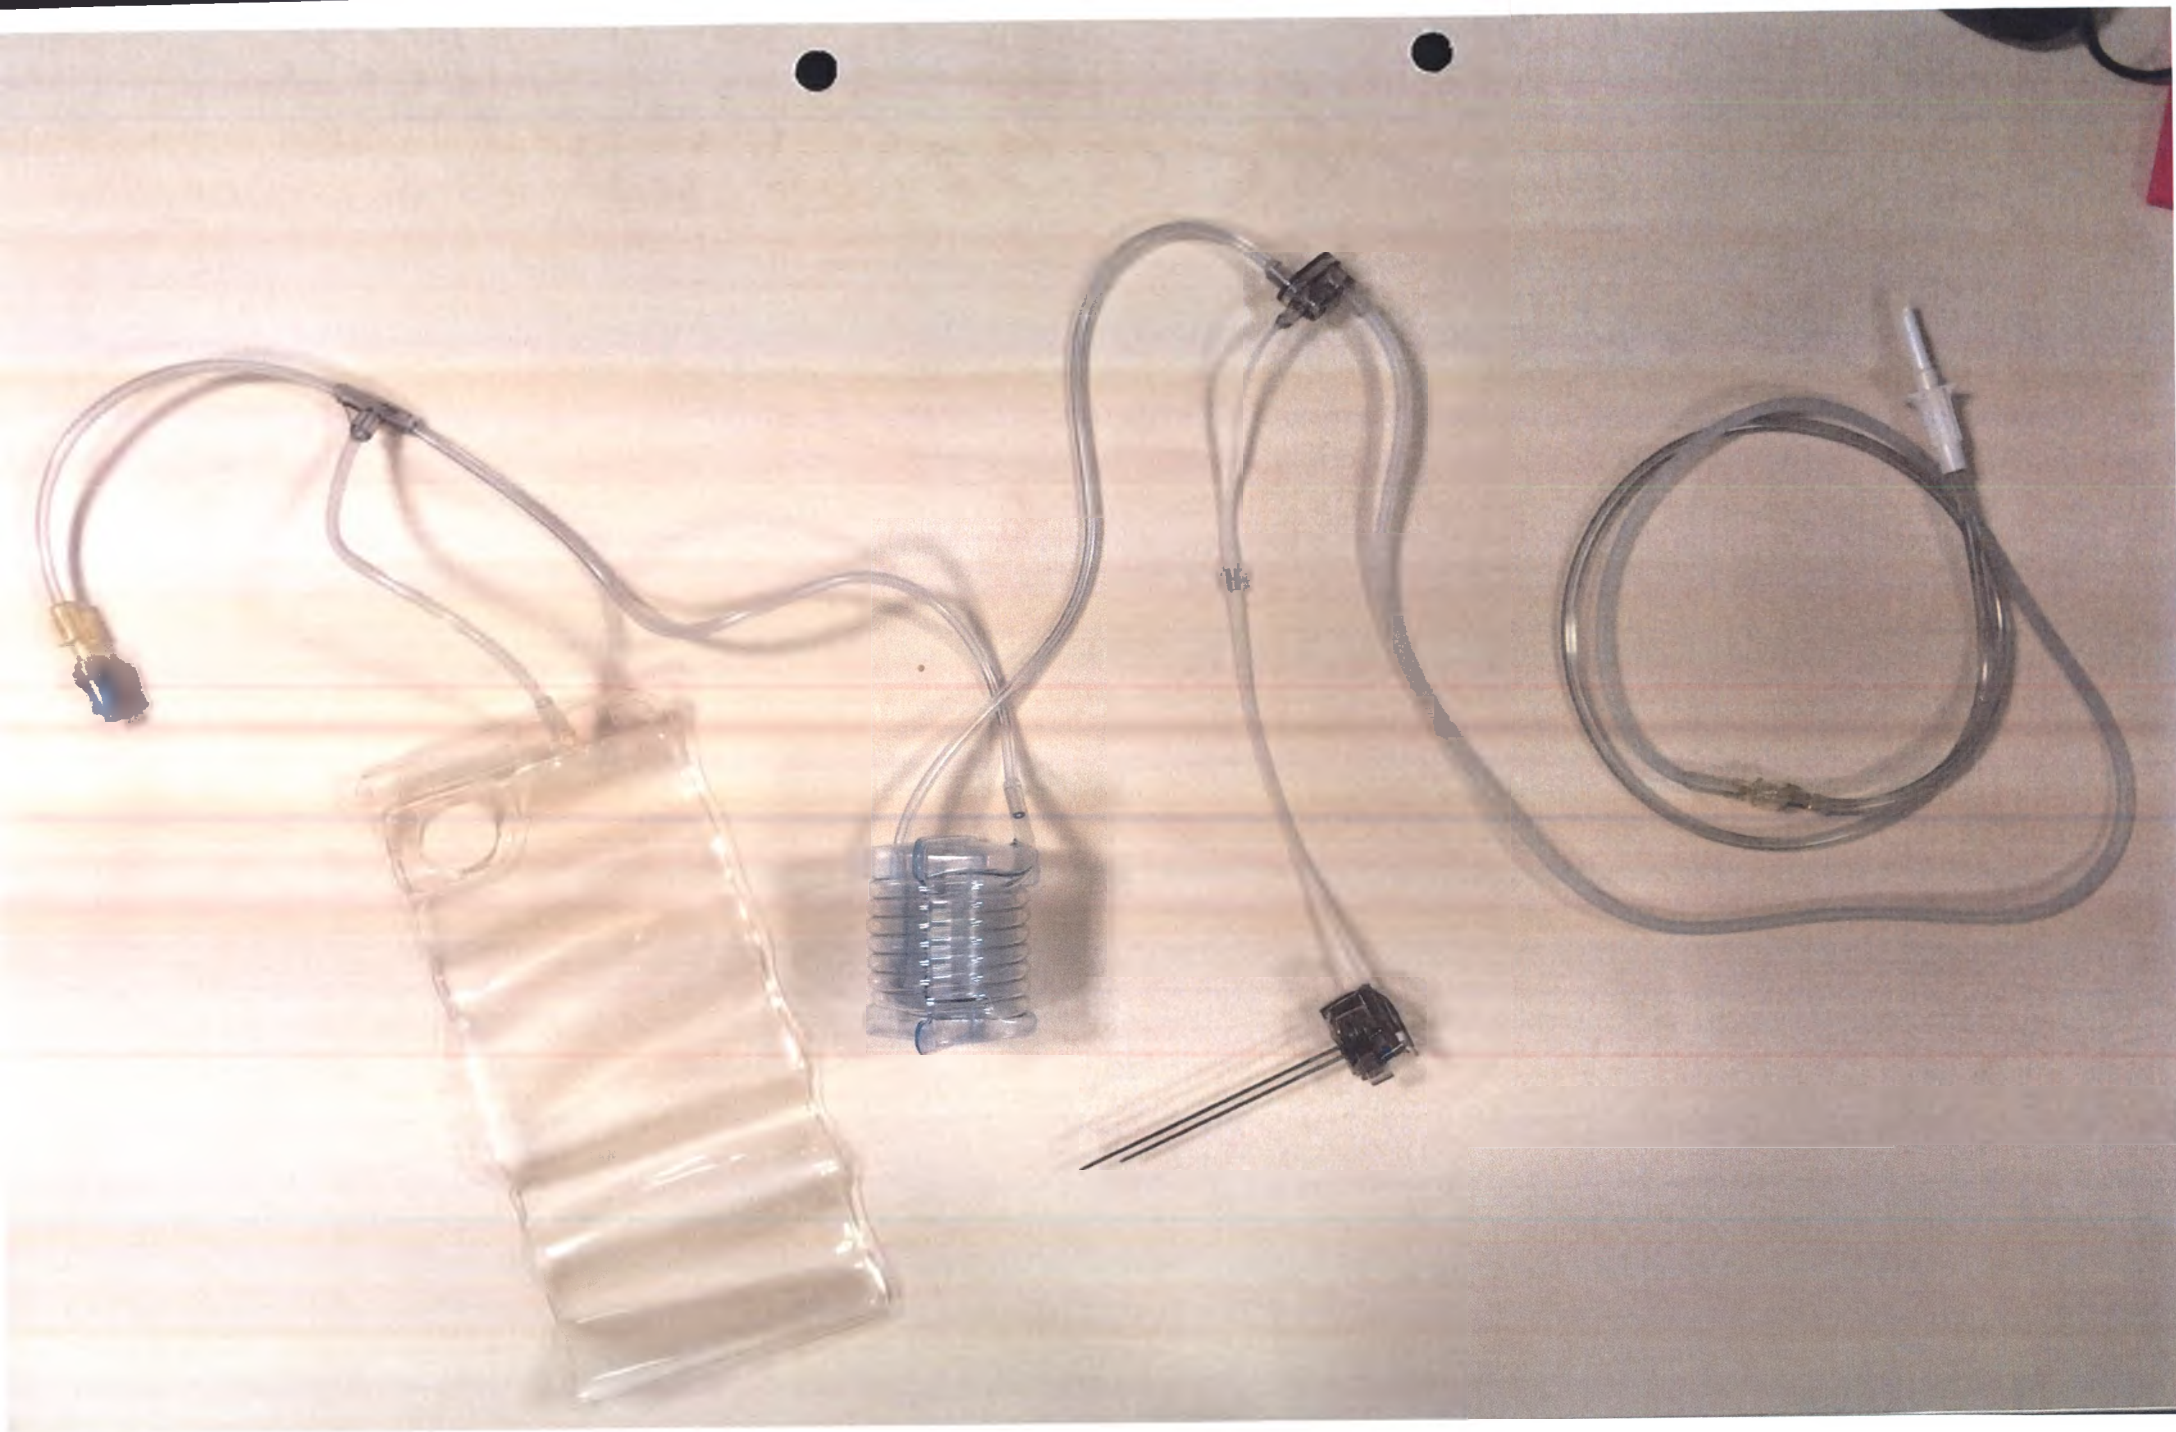



Набор одноразовый стерильный для введения источника (SAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD
Intego в составе в общем виде (без упаковки)

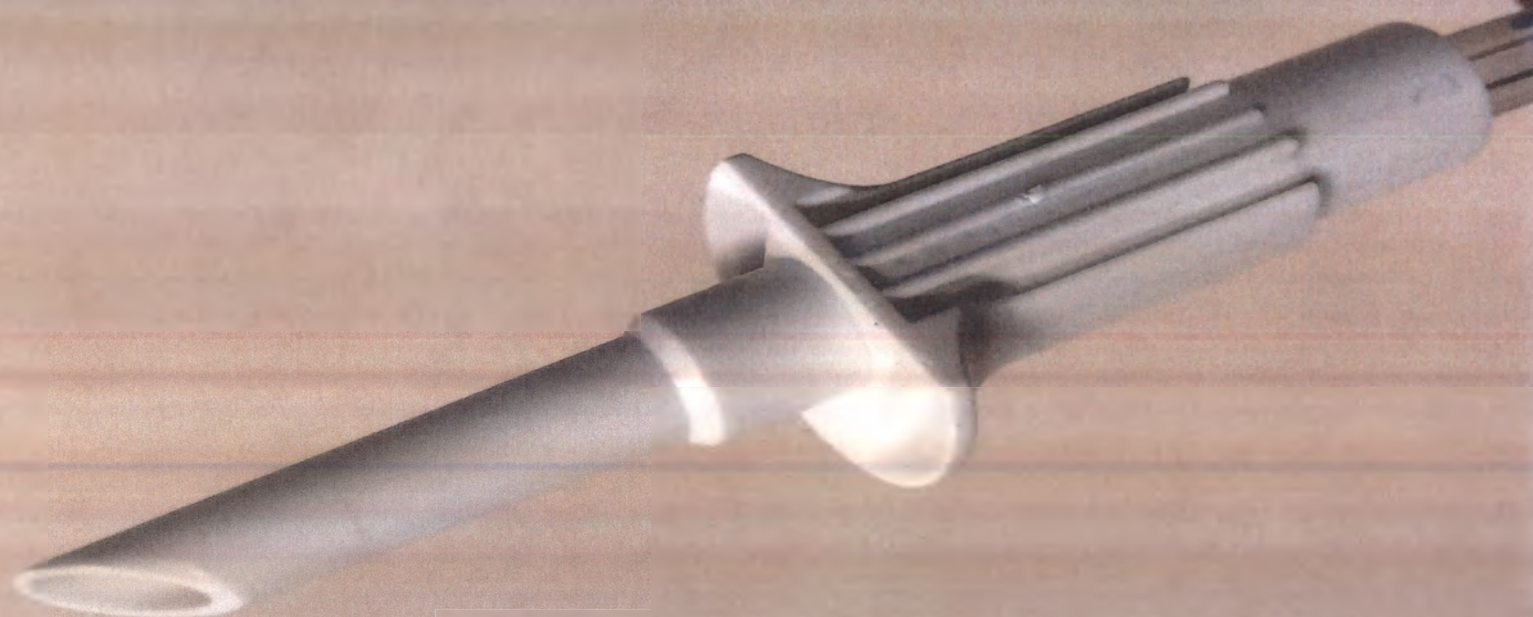


Игла для подачи физиологического раствора

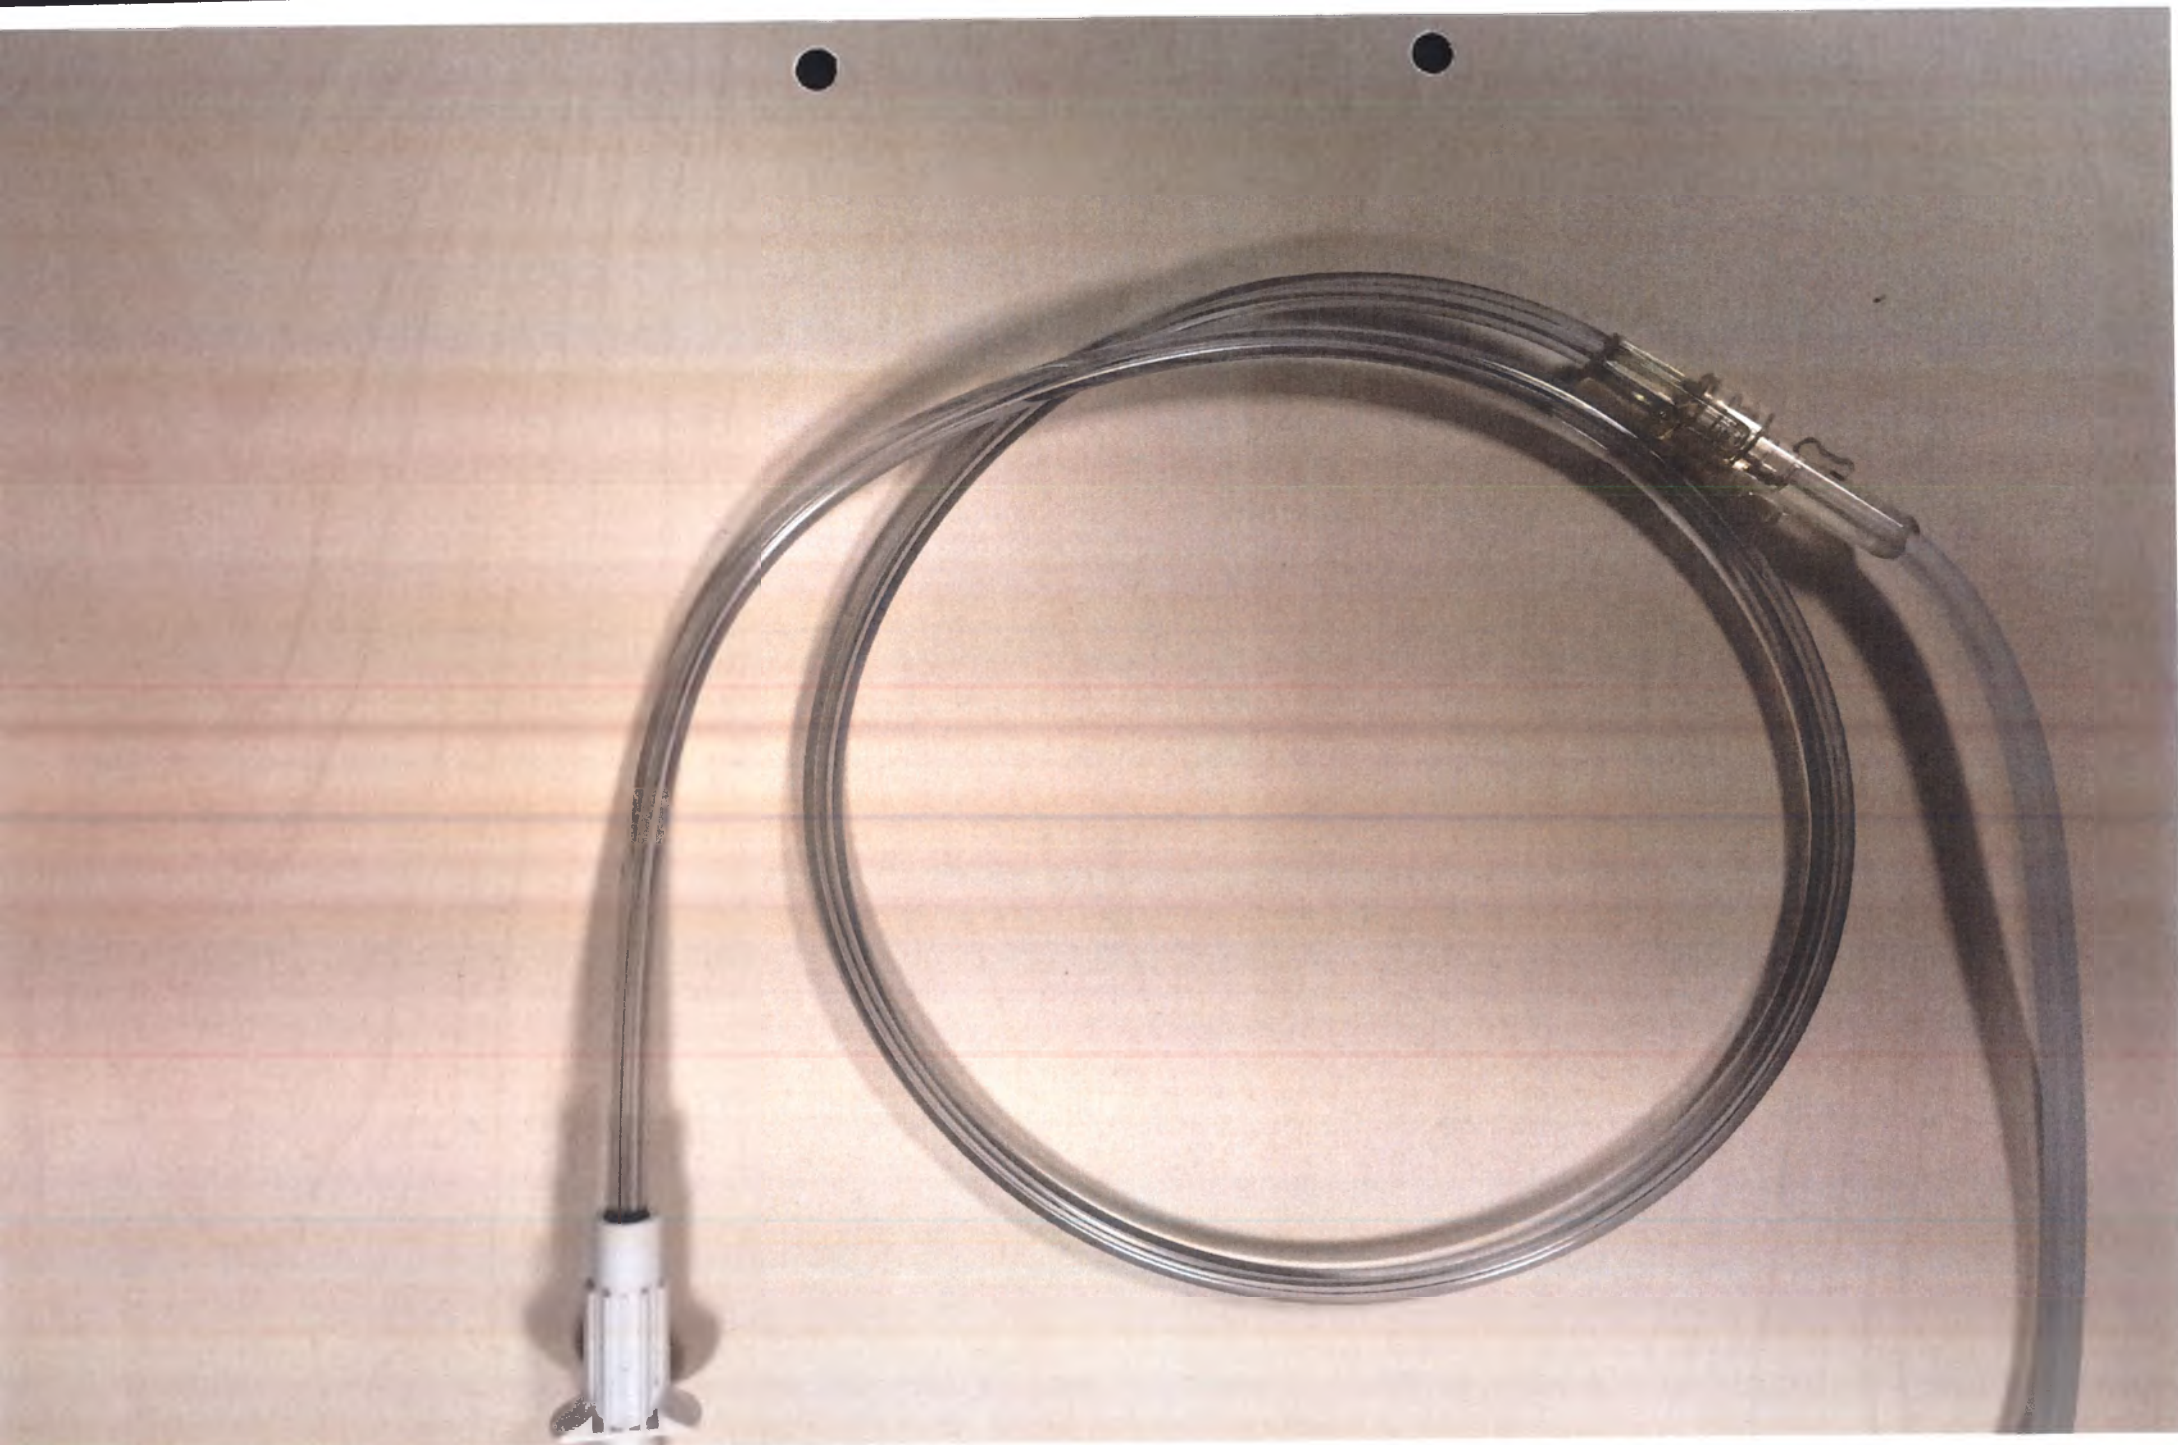

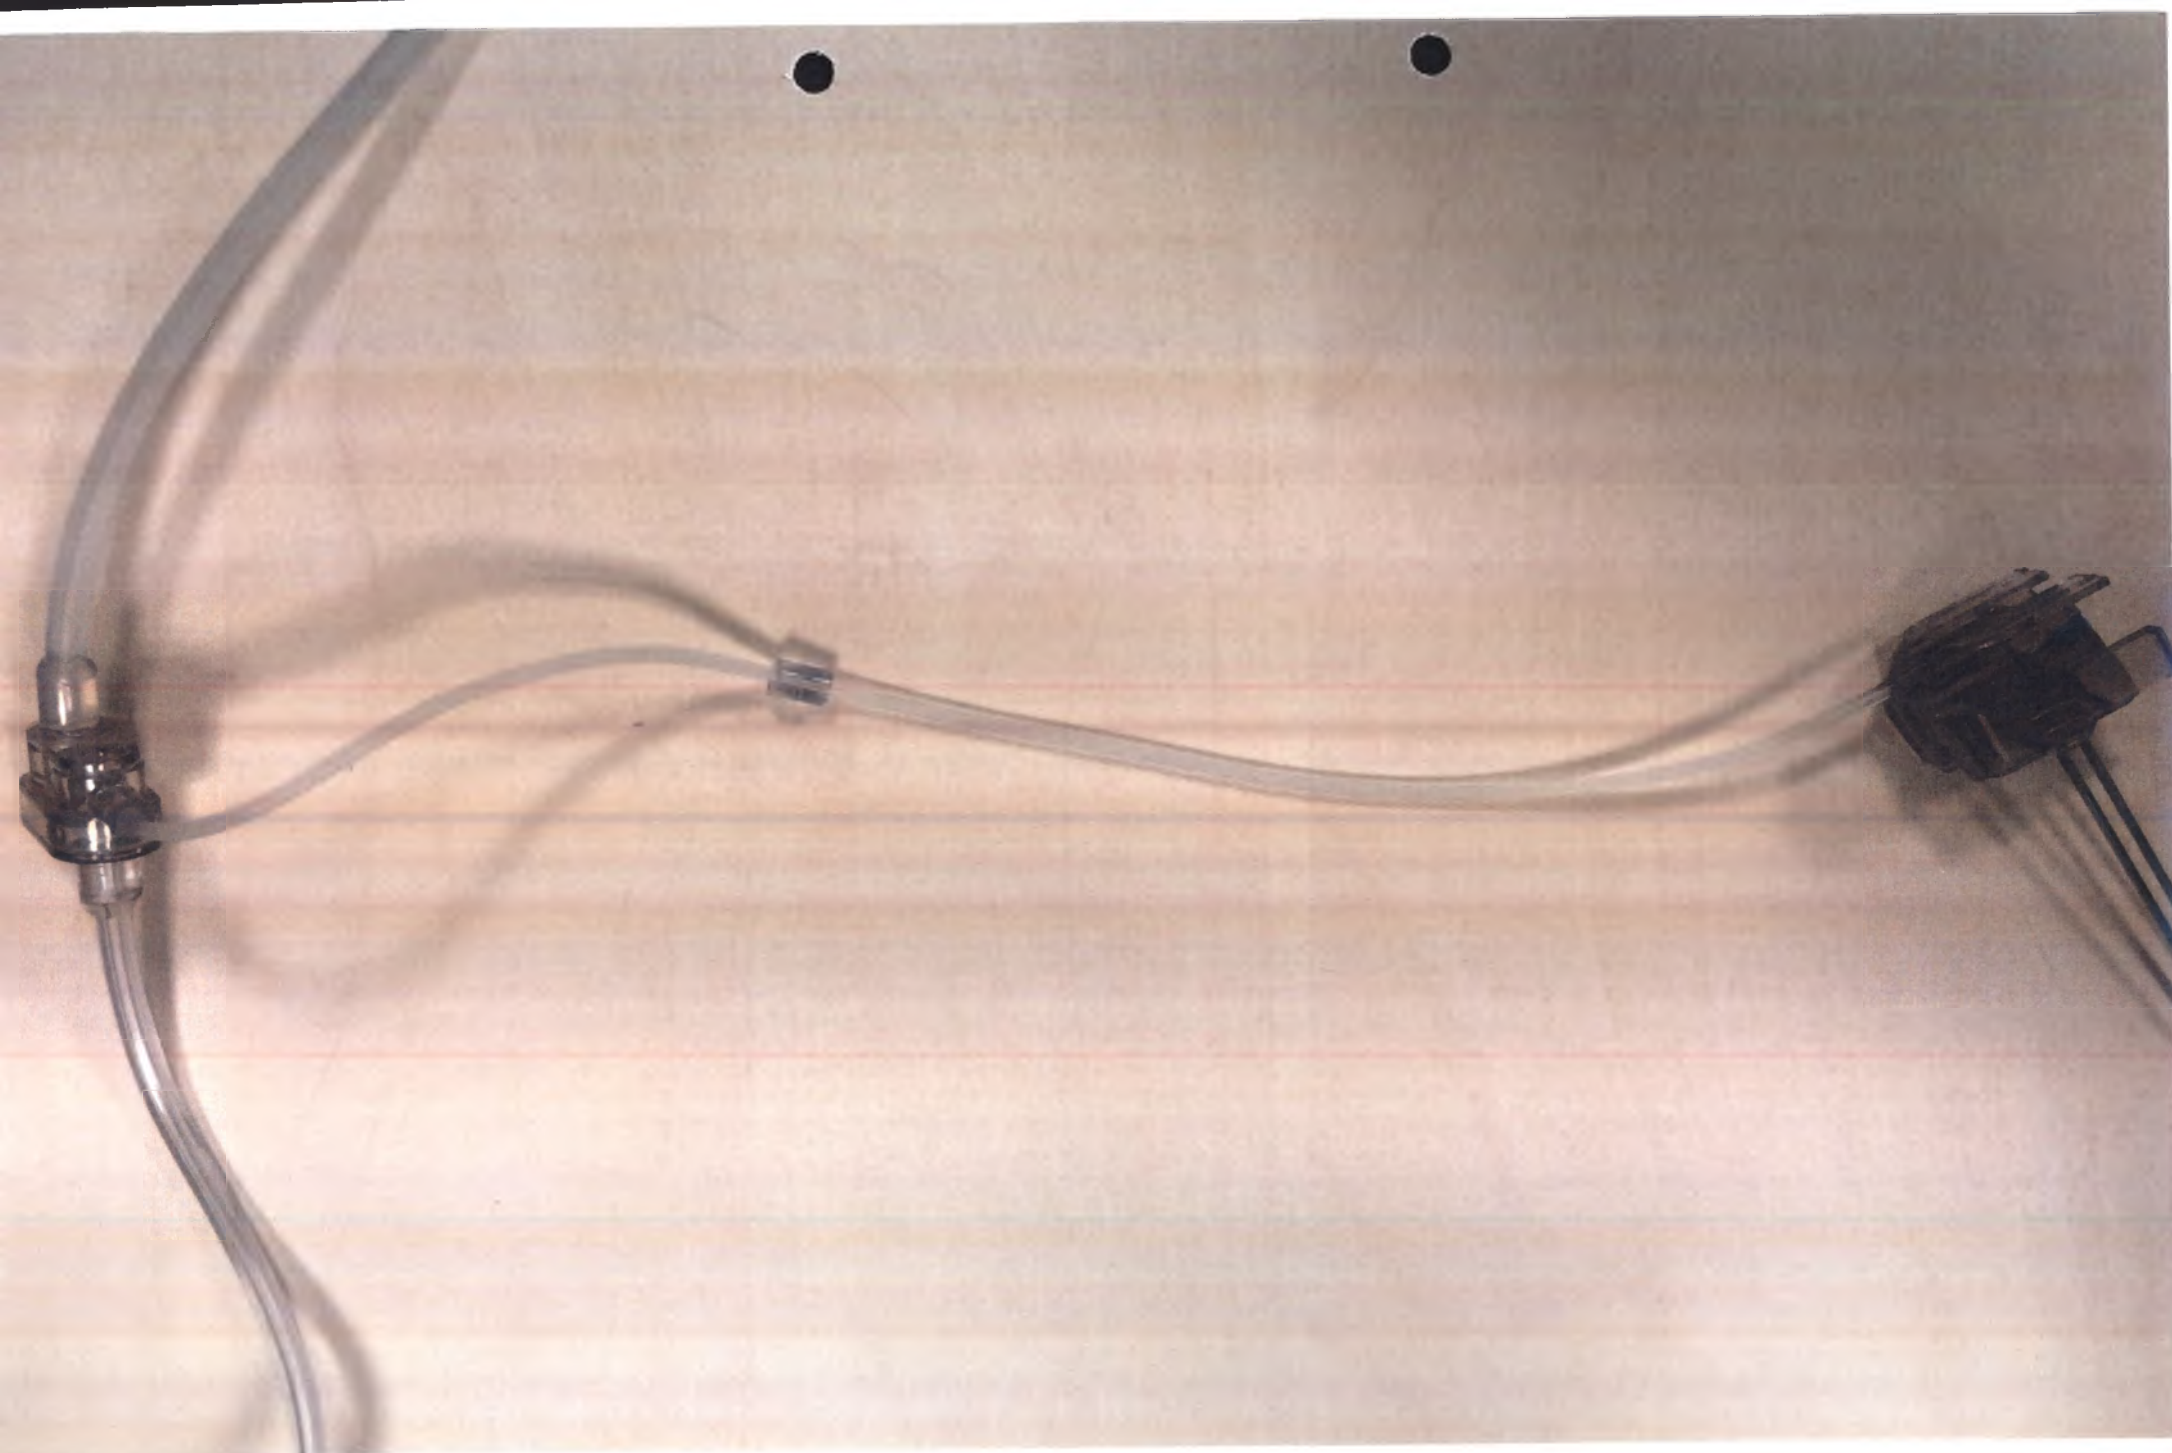


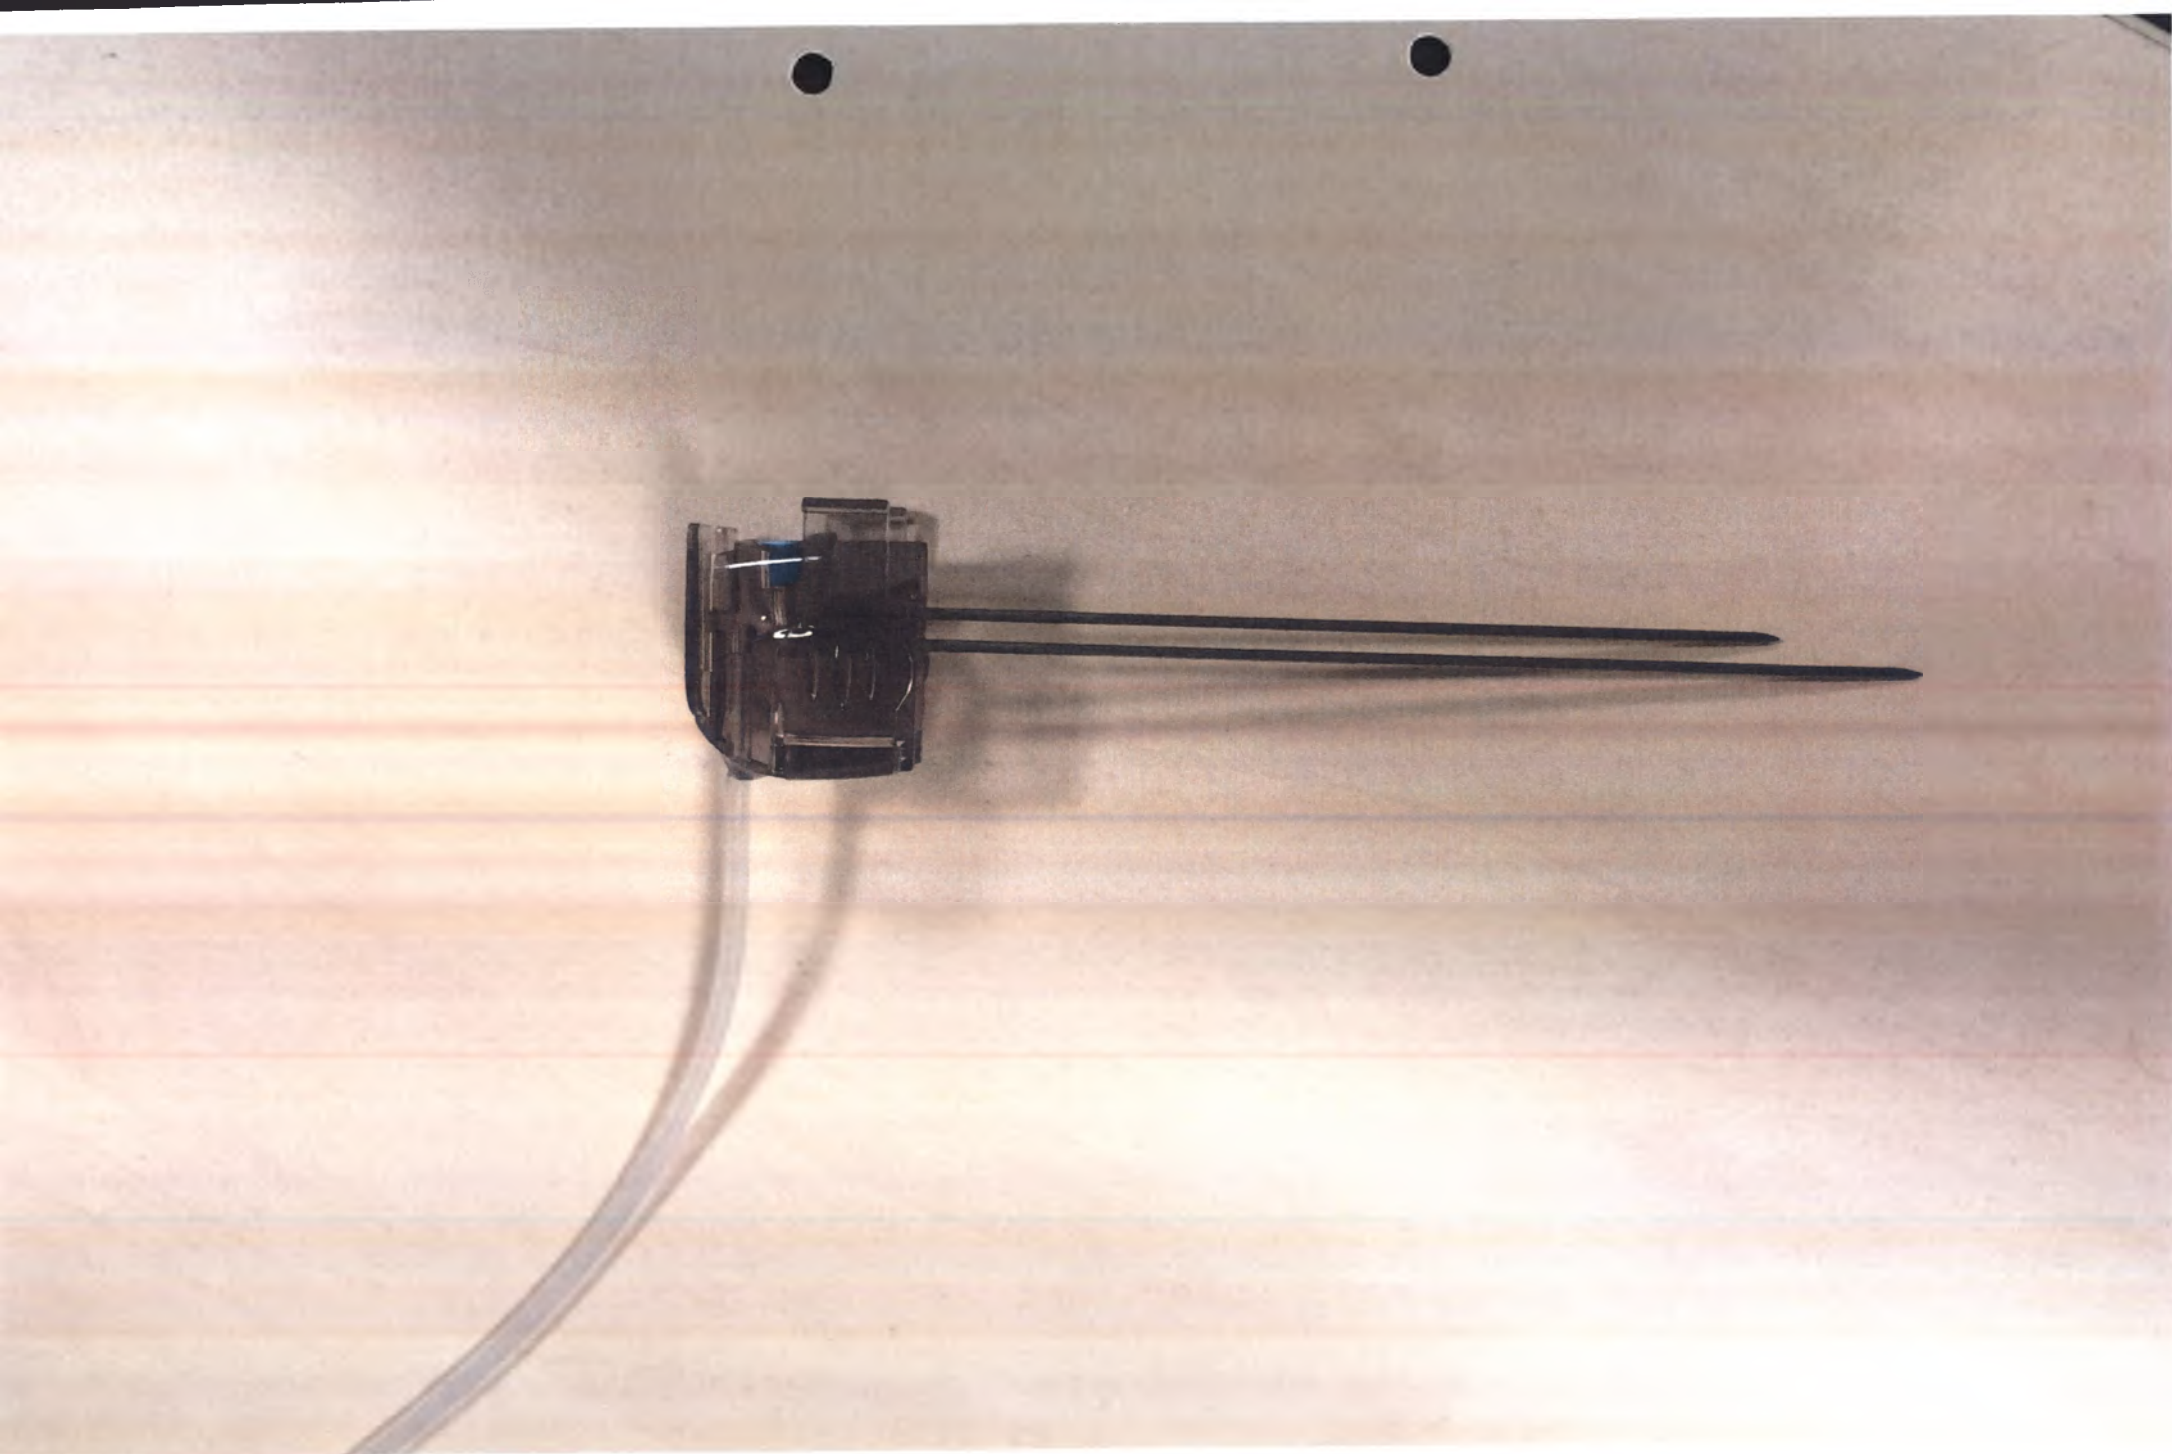




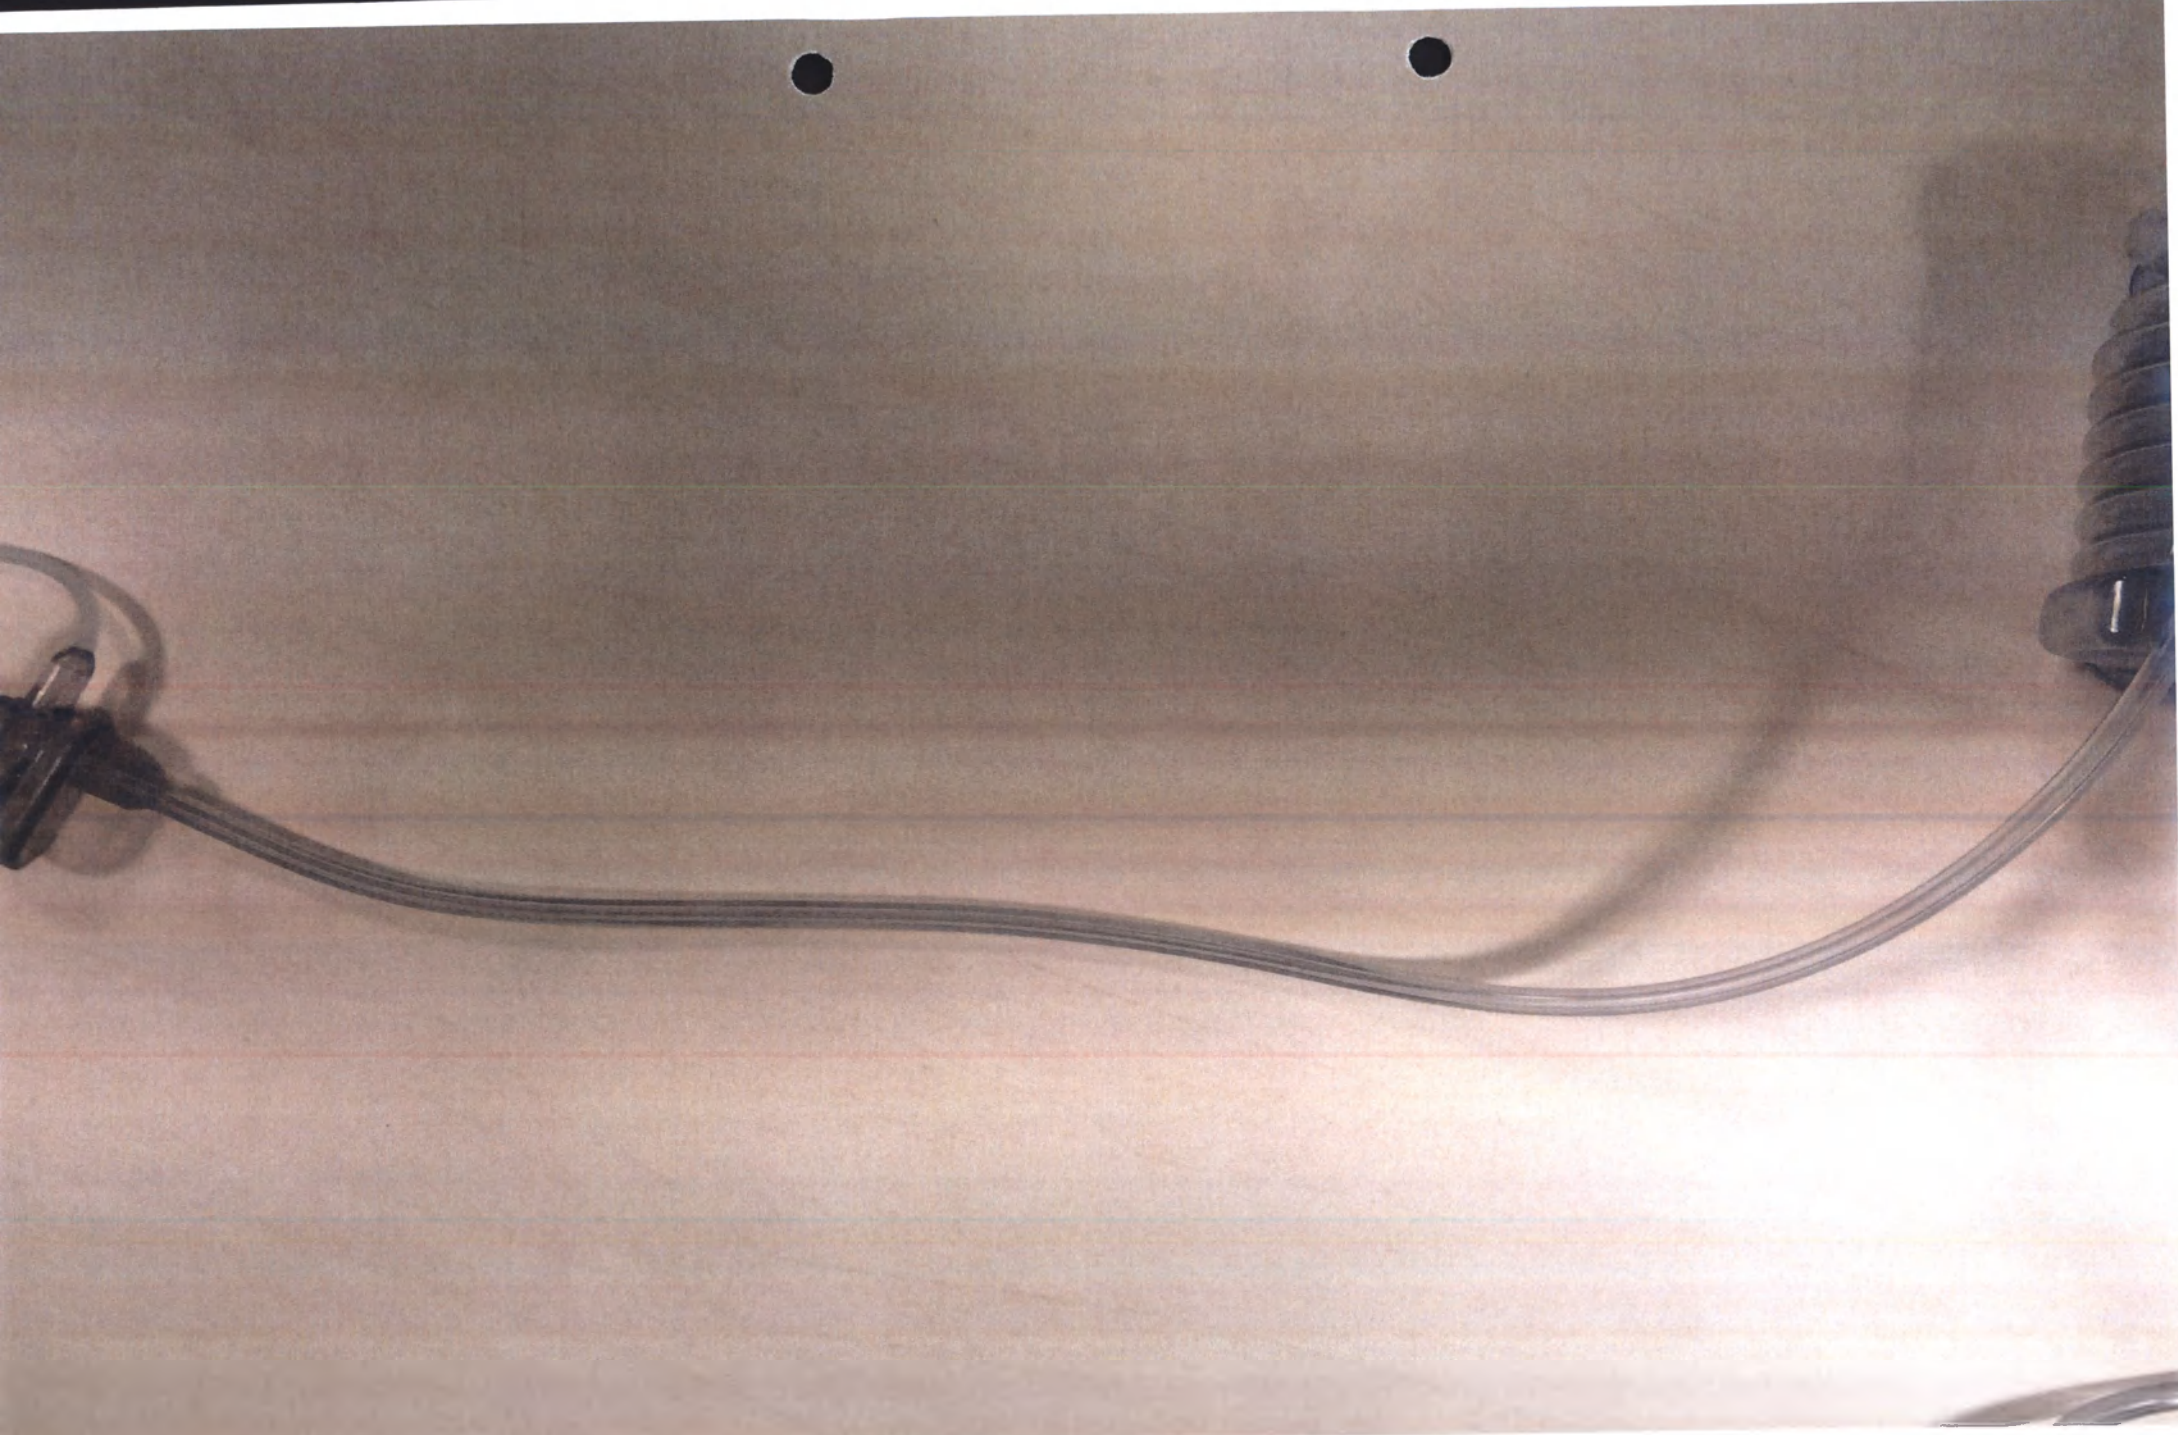



Докатущечный сегмент трубки 17176
21.03.2019

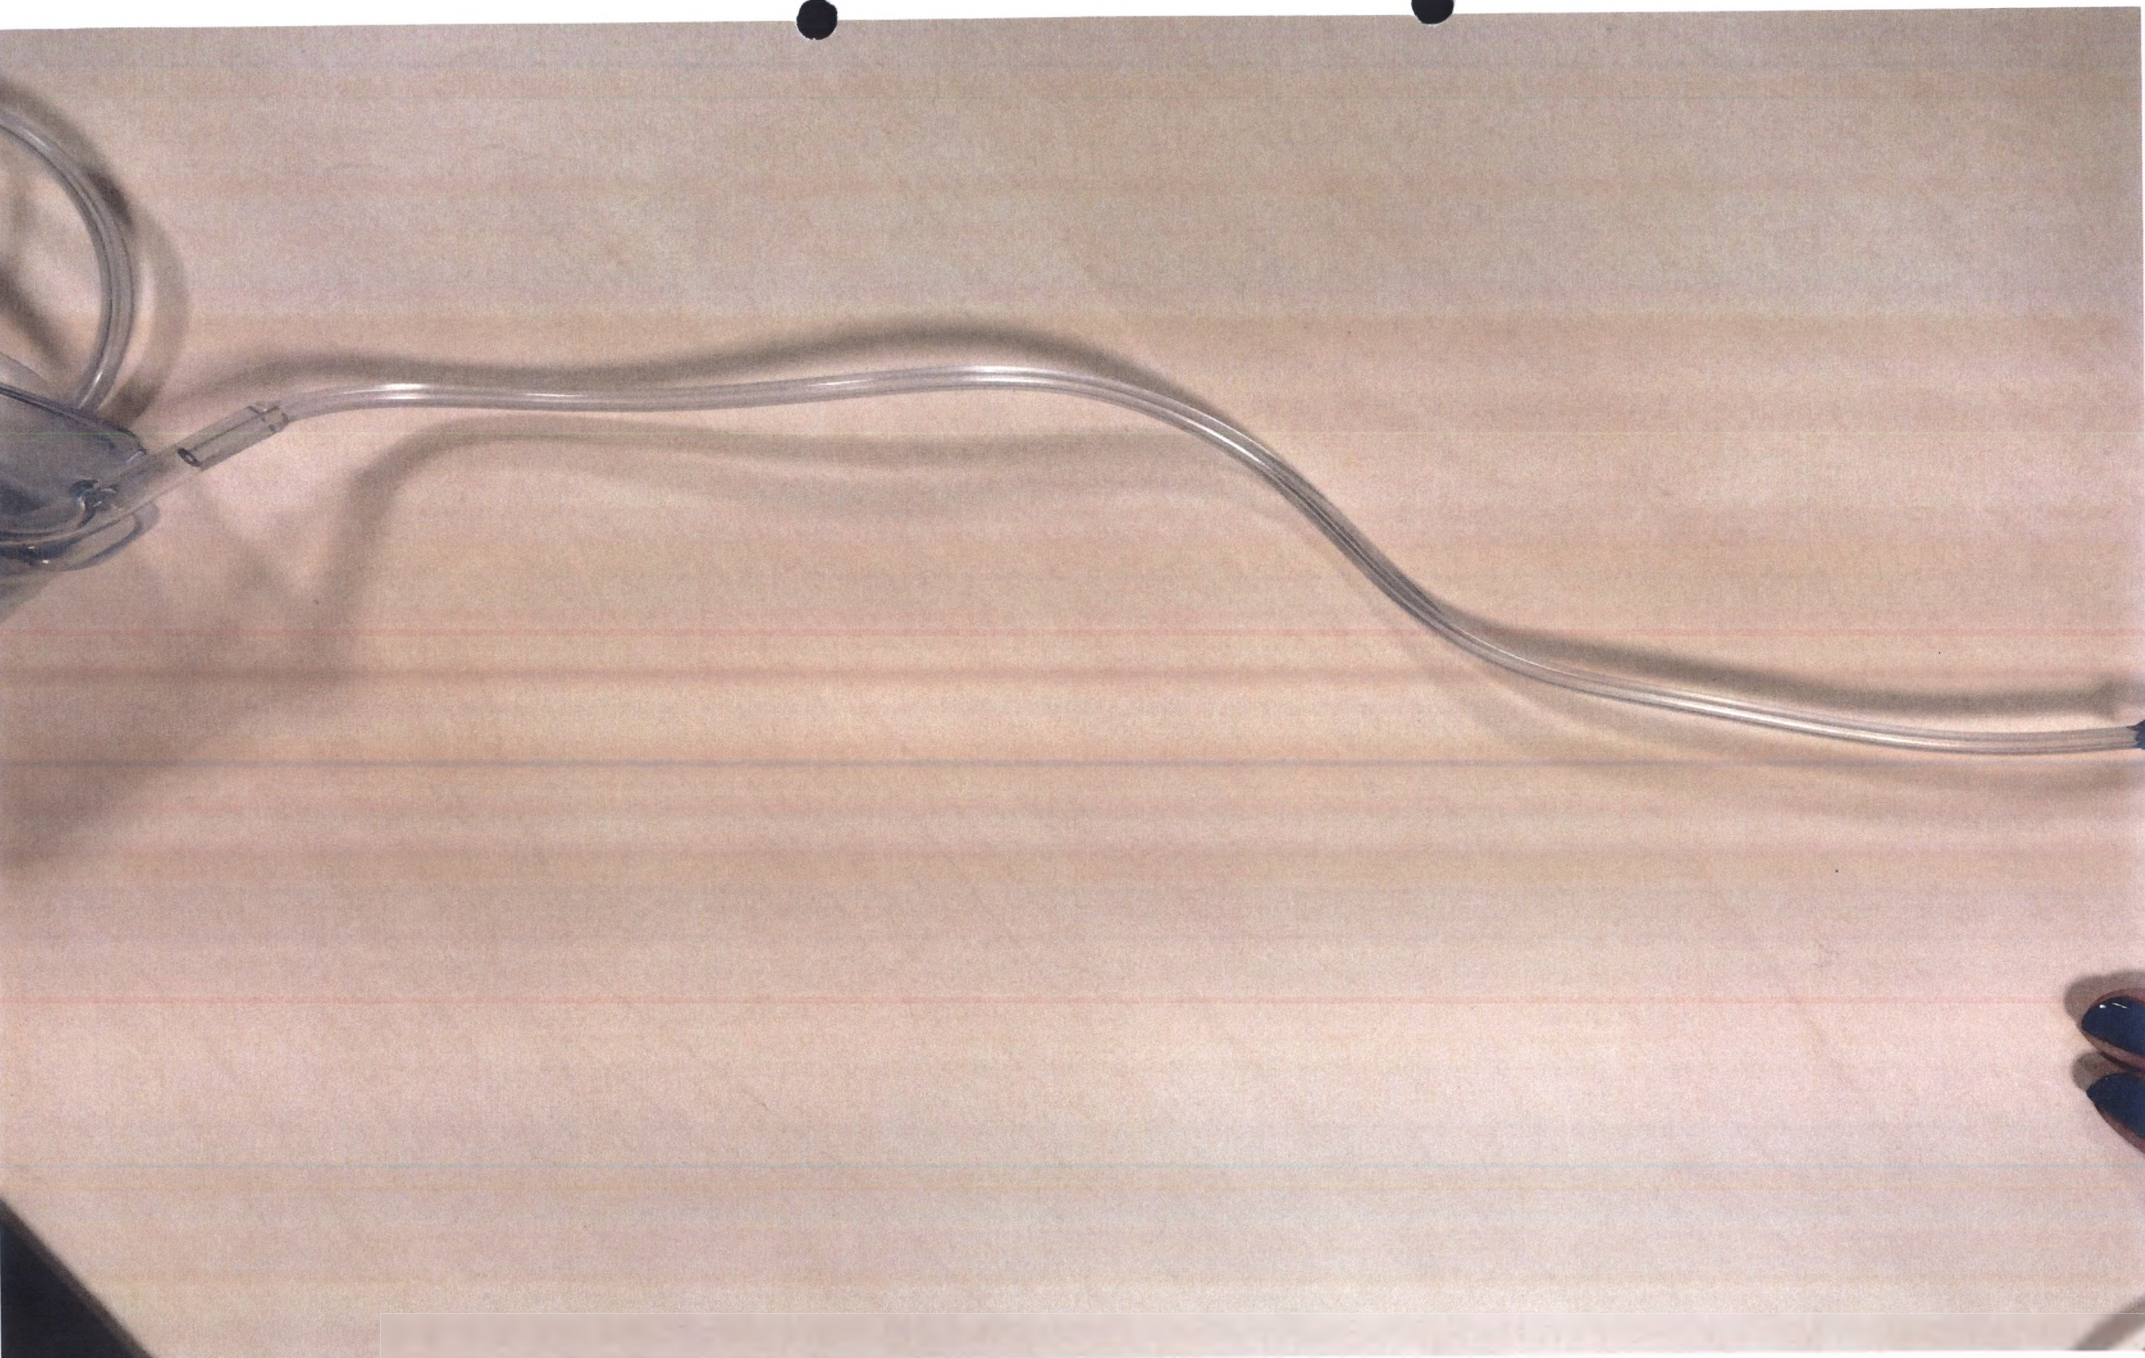


Послекатушечный сегмент трубки

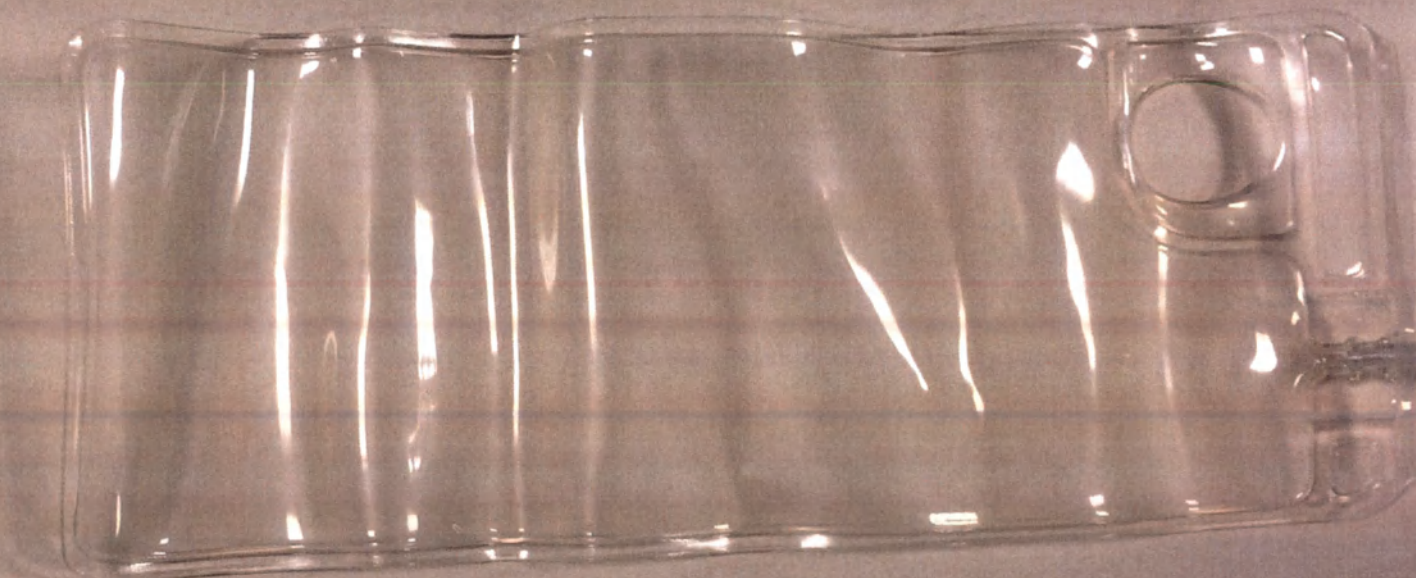


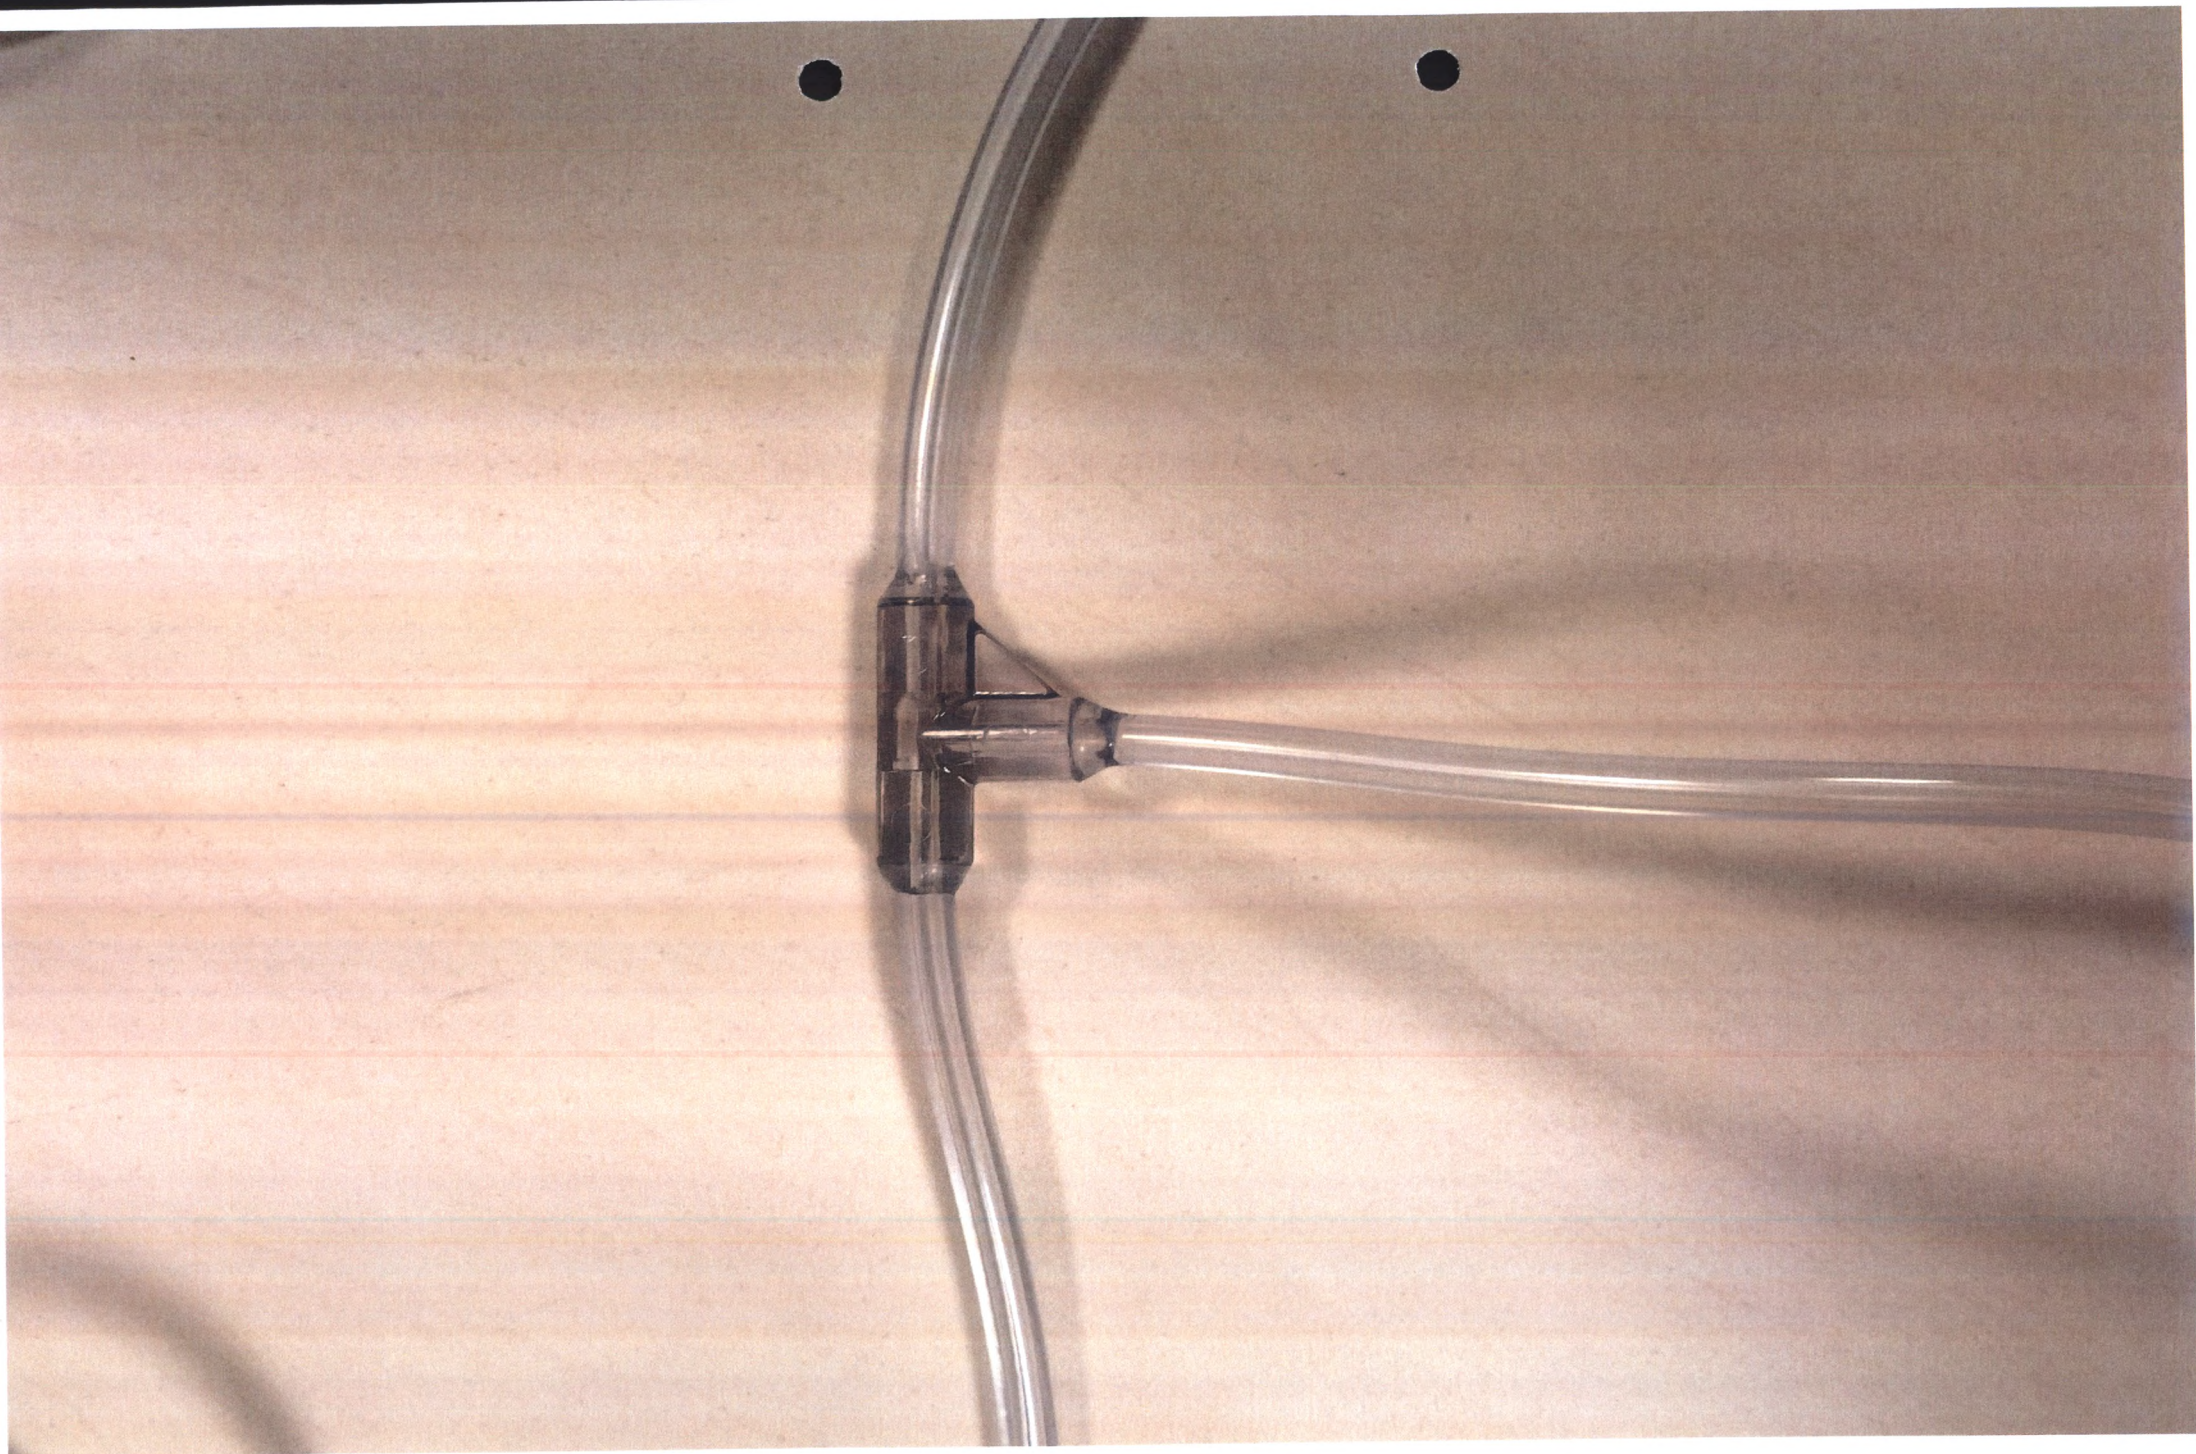


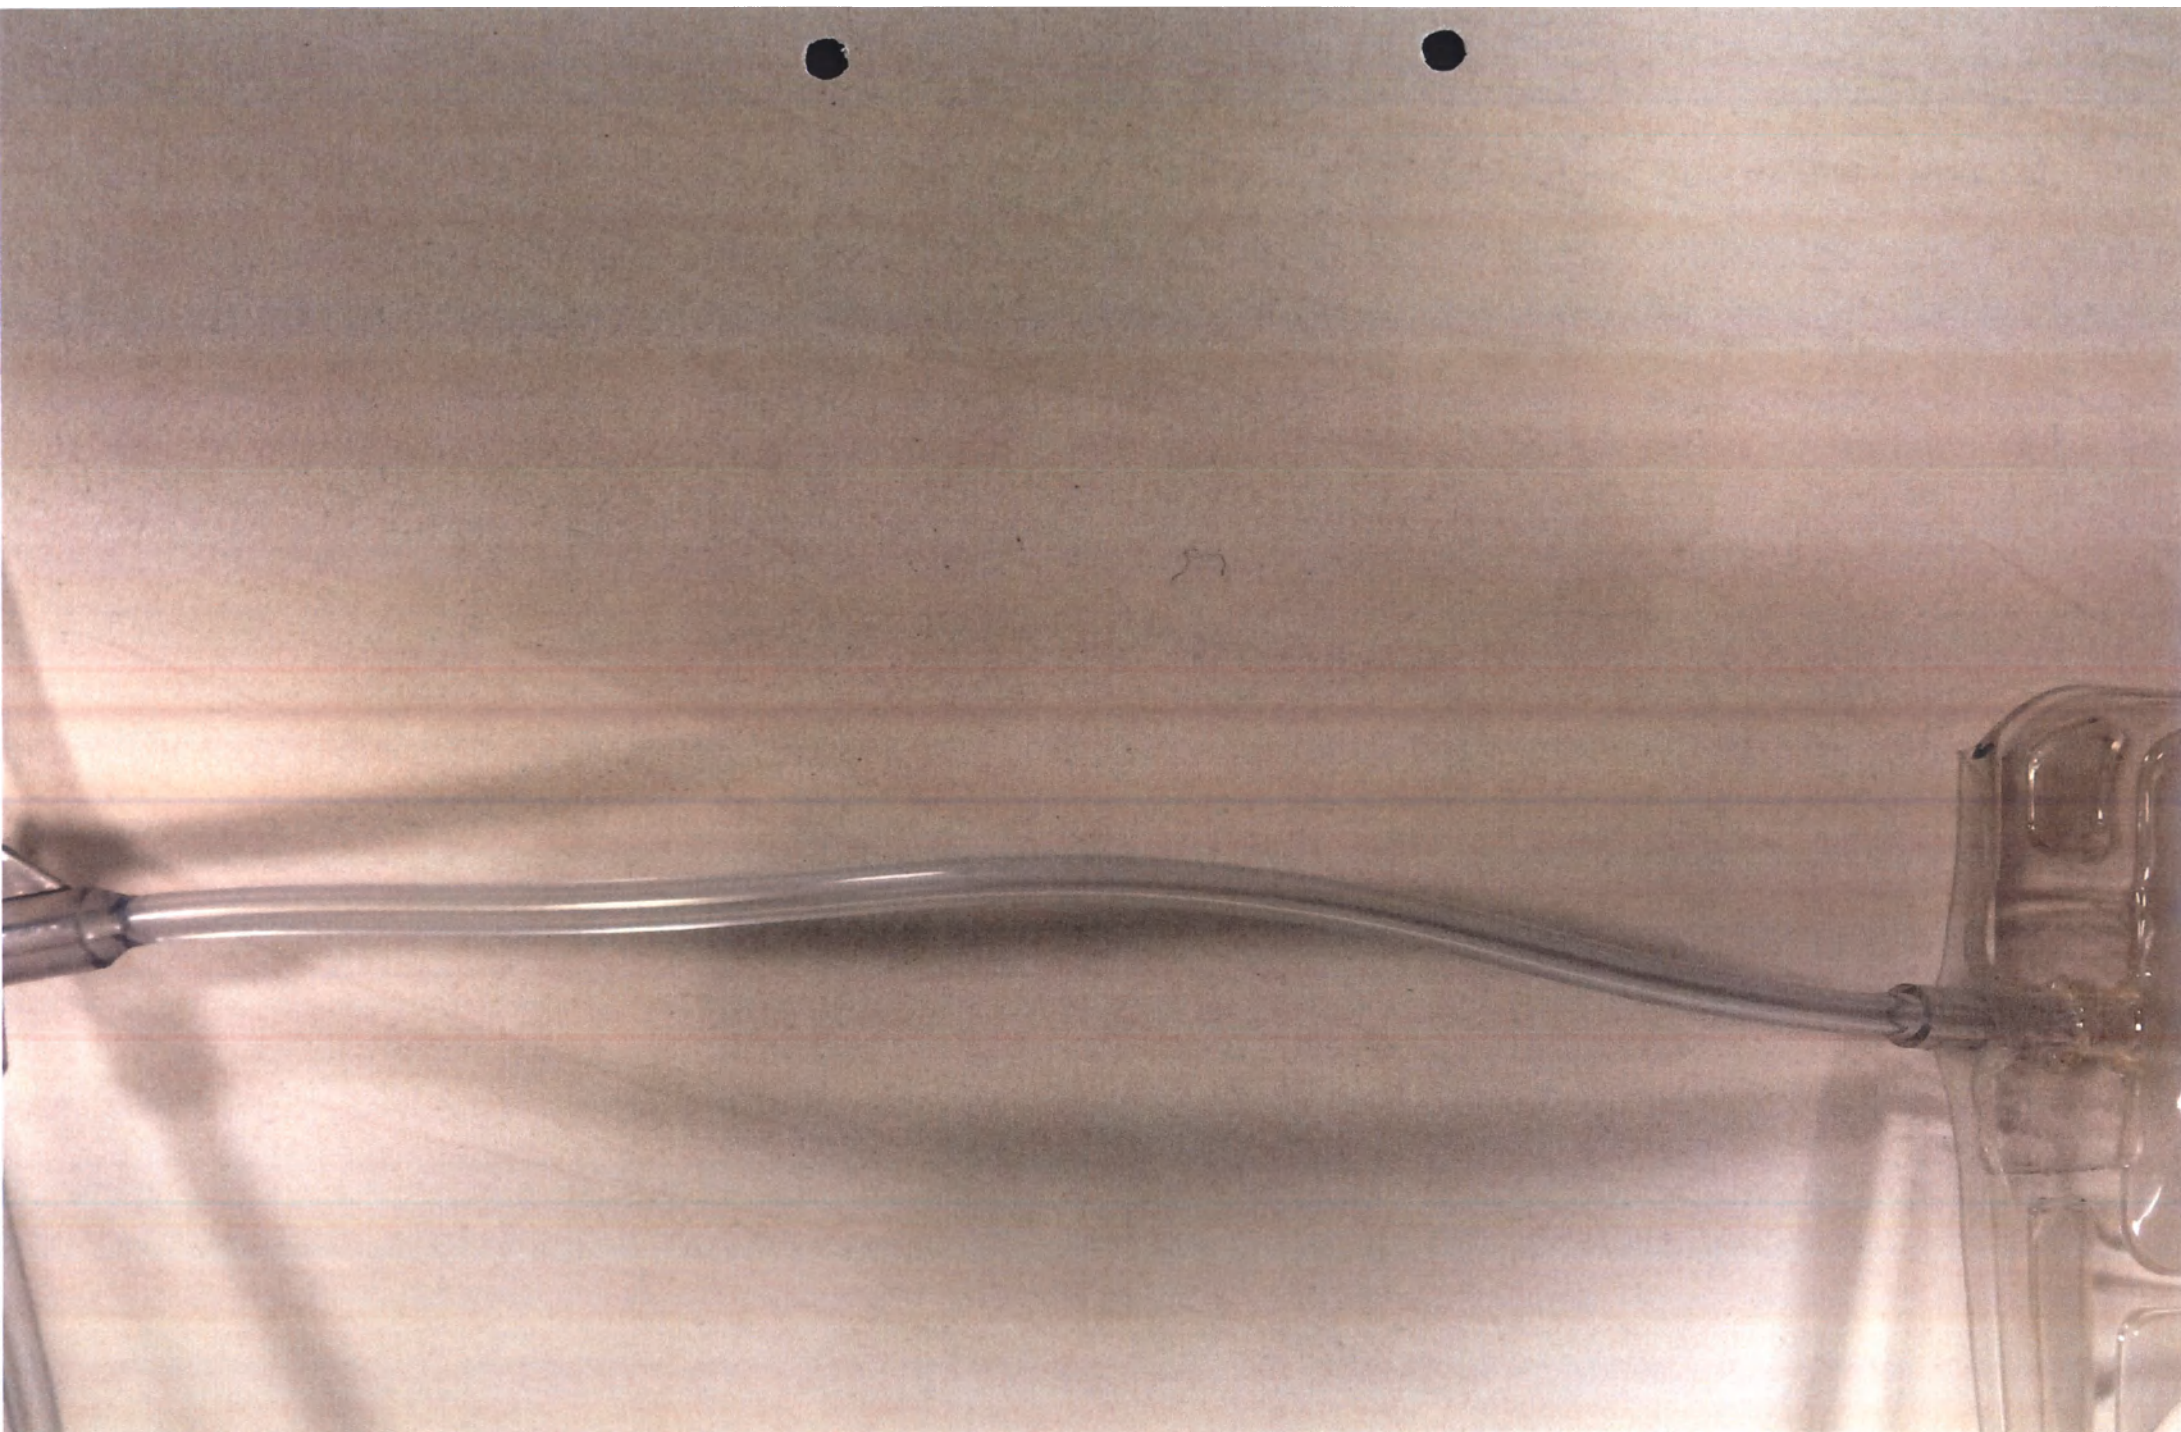

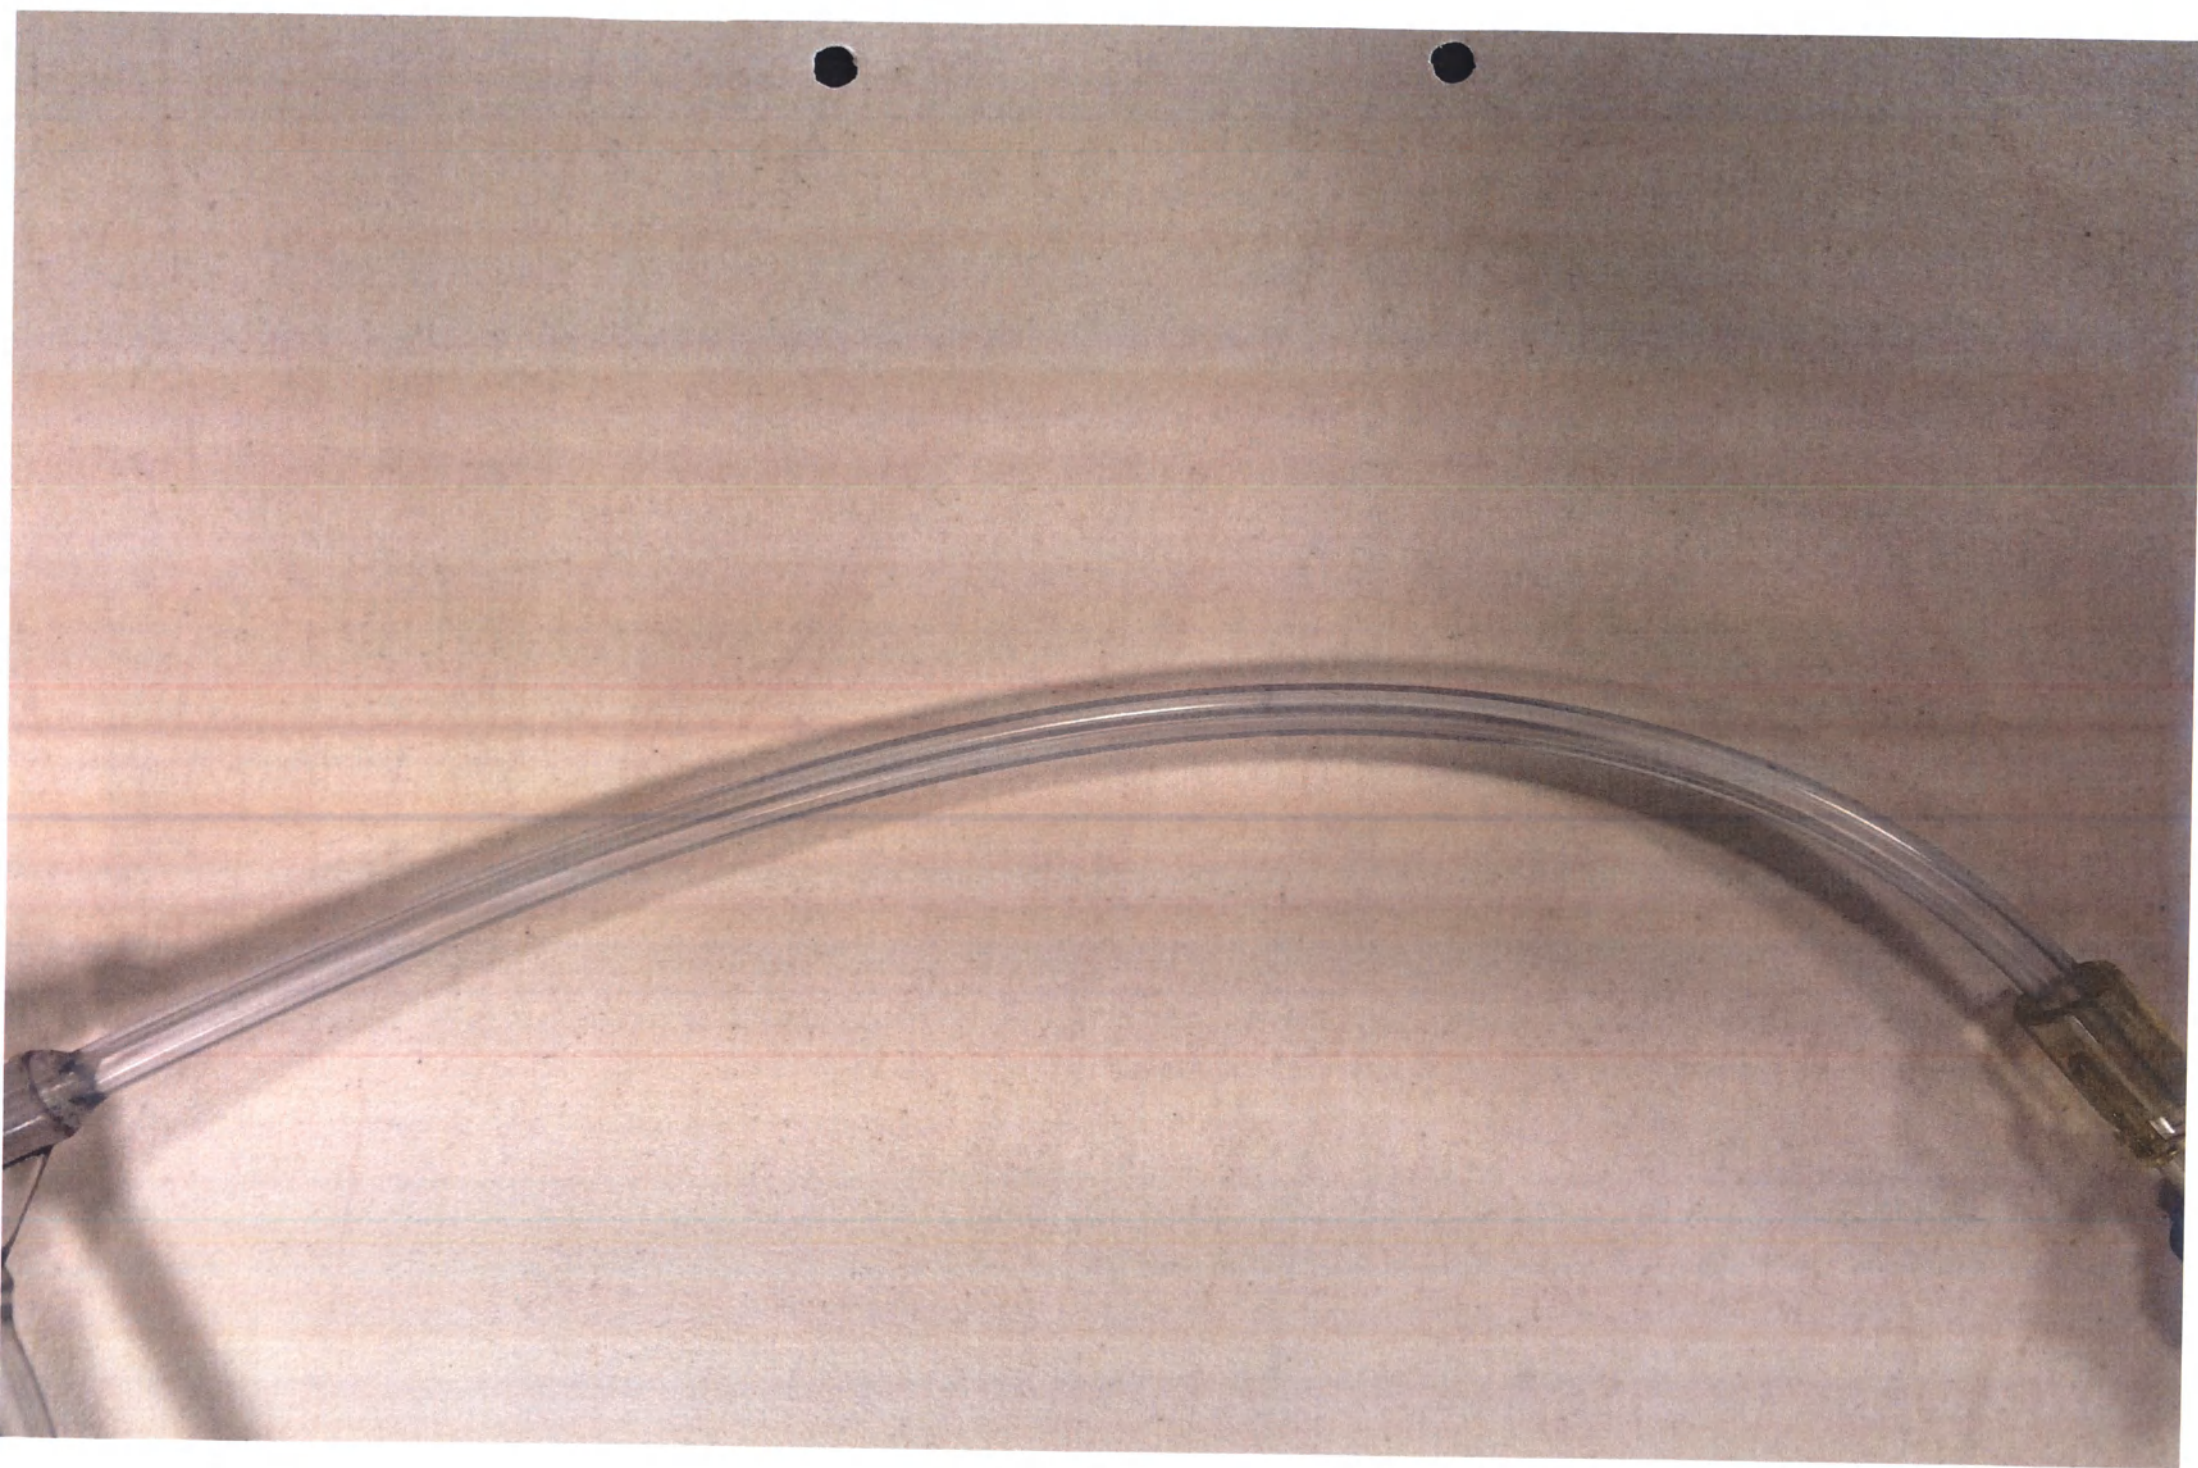



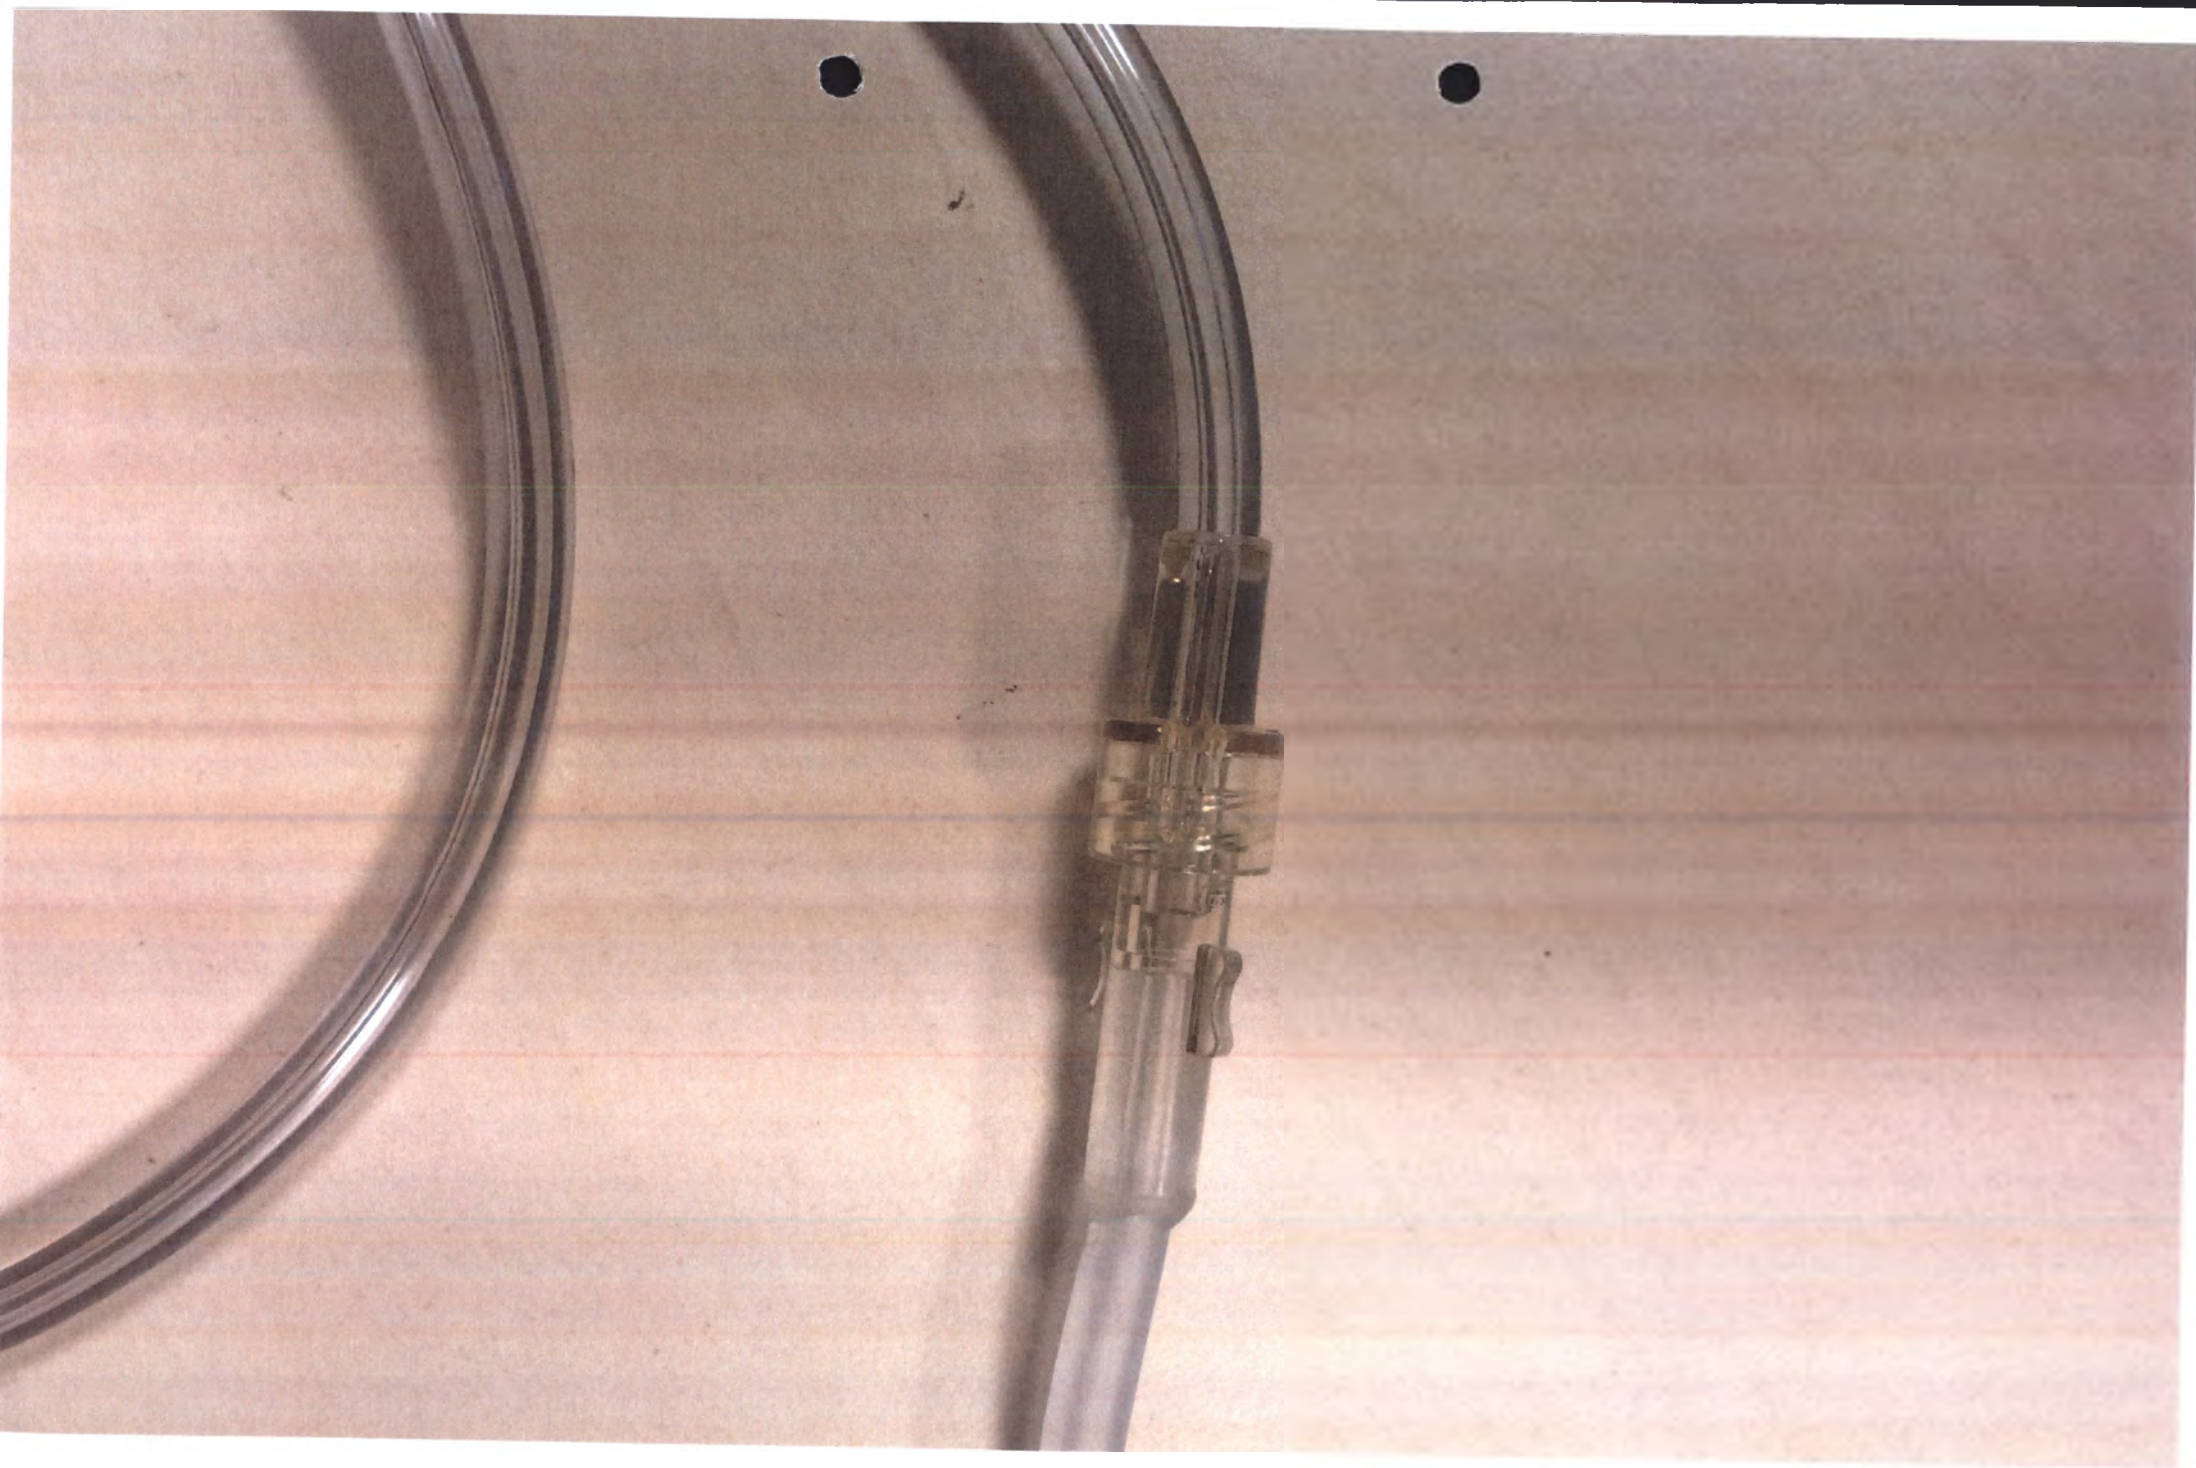

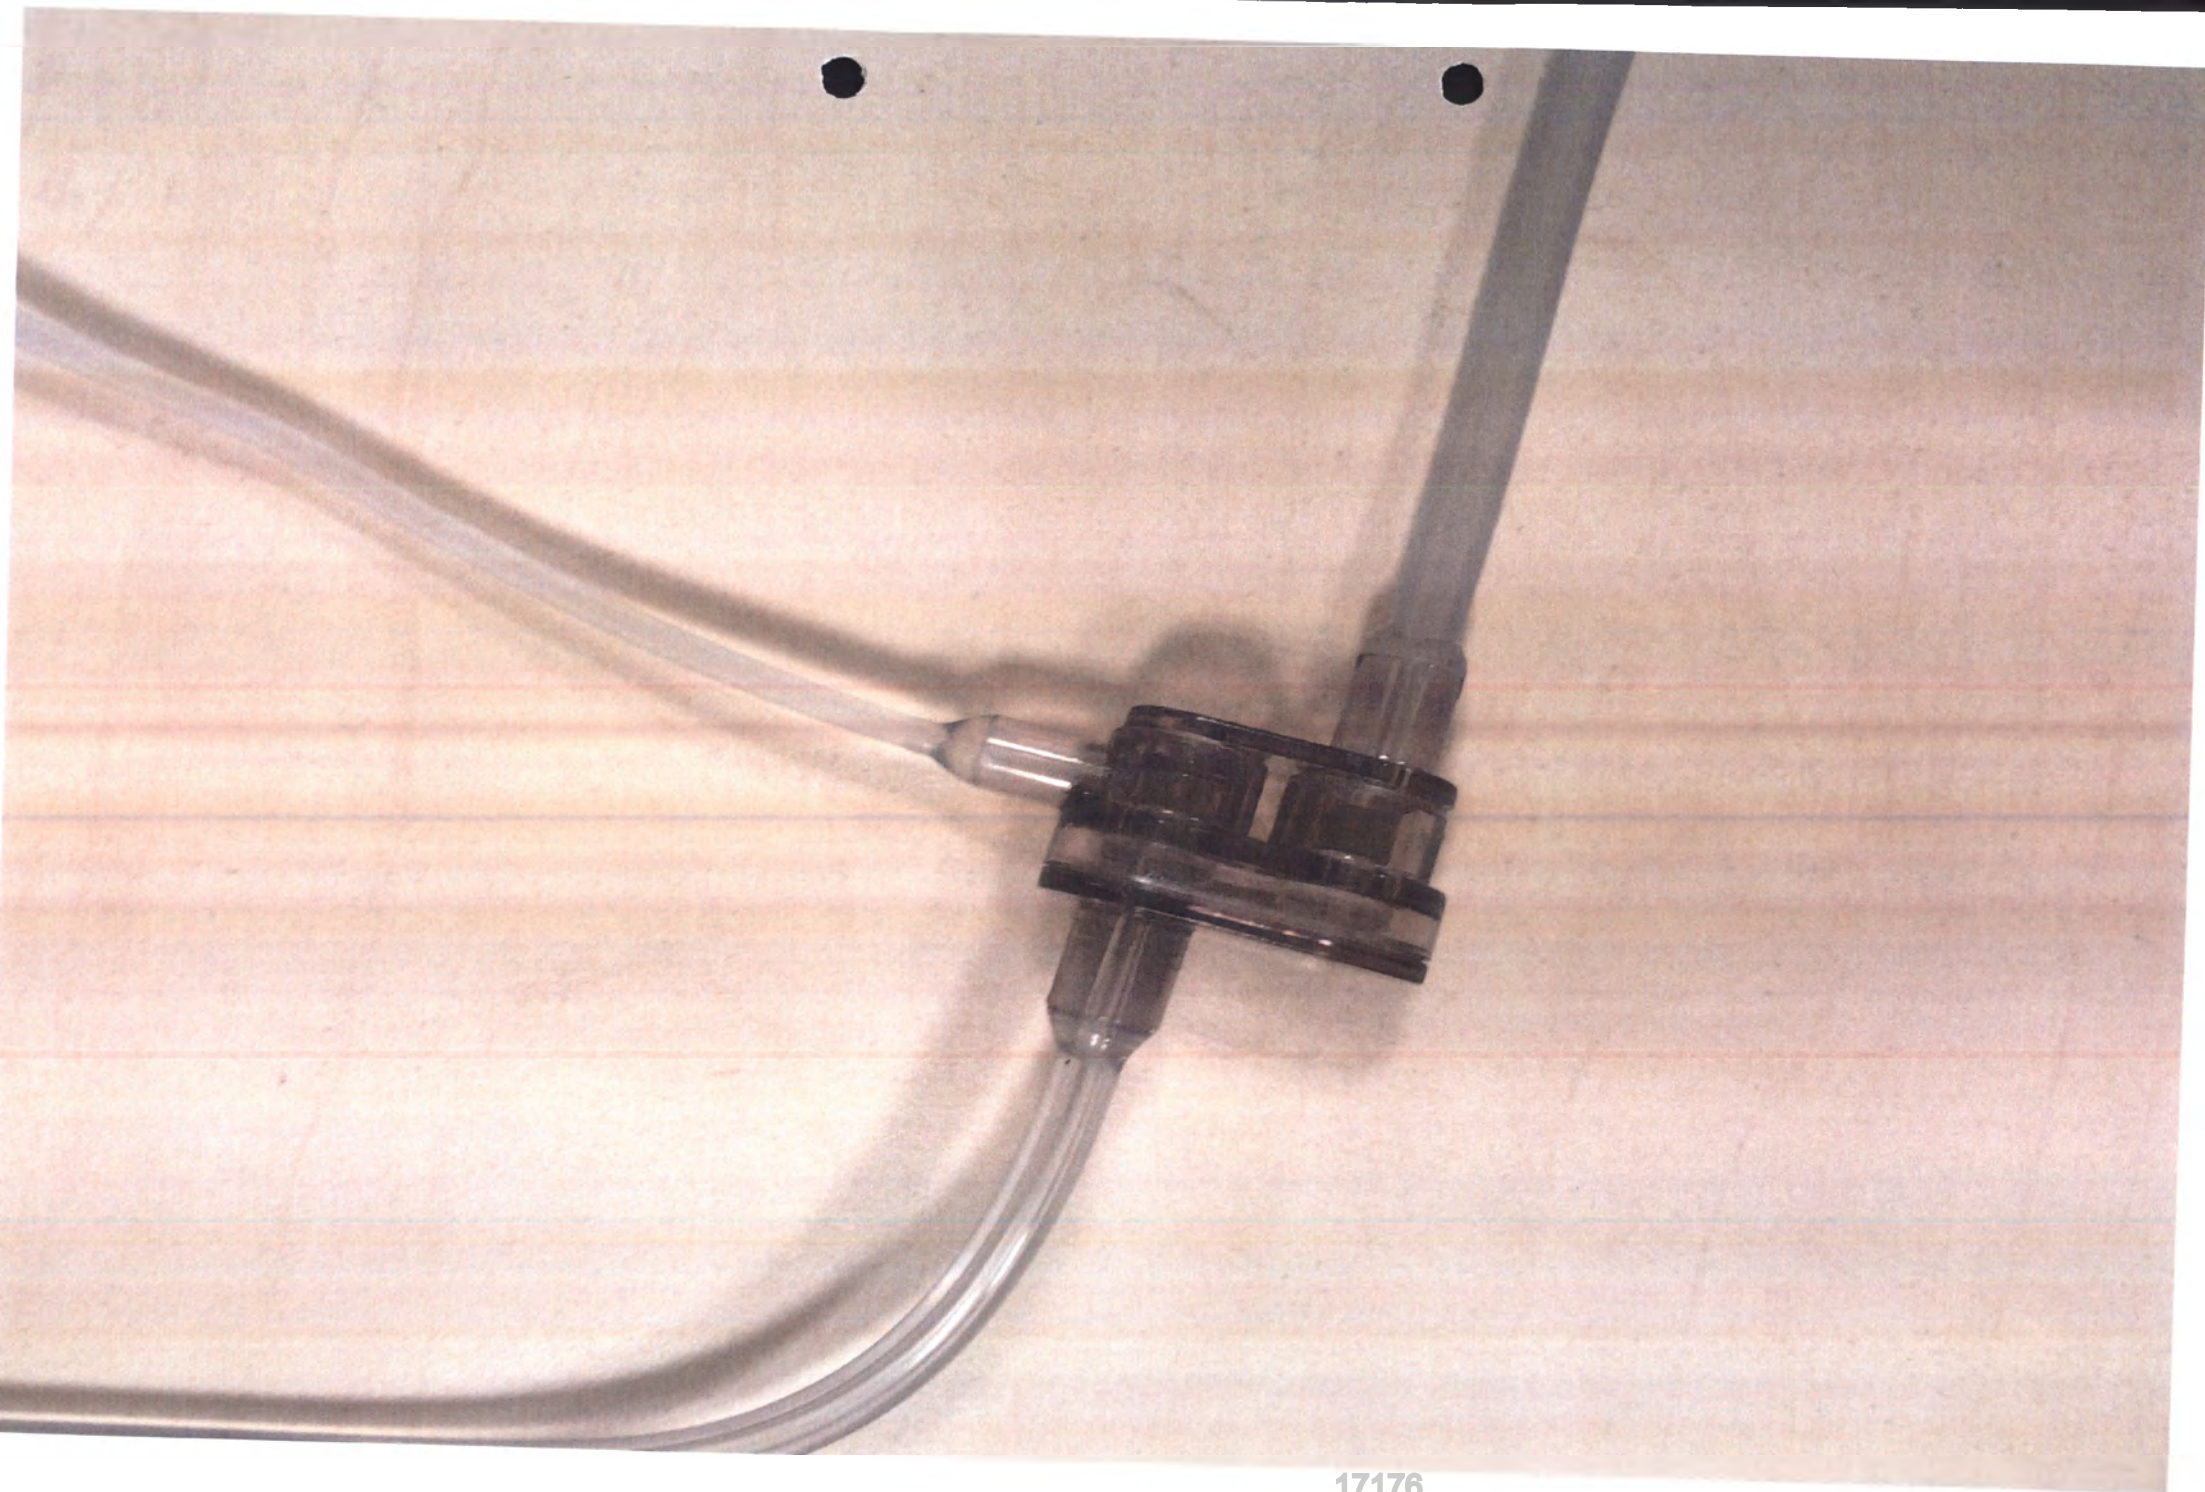



Набор одноразовый стерильный для введения раствора пациенту (PAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии
17176
21.03.2019
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU MEDRAD Intego в составе в общем виде (в стерильной упаковке)



медрад Intego
 Patient Administration Set

STERILE EO
 CE 0084
 PC
 Patents: www.medradpatients.bayer.com
 By Only
 Assembled in USA

Bayer Medical Care Inc.
 1 Bayer Drive
 Indianapolis, IN 46051-0780
 U.S.A.

Bayer Medical Care B.V.
 Hoesierweg 24
 6199 AC Maastricht Airport
 The Netherlands

REF INT CPS

2018-12-11

2021-12-11

LOT 8409597



(01)00616258011202
 (11)181211
 (17)211211
 (10)8409597

EX Contenido: Cantidad 1 Conjunto de administración de
 pacientes / Ensamblado en EE. UU. **FR** Nécessaires à
 l'infusion du patient / Assemblé aux Etats-Unis
CO Importado y distribuido por: Bayer S.A. Av. Antequera 57-52
 Bogotá, D.C./RS. No. INVIMA 20166 BC-0015408 MX RS No
 0942C2013 SSA Equipo de infusión/Conjunto de administración

del Sistema de infusión Intego Pcs Medrad (PAS) **PB** Contenu:
 Conjunto de administración ao paciente / PSICOLOGO
REPROCESAR / Esteril / Montado nos EUA / Importado por:
 Bayer S.A., Rua Domingos Jorge, 1100 CEP: 0479-900 -
 Sorocaba - São Paulo - SP CEP: 13.453-620/0001-15 Registro
 ANVISA nº: 80384389002 Resp. Tec. Renata de Ros Chado
 CRF-SP 38074, SMC 00800 702 12 41, 34@bayer.com

RU Набор для введения раствора пациенту / Импортёр
 на территории России: АО «Байер Фармасьютикал
 «Российская», 107113, 3-й Рубинский ул., д.18, стр.2,
 Москва, Россия тел: +7 495 231 3200 www.bayer.ru/
 Производител: Байер Медикал Кэа Инк. США /
 RU IP PZN 2016/4810 от 29 сентября 2016 год /

Сделано в США TR hasta procedure 5x8 / AUD de
 monte edlin / **CS** 德意志医药 / 产品名称:
 输液管路组件 / 型号: INT CPS / 经销商名称: Bayer
 Medical Care Inc. (拜耳医药保健公司) / 中国代理人:
 拜耳医药保健有限公司 / 地址:
 400-810-7020 / 医疗器械注册证编号:
 国械注进20173061962 / 其他内容详见说明书
 注册证编号: 20173061962 / 其他内容详见说明书

Bayer **拜耳** **Байер** **Rev 2** **3**

MEDRAD® Intego

Patient Administration Set



STERILE EO

CE 0086

PG



Rx Only

Patents: www.radpatents.bayer.com

Assembled in USA



Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.

EC REP

Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

REF

INT CPS



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX


RU Набор для введения раствора пациенту/Импортёр
на территорию России: АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит
«Радиология», 107113, 3-я Рыбинская ул., д.18, стр.2,
Москва, Россия тел.: +7 495 231 1200 www.bayer.ru /
Производитель: Байер Медикал Кэа Инк., США /
РУ № РЗН 2016/4810 от 29 сентября 2016 года /
Сделано в США

Набор одноразовый стерильный для введения раствора пациенту (PAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD Intego в составе (проект маркировки на русском языке)


* Номер РУ и дата его выдачи указаны для того, чтобы обозначить место, предназначенное для данной информации, а также используемый формат. Данные могут быть изменены по причине актуализации досье.


Дополнительная маркировка для каждой пользовательской упаковки:


Нетоксично внутри

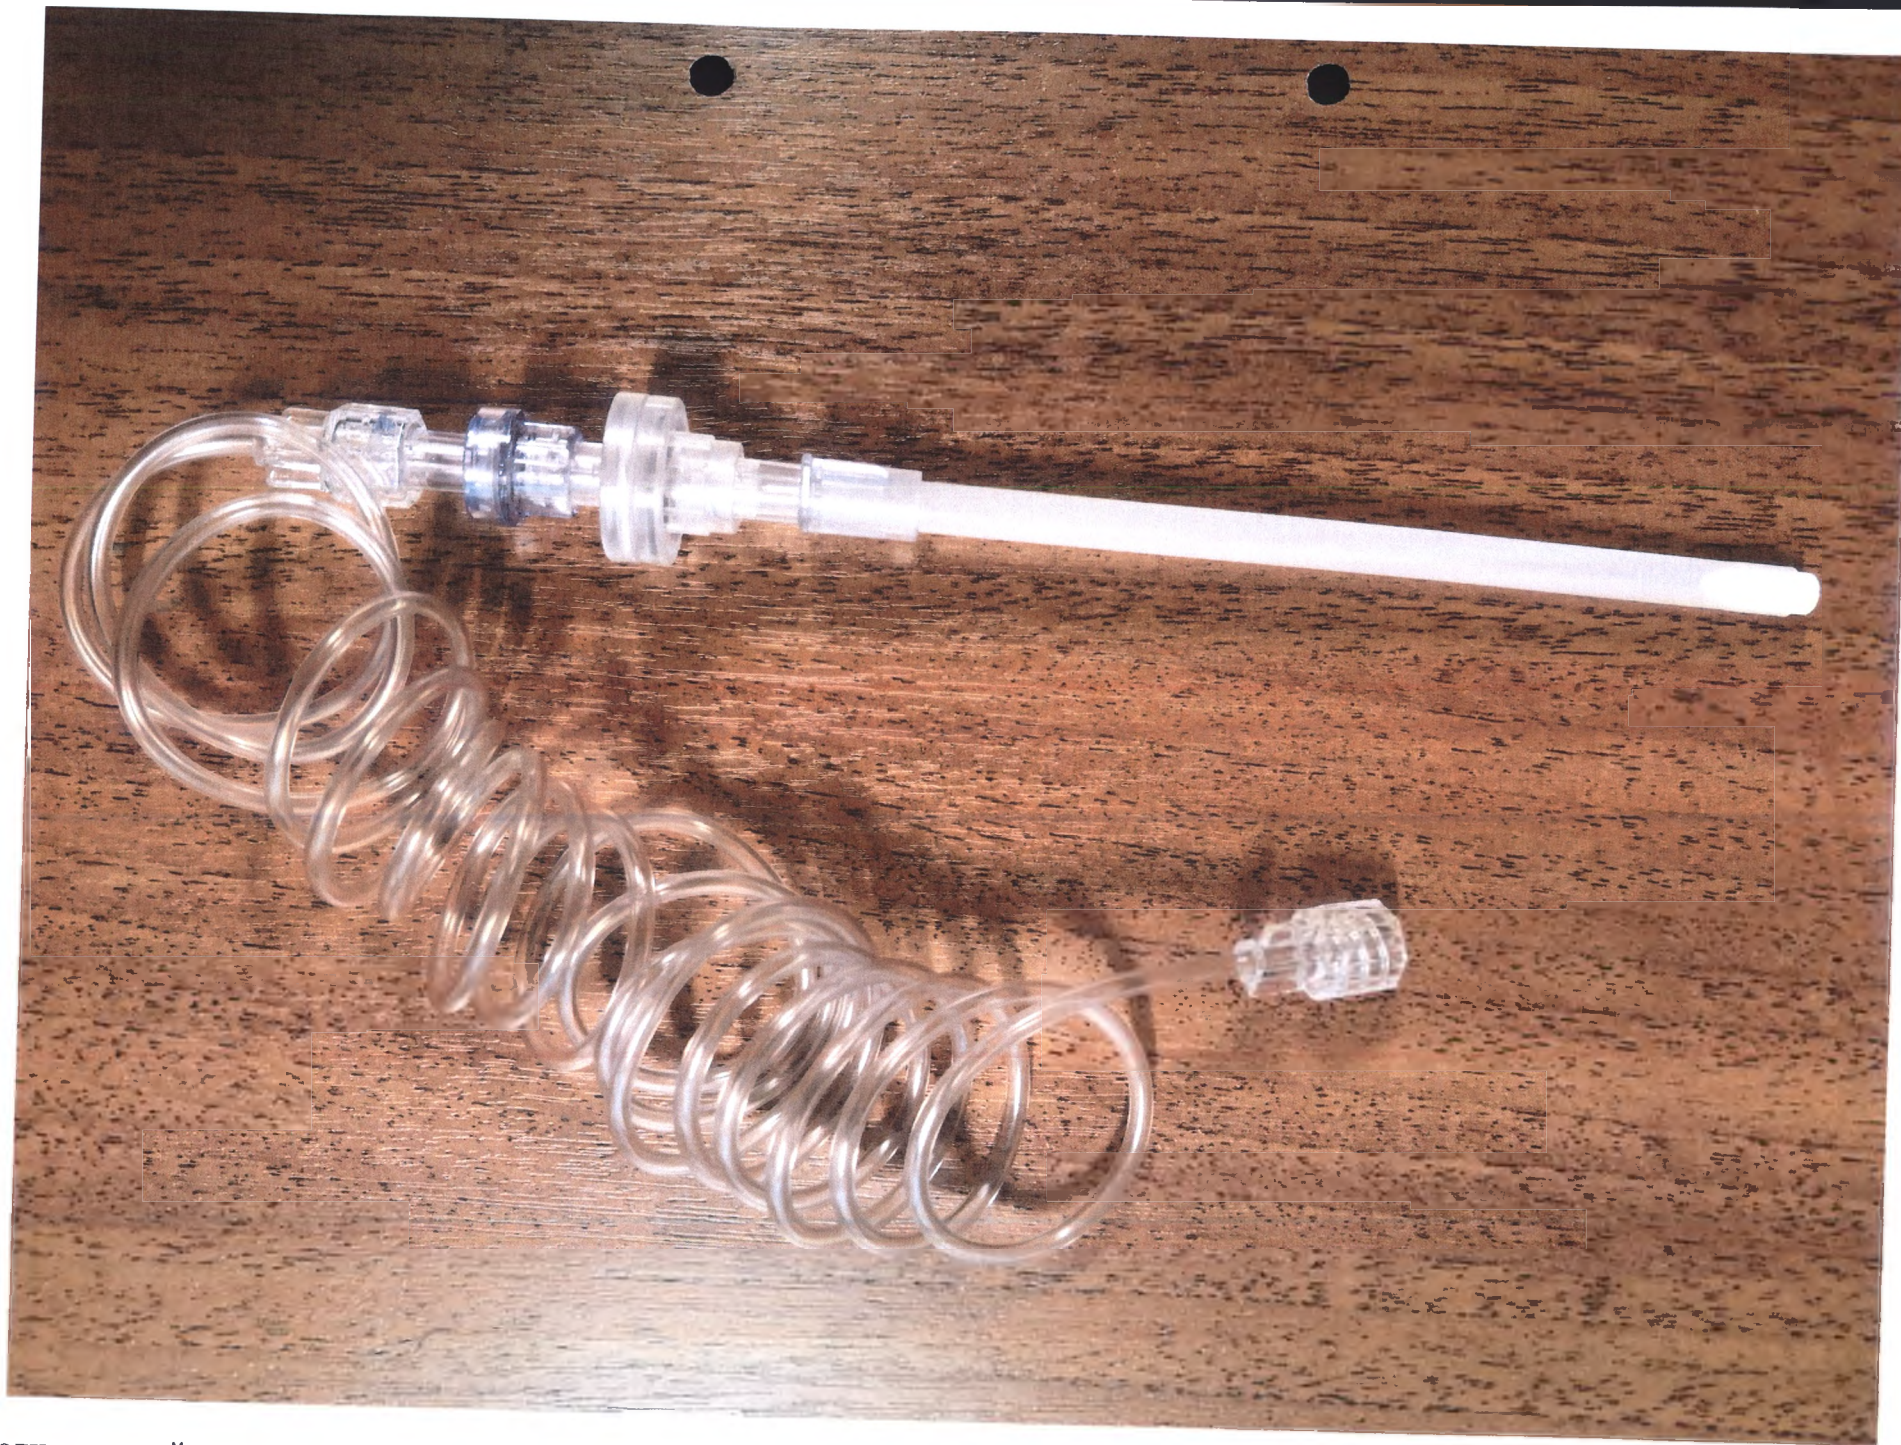


Набор одноразовый стерильный для введения раствора пациенту (PAS) для системы инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии

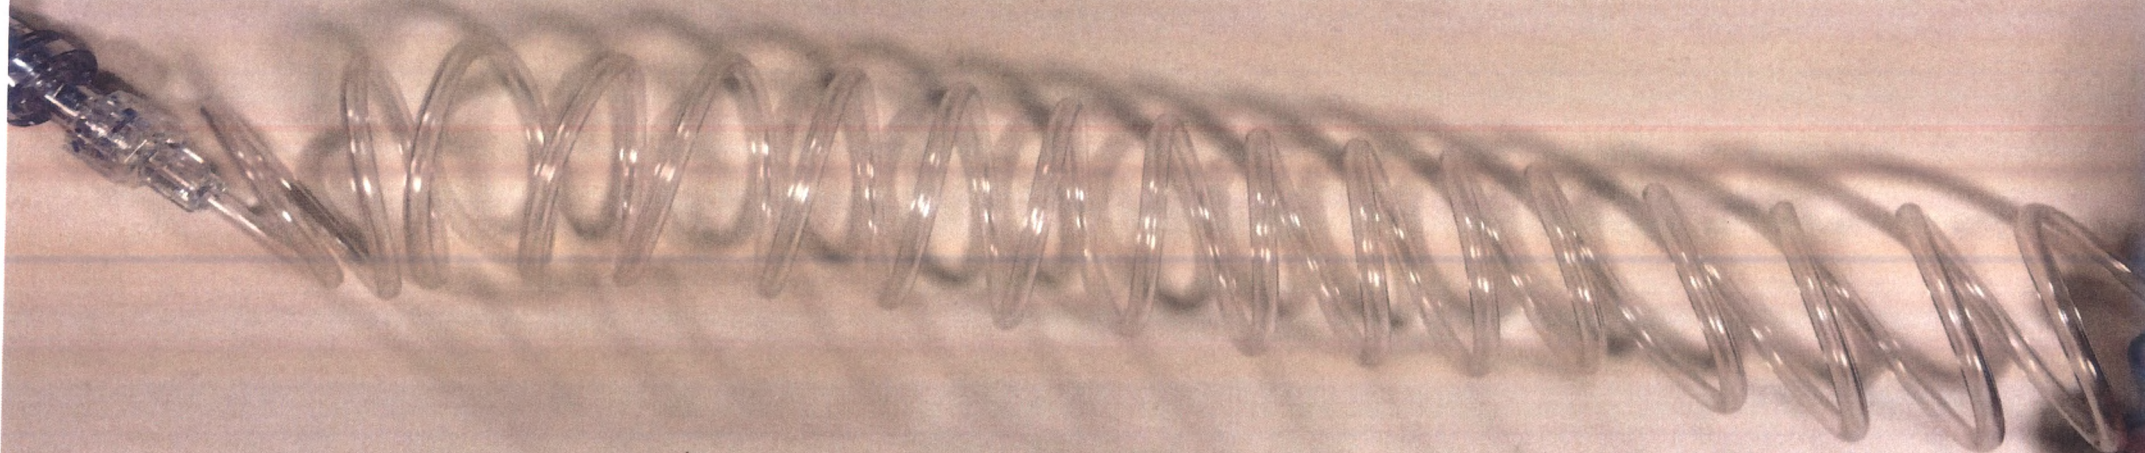

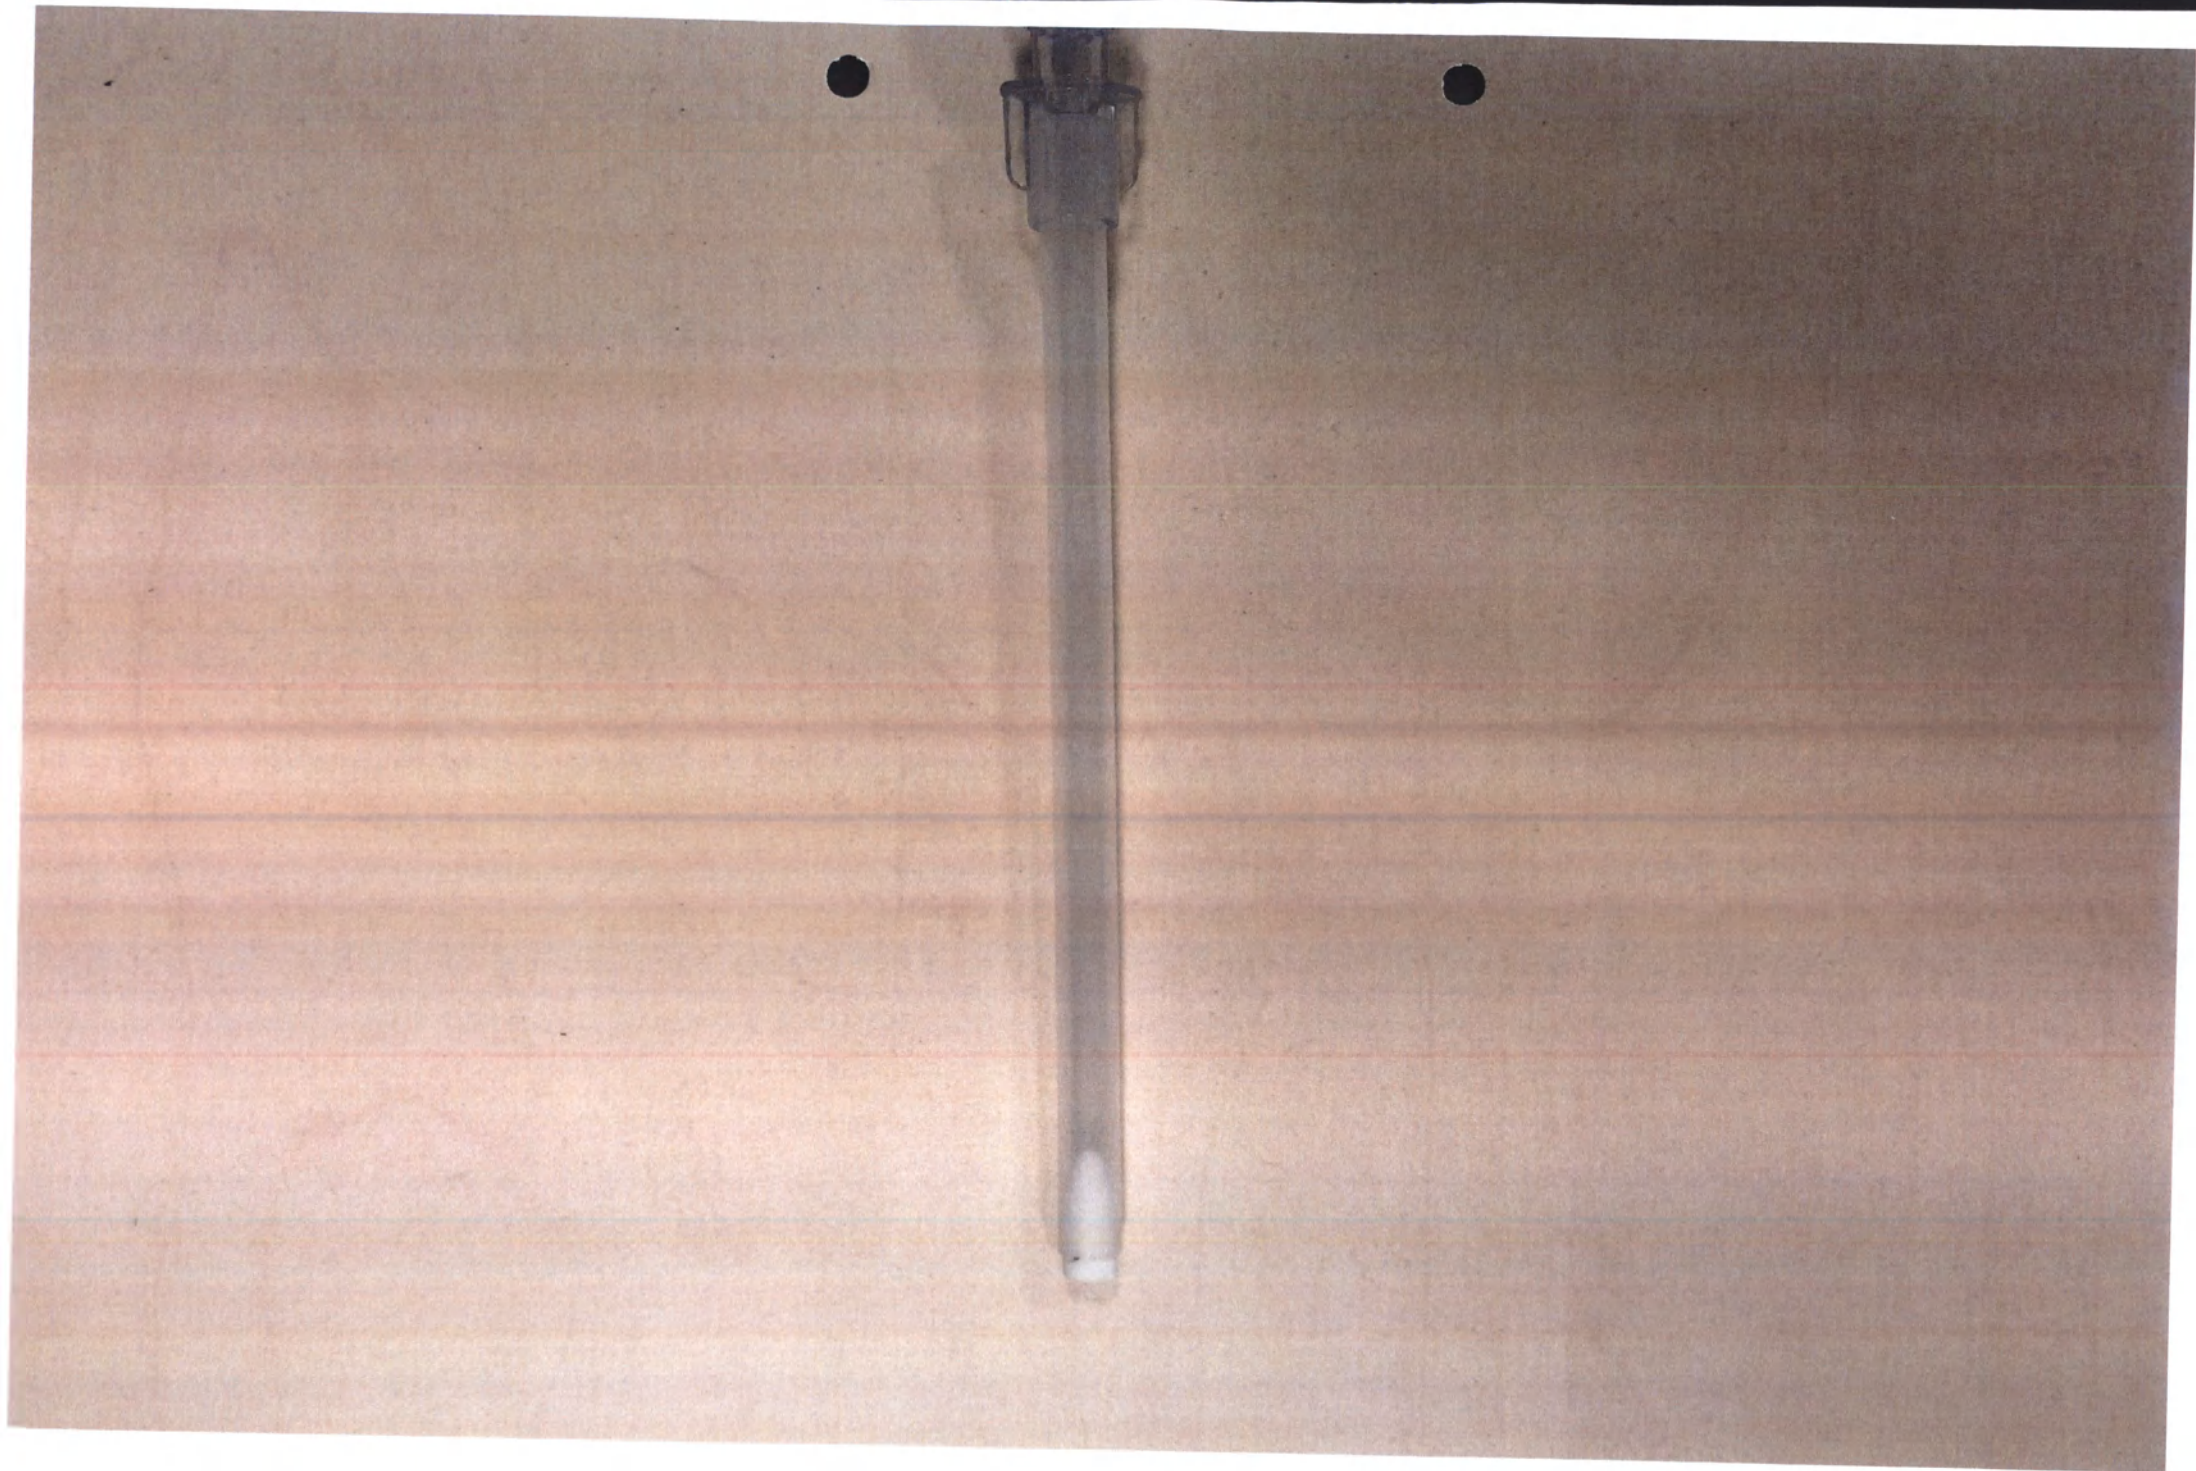

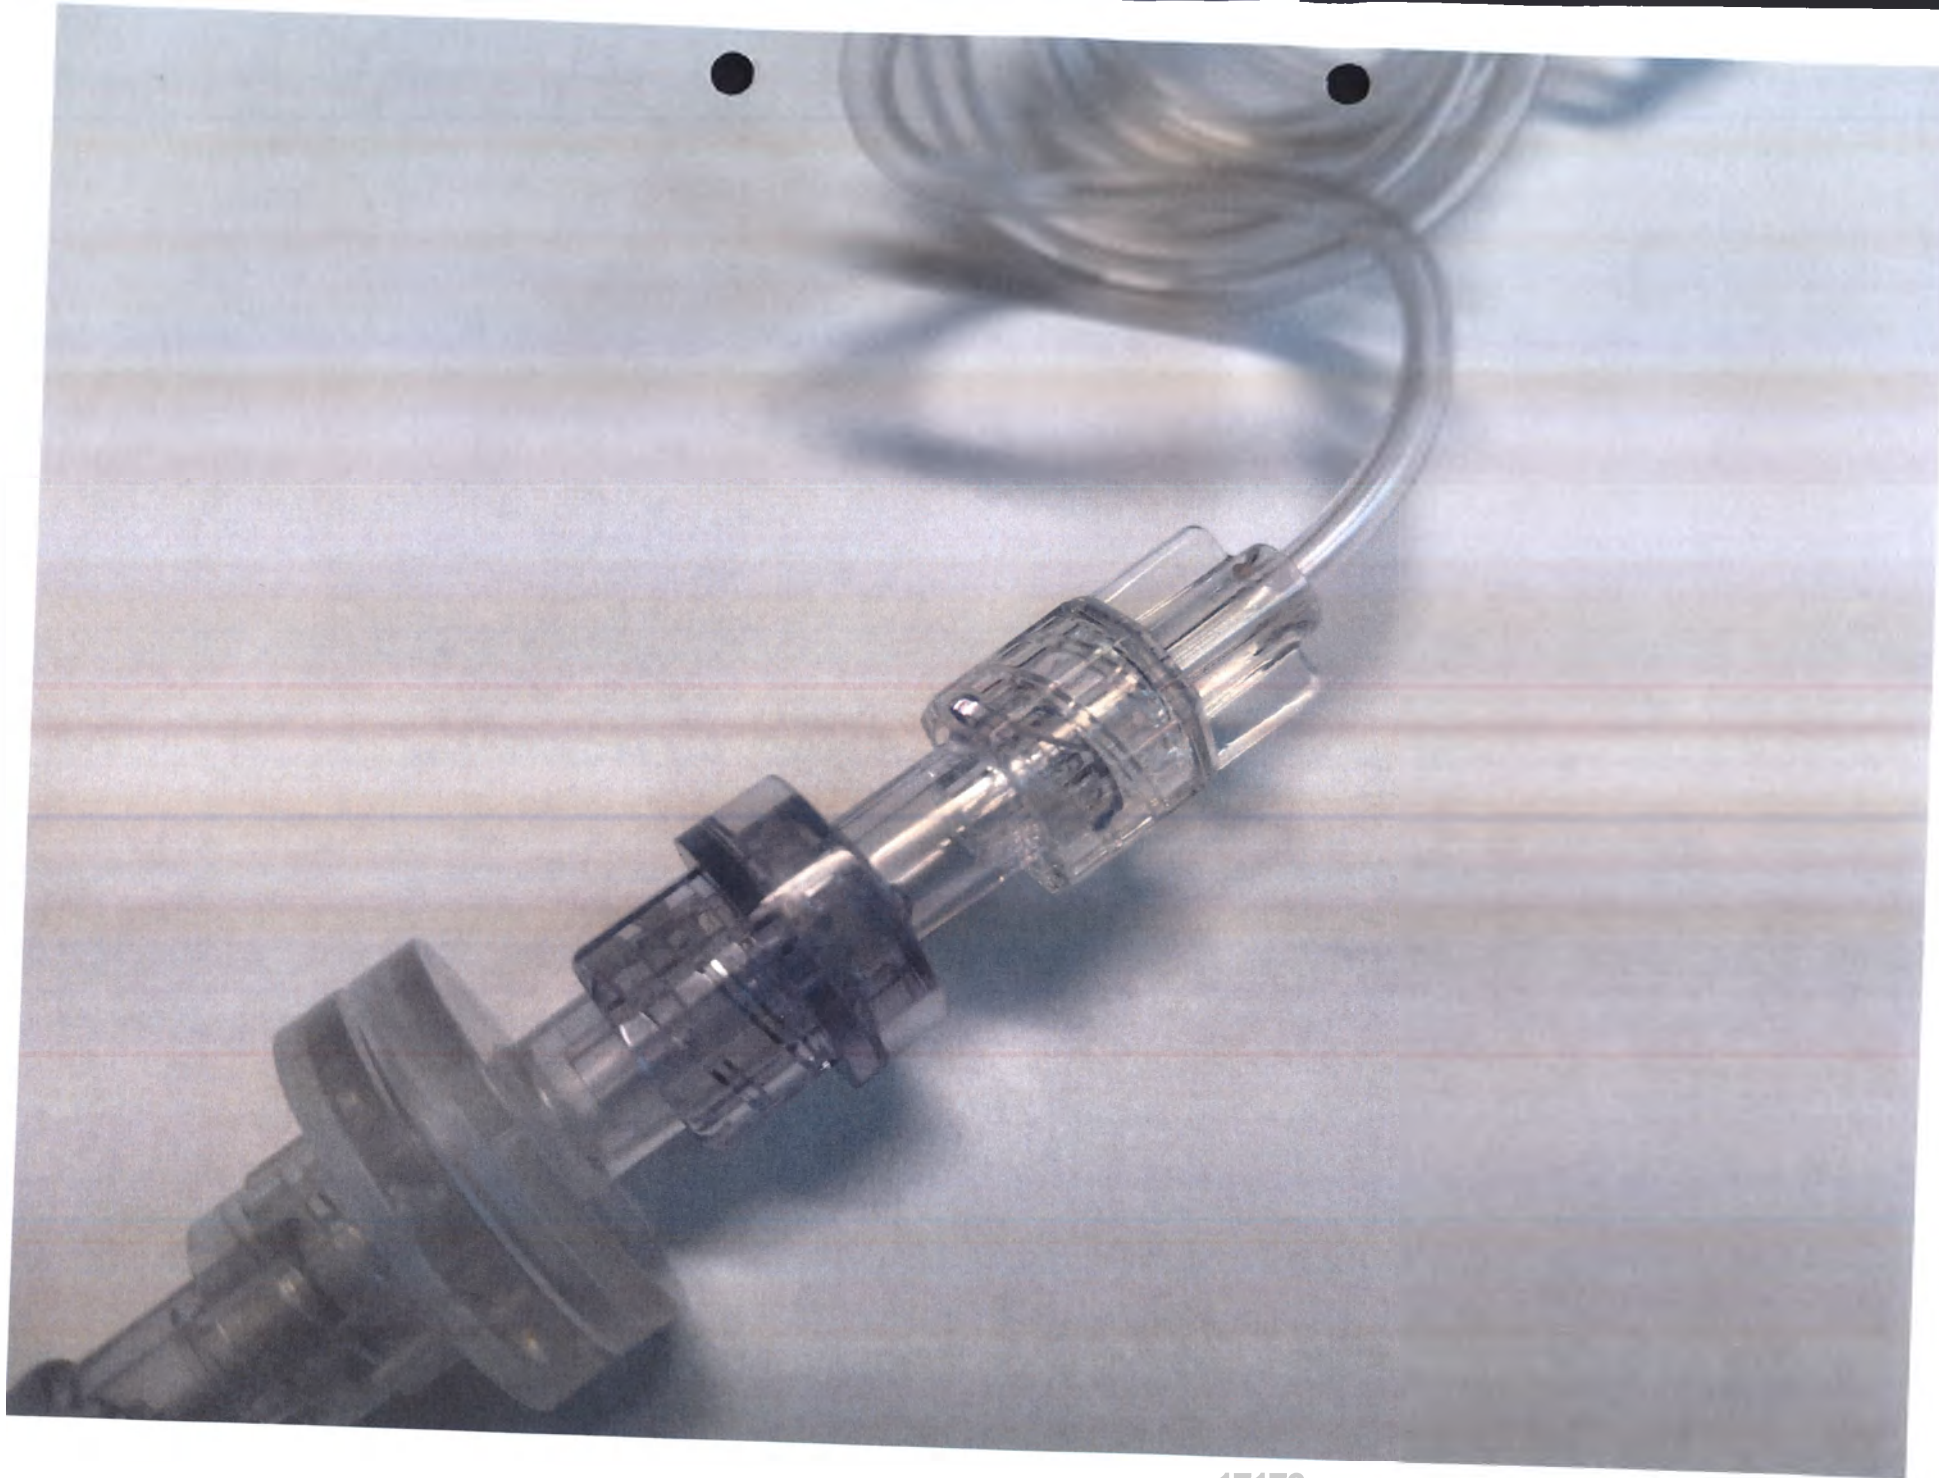

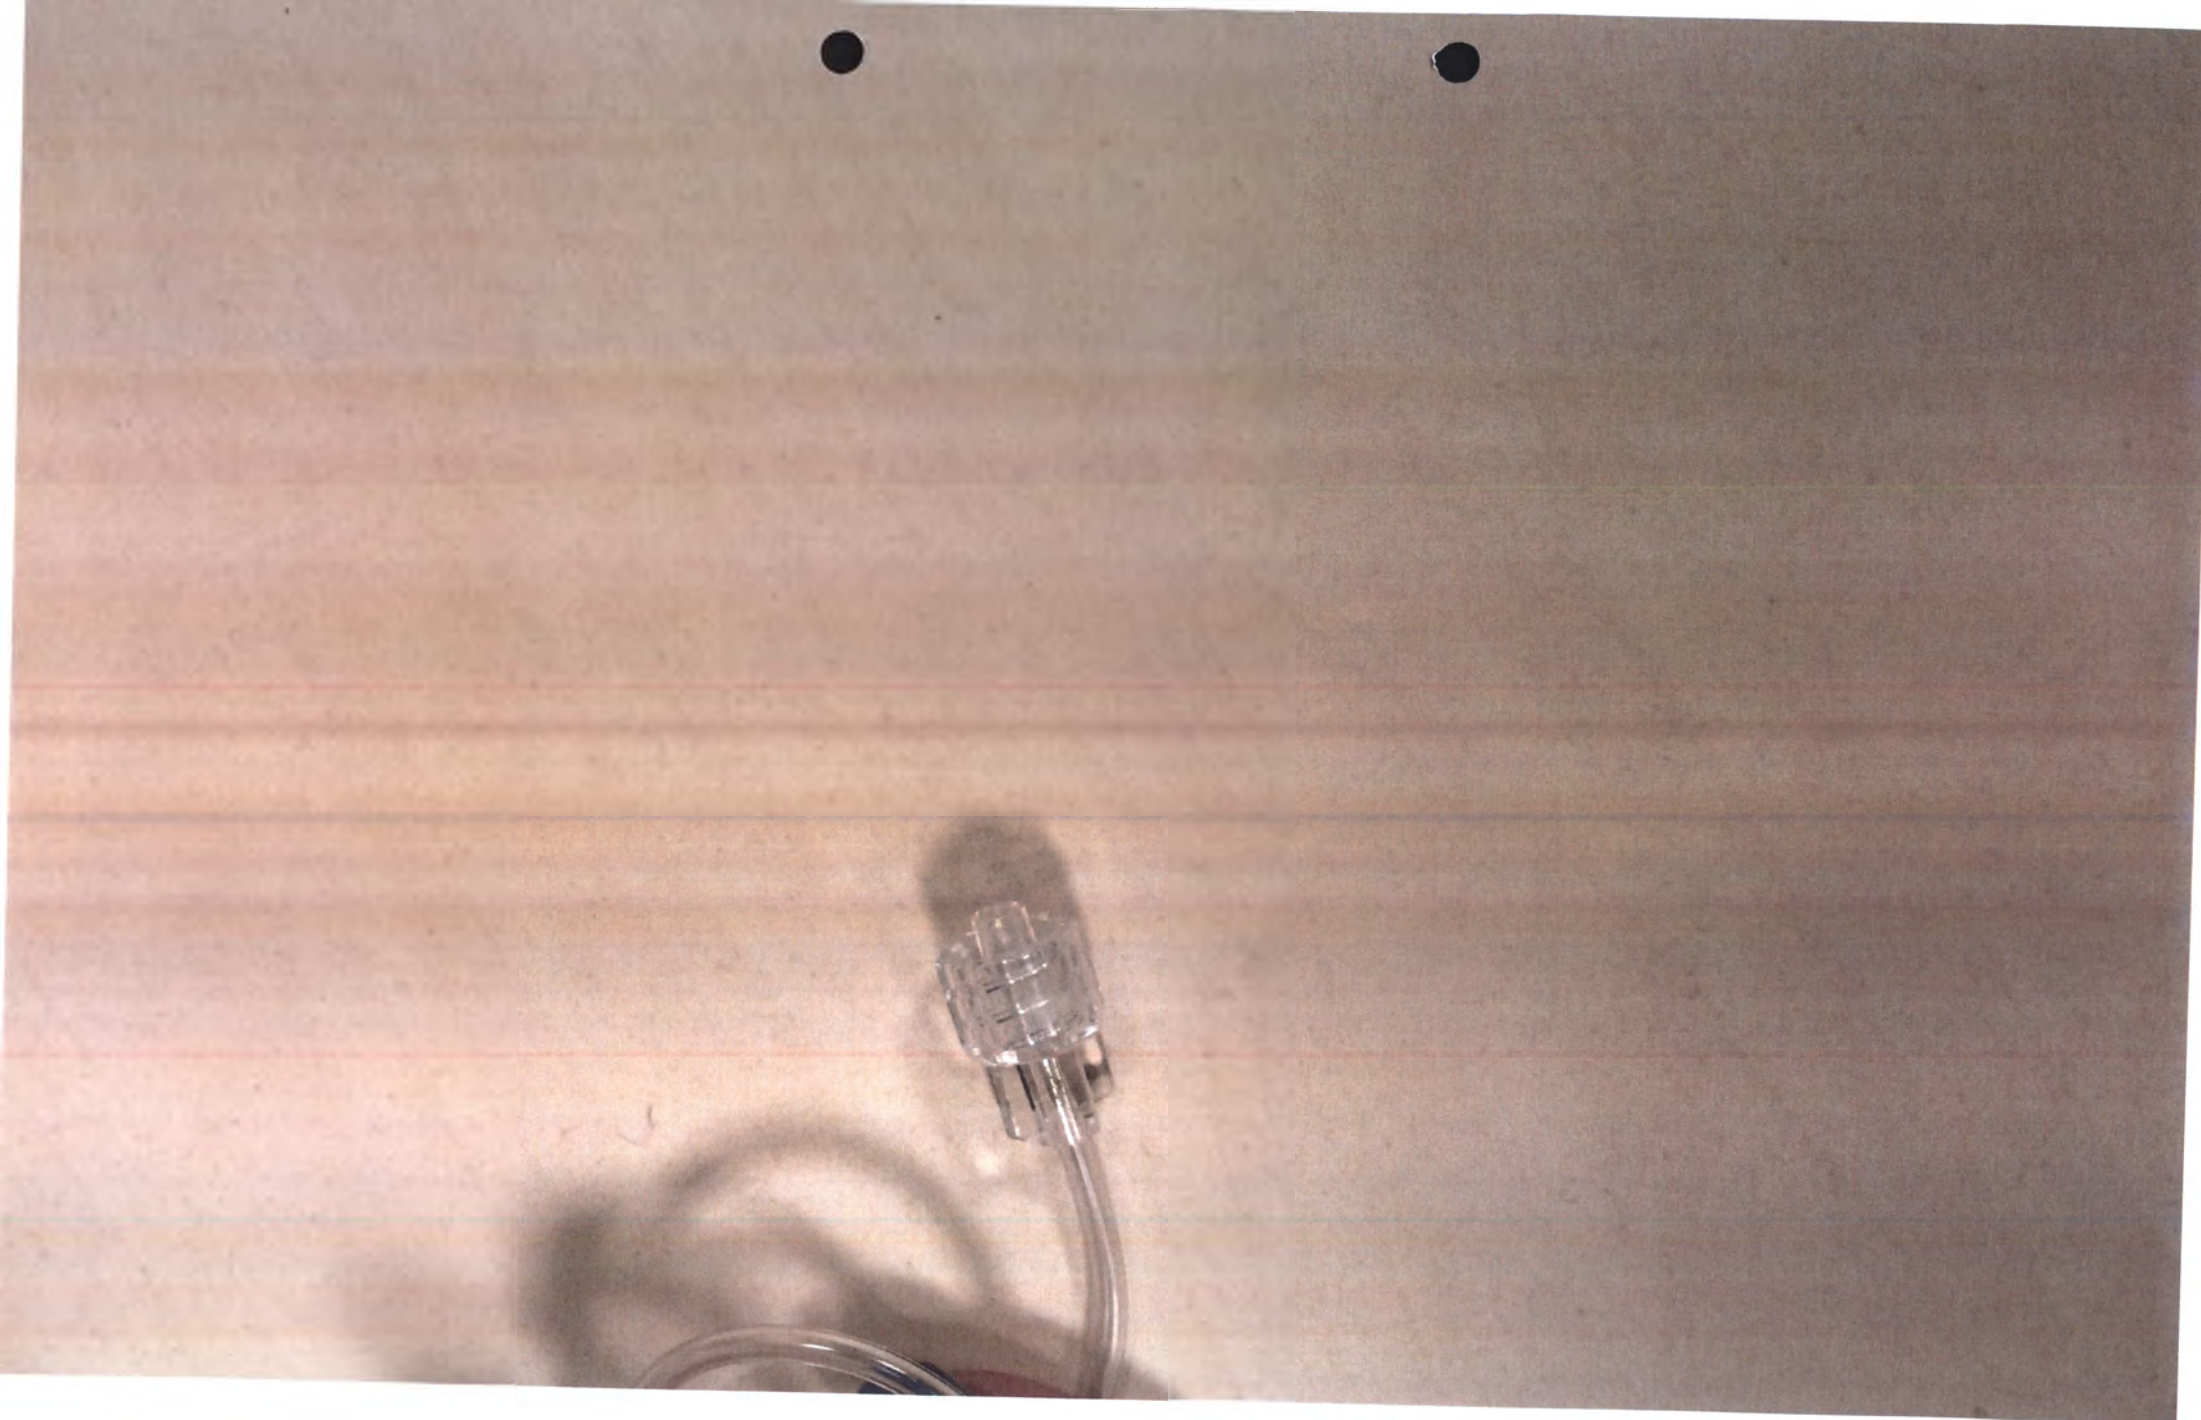

Разъем люэровский



Встроенный фильтр

17176
21.03.2019

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
28 листа (ов)

