

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека





В.Г. Акимкин
2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для диагностики in vitro

АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

производства
Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»,
Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А

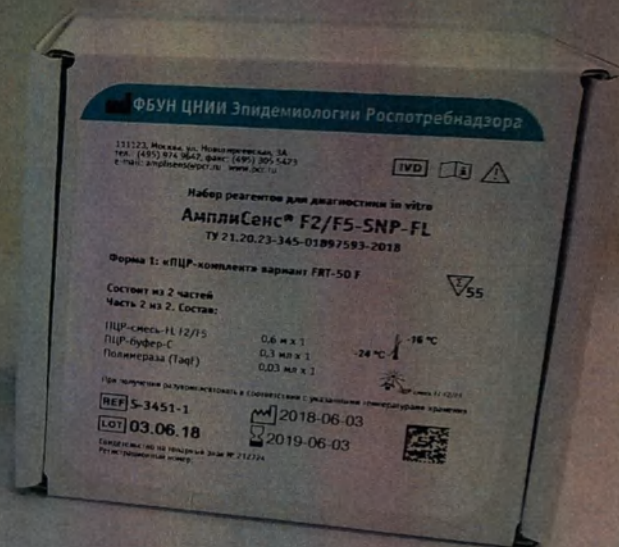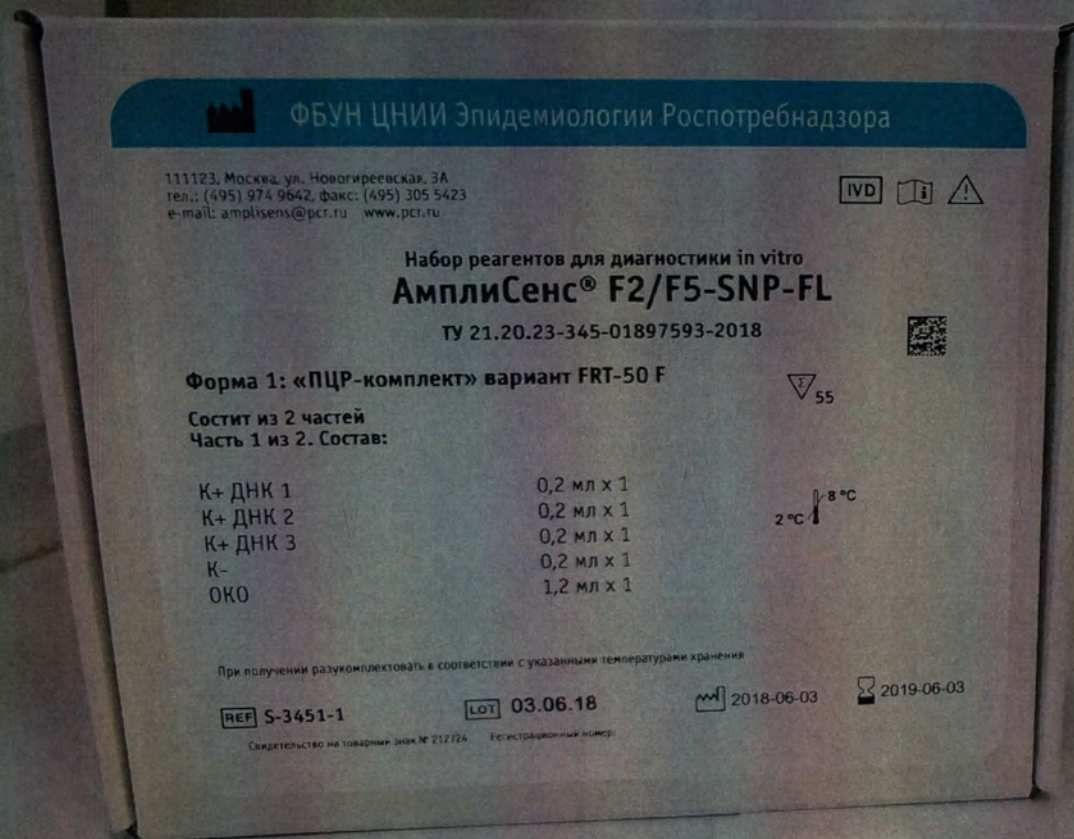

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
тел.: (495) 974 9842, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

ТУ 21.20.23-345-01897593-2018

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состит из 2 частей

Часть 1 из 2. Состав:

К+ ДНК 1

0,2 мл x 1

К+ ДНК 2

0,2 мл x 1

К+ ДНК 3

0,2 мл x 1

К-

0,2 мл x 1

ОКО

1,2 мл x 1

2 °C 8 °C

При получении разуконкомплектовать в соответствии с указанными температурами хранения

REF S-3451-1

03.06.18

2018-06-03

2019-06-03

Свидетельство на товарный знак № 212724

Регистрационный номер:

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
ВКЛАДЫШ

К набору реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

АмплиСенс®

 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора,
Российская Федерация, 111123,
город Москва, улица Новогиревская, дом 3А

AmpliSens®
Краткое руководство
набор реагентов
для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

111123, Москва, ул. Никольская, 28, стр. 1
Тел.: (495) 937-96-42, факс: (495) 937-54-32, e-mail: info@vniiv.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Набора реагентов для диагностики in vitro
AmpliSens® 7278-AMP-FL

Инструкция по применению набора реагентов предназначена на сайте www.RBC-TV или www.rbc-tv.ru


Форма 1: **REF S-345.1**
 Форма 2: **REF S-345.1.4**








Фотография образца маркировки и упаковки набора реагентов АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL формы 2 до вскрытия внешней упаковки.

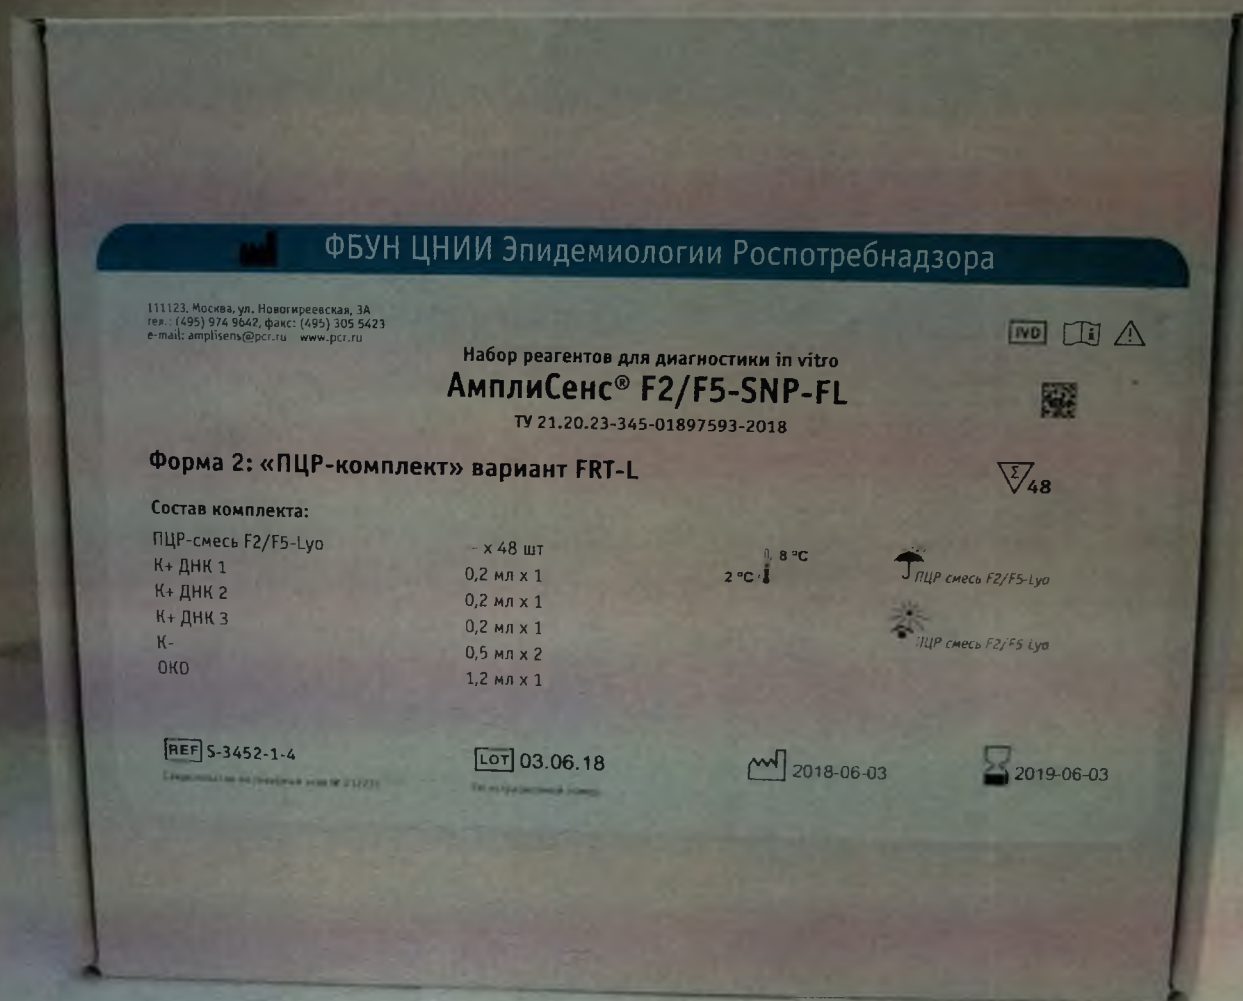

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
тел.: (495) 974-9642, факс: (495) 305-5423
e-mail: amplicens@fsc.ru www.fsc.ru

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL
ТУ 21.20.23-345-01897593-2018



Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L

Состав комплекта:

ПЦР-смесь F2/F5-Lyo	-- x 48 шт
К+ ДНК 1	0,2 мл x 1
К+ ДНК 2	0,2 мл x 1
К+ ДНК 3	0,2 мл x 1
К-	0,5 мл x 2
ОК0	1,2 мл x 1

2 °C 1-8 °C

ПЦР-смесь F2/F5-Lyo

ПЦР-смесь F2/F5-Lyo

REF S-3452-1-4

Сертификат на товарный знак № 212724

LOT 03.06.18

Регистрационный номер

2018-06-03

2019-06-03

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

АмплиСенс®



AmpliSens®
Контроль качества
для диагностики in vitro
АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
ВХОДЯЩИЙ
в состав реактивов in vitro АмплиСенс® F2/F5-SNP-FL



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 9 лист 06

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

В.Г. Акимкин

