

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СТЕМФИС»



И.В. Попов

2018 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Аппарат физиотерапевтический реабилитационный Robotic ATT с
принадлежностями

Производитель:

«ДЖЕЙ-ЭМ ТЕК КО., ЛТД»
(JM TECH Co., Ltd.)

84, Annam-ro 402beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Korea


1. Аппарат физиотерапевтический реабилитационный Robotic АТТ

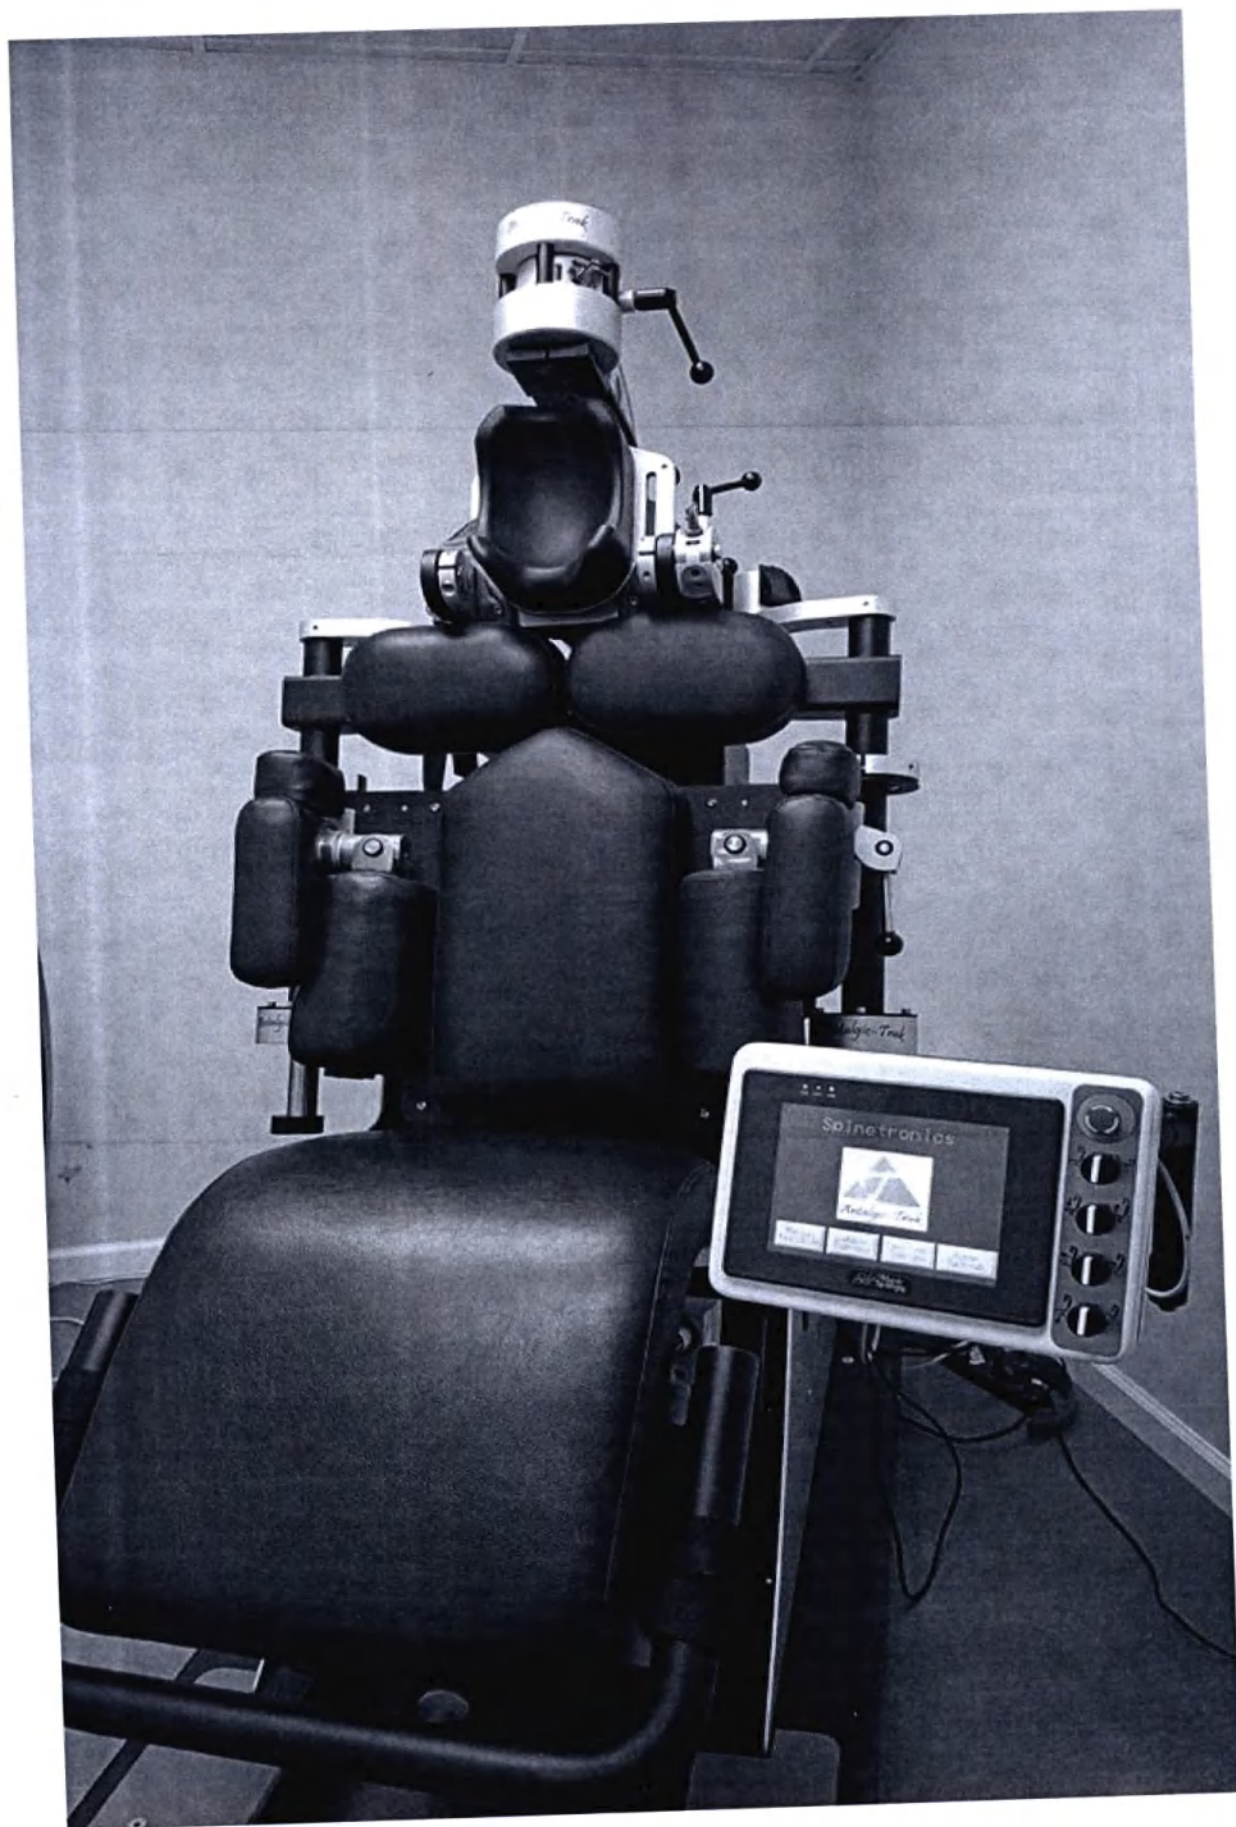

2. Пульт управления




3. Педальный переключатель

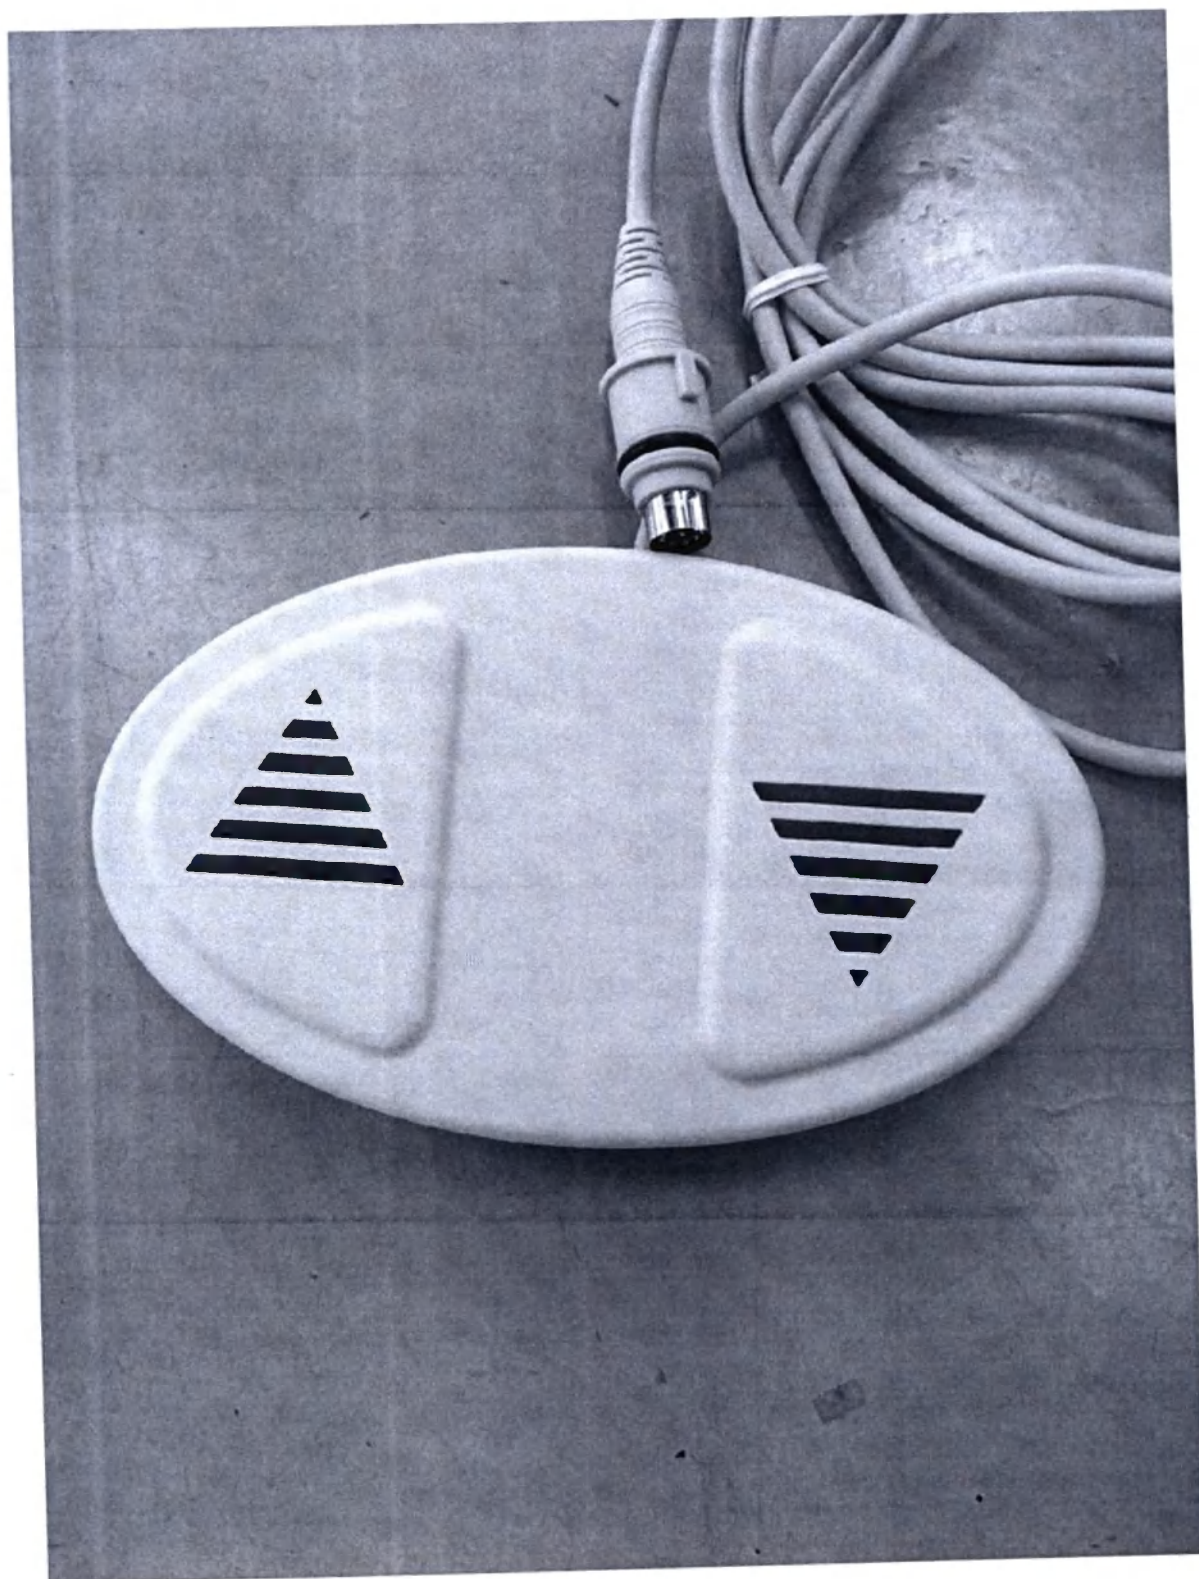


4. Экстренный выключатель для пациента




5. Ремень безопасности для фиксирования лба

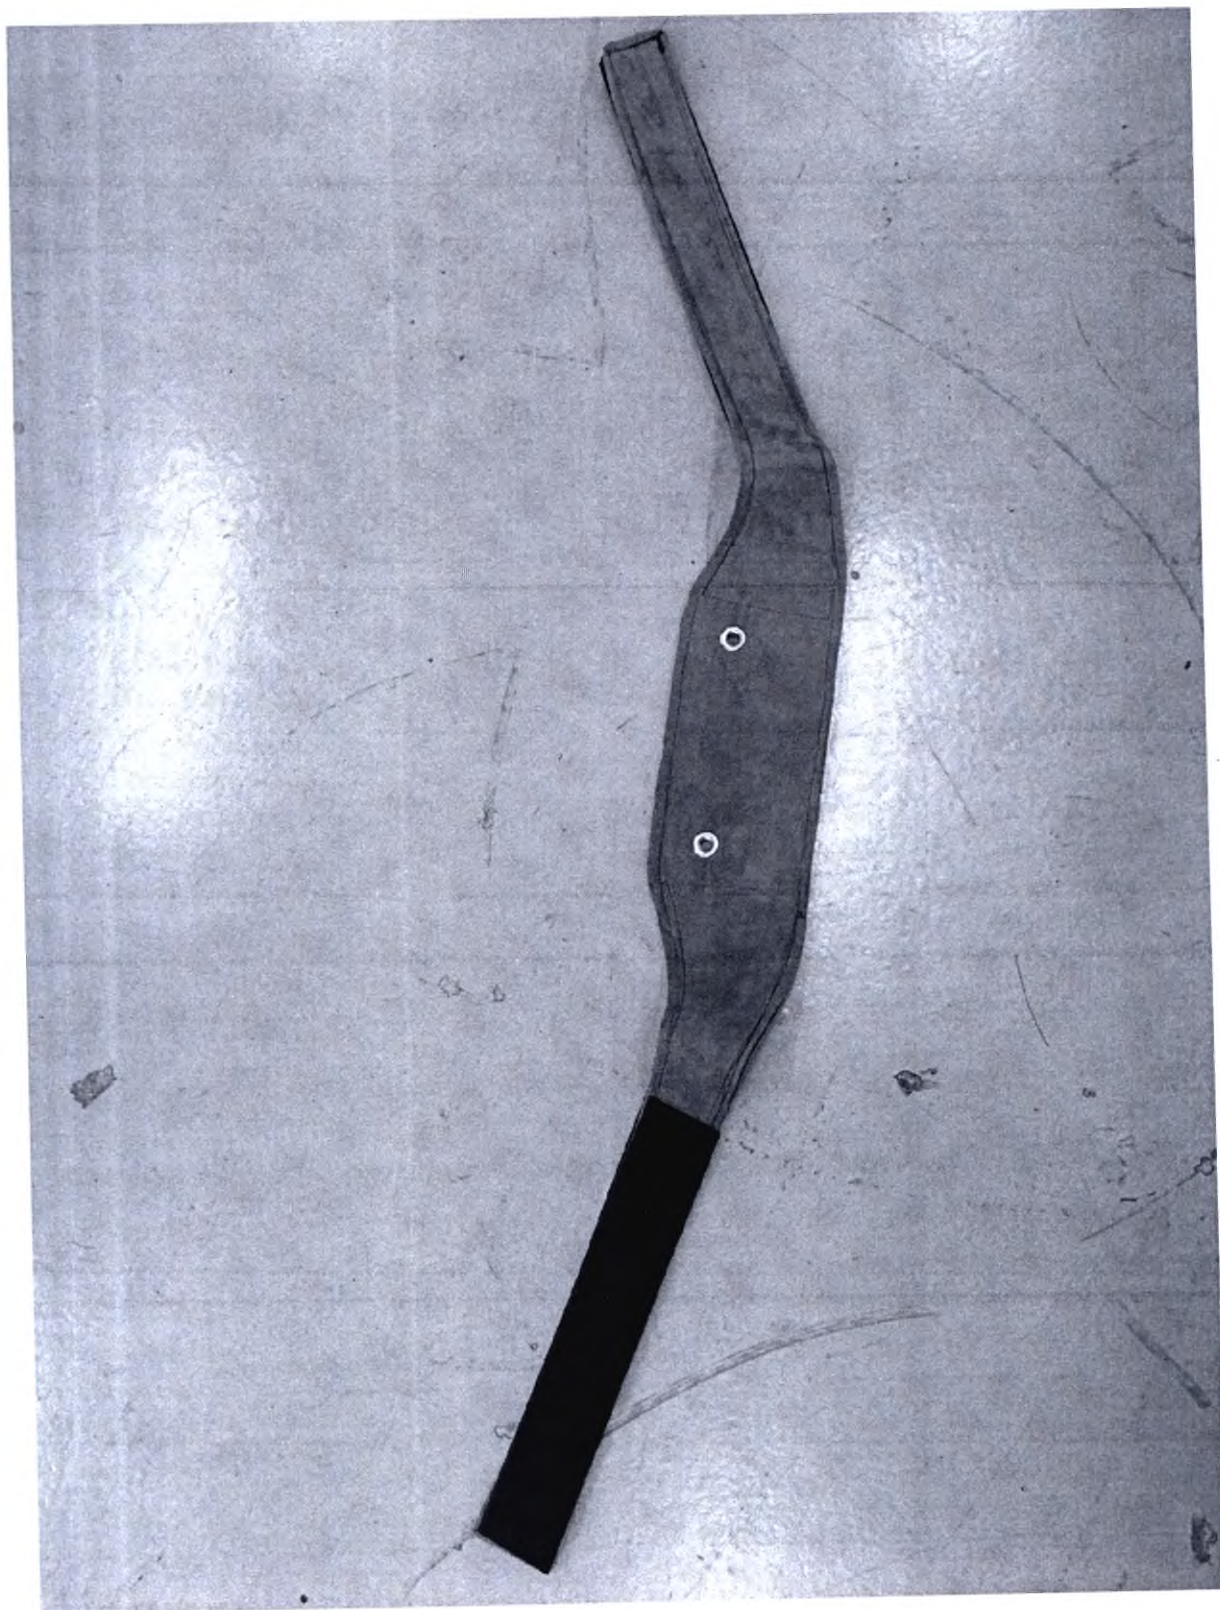

6. Ремень безопасности дополнительный для фиксирования лба

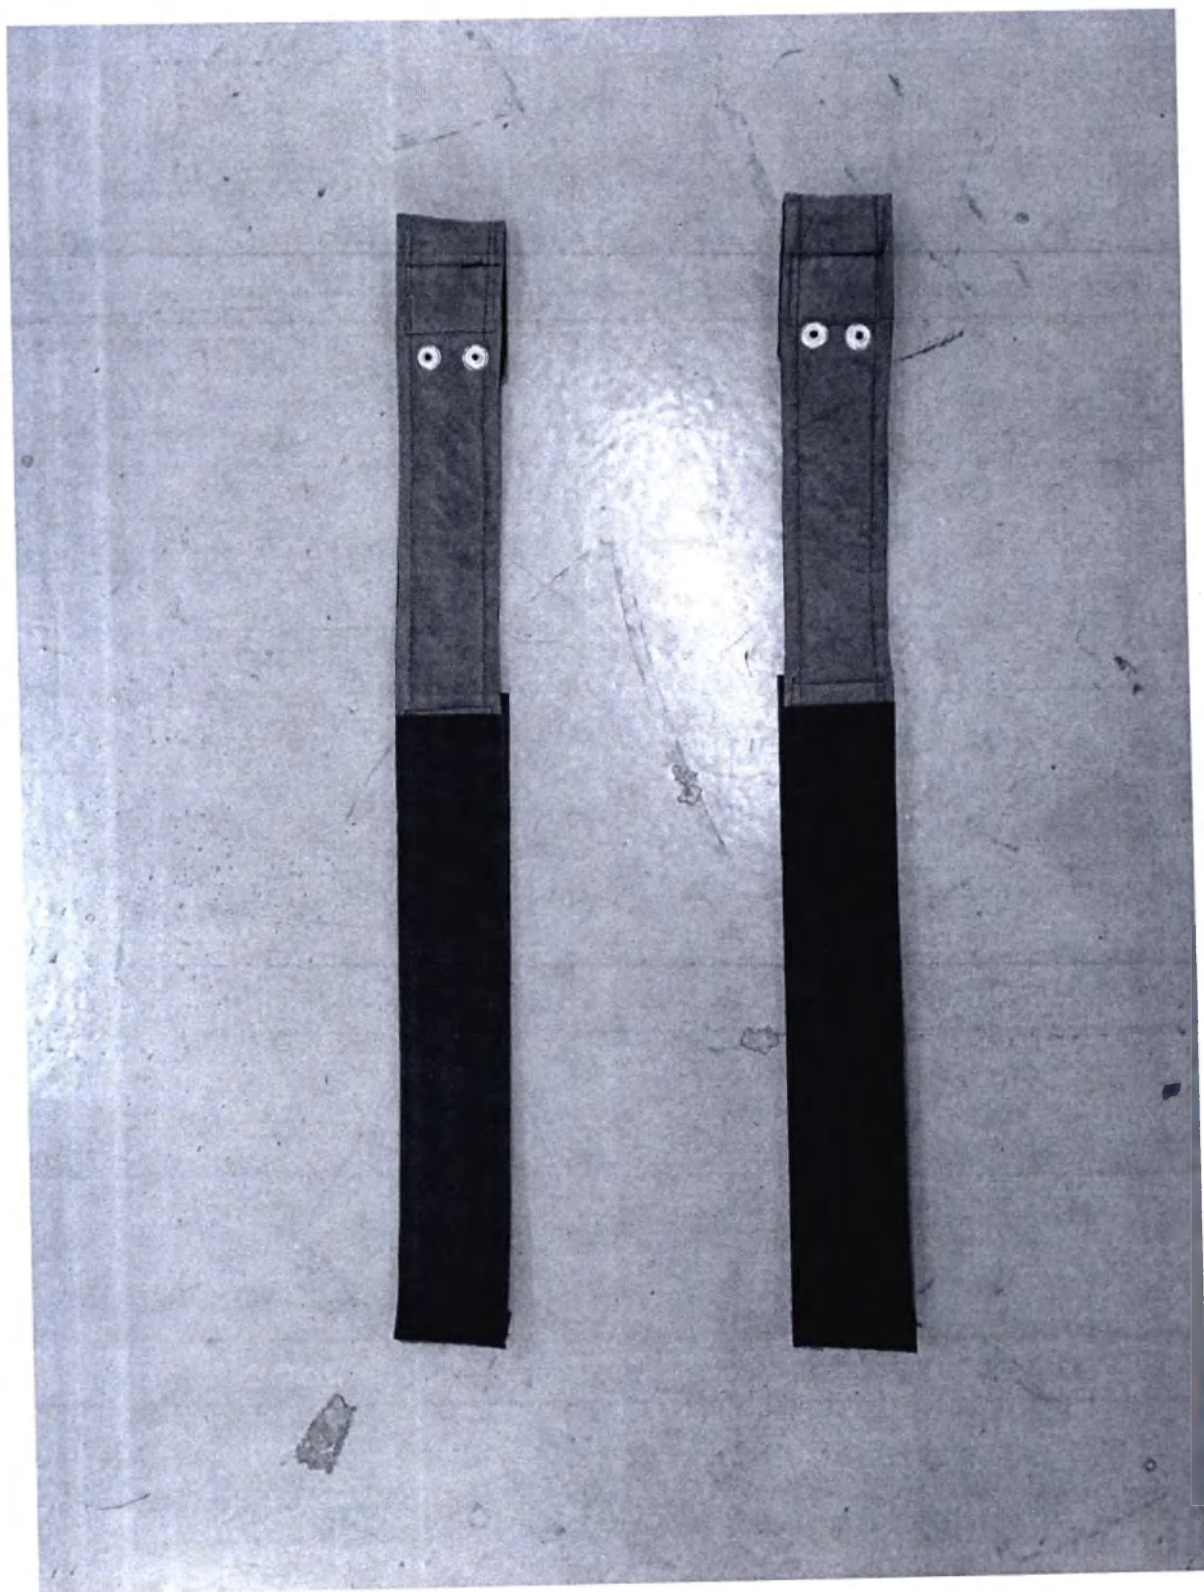

7. Ремень безопасности для фиксирования подбородка

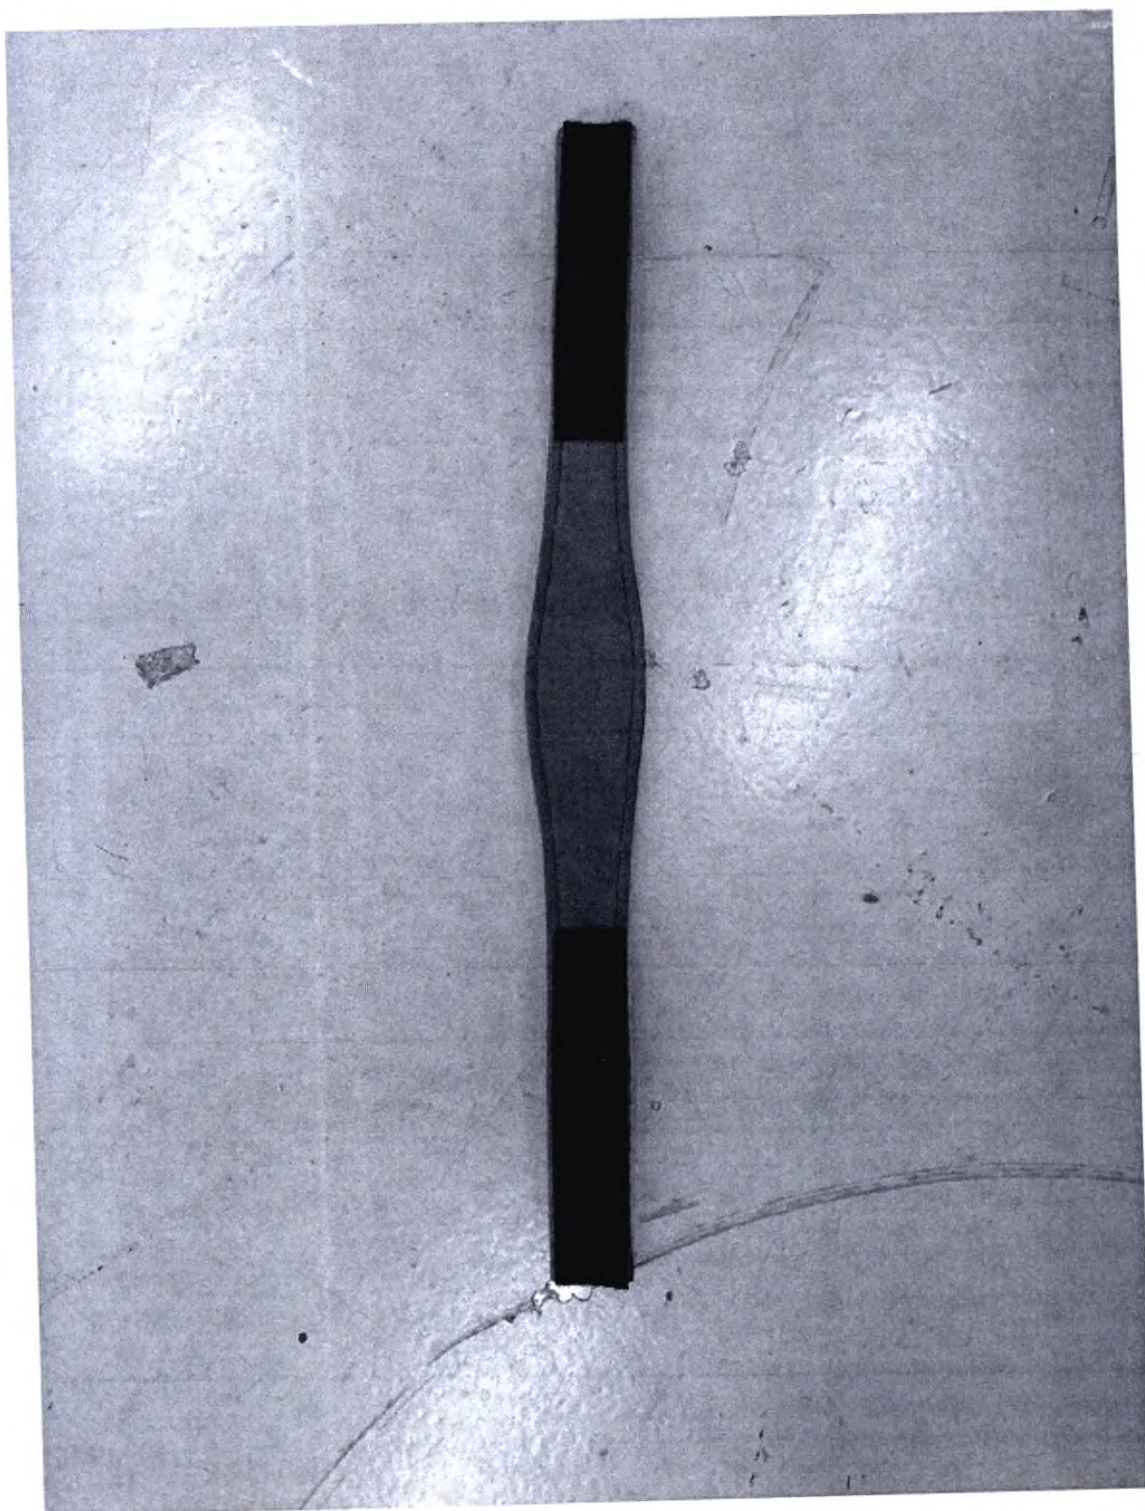

8. Фиксатор ремня безопасности



9. Ремень безопасности для фиксации поясничной области и грудного отдела, размер М




10. Ремень безопасности для фиксирования поясничной области и грудного отдела, размер L




11. Подголовник




12. Кабель

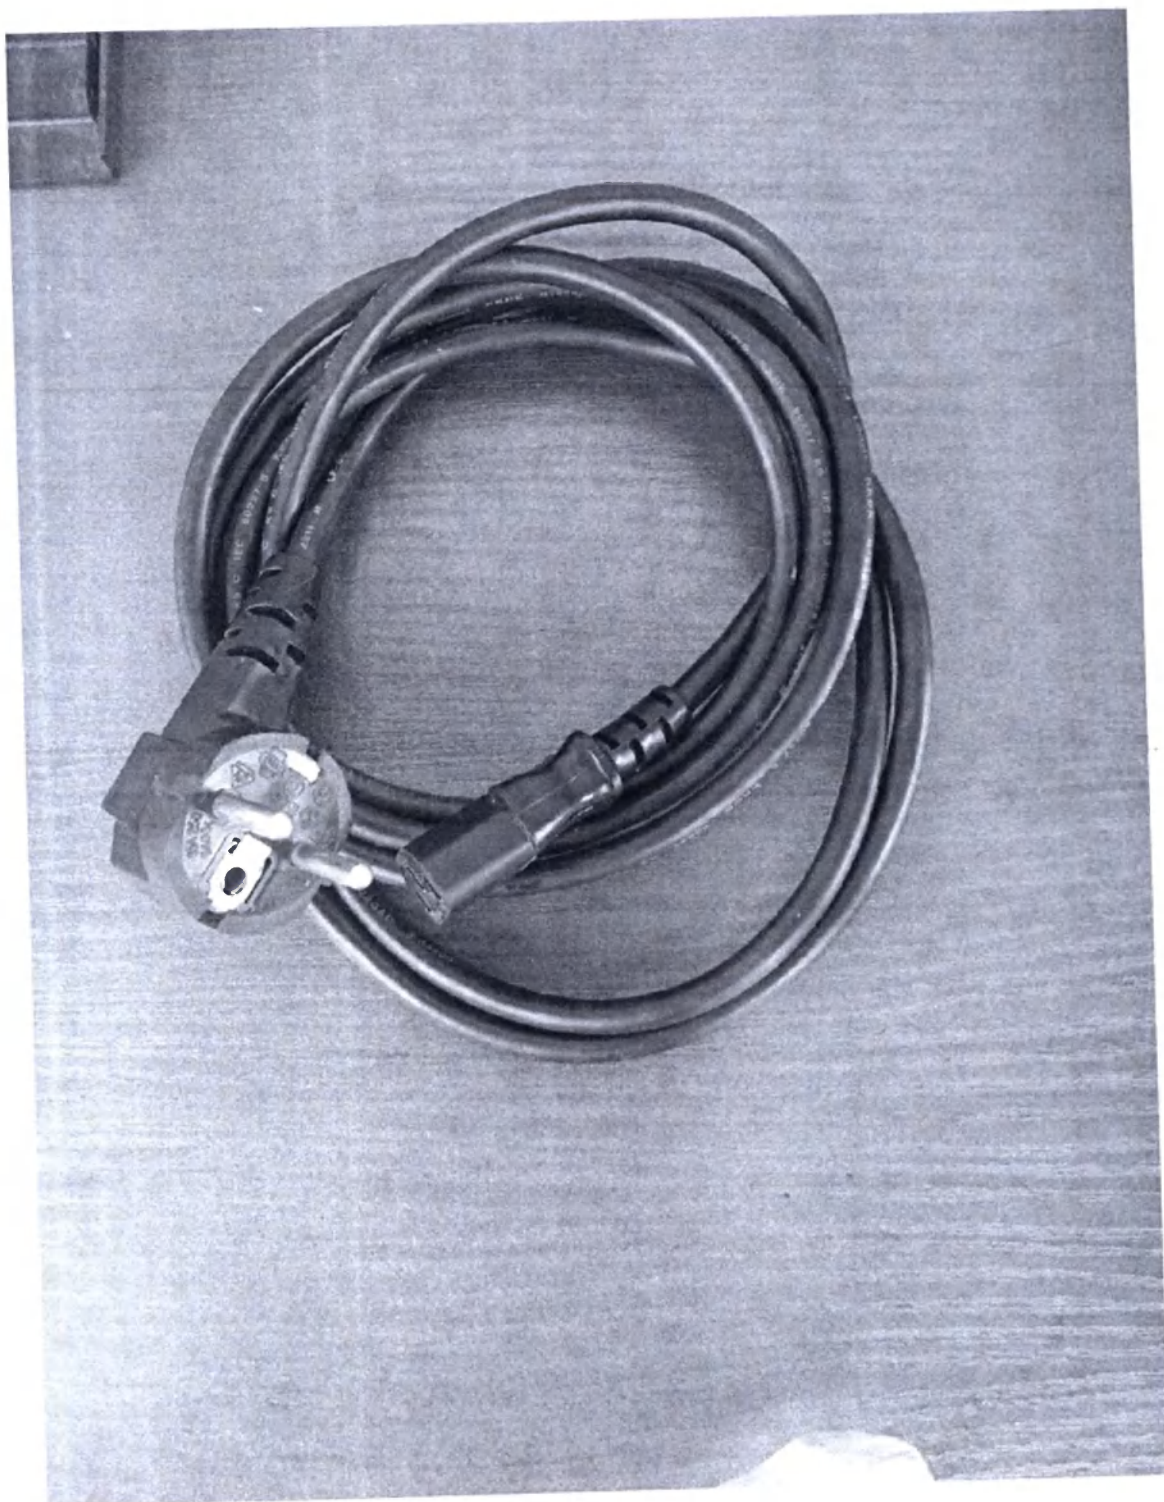


13. Запасной ремень безопасности для фиксирования лба

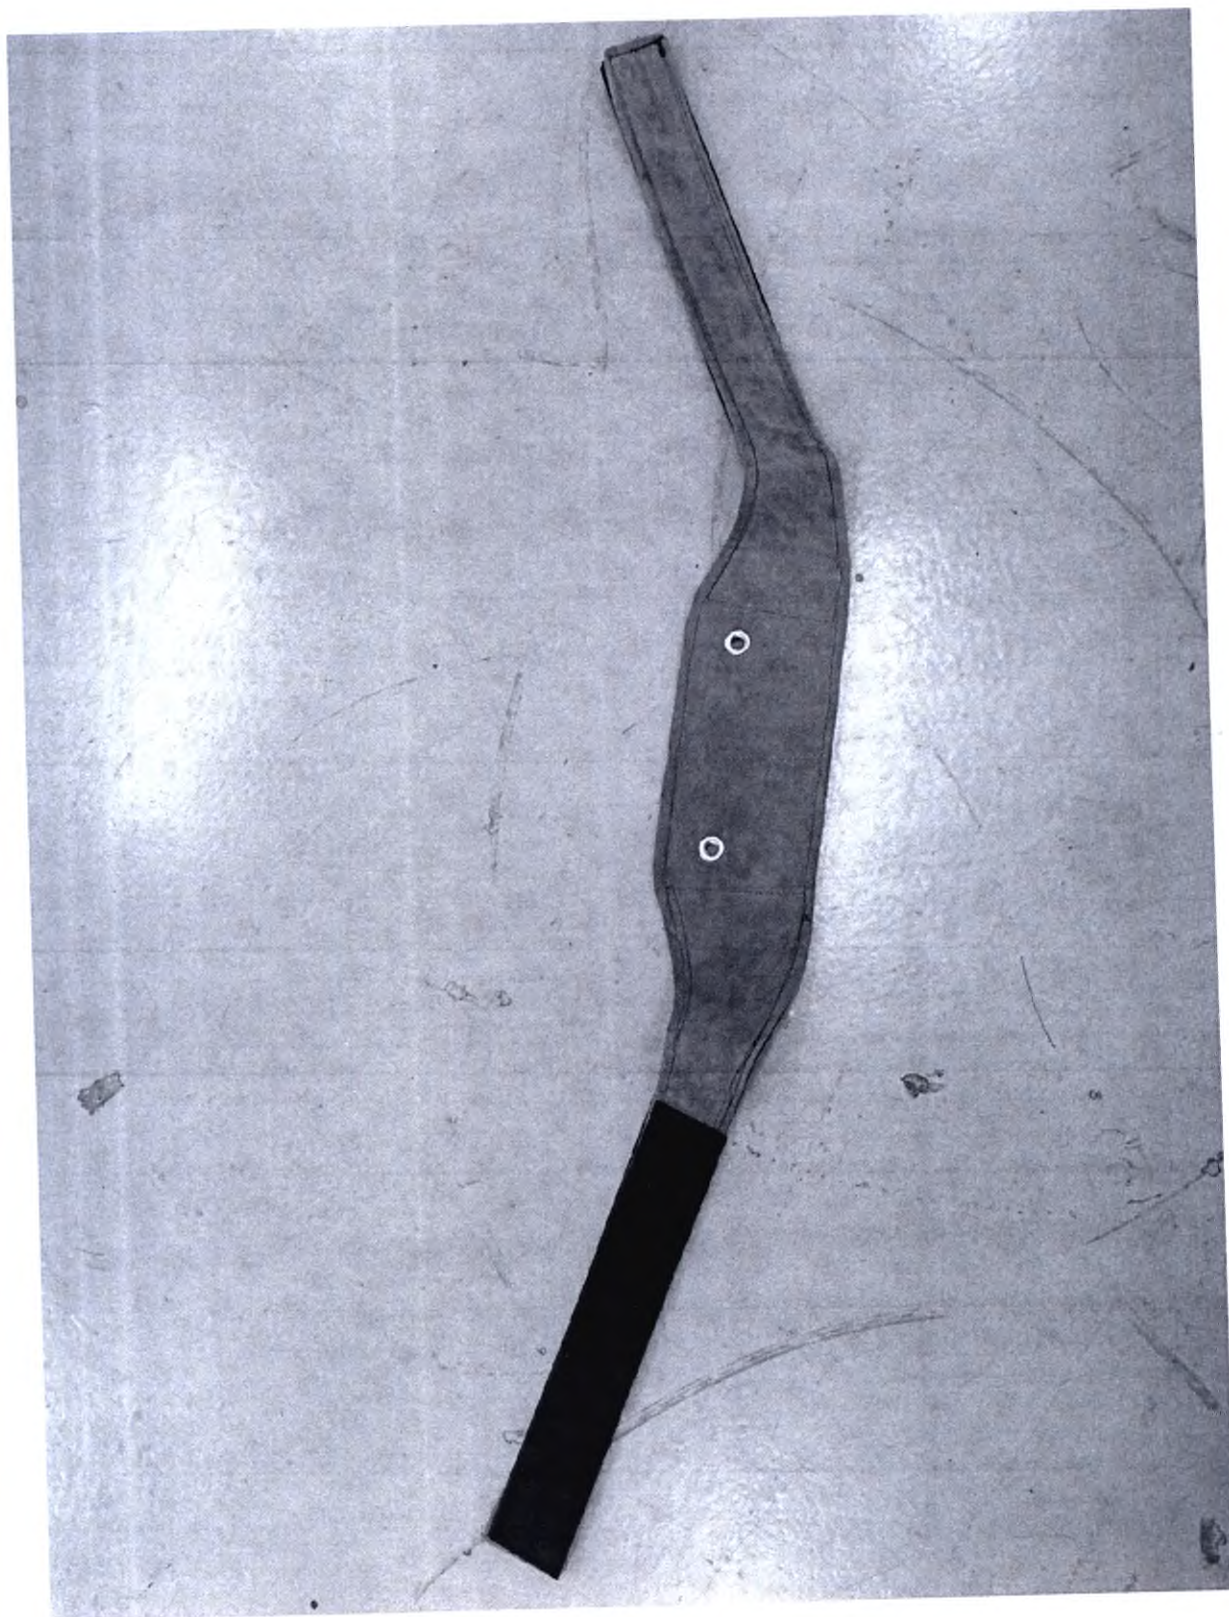

14. Запасной ремень безопасности дополнительный для фиксирования лба

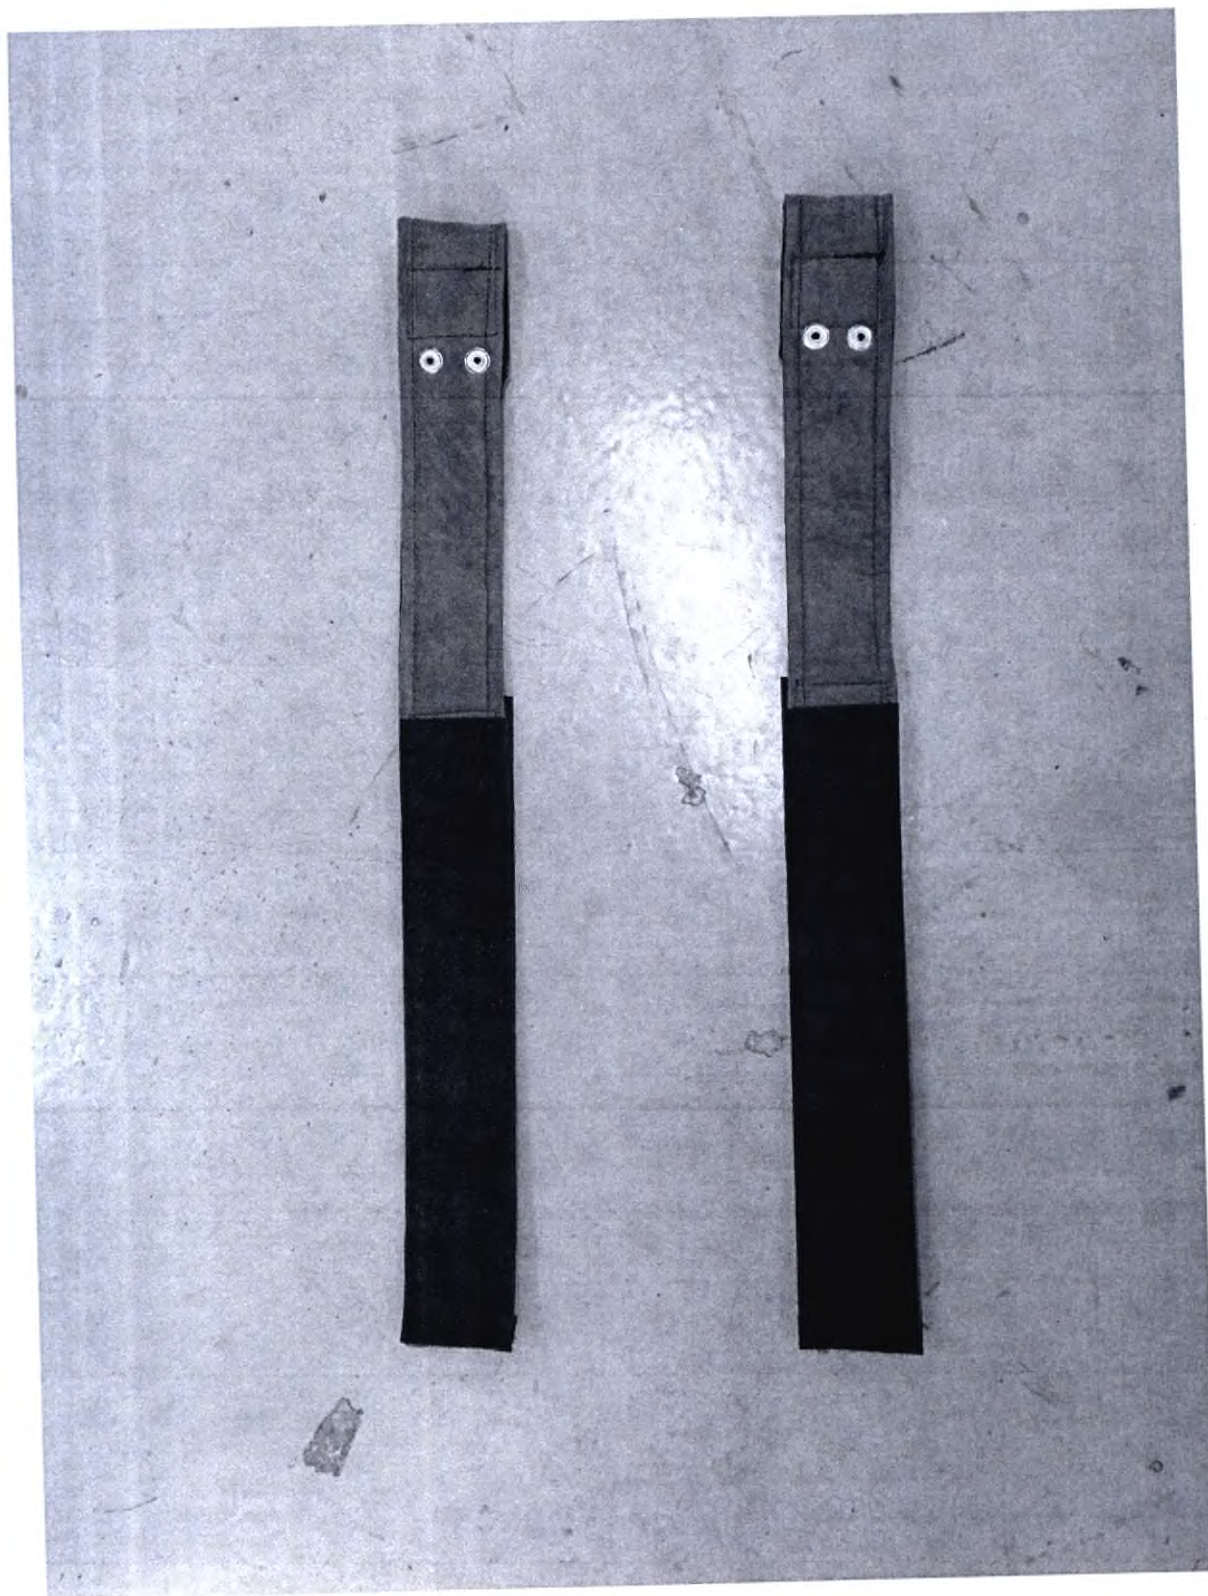


15. Запасной ремень безопасности для фиксирования подбородка

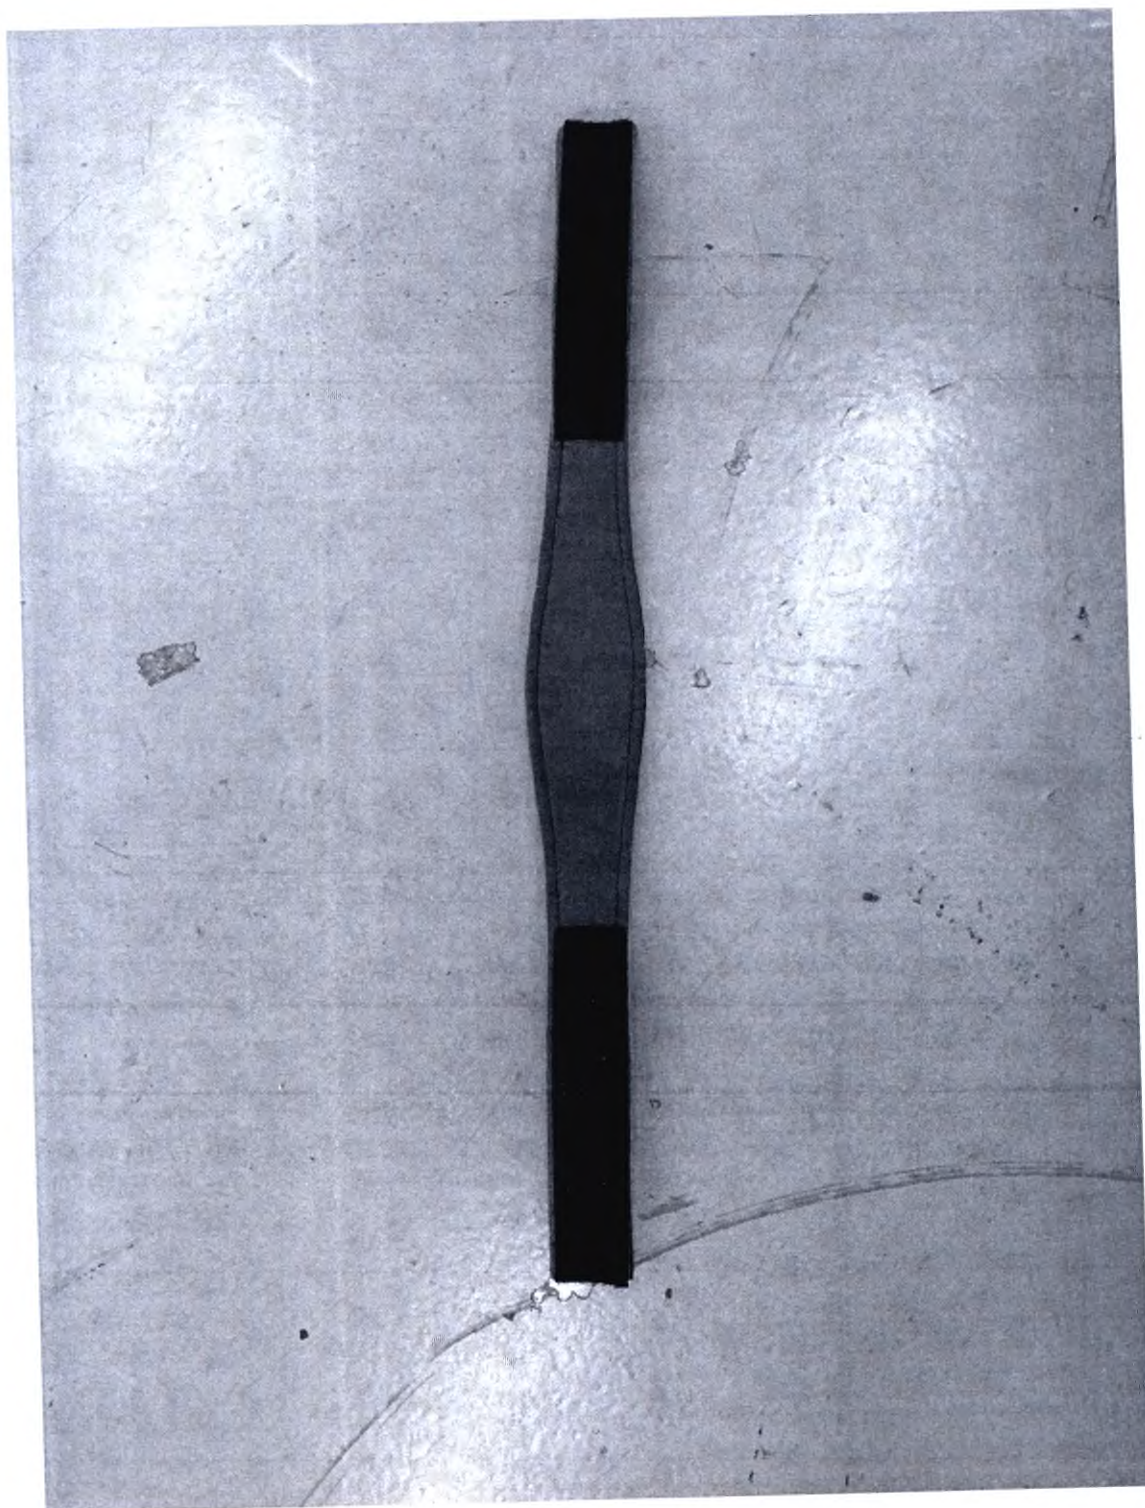

16. Запасной фиксатор ремня безопасности



17. Запасной ремень безопасности для фиксации поясничной области и грудного отдела, размер М

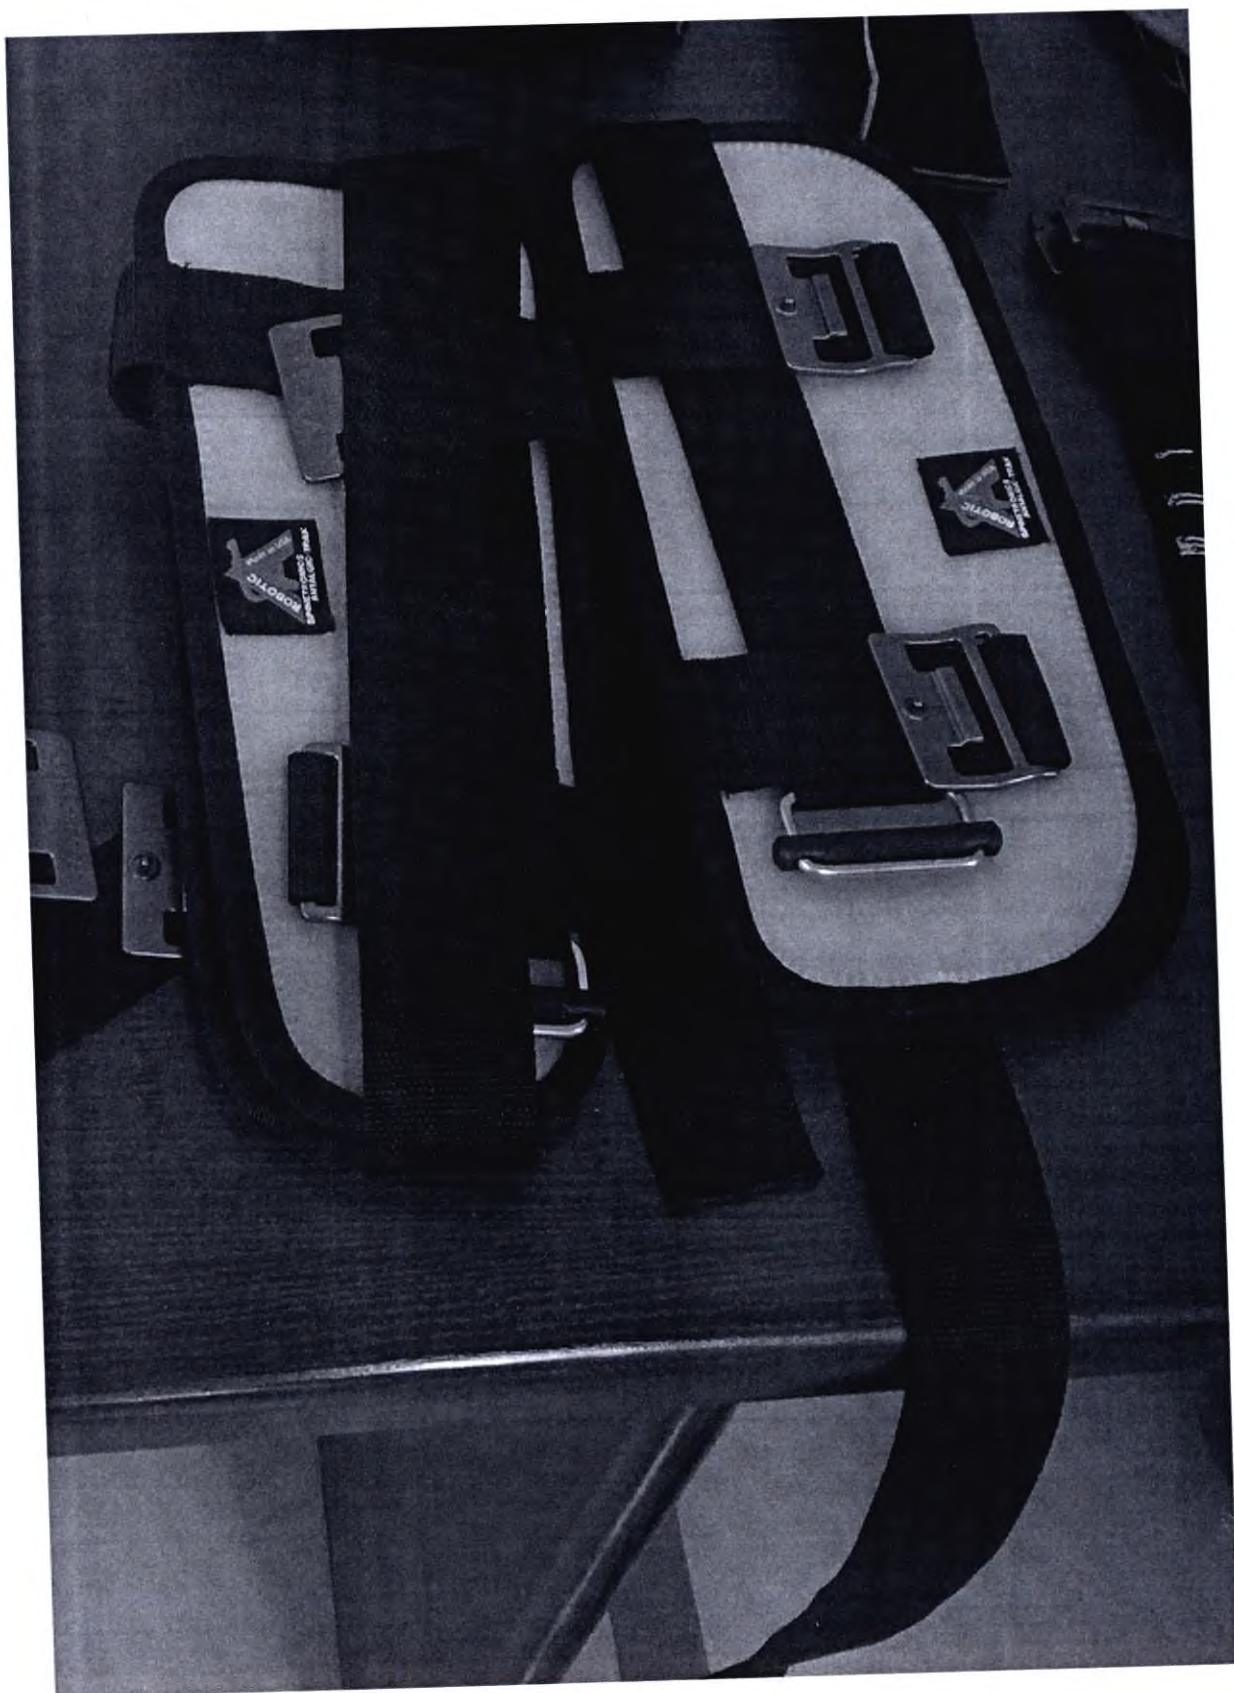


18. Запасной ремень безопасности для фиксирования поясничной области и грудного отдела, размер L




19. Набор гаечных ключей



20. Подушка подголовника

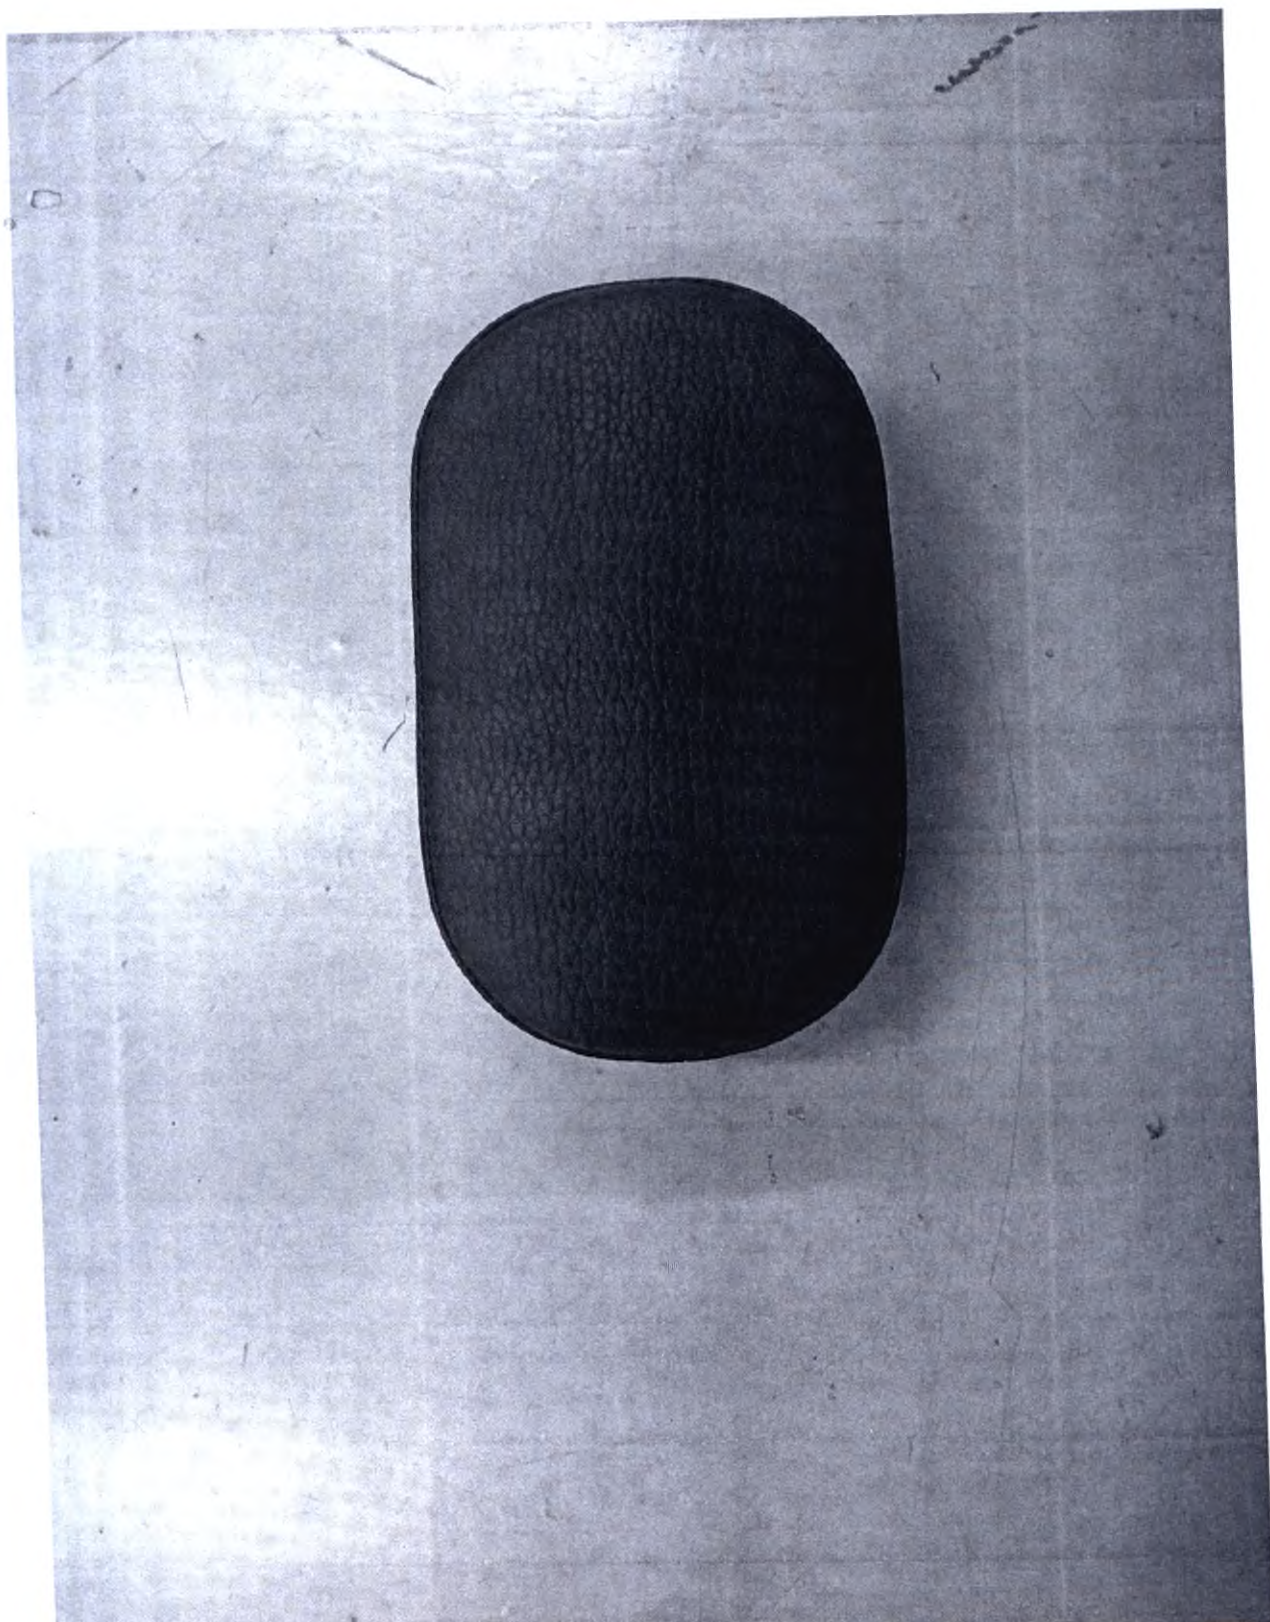


21. Угловой индикатор

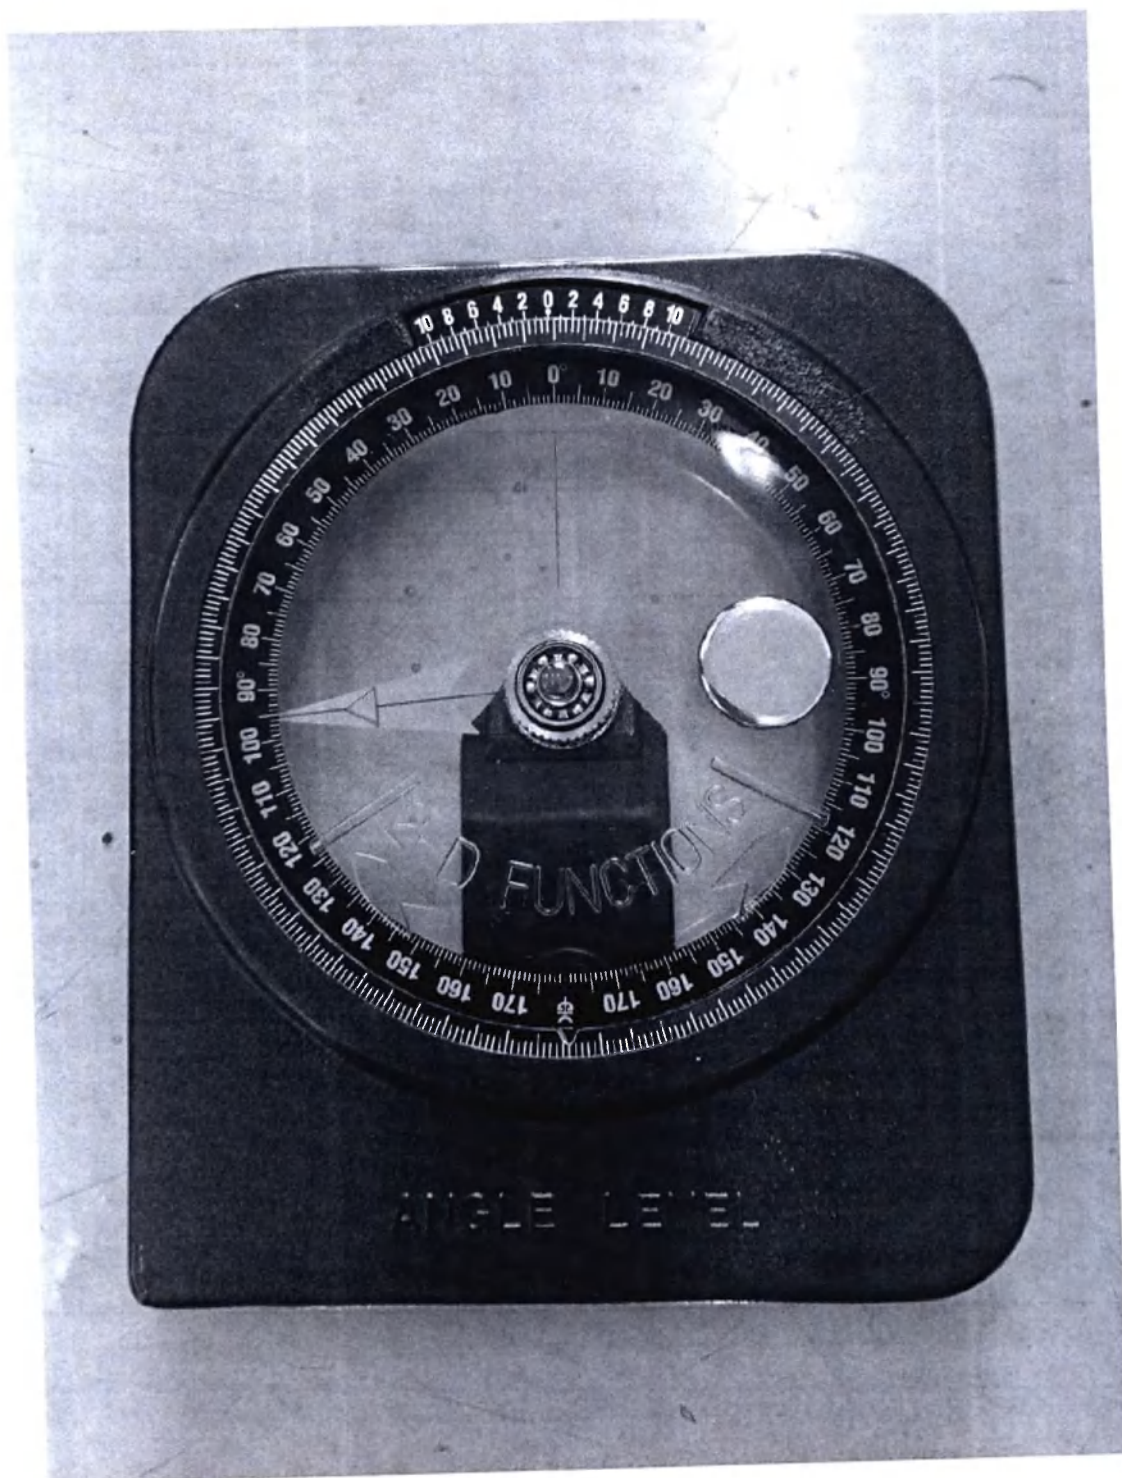

22. Фиксирующий винт



23. Предохранитель

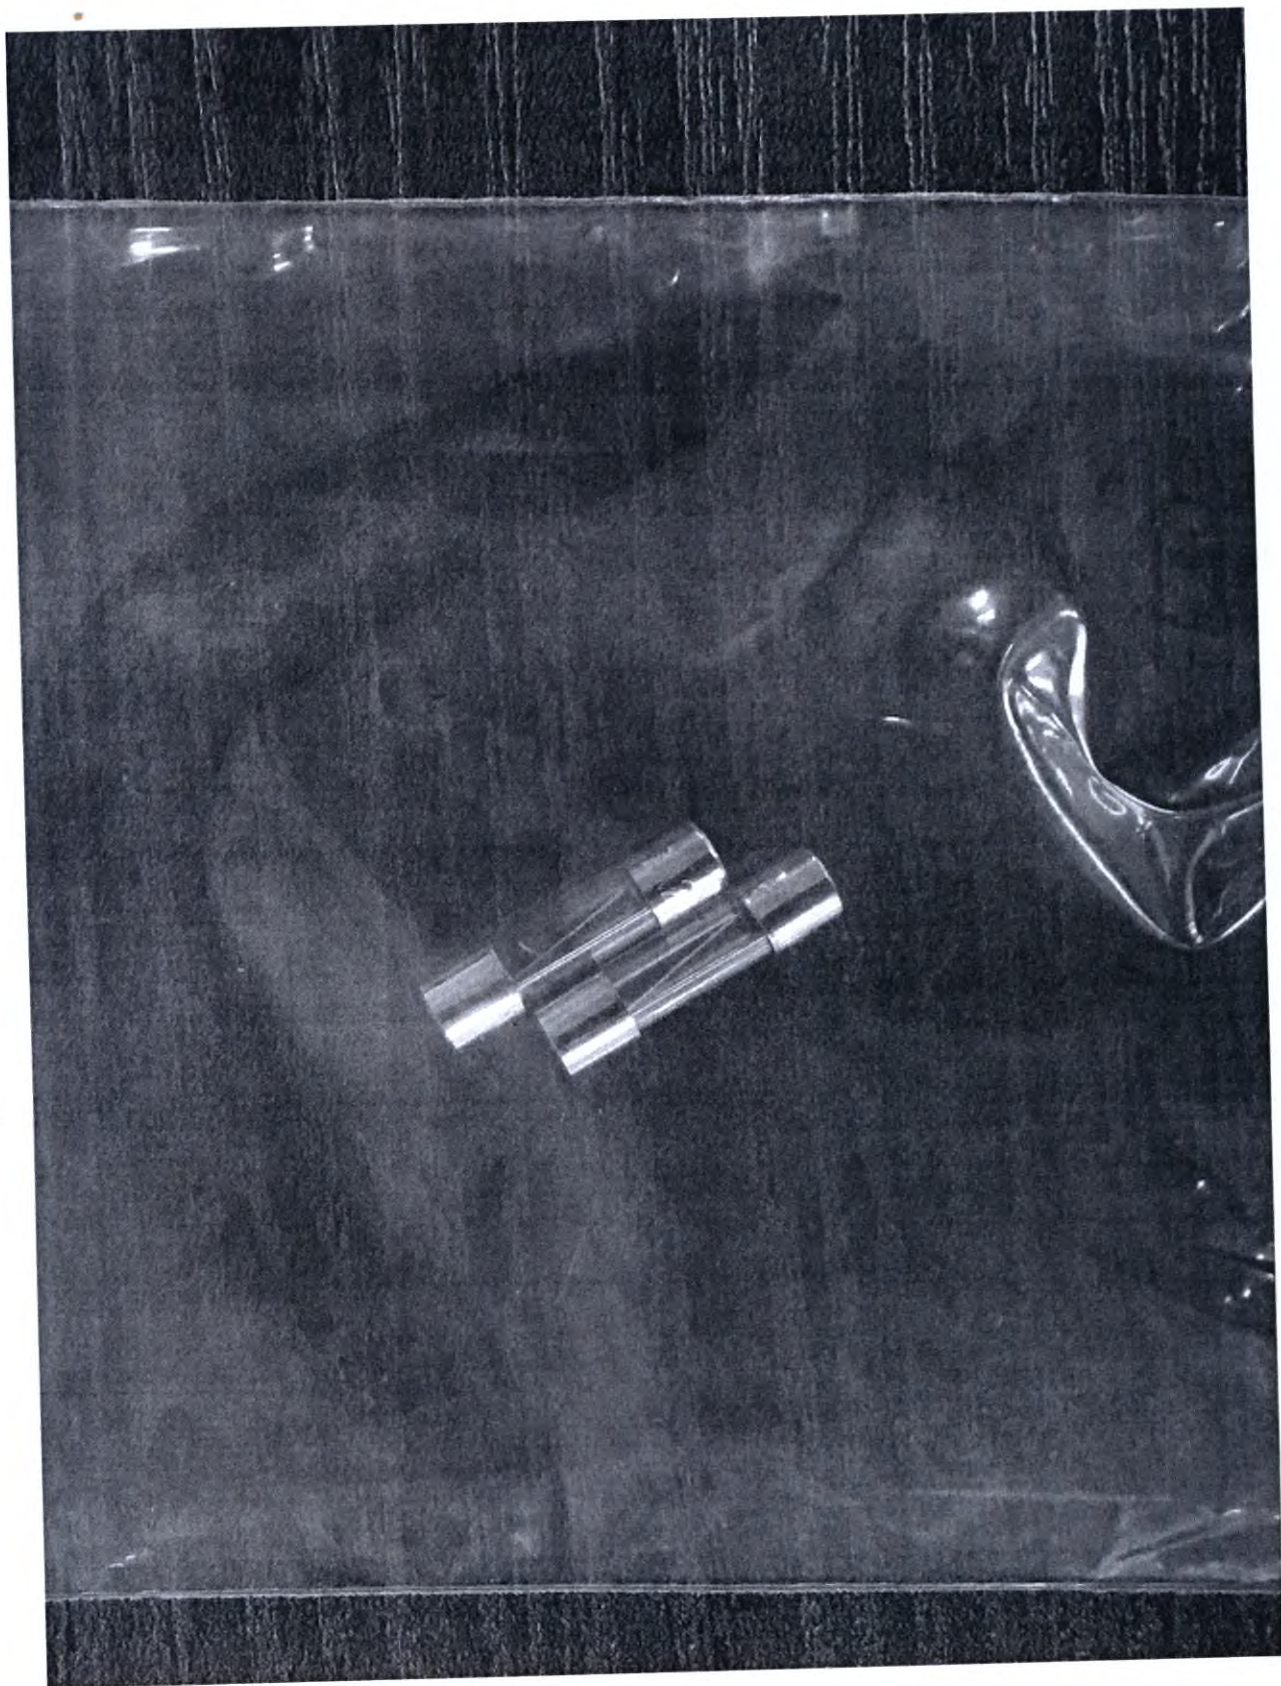

Исполнено в
сентябре 1980 г.
Исполнитель
Вед. инженер
Ромов И.Б.

