





ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Наборы для проведения биопсийных исследований
производства компании «ЗАМАР Д.О.О.», Хорватия**


1. Набор **Recharge "X" Type** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 12 G (2,7 мм), 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 100-300 мм, шаг 10 мм

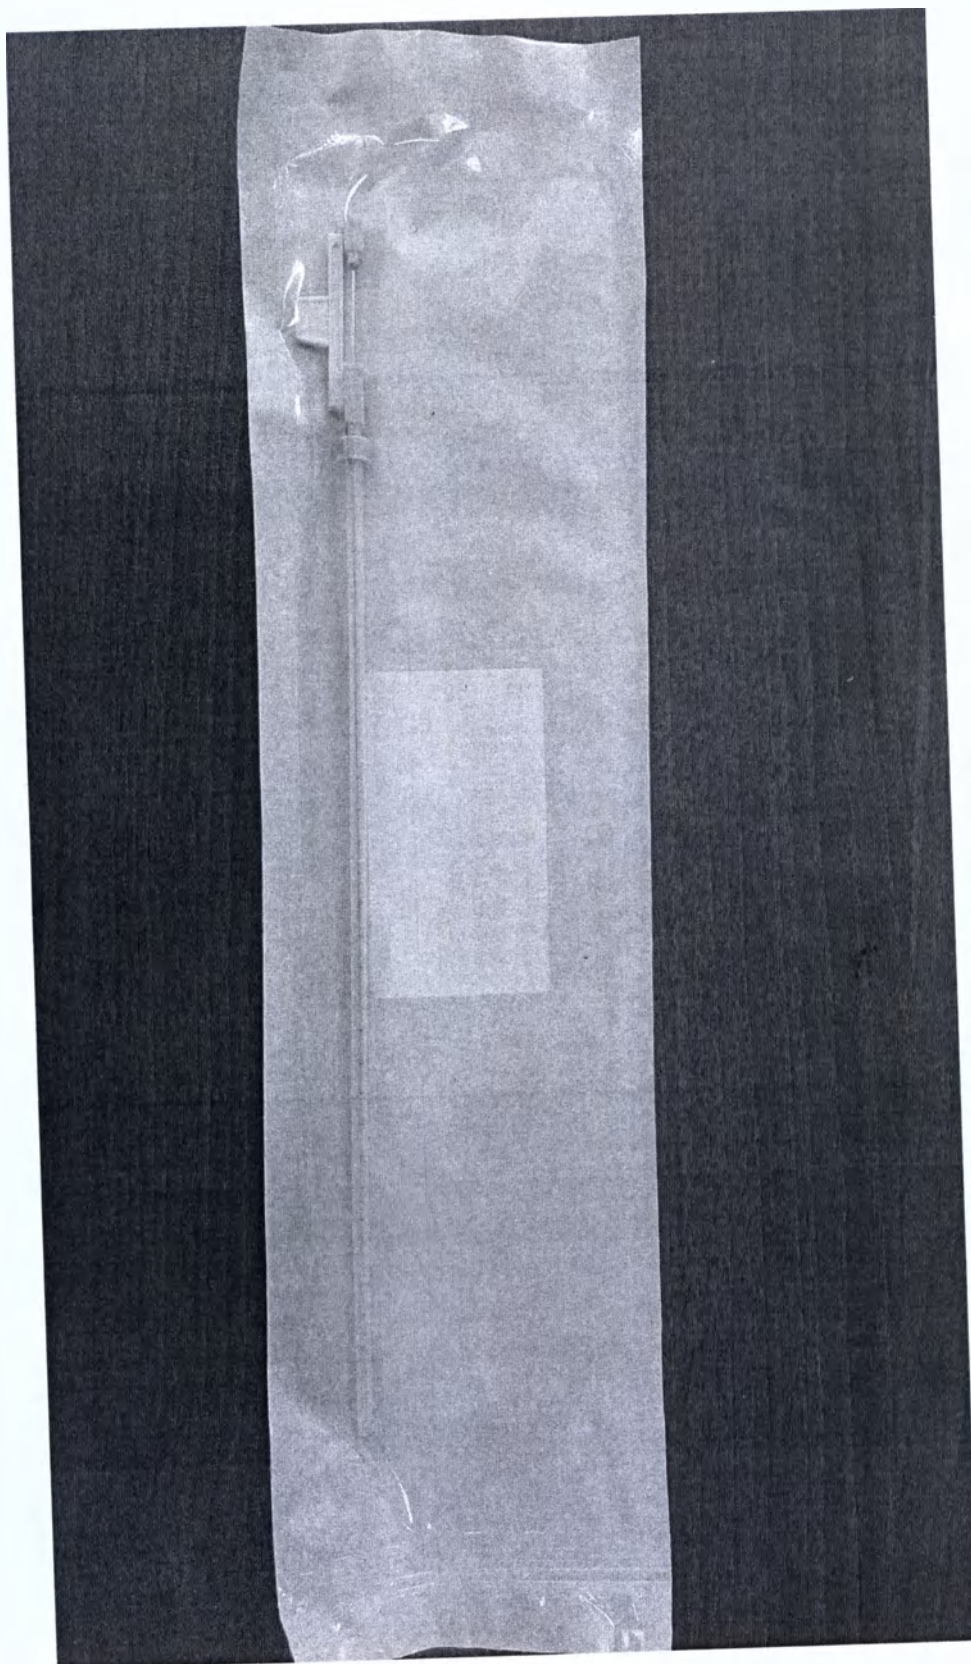


Пример маркировки упаковки набора Recharge "X" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей

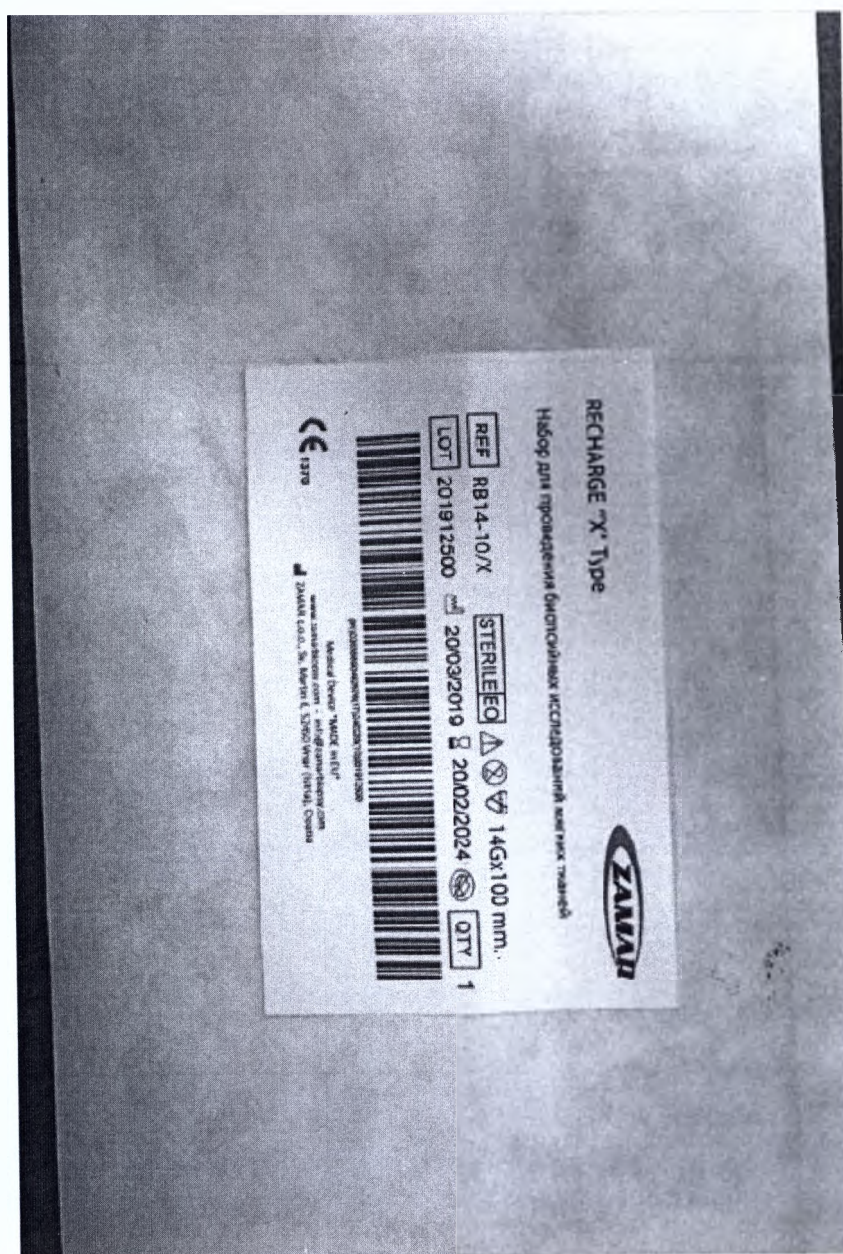


2. Набор **Recharge** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 12 G (2,7 мм), 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 100-300 мм, шаг 10 мм

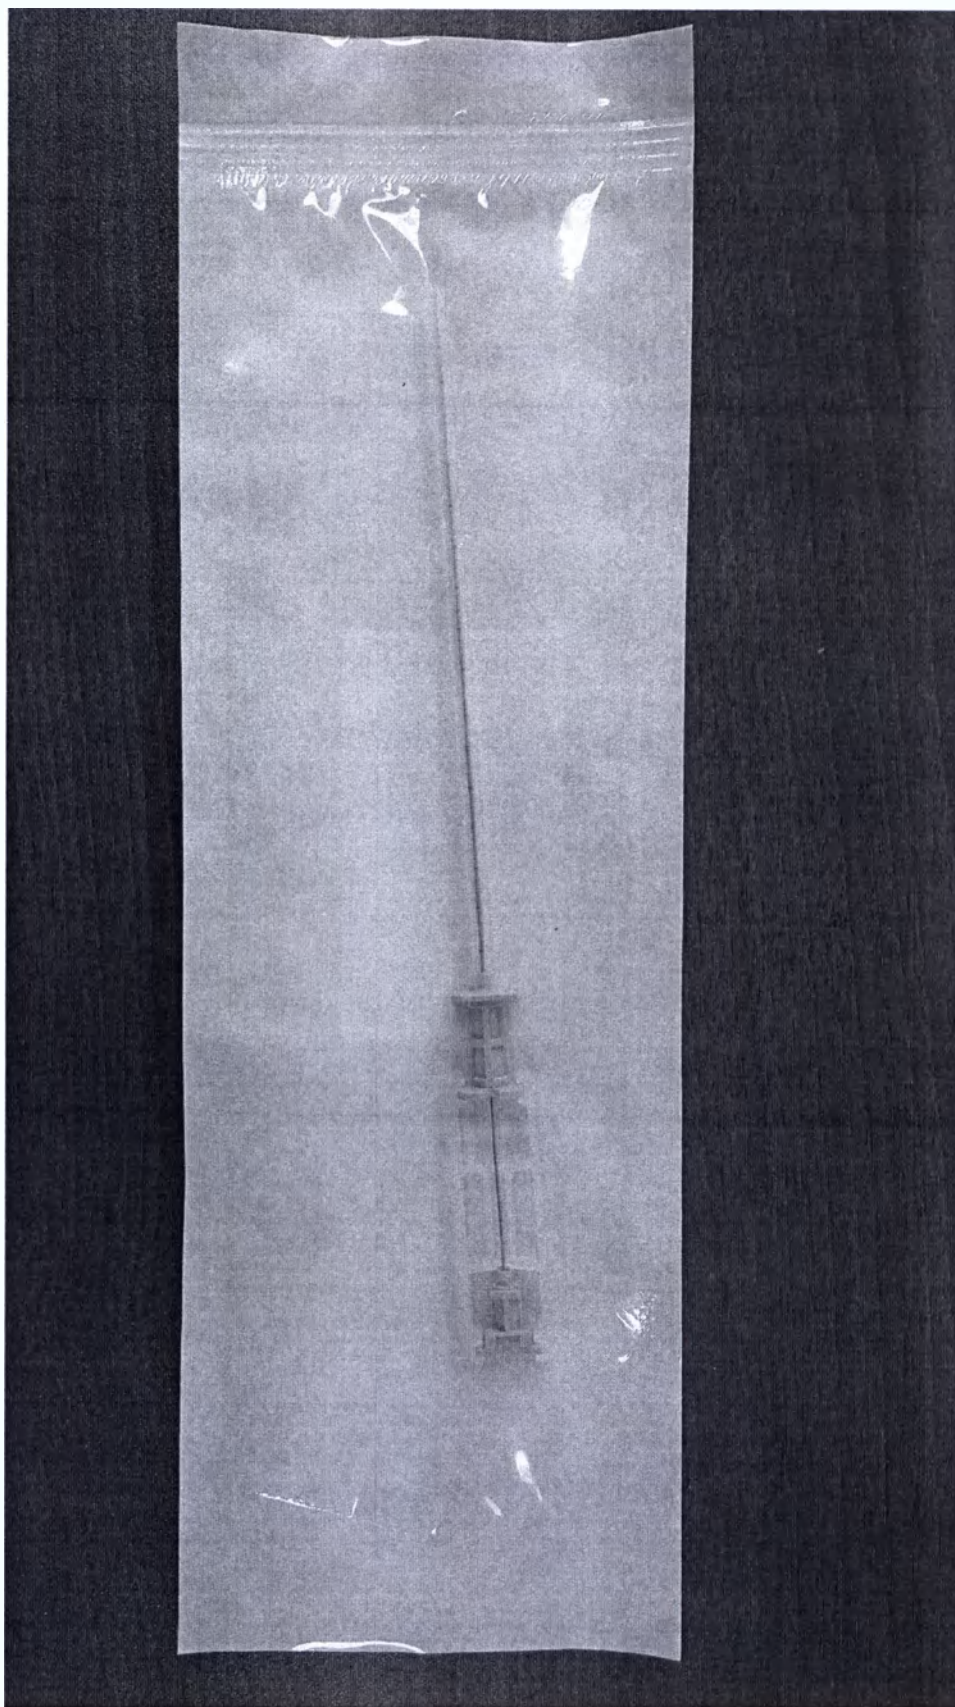


Пример маркировки упаковки набора Recharge для проведения биопсийных исследований мягких тканей

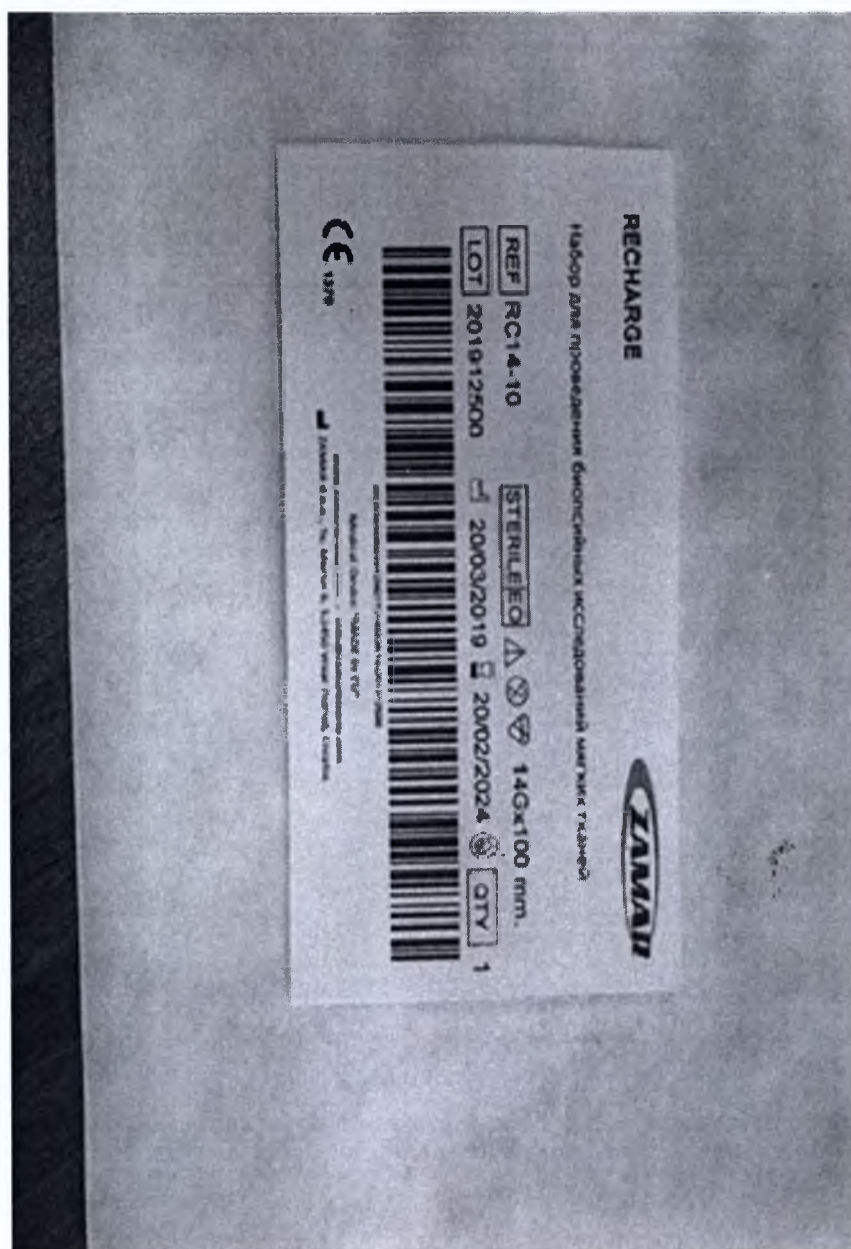


3. Набор **Recharge "V" Type** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 12 G (2,7 мм), 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 100-300 мм, шаг 10 мм

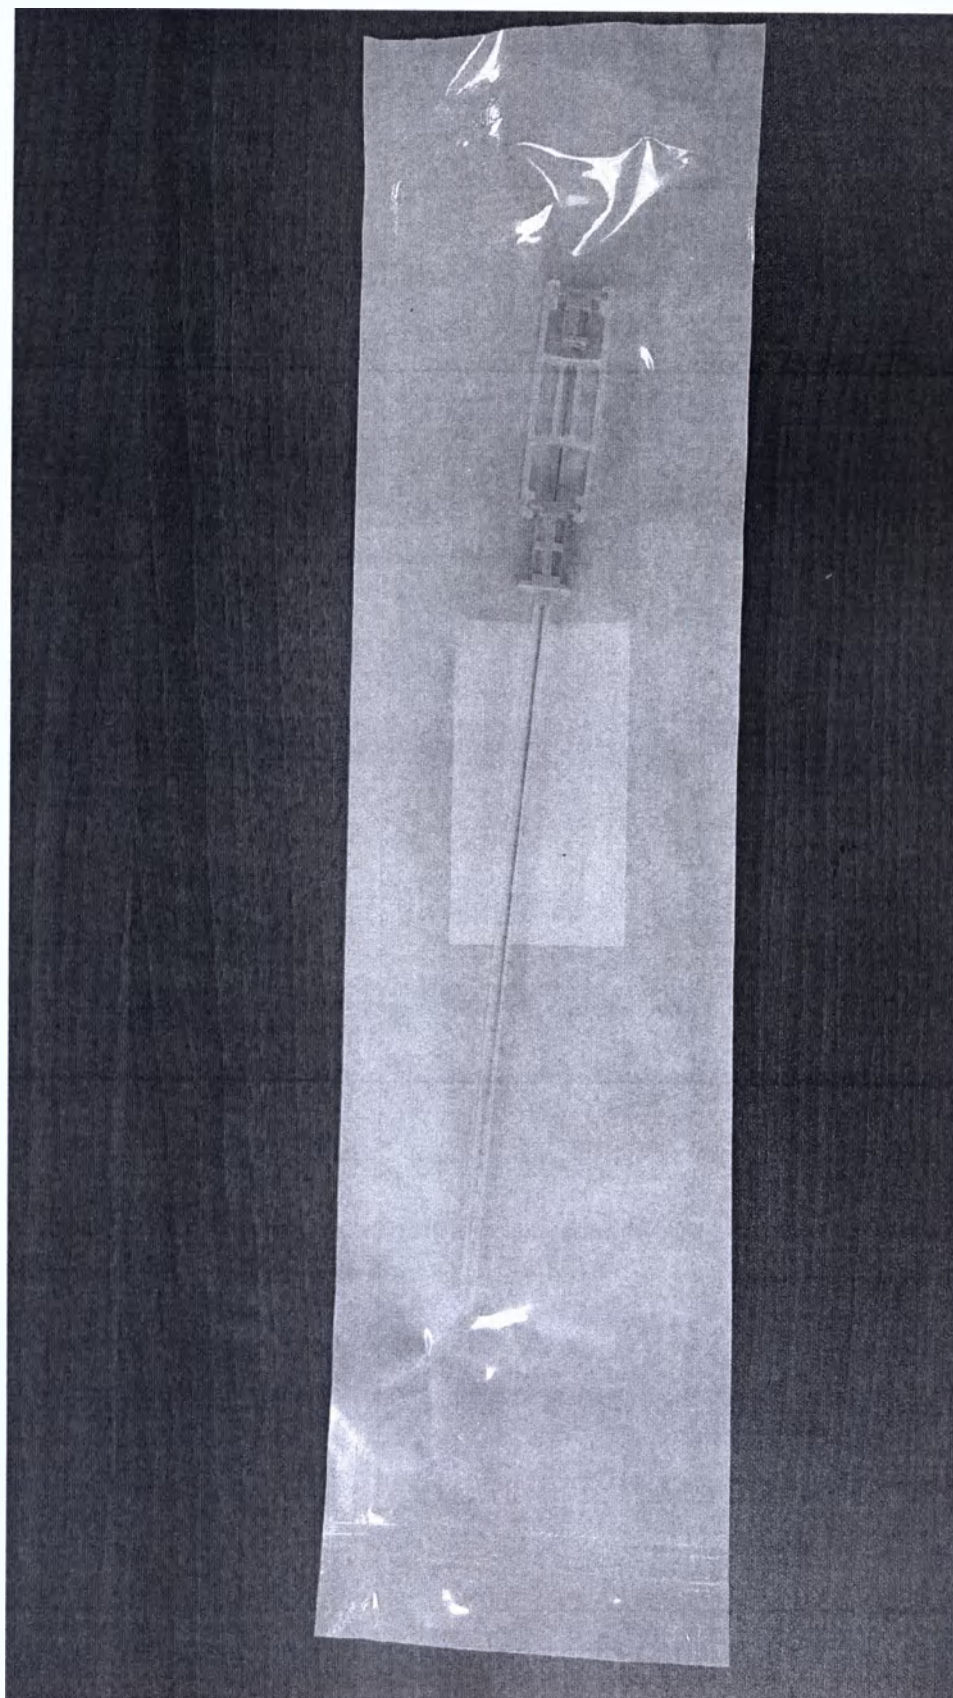

Пример маркировки упаковки набора Recharge "V" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей

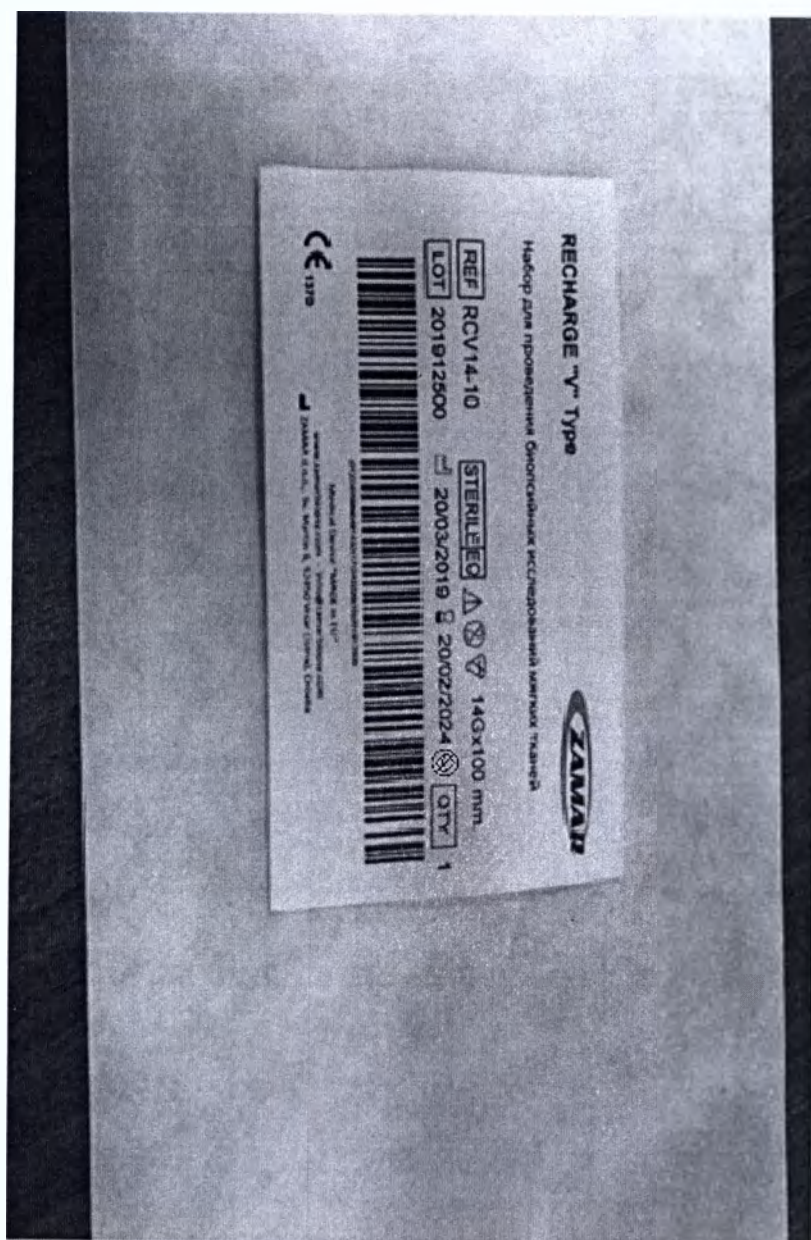


Набор **Recharge "B" Type** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 100-250 мм (шаг 10 мм), 300 мм, 470 мм

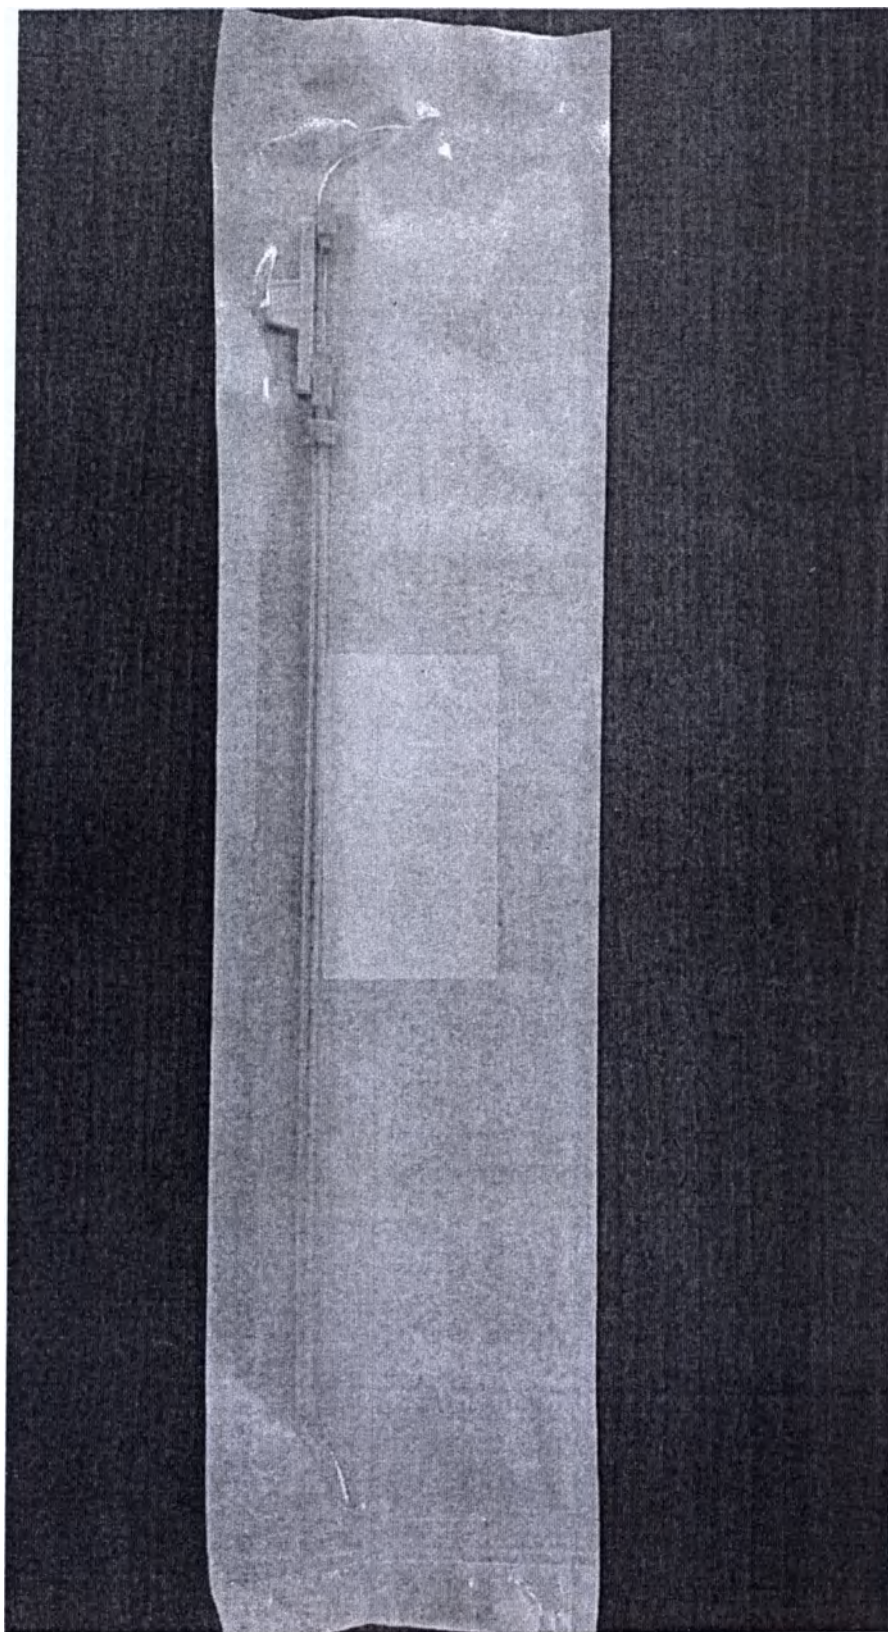


Пример маркировки упаковки набора Recharge "B" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей




5. Набор Recharge "P" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 100-250 мм (шаг 10 мм), 300 мм, 470 мм

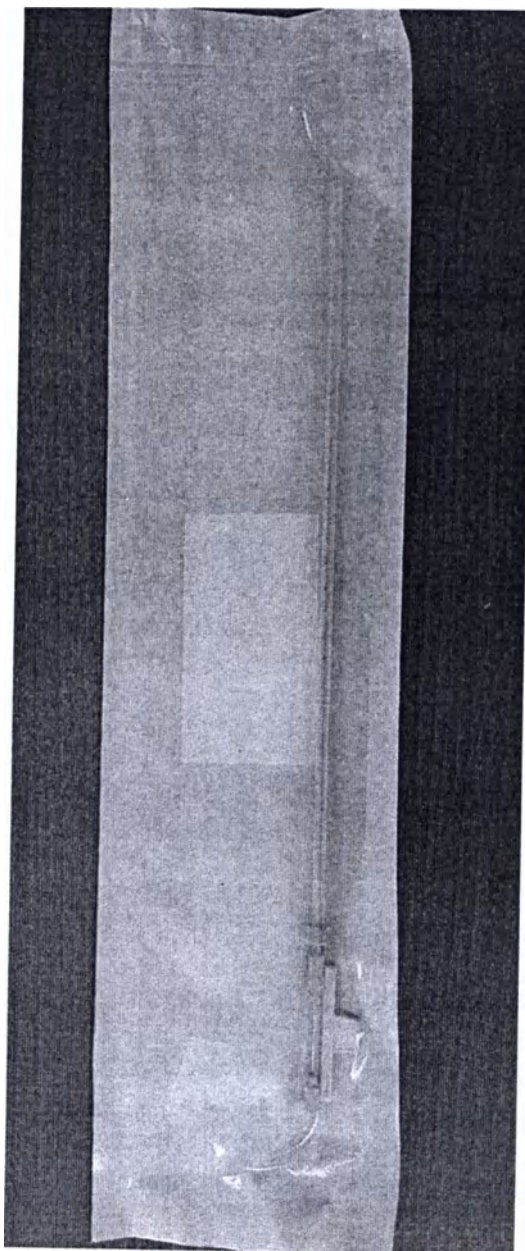

Пример маркировки упаковки набора Recharge "P" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей

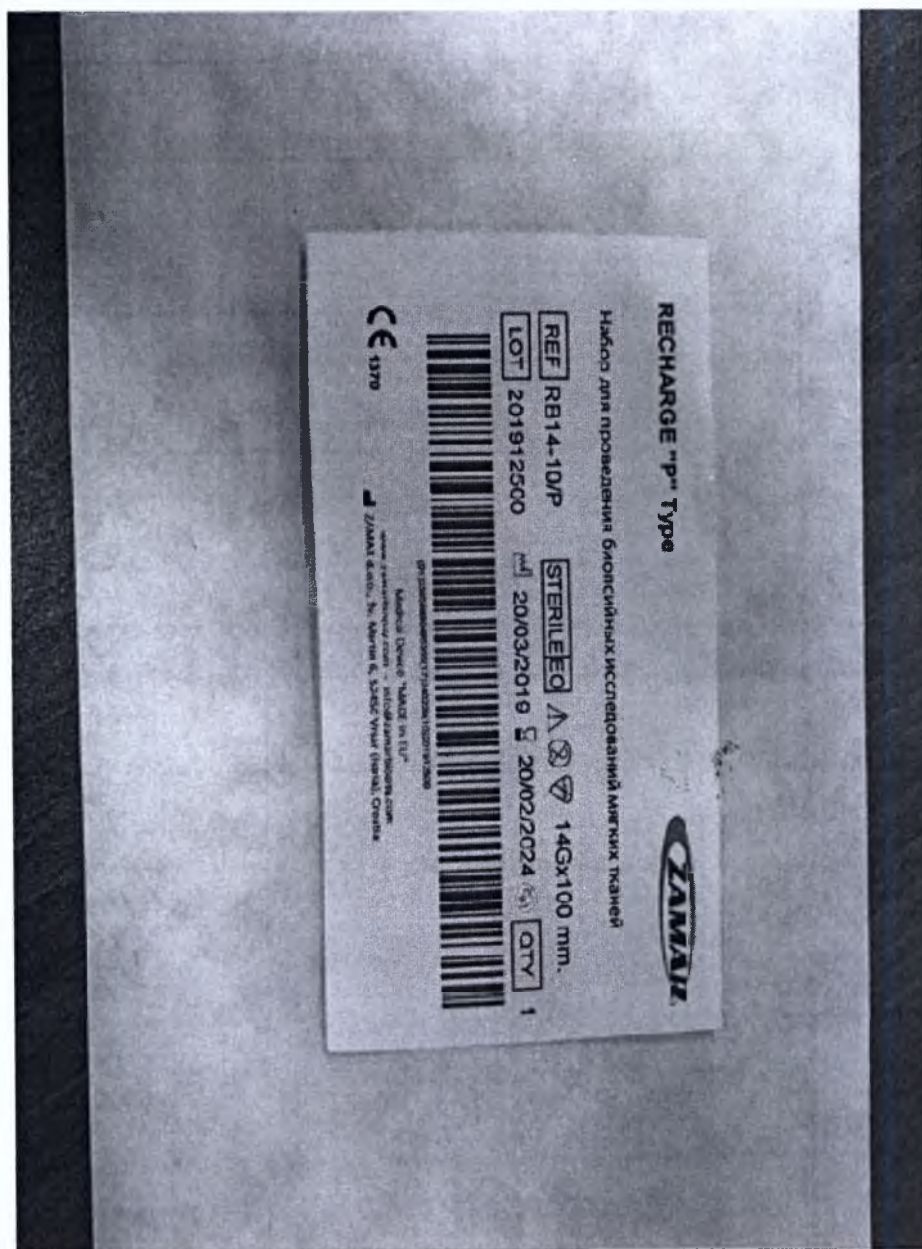


6. Набор **Ultimate** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

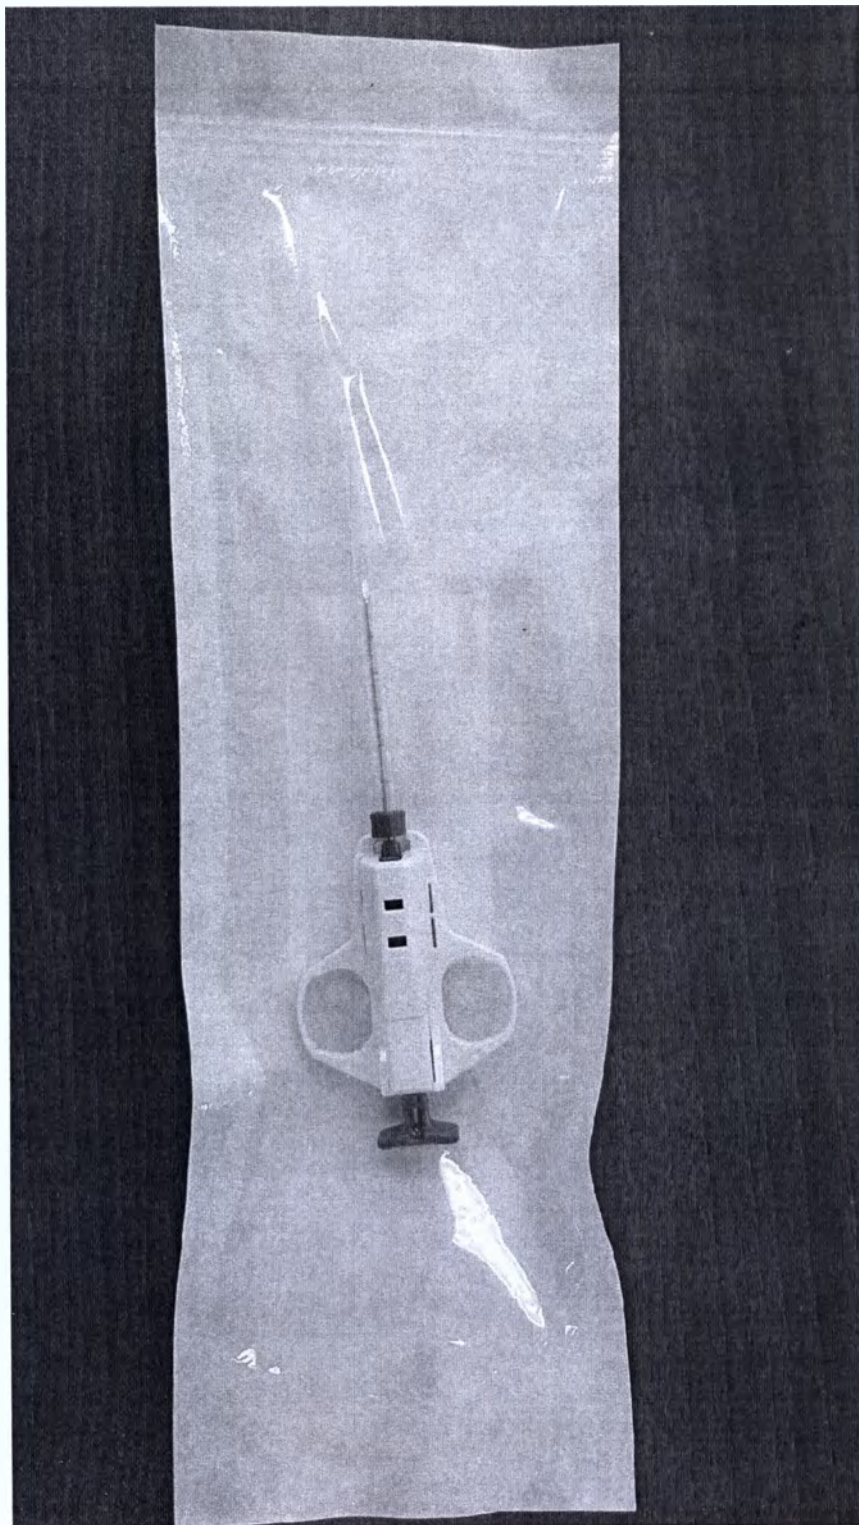


Пример маркировки упаковки набора **Ultimate** для проведения биопсийных исследований мягких тканей




7. Набор **Ultimate PMO** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

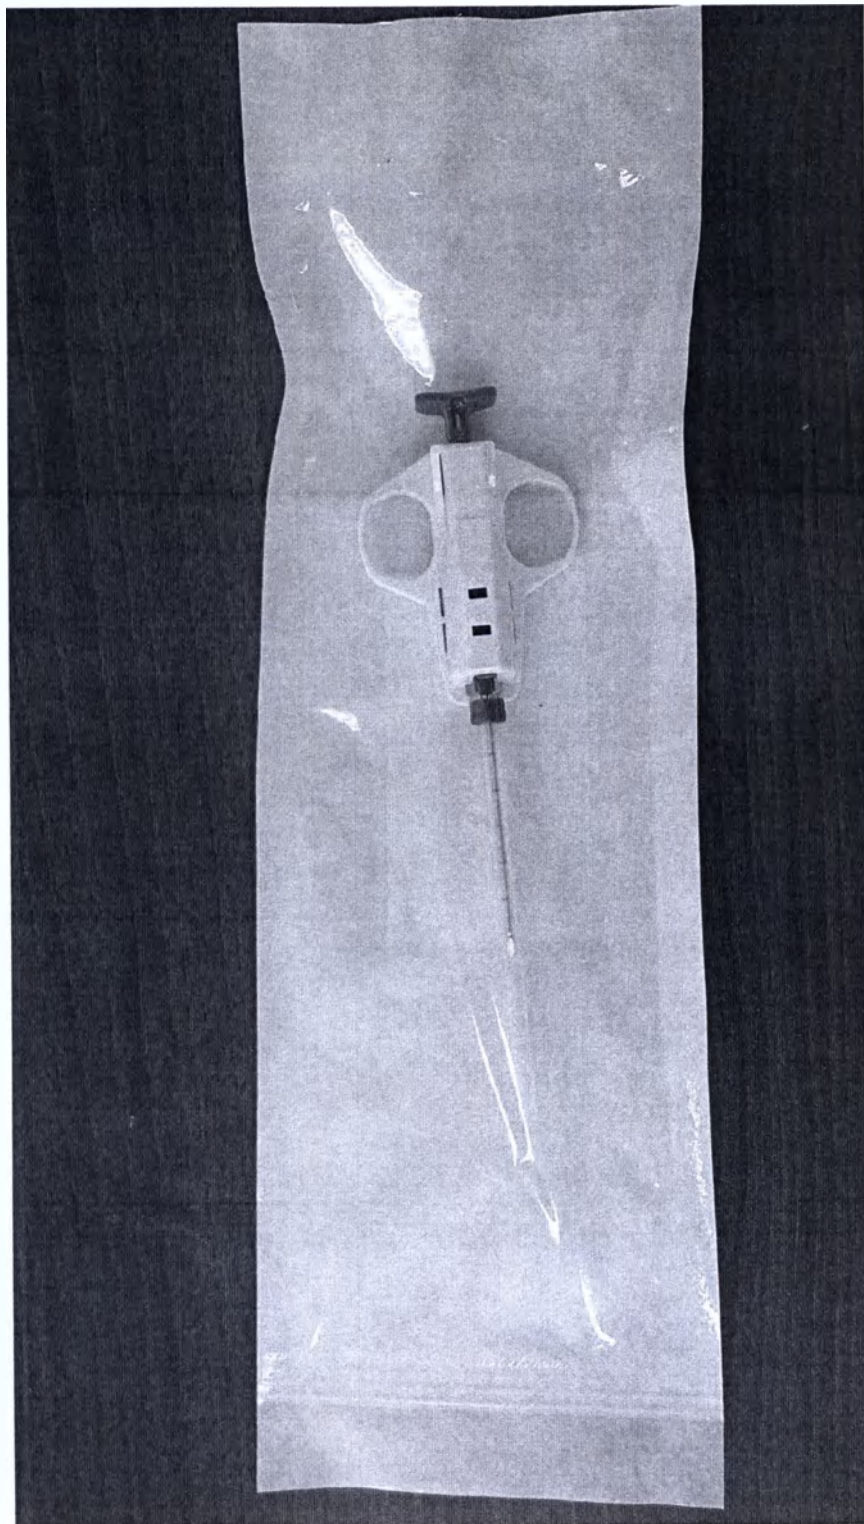


Пример маркировки упаковки набора Ultimate РМО для проведения биопсийных исследований мягких тканей

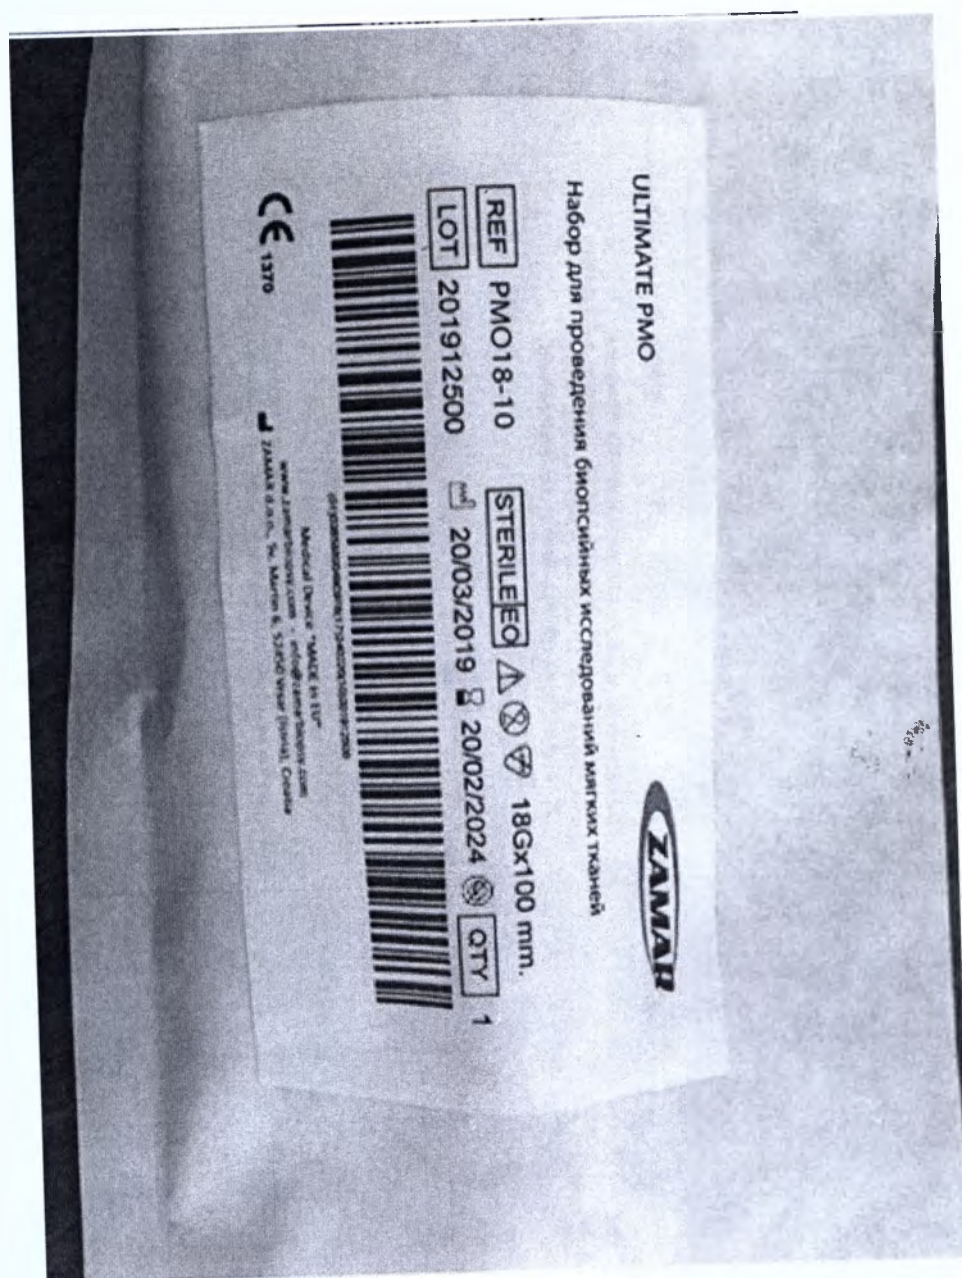


8. Набор **Ultimate MRI** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

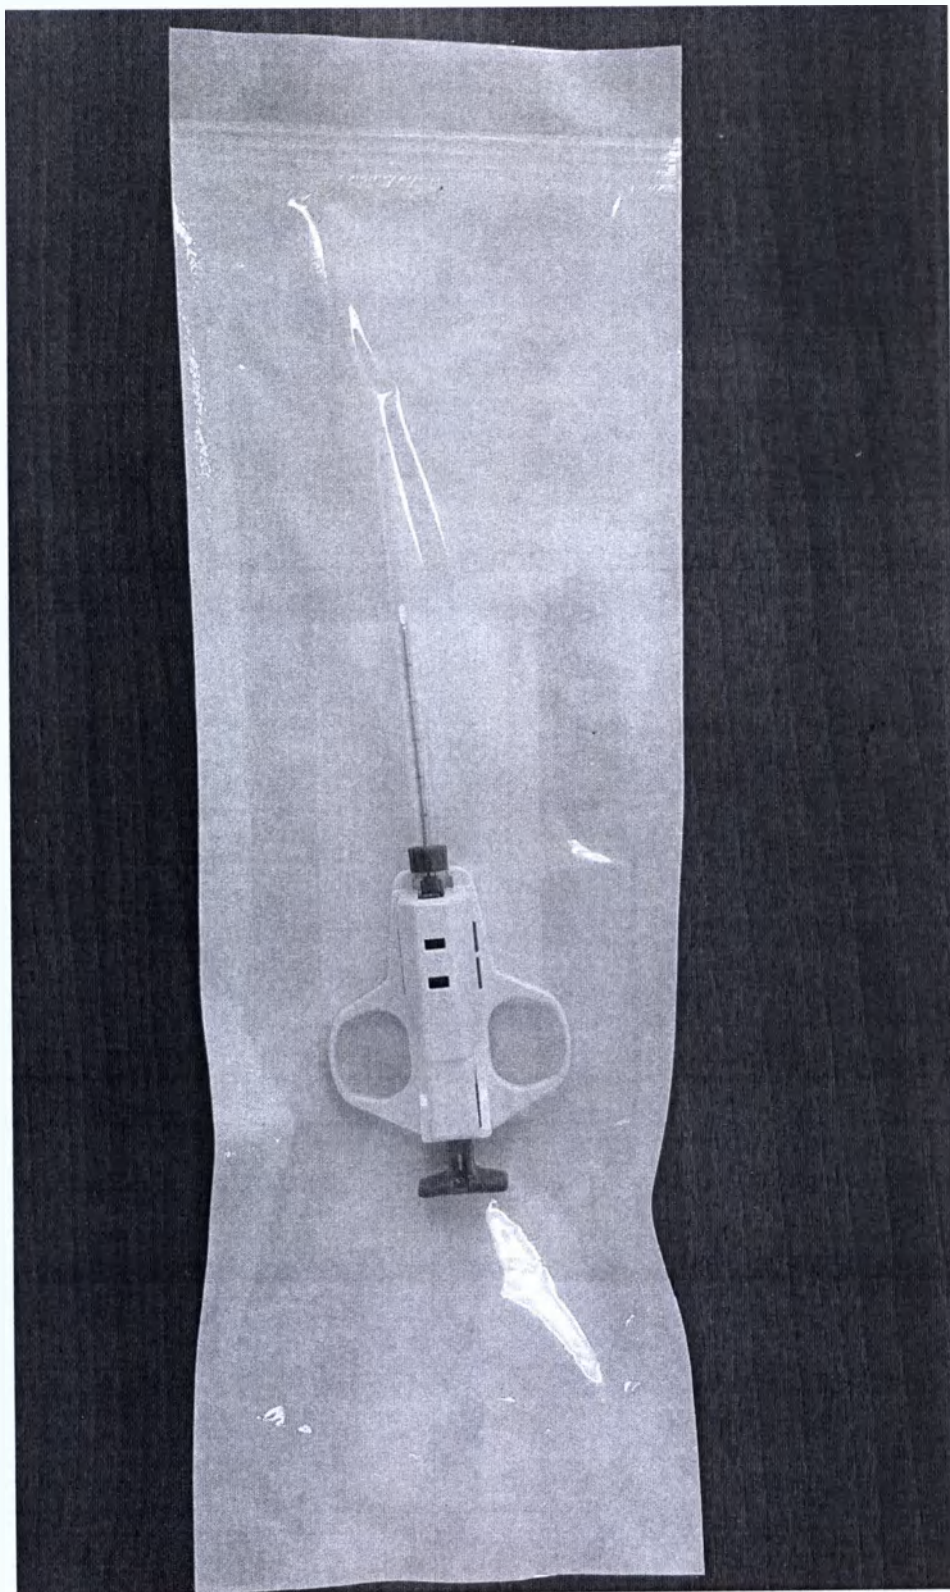

Пример маркировки упаковки набора Ultimate MRI для проведения биопсийных исследований мягких тканей

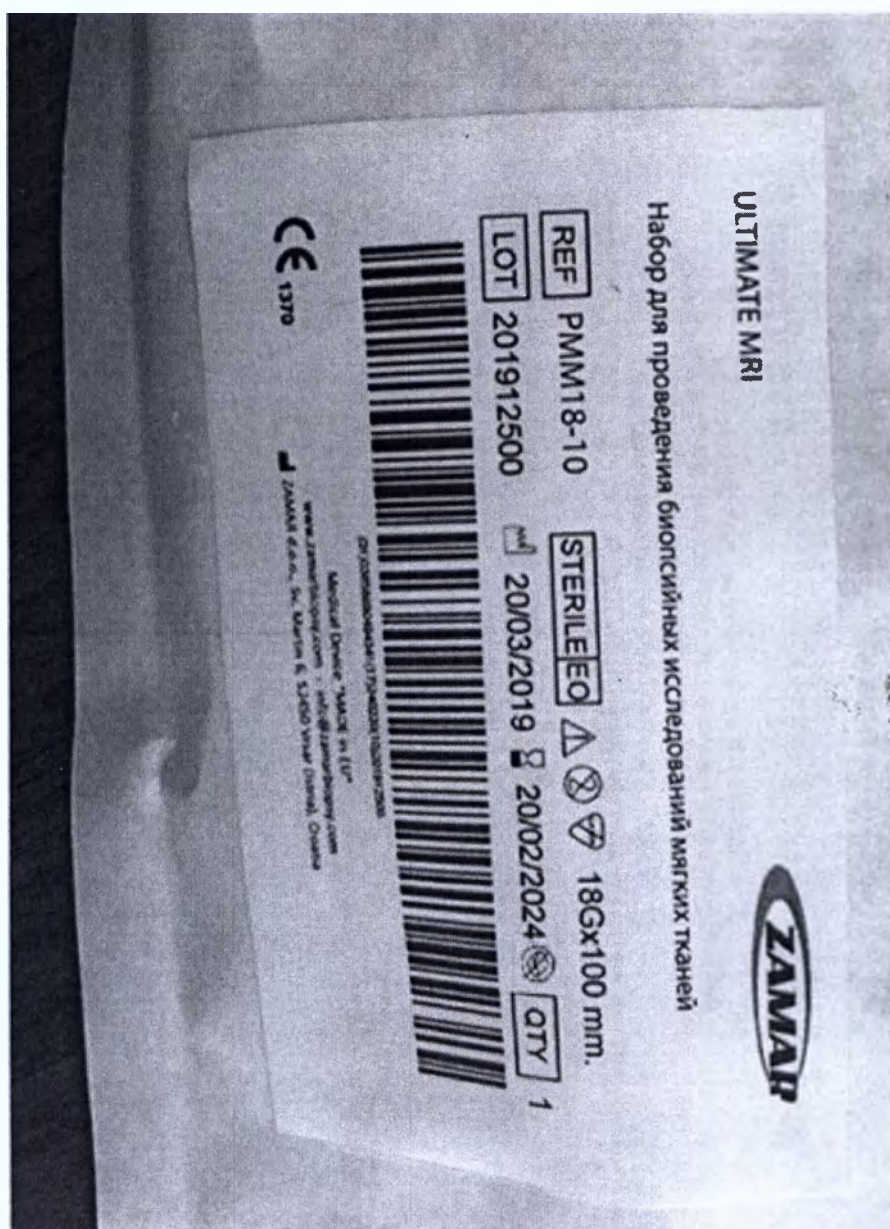


9. Набор **Ultimate Set** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70 мм, 100 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм, коаксиальная канюля диаметром 13G (2,4 мм), 15G (1,8 мм), 17G (1,40 мм), 19G (1,10 мм)

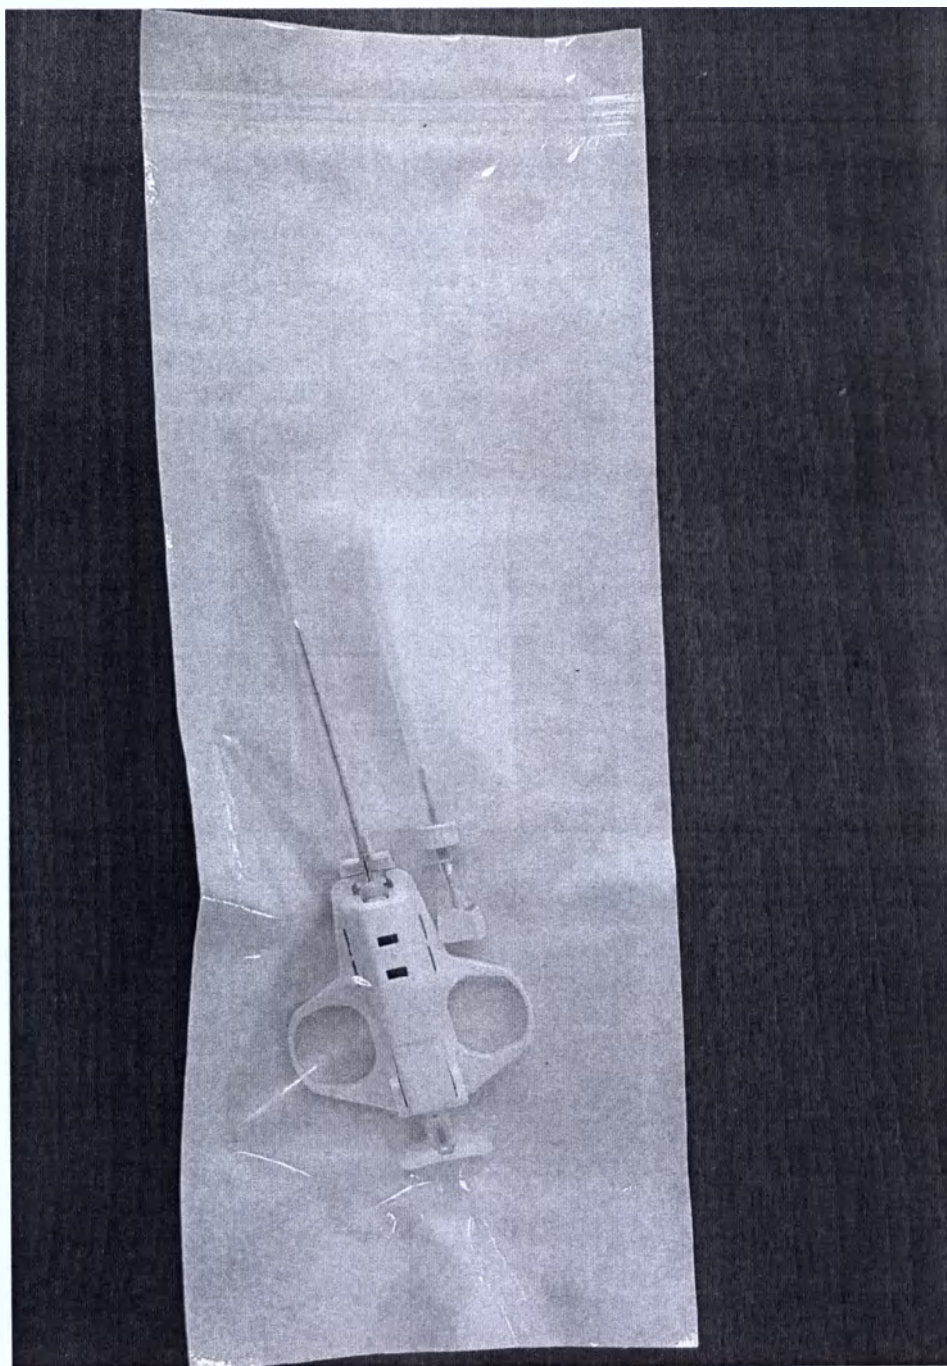


Пример маркировки упаковки набора Ultimate Set для проведения биопсийных исследований мягких тканей




10. Набор **Vantage** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

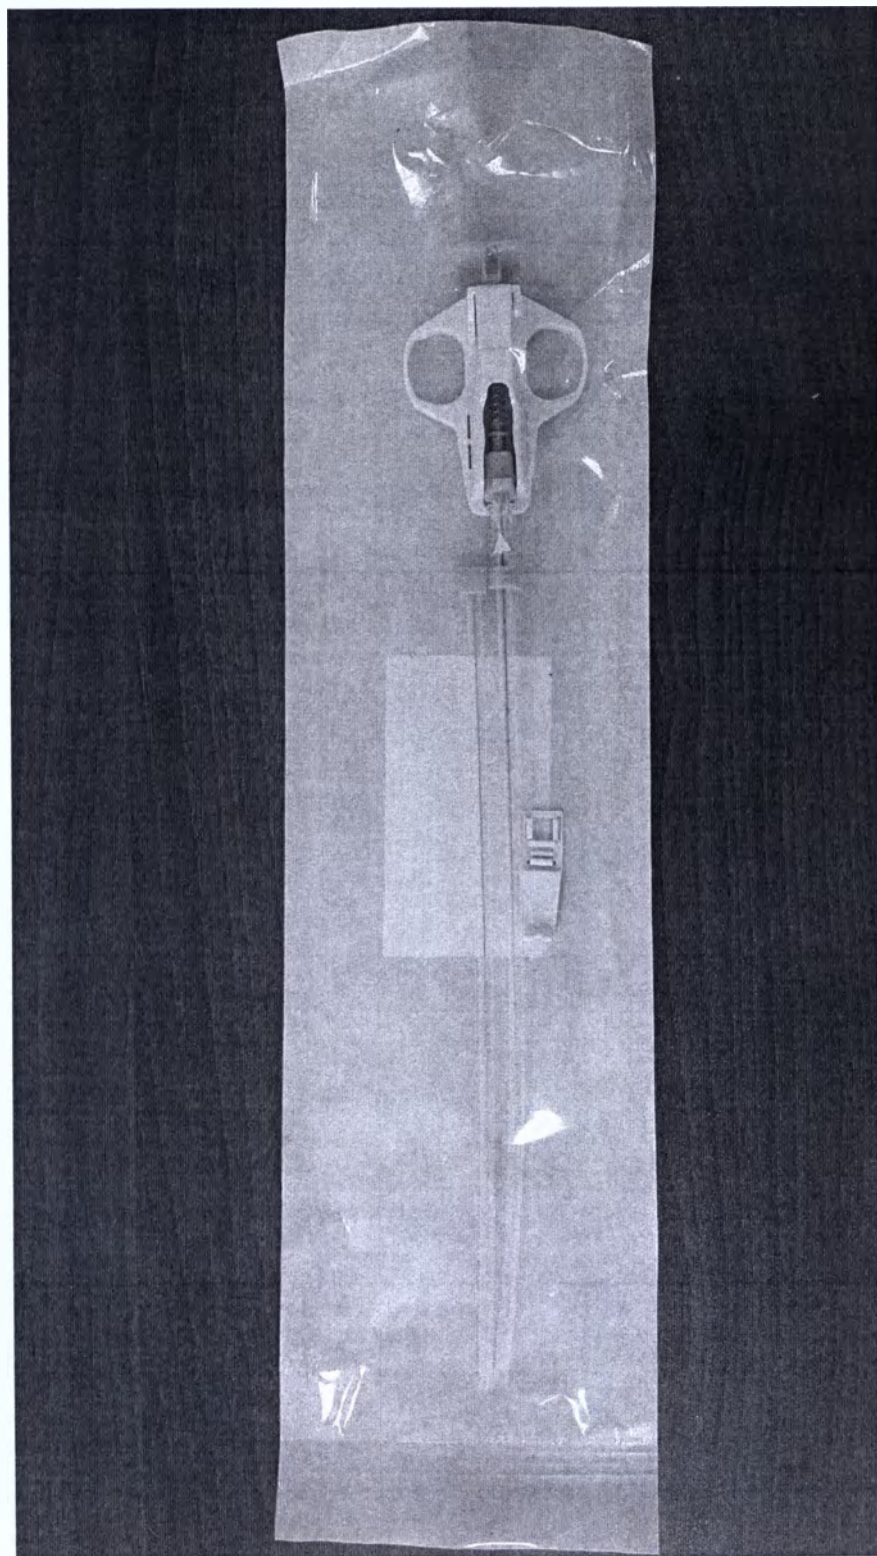

Пример маркировки упаковки набора **Vantage** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

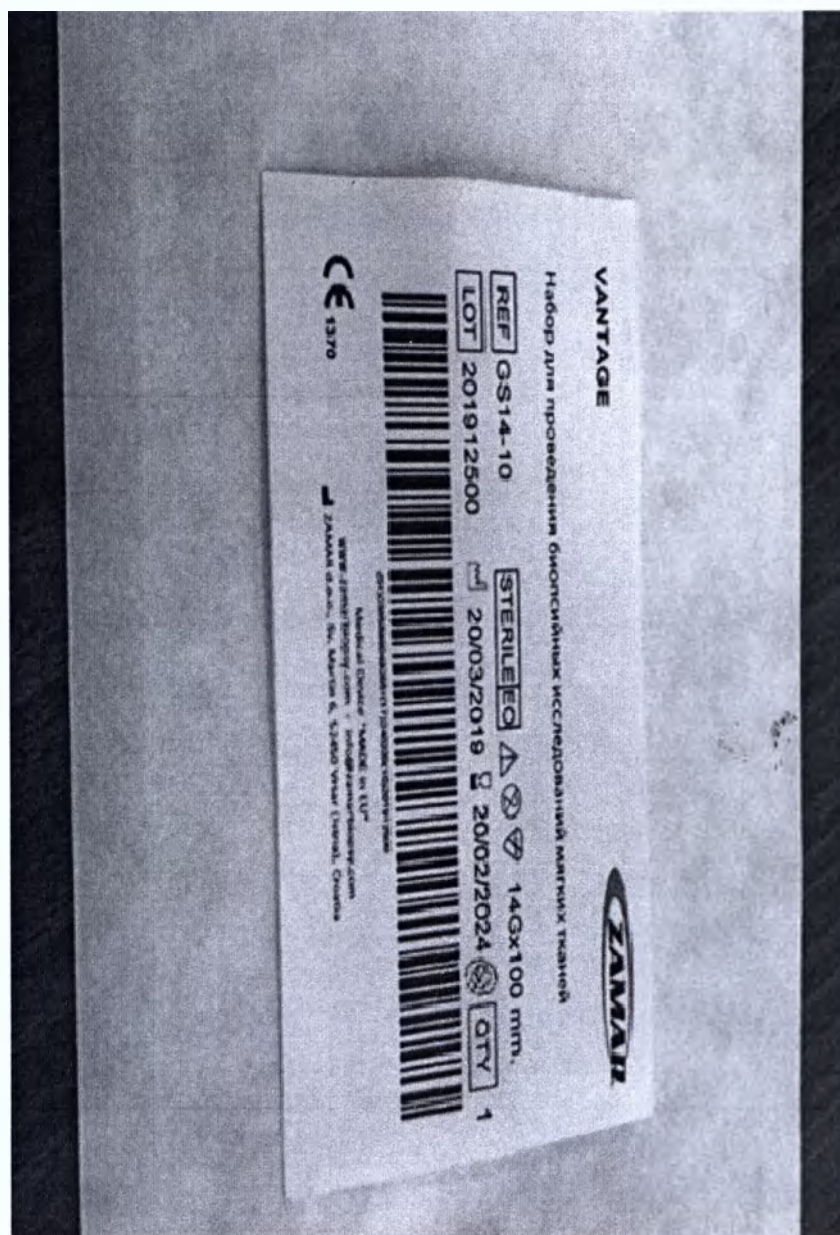


11. Набор **Vantage "B" Type** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 13G (2,50 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

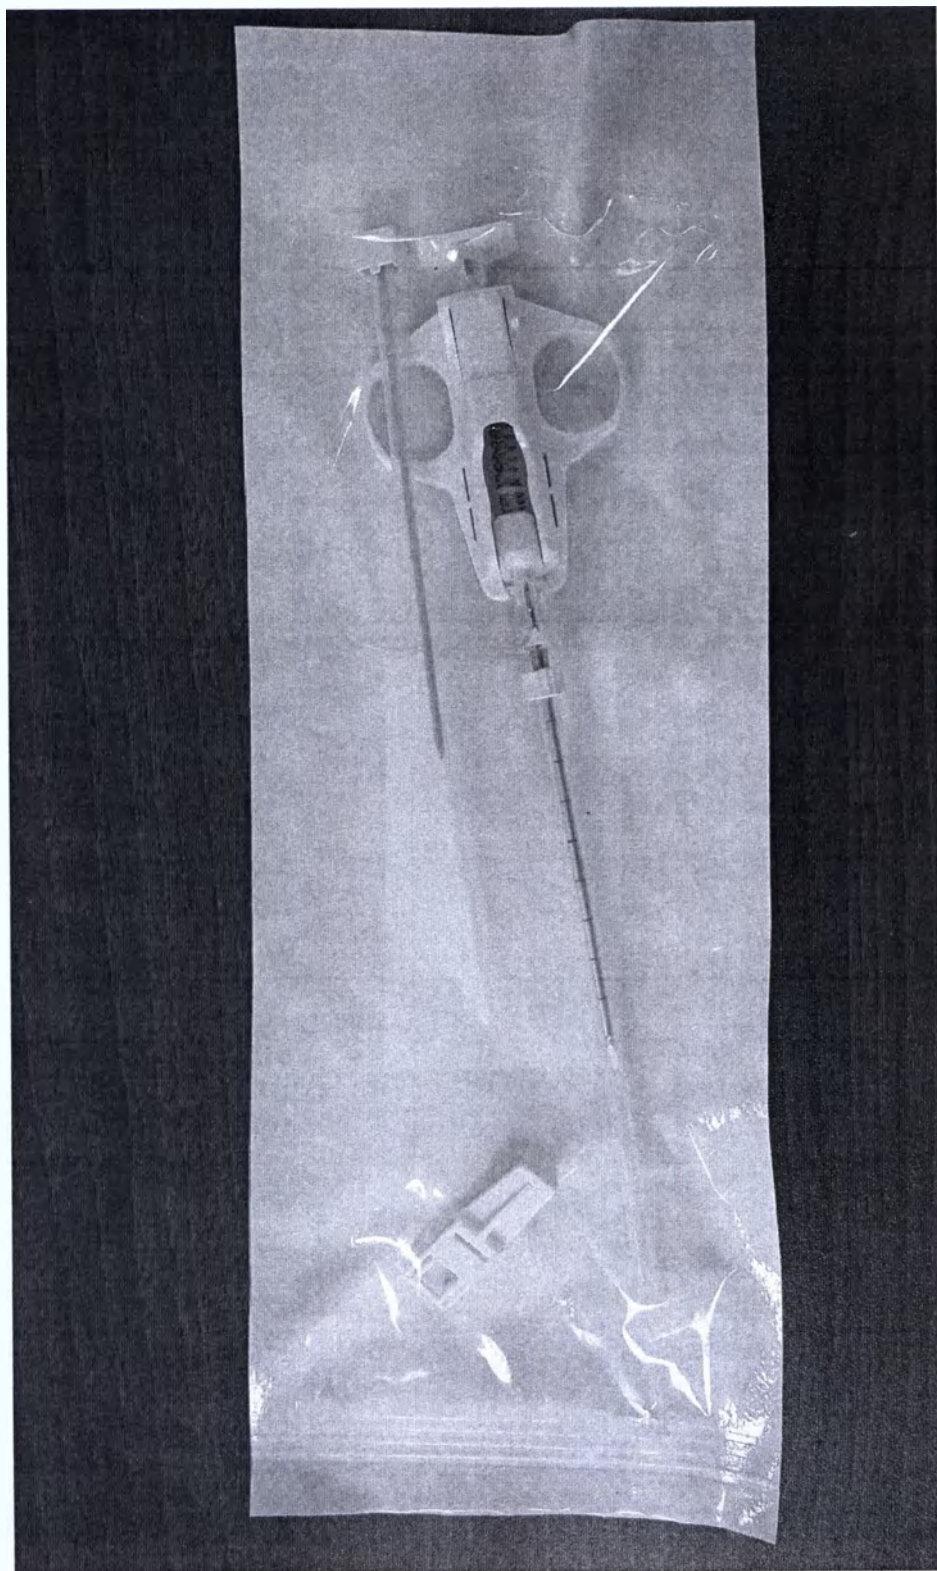

Пример маркировки упаковки набора Vantage "B" Type для проведения биопсийных исследований мягких тканей



12. Набор **Vantage GSO** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,6 мм), 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), длиной 70-250 мм, шаг 10 мм

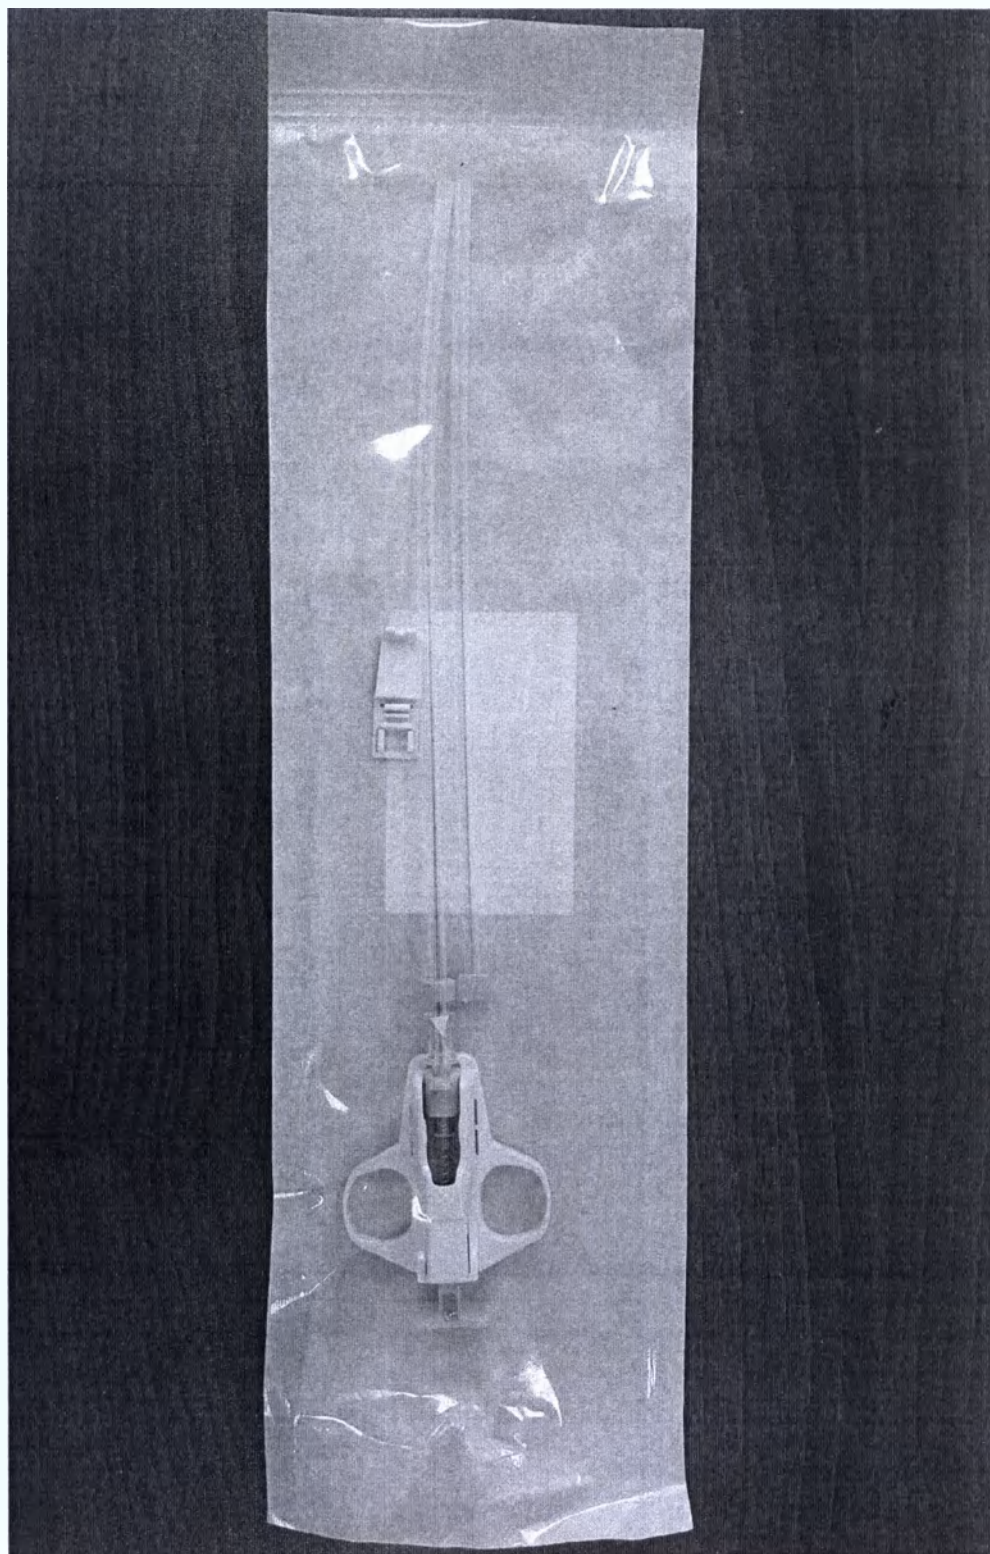


VANTAGE GSO

Набор для проведения биопсийных исследований маточных тканей

REF GSO20-20 **STERILE EO**    20Gx200 mm

LOT 201912500  20/03/2019  20/02/2024  **QTY** 1



CE 1370


Medical Device "MADE IN EU"

www.zammarbiology.com - info@zammarbiology.com


ZAMMAR DO. LLC, 5v. Martin 6, 52450 Vrsat (18819), Croatia




13. Набор **Coaxial needle** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 13G (2,50 мм), 15G (1,80 мм), 17G (1,47 мм), 19G (1,10 мм), длиной 20-150 мм, шаг 10 мм

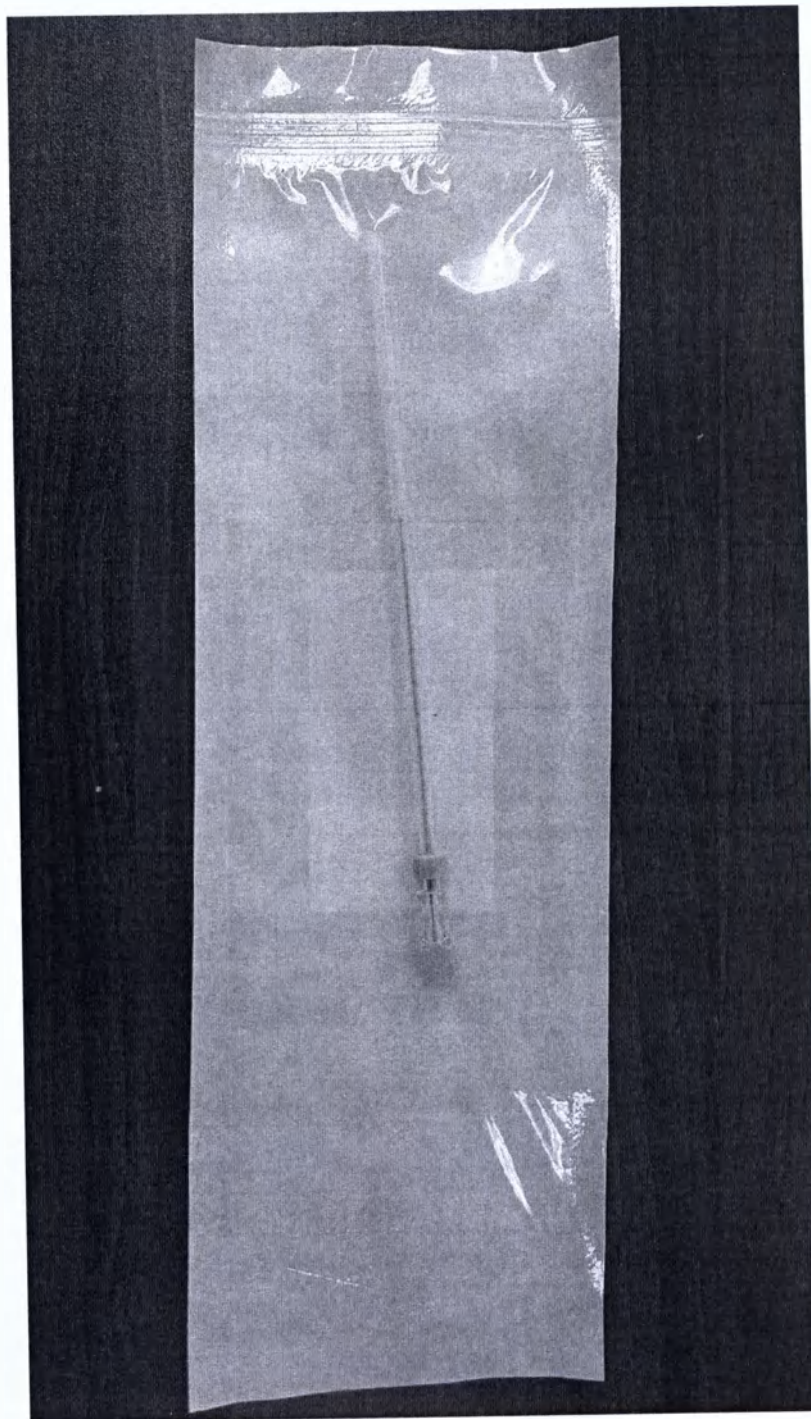


Пример маркировки упаковки набора **Coaxial needle** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

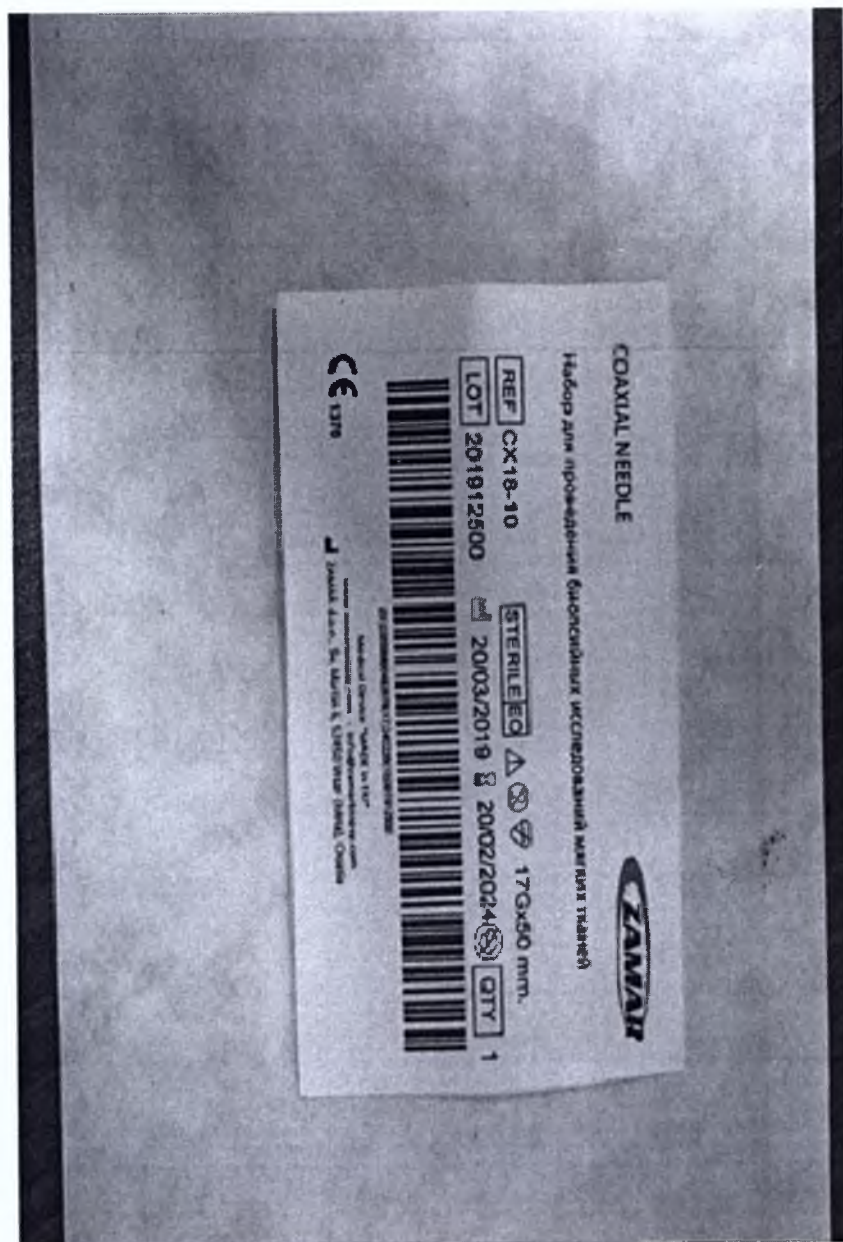


14. Набор **Coaxial needle MRI** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 13G (2,50 мм), 15G (1,80 мм), 17G (1,47 мм), 19G (1,10 мм), длиной 20-150 мм, шаг 10 мм

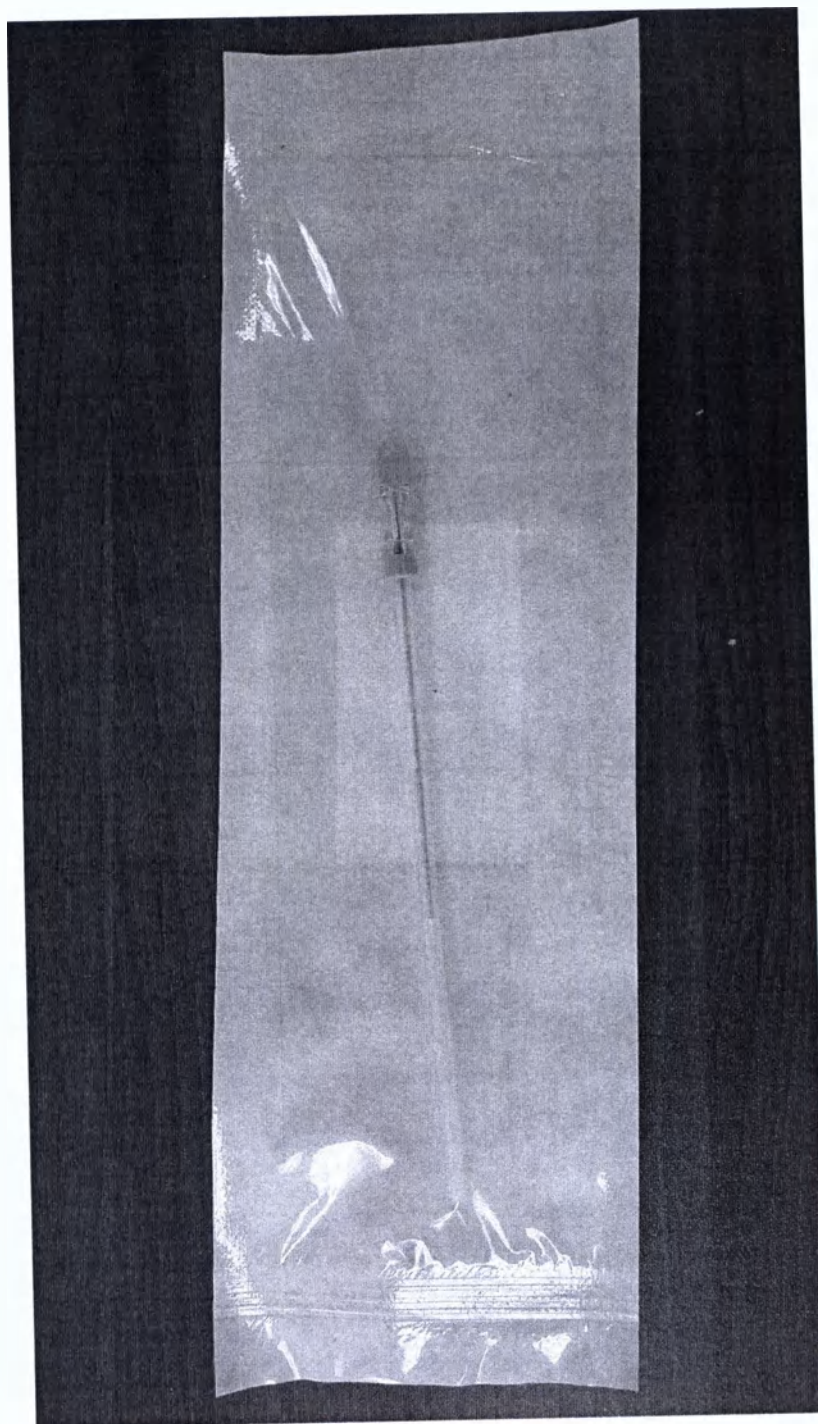


Пример маркировки упаковки набора **Coaxial needle MRI** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

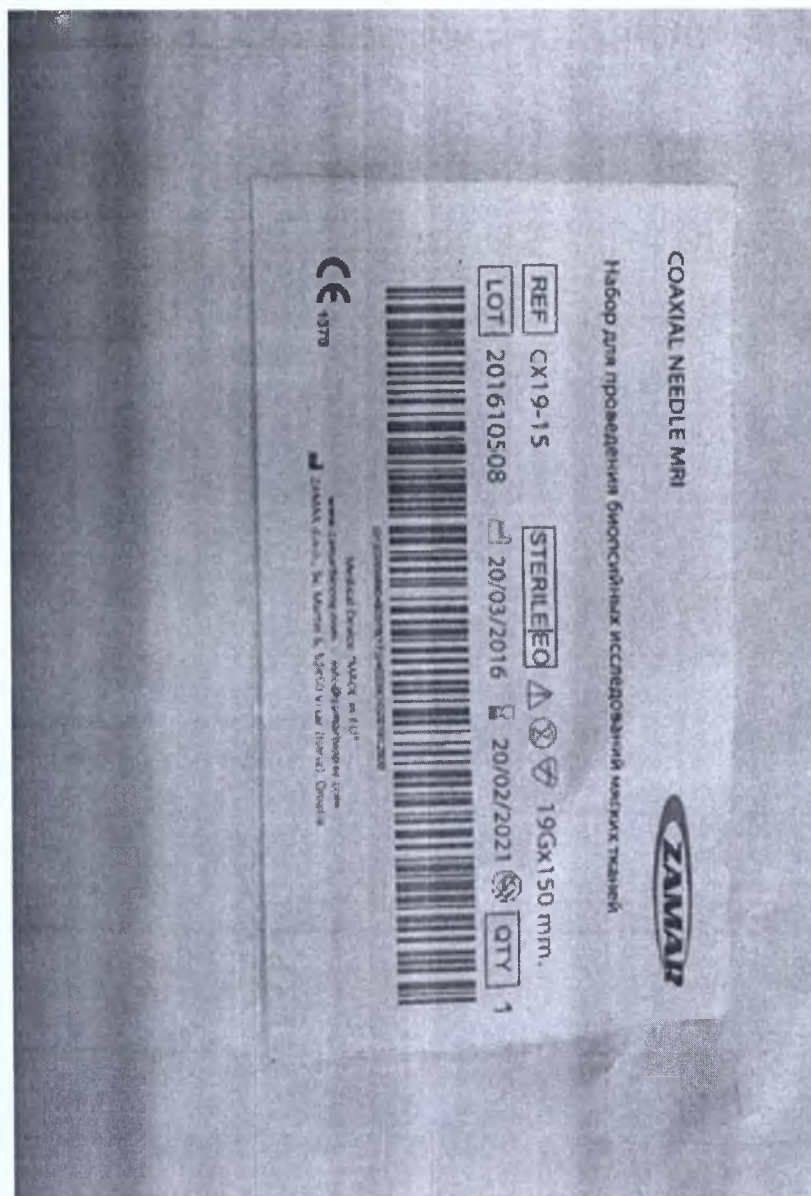


15. Набор **Chorial Villi** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), длиной 150 мм, 200 мм, коаксиальной канюлей, диаметром 1,15 мм, 1,10 мм, 0,95 мм

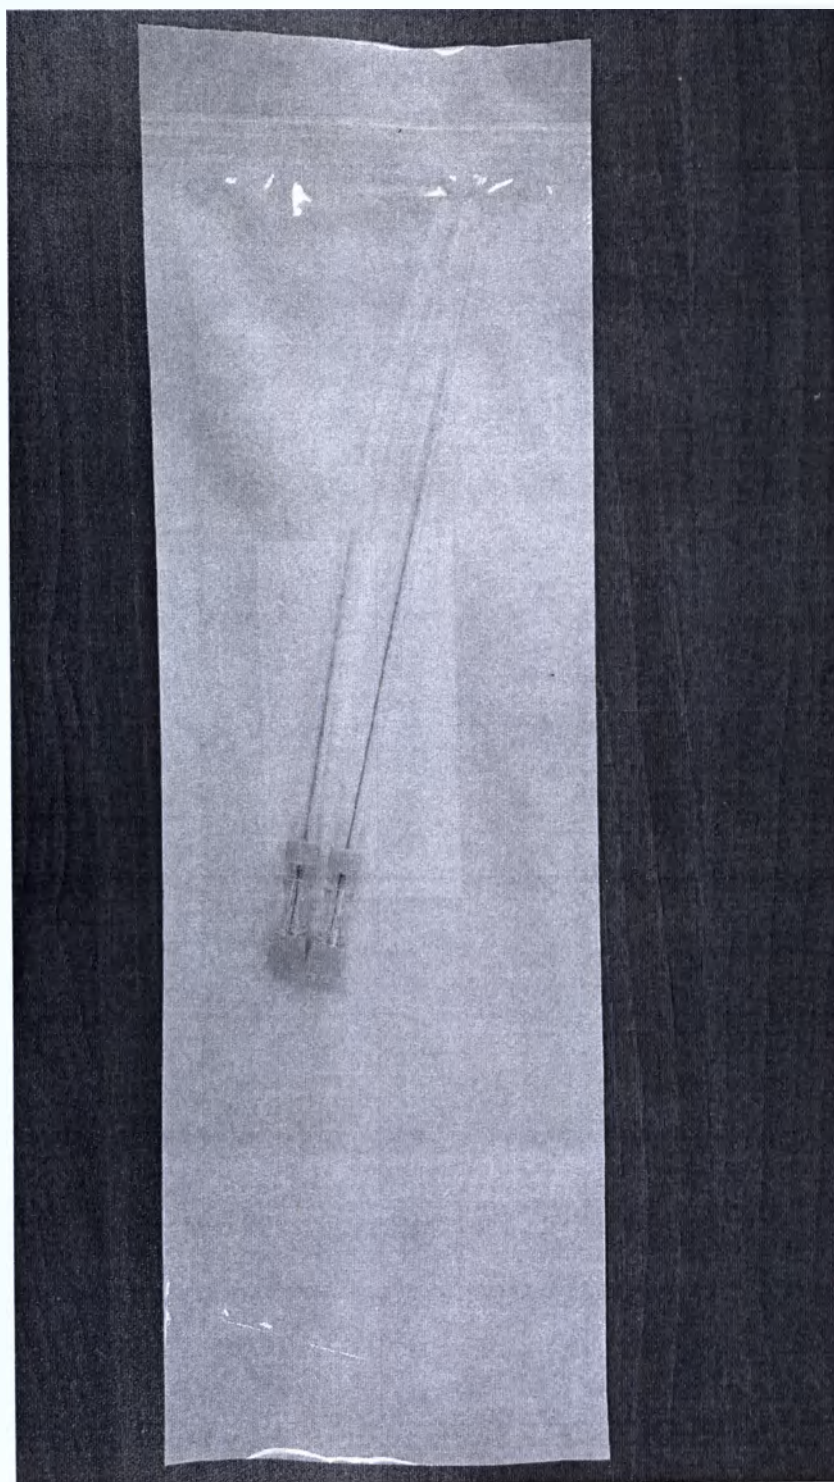


Пример маркировки упаковки набора **Chorial Villi** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

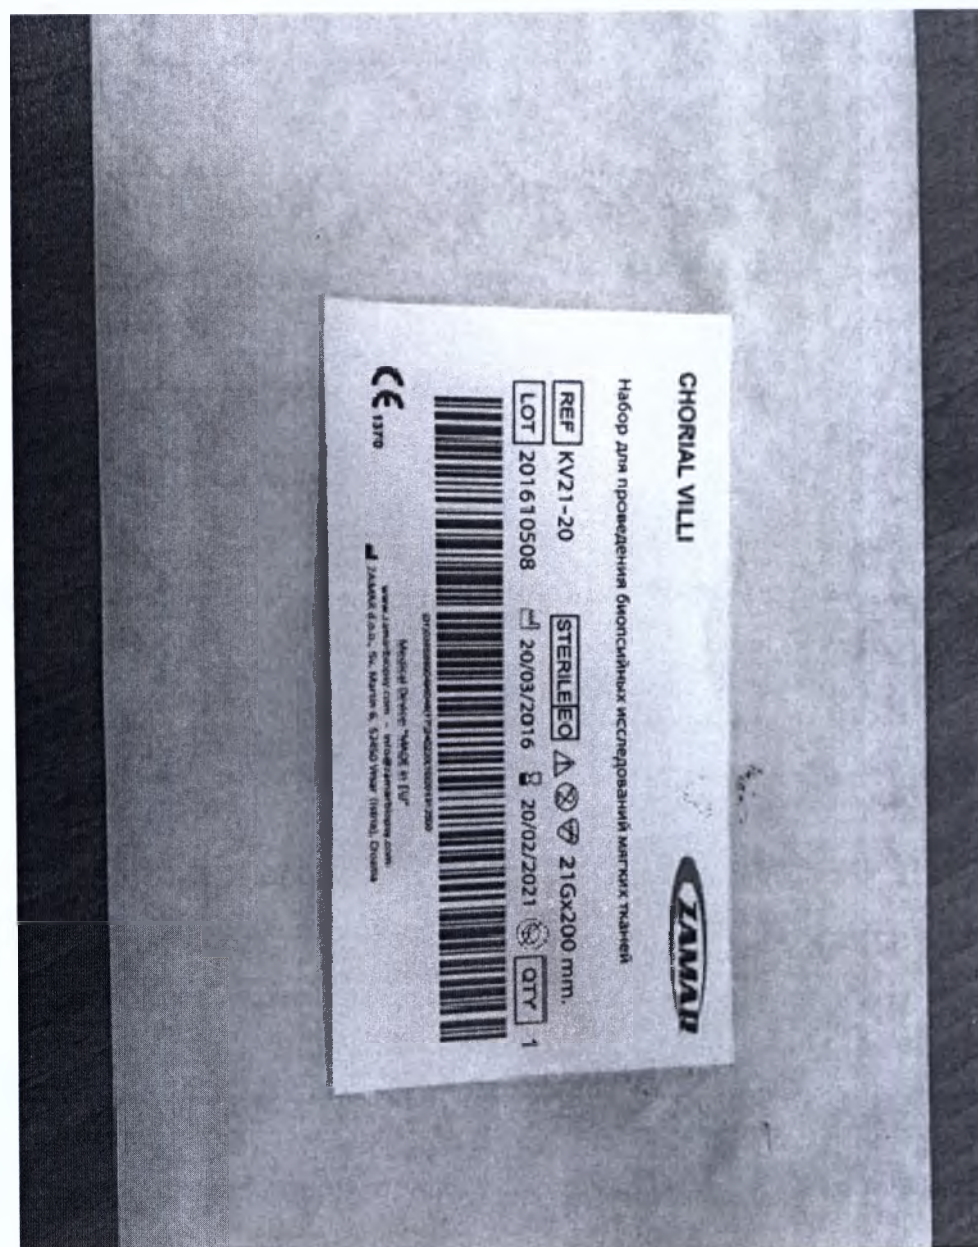


16. Набор **Funiculus Centesis** для проведения биопсийных исследований мягких тканей, с канюлей, диаметром 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), длиной 200 мм

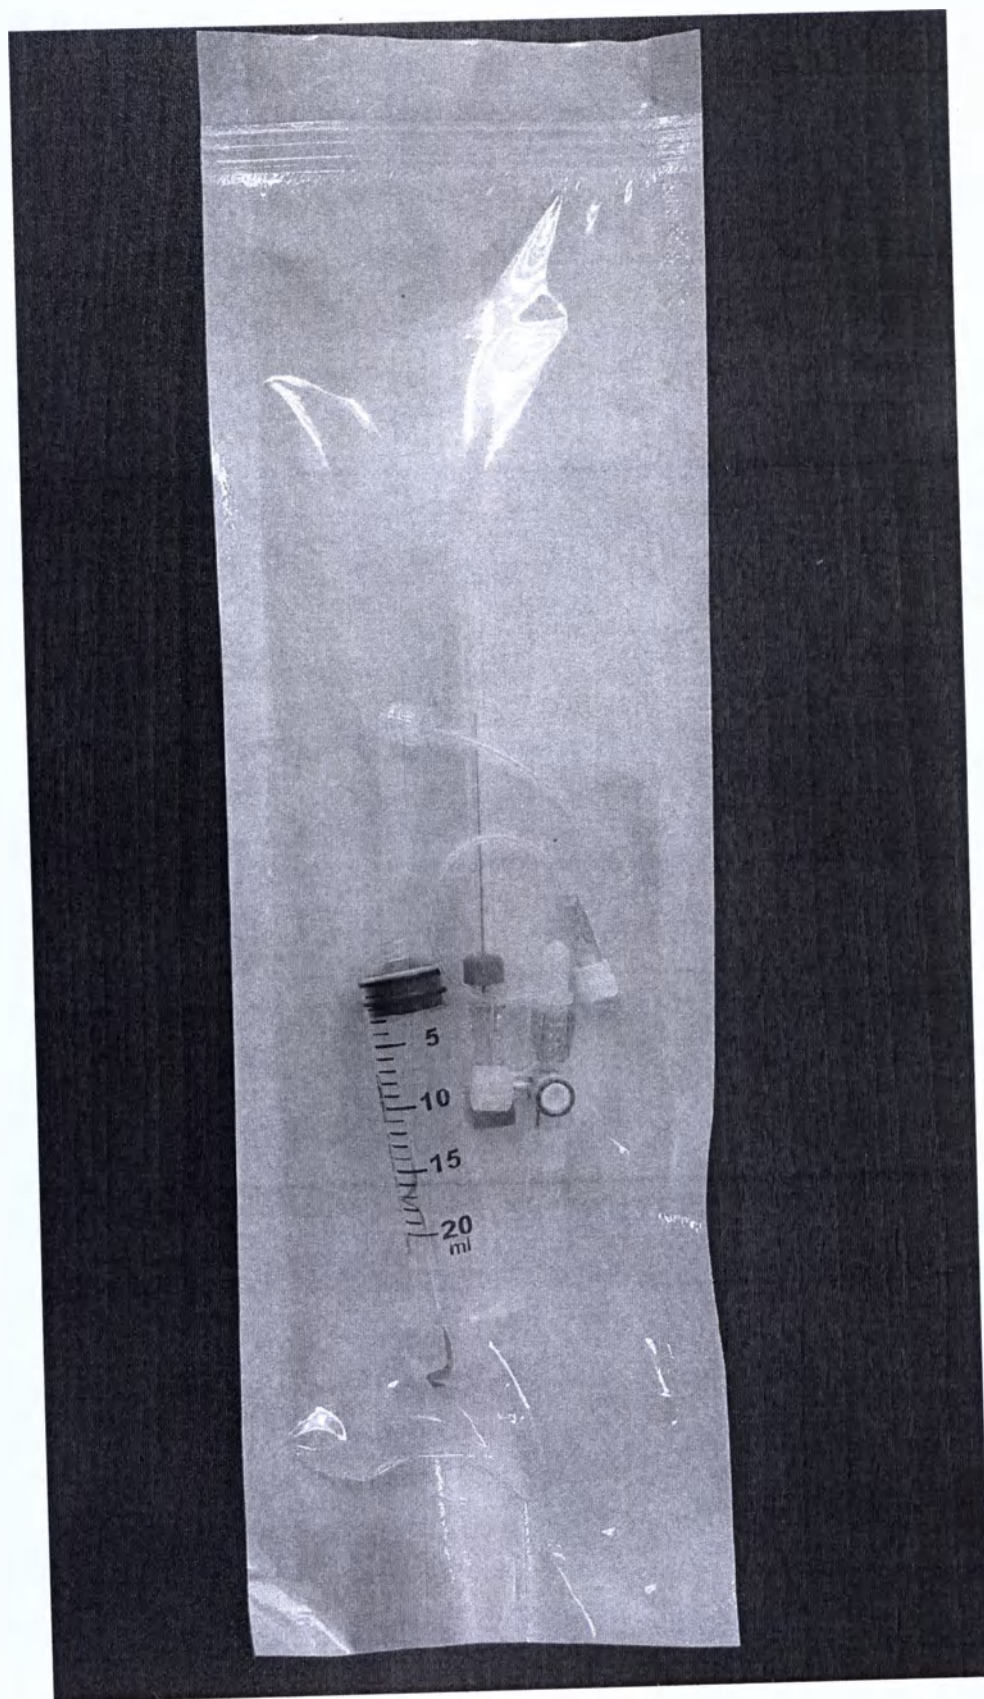


Пример маркировки упаковки набора **Funiculus Centesis** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

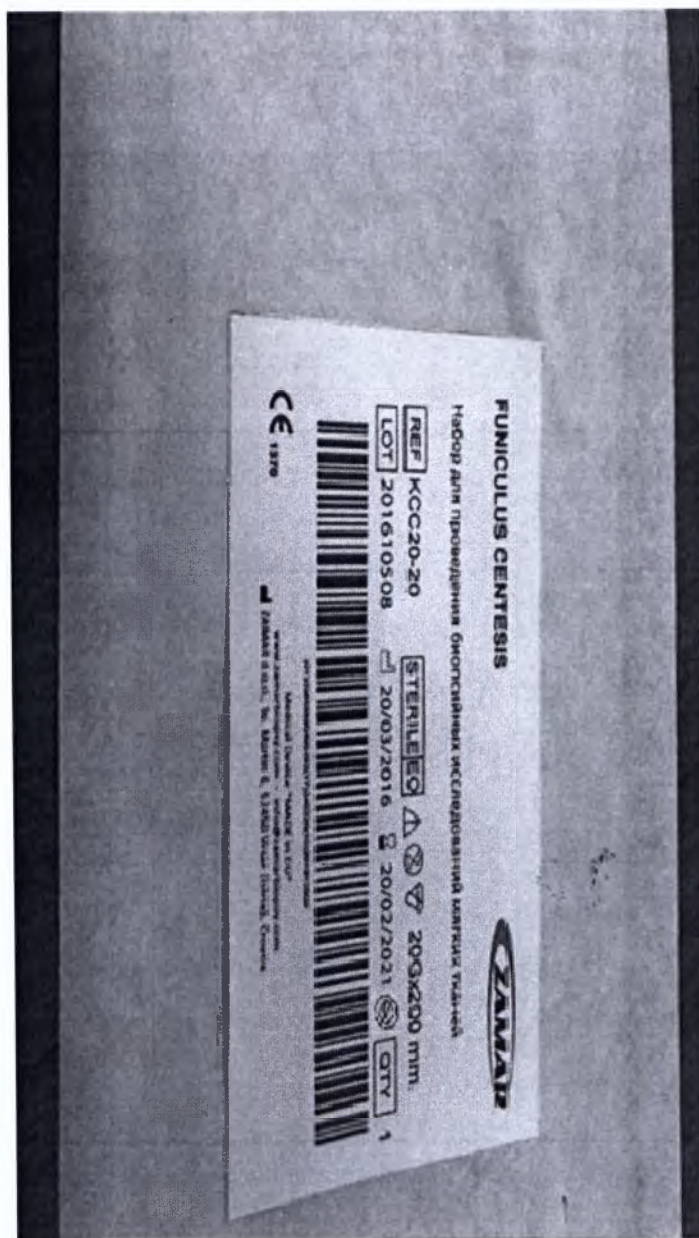


17. Набор **Explora** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), 23G (0,60 мм), 25G (0,51 мм), длиной 50-400 мм, шаг 10 мм

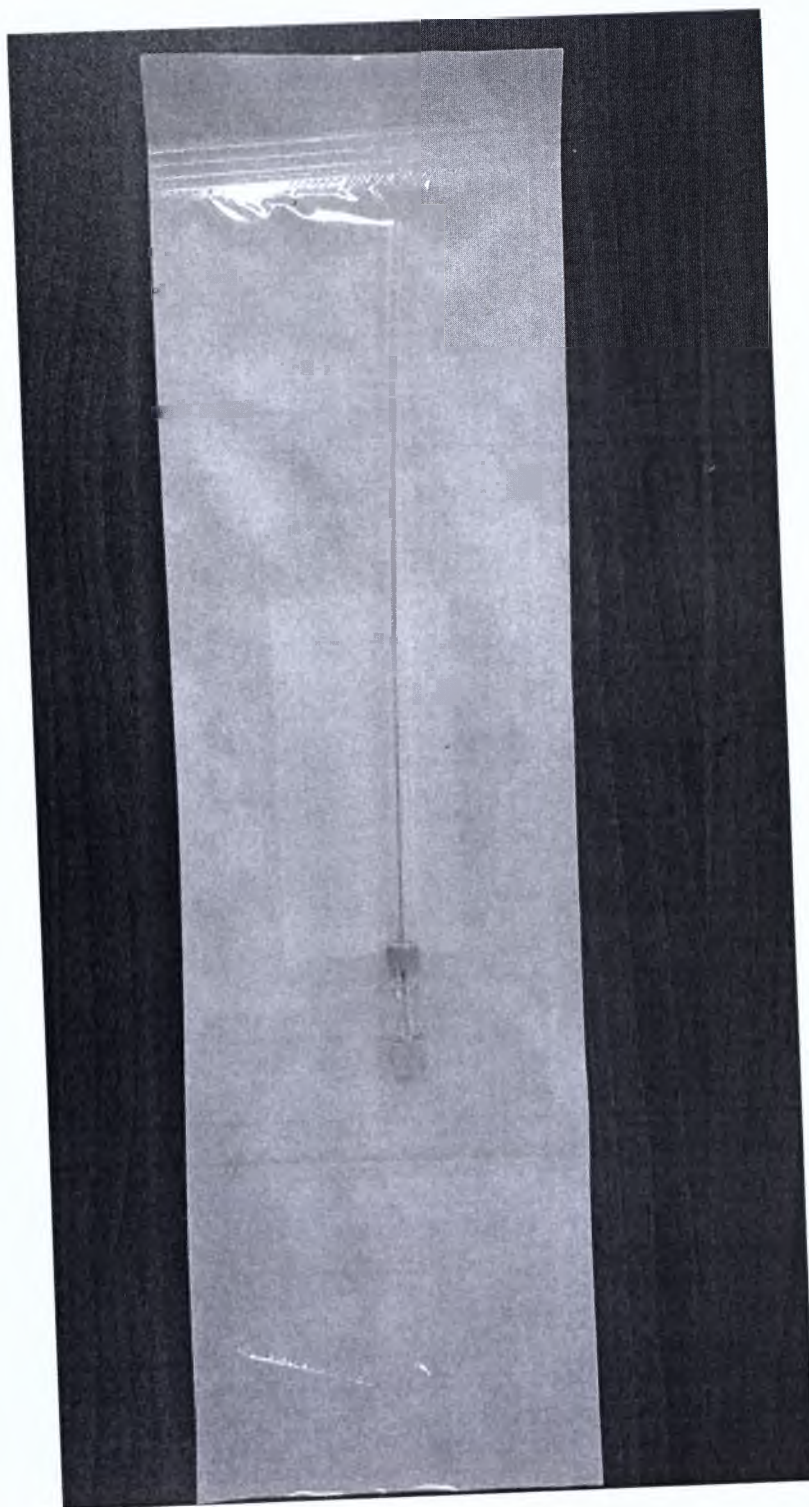


Пример маркировки упаковки набора **Explora** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

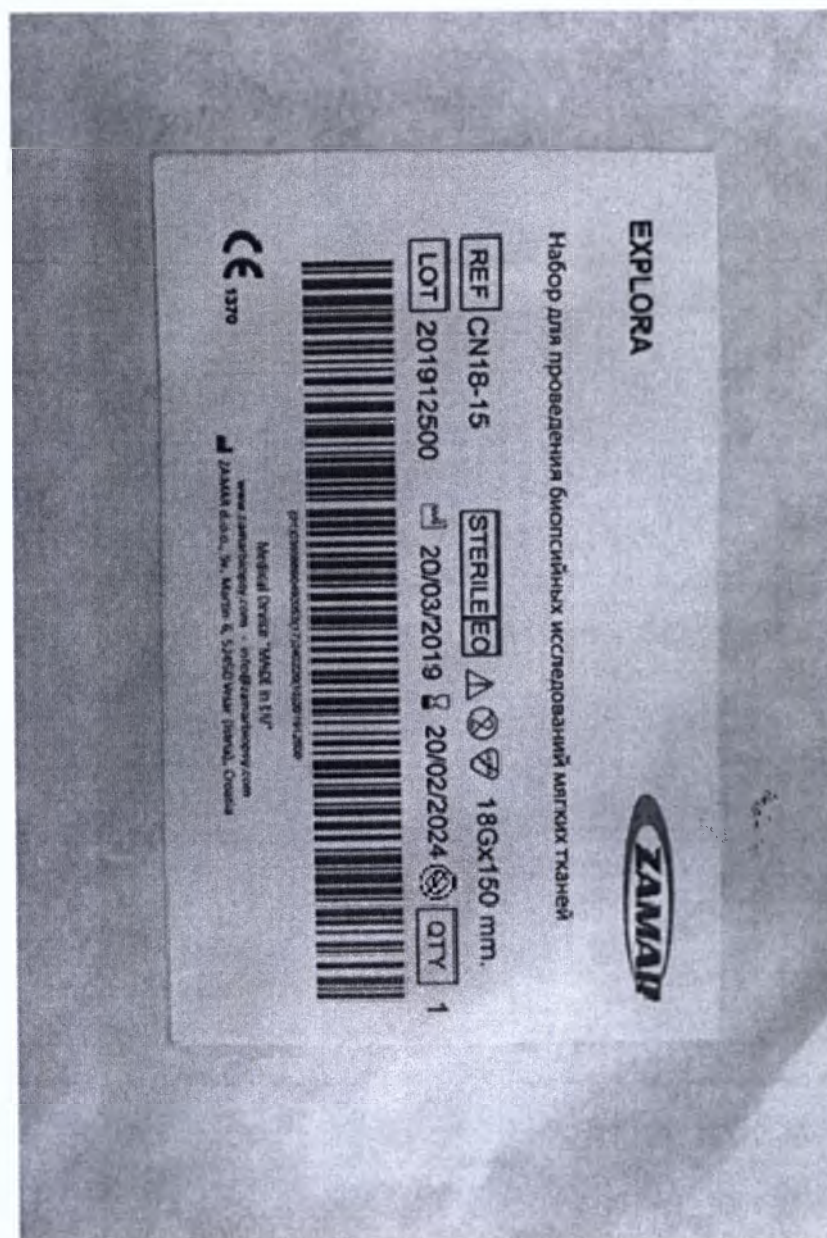


18. Набор **Explora MRI** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), 23G (0,60 мм), 25G (0,51 мм), длиной 50-400 мм, шаг 10 мм

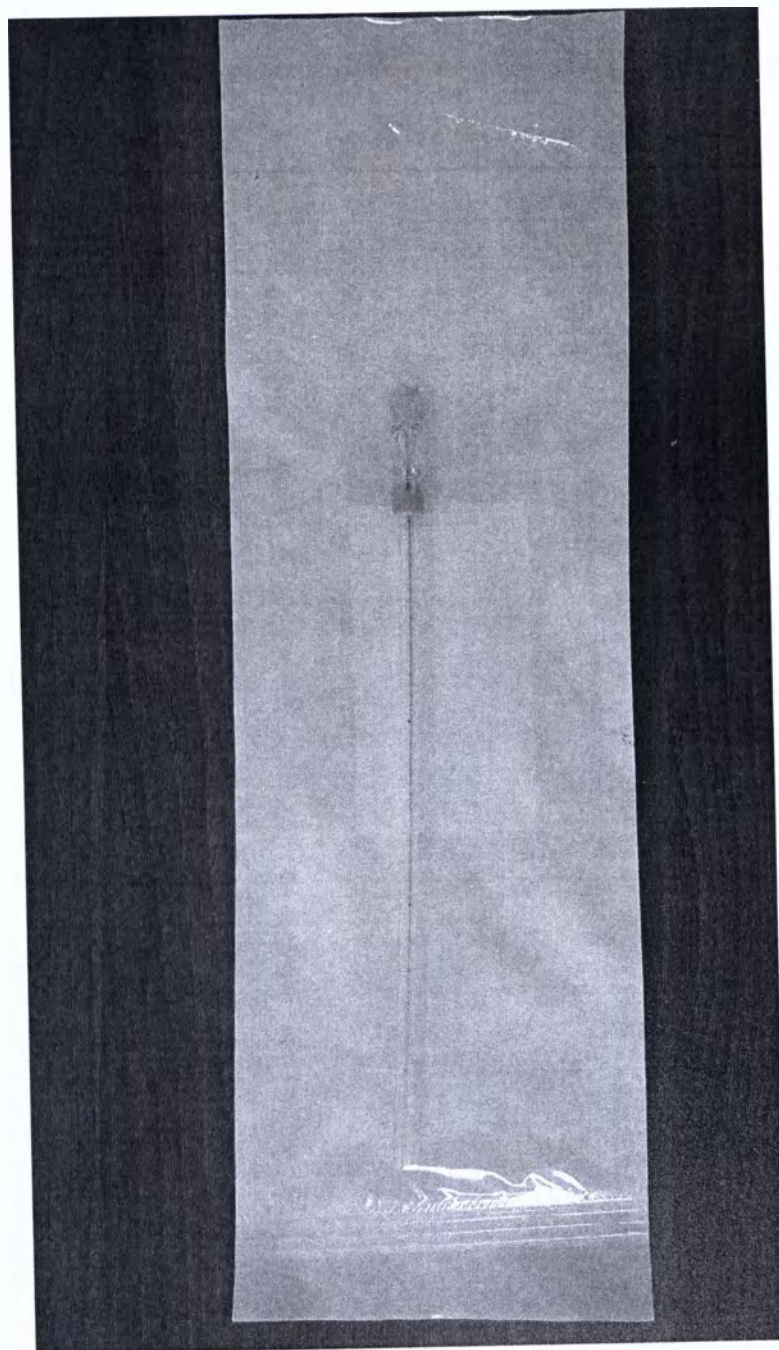


Пример маркировки упаковки набора Explora MRI для проведения биопсийных исследований мягких тканей

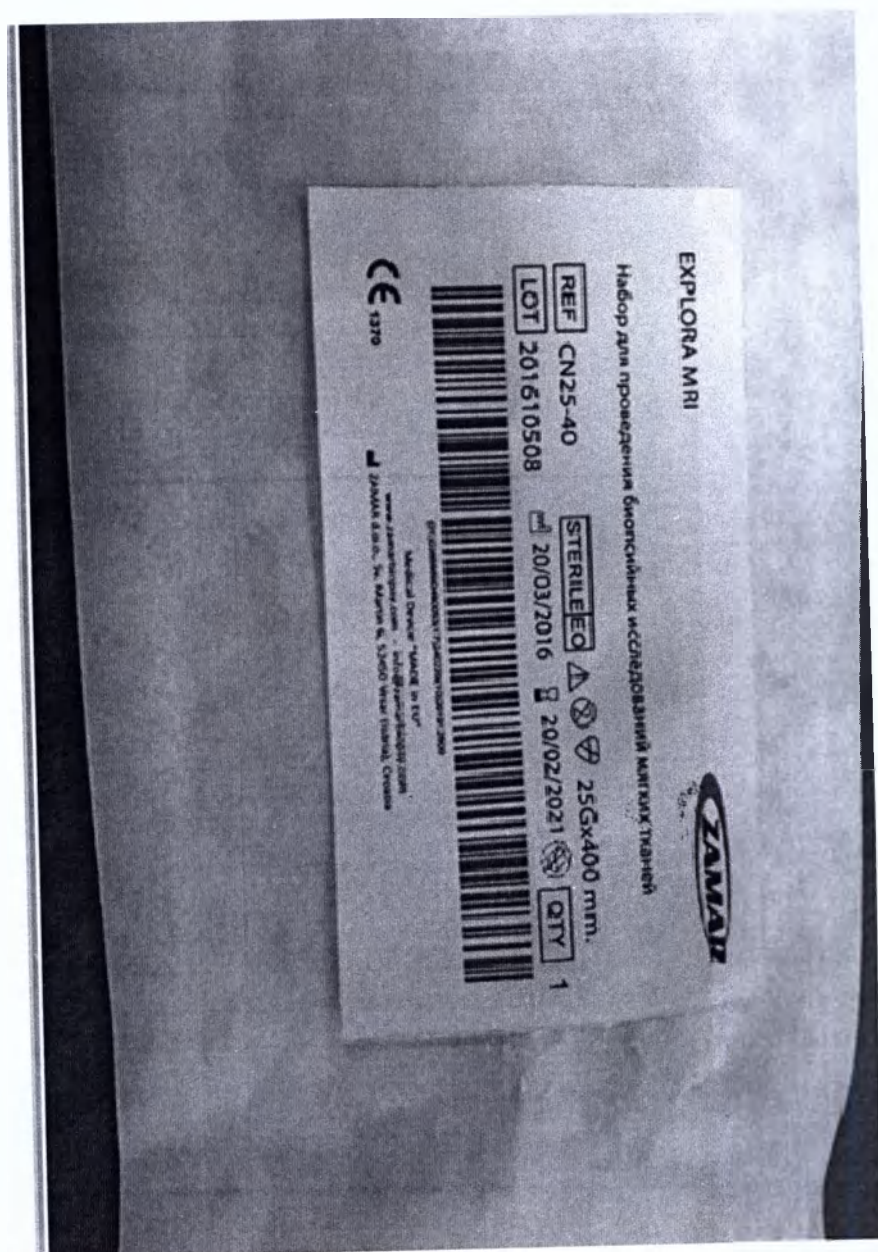


19. Набор **Scout** для проведения биопсийных исследований мягких тканей, с канюлей, диаметром 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), 23G (0,60 мм), 25G (0,51 мм), длиной 50-400 мм, шаг 10 мм

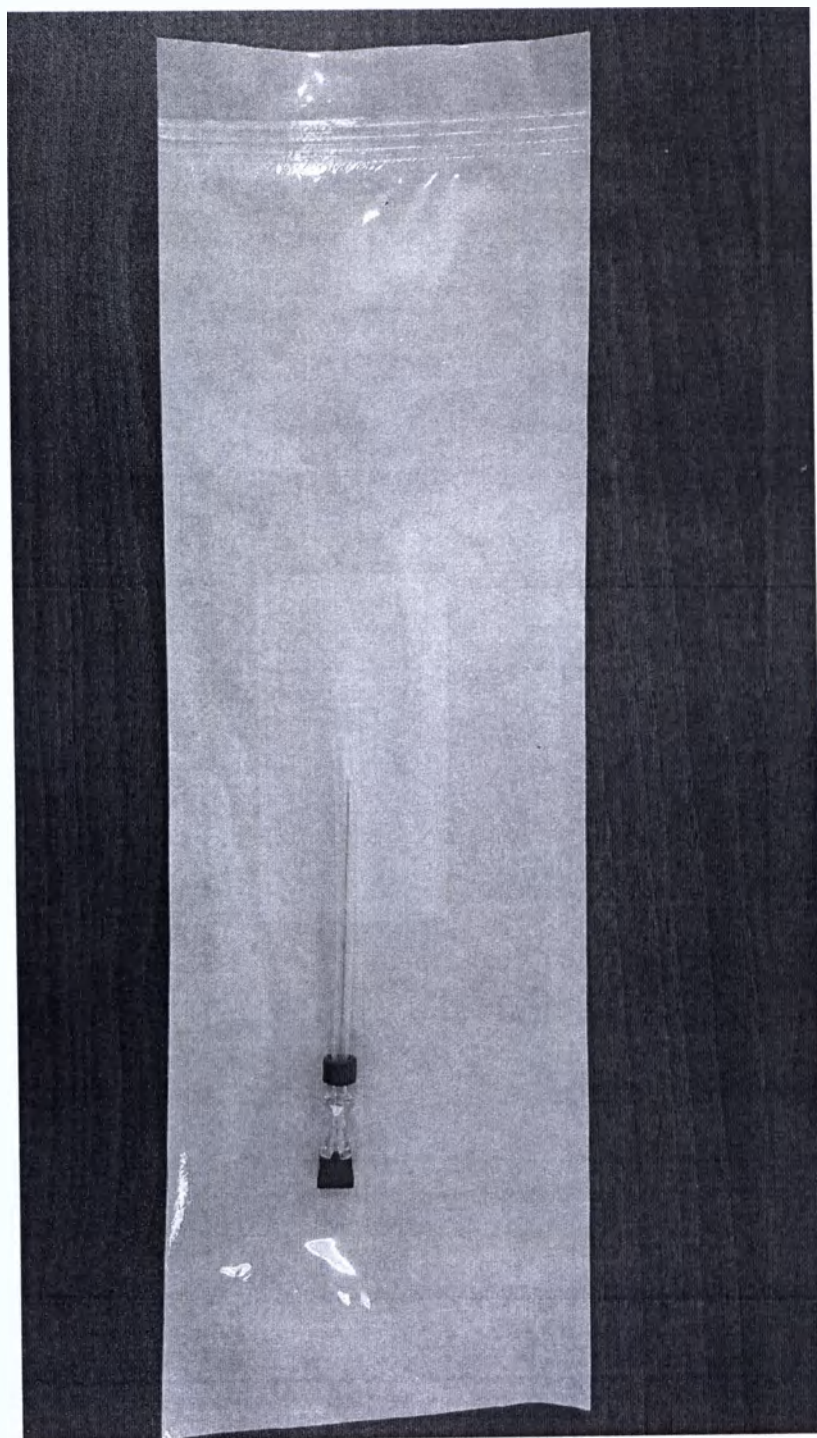


Пример маркировки упаковки набора Scout для проведения биопсийных исследований мягких тканей

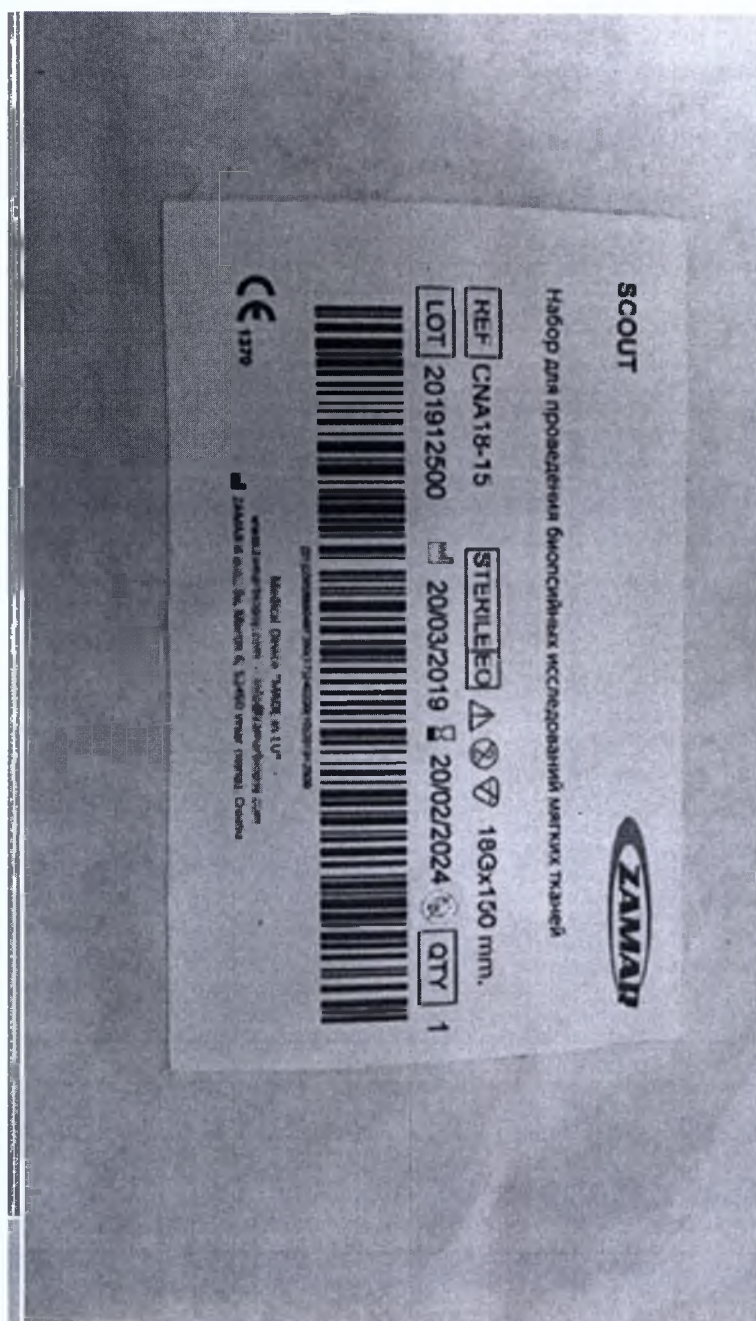

20. Набор **Amnio-centesis** для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей, с канюлей, диаметром 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), 23G (0,60 мм), 25G (0,51 мм), длиной 50 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм, 110 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм, 280 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм

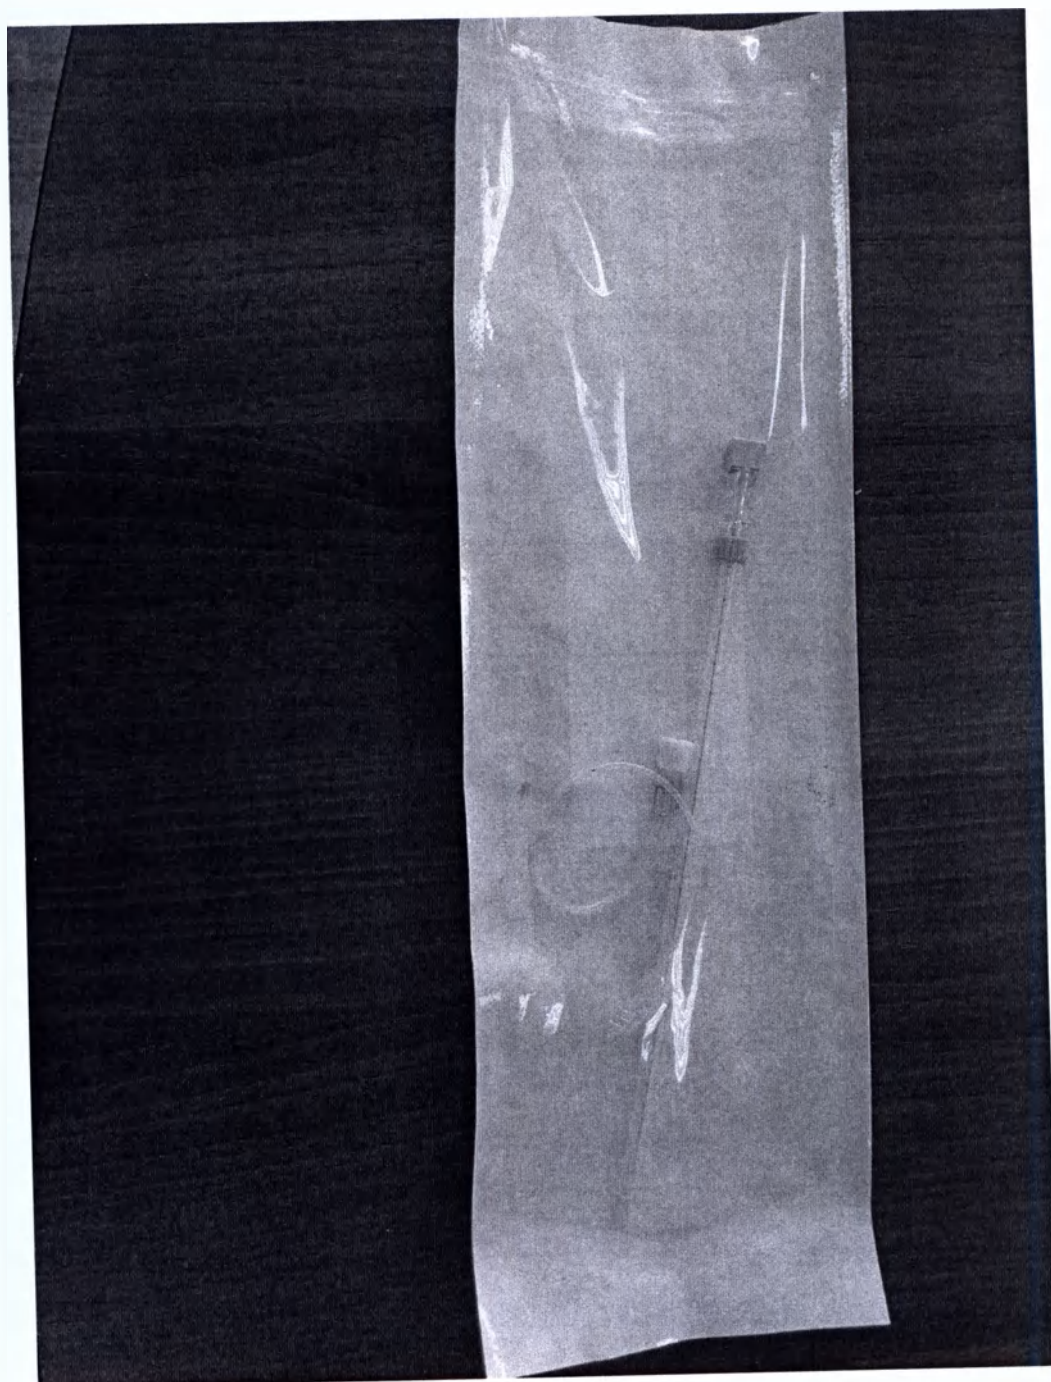


Пример маркировки упаковки набора Amnio-centesis для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей

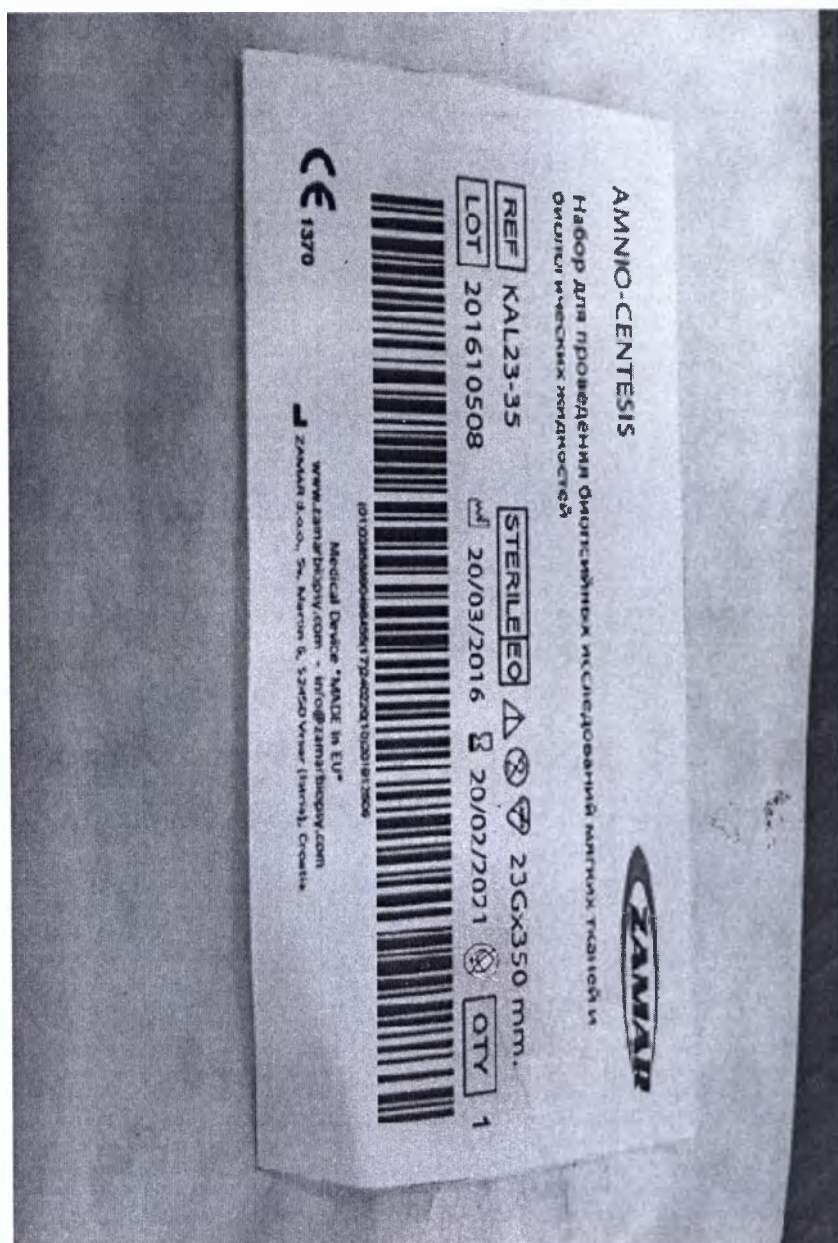


21. Набор **Amnio-centesis KAS** для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей, с канюлей, диаметром 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), 23G (0,60 мм), 25G (0,51 мм), длиной 50 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм, 110 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм, 280 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм



Пример маркировки упаковки набора Amnio-centesis KAS для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей

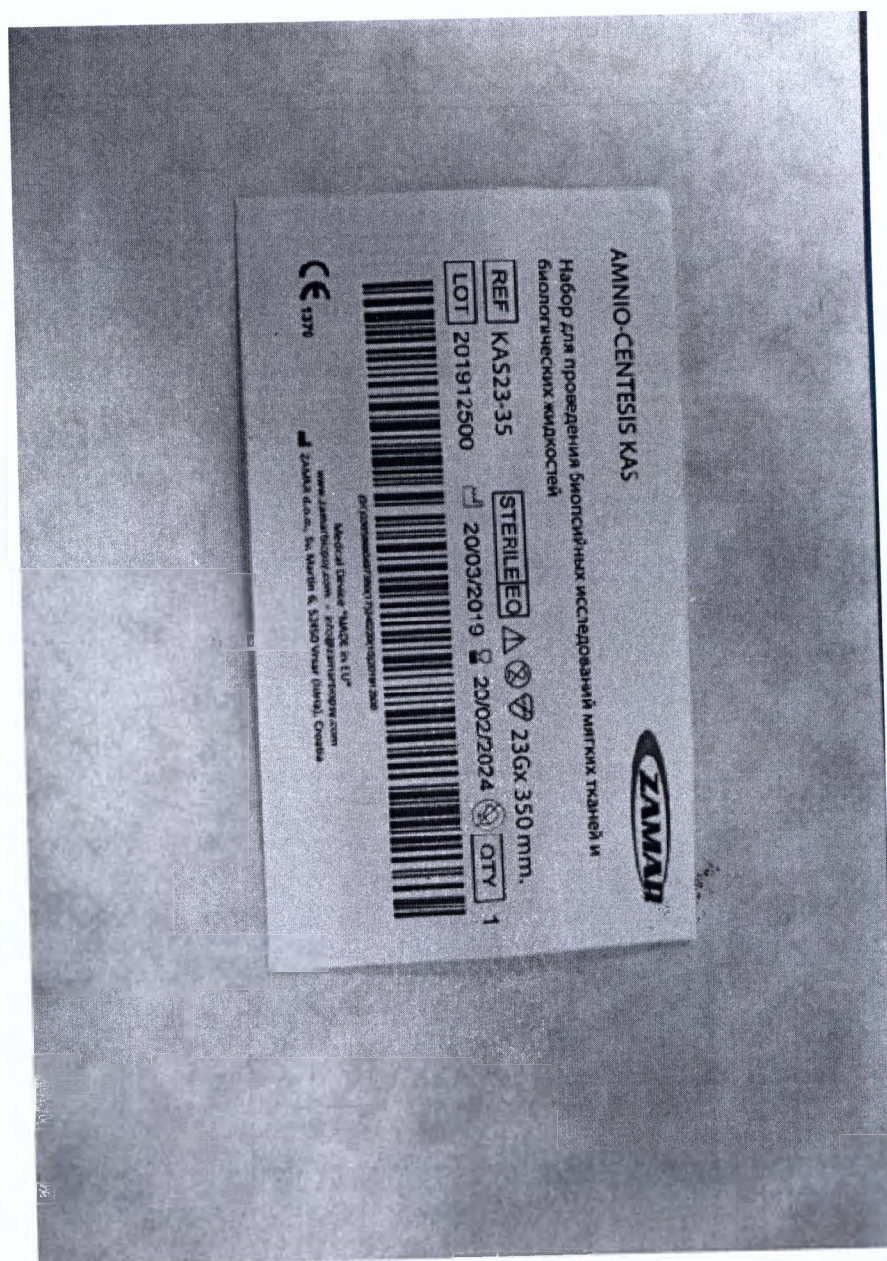

22. Набор **Нерамод** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 15G (1,80 мм), 16G (1,60 мм), 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), длиной 40 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм

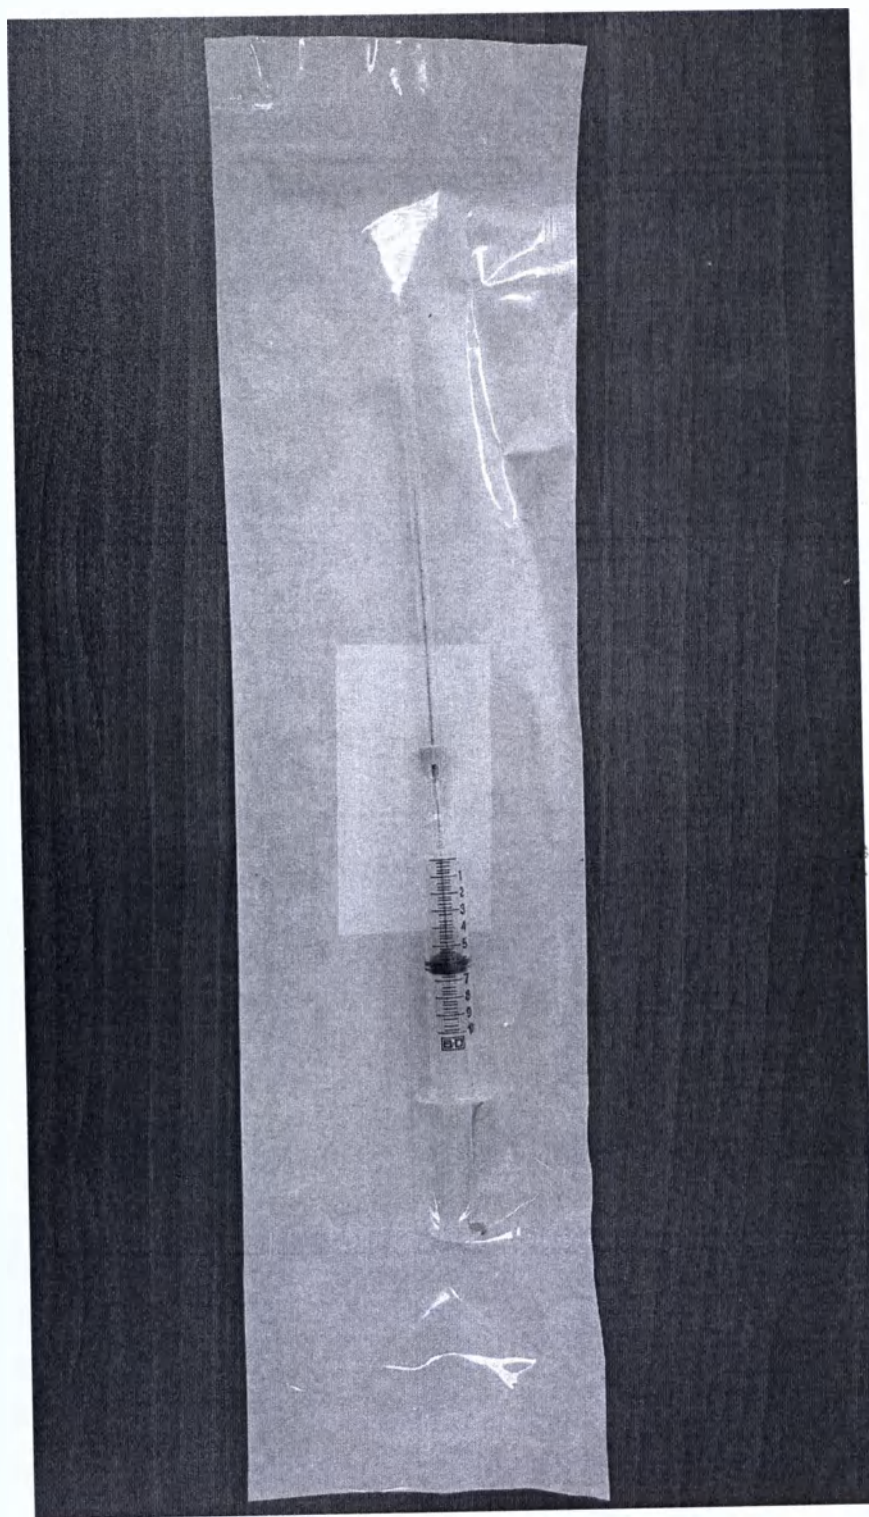

НЕРАМОД

Набор для проведения биопсийных исследований маточных тканей

REF HM15-04

STERILE EO

20/03/2016

20/02/2021

LOT 201610508

15Gx40 mm.

QTY 1

CE 1370


Medical Device "MADE IN EU"

www.danarbio.ru.com info@danarbio.ru.com

ZAMAD d.o.o. 34. Martin B. 5250 Vinar (Israel), Croatia

ГОСТ ИСО 13485:2017 (ISO 13485:2016)

23. Набор **Нерпатеk** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 16G (1,60 мм), 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), 19G (1,1 мм), 20G (0,9 мм), 21G (0,82 мм), 22G (0,7 мм), длиной 40 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм

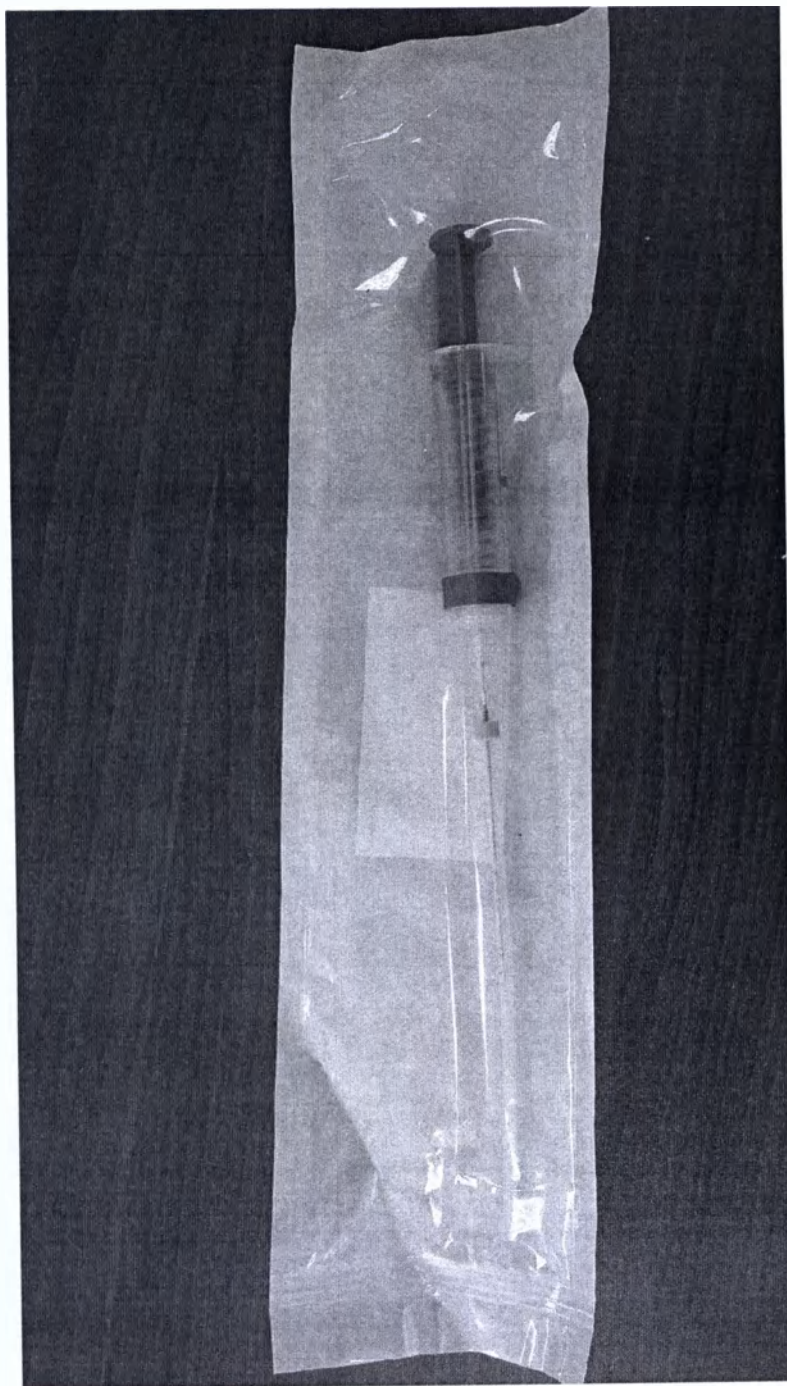

НЕПАТЕК

Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей

REF HS22-20
LOT 201610508

STERILE EO
20/03/2016 20/02/2021 QTY 1

22GX200 мм.


CE 1370

ЗАО «ИМАР»
г. Москва, ул. Вавилова д. 19, стр. 1


Медицинский Центр "ИМАР" в ЕСП
www.imarlab.ru
info@imarlab.ru

IMAR


24. Набор **Hepasys** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 15G (1,80 мм), 16G (1,60 мм), 17G (1,47 мм), 18G (1,27 мм), длиной 70 мм, 90 мм, 150 мм

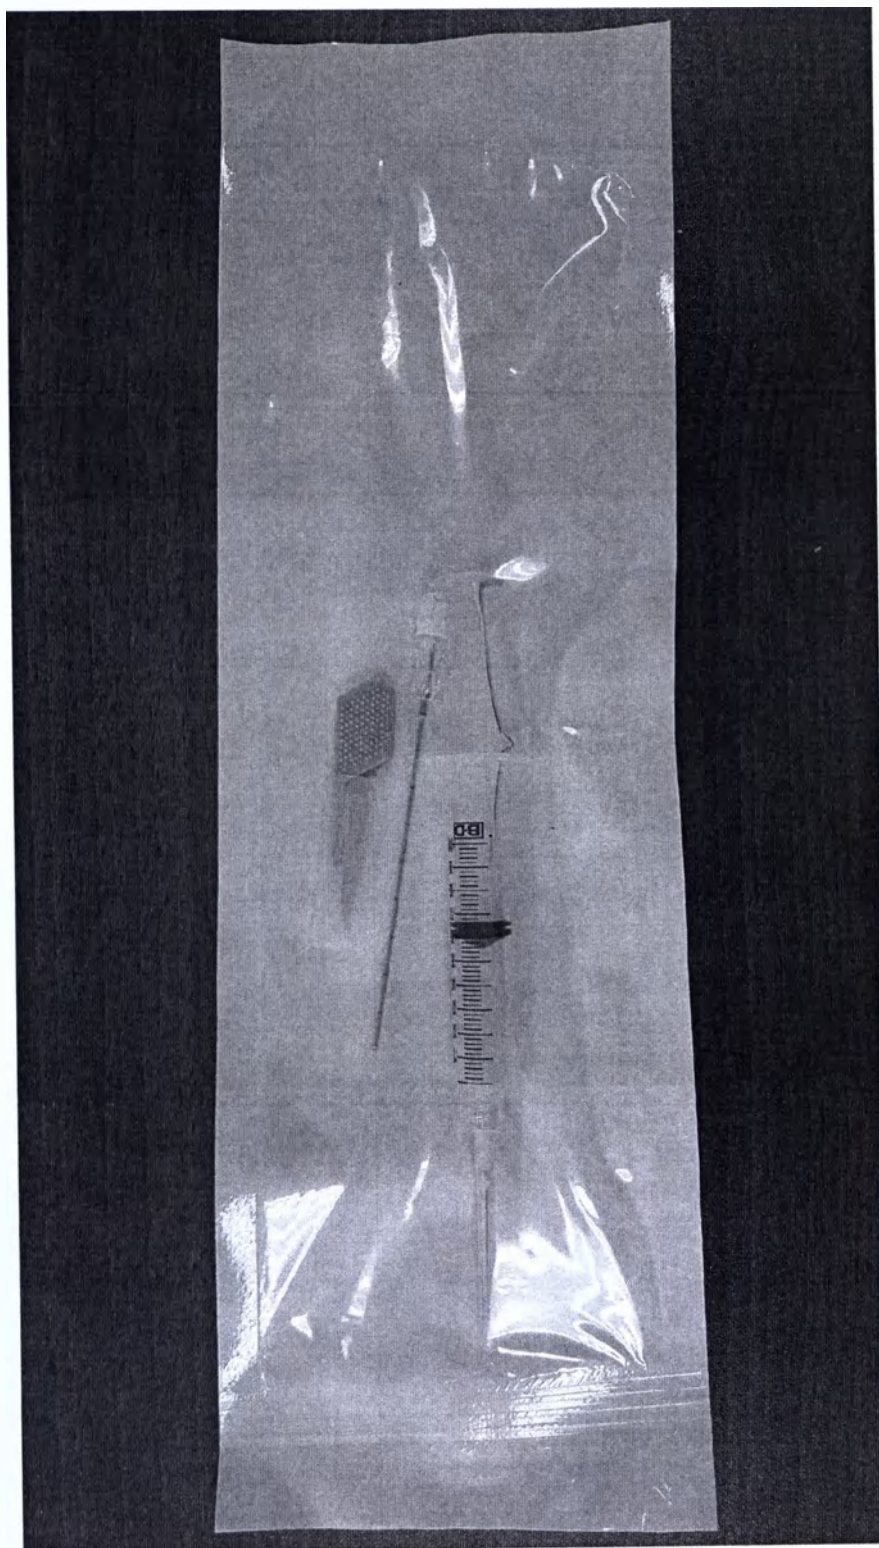


Пример маркировки упаковки набора **Hepasys** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

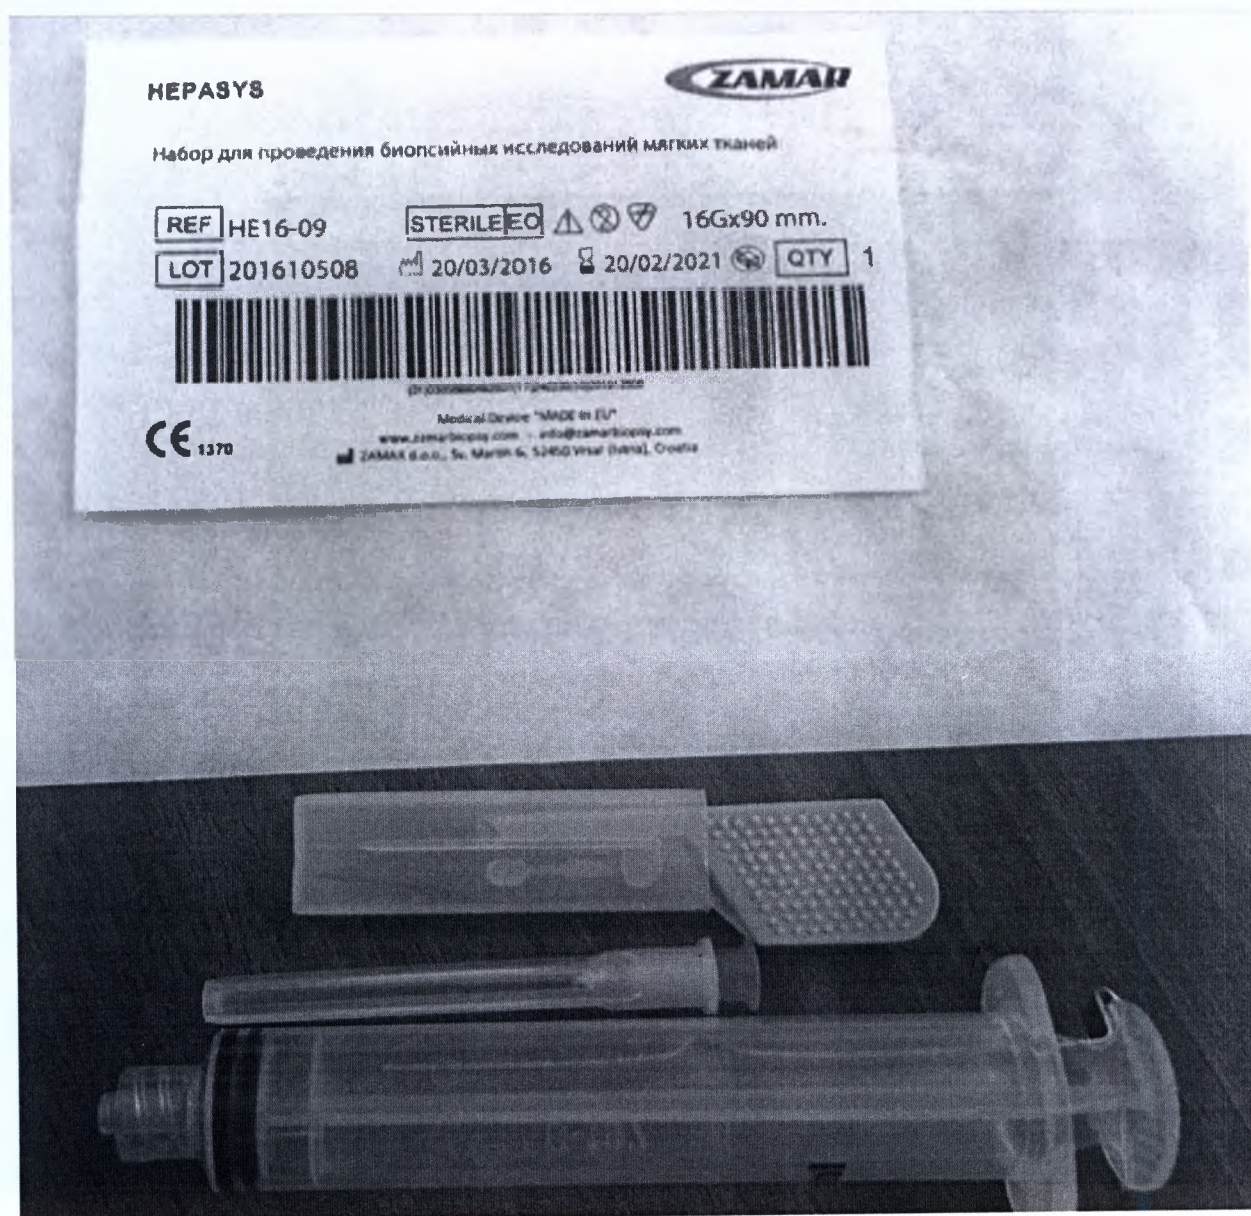


25. Набор **Westcott** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), 22G (0,70 мм), длиной 90 - 200 мм, шаг 10 мм

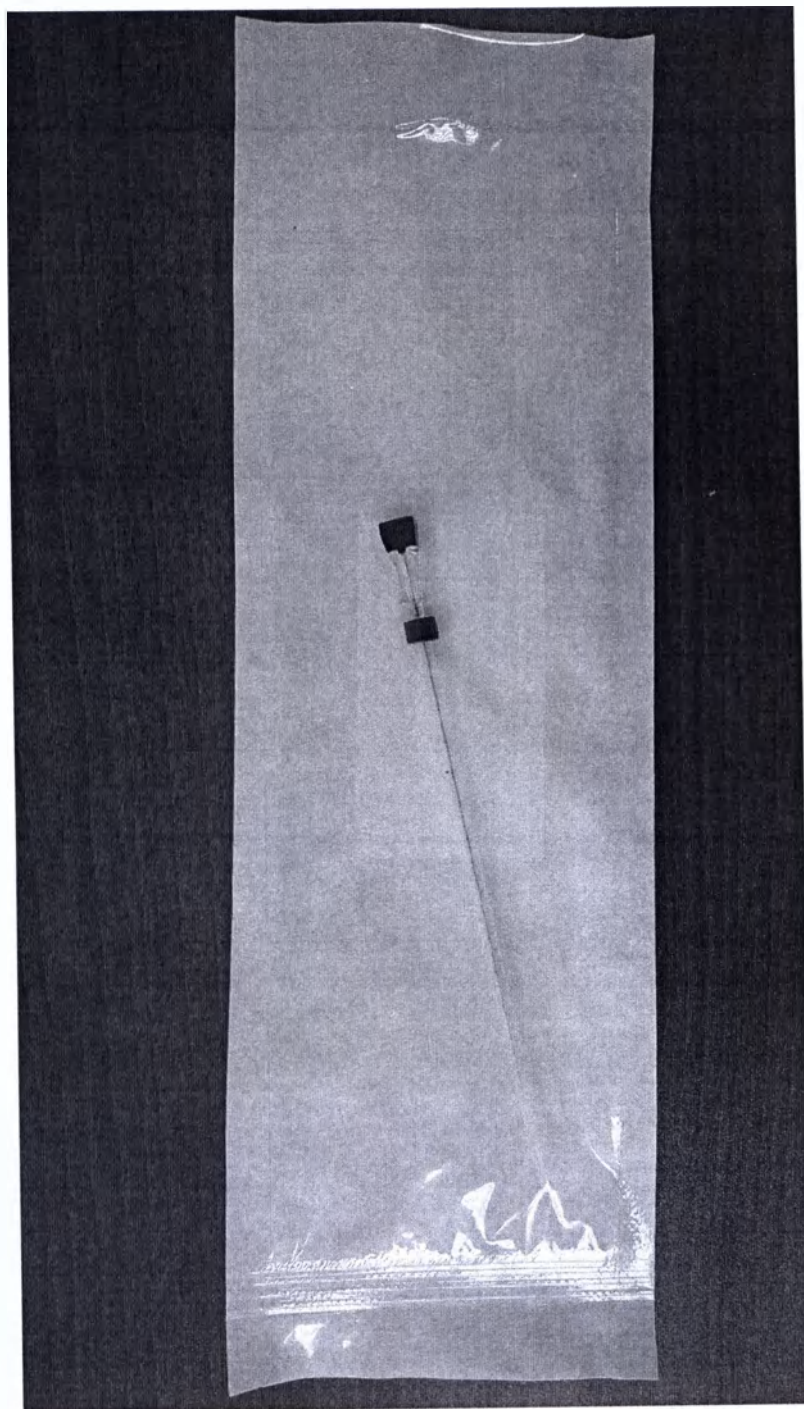


Пример маркировки упаковки набора **Westcott** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

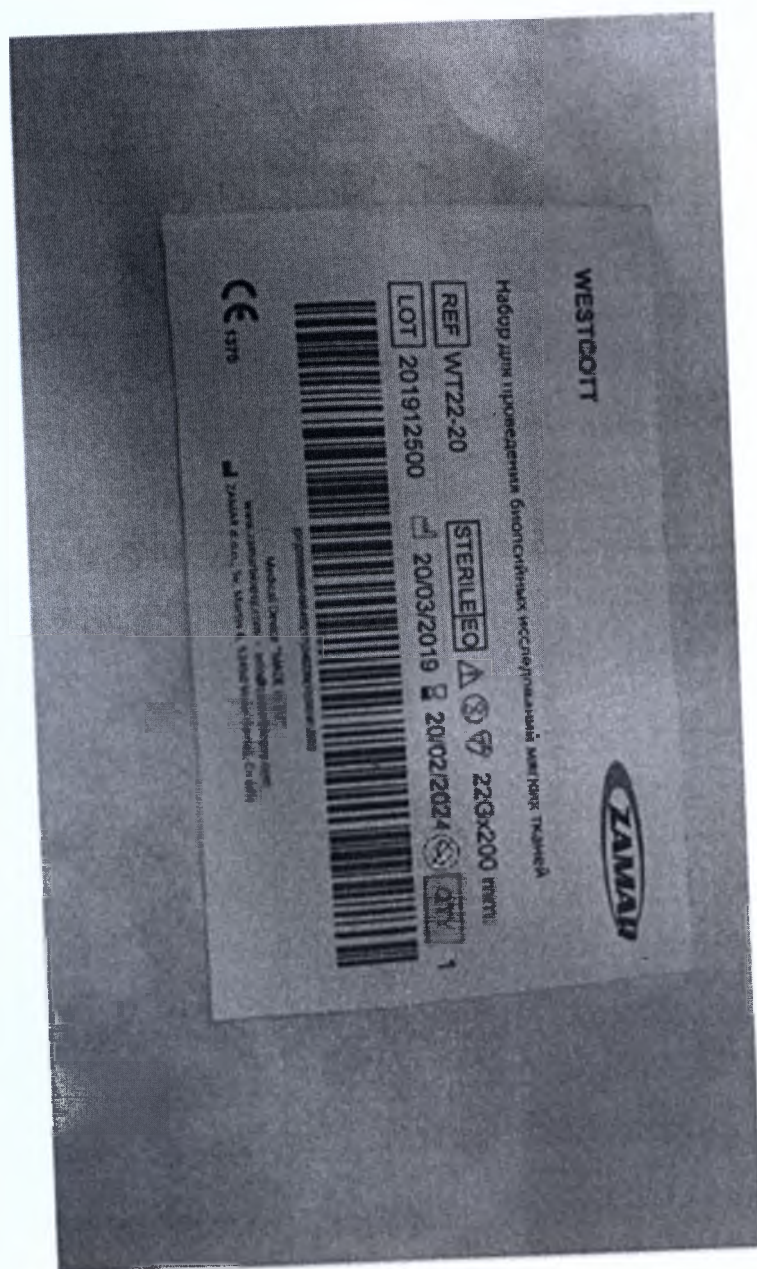


26. Набор **Franseen** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), 22G (0,70 мм), длиной 90 - 200 мм, шаг 10 мм

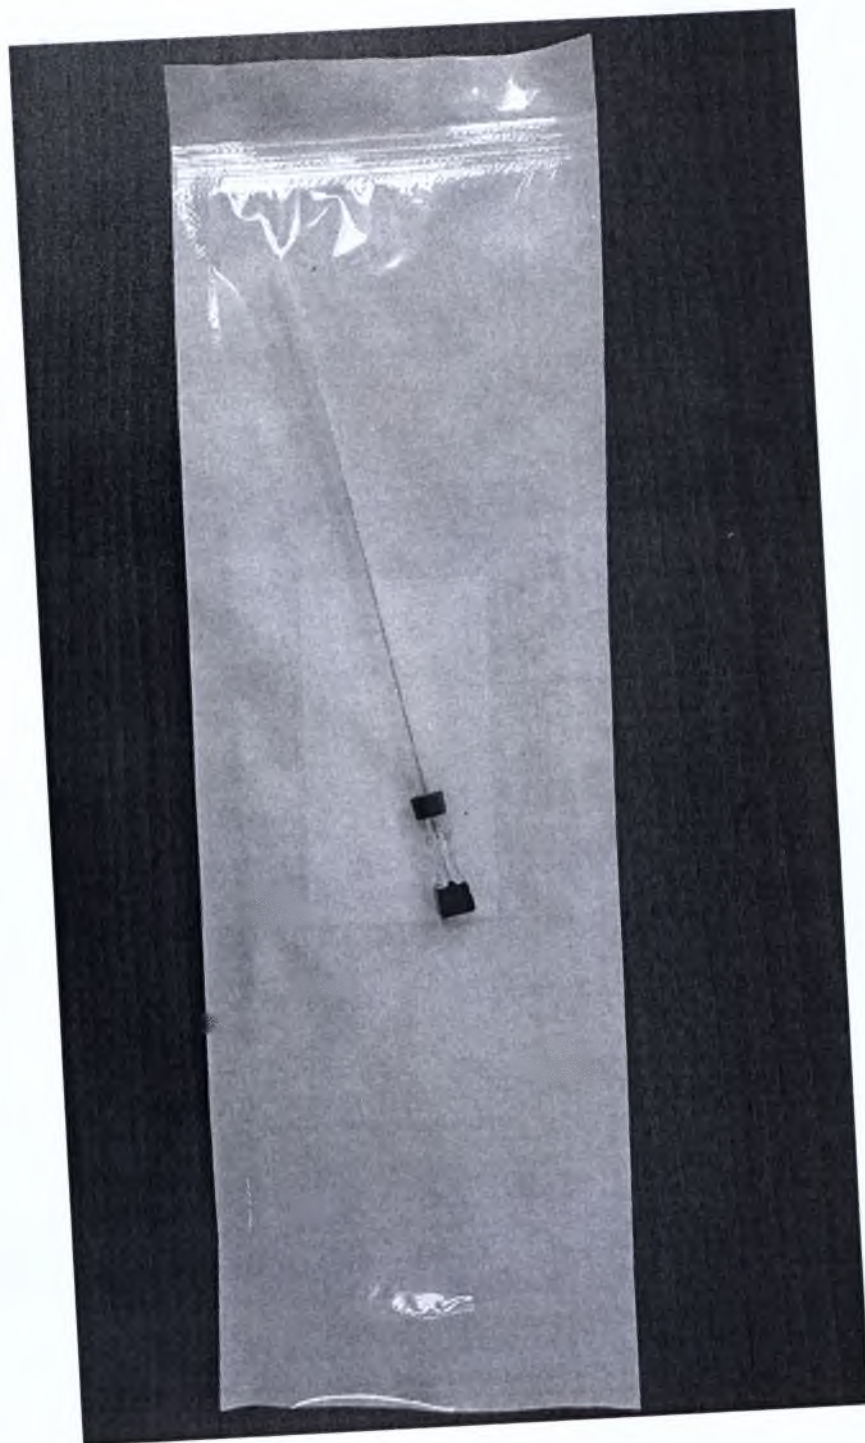


Пример маркировки упаковки набора **Franseen** для проведения биопсийных исследований мягких тканей

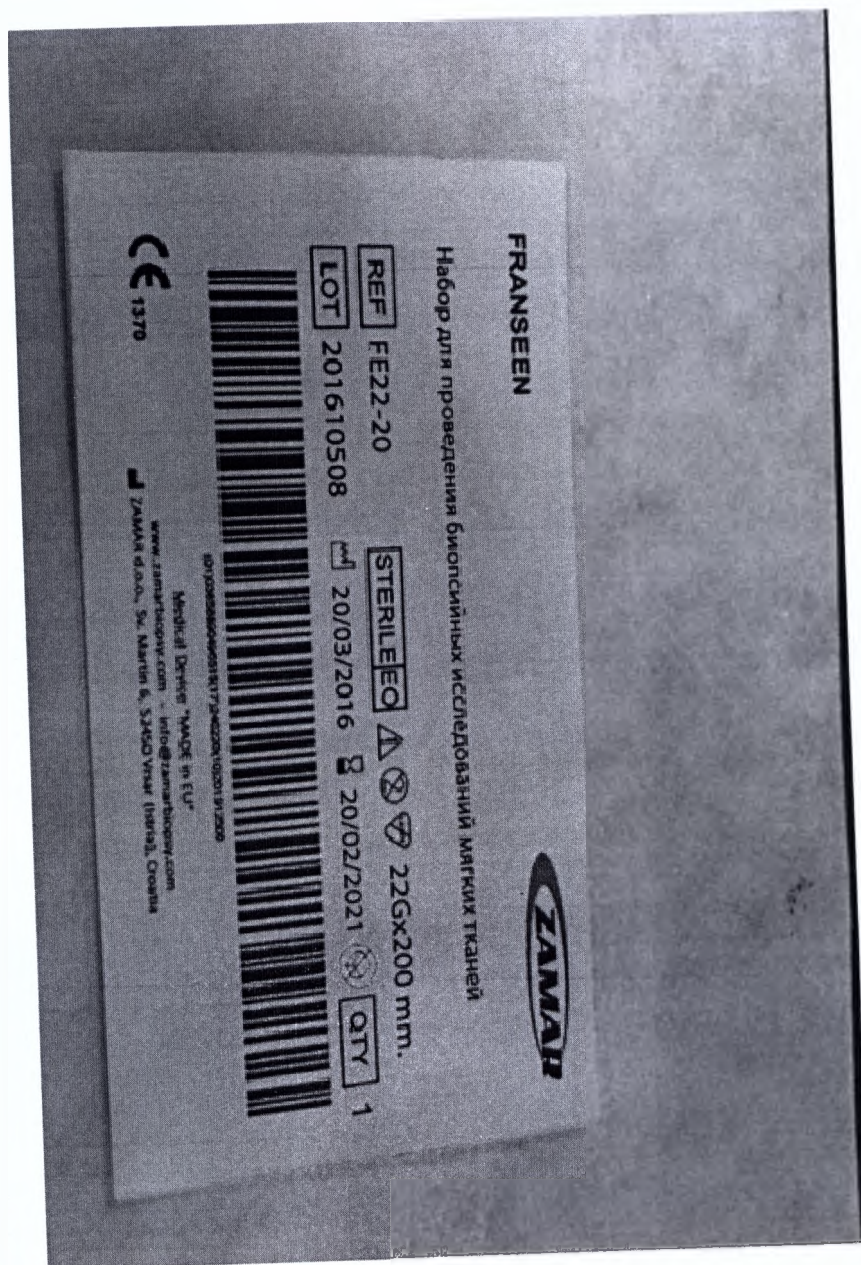


27. Набор Easyloc для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), 21G (0,82 мм), длиной 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм

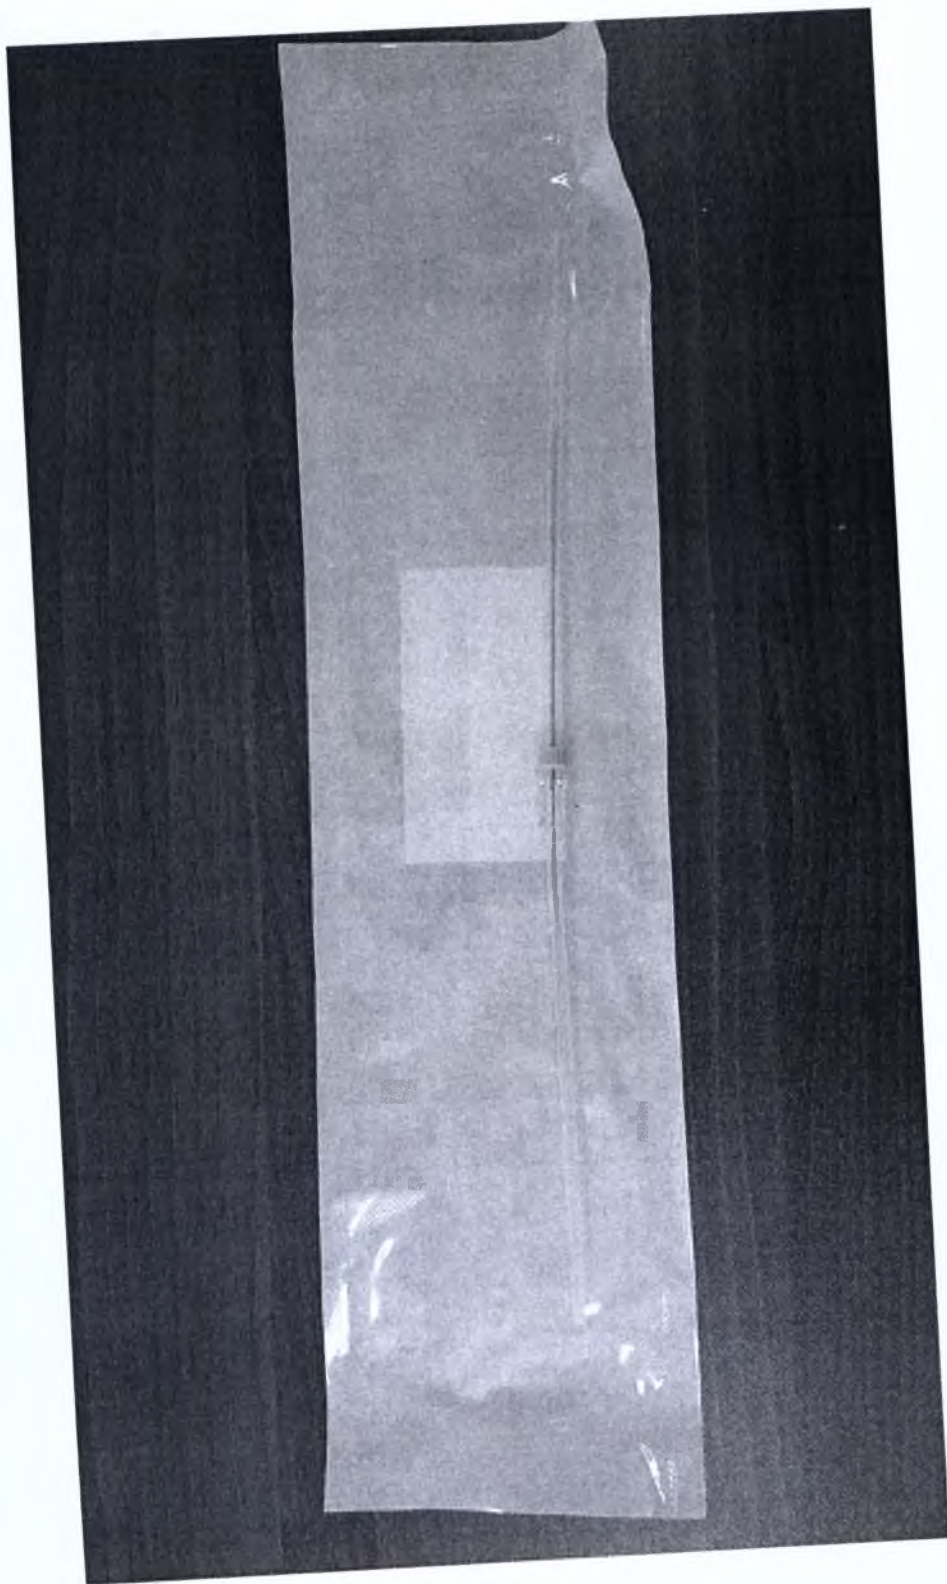

Пример маркировки упаковки набора Easyloc для проведения биопсийных исследований мягких тканей

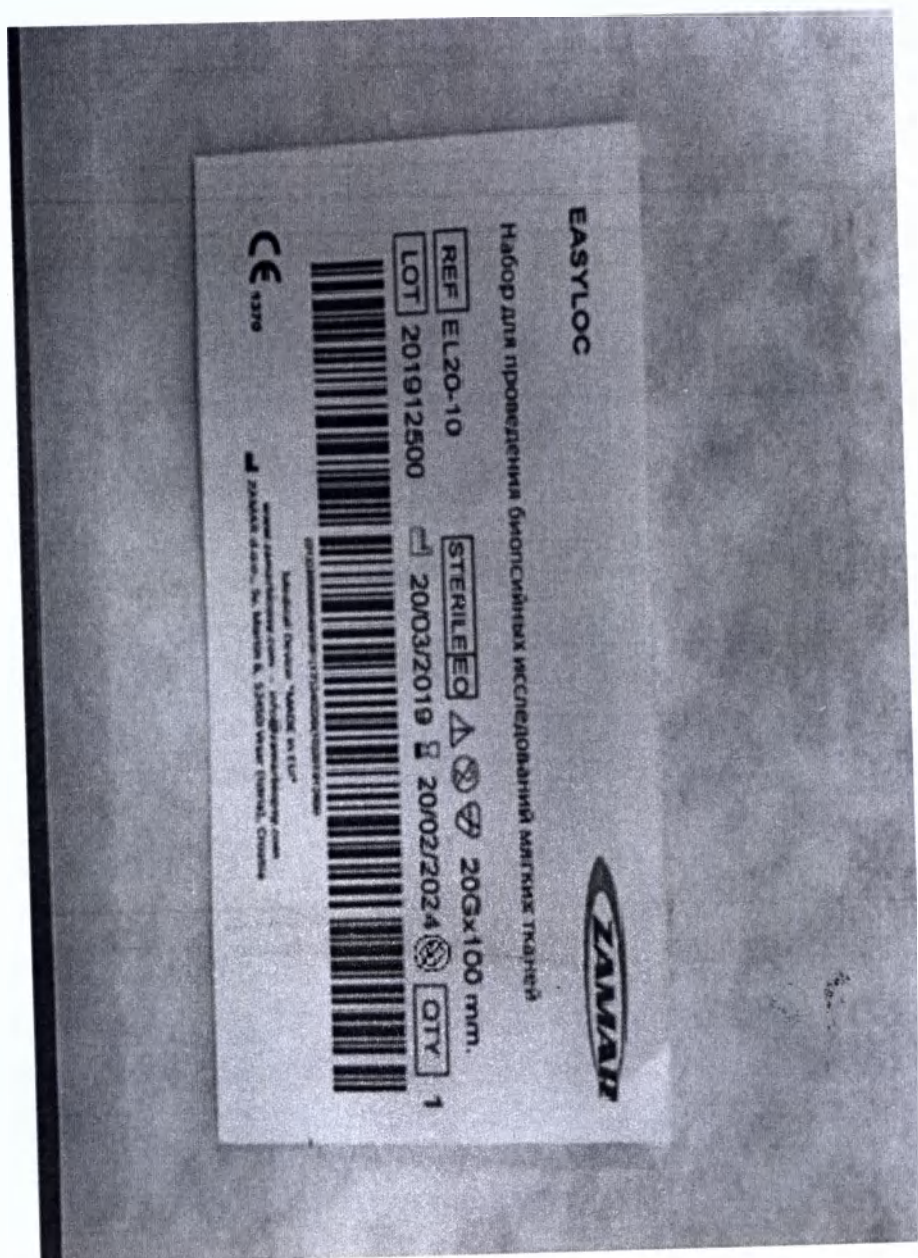

28. Набор **Easyloc ELX** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), 21G (0,82 мм), длиной 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм

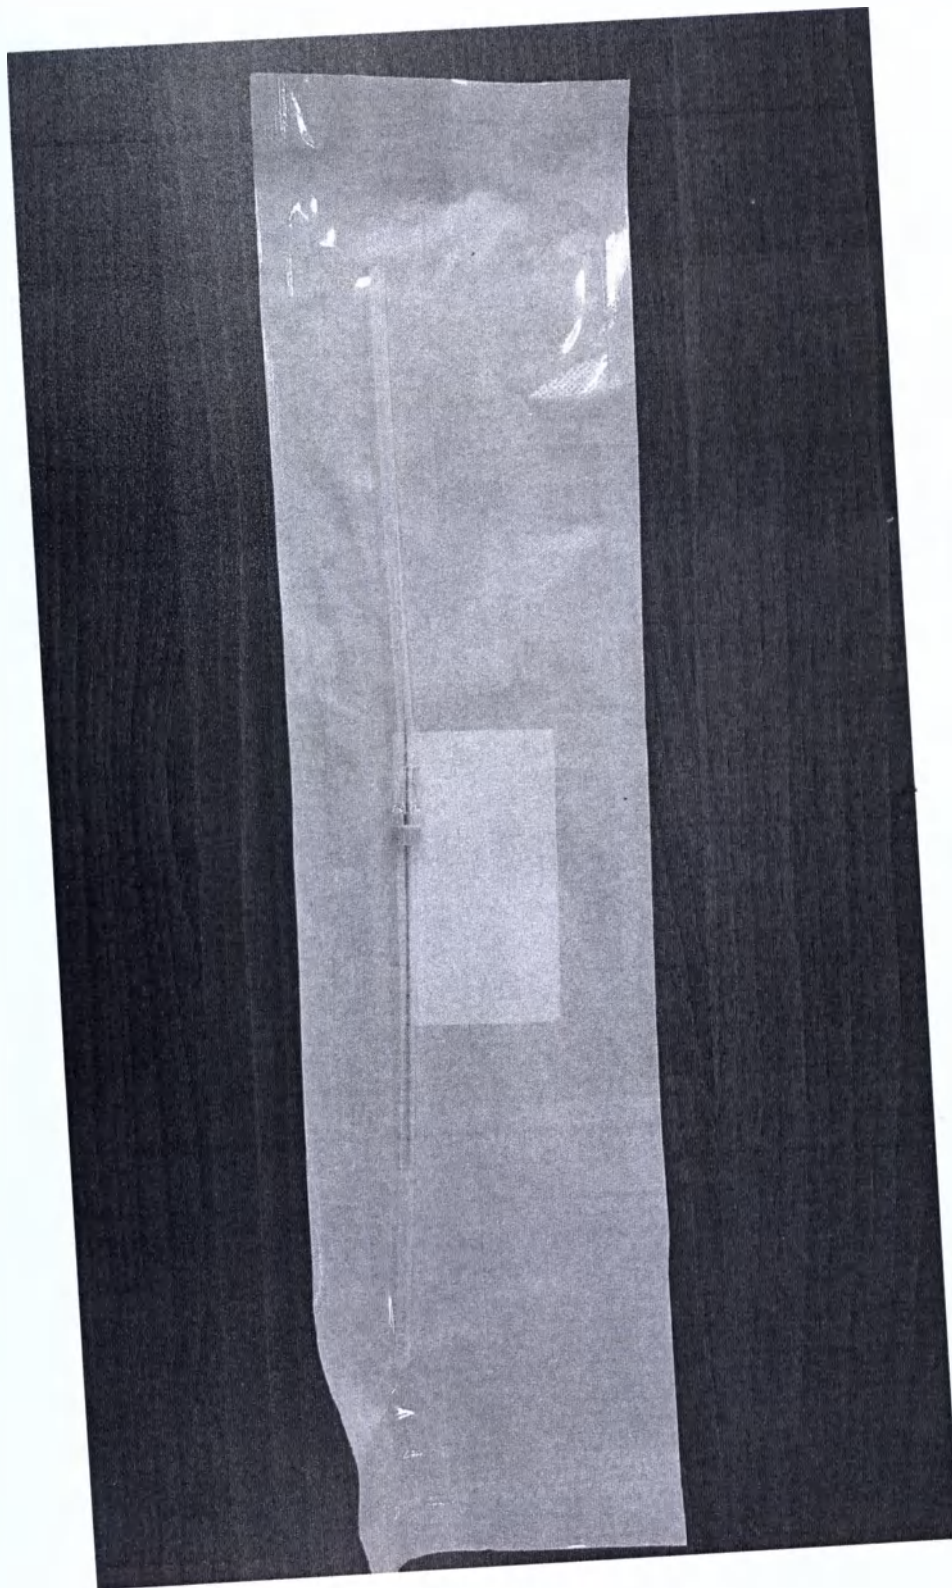

EASYLOC™ ELX™

Набор для приготовления бионсцириных висцеролизанов матрикс 17411004

REF ELX18-10

STERILE EO  18Gx100 mm.

LOT 201610508

20/03/2016 20/02/2021  QTY 1






CE 1370

 Завод д.д.д. № 14000000000000000000

Матрица (матрикс) "EASYLOC™ ELX™"
Стерилизована методом окислительного газа
Срок годности 24 мес. со дня изготовления

29. Набор Easyloc «REP» для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 18G (1,27 мм), 20G (0,90 мм), 21G (0,82 мм), длиной 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм

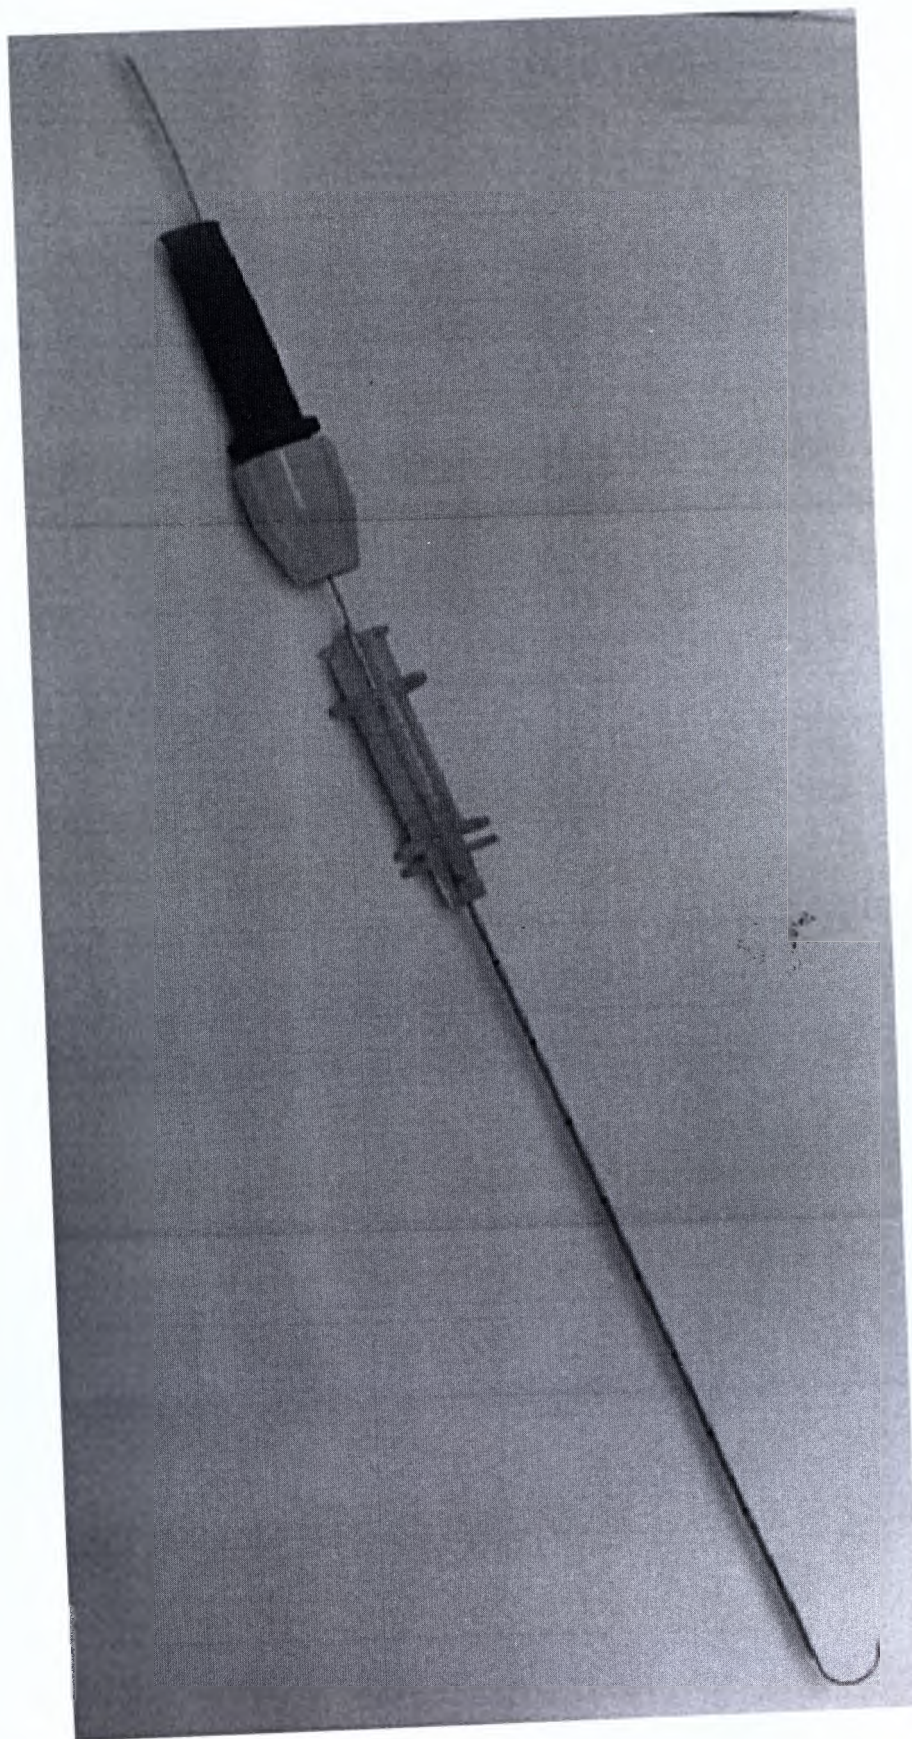

EASYLOC "REP"

Набор для проведения бытовых медицинских исследований

ZAMAR

REF ELR20-10
LOT 201912600

STERILE EO Δ ⊗ ∇ 20GX100 мм.

EXP 20/03/2019 □ 20/02/2024 Ⓢ QTY 1

Barcode


Импортёр в РФ:
ООО «Замар»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18/19 стр. 1
Тел.: +7 (495) 777-7777

CE 5370


30. Набор **Galattok** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 24G (0,55 мм), 27G (0,41 мм), длиной 10 мм, 20 мм, расширитель, диаметром 0,65 мм, 0,55 мм, 0,45 мм, 0,35 мм, 0,30 мм, 0,25 мм




Пример маркировки упаковки набора Galattok для проведения биопсийных исследований мягких тканей

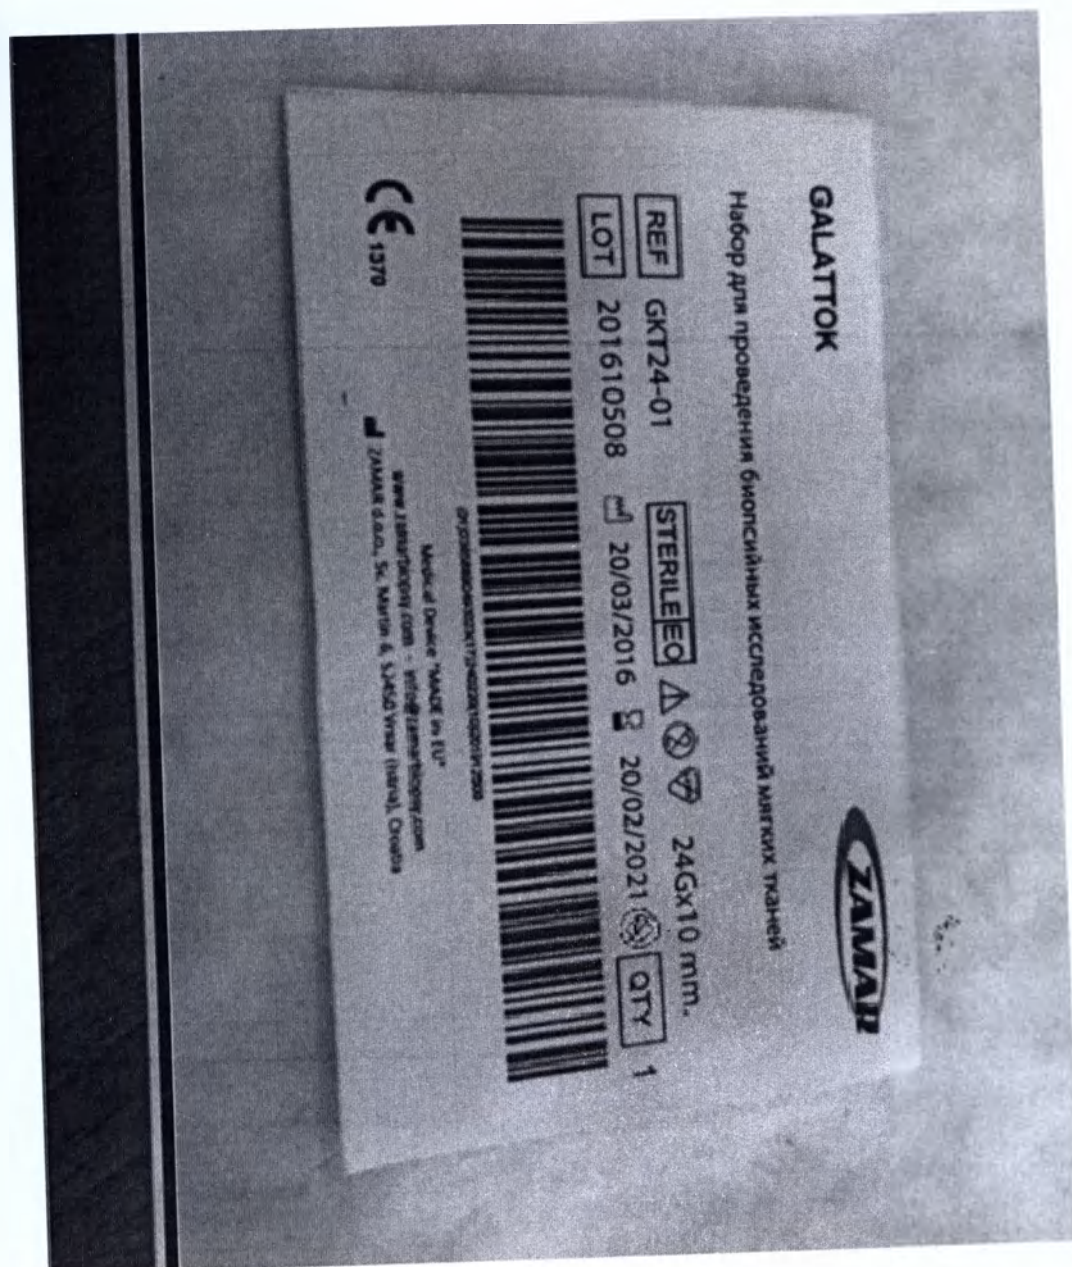


Набор Galattok GLSD для проведения биопсийных исследований мягких тканей с
яюлей, диаметром 24G (0,55 мм), 27G (0,41 мм), длиной 10 мм, 20 мм, расширитель,
диаметром 0,65 мм, 0,55 мм, 0,45 мм, 0,35 мм, 0,30 мм, 0,25 мм

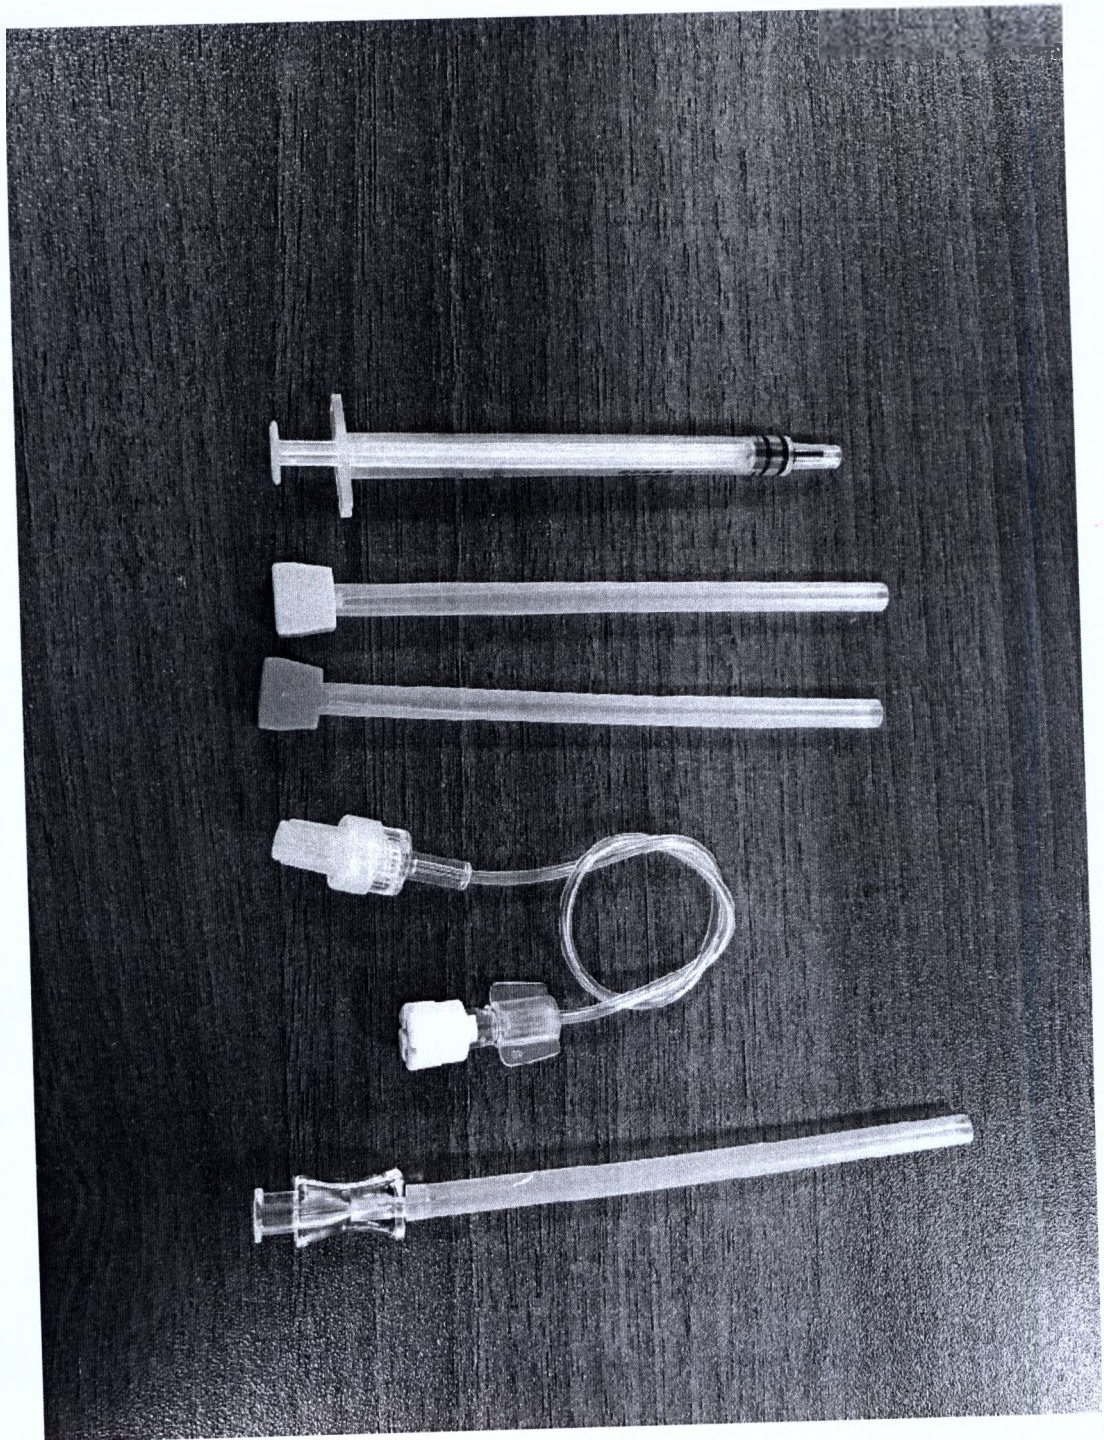

Пример маркировки упаковки набора Galattok GLSD для проведения биопсийных исследований мягких тканей

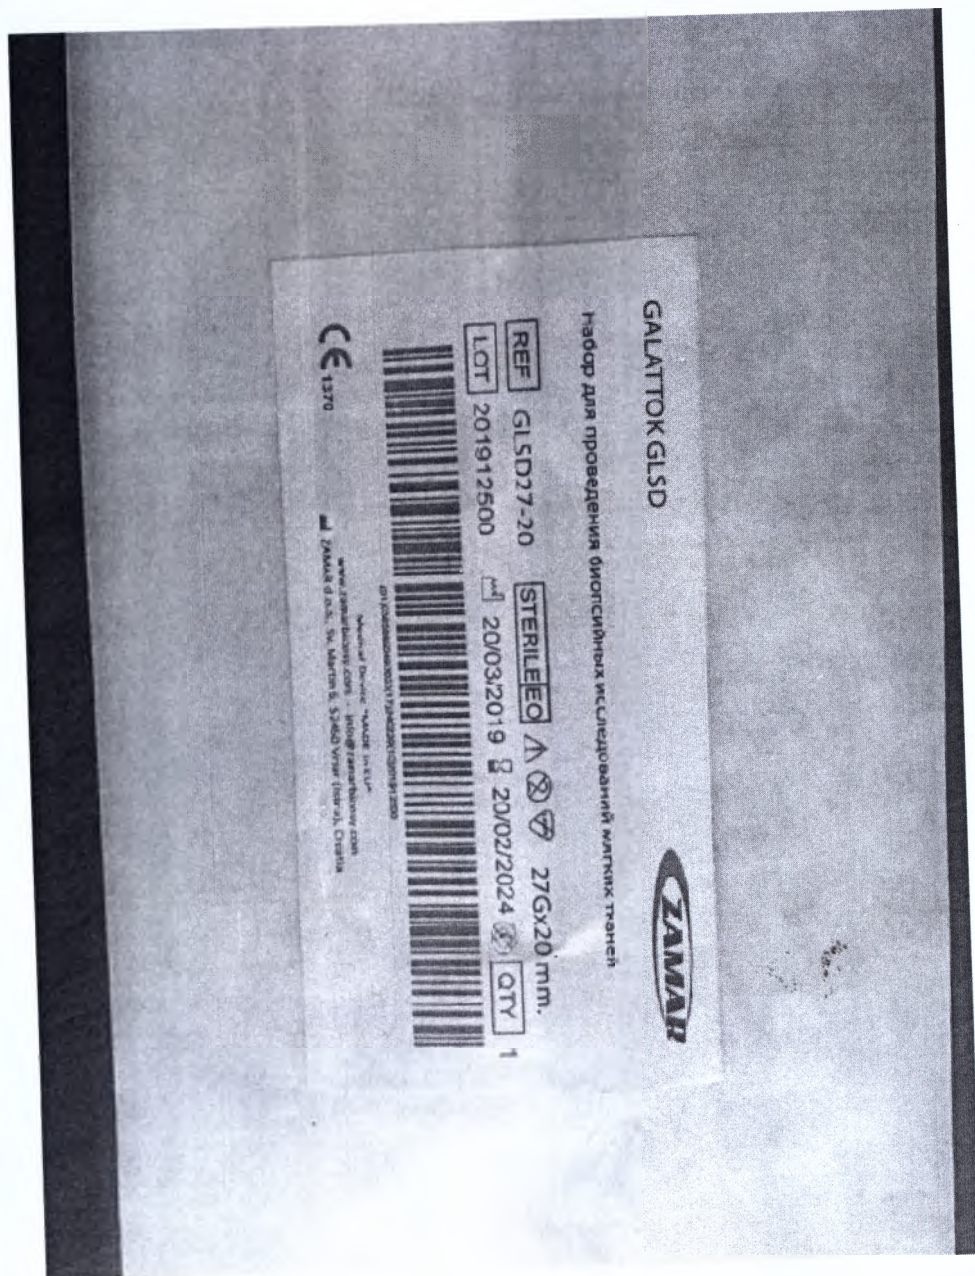

32. Набор **Galattok GLCD** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 24G (0,55 мм), 27G (0,41 мм), длиной 10 мм, 20 мм, расширитель, диаметром 0,65 мм, 0,55 мм, 0,45 мм, 0,35 мм, 0,30 мм, 0,25 мм

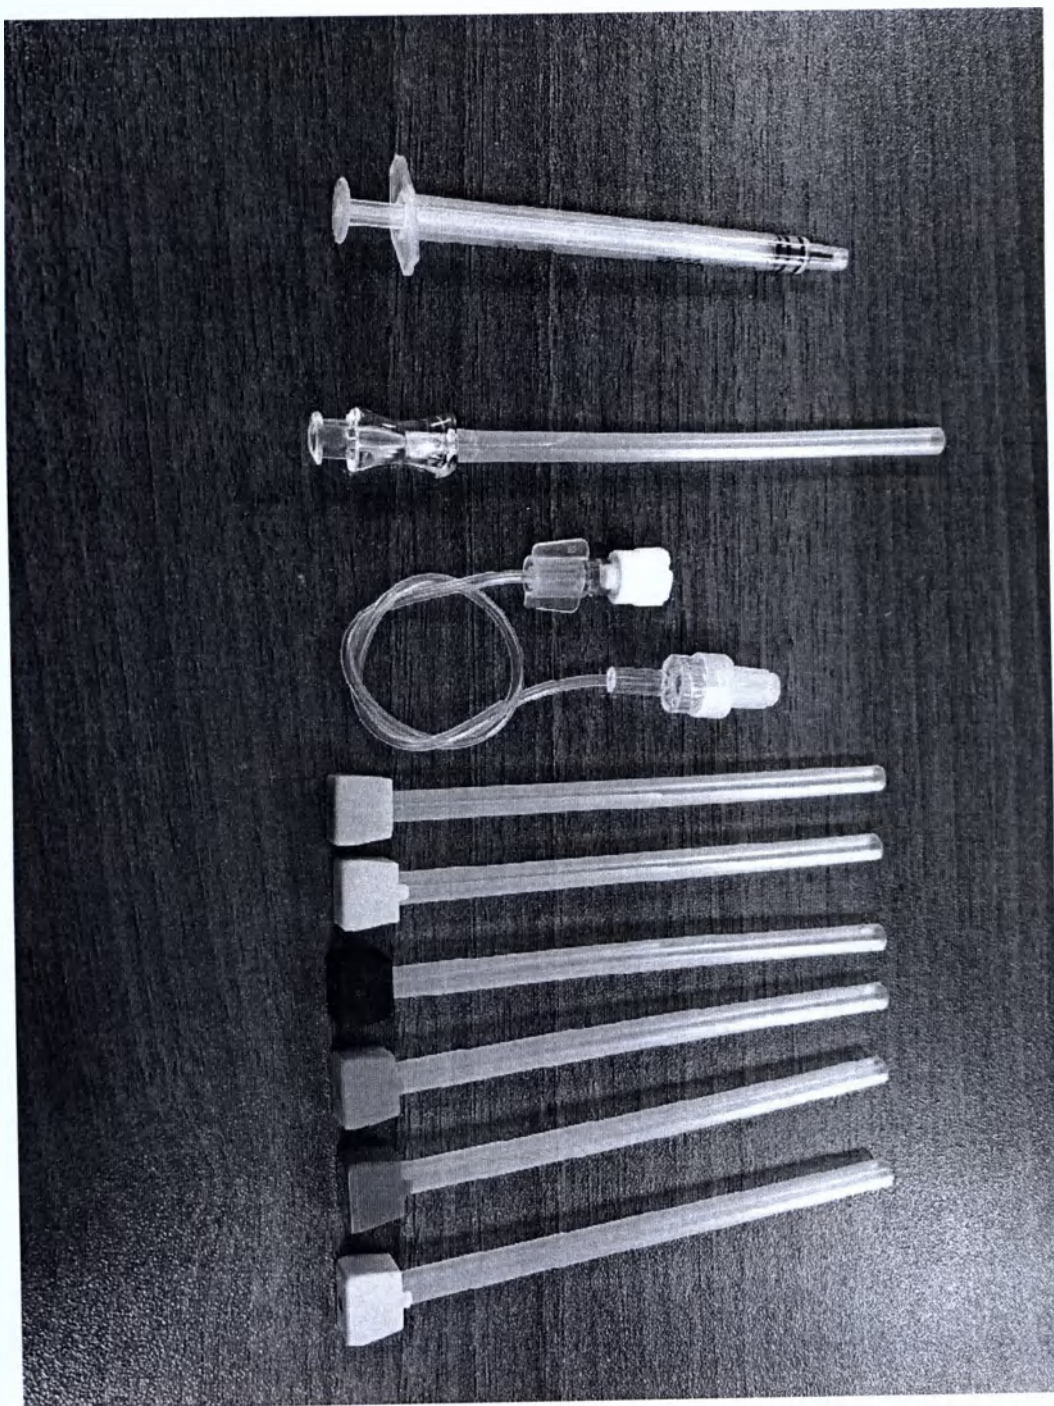

GALATOK GLCD

Набор для проведения биопсийных исследований малых тканей

REF GLCD27-20 **STERILE**    27Gx20 mm.

LOT 201912500  20/03/2019  20/02/2024 **QTY** 1




 9379




Medical Device "ZAMAD" in EU
www.zamad.com - info@zamad.com
ZAMAD s.r.o., Na Mlýnské 6, 15000 Praha (1800), Czechia


33. Набор **BGSET** для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей, диаметром 15G (1,80 мм), длиной 50 мм, 100 мм

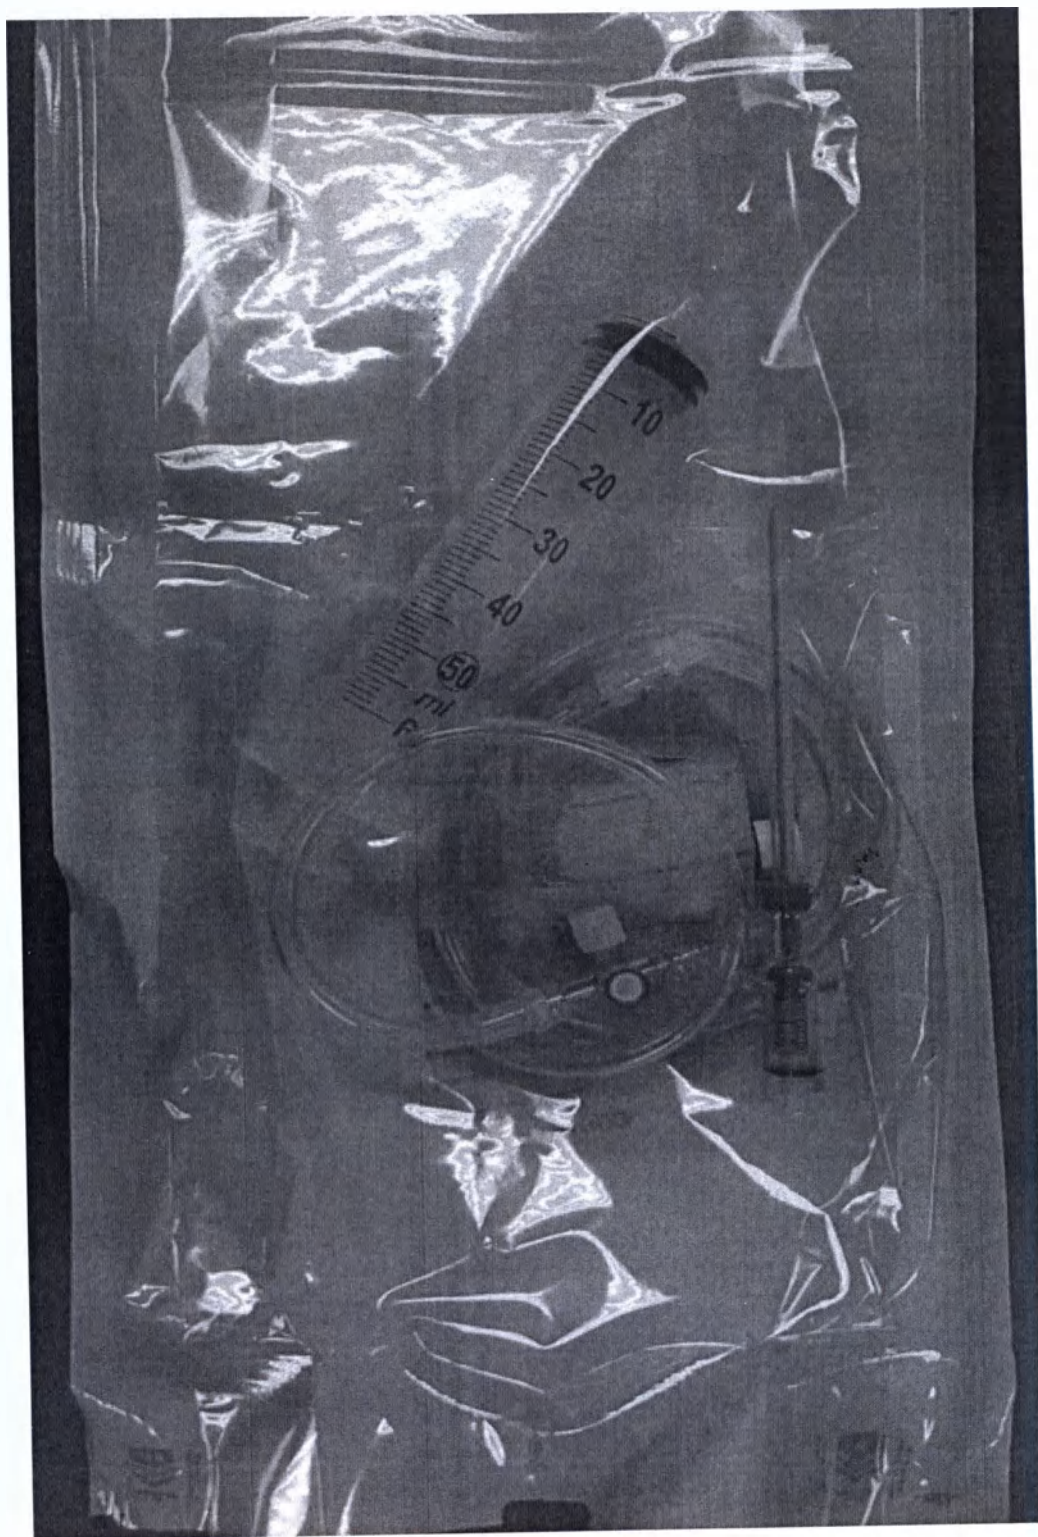

Пример маркировки упаковки набора BGSET для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей

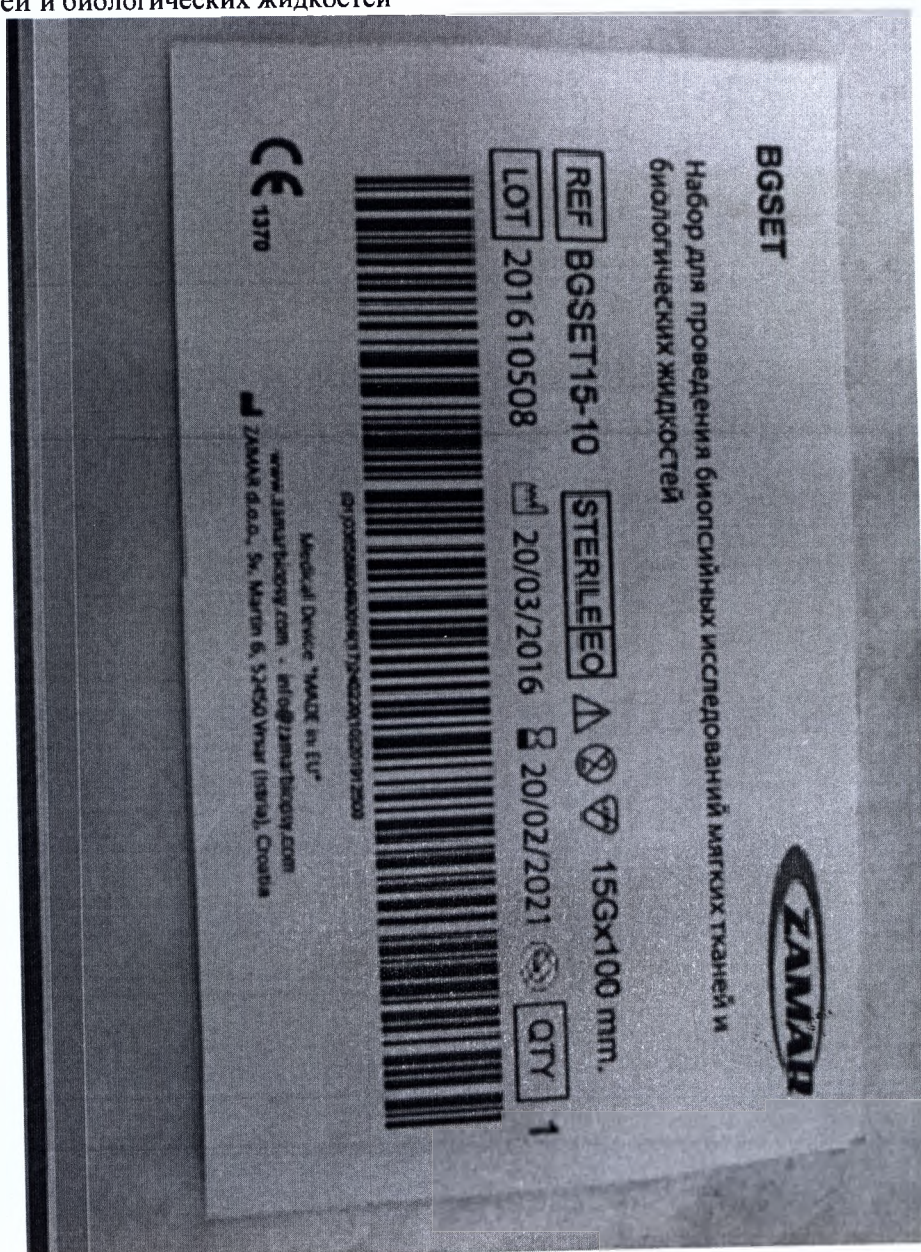

34. Набор **PKSET** для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей, диаметром 16G (1,60 мм), длиной 45 мм

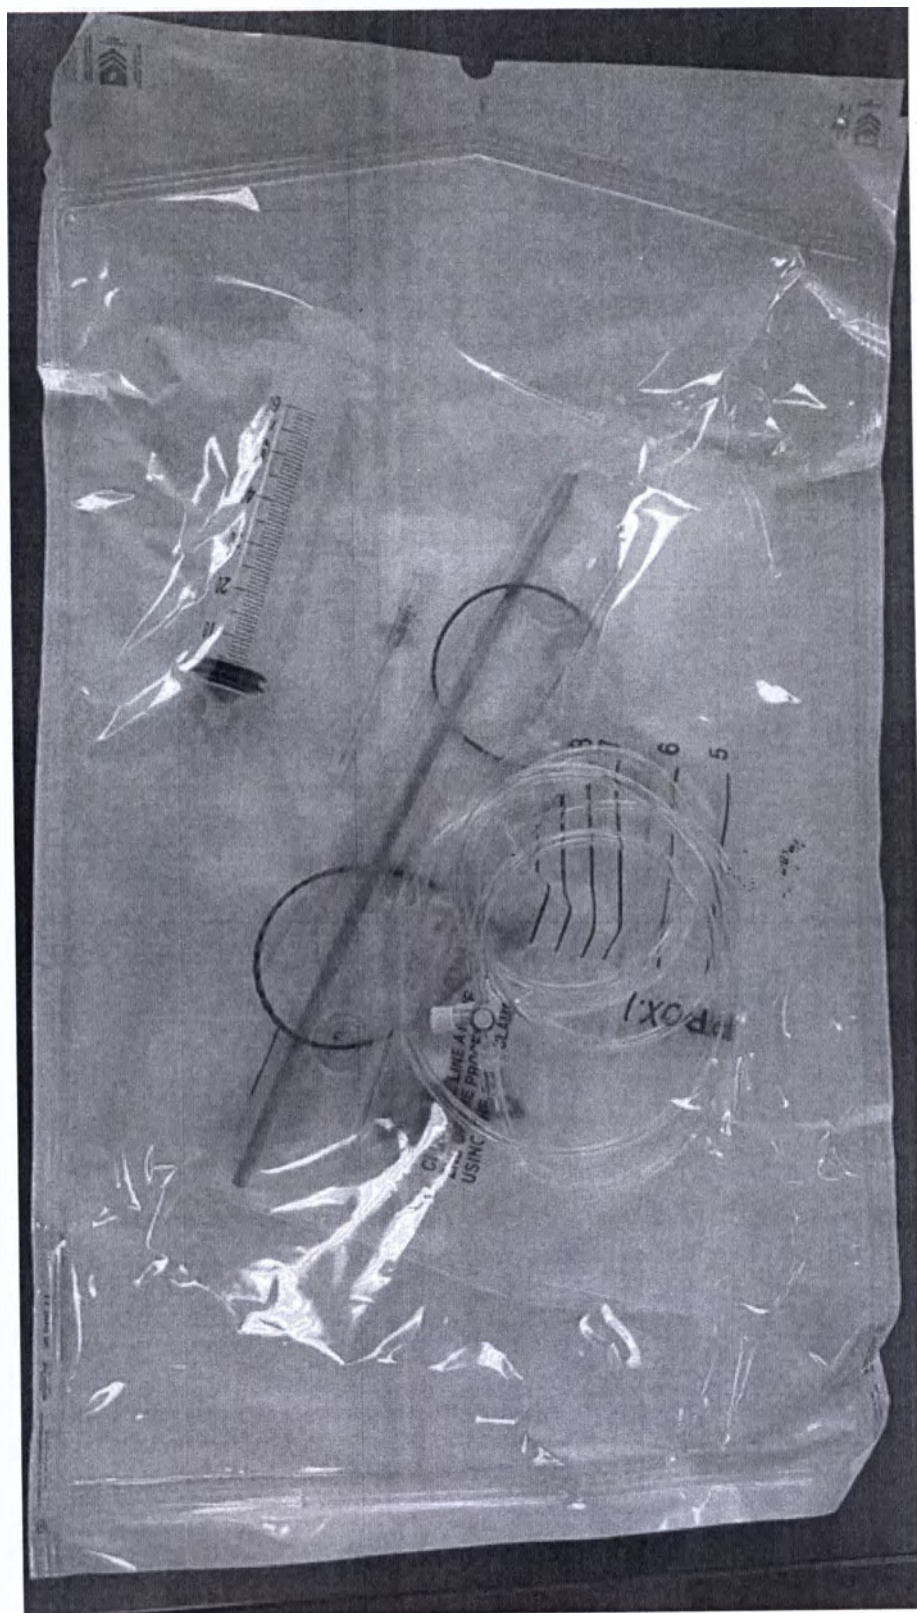


PKSET

Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей

REF PKSET

STERILE   16Gx45 mm.

LOT 201610508  20/03/2016  20/02/2021  **QTY** 1

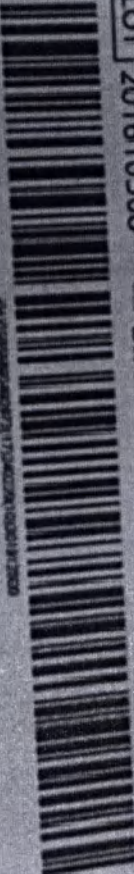

01 6254292000029173540226100061872000

Medical Device "MADE in EU"

www.zammarbionics.com - info@zammarbionics.com

ZAMMAR BIONICS SpA, Via Milan 6, 53050 Vinci (Livorno), Firenze

 1370

35. Набор **TPS** для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, диаметром 14G (2,1 мм), 16G (1,60 мм), 18G (1,27 мм), длиной 55 мм, 80 мм



TPS

Набор для проведения биологических исследований мягких тканей и биологических жидкостей

REF TPS80 **STERILE**  14, 16, 18x80 mm.

LOT 201610508  20/03/2016  20/02/2021  **QTY** 1



01 42000044000001712402201102011112000

Модель Device "MACE in EU"

www.zammarbore.com - info@zammarbore.com

ZAMAR Bore, St. Martin 6, 52000 Vieux (France), Croatia

 1370

Прошито и пронумеровано
11 лист
Ген.директор

