

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Имплант Гуру»



Хабиев Д.Н.

« 11 » 09 2017 г.

Фотографии медицинского изделия «Абатменты и принадлежности для ортопедических конструкций стоматологических имплантатов», производства MegaGen Implant Co., Ltd.», Korea/ «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.», Корея.

Москва

2016

1. Абатменты и принадлежности для ортопедических конструкций стоматологических имплантатов.

1. Абатмент Multi-unit в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Abutment):

MU5015HT, MU5025HT, MU5035HT, MU5045HT, MU5055HT, MU5015NT, MU5025NT, MU5035NT, MU5045NT, MU5055NT.

2. Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment): MU50117HT, MU50217HT, MU50317HT, MU50417HT, MU50117NT, MU50217NT, MU50317NT, MU50417NT, MU50129HT, MU50229HT, MU50329HT, MU50429HT, MU50129NT, MU50229NT, MU50329NT, MU50429NT.

3. Абатмент предохраняющий в комплекте с фиксирующим винтом и заглушкой (Fuse Abutment): AOFAP5535P, AOFAA5315P, AOFAA5325P.

4. Набор (Meg-Rhein PKG), в составе:

- Абатмент Meg-Rhein – 1 шт.

- Колпачок пластиковый слепочный – 1 шт.

- Колпачок металлический (Stainless Steel Housing) – 1 шт.

- Защитный диск – 1 шт.

- Колпачок ретенционный (Retentive Cap)– 5 шт.

ADR00P; ADR01P; ADR02P; ADR03P; ADR04P; ADR05P; ADR06P; DR00P; DR01P; DR02P; DR03P; DR04P; DR05P; DR06P.

5. Абатмент индивидуальный в вариантах исполнения ZrGEN, TiGEN:

- Абатмент индивидуальный ZrGEN (ZrGEN Abutment):

OSGSPA3111.MTN, OSGSPA3121.MTN, OSGSPA3211.MTN, OSGSPA3221.MTN, OSGSPA3111N.MTN, OSGSPA3112N.MTN, OSGSPA3112.MTN, OSGSPA3121N.MTN, OSGSPA3122N.MTN, OSGSPA3122.MTN, OSGSPA3211N.MTN, OSGSPA3212N.MTN, OSGSPA3212.MTN, OSGSPA3221N.MTN, OSGSPA3222N.MTN, OSGSPA3222.MTN, AANIPR4015.MTN, AANIPR4015N.MTN, AANIPR4016.MTN, AANIPR4016N.MTN, AANIPR4525.MTN, AANIPR4526.MTN, AANIPR4525N.MTN, AANIPR4526N.MTN, AAOIPR4015.MTN, AAOIPR4015N.MTN, AAOIPR4016.MTN, AAOIPR4016N.MTN, AAOIPR4525.MTN,

.MTN, AAOIPR4526.MTN, AAOIPR4526N.MTN, AOCEPS5015.MTN, AOCEPR5515.MTN, AOCEPW6515.MTN,
 .MTN, MIPN3013N.MTN, ANOEPS5015.MTN, ANOEPR5515.MTN, ANOEPW6515.MTN, ARZXN4515.MTN,
 ARZXN4525.MTN, ARZXN4516.MTN, ARZXN4526.MTN, ARZXN4515N.MTN, ARZXN4525N.MTN, ARZXN4516N.MTN,
 ARZXN4526N.MTN, ARZXM5015.MTN, ARZXM5525.MTN, ARZXM5016.MTN,
 ARZXM5526.MTN, ARZXM5015N.MTN, ARZXM5525N.MTN, ARZXM5016N.MTN, ARZXM5526N.MTN, ARZXL5515.MTN,
 ARZXL6025.MTN, ARZXL5516.MTN, ARZXL6026.MTN, ARZXL5515N.MTN, ARZXL6025N.MTN, ARZXL5516N.MTN,
 ARZXL6026N.MTN, ARCS3405.MTN, ARCS3410.MTN, ARCS3420.MTN, ARCS3805.MTN, ARCS3810.MTN, ARCS3820.MTN,
 ARCL4505.MTN, ARCL4510.MTN, ARCL4520.MTN, AOCS3405.MTN, AOCS3410.MTN, AOCS3420.MTN, AOCS3805.MTN,
 AOCS3810.MTN, AOCS3820.MTN, AOCL4505.MTN, AOCL4510.MTN, AOCL4520.MTN, STCSS3405.MTN, STCSS3410.MTN,
 STCSS3420.MTN, STCSS3805.MTN, STCSS3810.MTN, STCSS3820.MTN, STCSR3405.MTN, STCSR3410.MTN, STCSR3420.MTN,
 STCSR3805.MTN, STCSR3810.MTN, STCSR3820.MTN, STCLR4505.MTN, STCLR4510.MTN, STCLR4520.MTN, STBLPA1111.MTN,
 STBLPA1112.MTN, STBLPA1121.MTN, STBLPA1122.MTN, STBLPA1211.MTN, STBLPA1212.MTN, STBLPA1221.MTN,
 STBLPA1222.MTN, STGLPA2211.MTN, STGLPA2212.MTN, STGLPA2311.MTN, STGLPA2312.MTN, ATOOPA0211.MTN,
 ATOOPA0212.MTN, ATOOPA0221.MTN, ATOOPA0222.MTN, ATOOPA0311.MTN, ATOOPA0312.MTN, ATOOPA0321.MTN,
 ATOOPA0322.MTN, NBATPA3211.MTN, NBATPA3212.MTN, NBATPA3221.MTN, NBATPA3222.MTN, NBATPA3311.MTN,
 NBATPA3312.MTN, NBATPA3321.MTN, NBATPA3322.MTN, NBRPPA2111.MTN, NBRPPA2112.MTN, NBRPPA2121.MTN,
 NBRPPA2122.MTN, NBRPPA2211.MTN, NBRPPA2212.MTN, NBRPPA2221.MTN, NBRPPA2222.MTN, NBRPPA2311.MTN,
 NBRPPA2312.MTN, NBRPPA2321.MTN, NBRPPA2322.MTN, NBRPPA2411.MTN, NBRPPA2412.MTN, NBRPPA2421.MTN,
 NBRPPA2422.MTN, NBBMPA1111.MTN, NBBMPA1112.MTN, NBBMPA1121.MTN, NBBMPA1122.MTN, NBBMPA1211.MTN,
 NBBMPA1212.MTN, NBBMPA1221.MTN, NBBMPA1222.MTN, NBBMPA1311.MTN, NBBMPA1312.MTN, NBBMPA1321.MTN,
 NBBMPA1322.MTN, ZMTVPA1111.MTN, ZMTVPA1112.MTN, ZMTVPA1121.MTN, ZMTVPA1122.MTN, ZMTVPA1211.MTN,
 ZMTVPA1212.MTN, ZMTVPA1221.MTN, ZMTVPA1222.MTN, ZMTVPA1311.MTN, ZMTVPA1312.MTN, ZMTVPA1321.MTN,
 ZMTVPA1322.MTN, DFXVPA1111.MTN, DFXVPA1211.MTN, DFXVPA1212.MTN, DFXVPA1221.MTN, DFXVPA1222.MTN,
 DFXVPA1311.MTN, DFXVPA1312.MTN, DFXVPA1321.MTN, DFXVPA1322.MTN, DFXVPA1313.MTN, DFXVPA1314.MTN,
 DFXVPA1323.MTN, DFXVPA1324.MTN, DFXVPA1411.MTN, DFXVPA1412.MTN, DFXVPA1421.MTN,
 DFXVPA1422.MTN, TROCPA1111.MTN, TROCPA1112.MTN, TROCPA1121.MTN, TROCPA1122.MTN, TROCPA1211.MTN,
 TROCPA1212.MTN, TROCPA1221.MTN, TROCPA1222.MTN, TROCPA1311.MTN, TROCPA1312.MTN,
 TROCPA1321.MTN, TROCPA1322.MTN, TREXPA2111.MTN, TREXPA2112.MTN, TREXPA2121.MTN,
 TREXPA2122.MTN, TREXPA2211.MTN, TREXPA2212.MTN, TREXPA2221.MTN, TREXPA2222.MTN, TREXPA2311.MTN,
 TREXPA2312.MTN, TREXPA2321.MTN, TREXPA2322.MTN, TREXPA2411.MTN, TREXPA2412.MTN,
 TREXPA2421.MTN, TREXPA2422.MTN.

- Абатмент индивидуальный TiGEN (TiGEN Abutment):

ARTR1220.MTN, ARTR1220N.MTN, AOTR1220.MTN, AOTR1220N.MTN, MITN1020.MTN, MITN1020N.MTN, OSTG3111.MTN, OSTG3211.MTN, OCTS1220.MTN, OCTR1220.MTN, OCTW1220.MTN, NOTS1220.MTN, NOTR1220.MTN, NOTW1220.MTN, OSTG3111N.MTN, OSTG3211N.MTN, ARTXN1220.MTN, ARTXN1220N.MTN, ARTXM1220.MTN, ARTXM1220N.MTN, ARTXL1220.MTN, ARTXL1220N.MTN, STTG1111.MTN, STTG1211.MTN, STTG2211.MTN, STTG2311.MTN, ATTG0211.MTN, ATTG0311.MTN, NBTG3211.MTN, NBTG3311.MTN, NBTG2111.MTN, NBTG2211.MTN, NBTG2311.MTN, NBTG2411.MTN, NBTG1111.MTN, NBTG1211.MTN, NBTG1311.MTN, ZMTG1111.MTN, ZMTG1211.MTN, ZMTG1311.MTN, DFTG1111.MTN, DFTG1211.MTN, DFTG1311.MTN, DFTG1313.MTN, DFTG1411.MTN, TRTG1111.MTN, TRTG1211.MTN, TRTG1311.MTN, TRTG2111.MTN, TRTG2211.MTN, TRTG2311.MTN, TRTG2411.MTN.

6. Абатмент сканируемый в комплекте с фиксирующим винтом (Scan Abutment):

AANISR4009T, AANISR4013T, AAOISR4009T, AAOISR4013T, MISS3509T, MISS3513T, OSGSSC3110T, OSGSSC3111T, OSGSSC3210T, OSGSSC3211T, AOCECSC4011T, STBLSC1111T, STBLSC1211T, STGLSC2211T, ATOOSC0211T, ATOOSC0311T, NBATSC3211T, NBATSC3311T, NBRPSC2111T, NBRPSC2211T, NBRPSC2311T, NBRPSC2411T, NBBMSC1111T, NBBMSC1211T, NBBMSC1311T, ZMTVSC1111T, ZMTVSC1211T, ZMTVSC1311T, DFXVSC1111T, DFXVSC1211T, DFXVSC1311T, TROCSC1111T, TROCSC1211T, TREXSC2111T, TREXSC2211T.

7. Сканируемый штифт (Scan Post):

SP4007.MTN, SP5007.MTN, SP6007.MTN, SP7007.MTN.

8. Сканируемый формирователь десны в комплекте с фиксирующим винтом (Scan Healing Abutment):

ARISH4004T, ARISH4005T, ARISH4007T, ARISH5004T, ARISH5005T, ARISH5007T, ARISH6004T, ARISH6005T, ARISH6007T, ARISH7004T, ARISH7005T, ARISH7007T,

AOISH4004T, AOISH4005T, AOISH4007T, AOISH4504T, AOISH4505T, AOISH4507T, AOISH5504T, AOISH5505T, AOISH5507T, AOISH6504T, AOISH6505T, AOISH6507T.

II. Принадлежности:

1. Винт абатмента (Abutment Screw):

АТООАС0210, АТООАС0310, DFXVAS1110, DFXVAS1210, DFXVAZ1110, OSGSAS3110, OSGSAS3210, TROCAS1010, ZMTVAS1010, MIAZ1410, NBATAS3210, NBATAS3310,

NBRPAS2110, NBRPAS2210, STBLAS1110, STBLAS1210, STGLAS2010, NBBMAS1110, NBBMAS1210, NBBMAS1310, TREXAS2210, MIAS14, MIAZ1410, IRCS200.

2. Винт мульти-абатмента (Multi Post Screw):

AANMSF, MUS15, MUS25, MUS35, MUS45, MUS55, MUAS20.

3. Ключ для сканируемого штифта (Scan Post Carrier):

SPC16.

4. Винт сканируемого формирователя десны (Scan Healing Abutment Screw):

AOIHS2004, AOIHS2005, AOIHS2007, ARIHS1804, ARIHS1805, ARIHS1807.

With Concept
Implant System

MEGA'GEN

CE
0434

Multi-unit abutment [AO]

Ø5/ C=1.5/ Hex

REF MU5015HT

 2015-01-21

LOT 150121A0211-01

MODEL NAME MU5015H

SN 019

Rx Only



Do not reuse



Non-sterile




Caution



Consult
Instructions
for use




Do not use
if package
is damaged



rev.01



Temperature
limitation



ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjunggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



Рис. 1. Абатмент Multi-unit в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Abutment)

With Concept
Implant System

MEGA^IGEN

CE
0434

Multi-unit angled abutment [AO]

Ø5/ C=4/ A=29/ Non-Hex

REF MU50429NT

 2014-11-20

LOT 141120A0442-01

MODEL NAME MU50429N

SN 006


Rx Only



Do not reuse



Non-sterile



Caution




Consult
Instructions
for use




Do not use
if package
is damaged



rev.02



Temperature
limitation



ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



Рис. 2. Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment)

With Concept
Implant System

MEGAⁱGEN

CE
0434

Fuse Abutment [AO]

Ø5.5/ C=3/ 15°/ Hex

REF AOFAA5315P

 2013-08-13

LOT 130813A04-01

MODEL NAME AOFAA5315

SN 088

Rx Only



Do not reuse



Non-sterile




Caution




Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev.00



Temperature
limitation

EC **REP**

ImplaMedica Ltd
Fabijoniškių 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237436

MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



Рис.3. Абатмент предохраняющий в комплекте с фиксирующим винтом и заглушкой (Fuse Abutment)

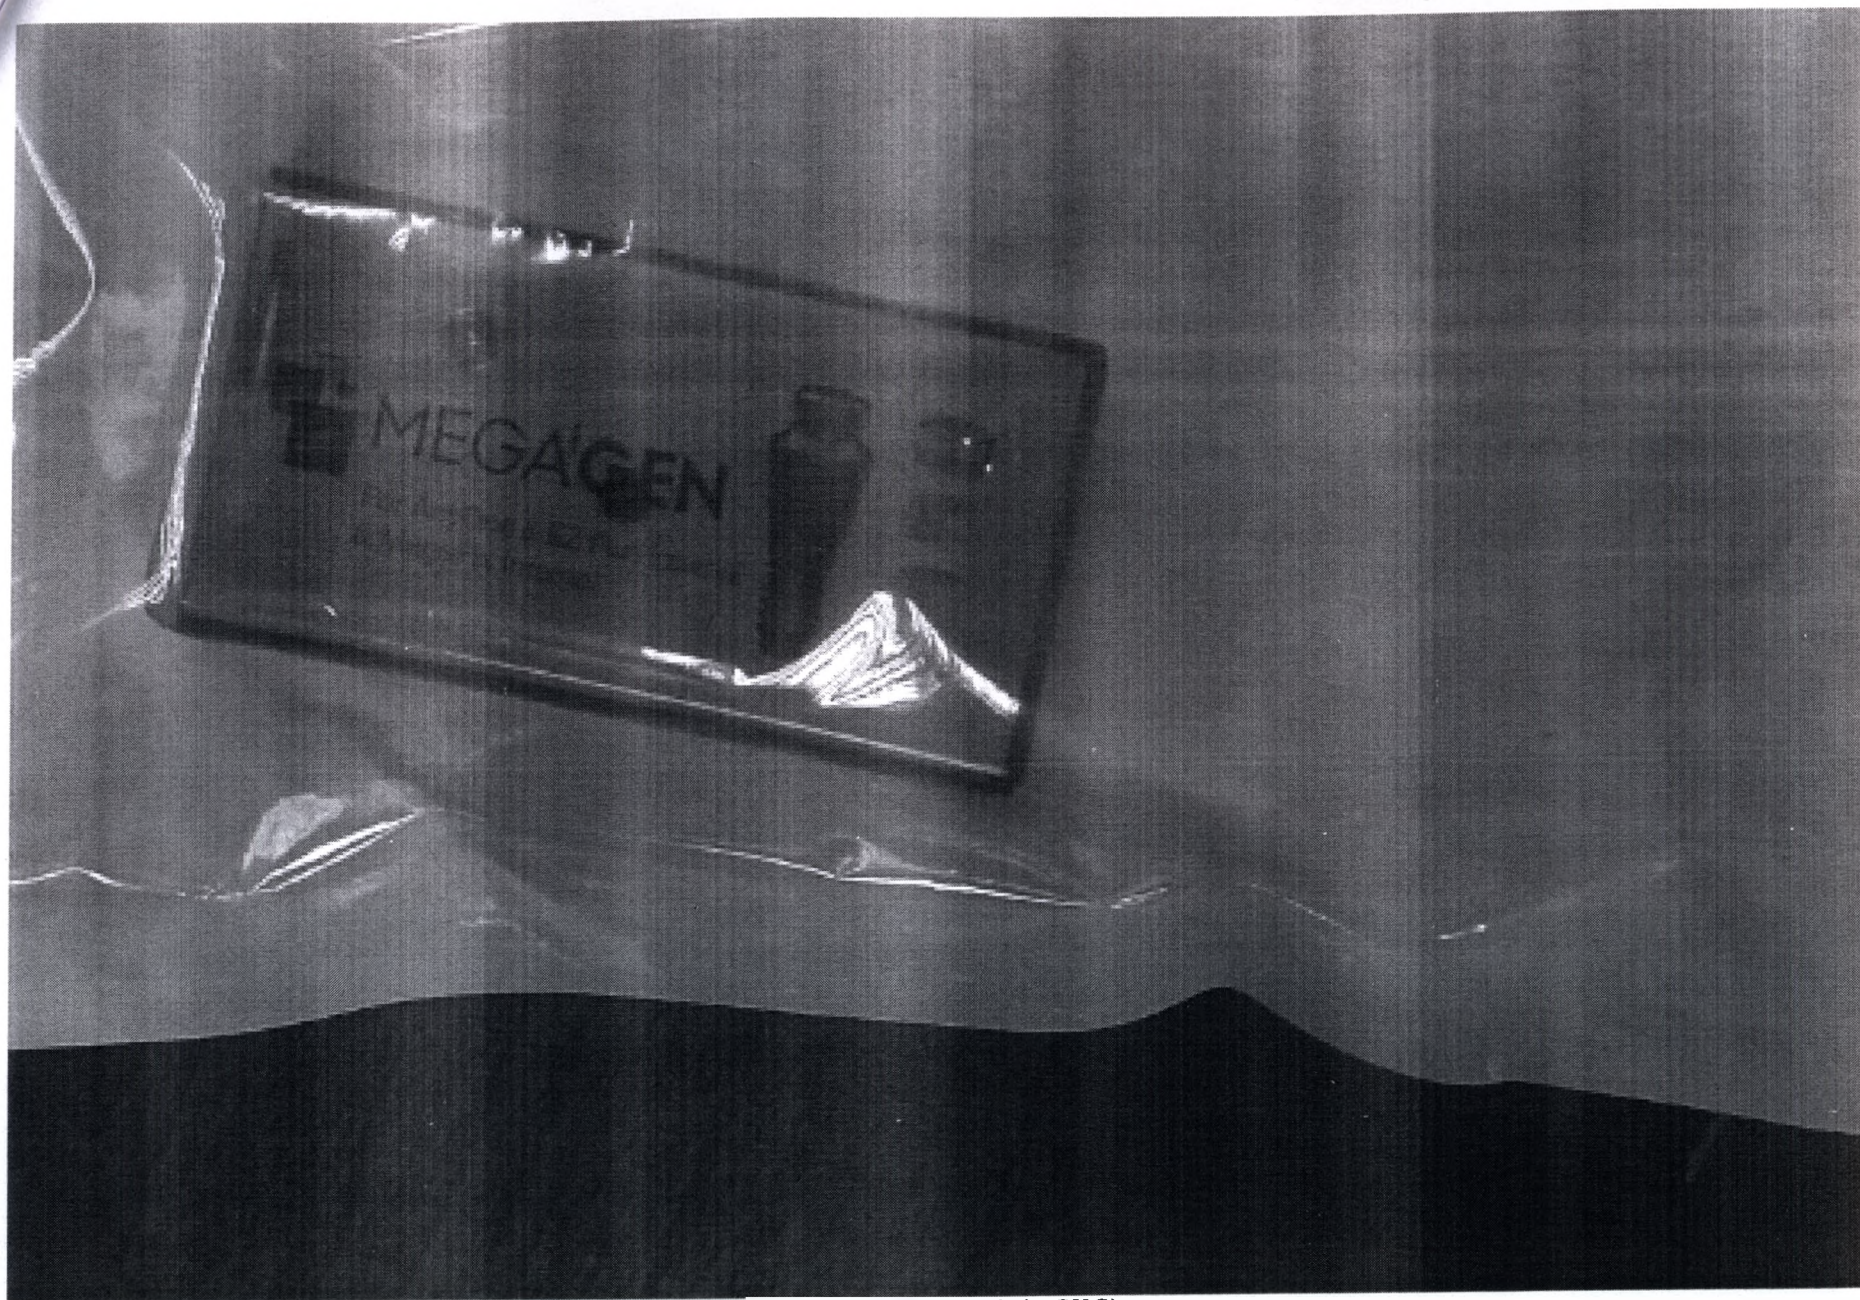


Рис.4. Набор (Meg-Rhein PKG)



Рис.5. Абатмент индивидуальный ZrGEN (ZrGEN Abutment)

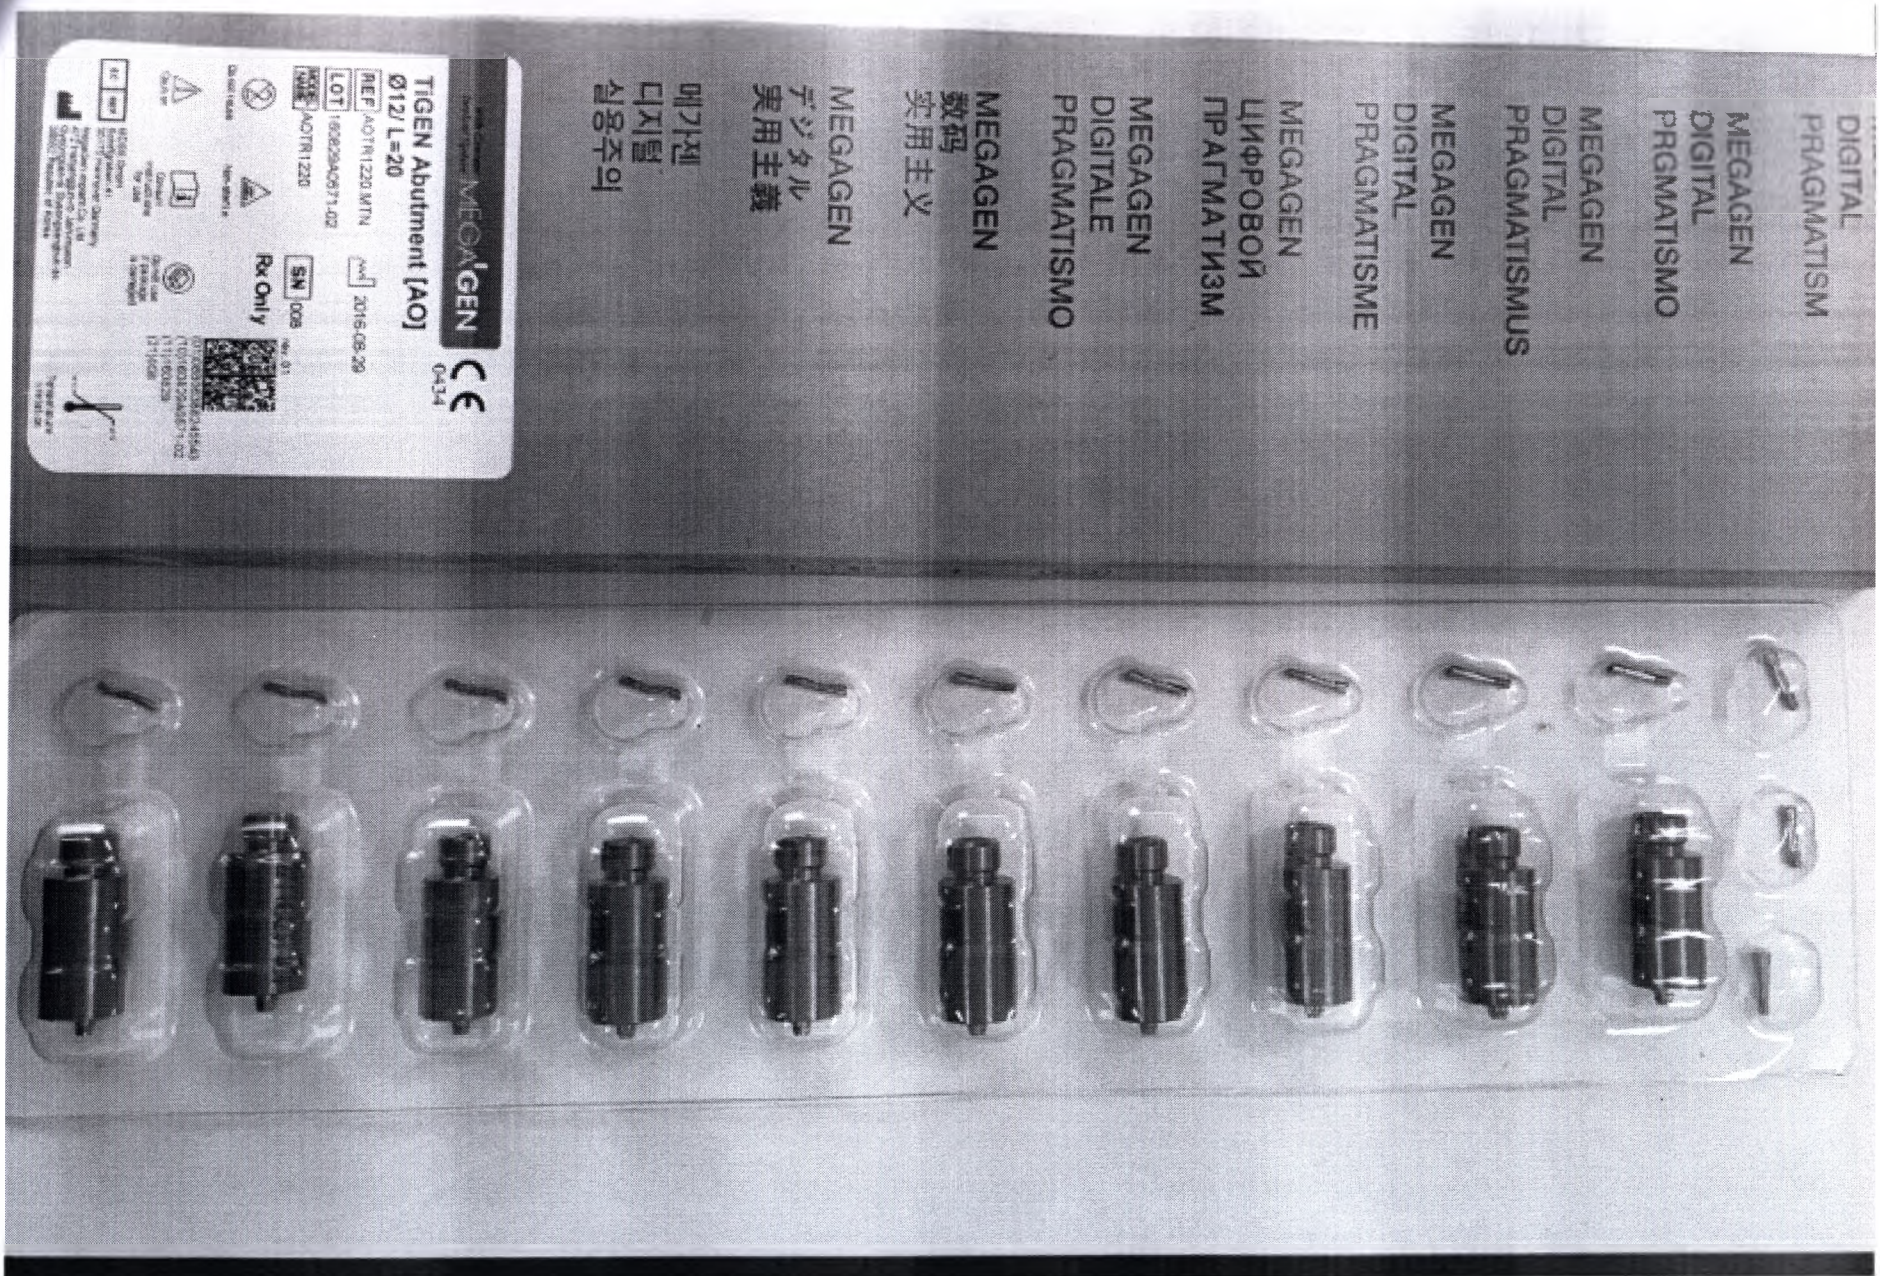


Рис.6. Абатмент индивидуальный TIGEN (TIGEN Abutment)

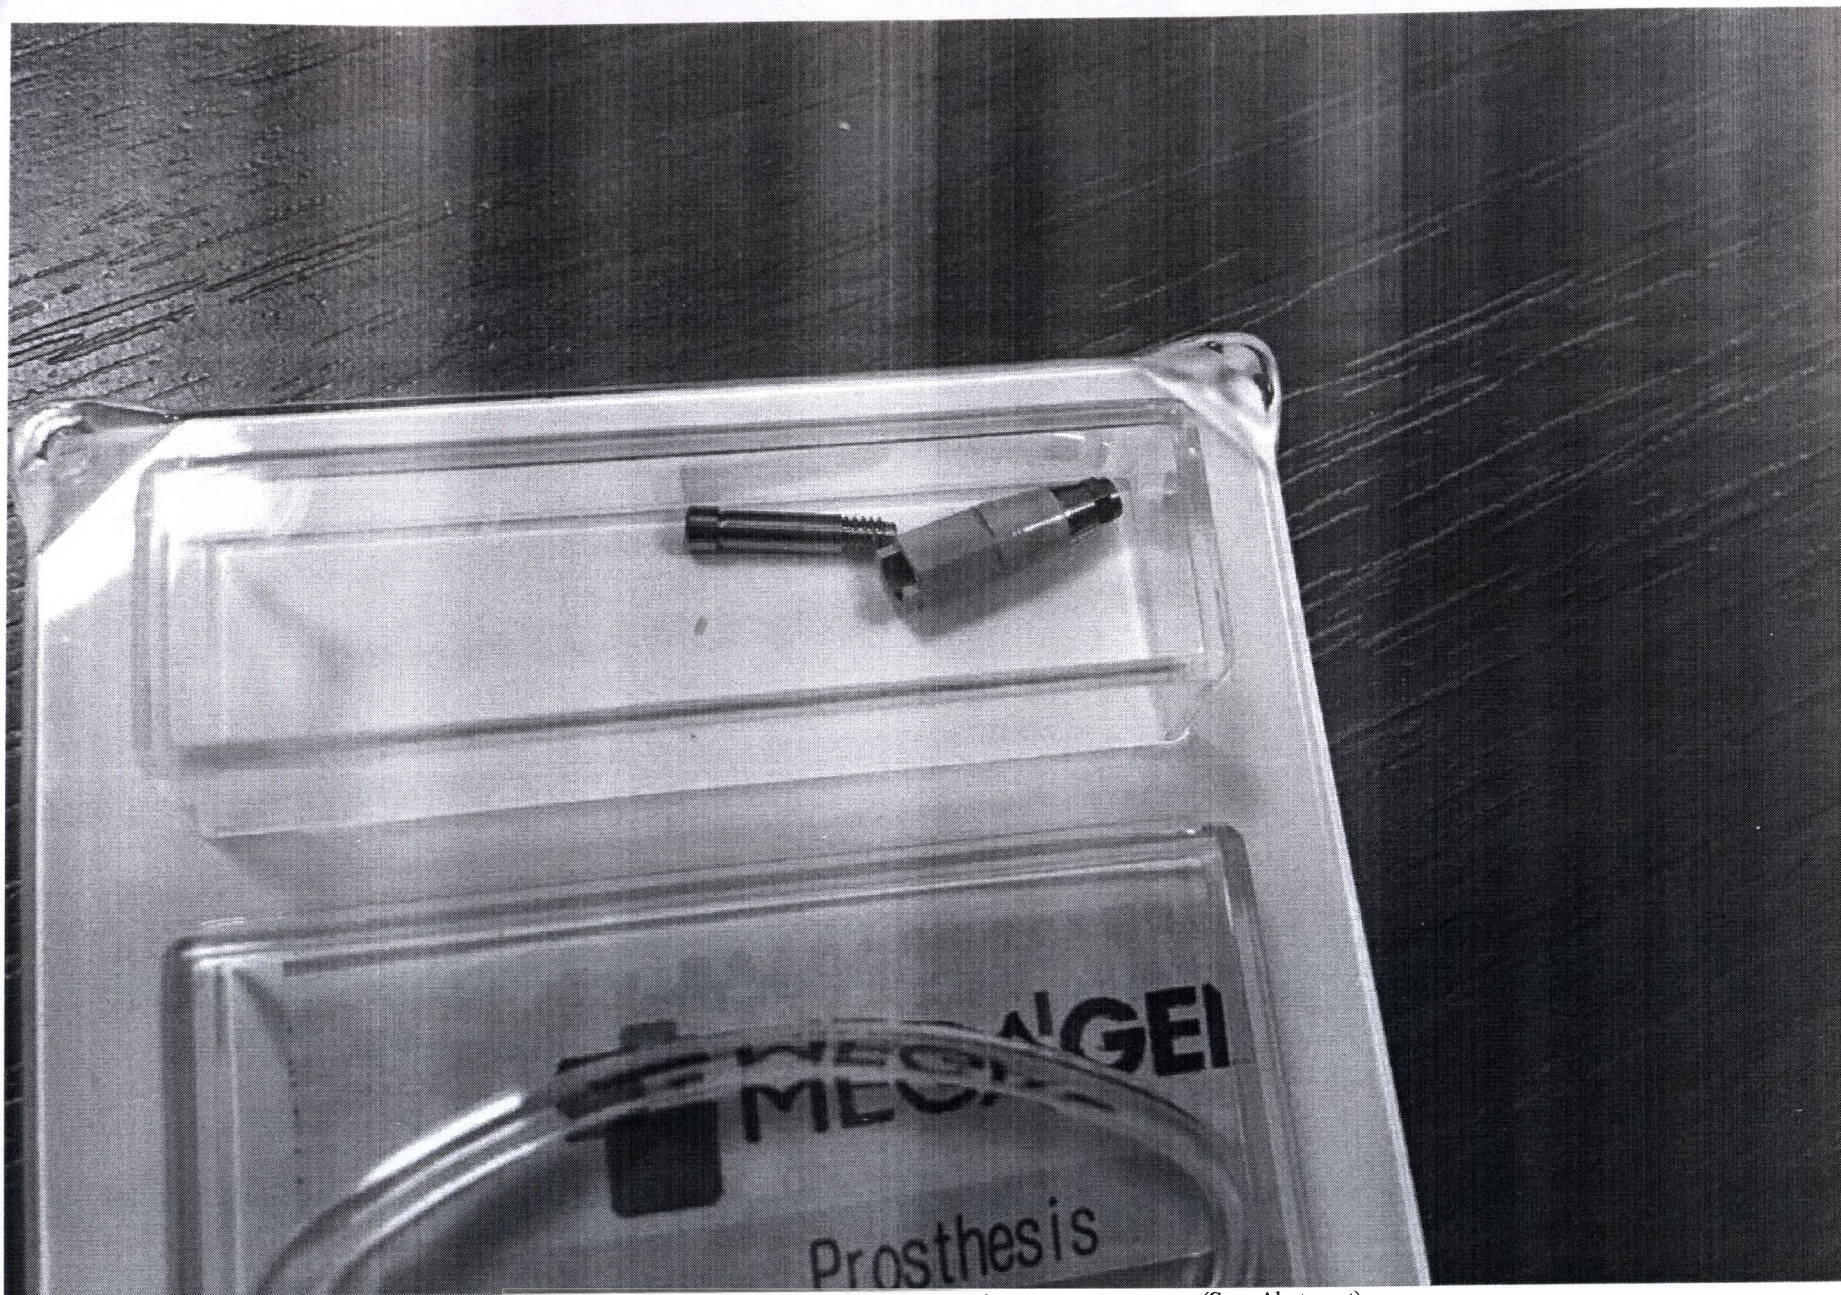


Рис.7. Абатмент сканируемый в комплекте с фиксирующим винтом (Scan Abutment)

With Concept
Implant System

MEGA'GEN



Scan Post [CM]

Ø5/ L=7

REF SP5007.MTN


2016-09-29

LOT 160929A0030-02

MODEL NAME SP5007

SN 038

rev. 00



Rx Only



Do not reuse



Non-sterile



Caution




Consult
instructions
for use




Do not use
if package
is damaged

(01)08806388250486
(10)160929A0030-02
(11)160929
(21)038



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
38552 Republic of Korea



Temperature
limitation

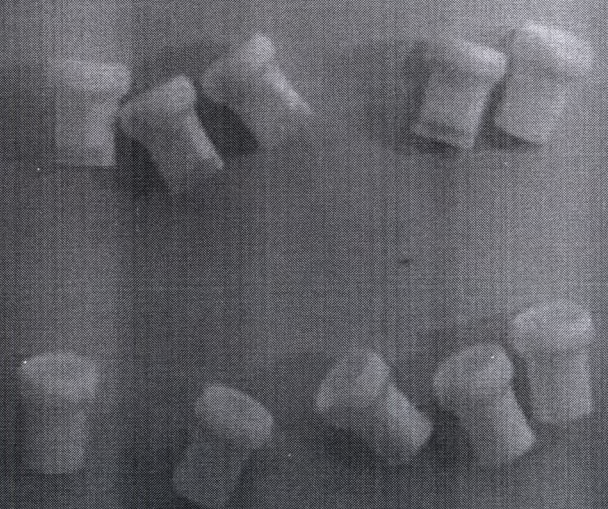


Рис.8. Сканируемый штифт (Scan Post)

With Concept
Implant System

MEGA¹GEN

CE
0434

Scan Healing Abutment [AR] Ø4/ H=4

REF ARISH4004T

 2016-09-07

LOT 160906A1030-01


 2021-09-06

MODEL NAME ARISH4004

SN 027

rev.00

Rx Only



(01)08806388250219
(10)160906A1030-01
(11)160907
(17)210906
(21)027



Do not reuse



Non-sterile



Caution




Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged

EC **REP**

MDSS GmbH
Schriffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
36552 Republic of Korea



Temperature
limitation



Рис.9. Сканируемый формирователь десны в комплекте с фиксирующим винтом (Scan Healing Abutment)


With Concept
Implant System

MEGA'GEN

CE
0434

Abutment Screw [EX] M2

REF IRCS200

 2017-04-07

LOT 170407A0251-02

MODEL NAME IRCS200

SN 264

rev. 01

Rx Only



Do not reuse



Non-sterile




Caution



Consult
Instructions
for use




Do not use
if package
is damaged



(01)08806388222339
(10)170407A0251-02
(11)170407
(21)264

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
38552 Republic of Korea



Temperature
limitation

Рис.10. Винт абатмента (Abutment Screw)

With Concept
Abutment System

MEGA¹GEN

CE
0434

Multi Post Screw [AR] M1.8

REF AANMSF

 2017-03-28

LOT 170328A0401-01

MODEL NAME AANMSF

SN 374

rev. 01

Rx Only



(01)08806388202911
(10)170328A0401-01
(11)170328
(21)374



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use




Do not use
if package
is damaged

EC **REP**

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
38552 Republic of Korea



Temperature
limitation

Рис.11. Винт мульти-абатмента (Multi Post Screw)

With Concept
Implant System

MEGA

GEN



Scan
L=16

Carrier [CM]

REF

SPC16



7-04-05

LOT

170405A0160-01

MODEL
NAME


SPC16

SN

005

rev. 00

Rx Only



(01)08806388250202
(10)170405A0160-01
(11)170405
(21)005



Caution



Non-sterile



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is

EC

REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

Ltd

472
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk
38552 Republic of Korea



Temperature
limitation

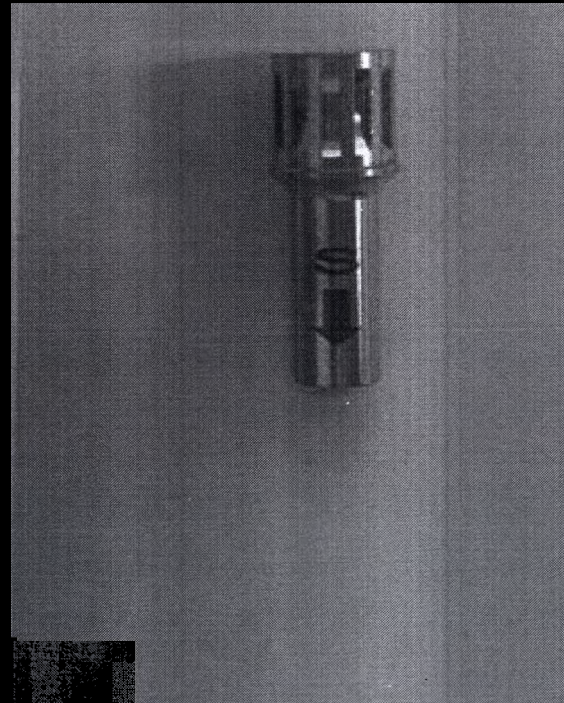


Рис. 12. Ключ для сканируемого штифта (Scan Post Carrier)

With Concept
Implant System

MEGA¹GEN

CE
0434

S.H.A Screw [AO] M2/ H=7

REF AOIHS2007

 2017-04-10

LOT 170410A0510-01

MODEL NAME AOIHS2007

SN 001

rev. 00

Rx Only



(01)08806388252916
(10)170410A0510-01
(11)170410
(21)001



Do not reuse



Non-sterile




Caution




Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
38552 Republic of Korea



Temperature
limitation

Рис.13. Винт сканируемого формирователя десны (Scan Healing Abutment Screw)

Прошито и скреплено печатью

18 листов

« 11 » 09 20 17 год

Генеральный директор

ООО «Имплант Гурур»

Хабиев Д.Н.

