

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



В.Г. Акимкин

2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс[®] ИФА Zika virus-IgM

ТУ 21.20.23-355-01897593-2018,

производства

Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»,
Российская Федерация, 111123, город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А

Разработано совместно с ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора
(142279, Московская область, п. Оболенск, тел.: +7 (4967) 36-00-03, e-mail:
info@obolensk.org)

2019


ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® ИФА Zika virus-IgM
ТУ 21.20.23-355-01897593-2018

Форма 1: «ИФА Zika virus-IgM»

Состав комплекта:

Иммуносорбент ZIKV-IgM	--- x 1
K+ ZIKV-IgM инактивированный	0,05 мл x 1
K- ZIKV инактивированный	0,05 мл x 1
Концентрат конъюгата anti-IgM	0,2 мл x 1
Раствор для разведения (ИФА)	40 мл x 1
10х отмывочный раствор	40 мл x 1
ТМБ	15 мл x 1
Стол-реагент	10 мл x 1
Планшет для предварительного разведения образцов	--- x 1
Ванночка для разведения реагентов	- x 2
Пленка для заклеивания планшета	- x 2



96



ТМБ



Иммуносорбент ZIKV-IgM

Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ 1 и 2 типов, вирусу гепатита С, возбудителю сифилиса и HBsAg вируса гепатита В отсутствуют.

При получении разукрупнять соответствия с указанными температурами хранения

REF H-3551-10

LOT 27.02.19

2019-02-27

2019-11-27

Разработано совместно с ФБУН "ГНЦ ПМБ" Роспотребнадзора (142279, Московская область, п. Оболensk, тел.: +7 (4967) 36-00-03, e-mail: info@obolensk.org)


Свидетельство на товарный знак № 212724

Регистрационный номер:


AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Леонидовская, 54
тел.: (495) 934-0000
факс: (495) 934-0000
Federal Budget Institute for Scientific
Central Research Institute for Epidemiology
Moscow, 111123, Russia
tel.: (495) 934-0000
fax: (495) 934-0000


Фотография набора реагентов АмплиСенс® ИФА Zika virus-IgM (форма 1, серия 27.02.19) после вскрытия внешней упаковки.

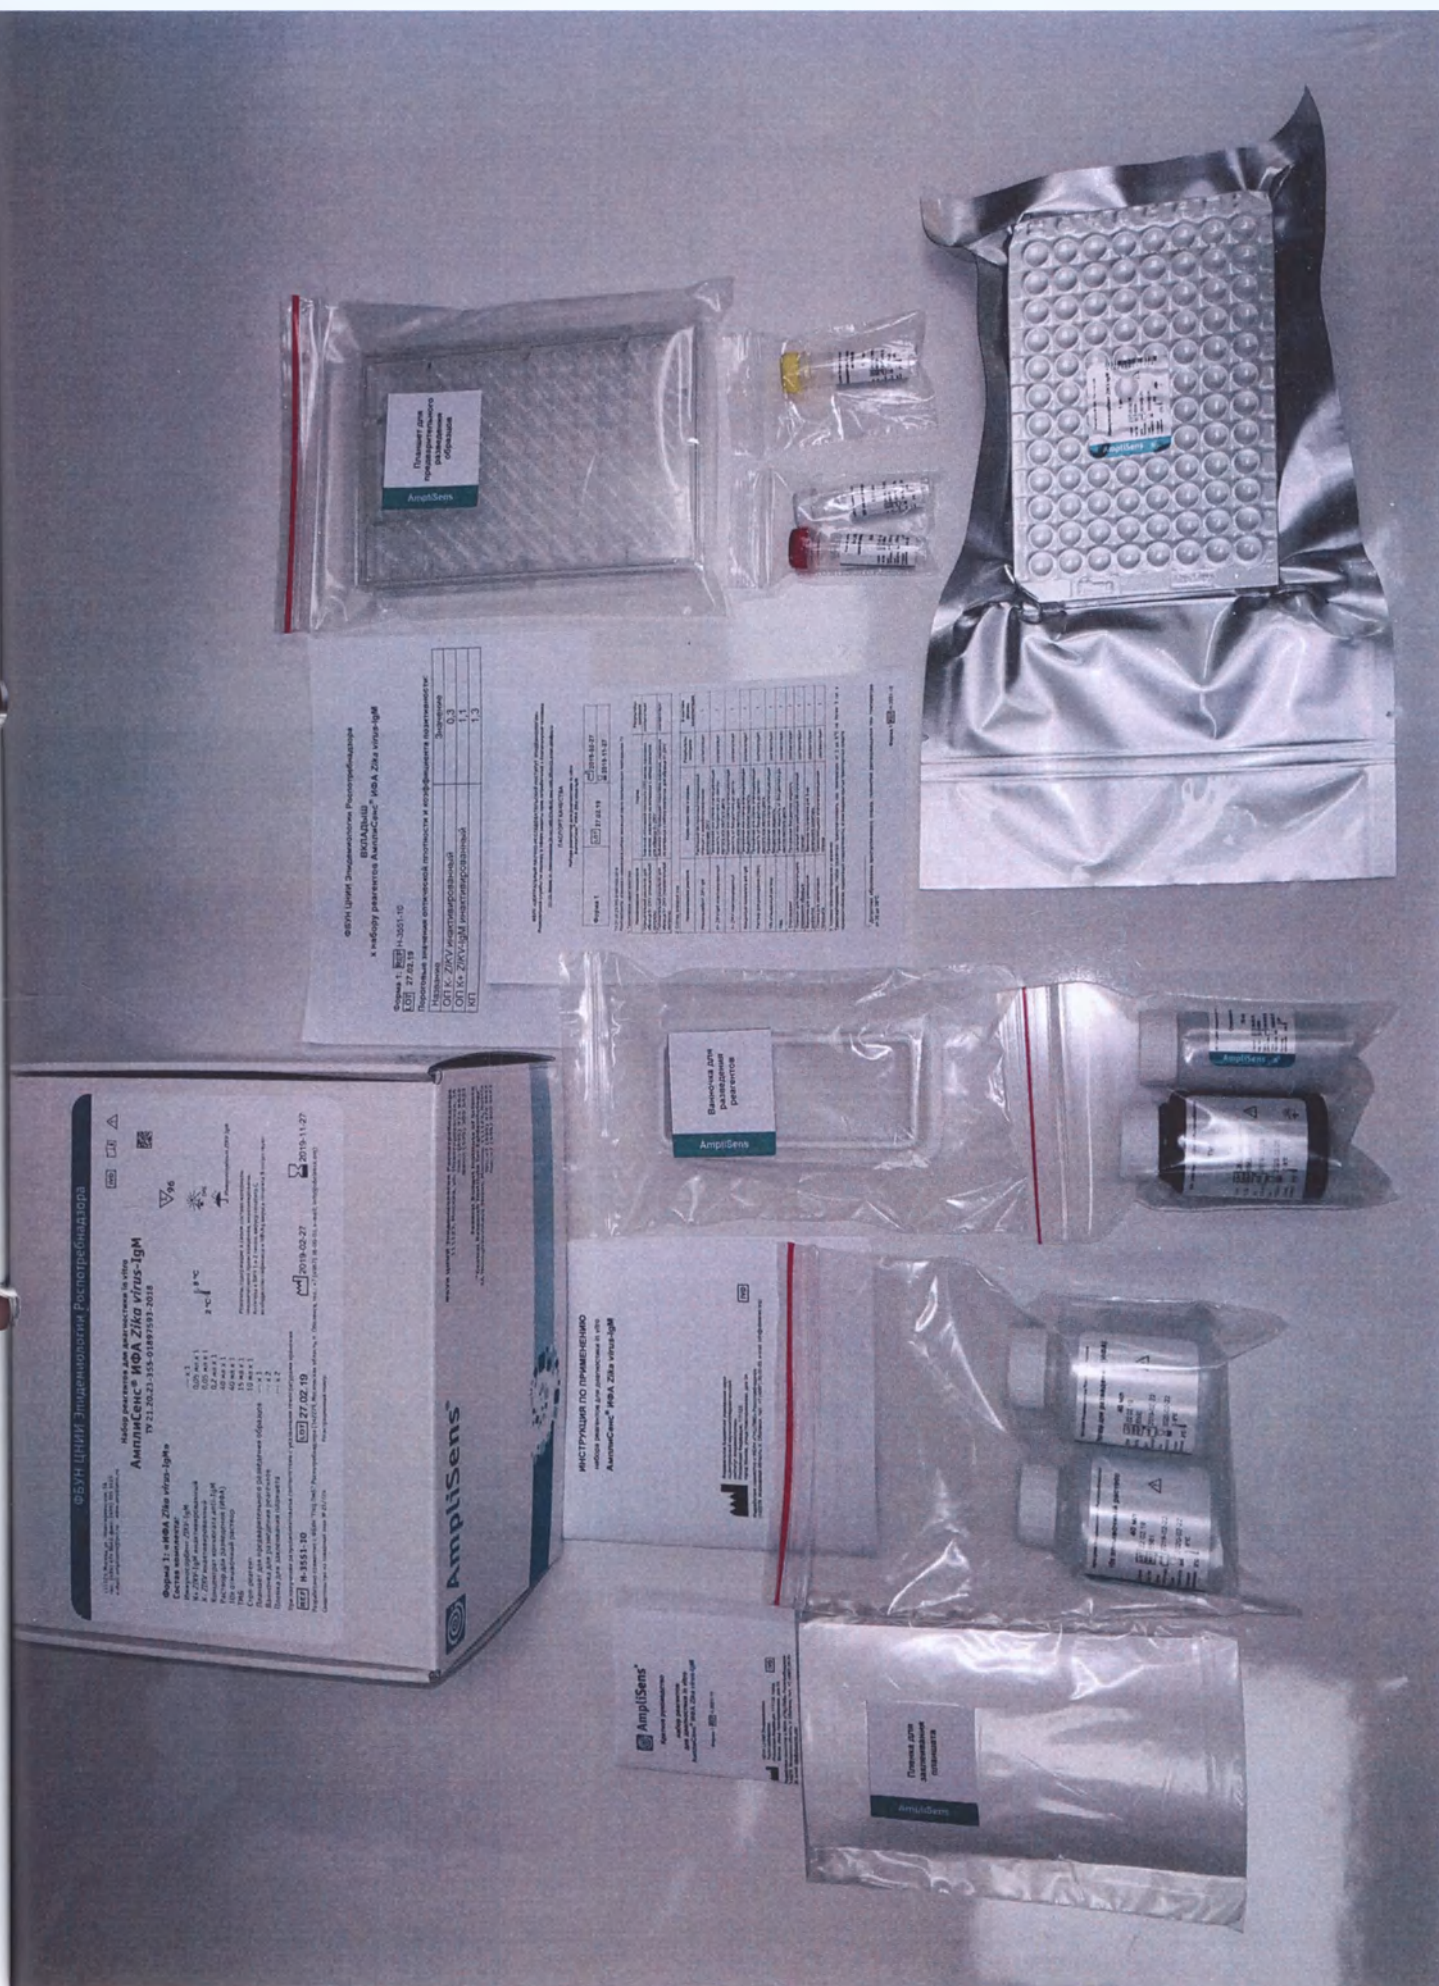

Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ИФА Zika virus-IgM
(форма 1, серия 27.02.19) после вскрытия упаковки.

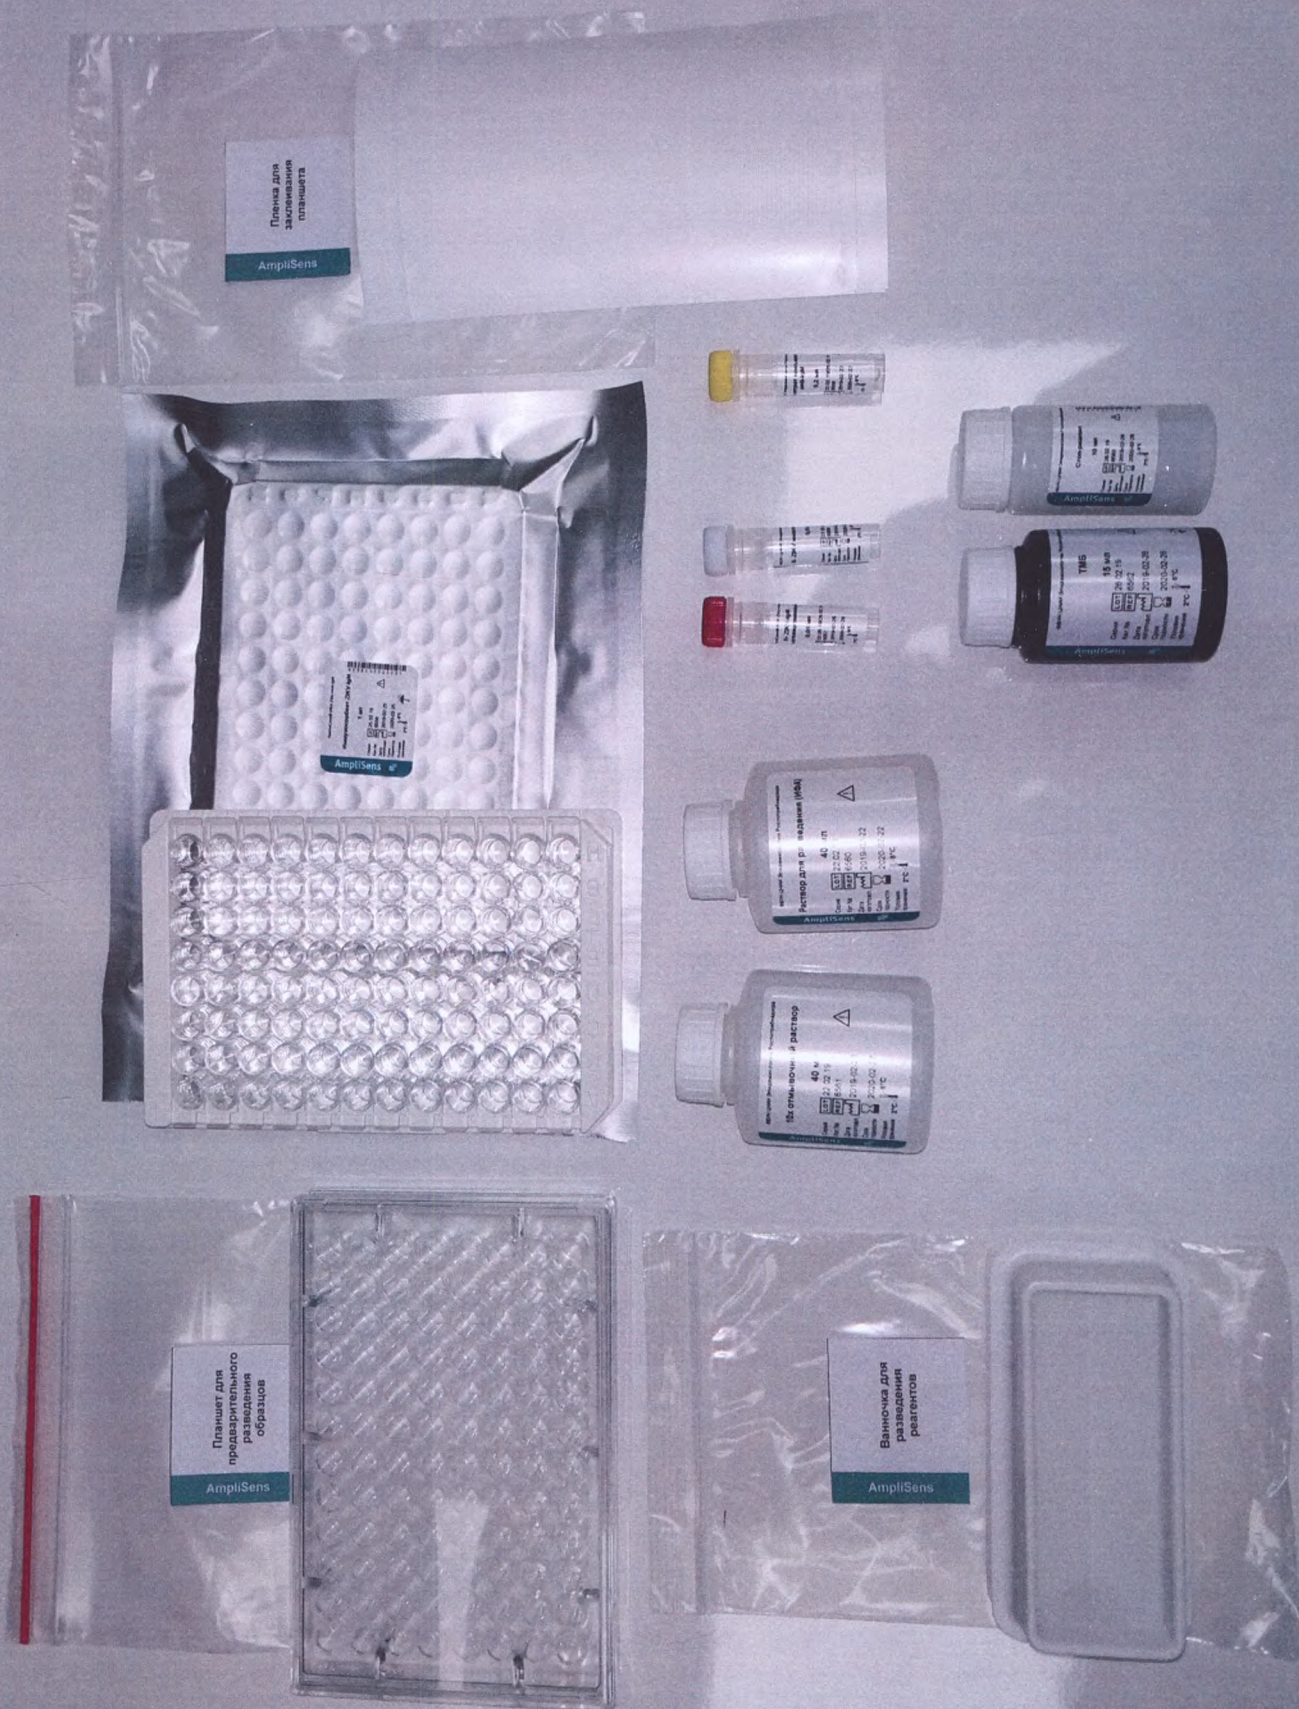

Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ИФА Zika virus-IgM (форма 1, серия 27.02.19), после вскрытия упаковки.

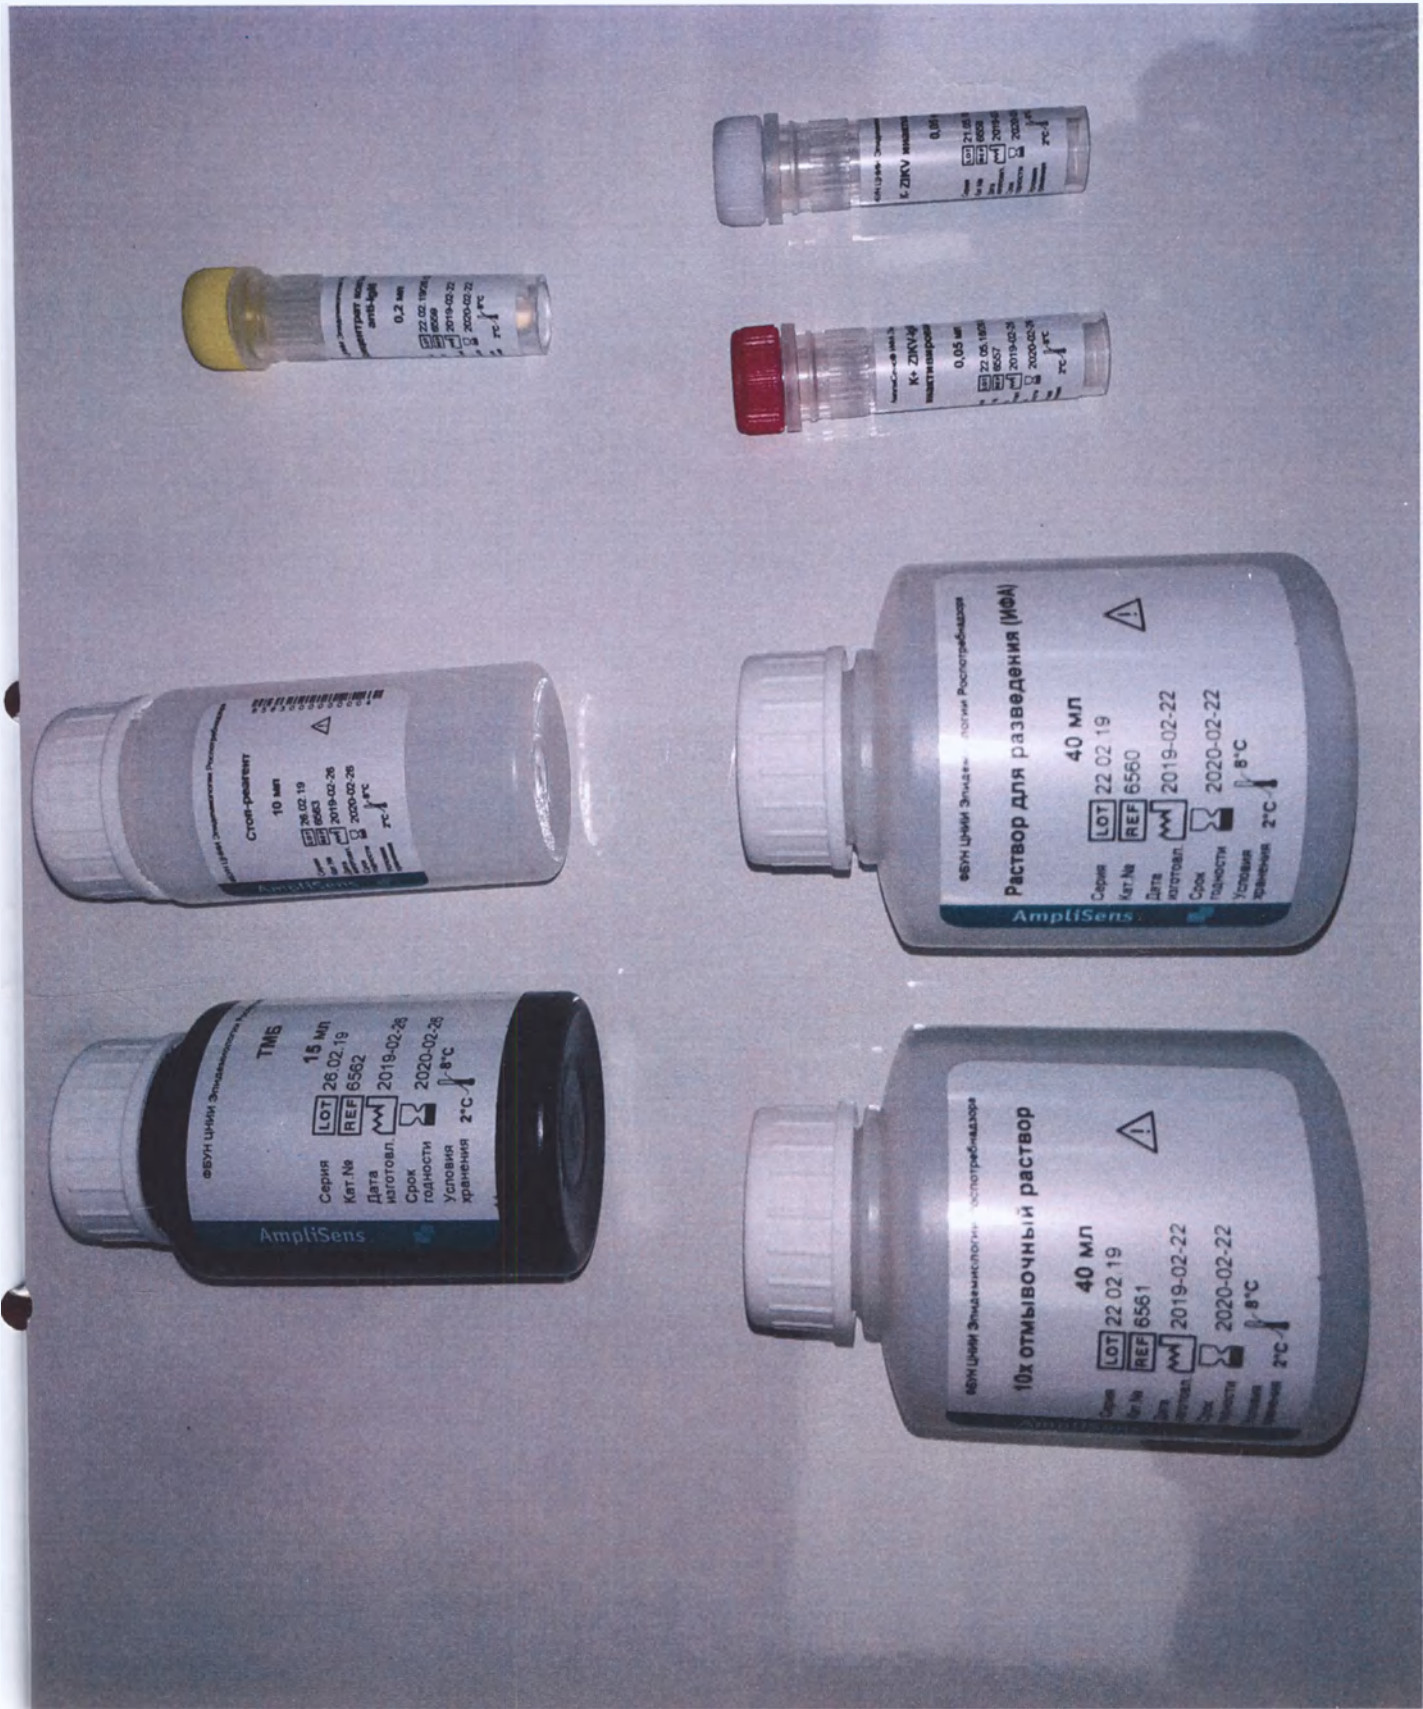

Фотография Иммуносорбента ZIKV-IgM, входящего в состав набора реагентов АмплиСенс® ИФА Zika virus-IgM (форма 1, серия 27.02.19), после вскрытия упаковки.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 6 лист сб
шестю

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

