


2019 г.




ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Анализатор

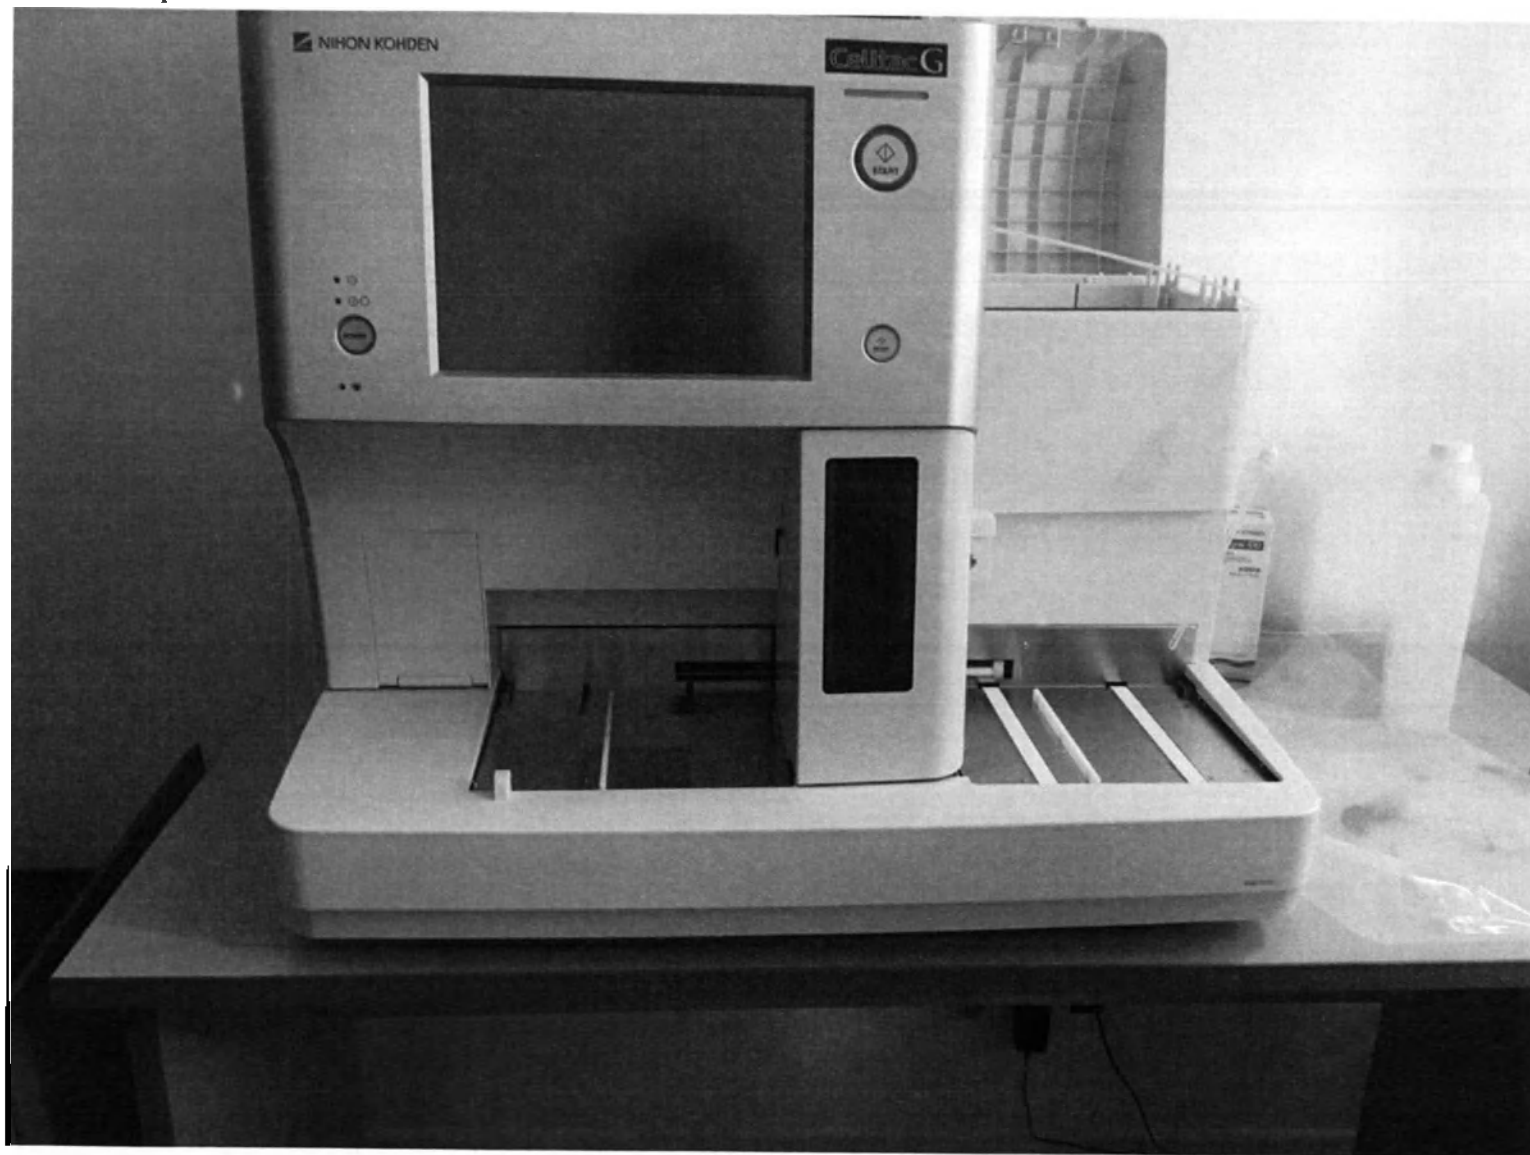

2. Штатив

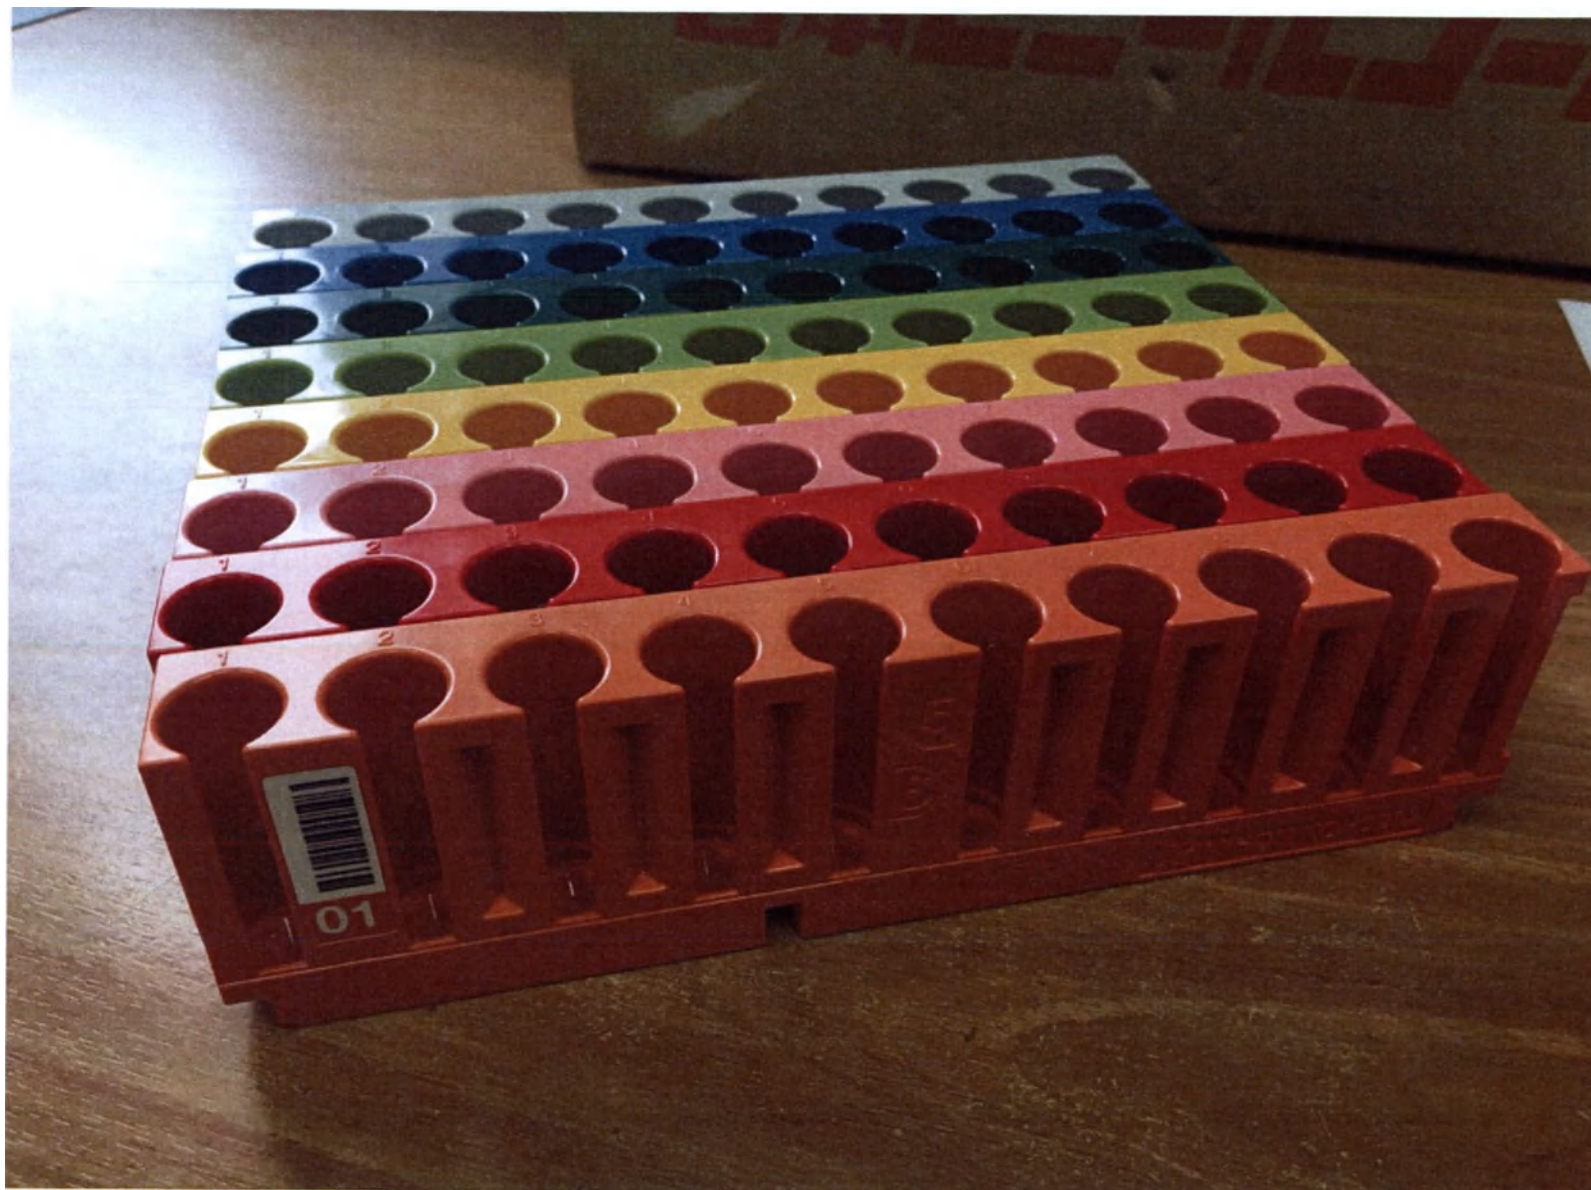

3. Трубка для дилуента ISOTONAC в сборе



4. Трубка для детергента CLEANAC в сборе



5. Набор трубок для реагента HEMOLYNAC



6. Трубка для отходов в сборе



7. Перегородка



8. Поддон



9. Адаптер для пробирки с пробой



10. Адаптер для пробирки MiniCollect



11. Адаптер для микропробирки



12. Адаптер для детергента



13. Кисточка для очистки



14. Шнур электропитания W (для Японии)



15. Шнур электропитания W (для Европы)



16. Провод заземления D



17. Плавкий инерционный предохранитель 6.3 А



18. Считыватель штрихкодов



19. Контейнер для отходов 10 L



20. Контейнер для отходов 20 L



21. Фиксирующая планка



22. Полимерная микросферная суспензия



23. Трубка дилуента (с синей манжетой) (для дилуента ISOTONAC•3/4)




24. Трубка детергента (с зеленой манжетой) (для детергента CLEANAC•710)



25. Трубка в сборе 3 (для дилюента ISOTONAC•3/4)



26. Трубка в сборе (для детергента CLEANAC•710)

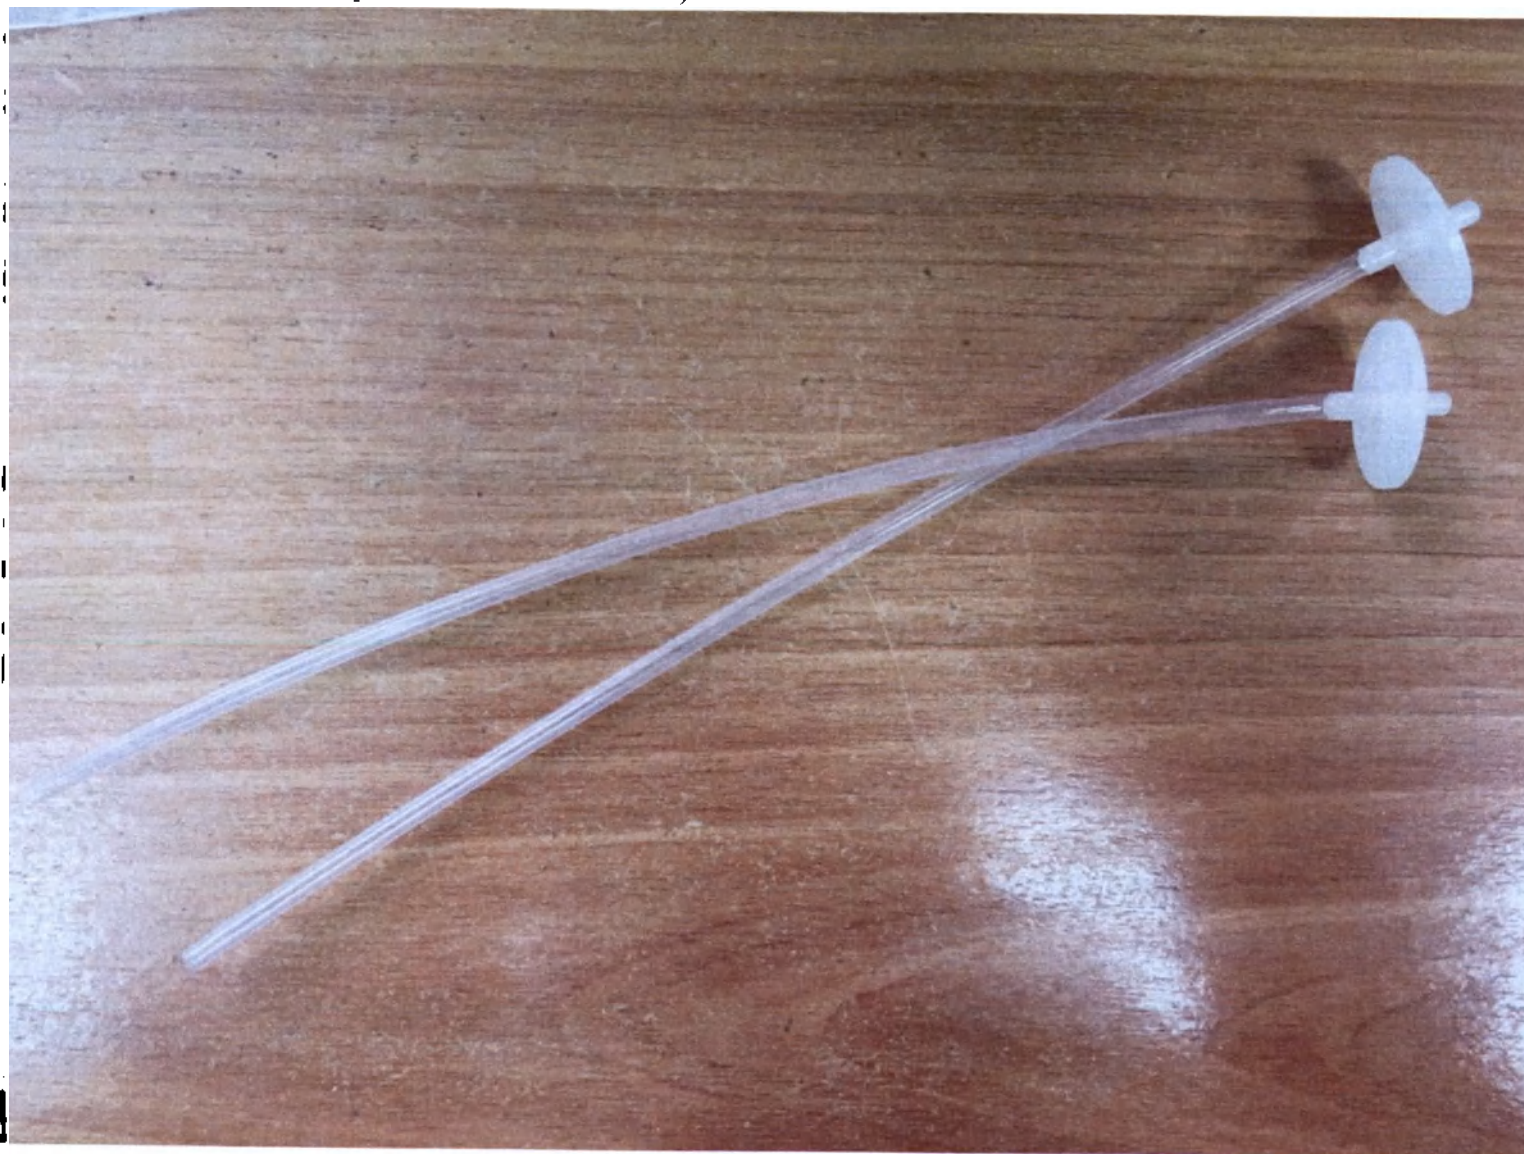

27. Трубка 3 L в сборе (для детергента CLEANAC•710)



28. Дополнительные штативы



29. Крышка контейнера для отходов



30. Крышка (для дилуэнта ISOTONAC•3/4)



31. Крышка МЕК (для детергента CLEANAC•710)



32. Крышка реагента НЕМОЛЫНАС•310 (оранжевая)




33. Крышка реагента HEMOLYNAC•510 (сиреневая)




34. Комплект для очистки 2




35. Фильтр лейкоцитов в сборе

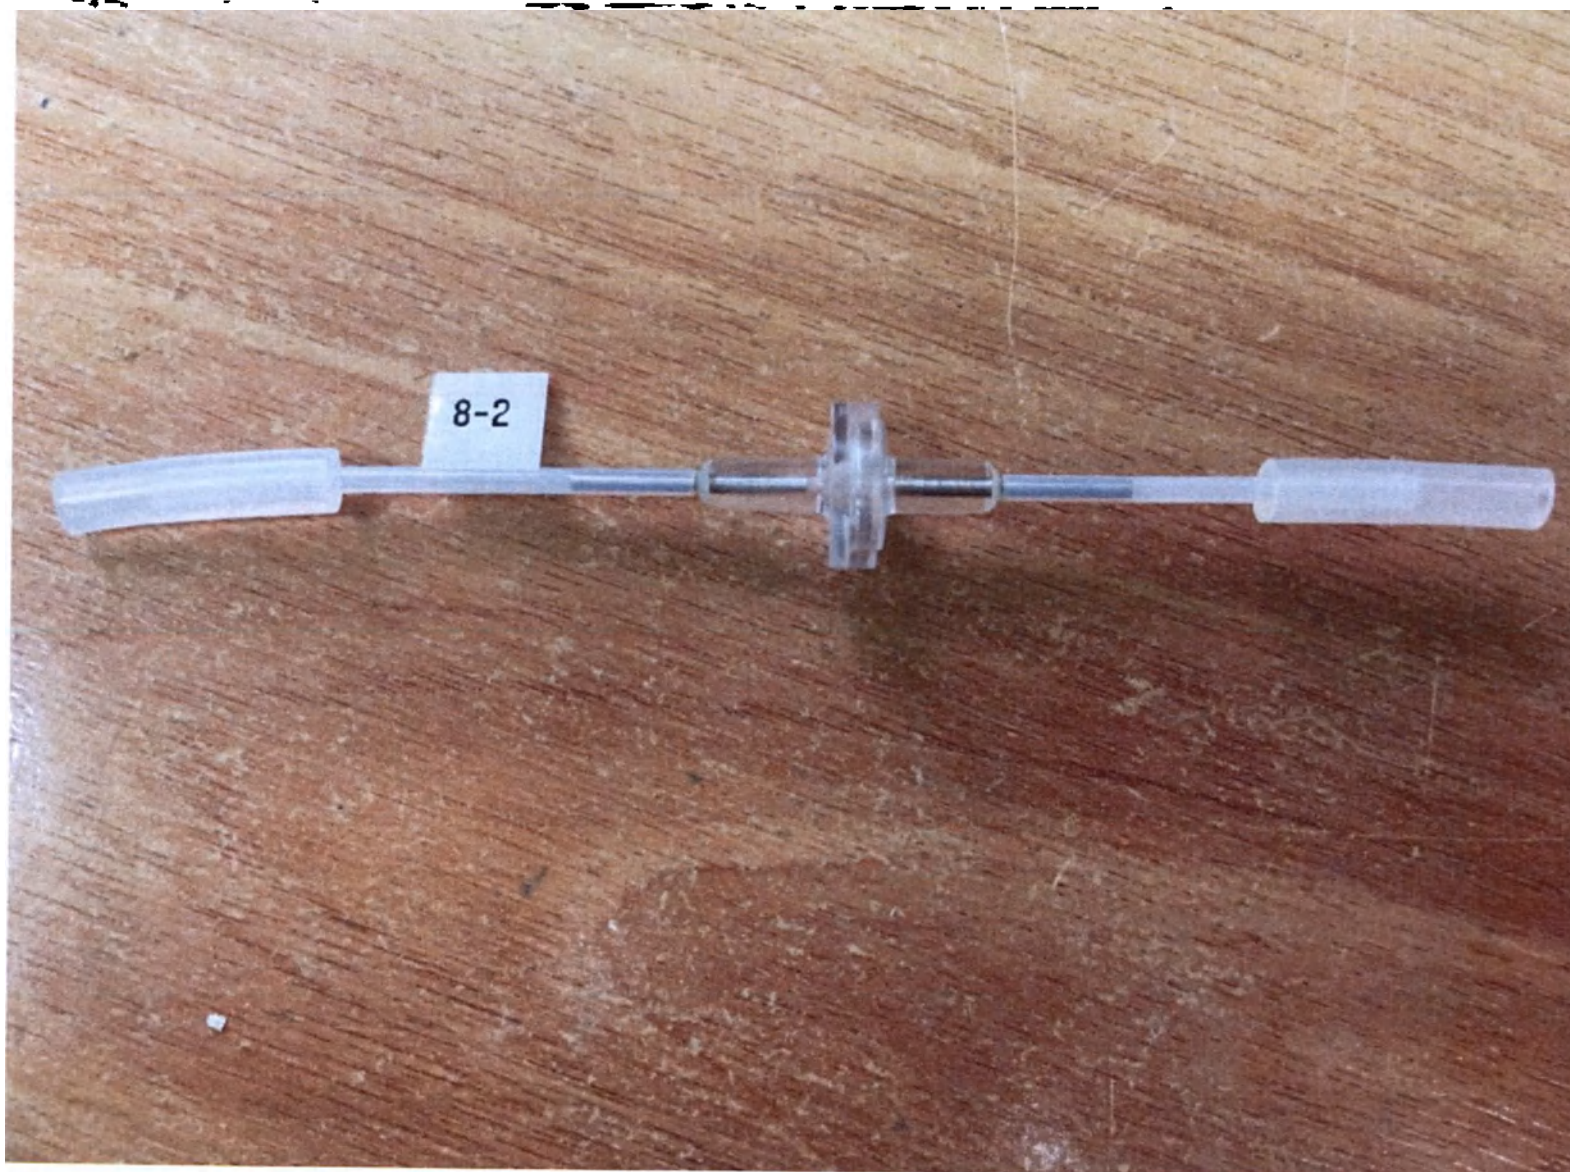


36. Наконечник для отбора проб в сборе

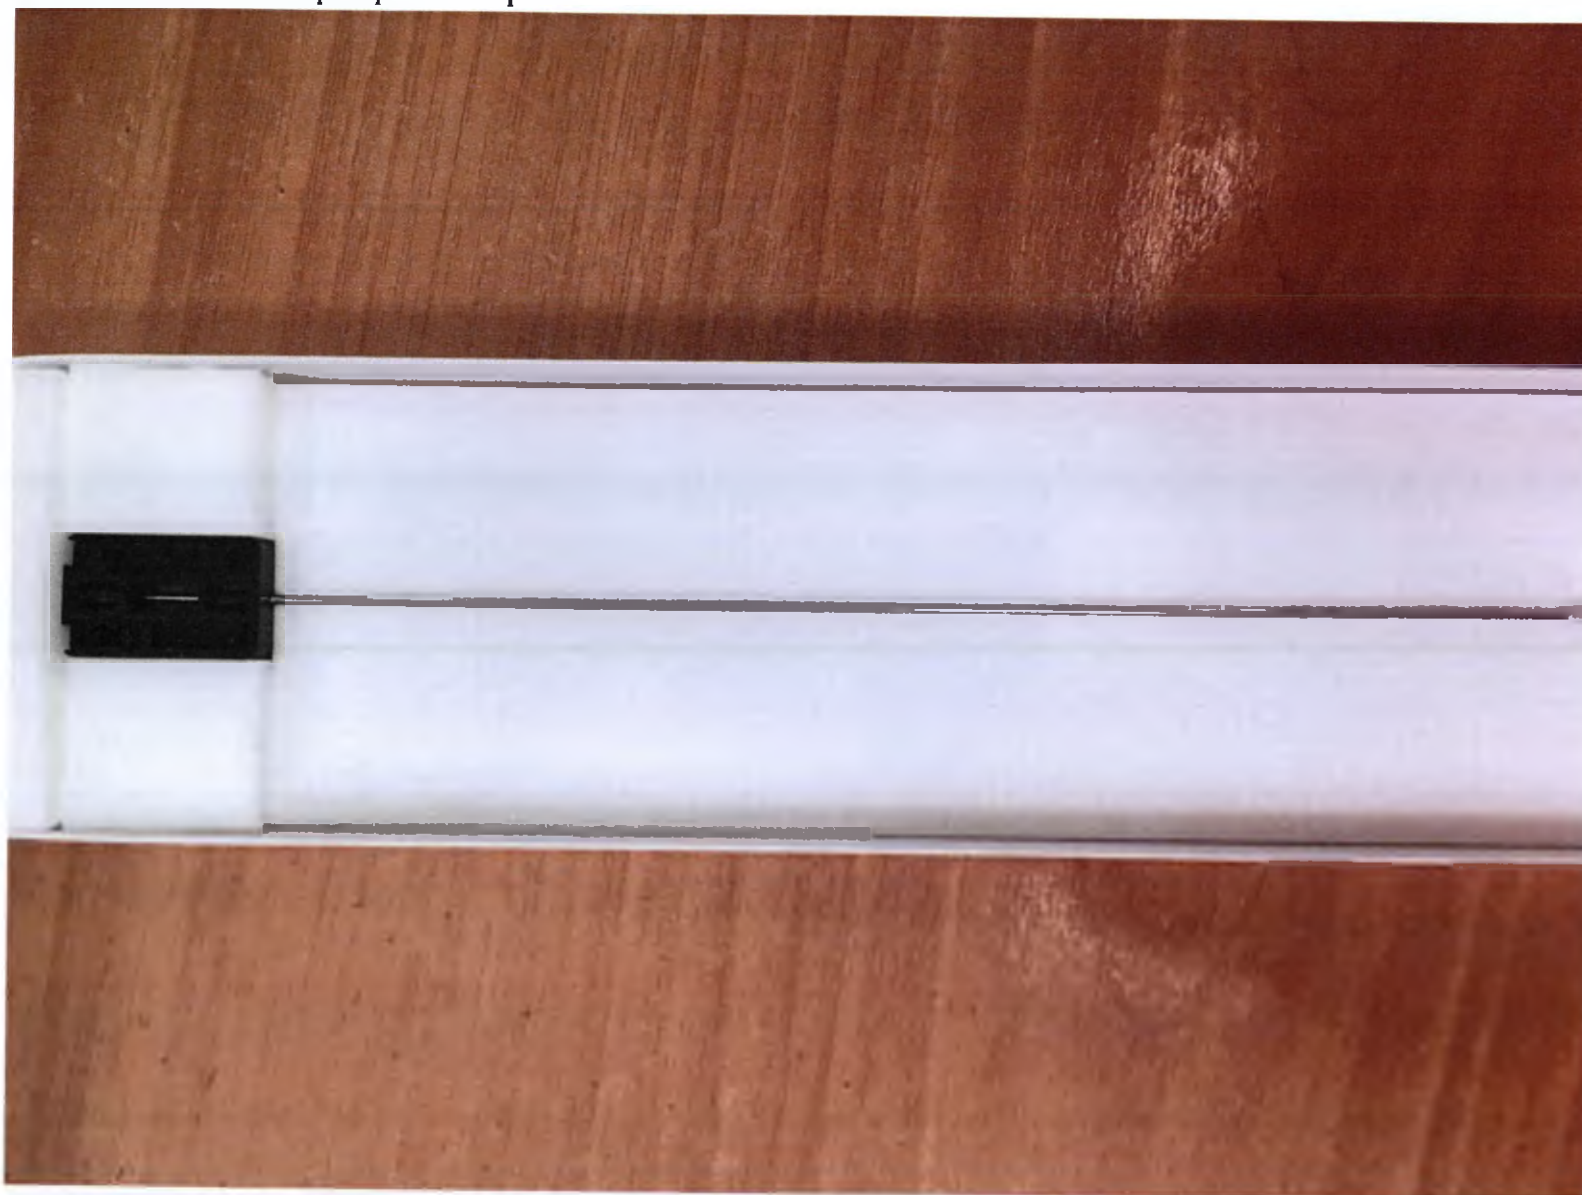

37. Игла прокалывателя

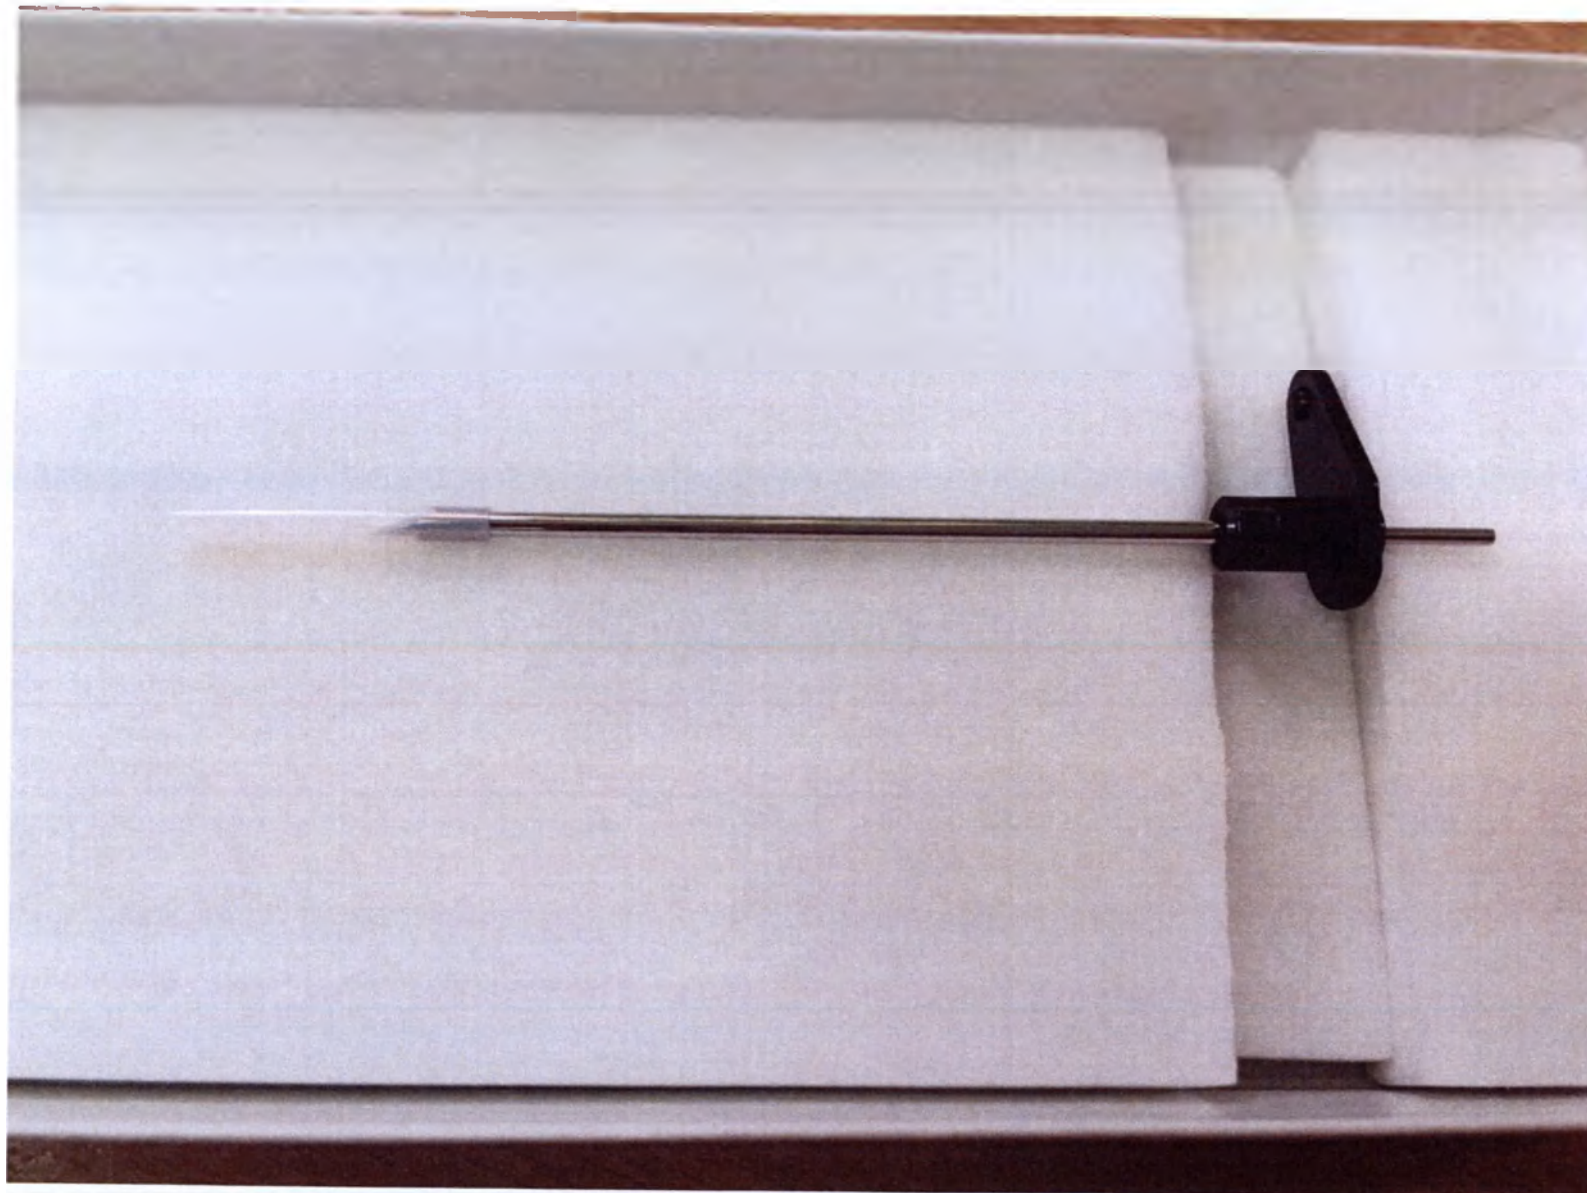


38. Кабель LAN, 2 м

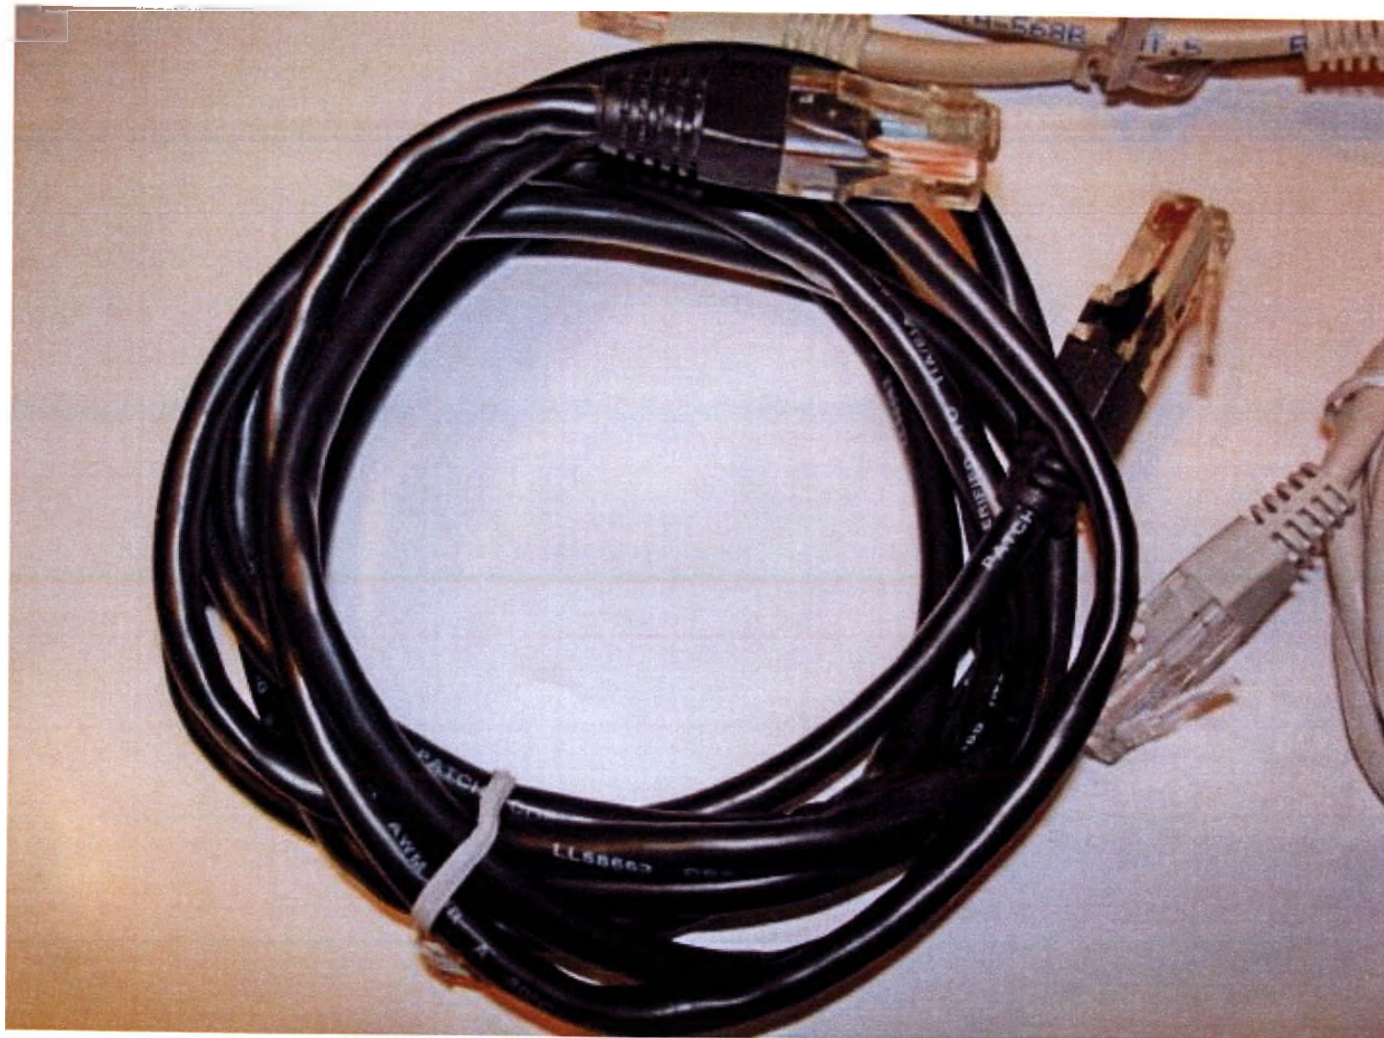

39. USB-кабель, 2 м



40. Комплект SARSTEDT, в составе:

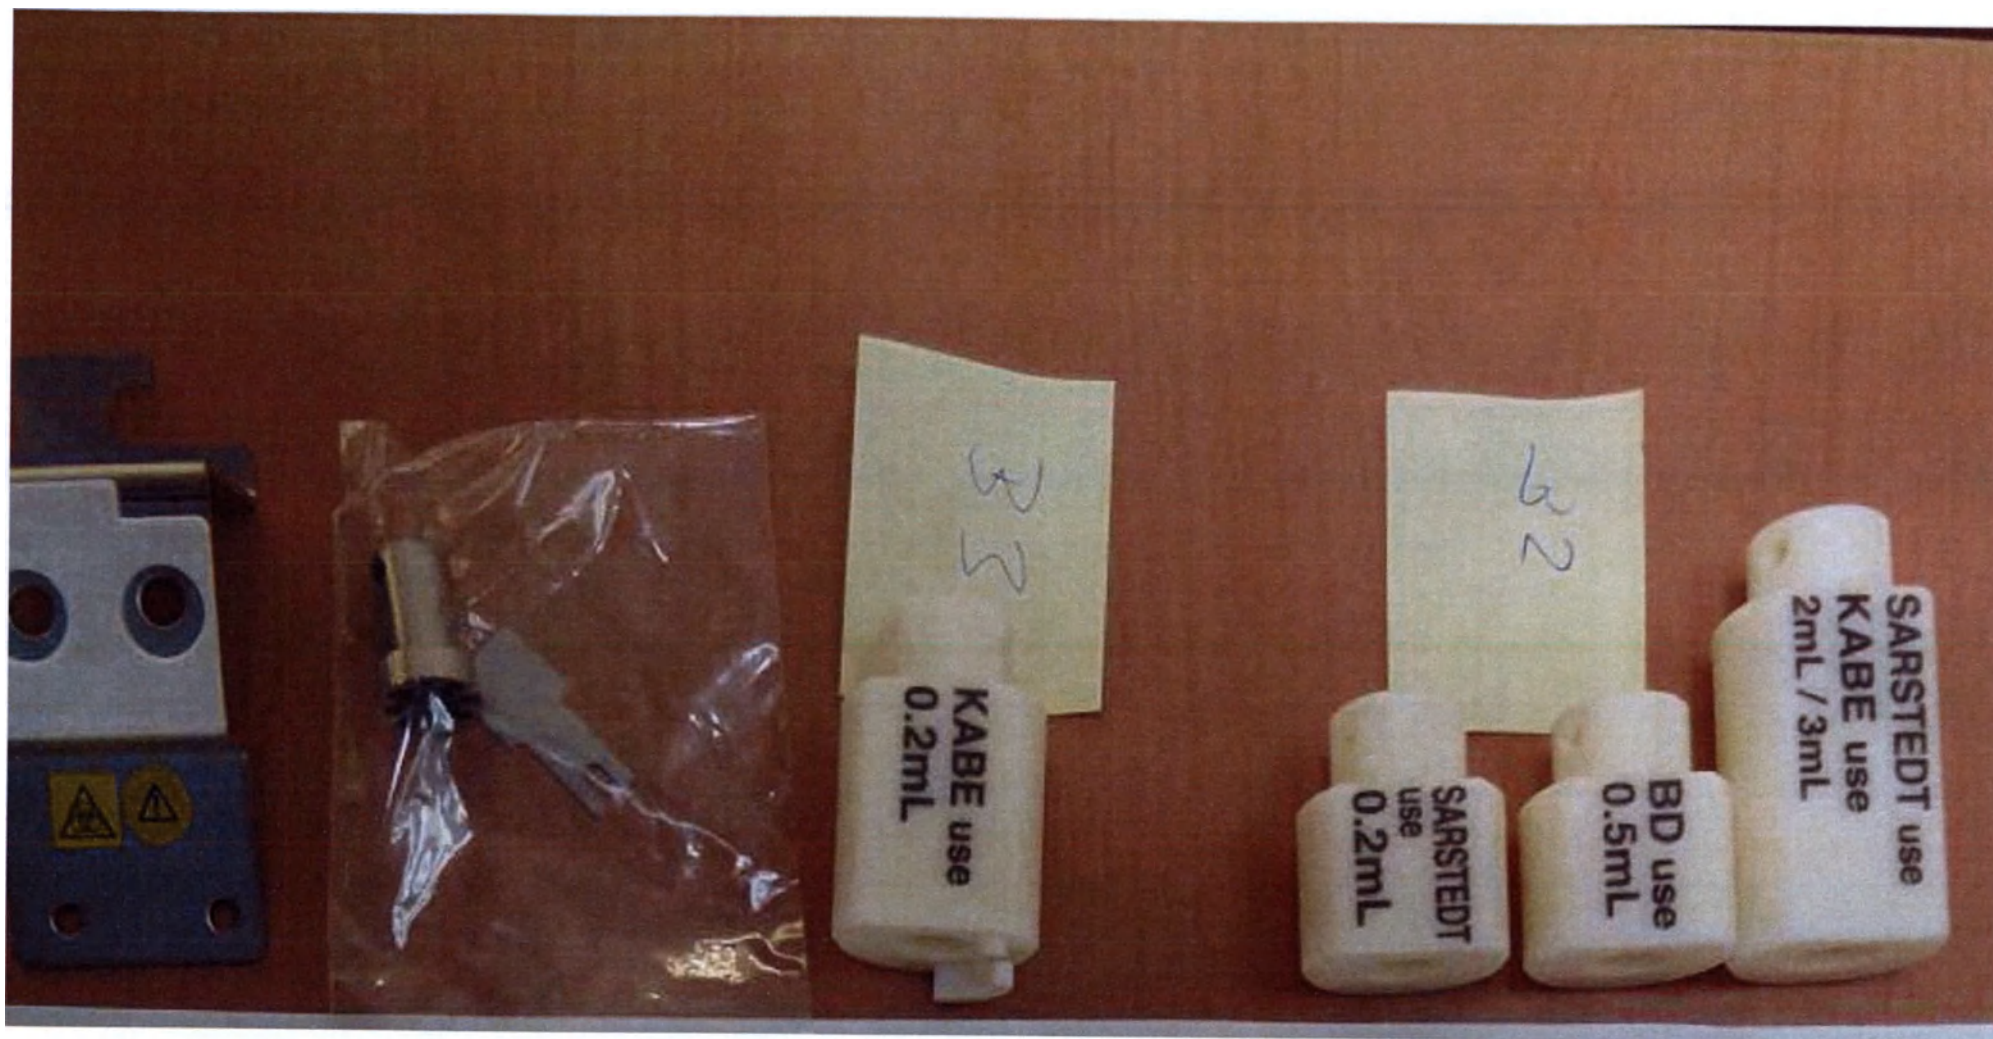

41. Комплект KABEVETTE G

KABE

Use the below special kit.

YZ-008B2 (KABEVETTE G KIT)

TUBE HOLDER(SARSTEDT)

KABE
Kabevette G 102325

TUBE HOLDER(SAR200)

SARSTEDT
Microvette 20.1288

TUBE HOLDER(KABE200)

KABE GK150 077001

TUBE HOLDER(BD500)

BD Microtainer 365974
Microtainer 365975

NIHON KOHDEN

SARSTEDT use
KABE use
2mL / 3mL

SARSTEDT use
0.2mL

KABE use
0.3mL

BD use
0.5mL

Маркировка анализатора:



Маркировка сканера штрихкода:



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 44
(серия 4479 № 4479)
листов. Генеральный директор



Н.А.Ворошилов